



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Уромед М»

 Ефремова Л.А.

«31»  2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система криоабляции ProSense

Производитель: IceCure Medical Ltd. (Айскьюр Медикал Лтд.), Израиль

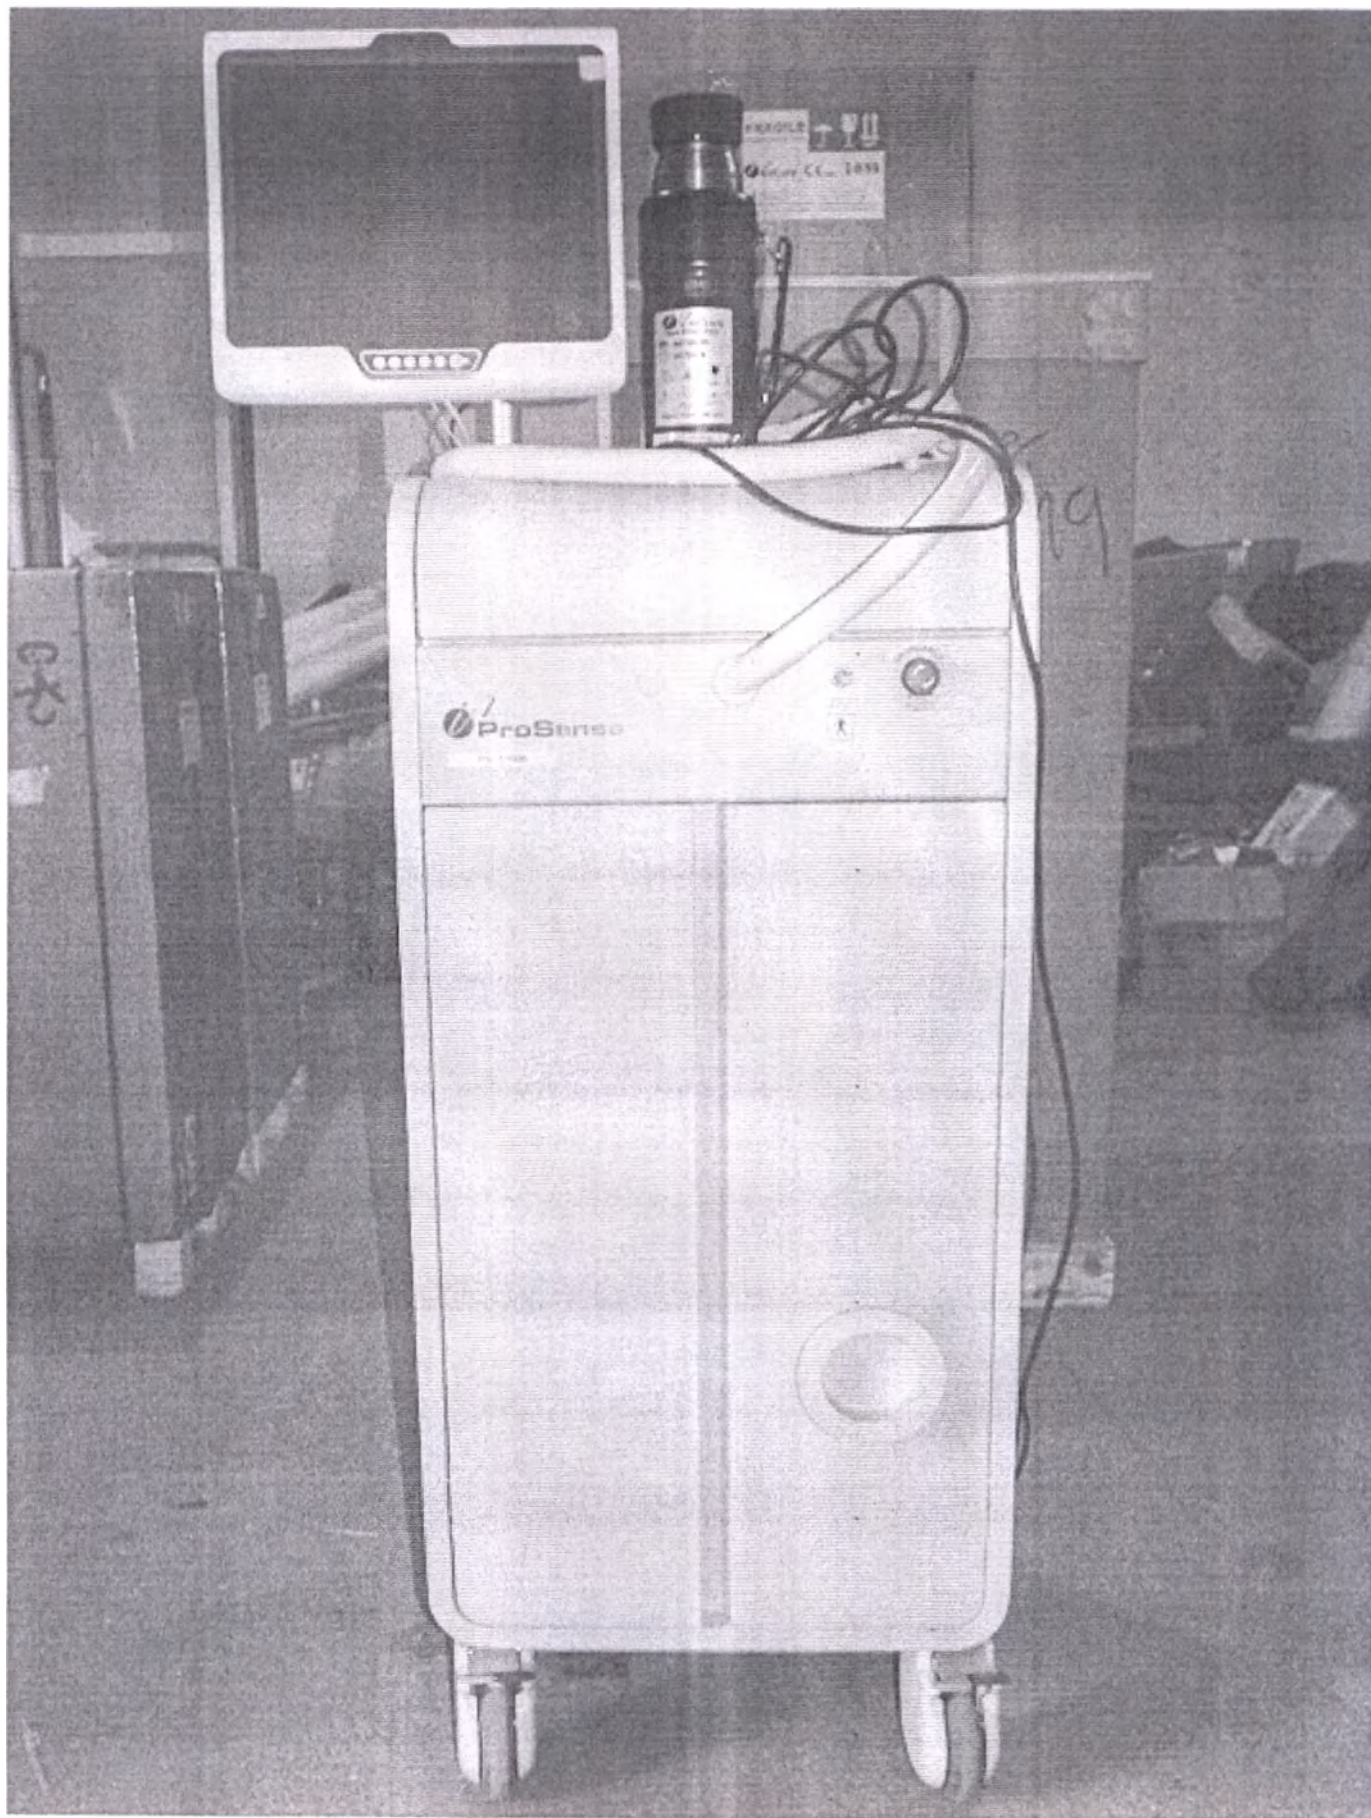


Рис. 1. Криотерапевтическая консоль

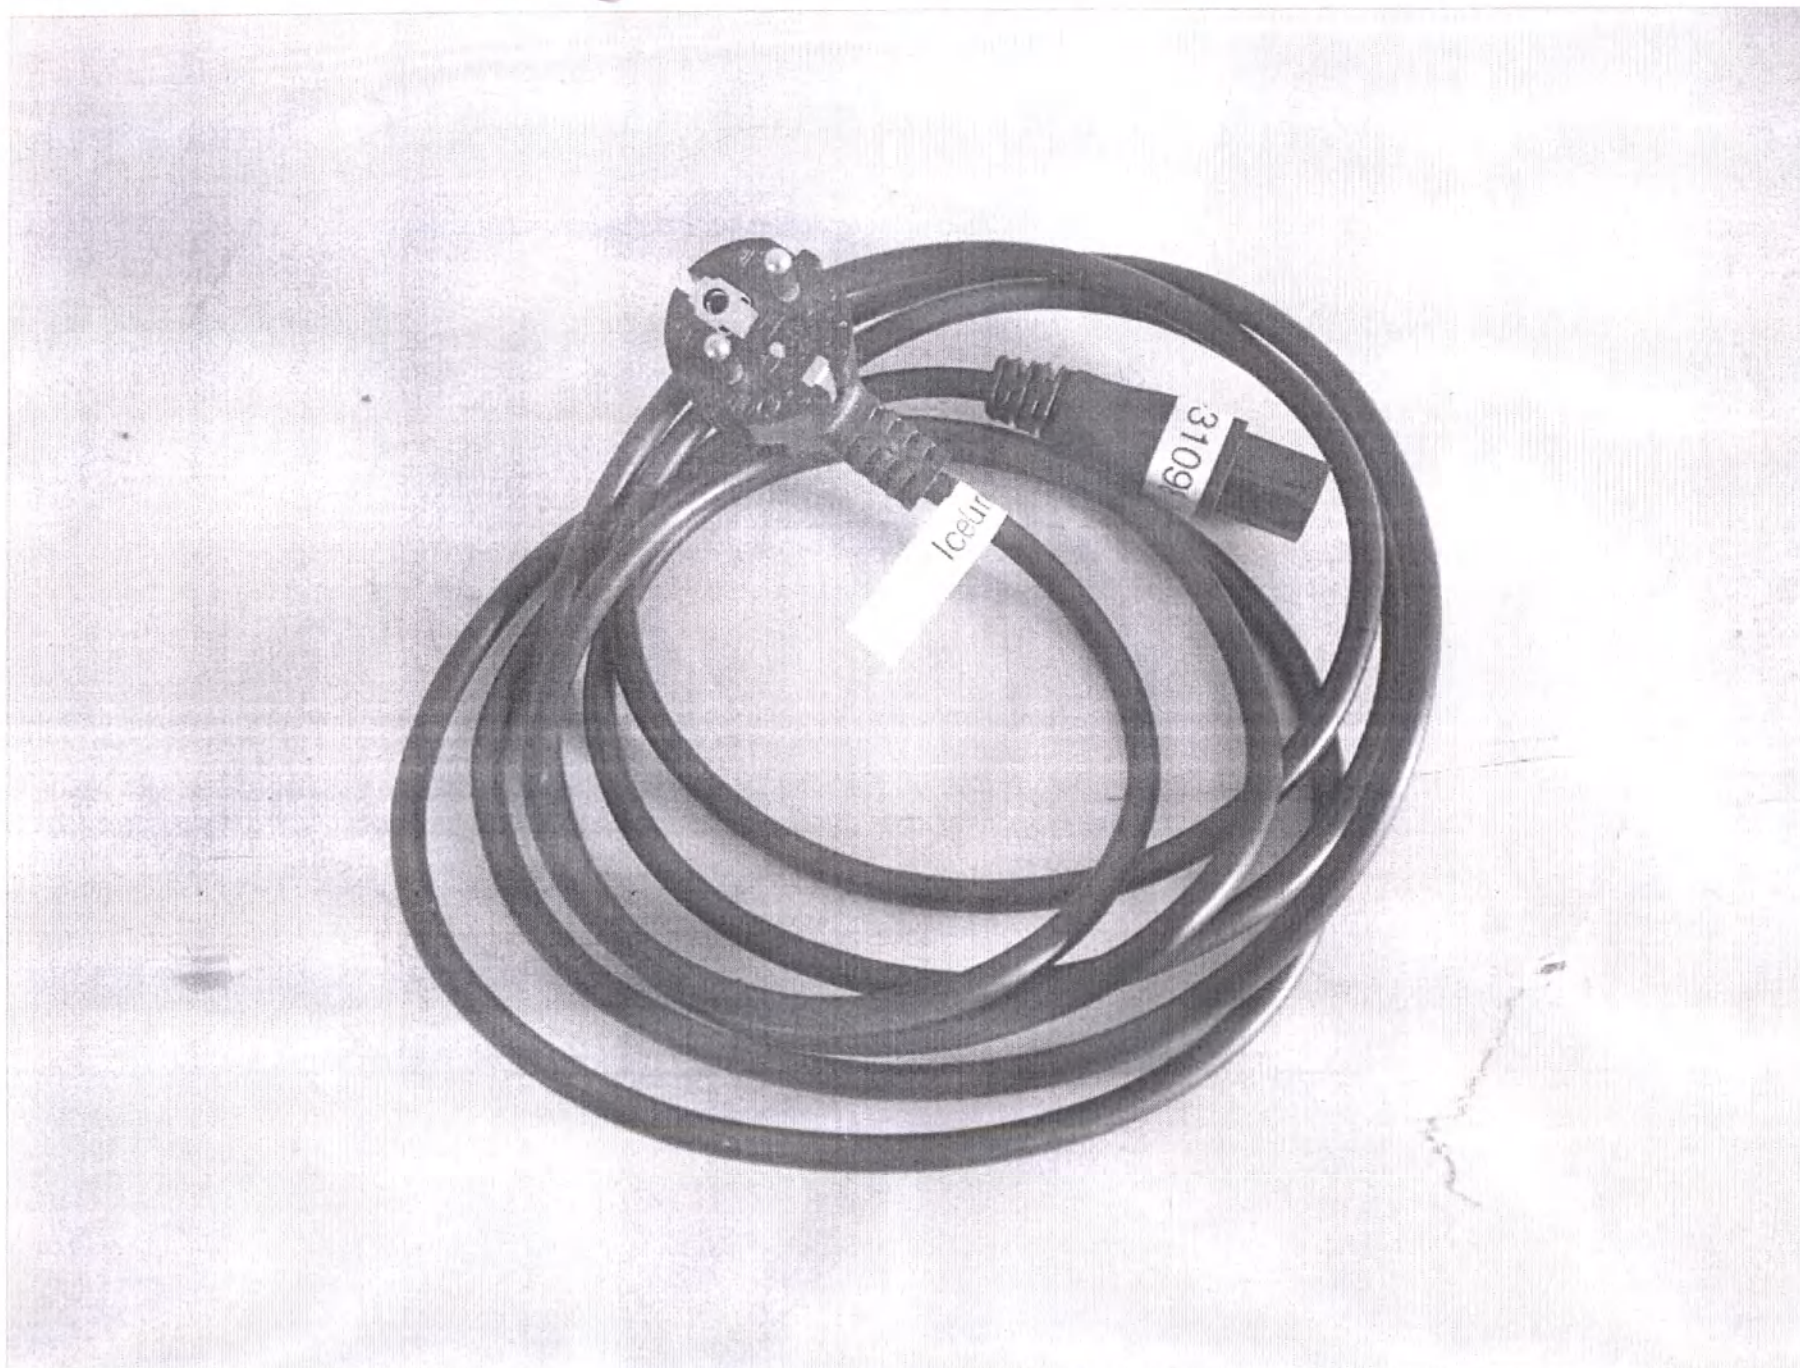


Рис. 2. Шнур питания

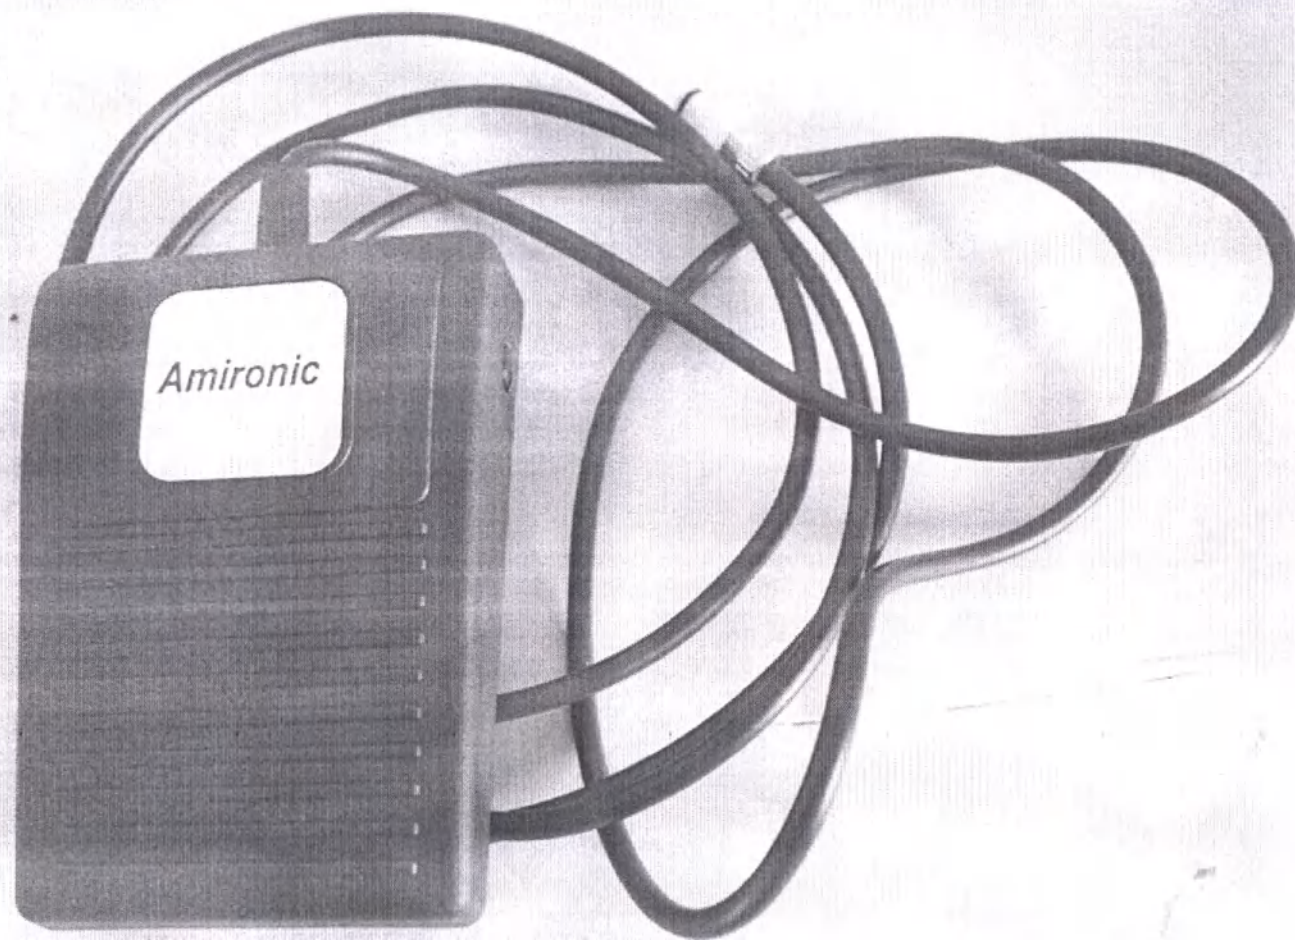


Рис. 3. Ножная педаль

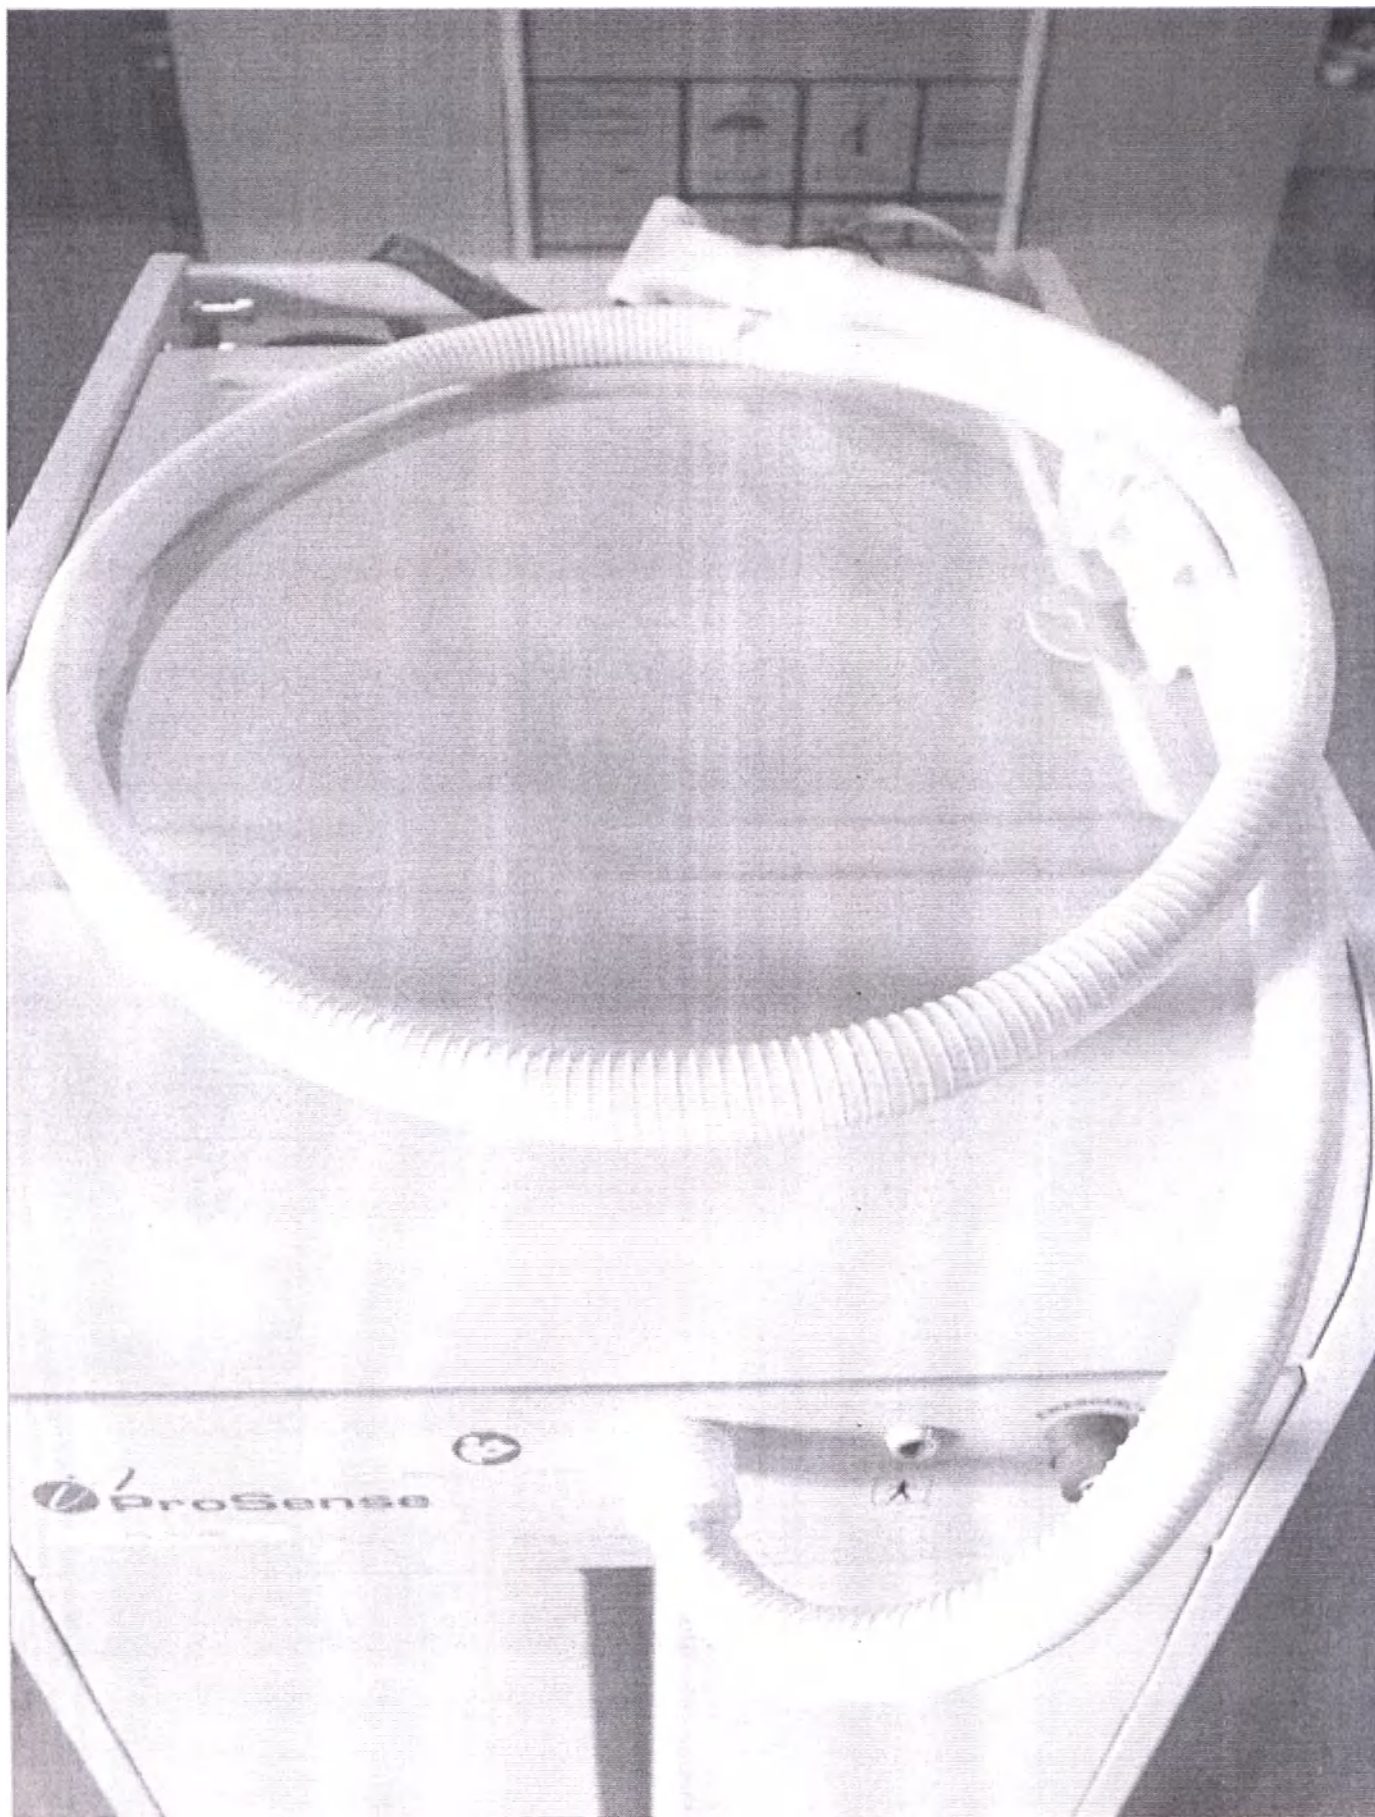


Рис. 4. Шланг жидкого азота

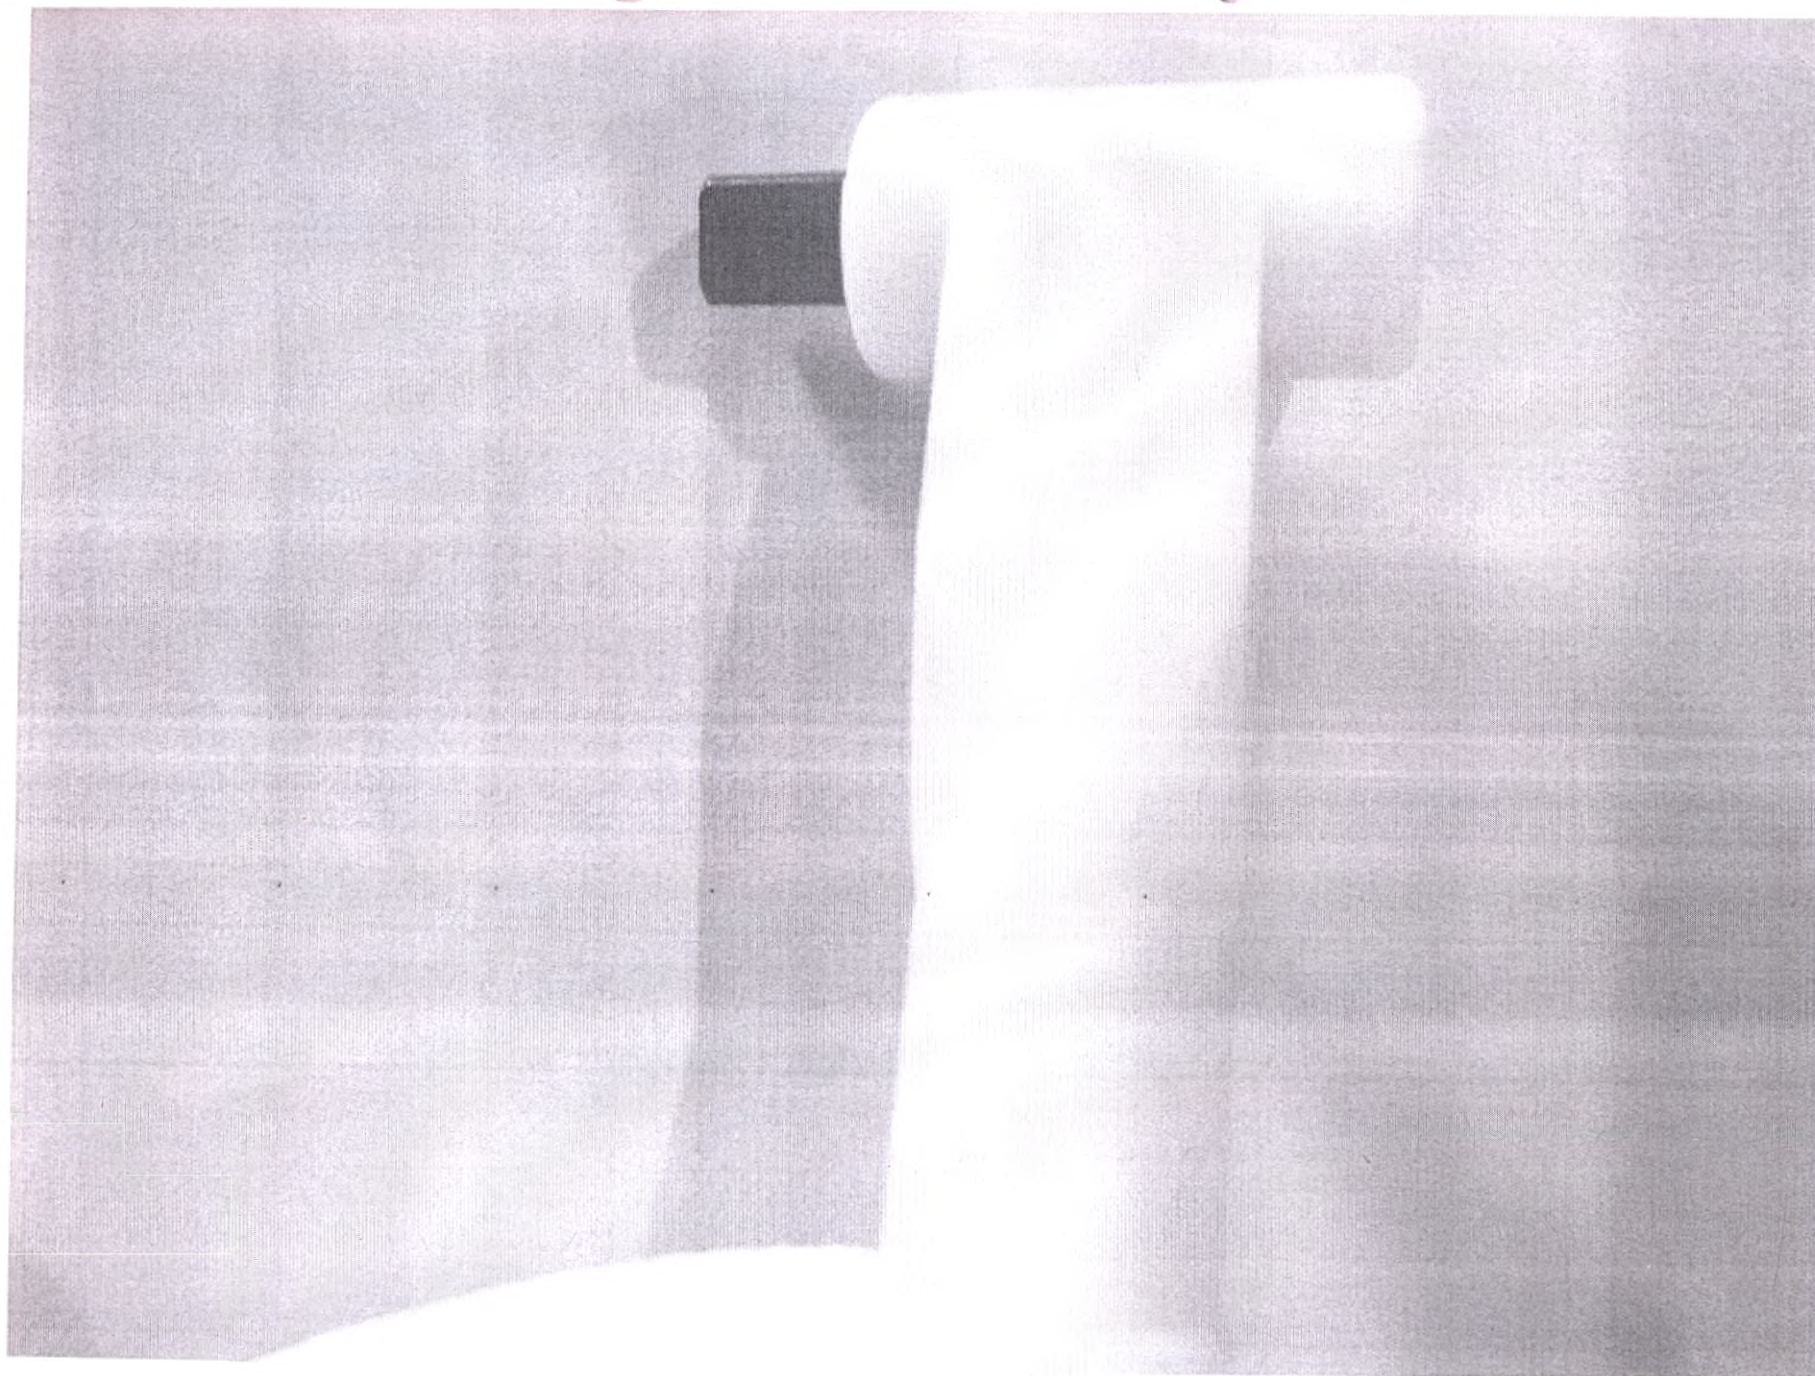


Рис. 5. Рукоятка изогнутая для криозондов



Рис. 6. Сосуд Дьюара для жидкого азота (объемом 2 л.) - 2 шт.

AX



«УТВЕРЖДАЮ» / "APPROVE"


IceCure Medical Ltd Israel

The Director General

(должность/position)

Eyal Shamir

(имя/name)

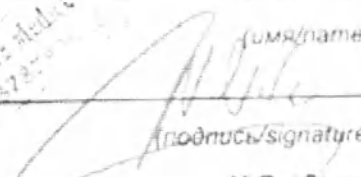
(подпись/signature)

М.П. / Stamp

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «Система криоабляции ProSense»

Номер руководства по эксплуатации:

DSR3200000 ред. RU-1

Дата вступления в силу:

30 июля 2019

Пожалуйста, внимательно прочитайте этот документ перед использованием системы криоабляции ProSense. Не пытайтесь выполнить какую-либо процедуру пока вы внимательно не прочитаете всю инструкцию. Всегда следуйте указаниям на маркировке продукта и рекомендациям производителя. Если у вас есть сомнения относительно того как действовать в той или иной ситуации, обратитесь к вашему представителю IceCure Medical Ltd.

Производитель:

IceCure Medical Ltd.

7 Haeshel St, Caesarea, 3088900 –

Israel (Израиль)

info@icecure-medical.com

Тел. +972-4-623 0333

Факс +972-4-623 0222

Представительство в РФ:

ООО «Уромед М»

117342 г Москва улица Введенского дом

1 строение 1, комнаты 2-14, 25

info@uromed-m.ru

Тел. +7 (495) 783-68-11

Факс +7 (495) 678-69-95

Информация в этом документе является конфиденциальной и предназначена только для использования получателем. Несанкционированное использование, копирование, публикация или раскрытие информации строго запрещено. Если вы получили этот документ по ошибке, пожалуйста, сообщите об этом IceCure Medical Ltd незамедлительно.

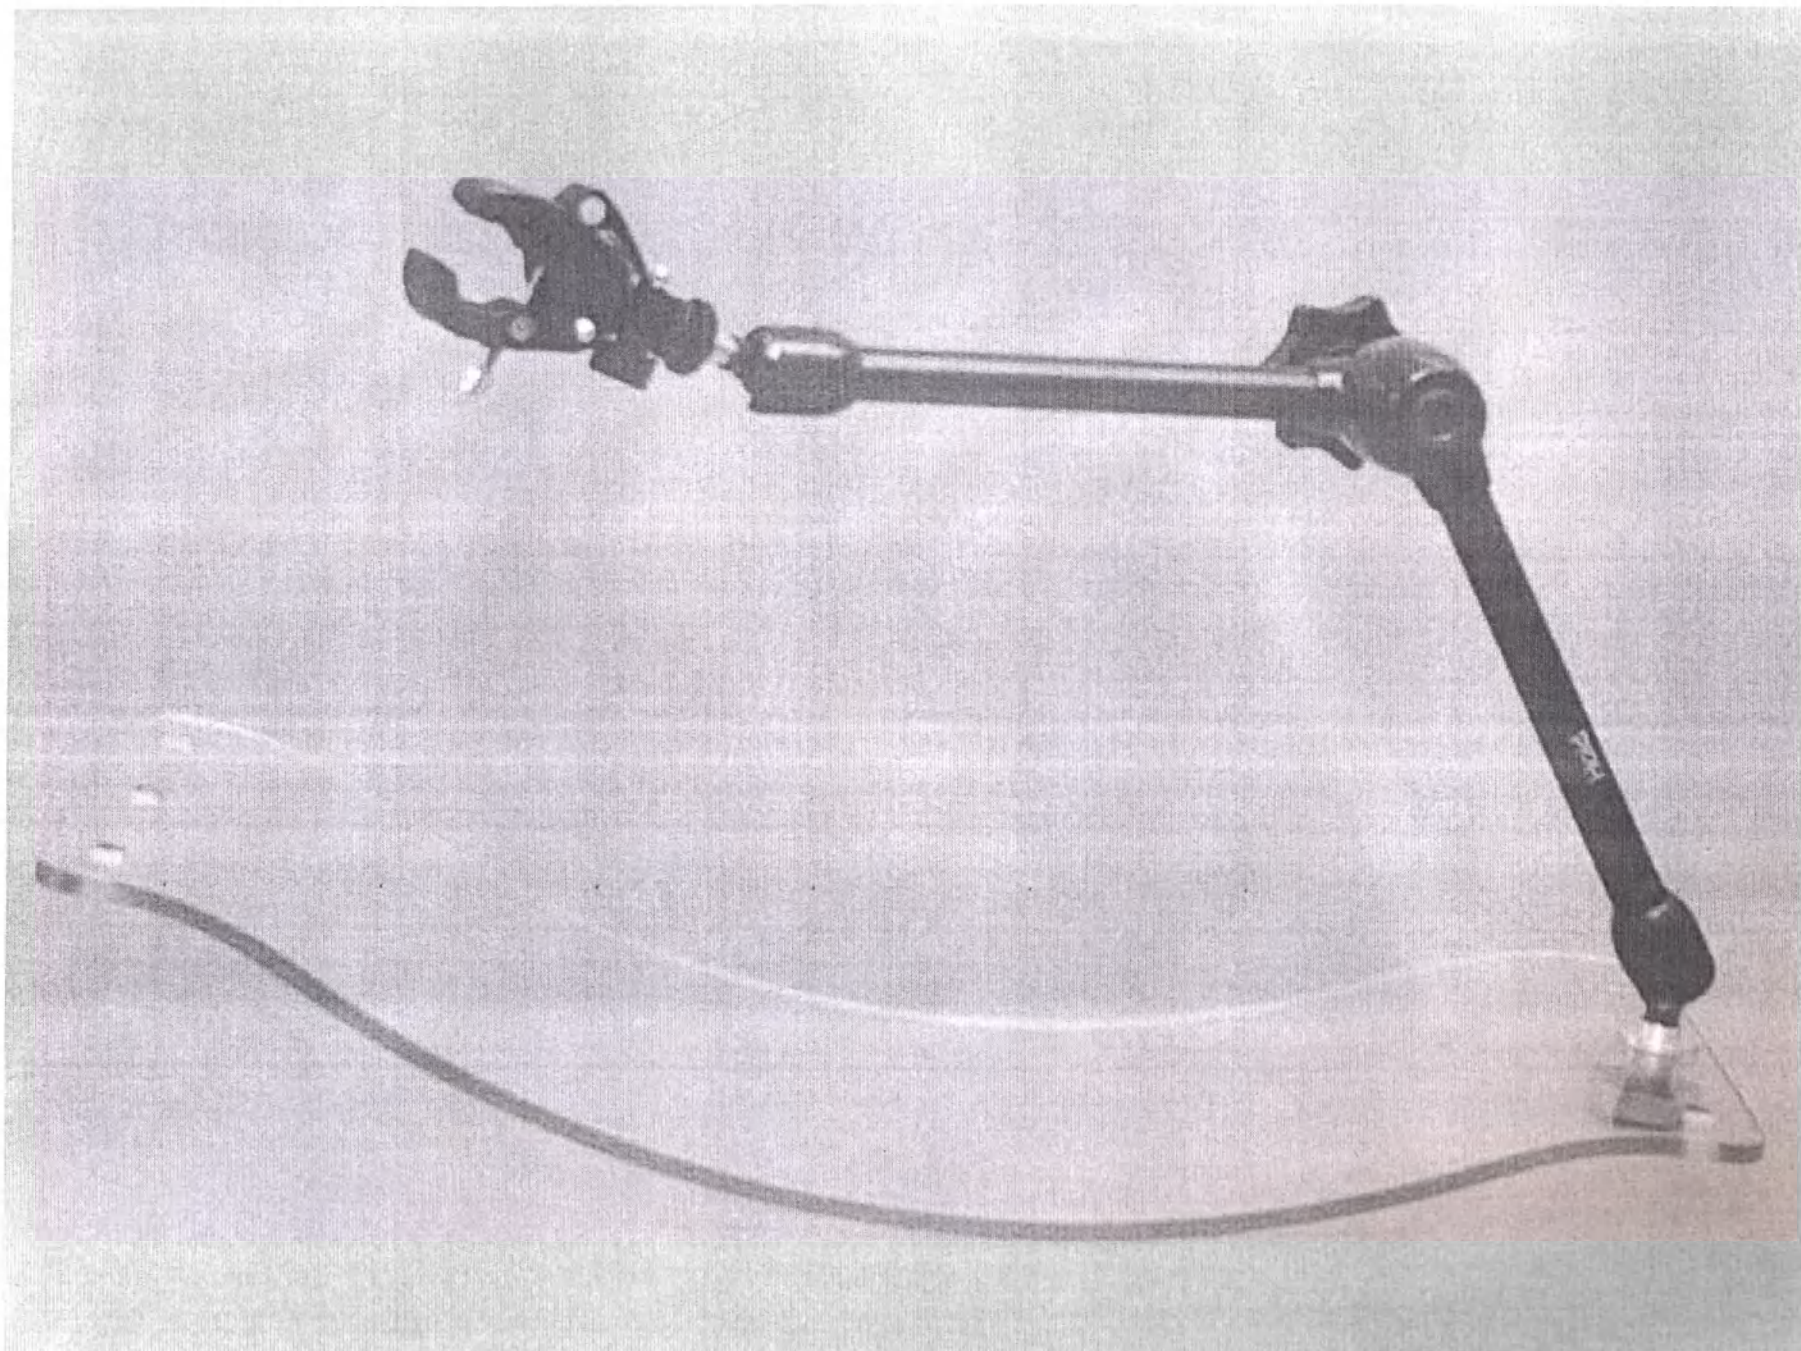


Рис. 8. Держатель рукоятки

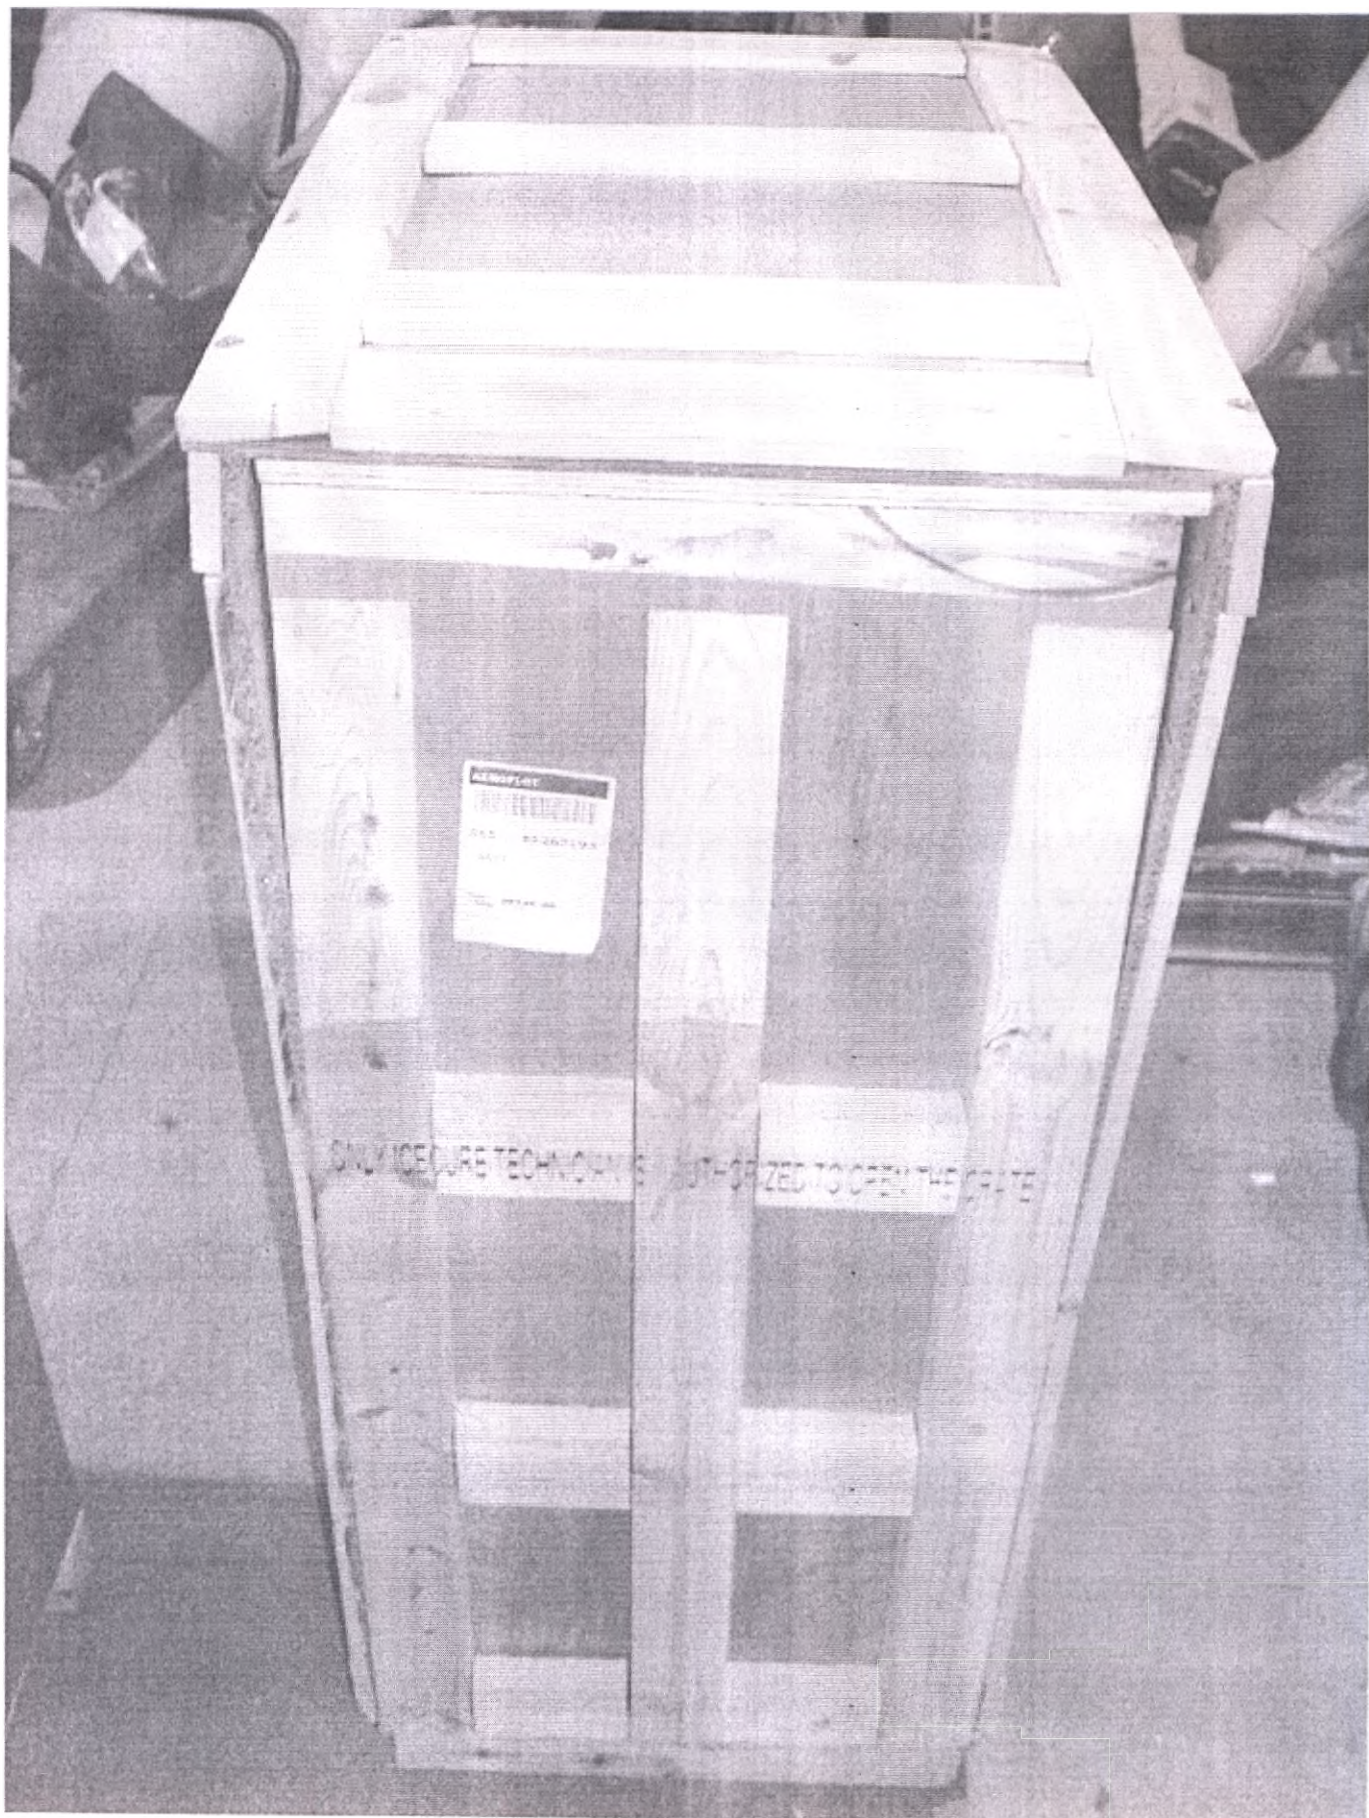


Рис. 9. Общая транспортная тара для отправки

ФОТО МАРКИРОВКИ



SN PS- XXXXX

DD- MMM- YYYY RoHS

REF FAS3XXXXXX Rev. X



Rx only



IceCure Medical LTD
Haeshei 7, 2nd Floor,
Caesarea I.P.
3088900, Israel
Tel: 972- 4- 623 0333
Fax: 972- 4- 623 0222
www.icecure-medical.com



Conforms to UL Std. 60601- 1
E114081



220-240 VAC, 50/60 Hz, 7A

MLS3080003 Rev C



SN PS- XXXXX

DD- MMM- YYYY RoHS

REF FAS3XXXXXX Rev. X



Rx only



IceCure Medical LTD
Haeshei 7, 2nd Floor,
Caesarea I.P.
3088900, Israel
Tel: 972- 4- 623 0333
Fax: 972- 4- 623 0222
www.icecure-medical.com



Conforms to UL Std. 60601- 1
E114081



Уполномоченный представитель:
ООО "Уромед М", адрес: 117342, г. Москва, ул.
Введенского, д. 1 стр. 1, комнаты 2-14;25

ПУ №... от

220-240 VAC, 50/60 Hz, 7A


MLS3080003 Rev C



Liquid Nitrogen Dewar

REF PMT1000105

LOT YYYYMMDD



sufficient for one Oxygen Depleting
procedure only

Caution: Handle with care

MLST1000001 Rev. E



Сосуд Дьюара для жидкого

REF PMT1000105

LOT YYYYMMDD



sufficient for one Oxygen Depleting
procedure only

Внимание: обращаться с
осторожностью

MLST1000001 Rev. E



Holder

REF FAG3000000 Rev X



IceCure Medical LTD
Haeshel 7, 2nd floor,
Caesarea I.P. 3088900, Israel
Tel: 972- 4- 623 0333
Fax: 972- 4- 623 0222
www.icecure-medical.com


MLG1000006 Rev. B

Caution: Handle with care



Держатель рукоятки

REF FAG3000000 Rev X



IceCure Medical LTD
Haeshel 7, 2nd floor,
Caesarea I.P. 3088900, Israel
Tel: 972- 4- 623 0333
Fax: 972- 4- 623 0222
www.icecure-medical.com

MLG1000006 Rev. B

Внимание: обращаться с осторожностью

Рис. 3. Маркировка Держатель рукоятки оригинальная на английском языке (слева) и при поставке в РФ на русском языке (справа)





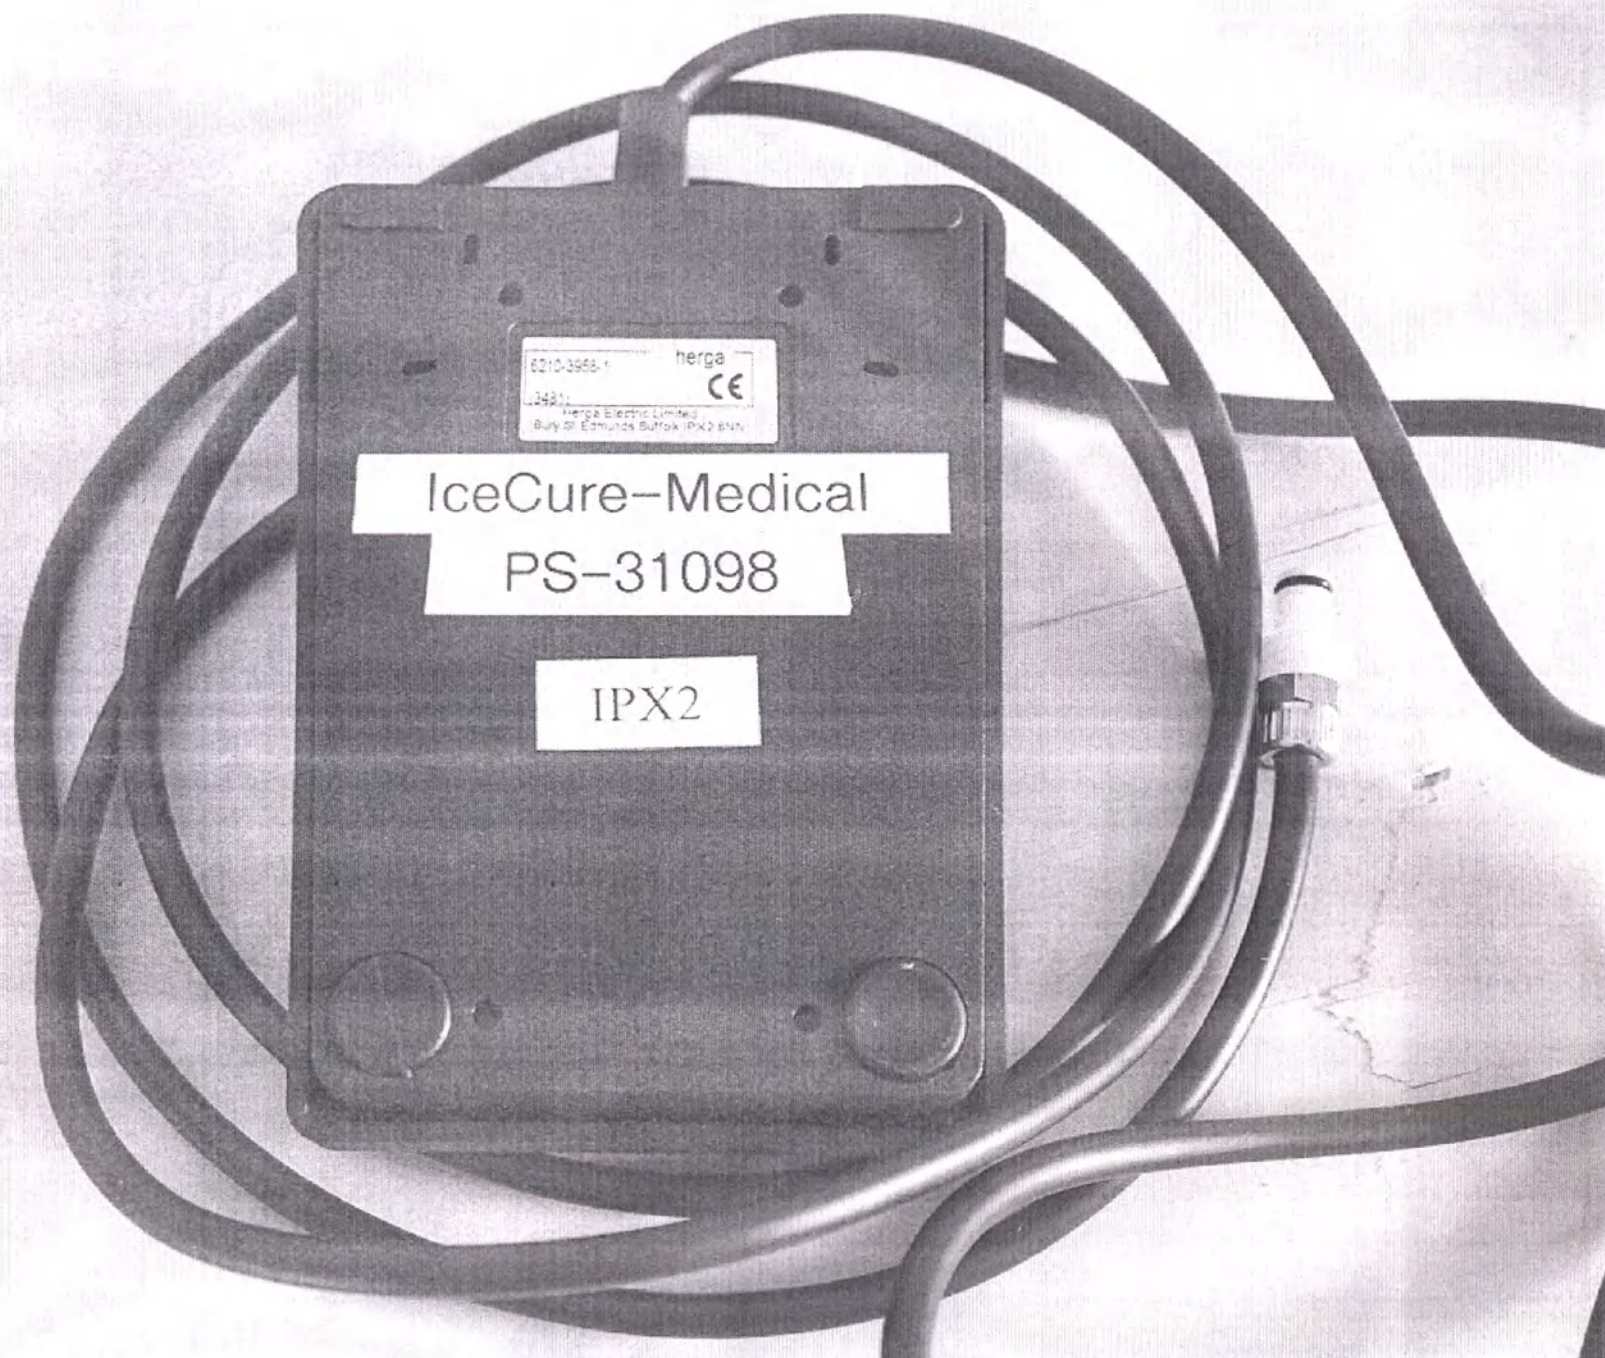


Рис. 4. Маркировка Ножная педаль

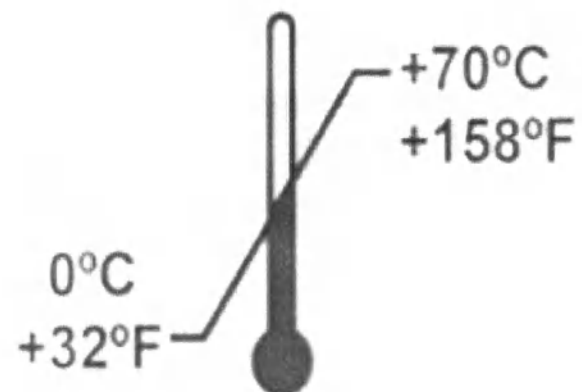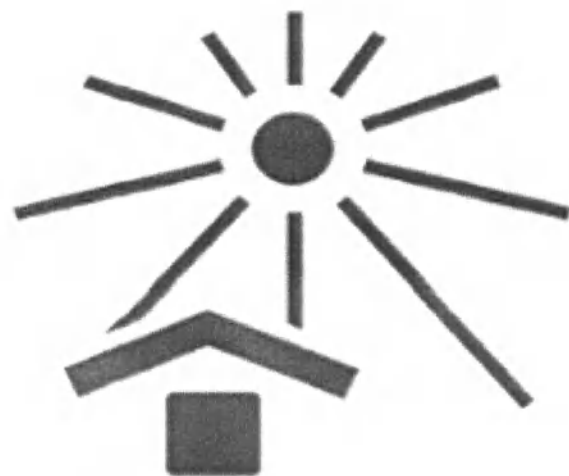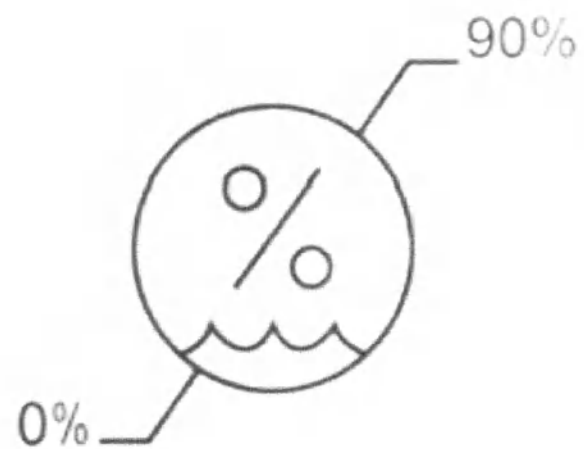

P/N: MLS3080002 Rev A

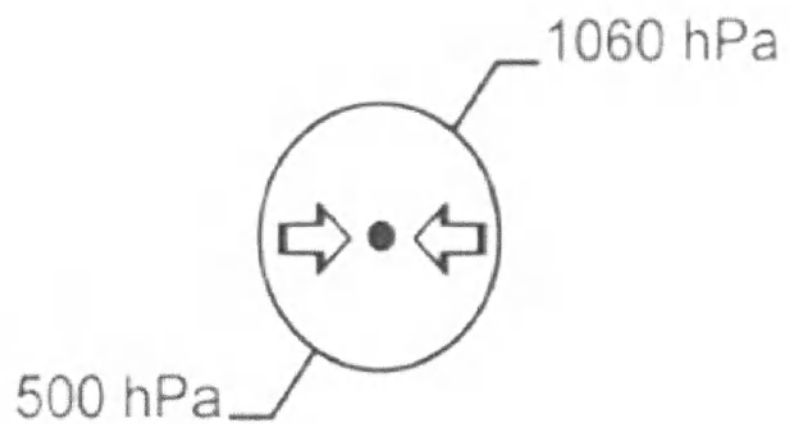

СИСТЕМА КРИОАБЛЯЦИИ PROSENSE

SN PS-31098

REF FAS3100000



IceCure Medical Ltd.
Haeshel 7, 2nd floor, Caesarea
3088900, Israel

Тел: 972-4-623 0333
Факс: 972-4-623 0222
www.icecure-medical.com

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Уромед М»
117342, город Москва, улица Введенского,
дом 1 строение 1, комнаты 2-14;25

Тел.: +7 (495) 783 68 11
Факс: +7 (495) 678 69 95
www.uro-med-m.ru

Претензии потребителя принимаются Уполномоченным представителем

Вес брутто: 200 кг
Габариты: 100 x 65 x 150 см

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Figure 1

(снизу)



Рис. 8. Транспортная этикетка оригинальная на английском языке (сверху) и при поставке в РФ на русском языке (снизу)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
19 (девятнадцать) листов

Генеральный директор
ООО "Уромед М"

 Ефремова Л. А.

