

**Набор инструментов для проведения
транслюминальных эндоскопических
лапароскопически-ассистированных
вмешательств однократного применения
стерильный - «ЭСТЭН»
по ТУ 32.50.50-002-65500831-2018**

Фотографические изображения



Рис.1 Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных

повторного применения стерильный - «ЭСТЭН» по ТУ 32.50.50-002-65500831-2018

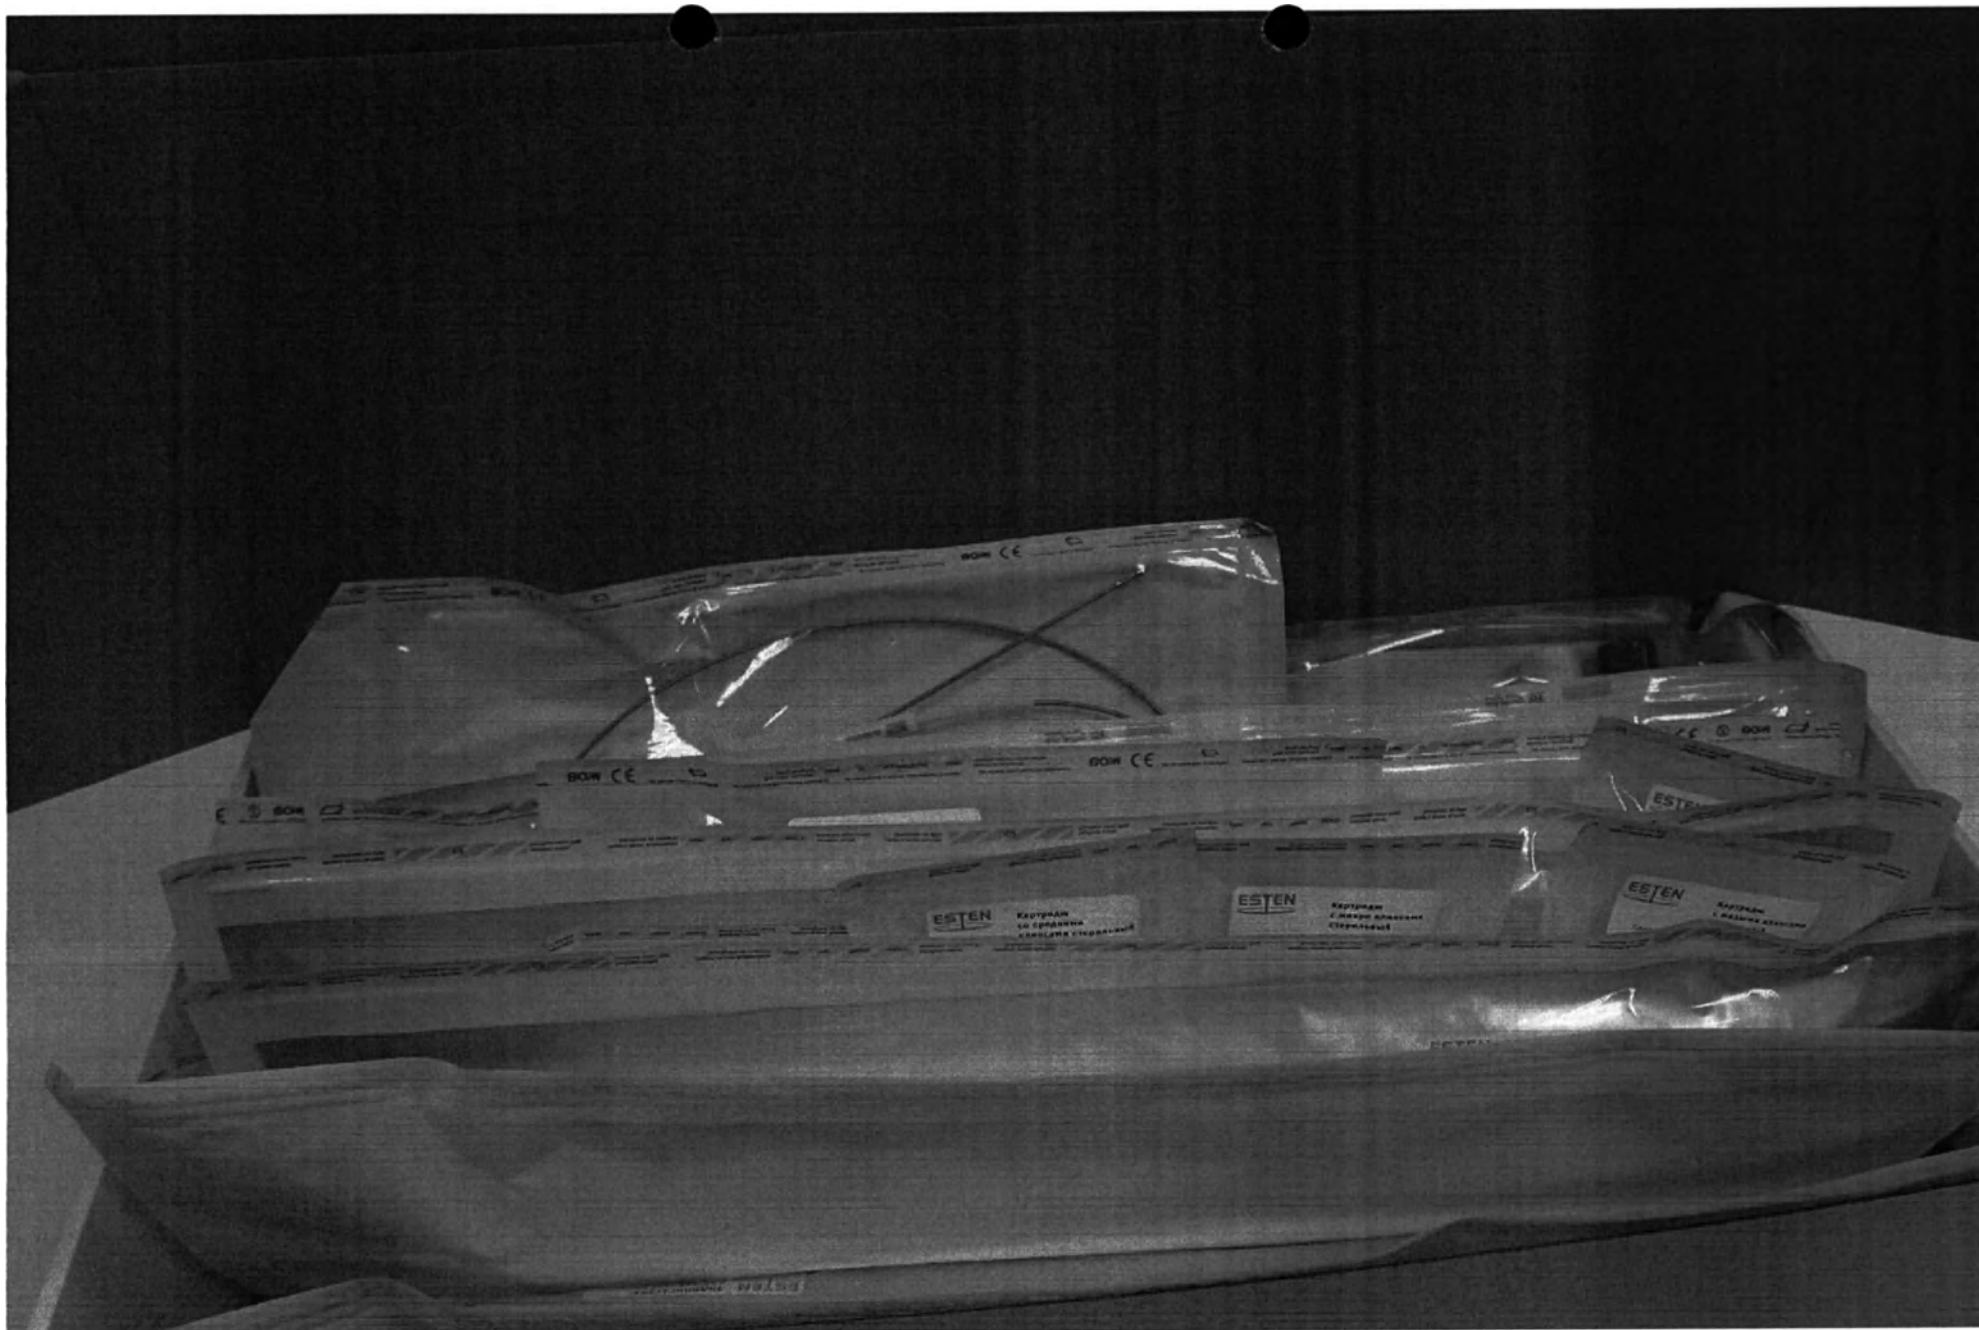


Рис.2 Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных операций при применении стерильный - «ЭСТЭН» по ТУ 32.50.50-002-65500831-2018 (открытая упаковка)



Рис 3. Упаковка инструмента набора (Троакар с силиконовым клапаном стерильный)

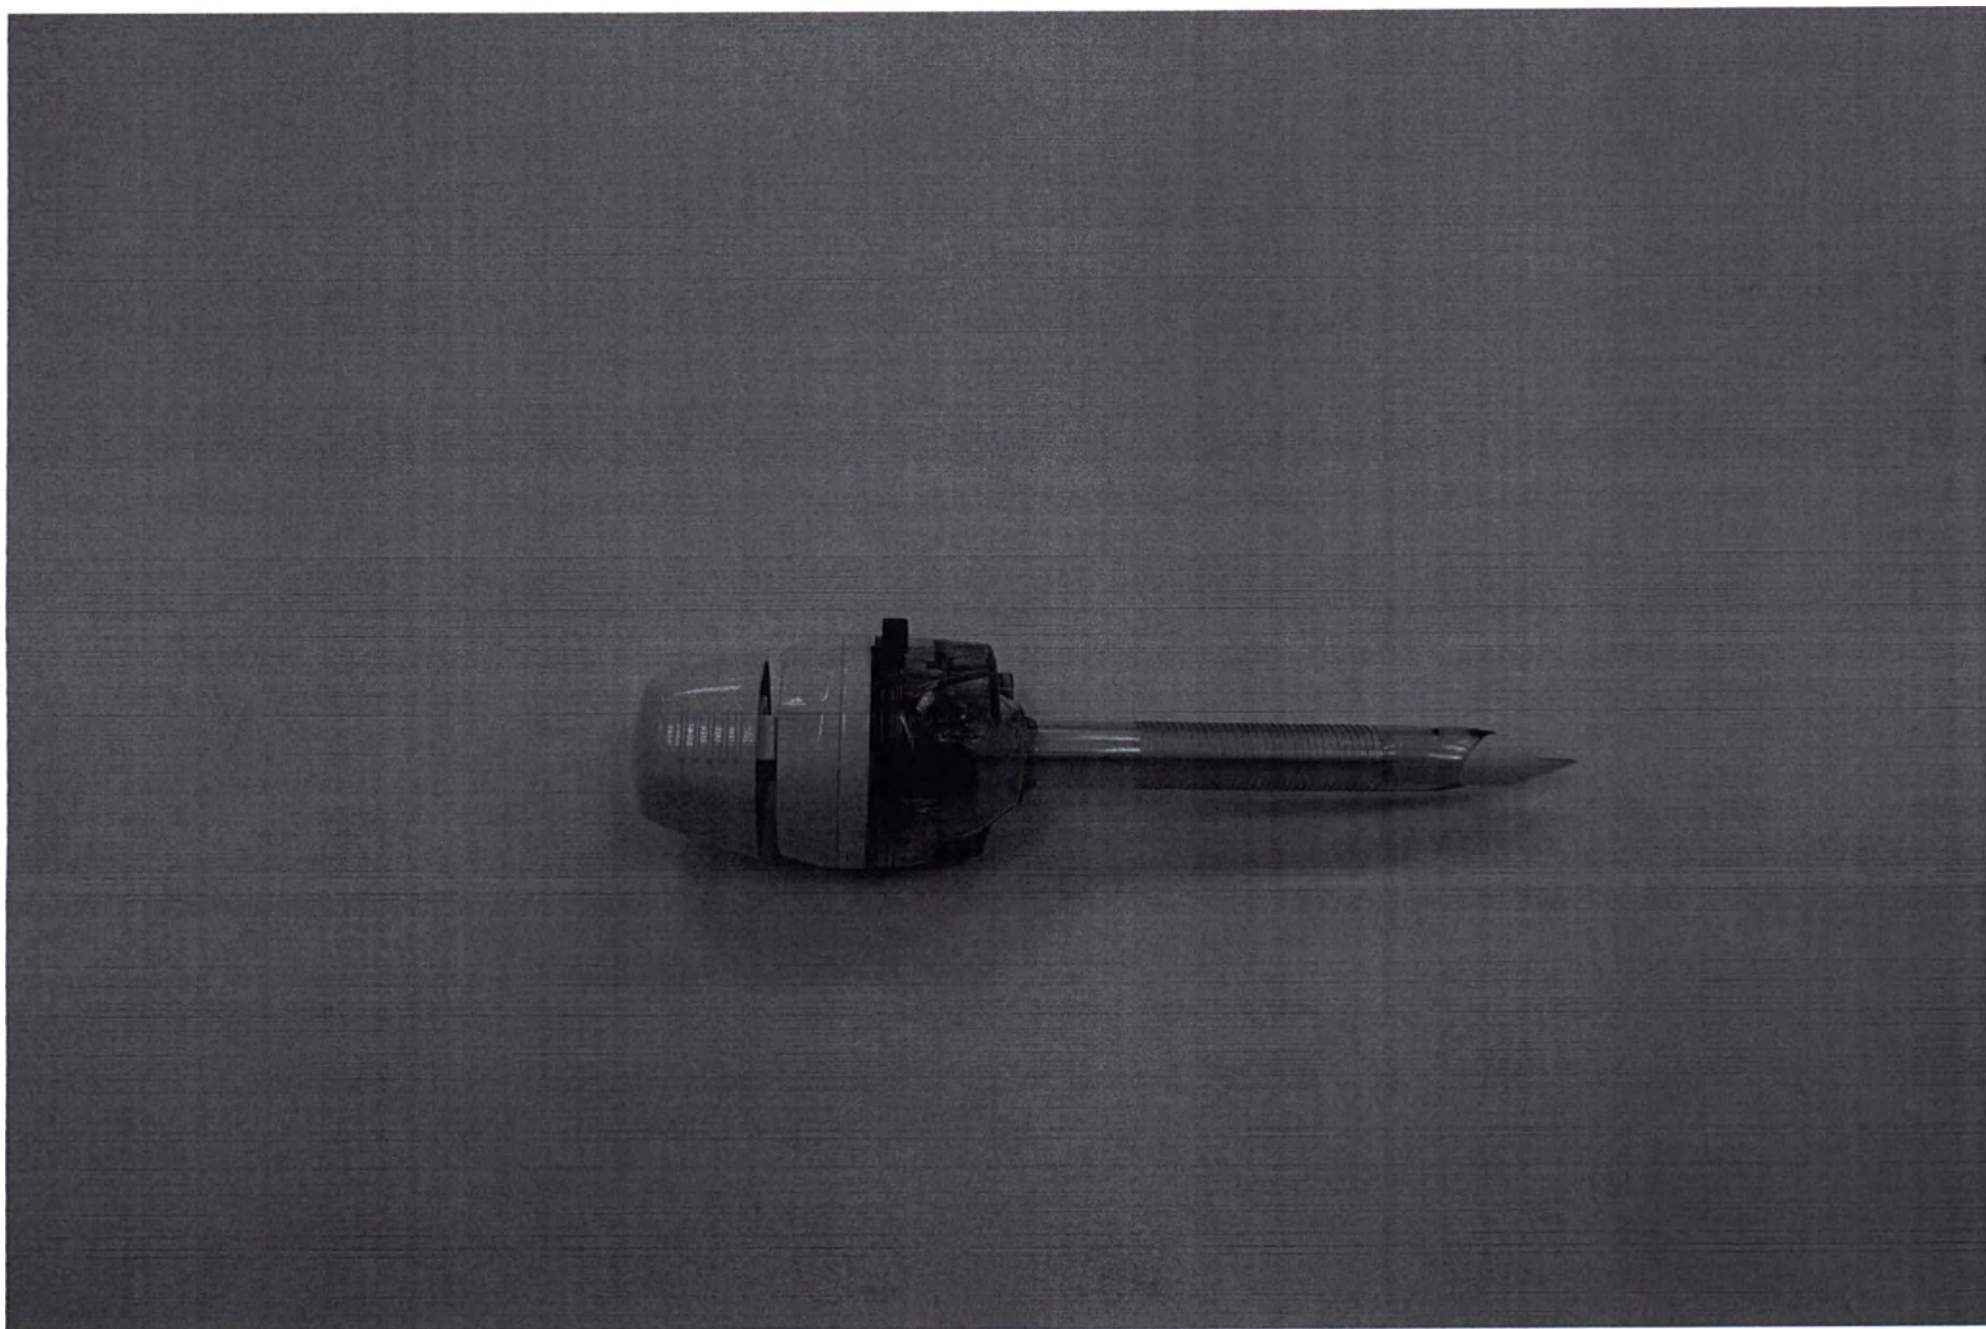


Рис.4 Троакар с силиконовым клапаном (без упаковки)

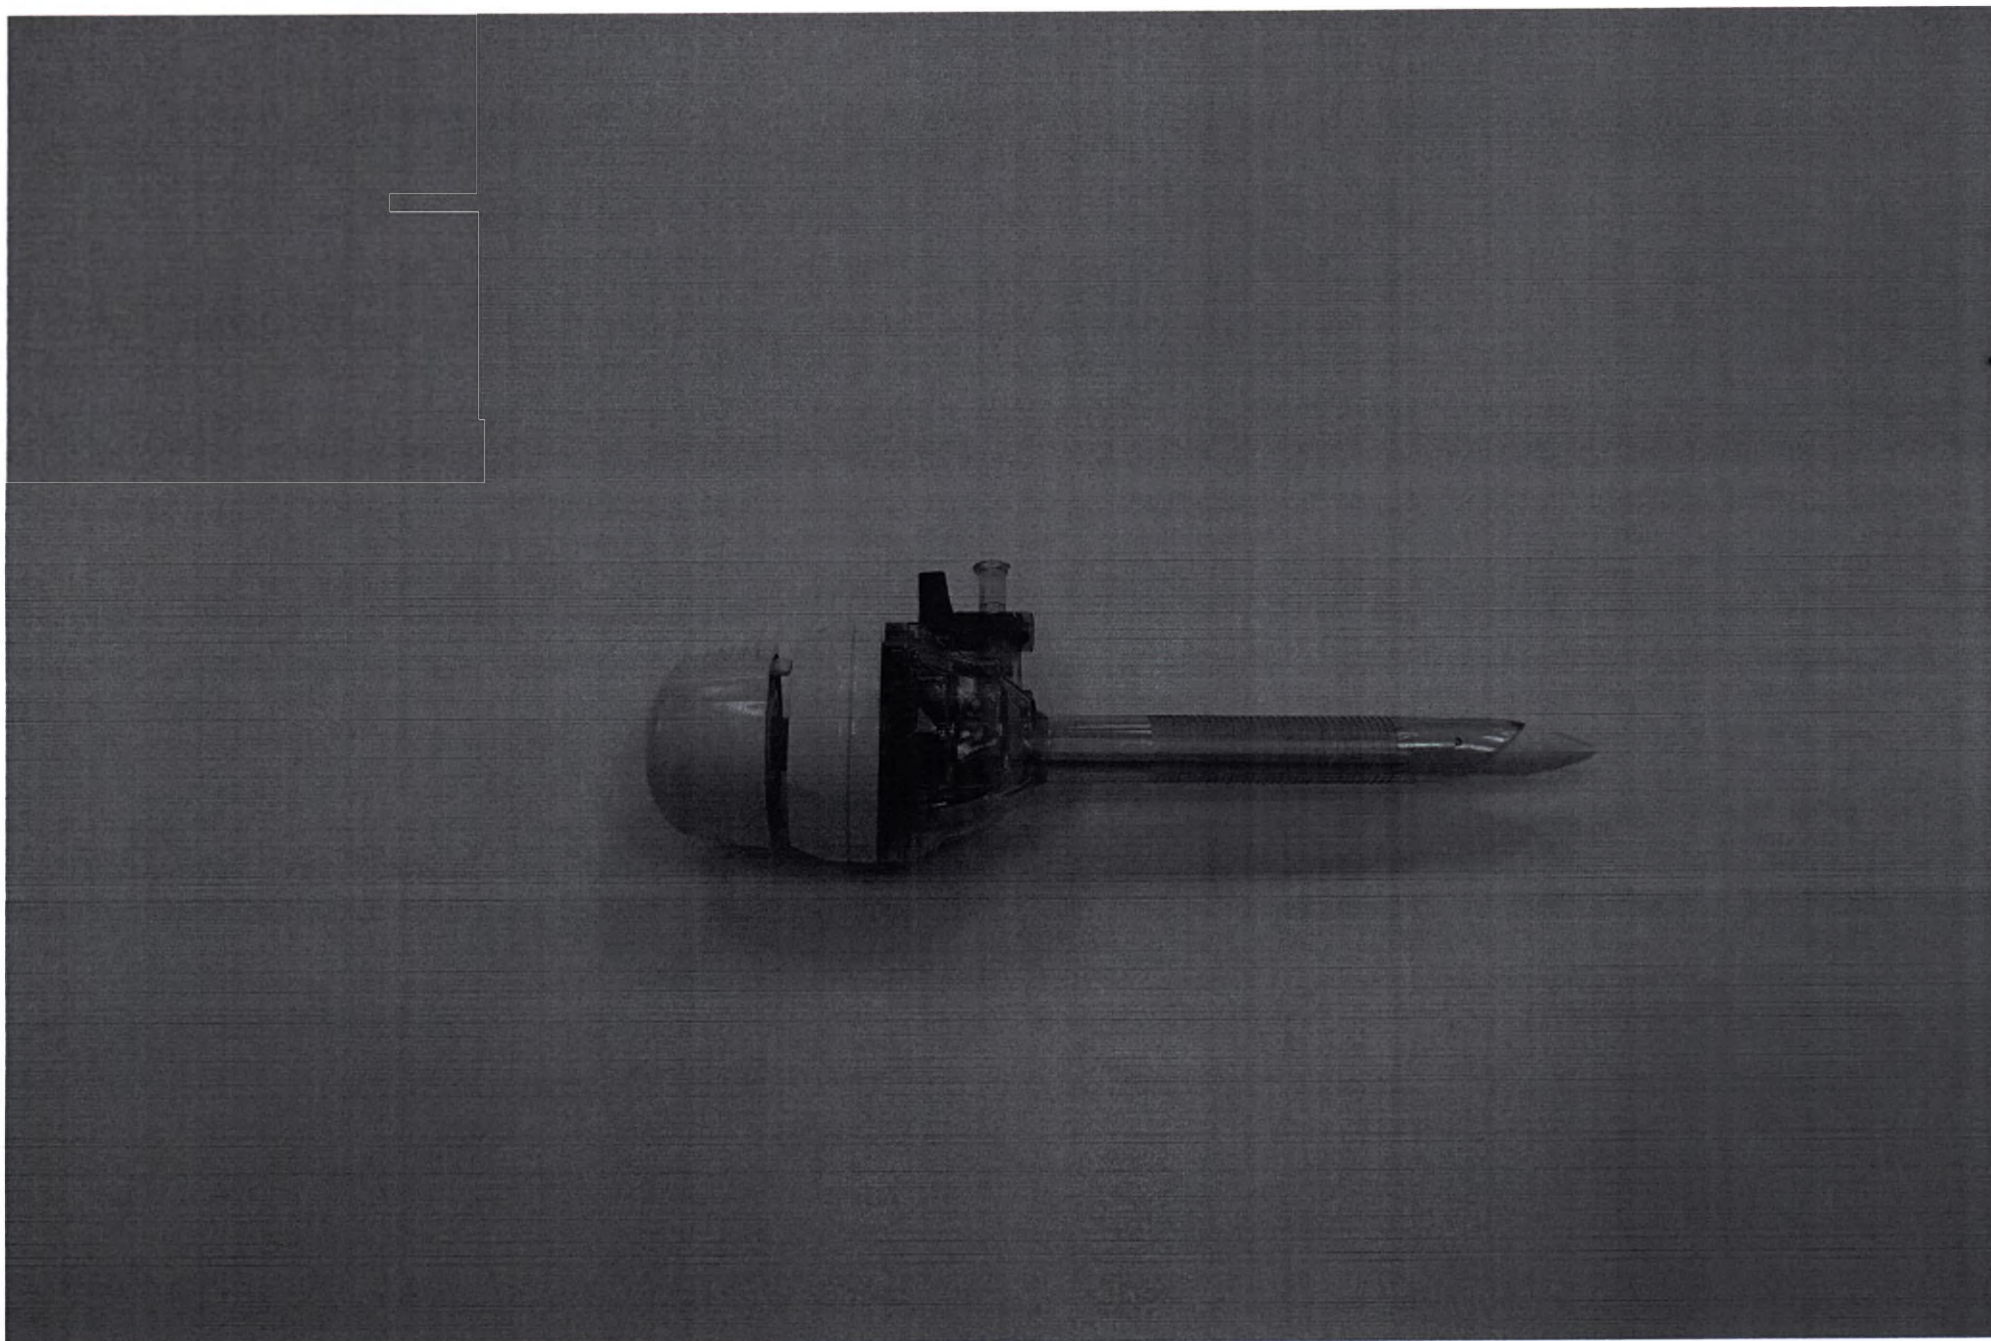


Рис. 5. Трещак с силиконовым клапаном и краном газоподачи стерильный (без упаковки)

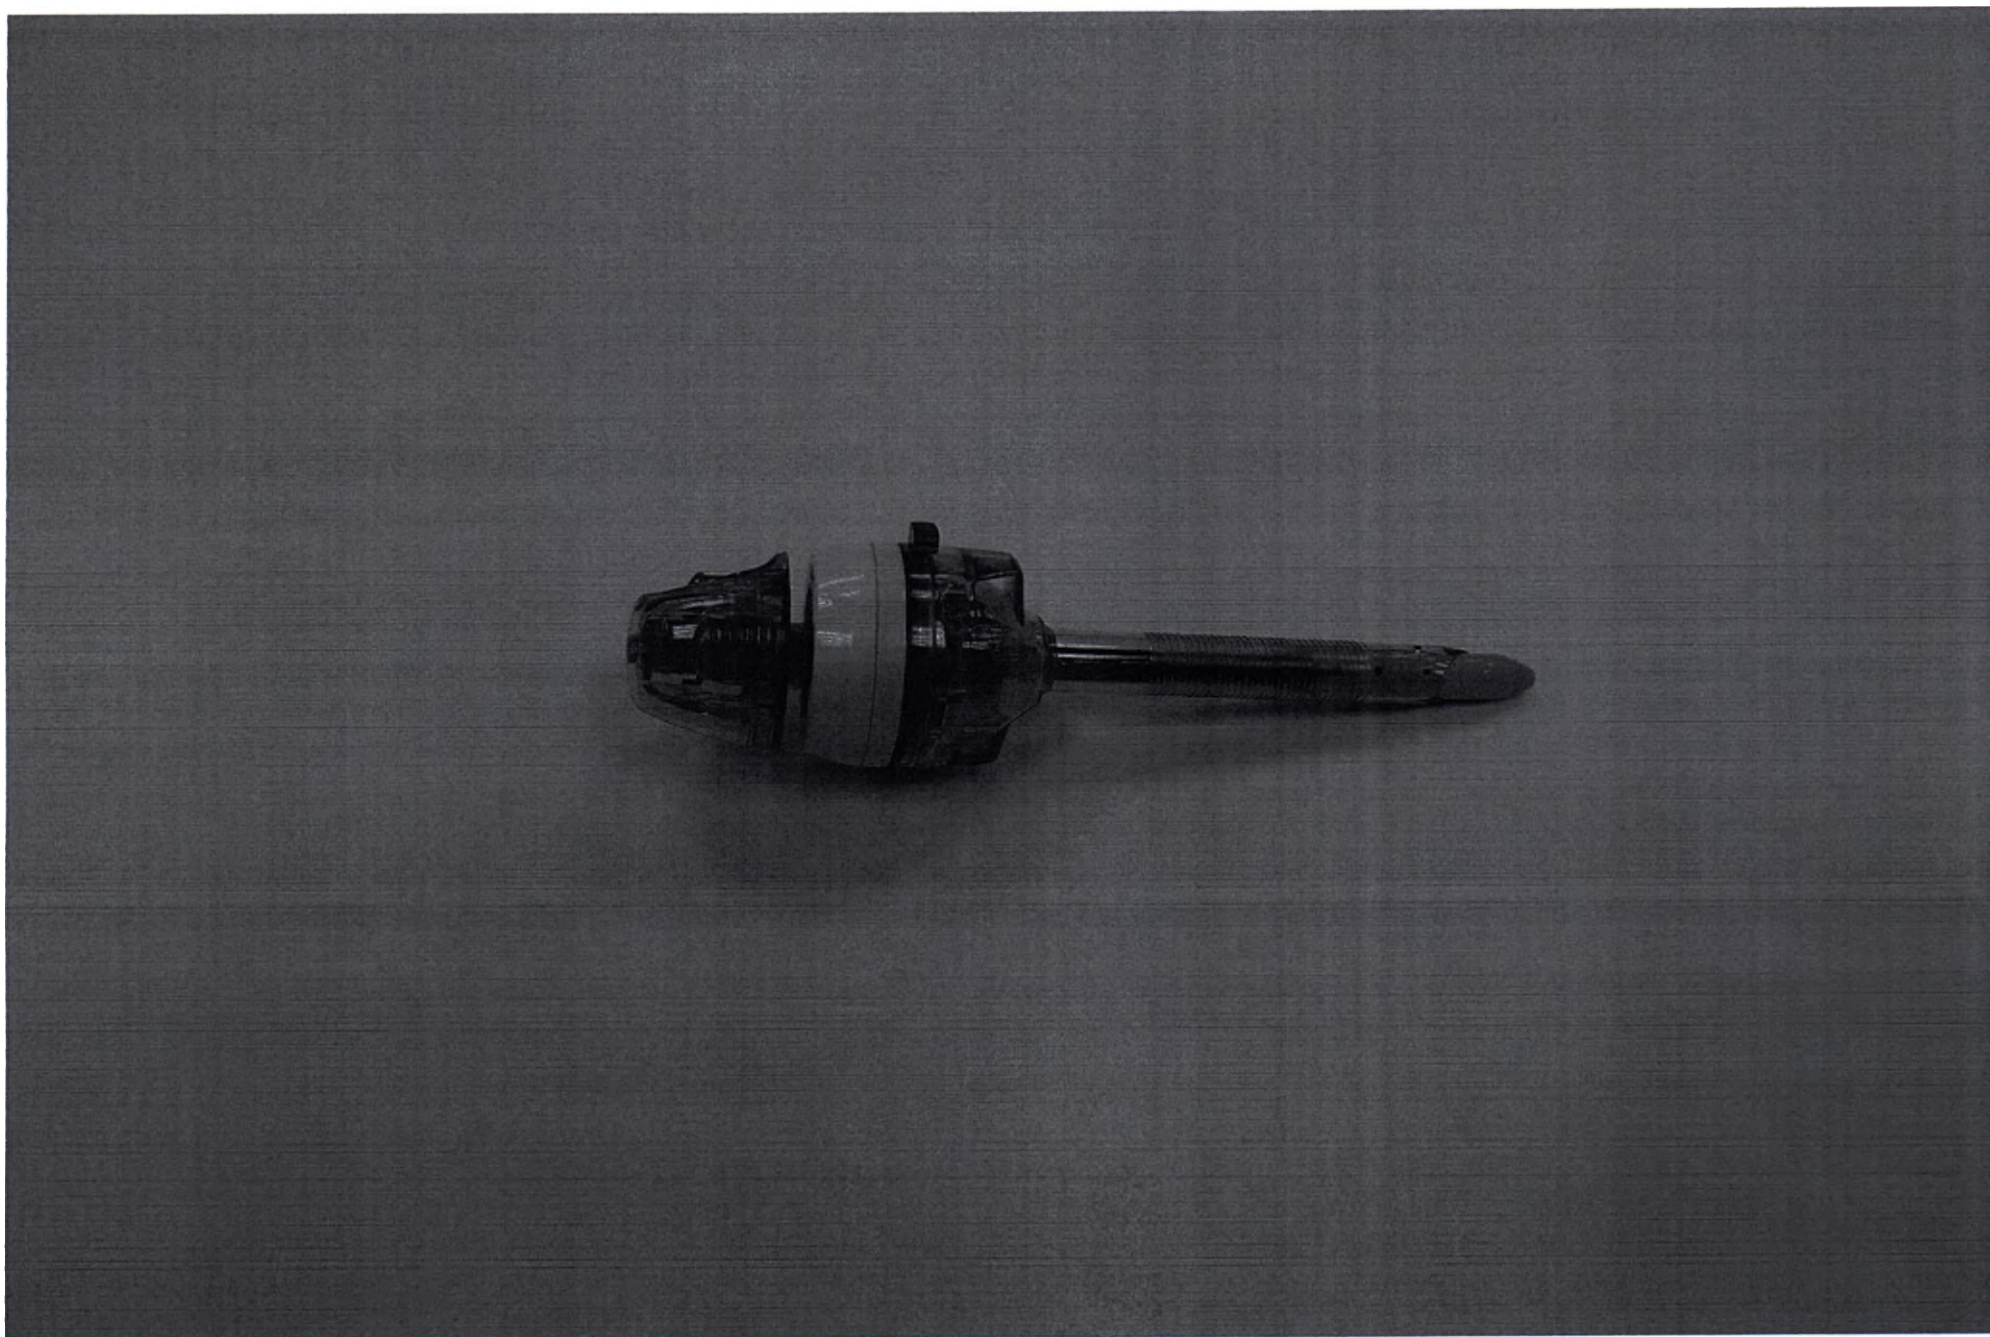


Рис.6 Троакар с форточным клапаном стерильный (без упаковки)

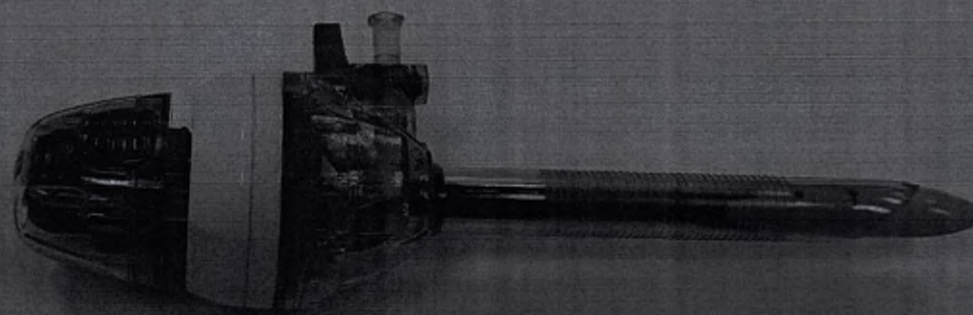


Рис 7. Трокар с форточным клапаном и краном газоподачи стерильный (без упаковки)

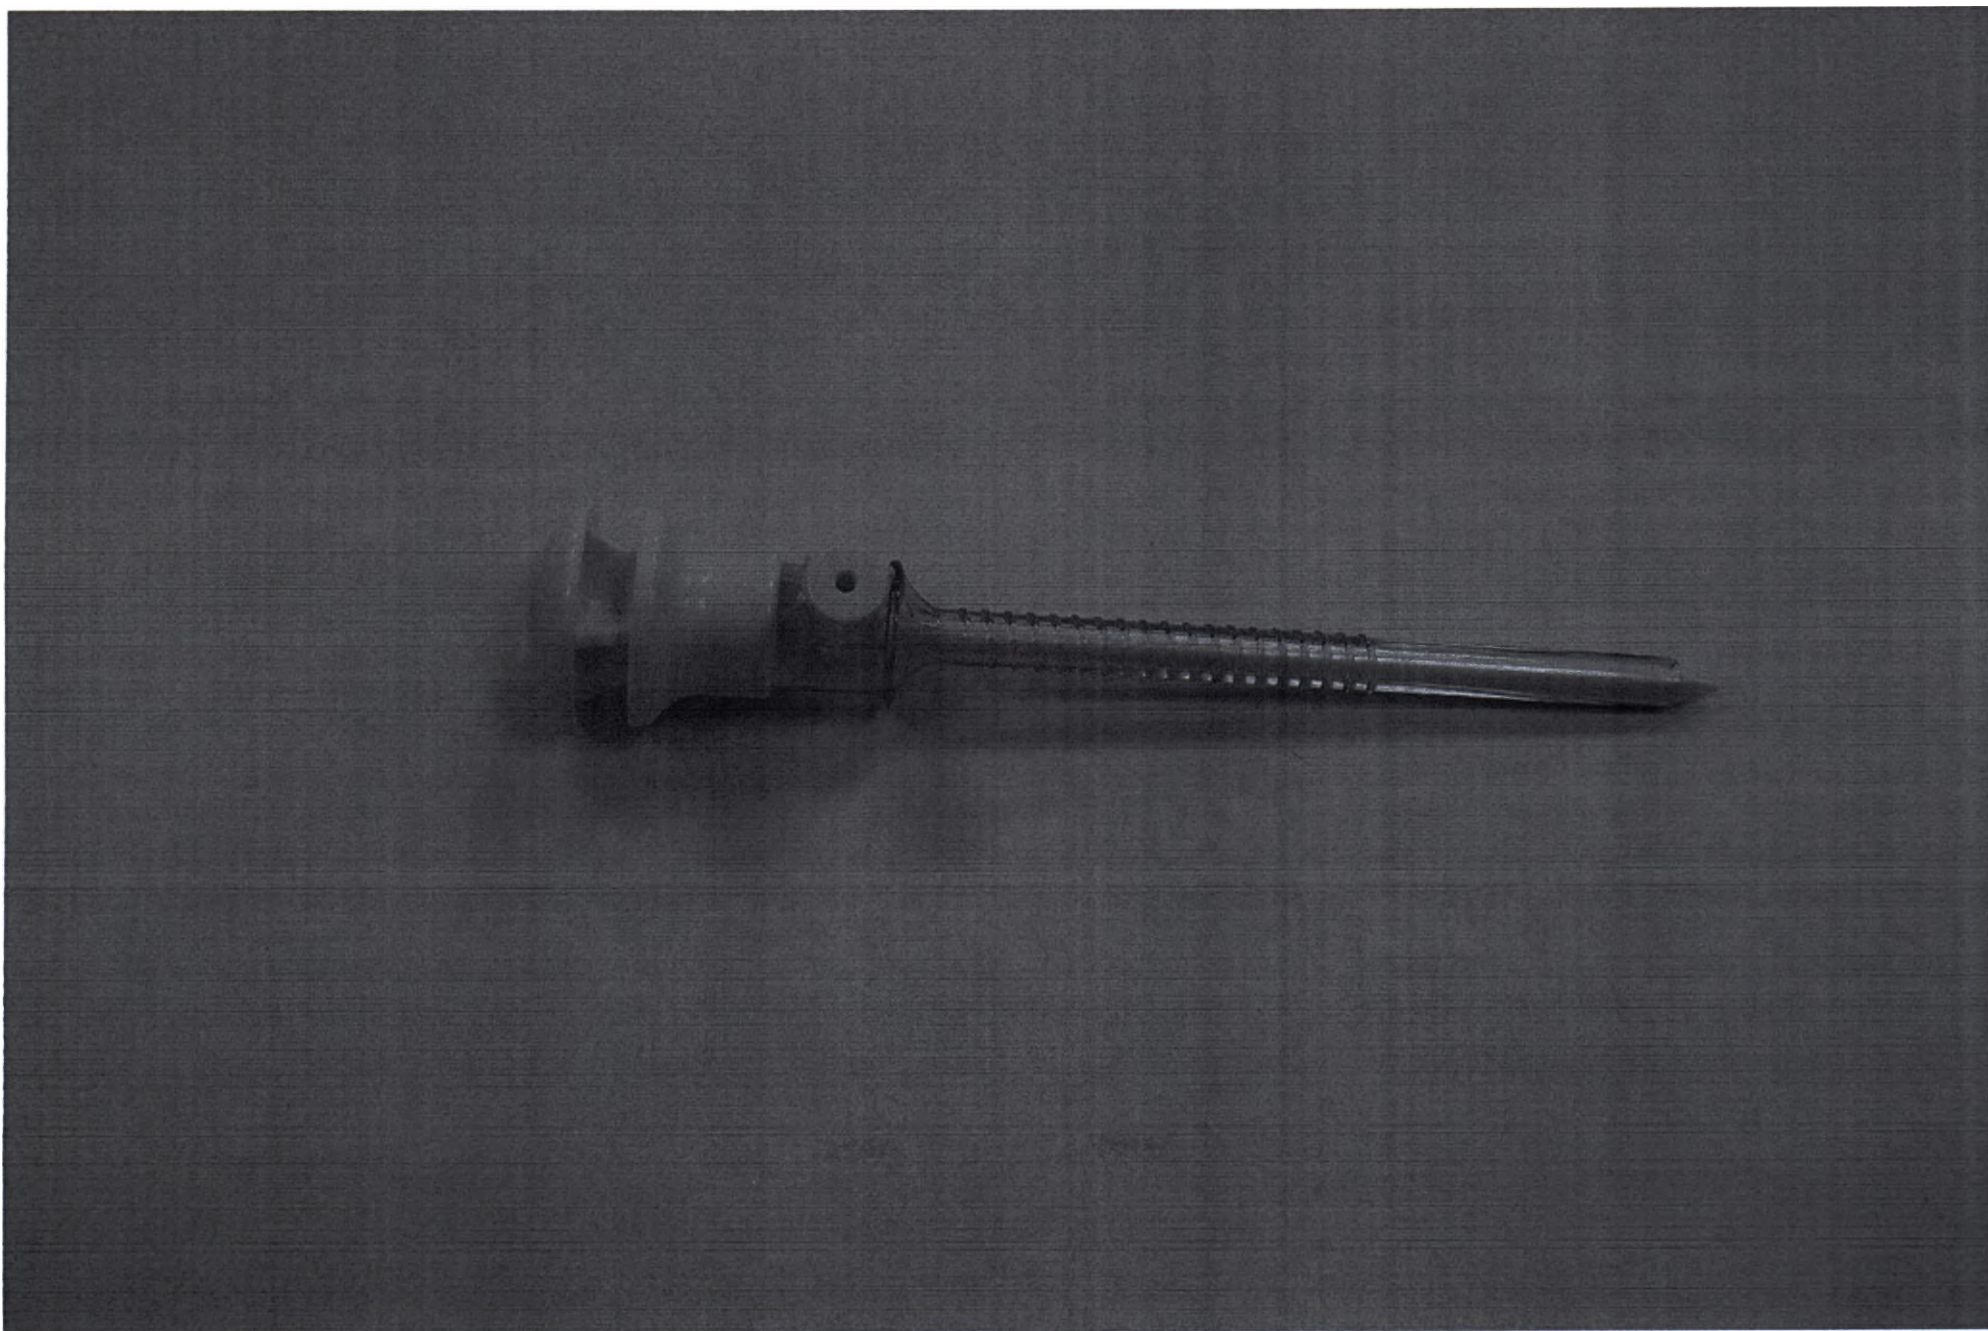


Рис.8 Троякар бесклапанный стерильный (без упаковки)



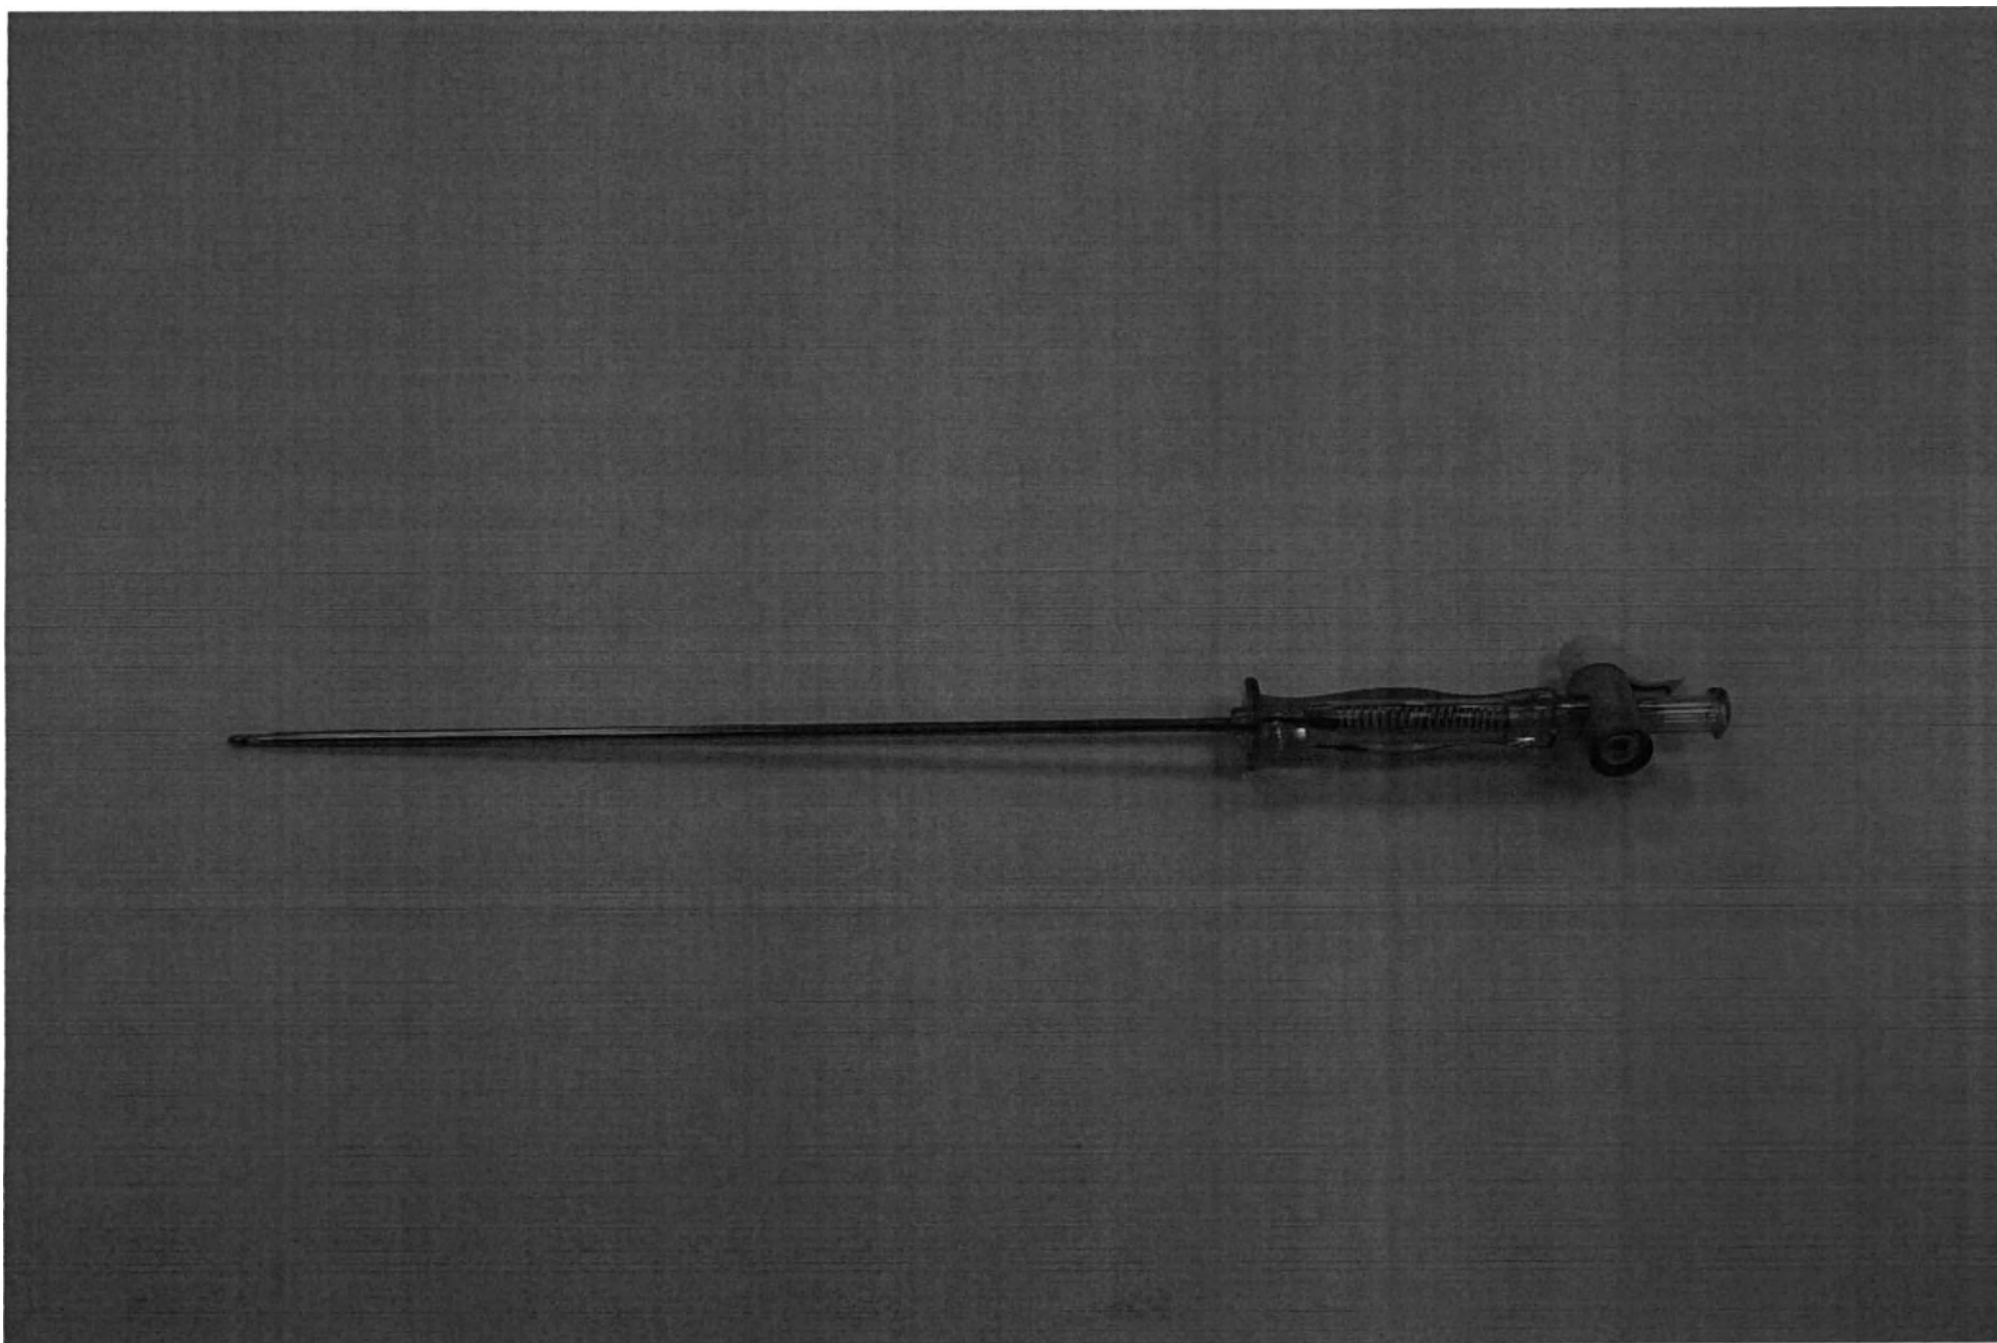


Рис. 9 Игла для пневмоперитонеума типа Вереша стерильная (без упаковки)

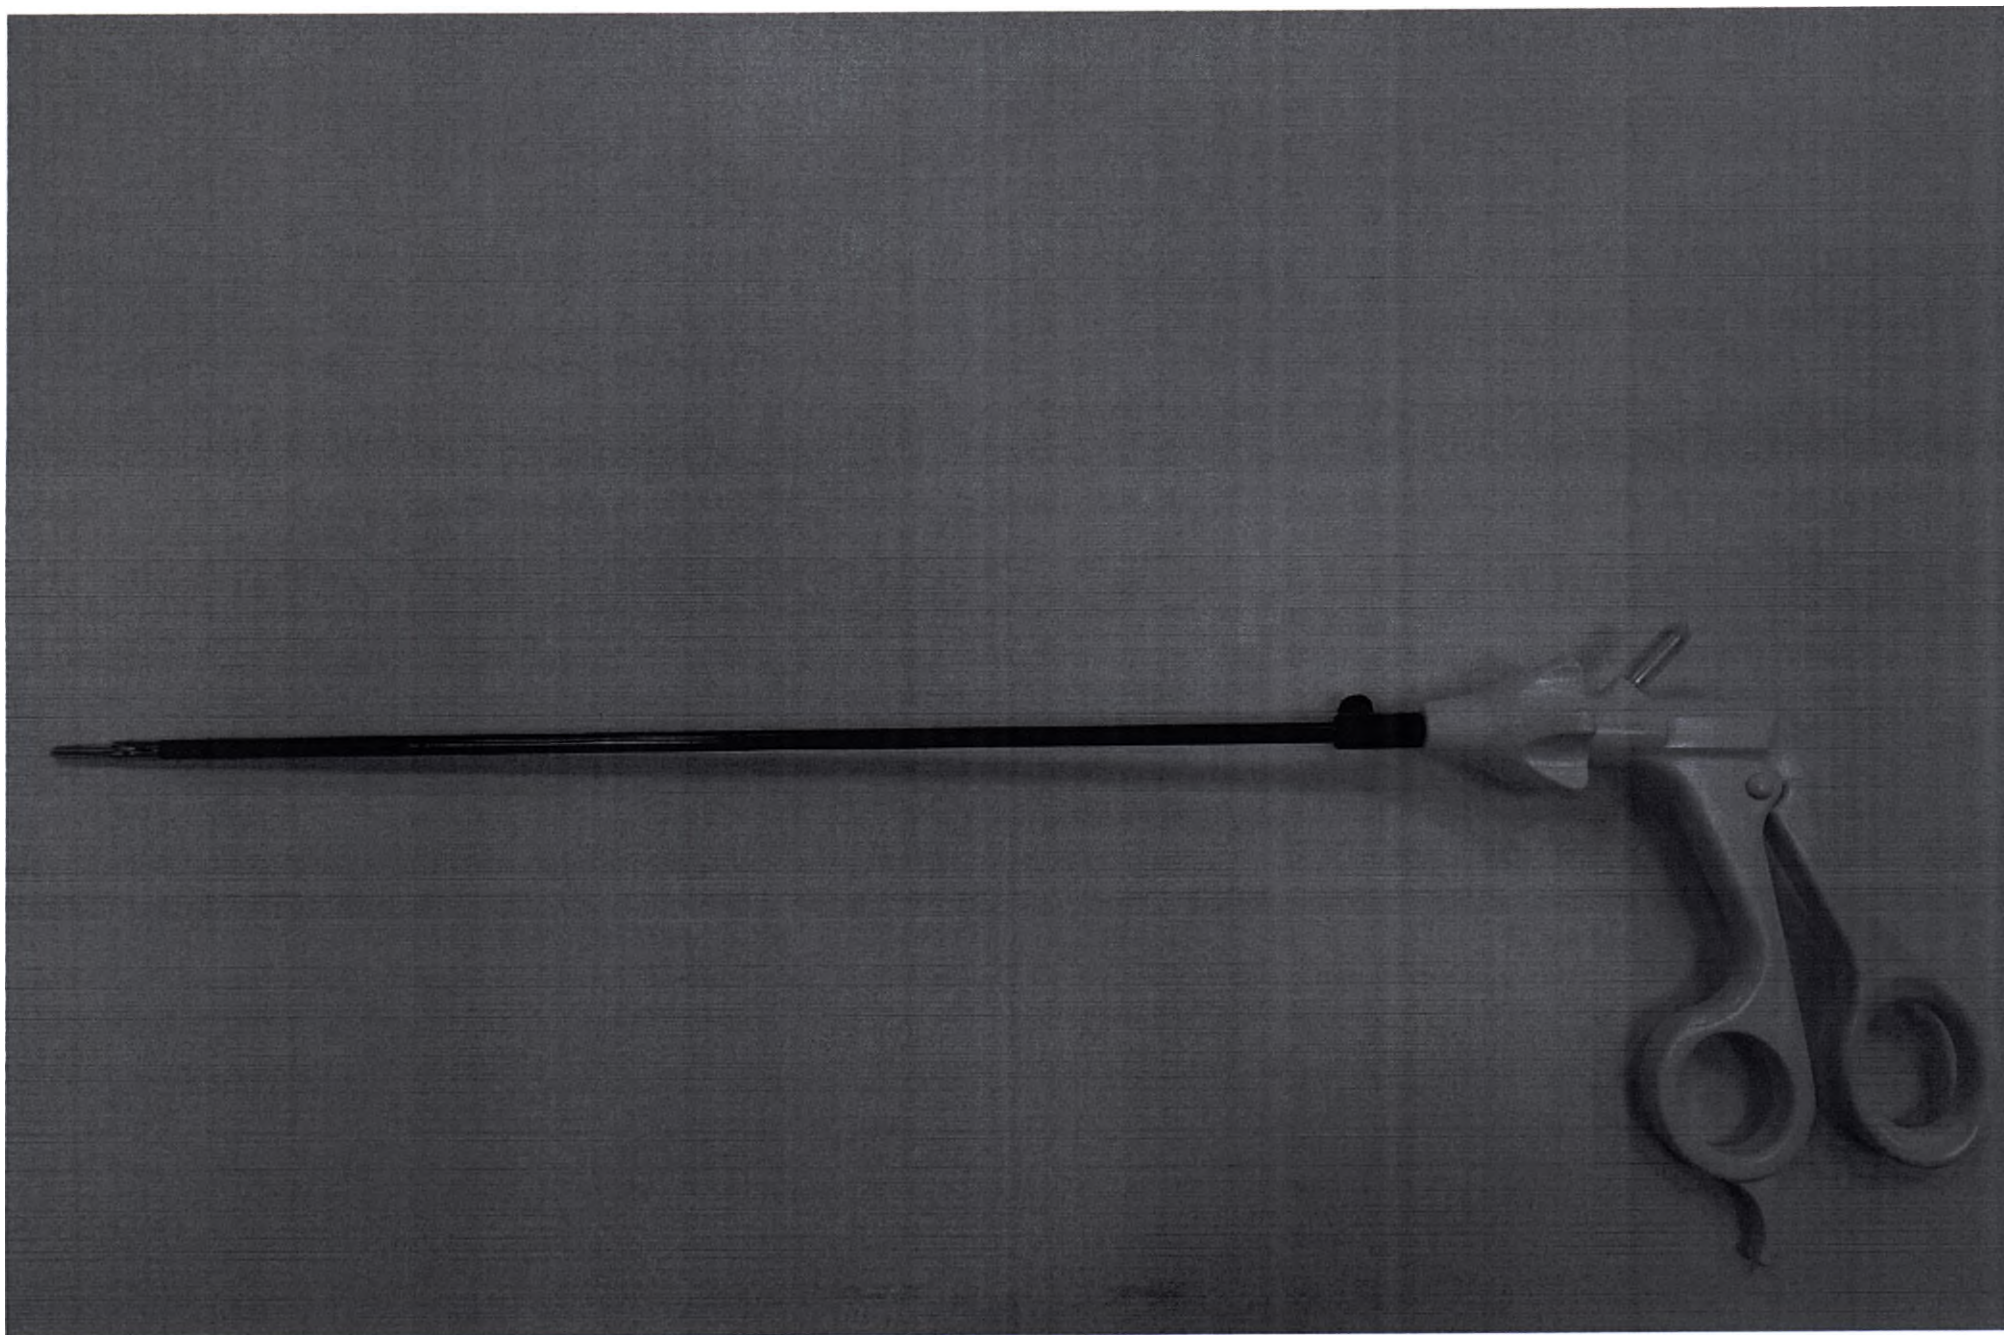

Вид 10. Ножницы односторонние прямые типа Митценбаум стерильные (без упаковки)

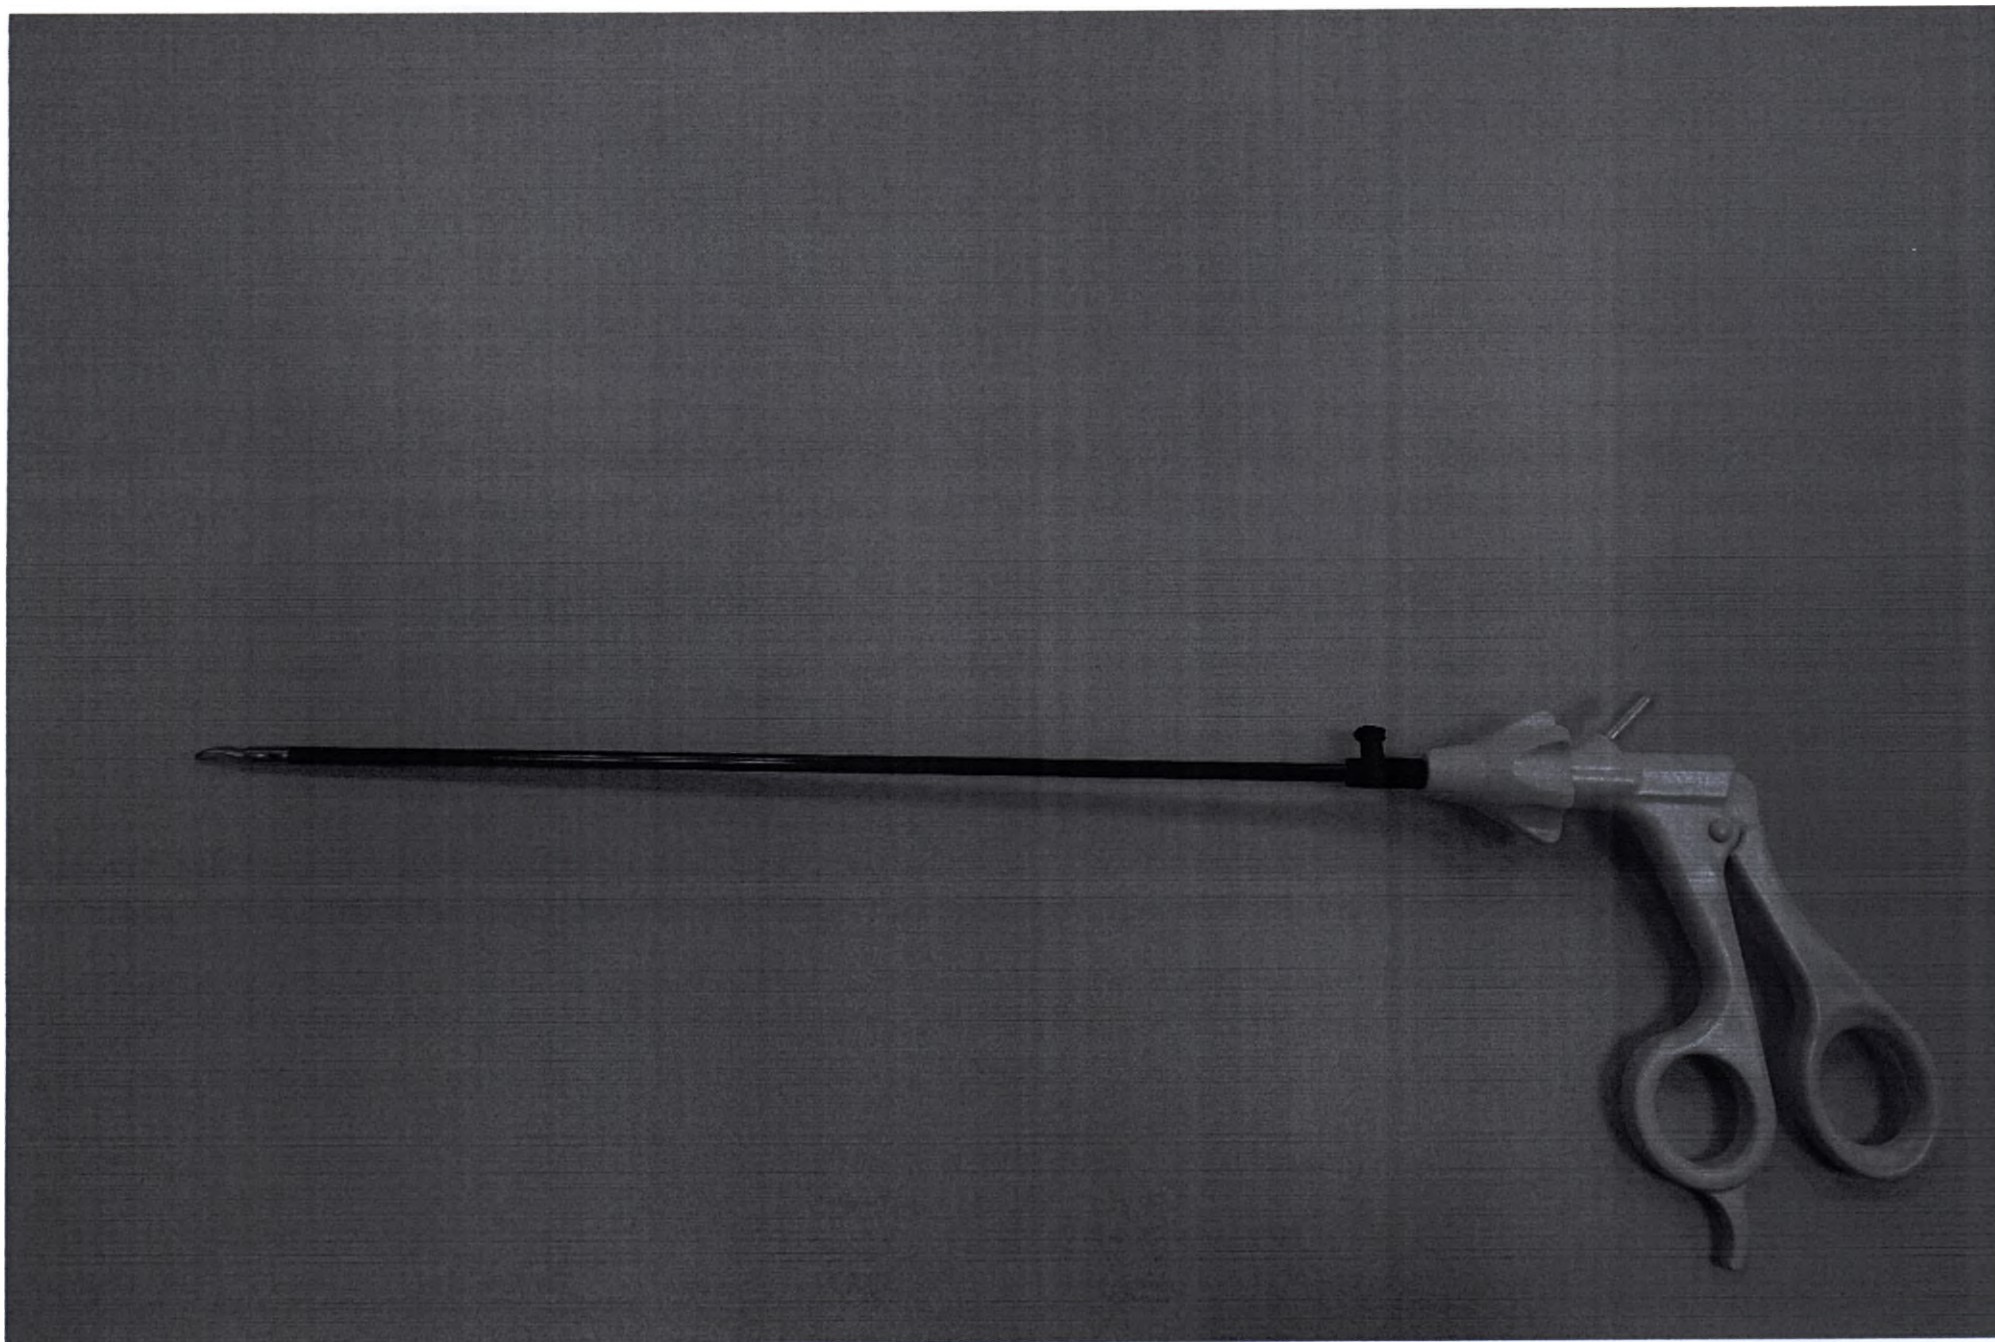

Вид 11. Щипцы анатомические изогнутые по плоскости правые типа Митценбаум стерильные (без упаковки)

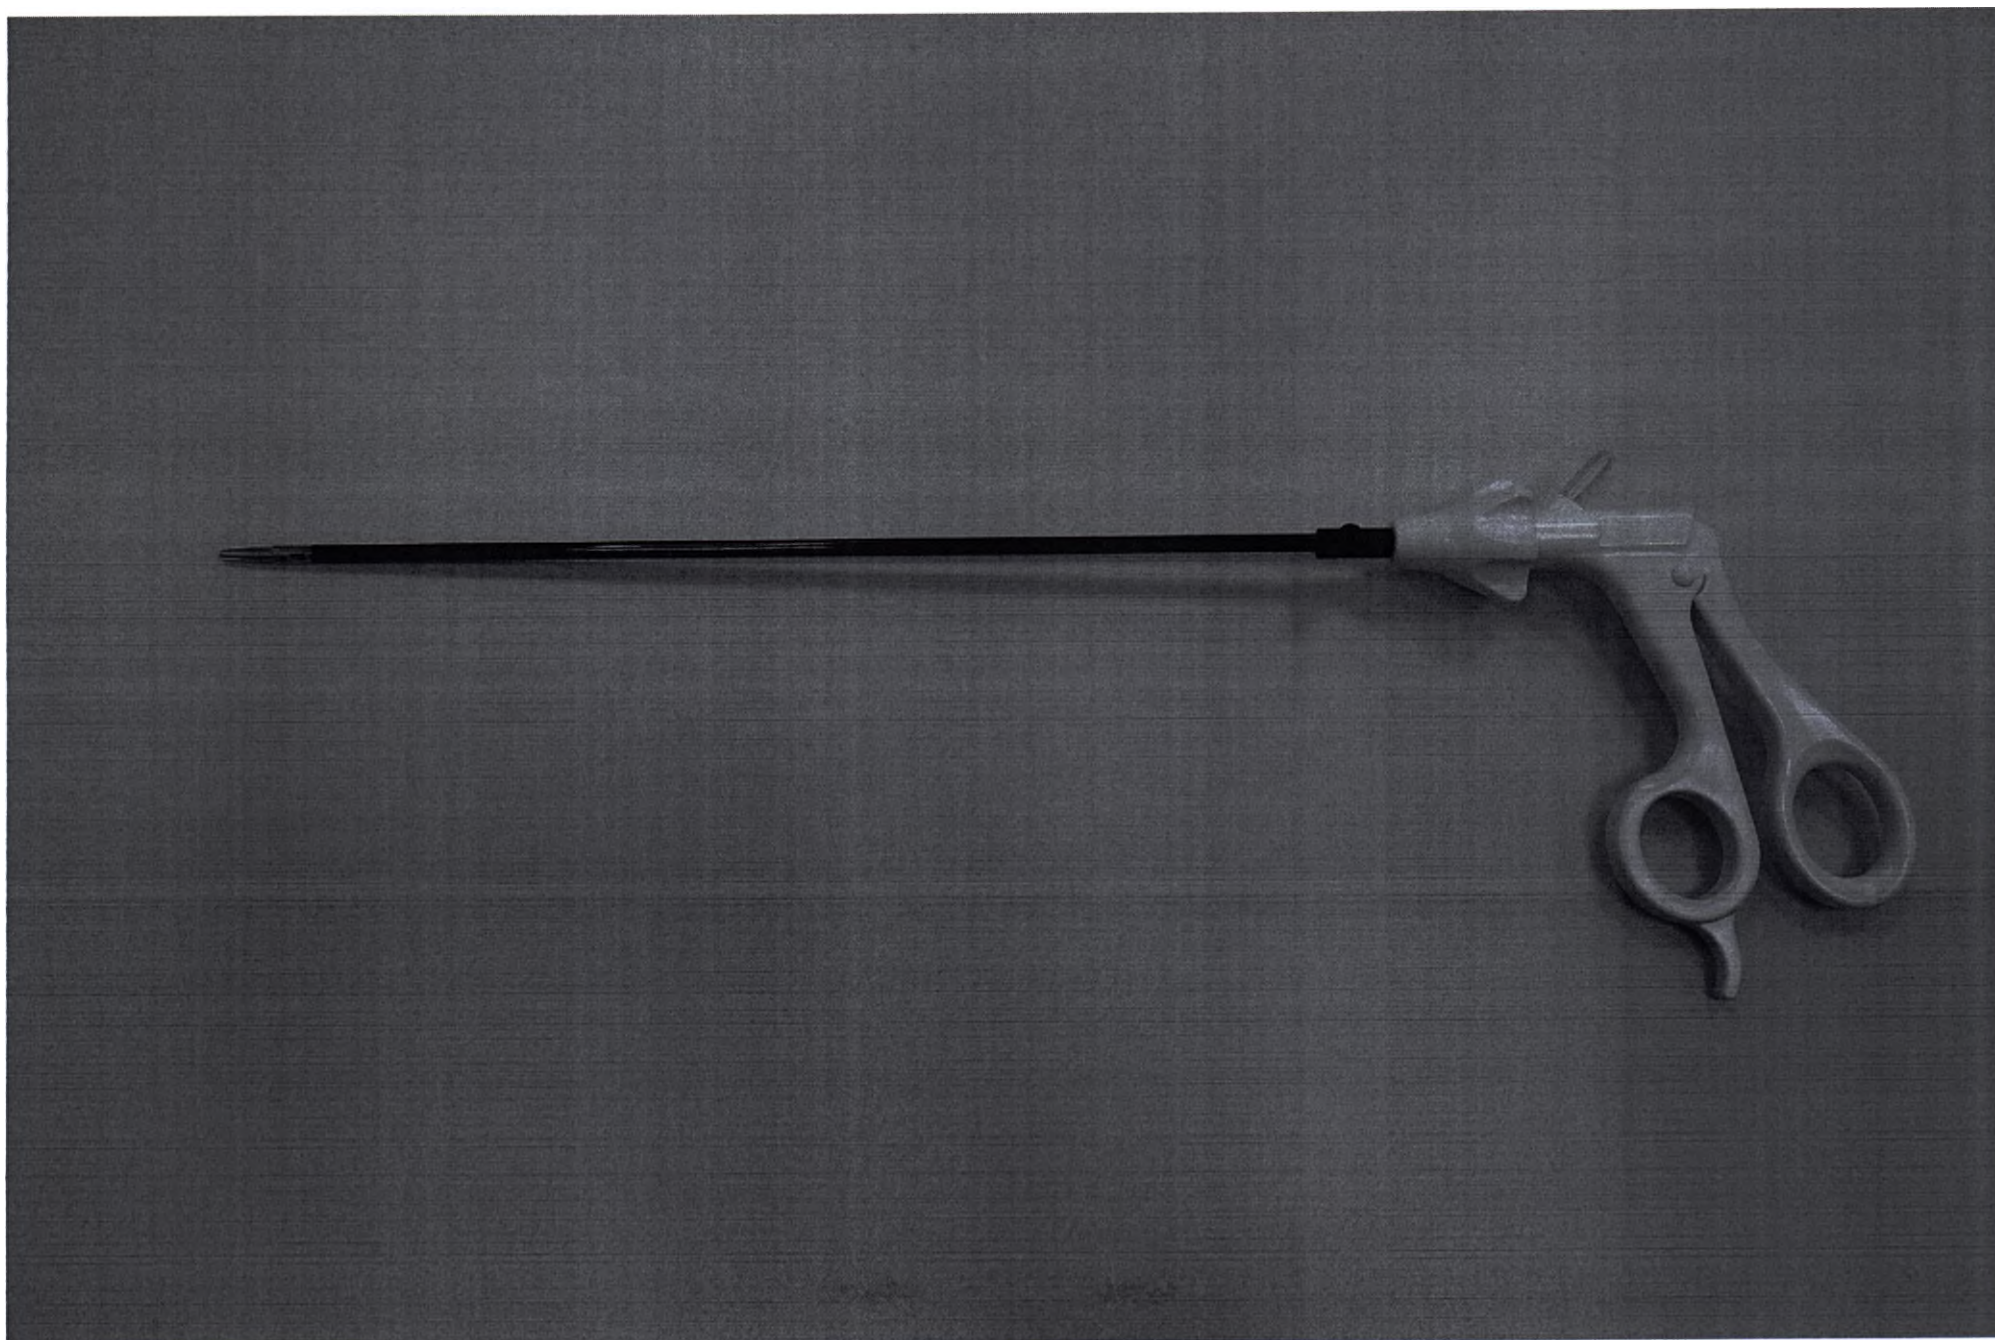


Рис. 12 Ножницы односторонние изогнутые по ребру стерильные (без упаковки)

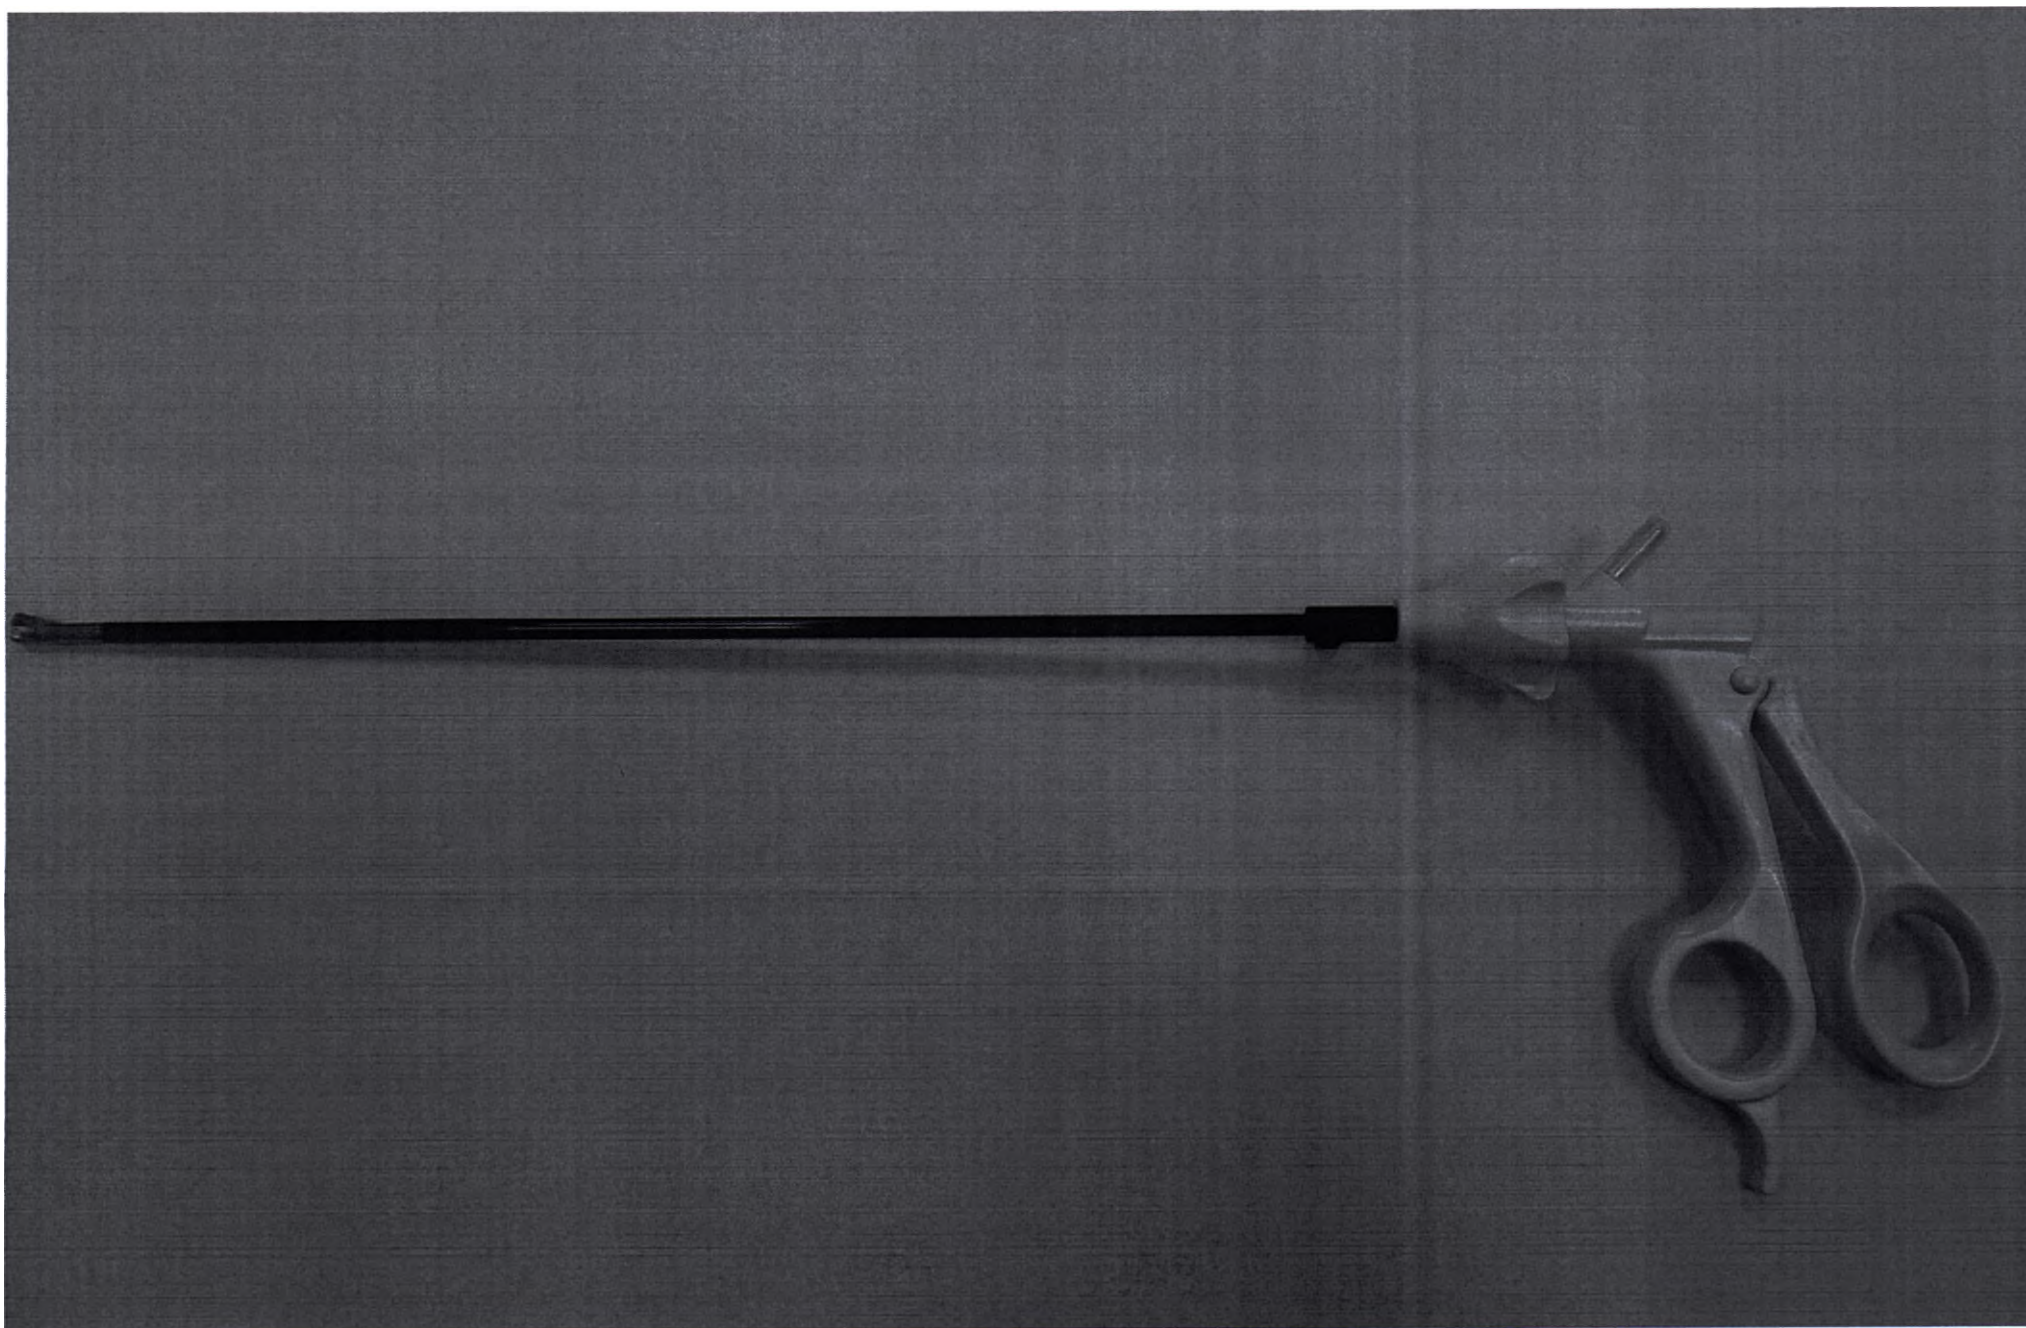


Рис. 14 Ножницы односторонние серповидные стерильные (без упаковки)

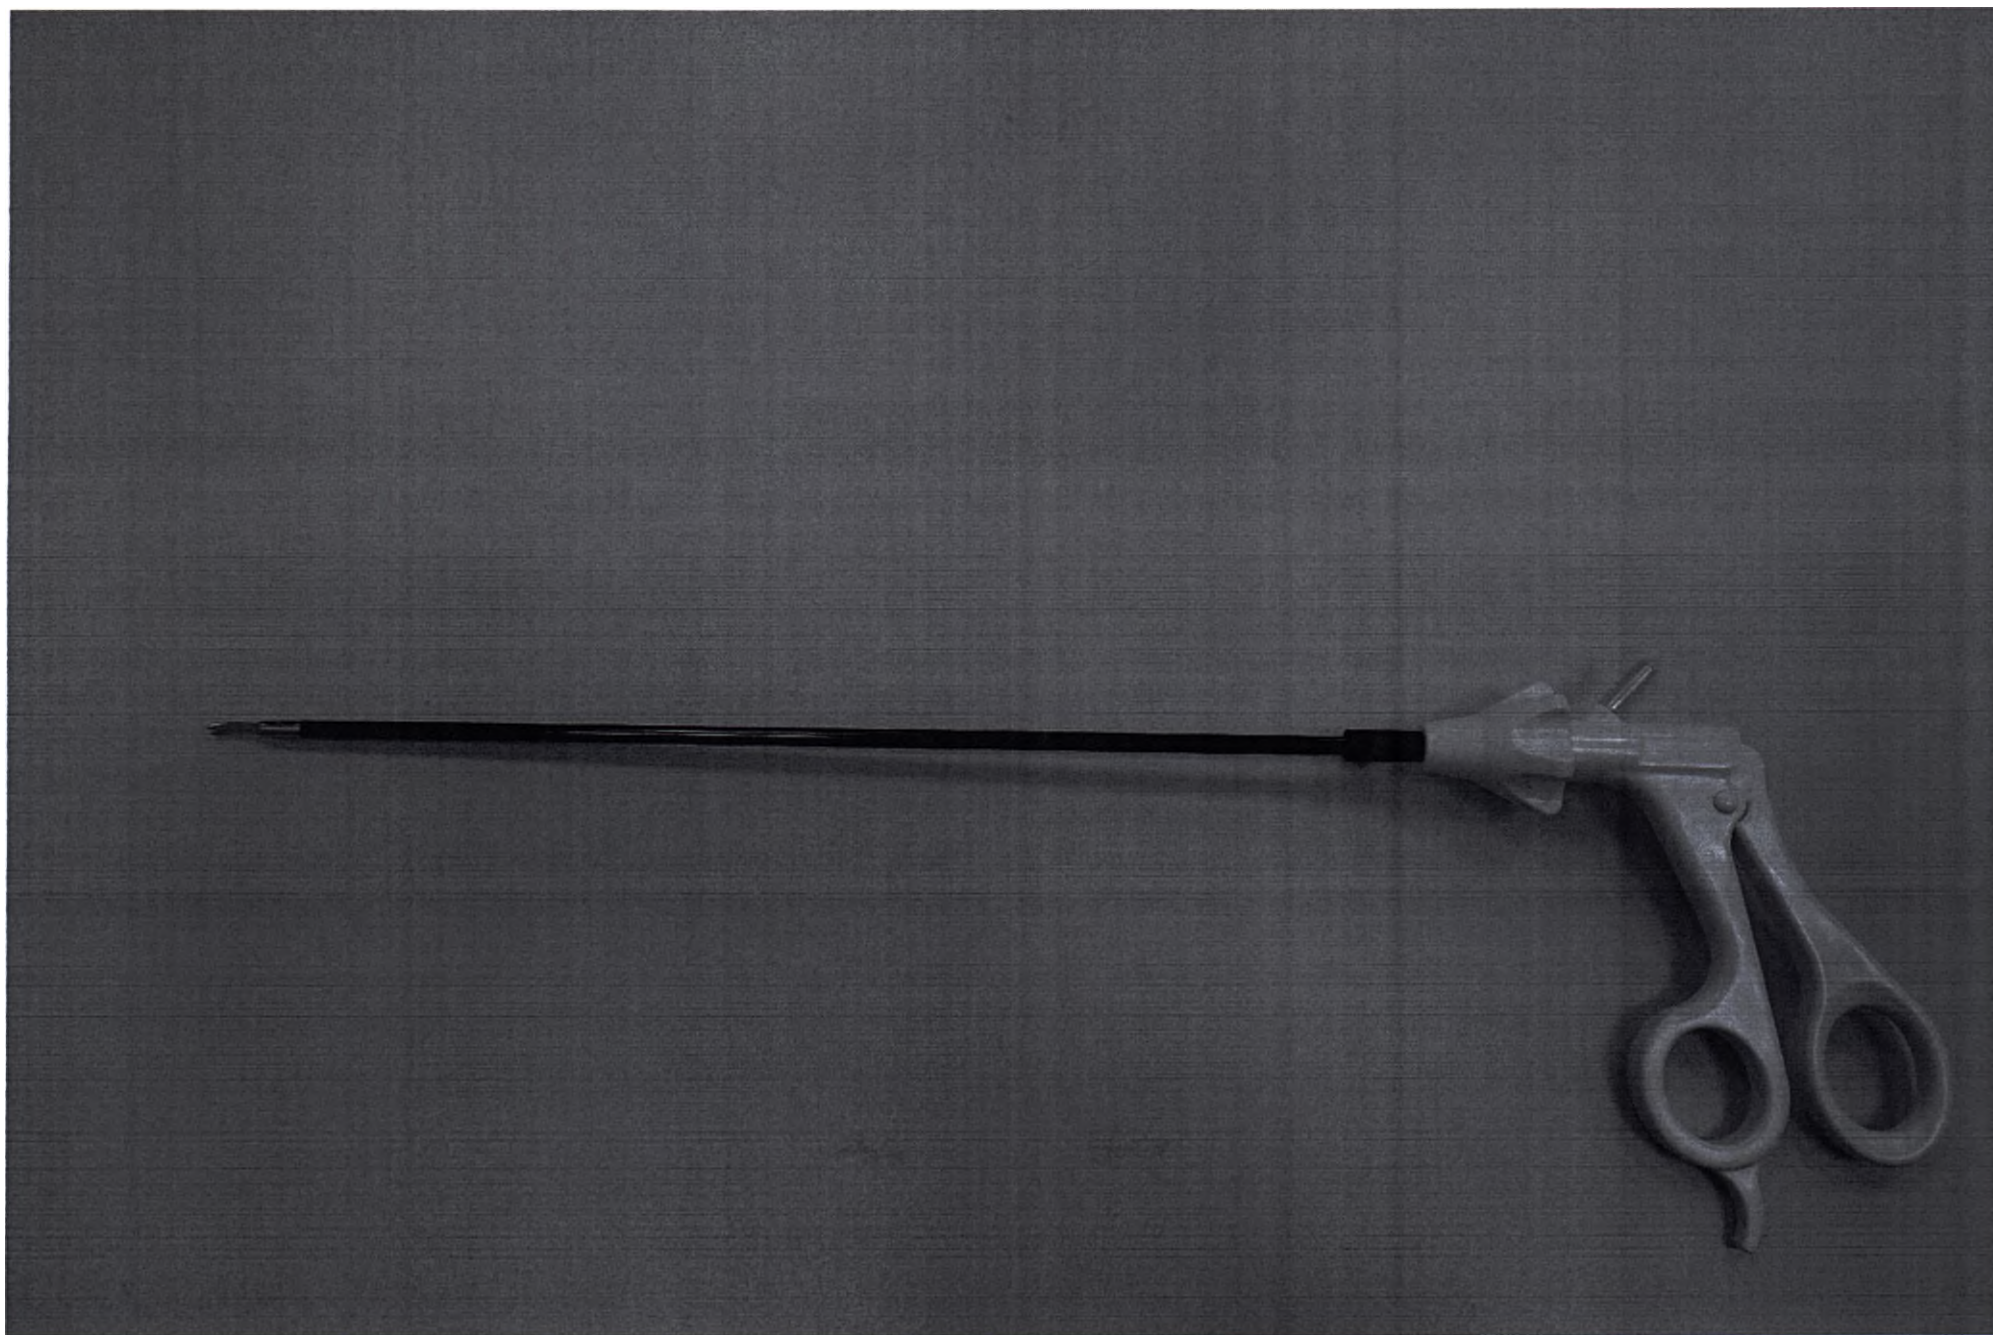




Рис. 16 Ножницы отщиповочные изогнутые по плоскости правые миниатюрные типа Митценбаум стерильные (без упаковки)



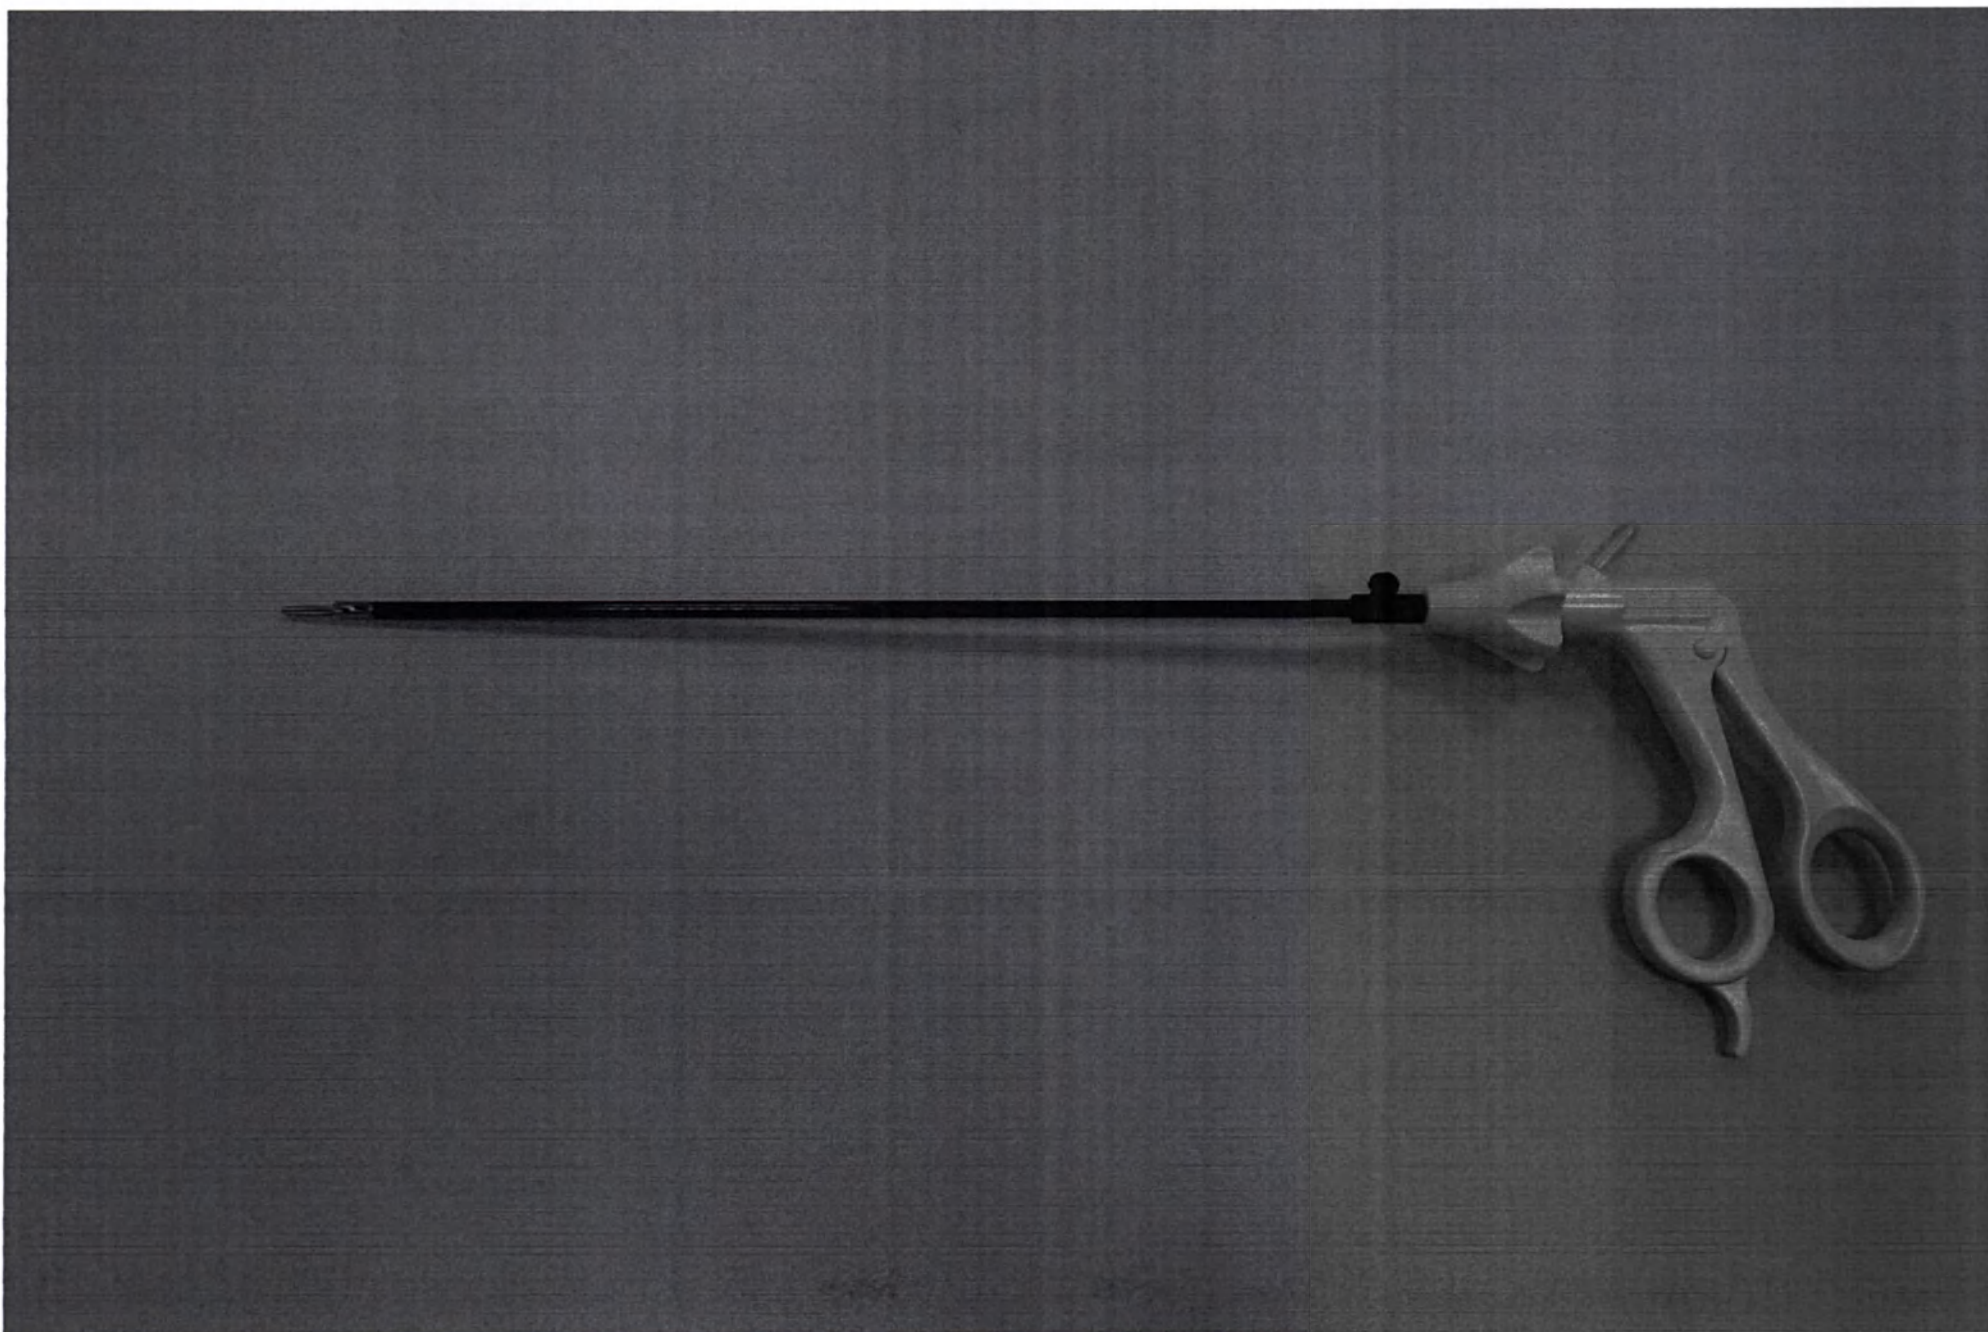
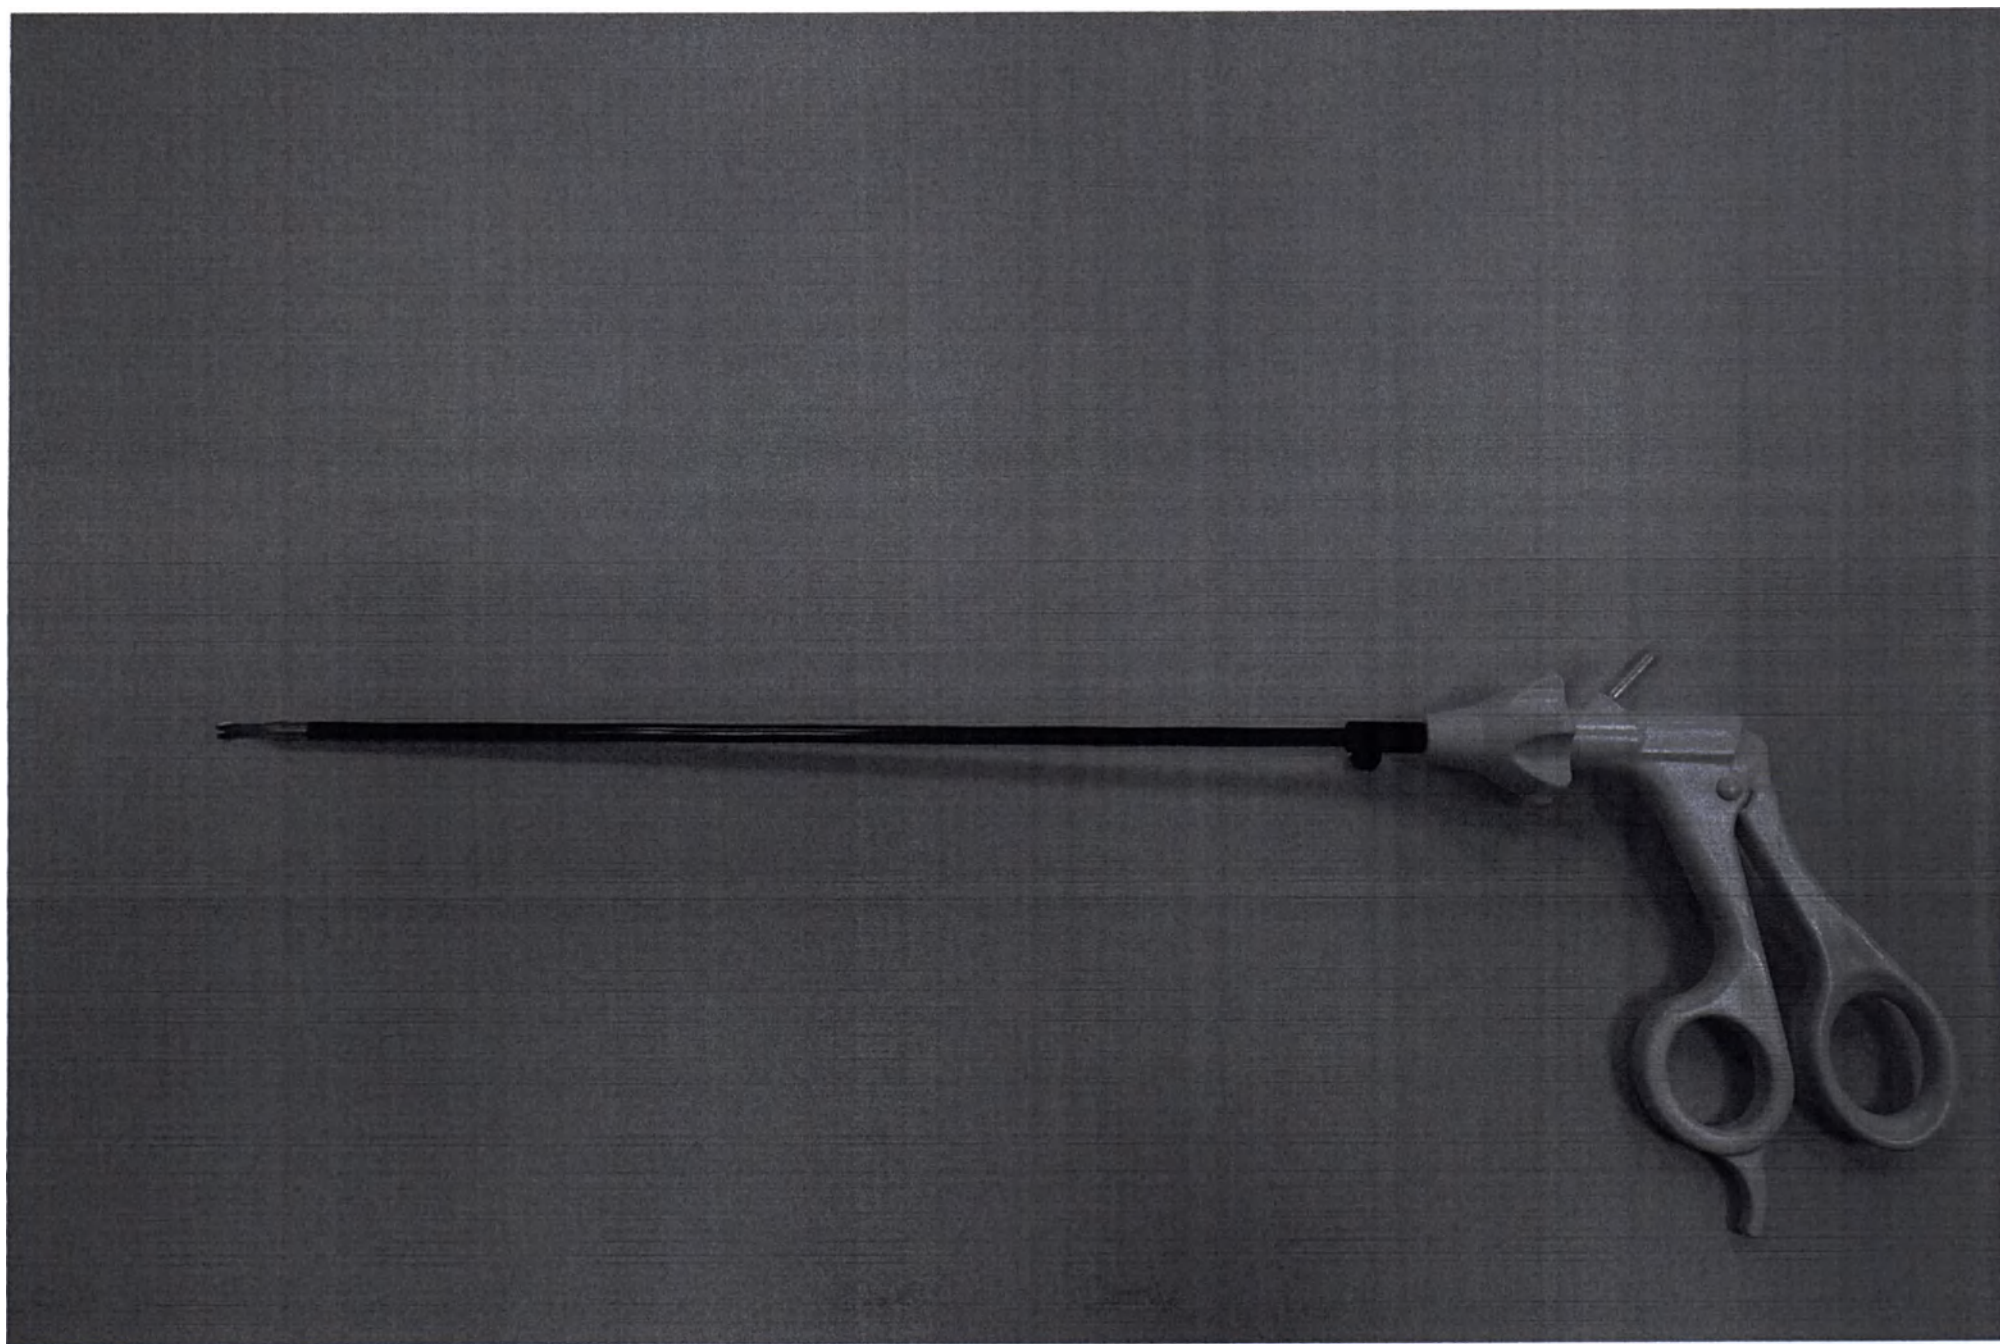


Рис 18 Ножницы двухбраншевые прямые типа Митценбаум стерильные (без упаковки)



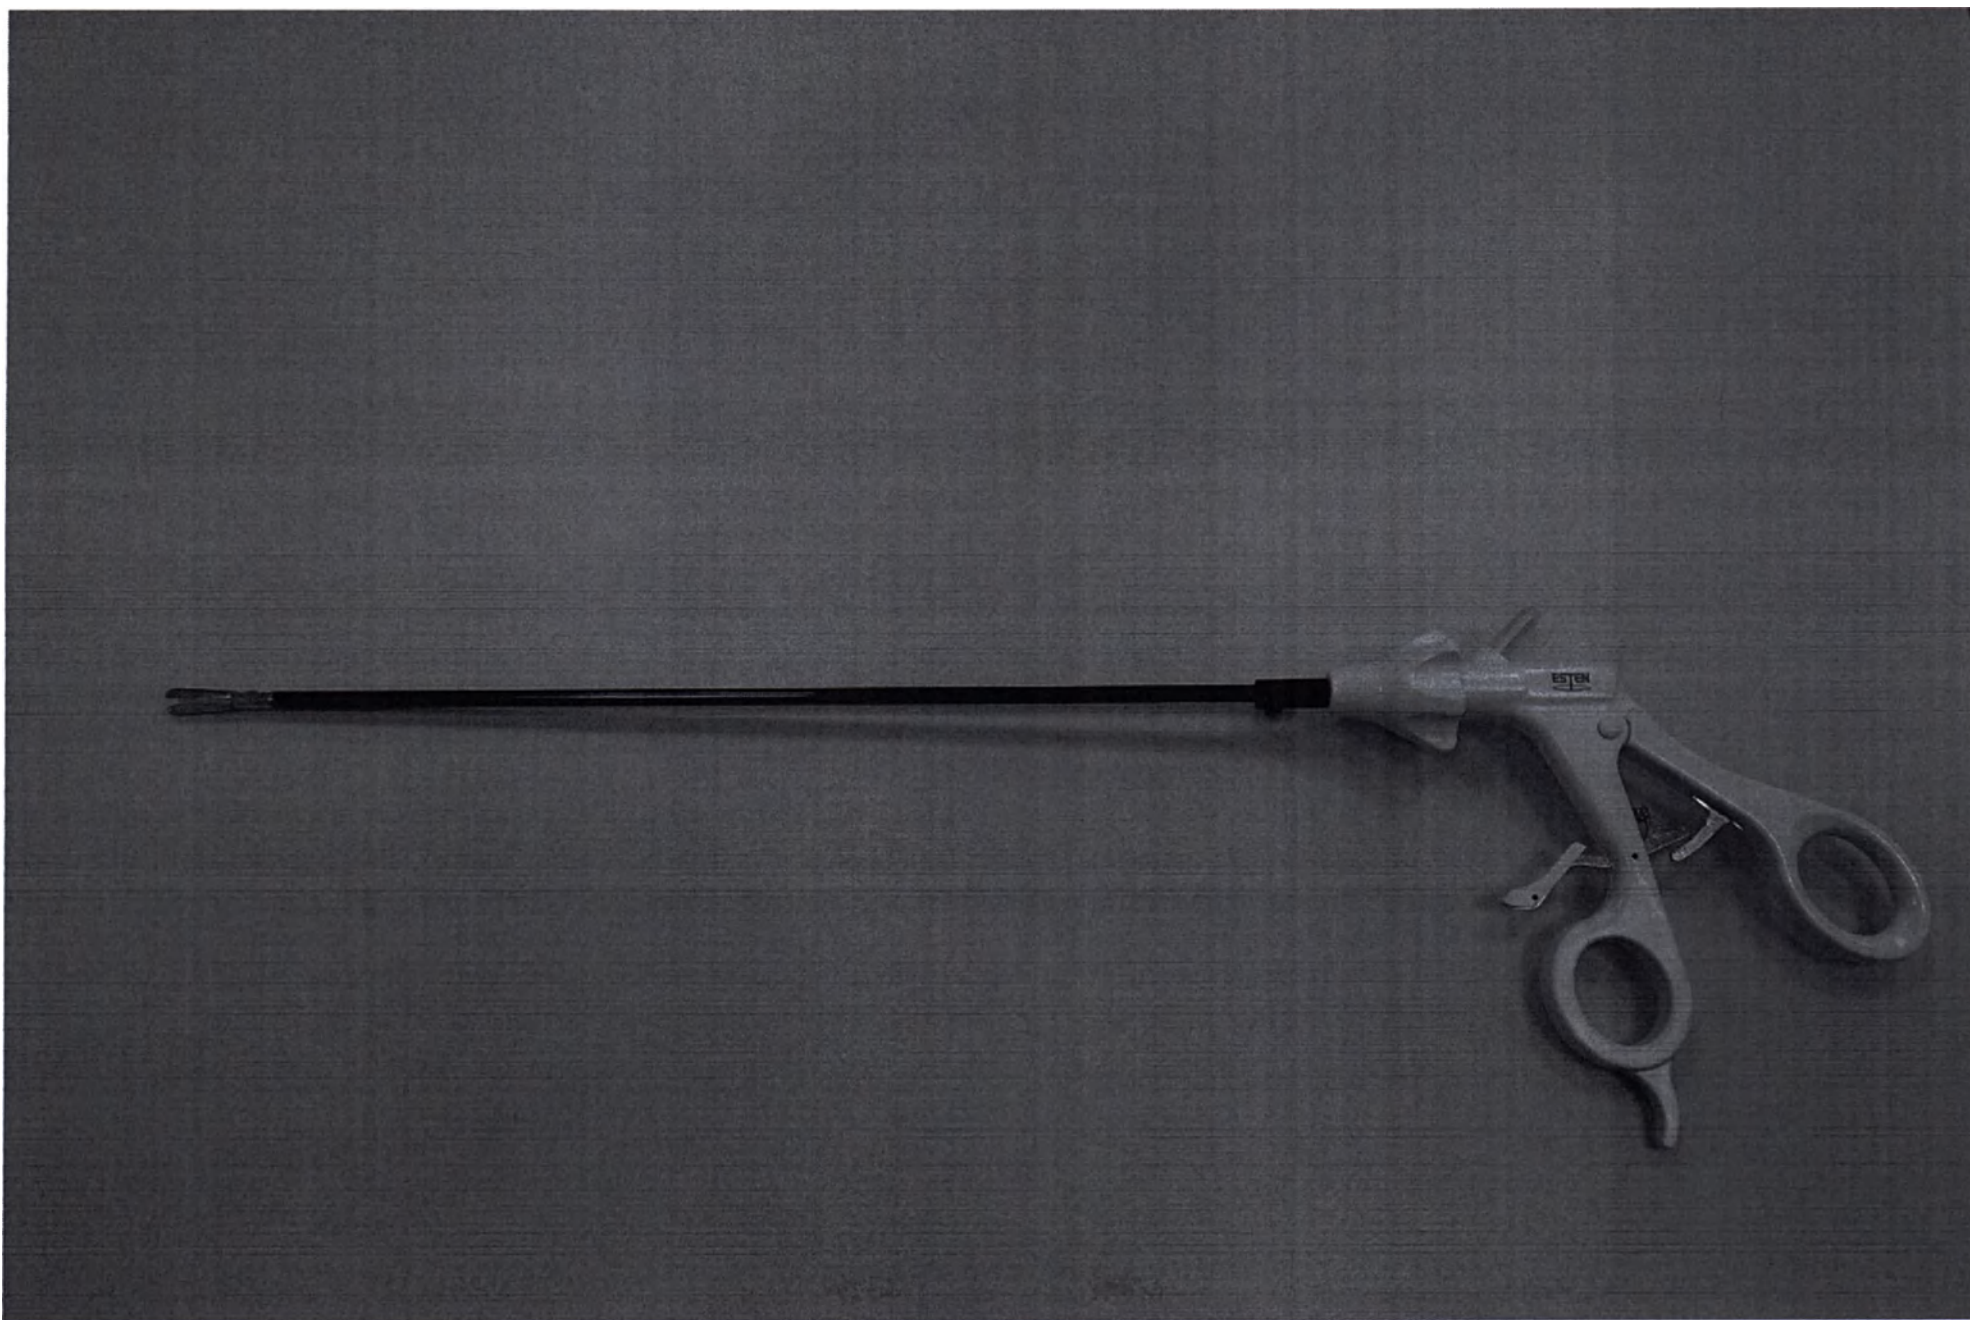


Рис.20 Зажим хирургический стерильный (без упаковки)

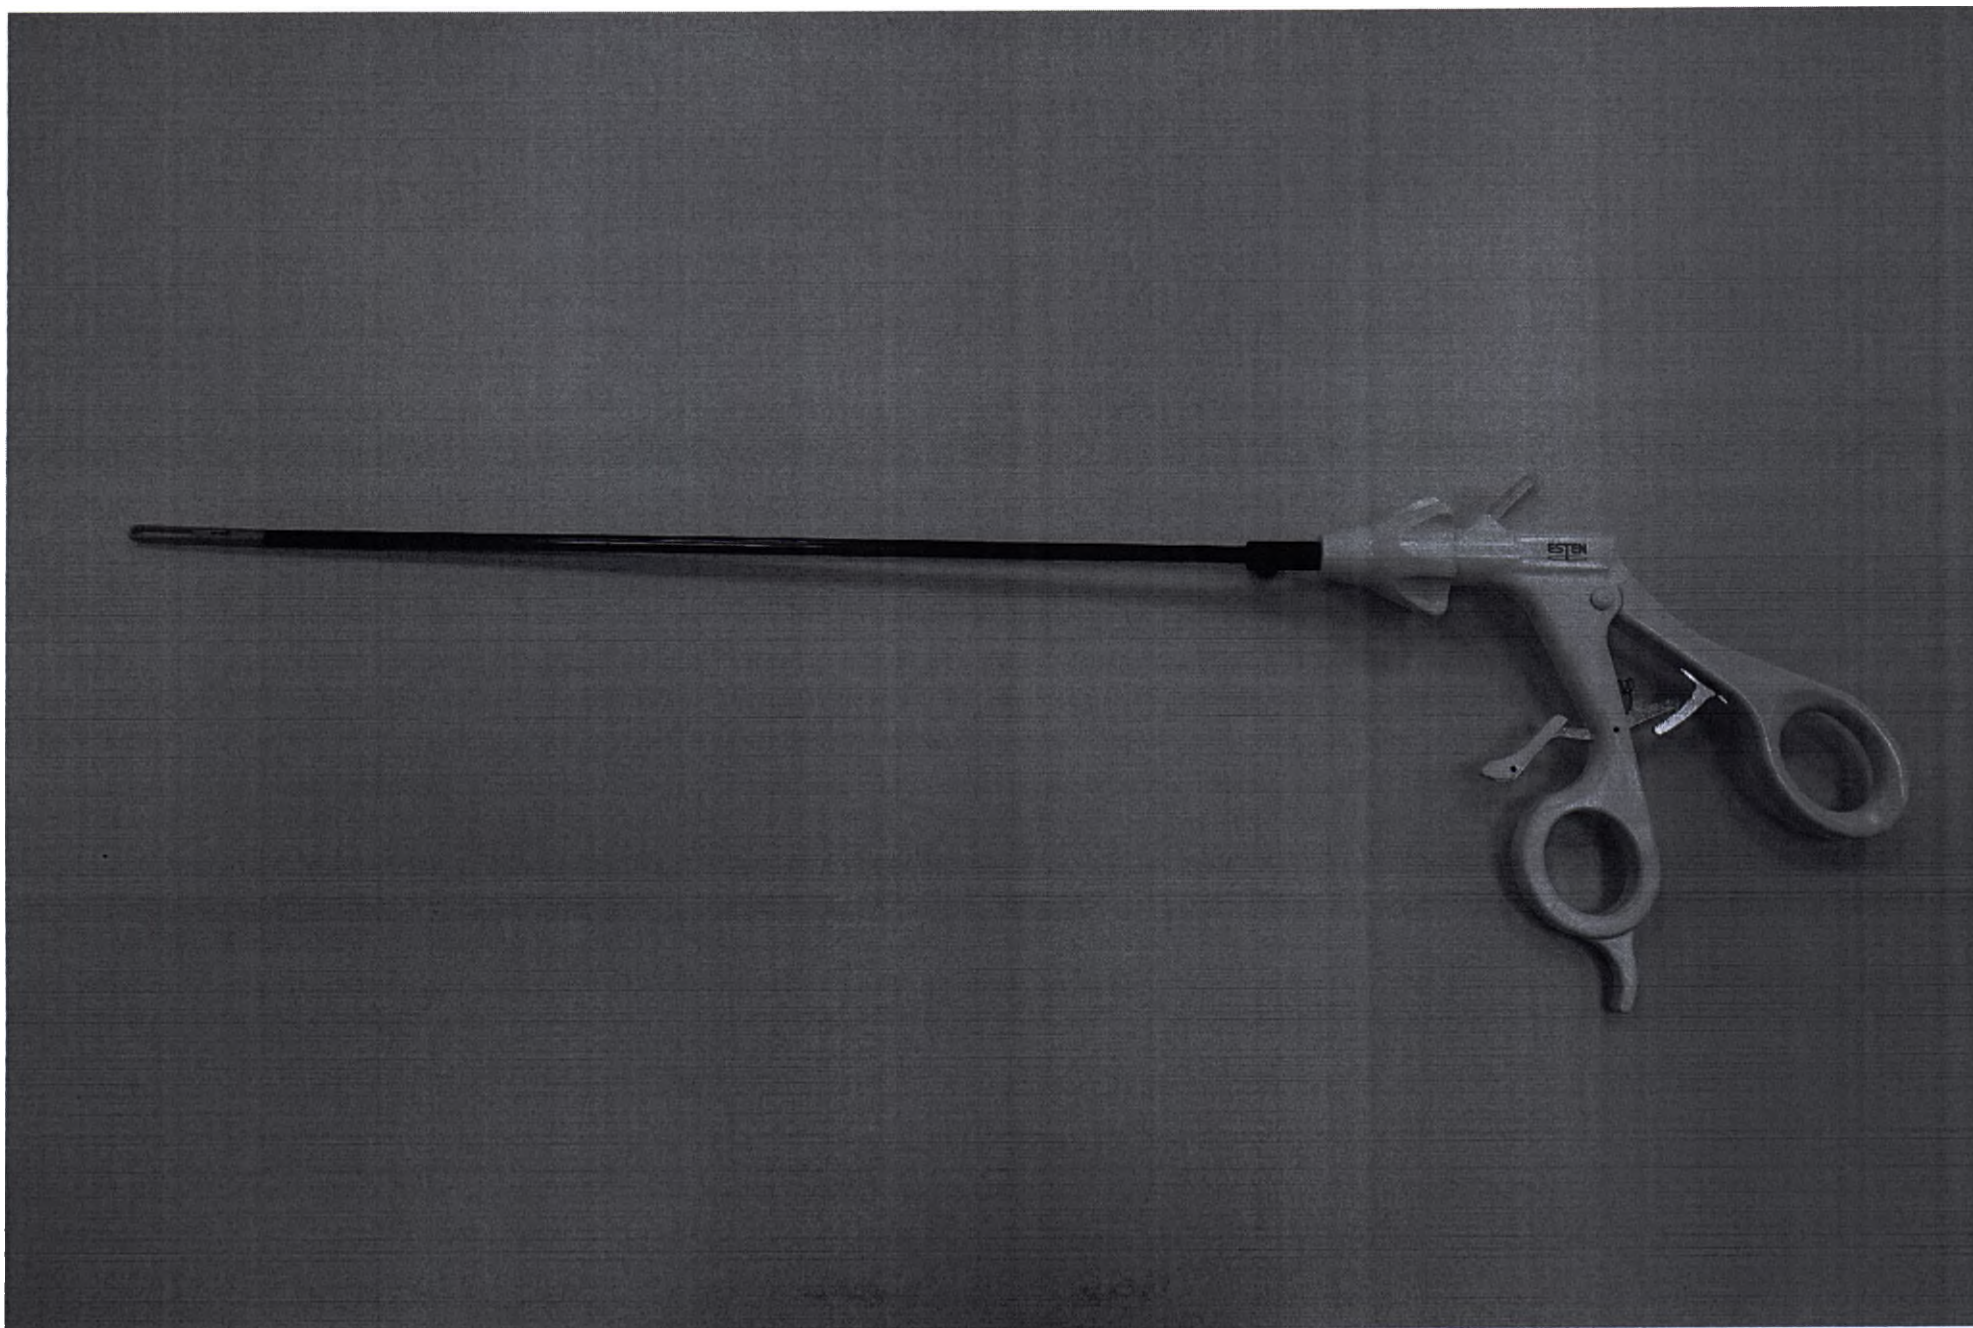


Рис.21 Зажим окончательный стерильный (без упаковки)

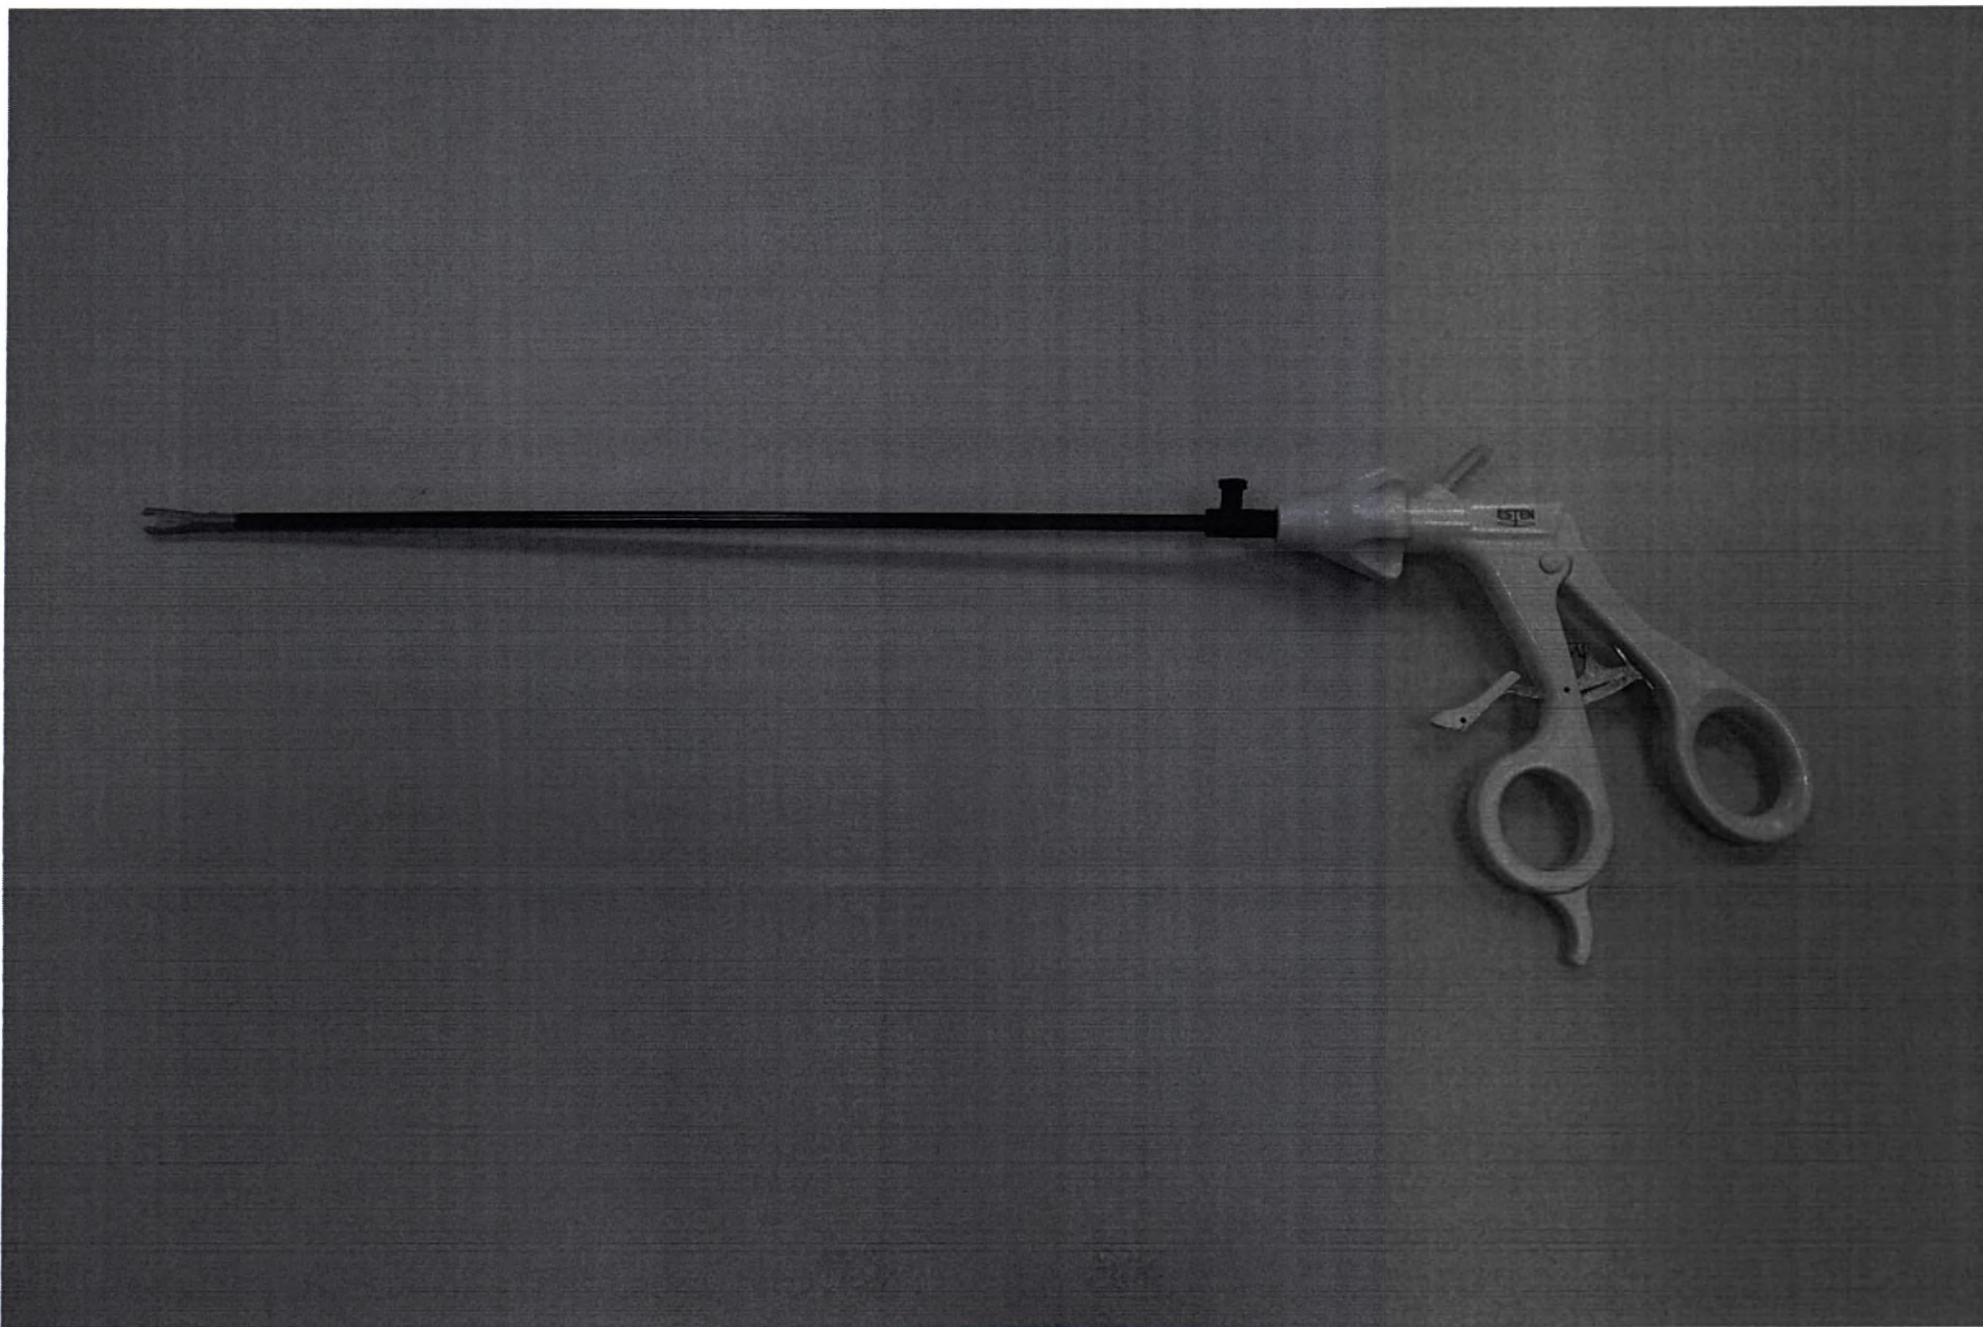


Рис.22 Зажим типа Аллис стерильный (без упаковки)

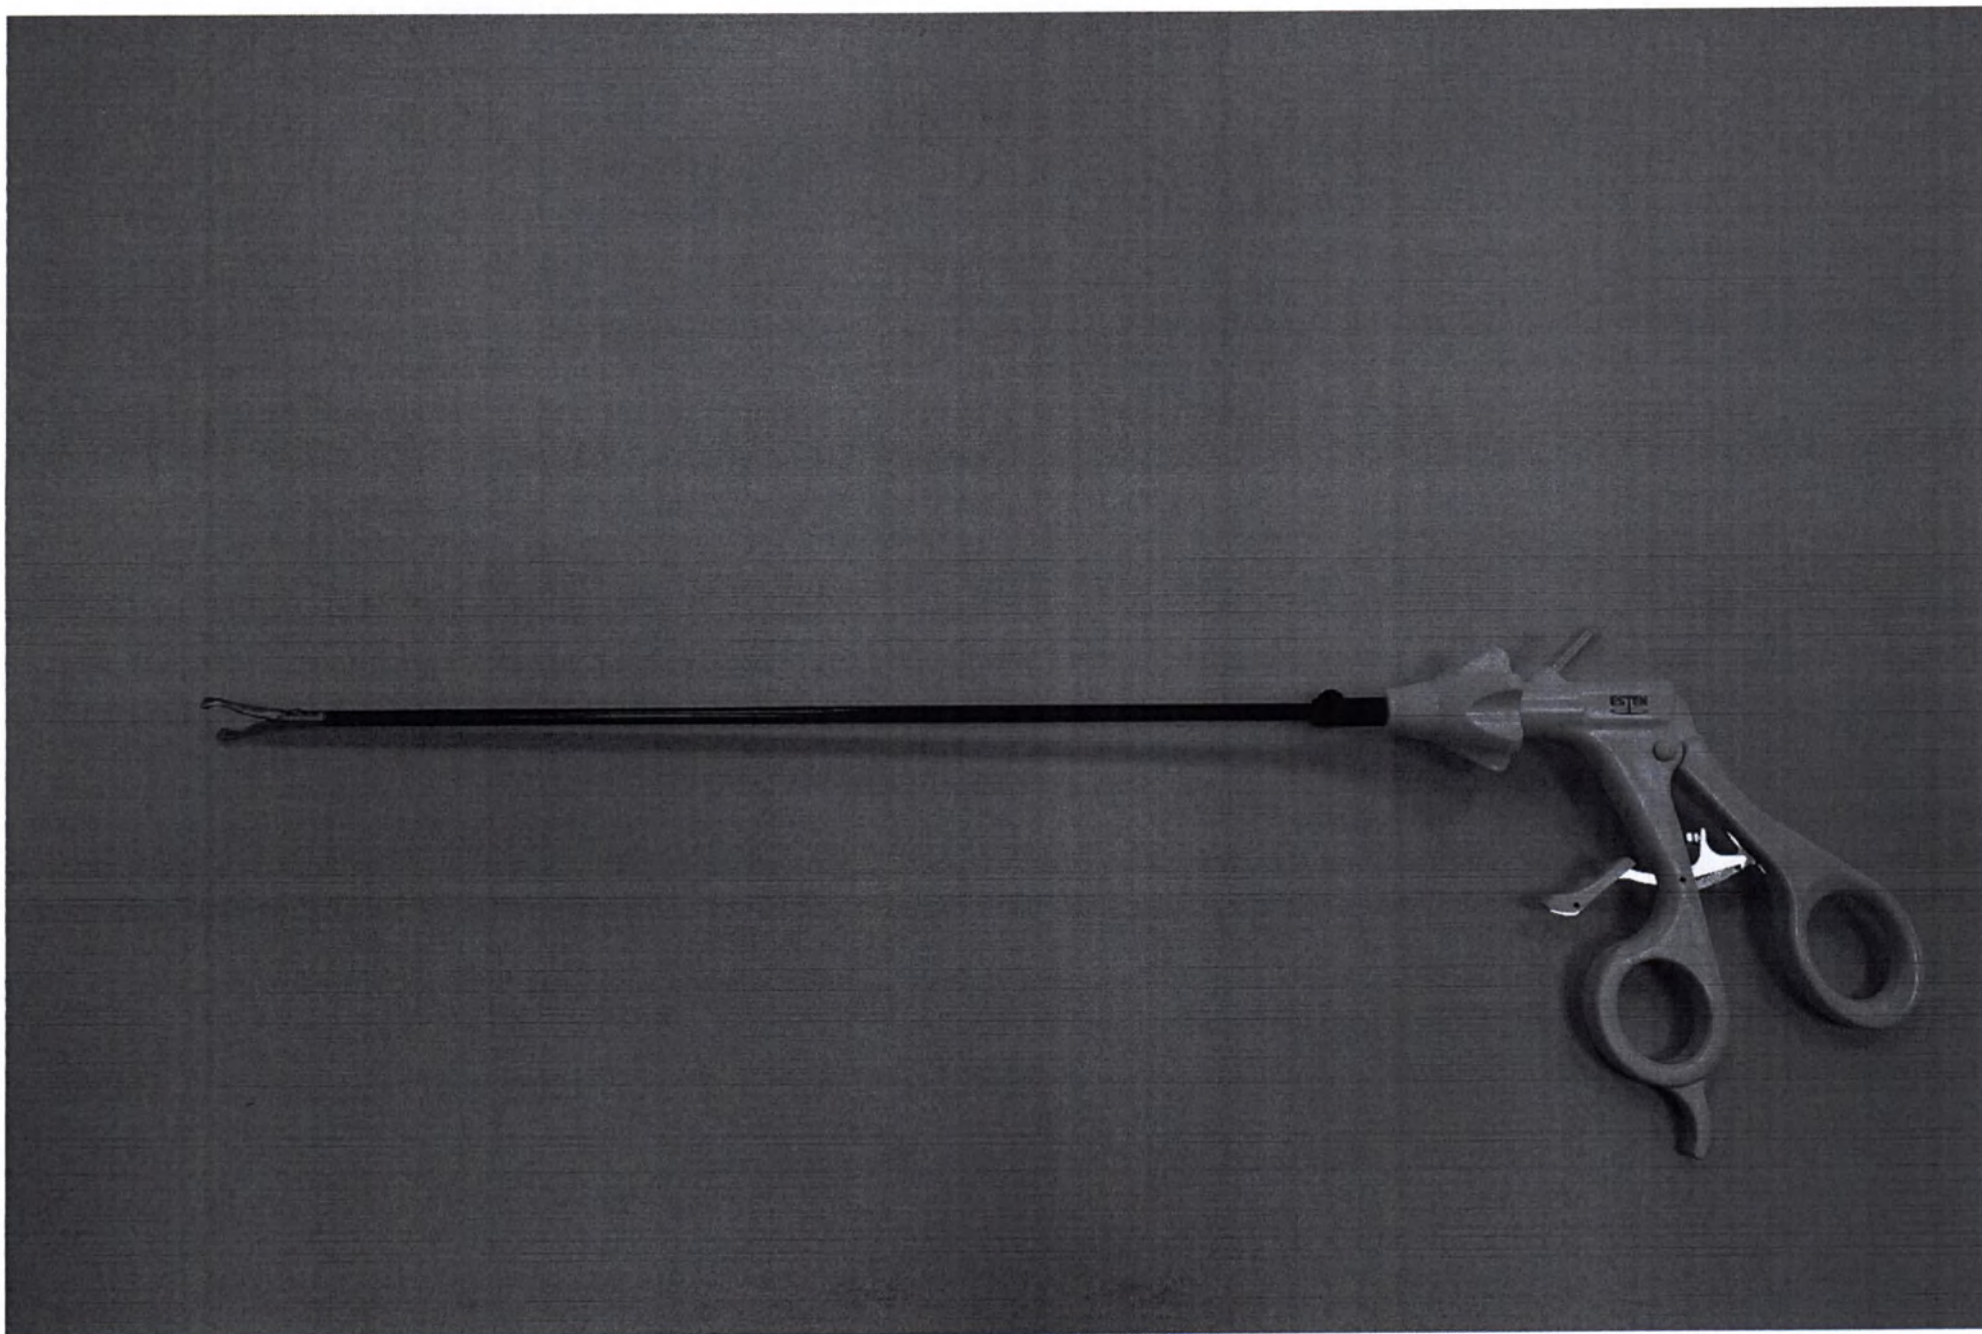


Рис.23 Зажим типа Бэбкок стерильный (без упаковки)

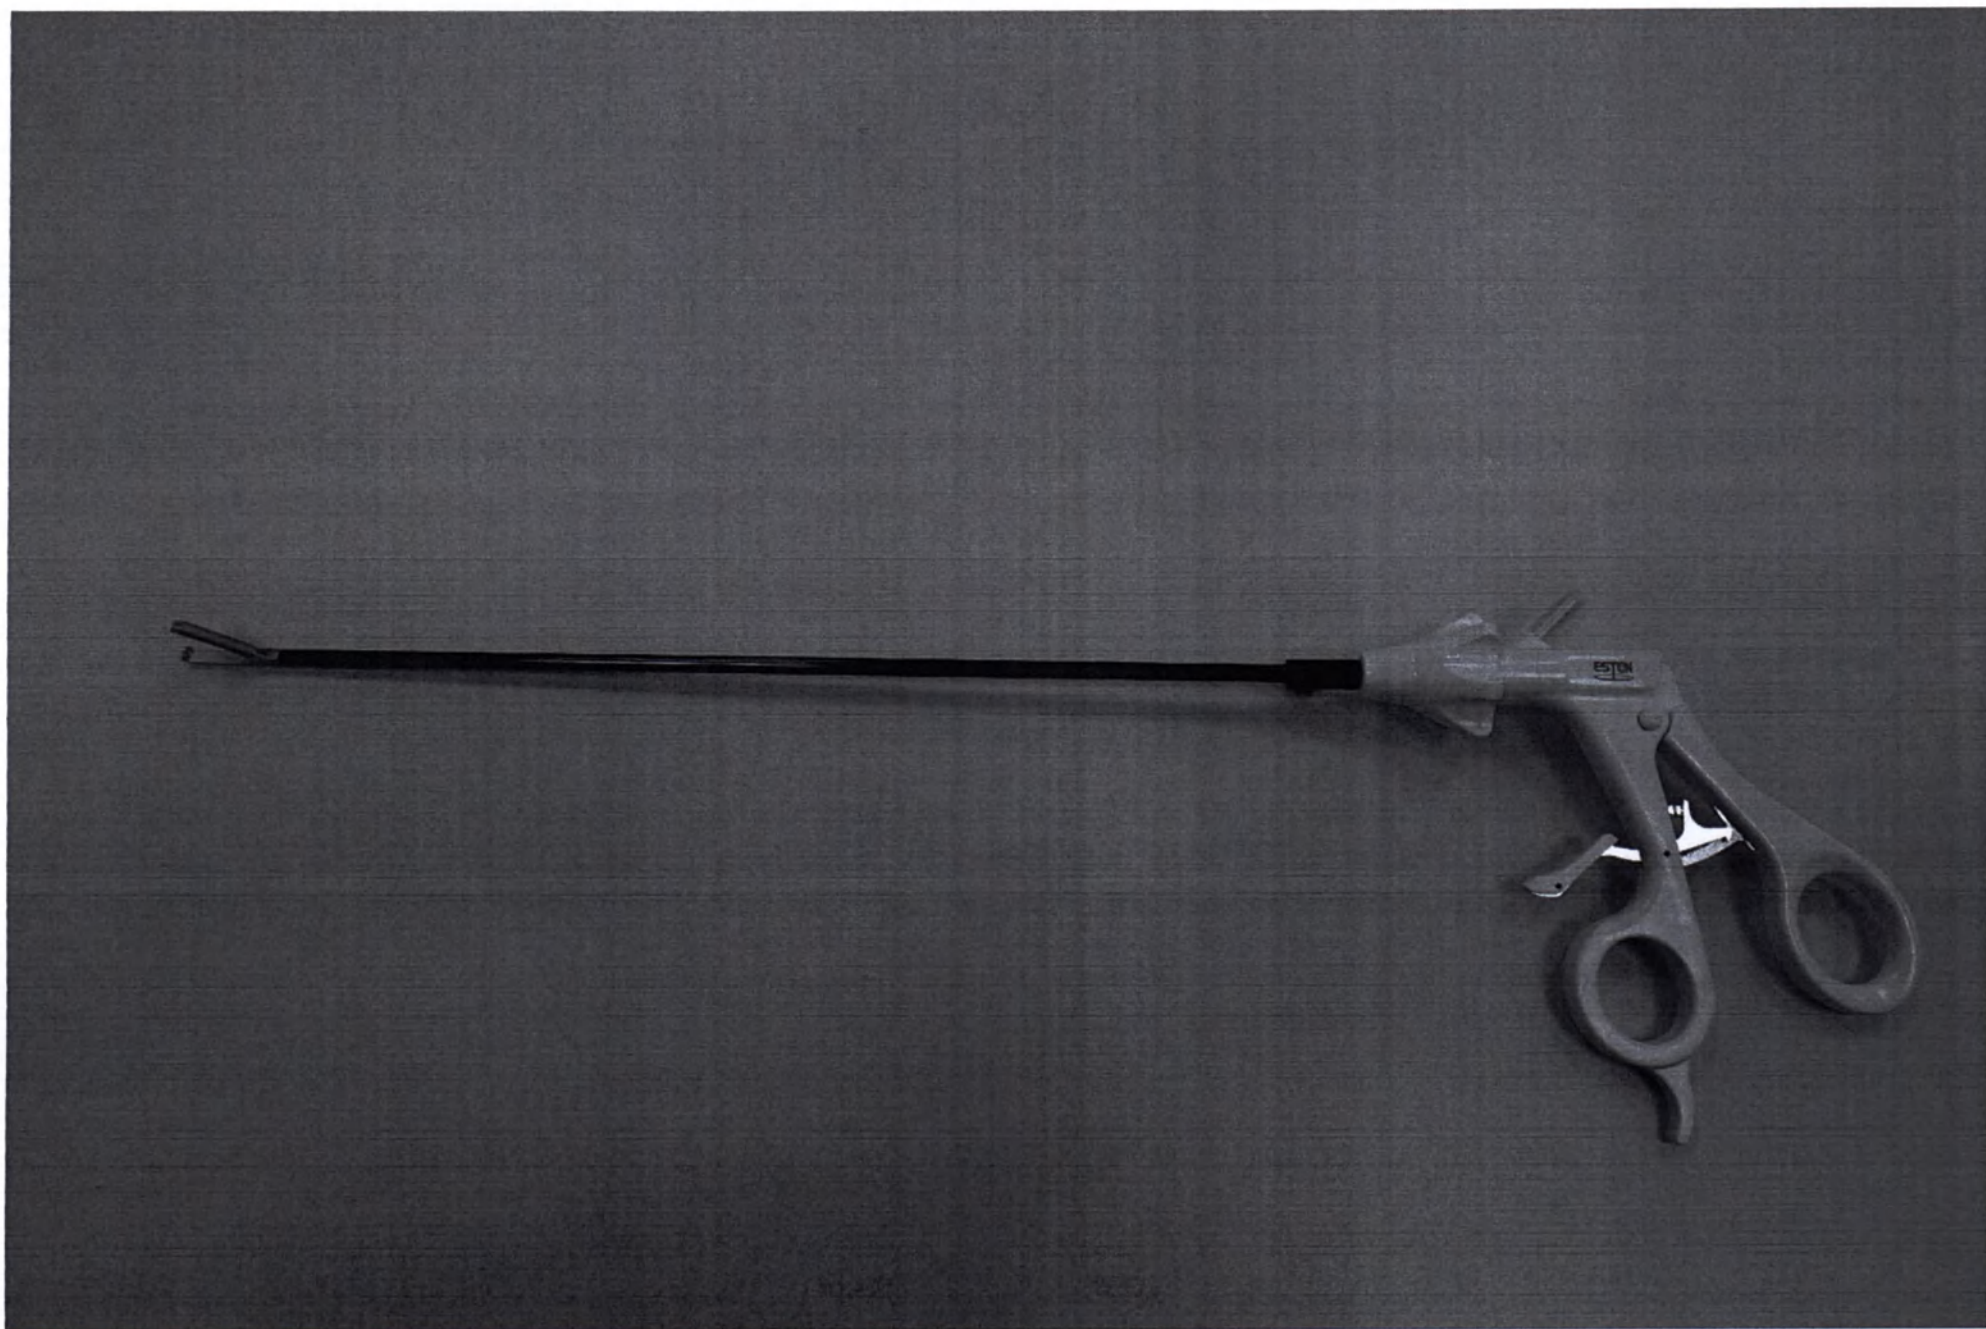


Рис.24 Зажим когтевой стерильный (без упаковки)

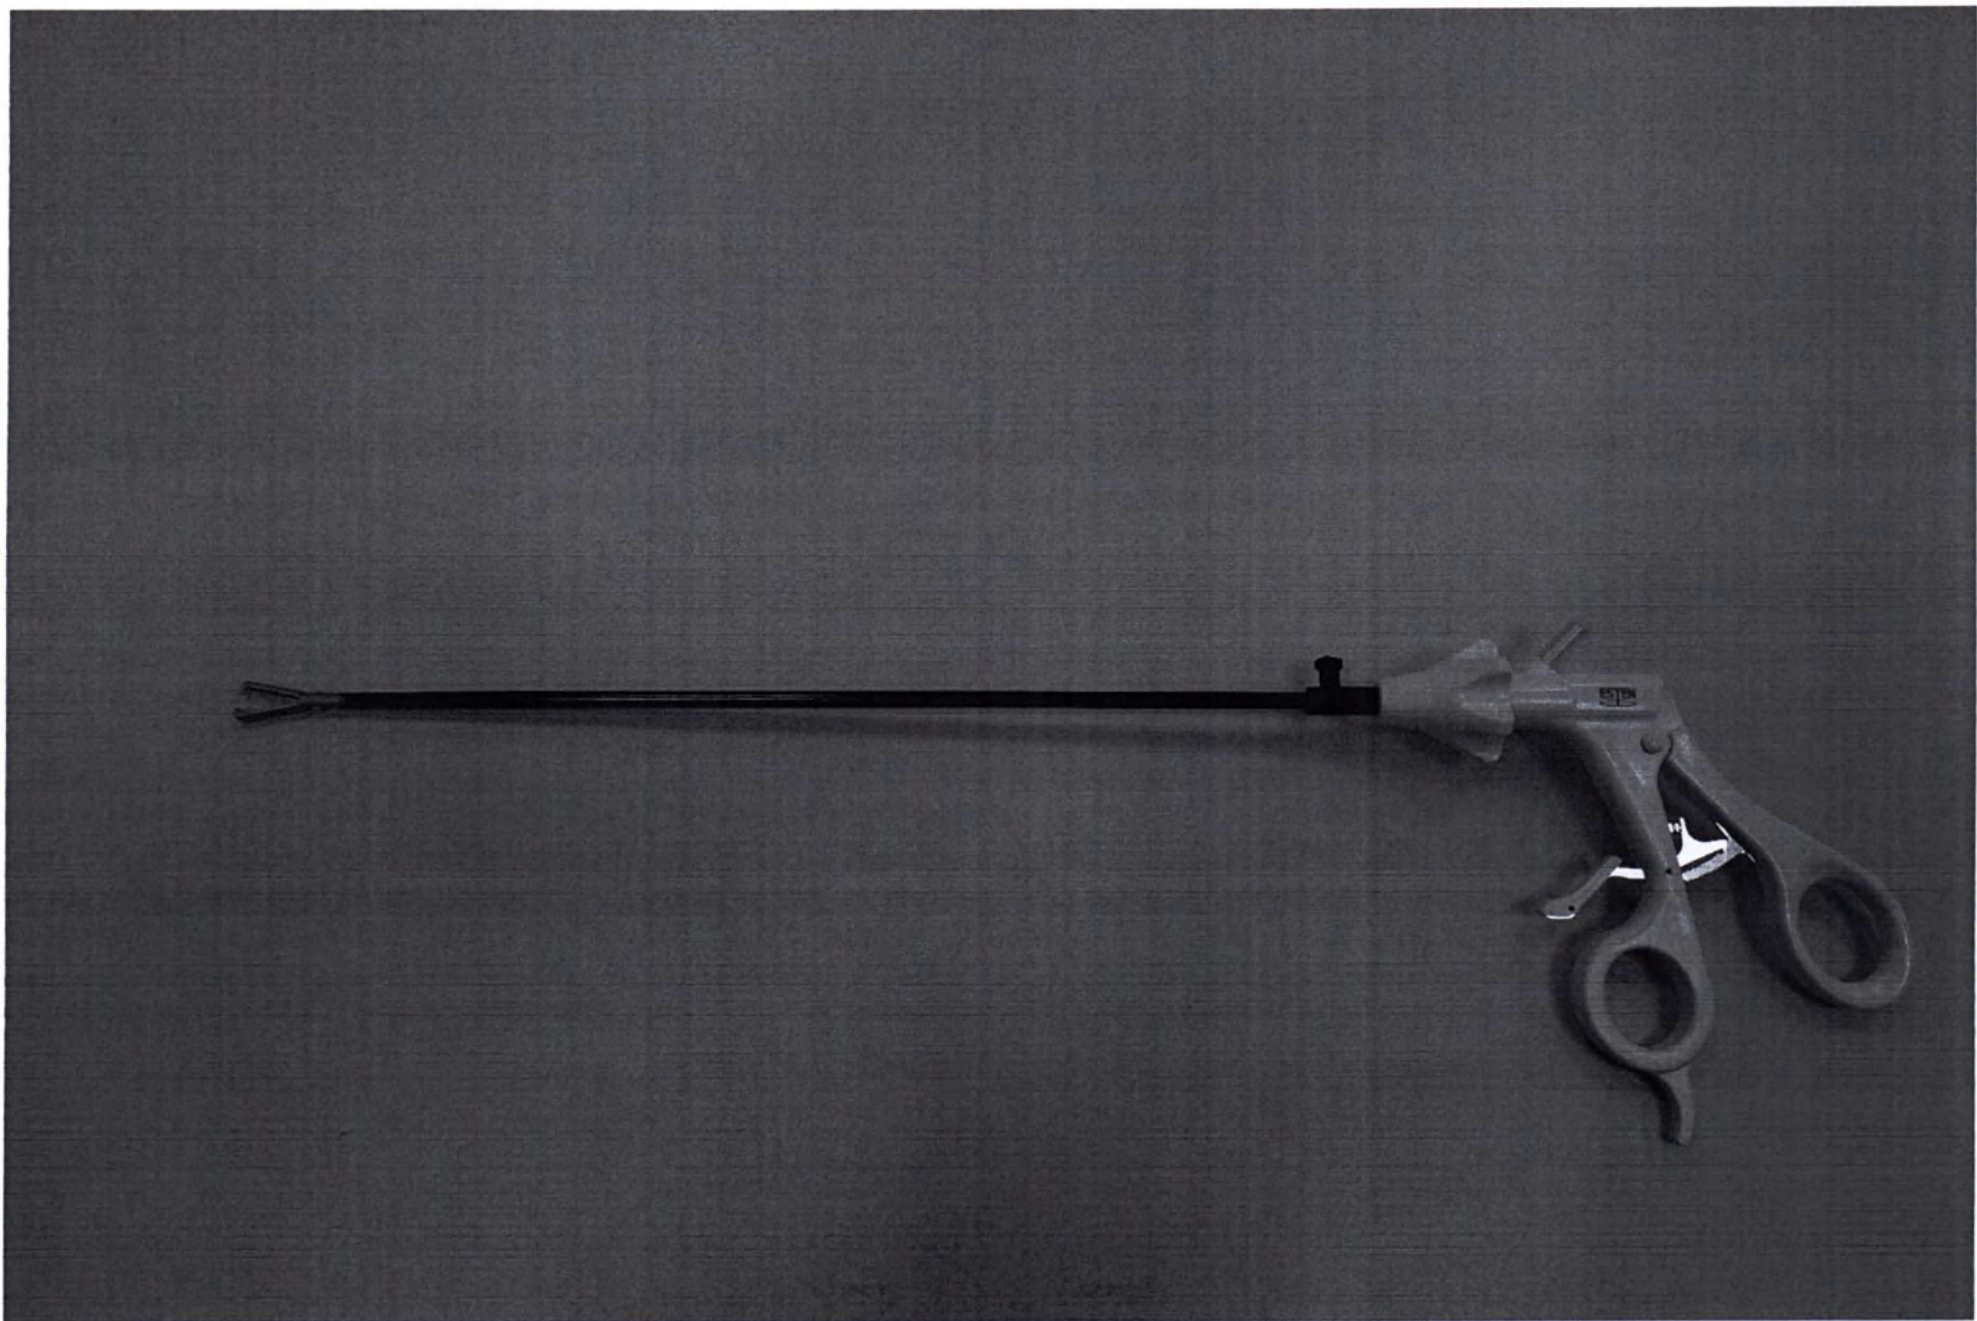


Рис.25 Зажим «кобра» 2х3 зубый зубчатый стерильный (без упаковки)

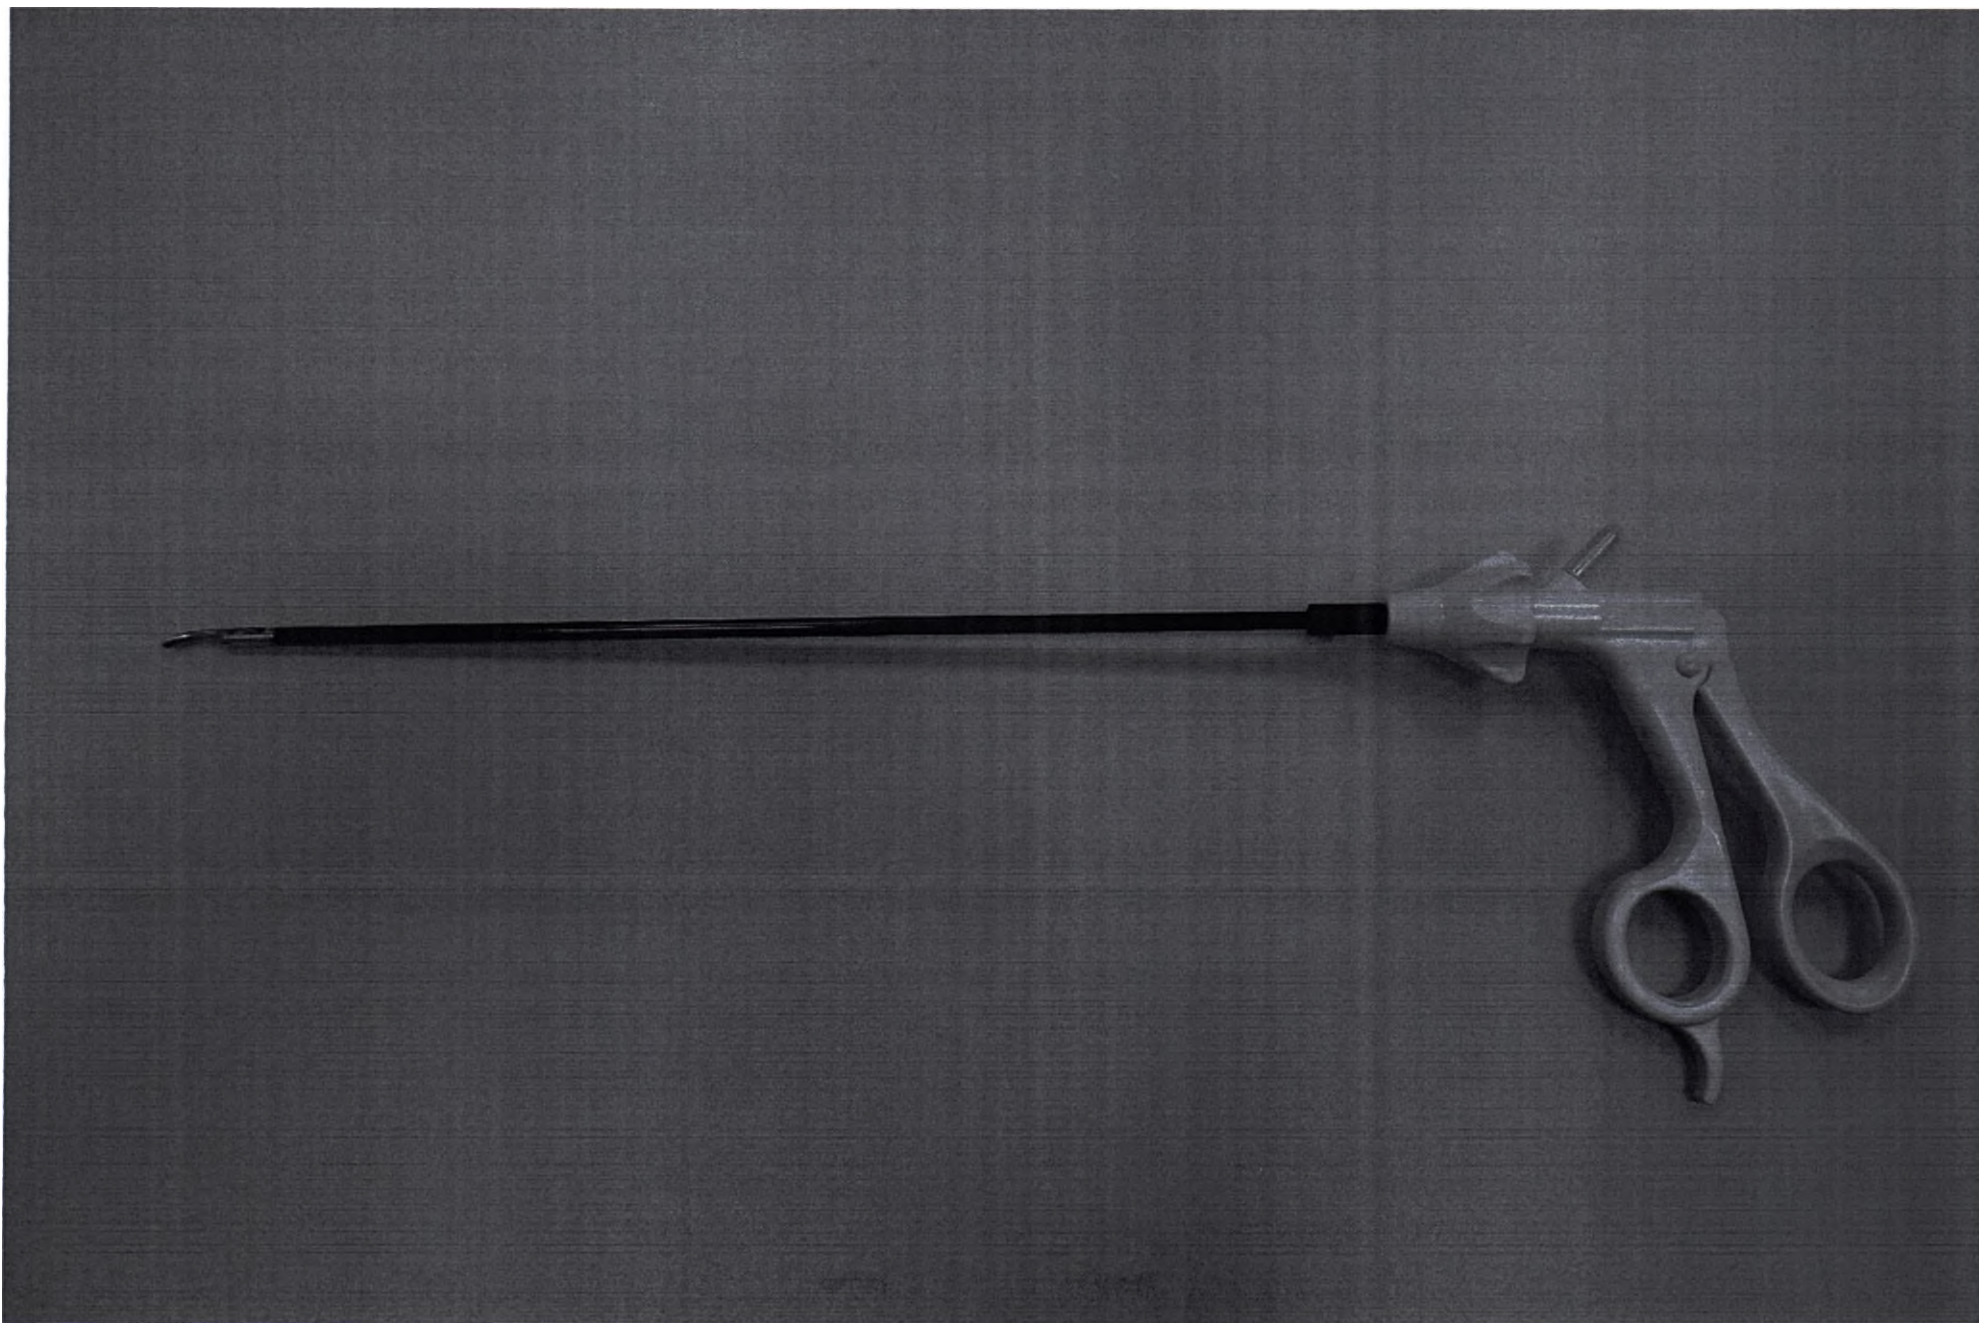


Рис.26 Диссектор типа Мэриленд стерильный (без упаковки)

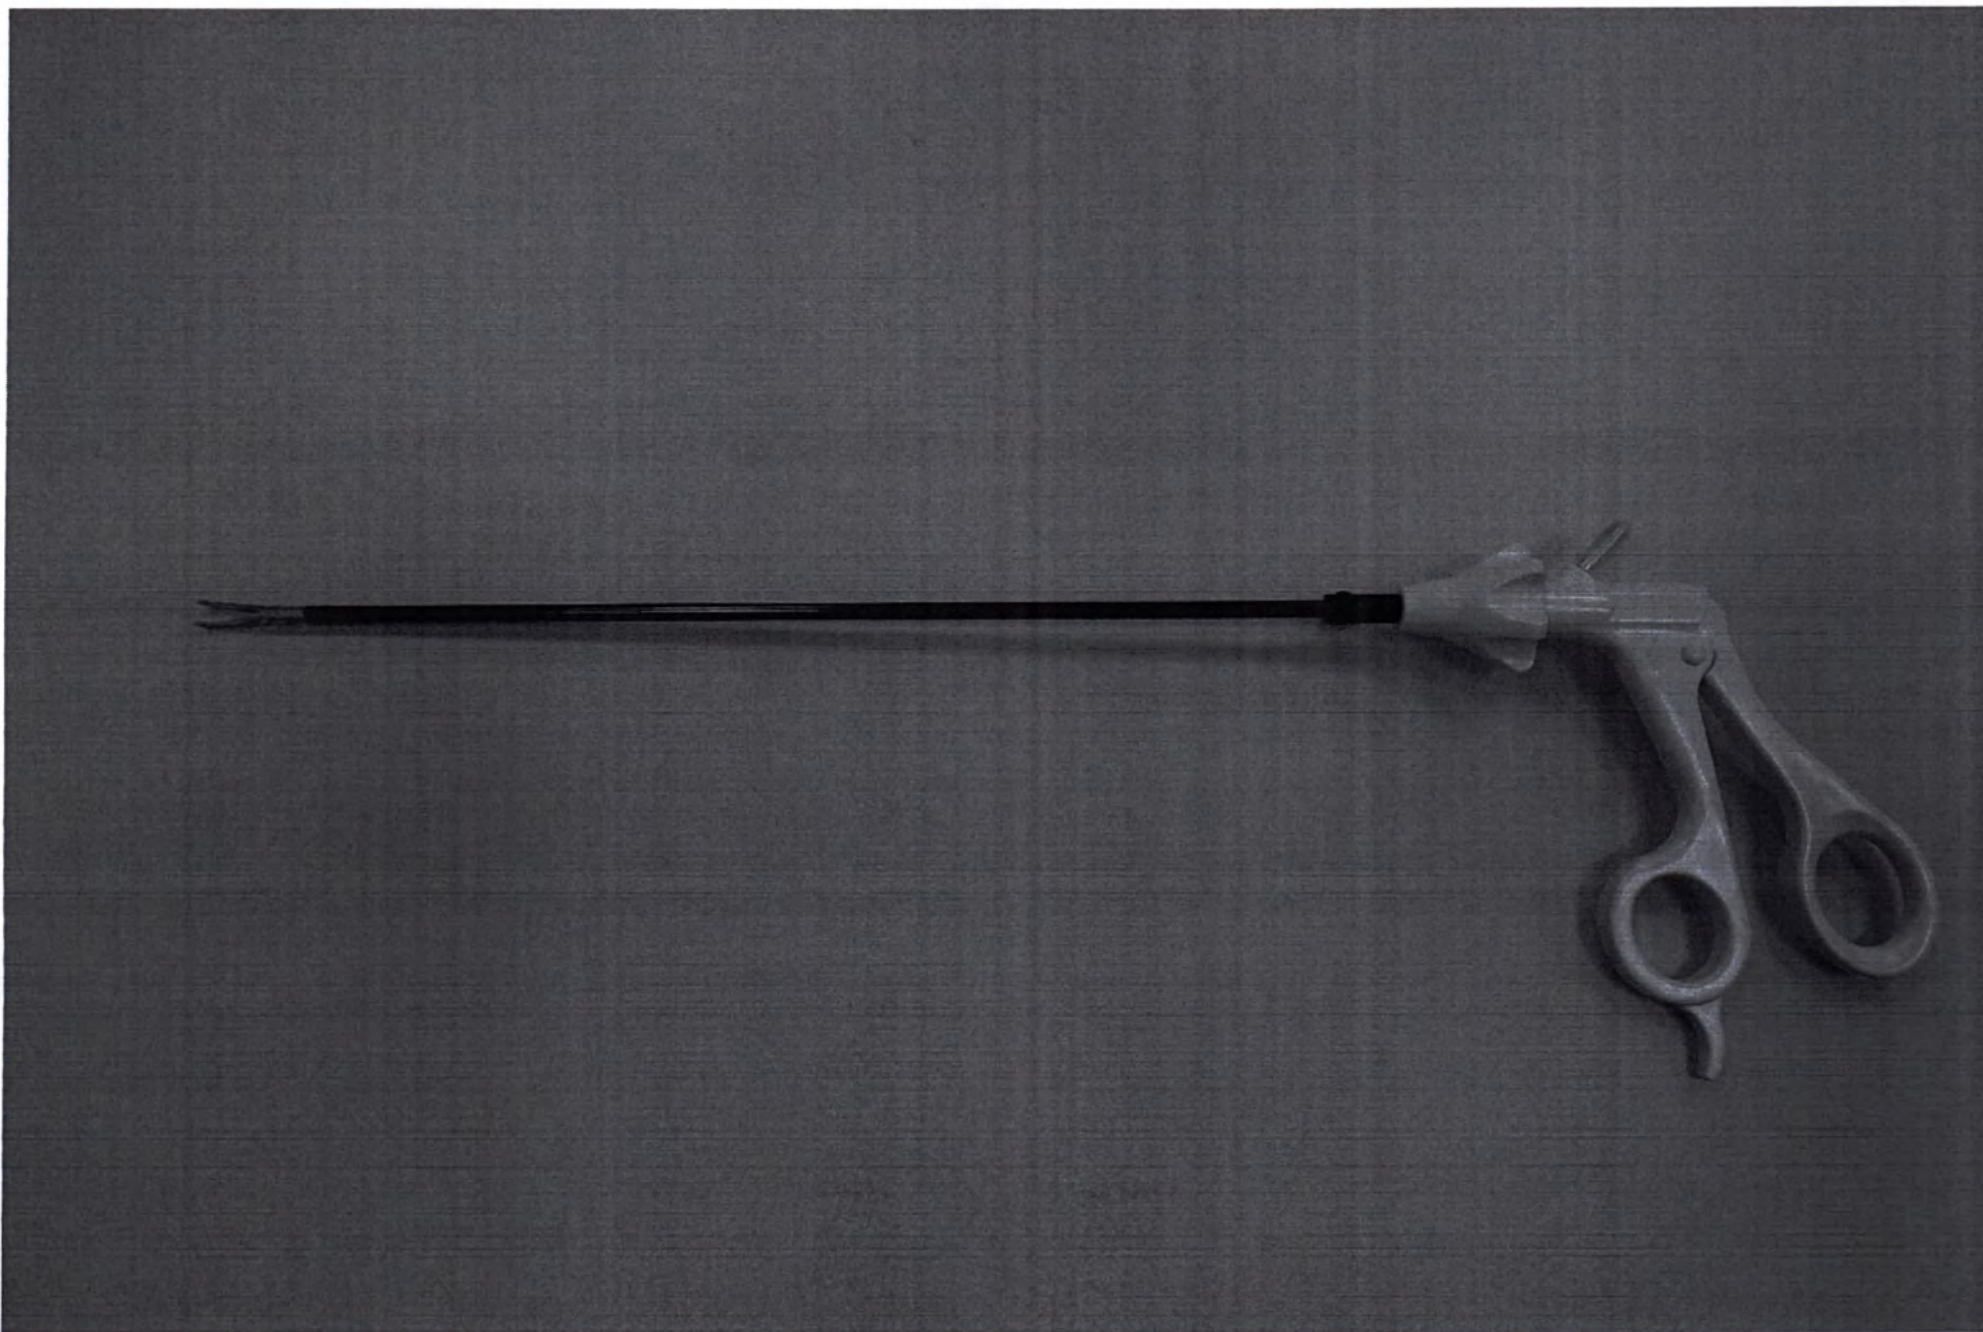
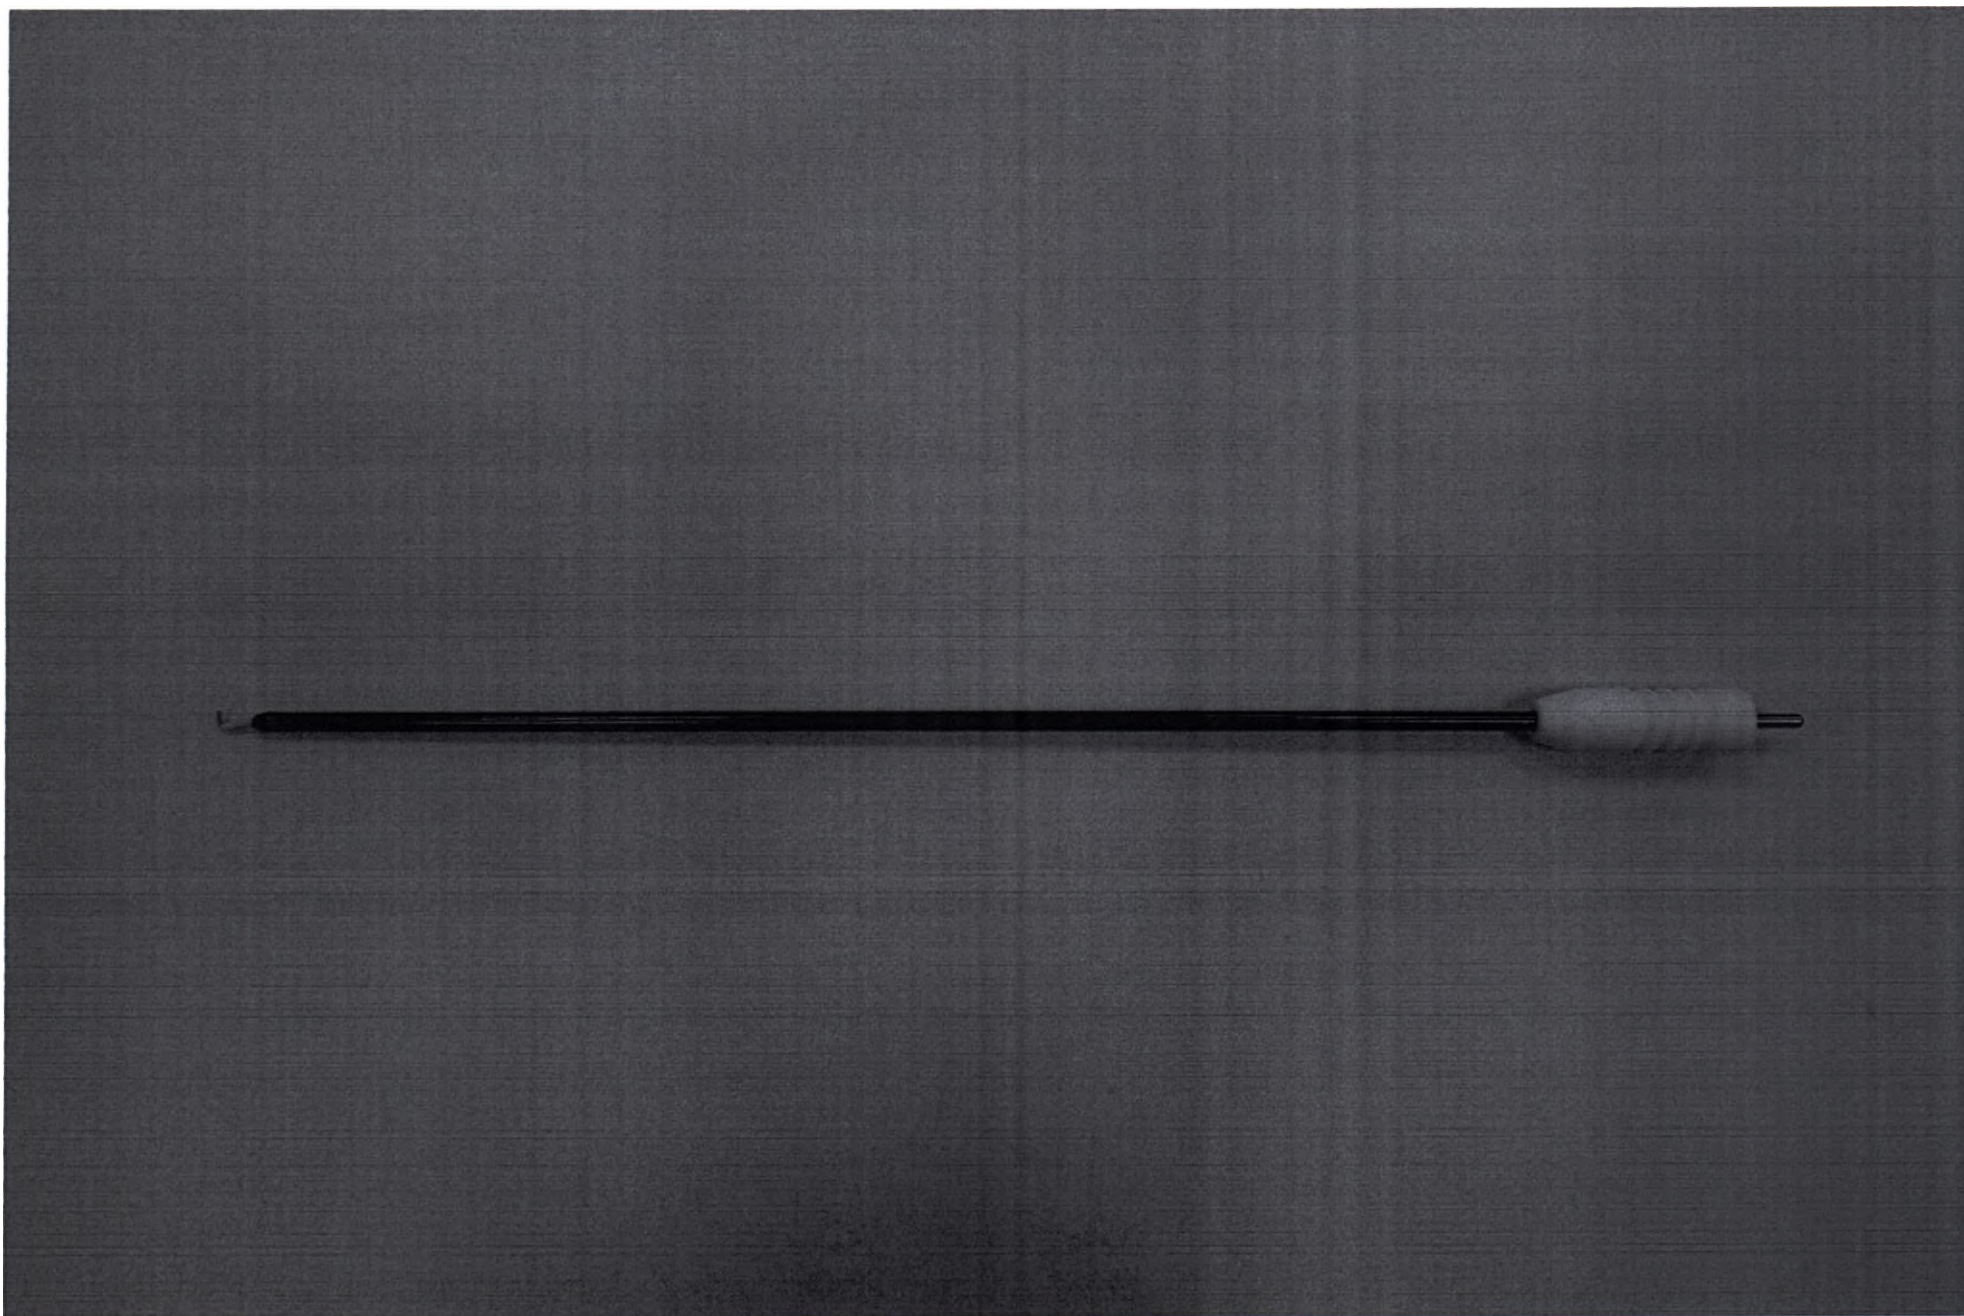


Рис 27 Лиссектор изогнутый под углом 90° типа Микстер стерильный (без упаковки)



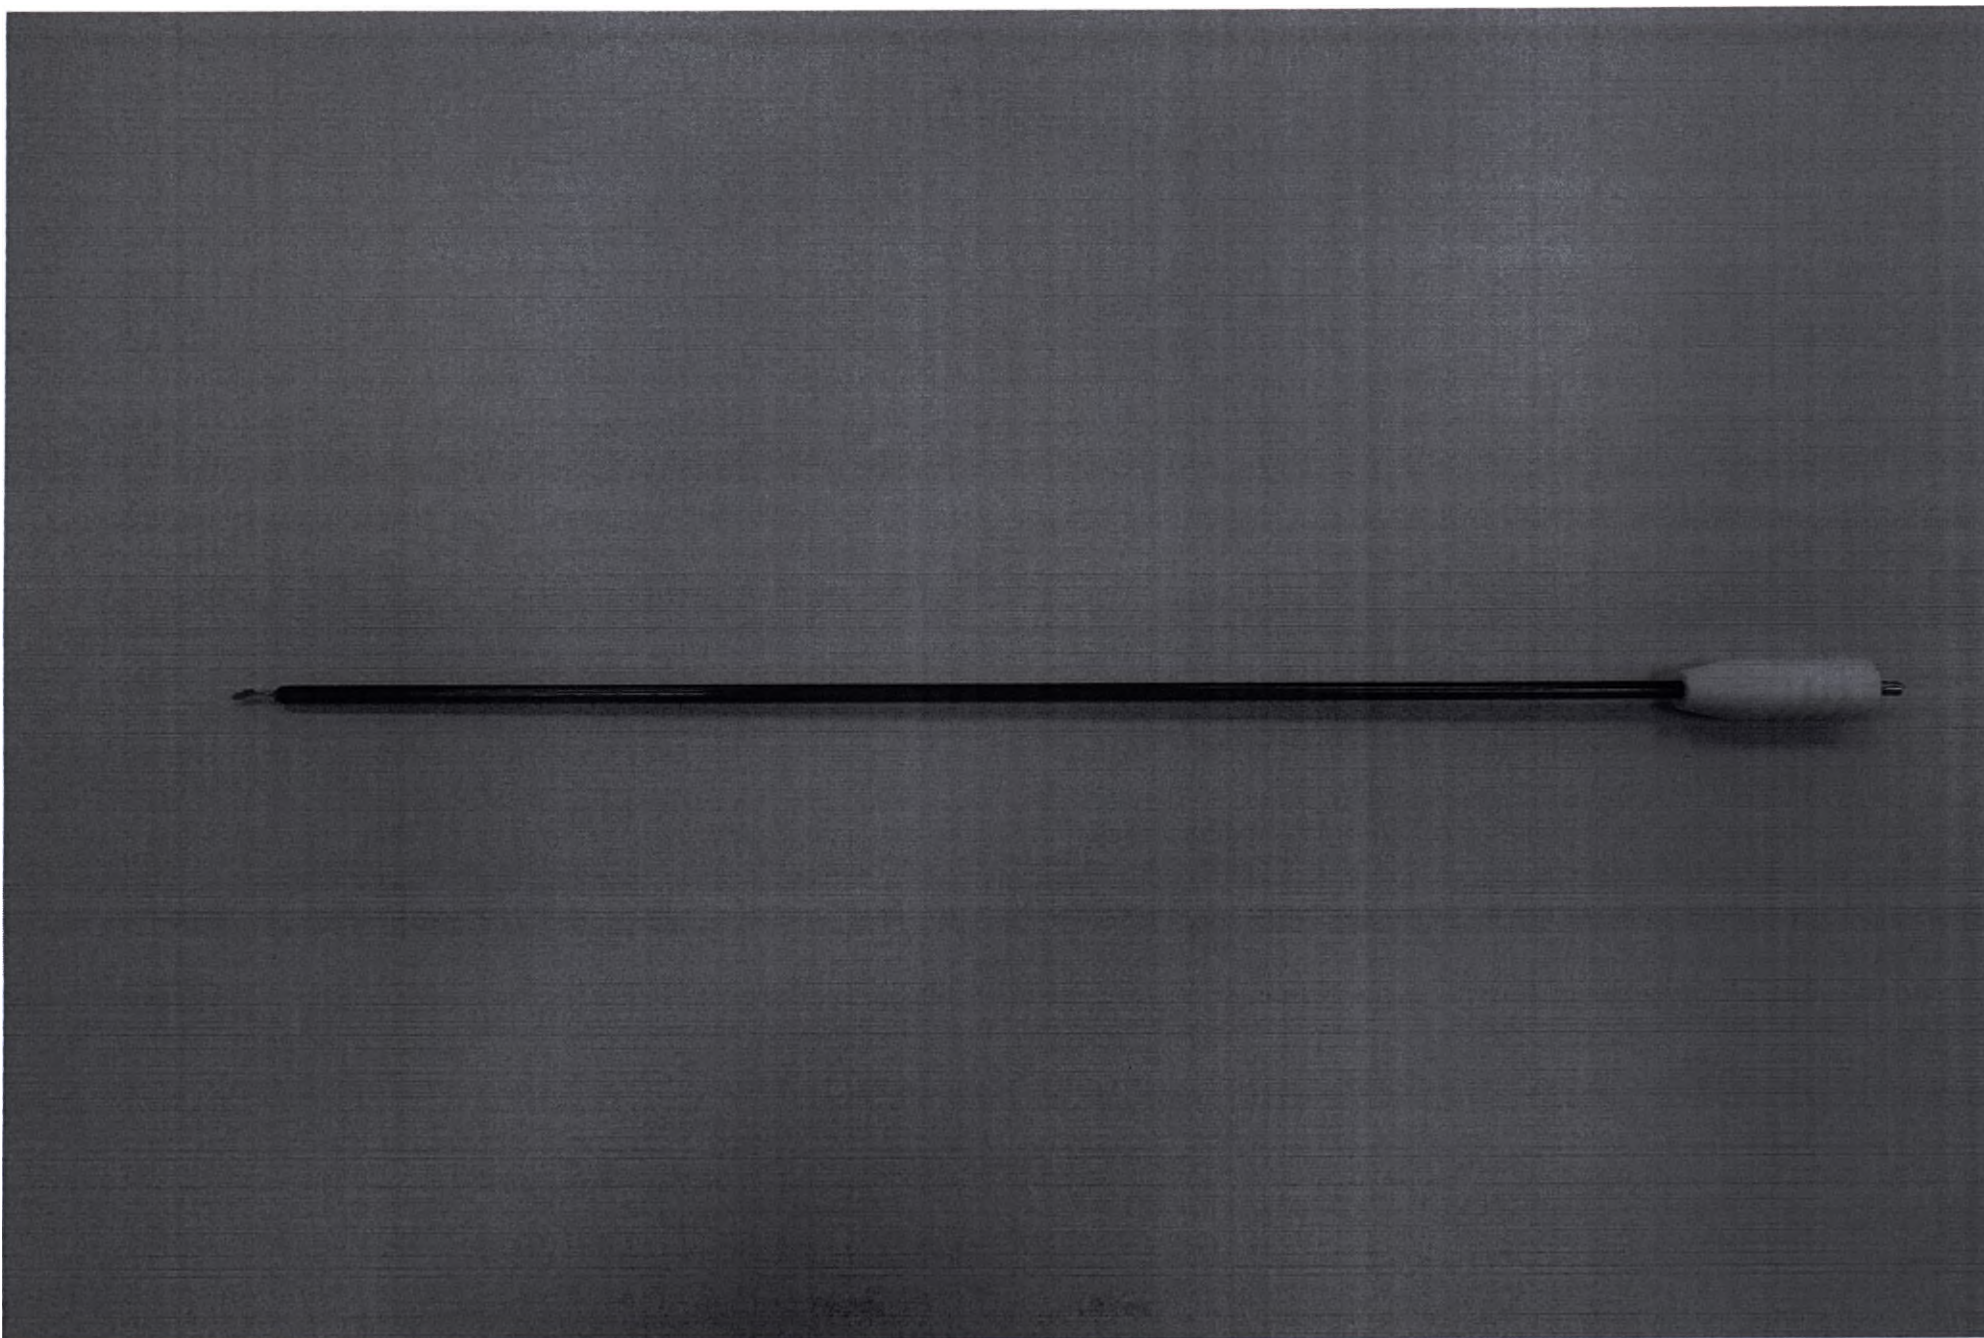


Рис.29 Электрод-лопатка монополярный стерильный (без упаковки)

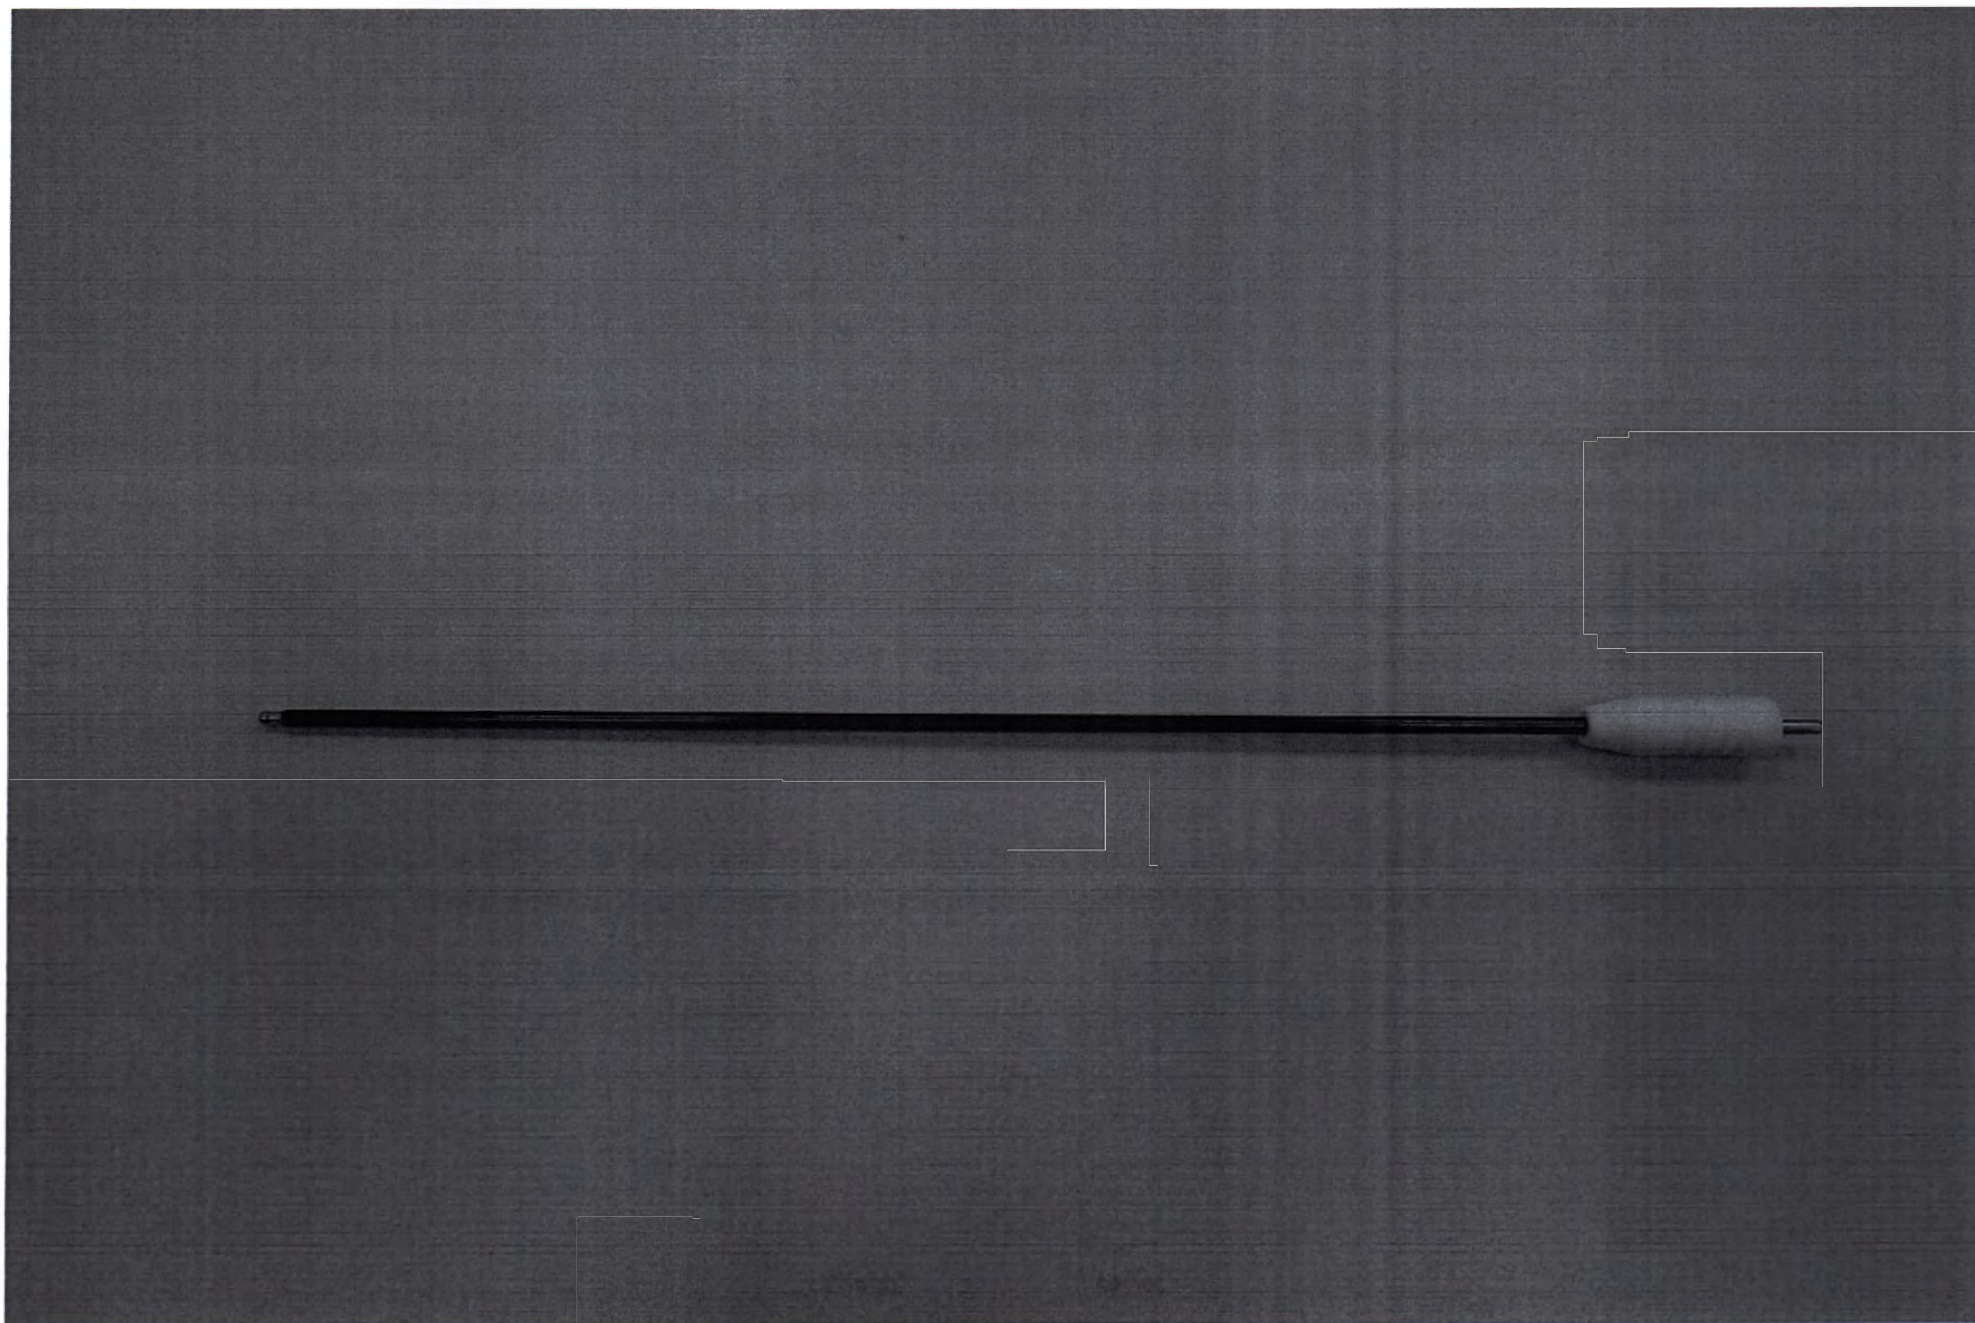
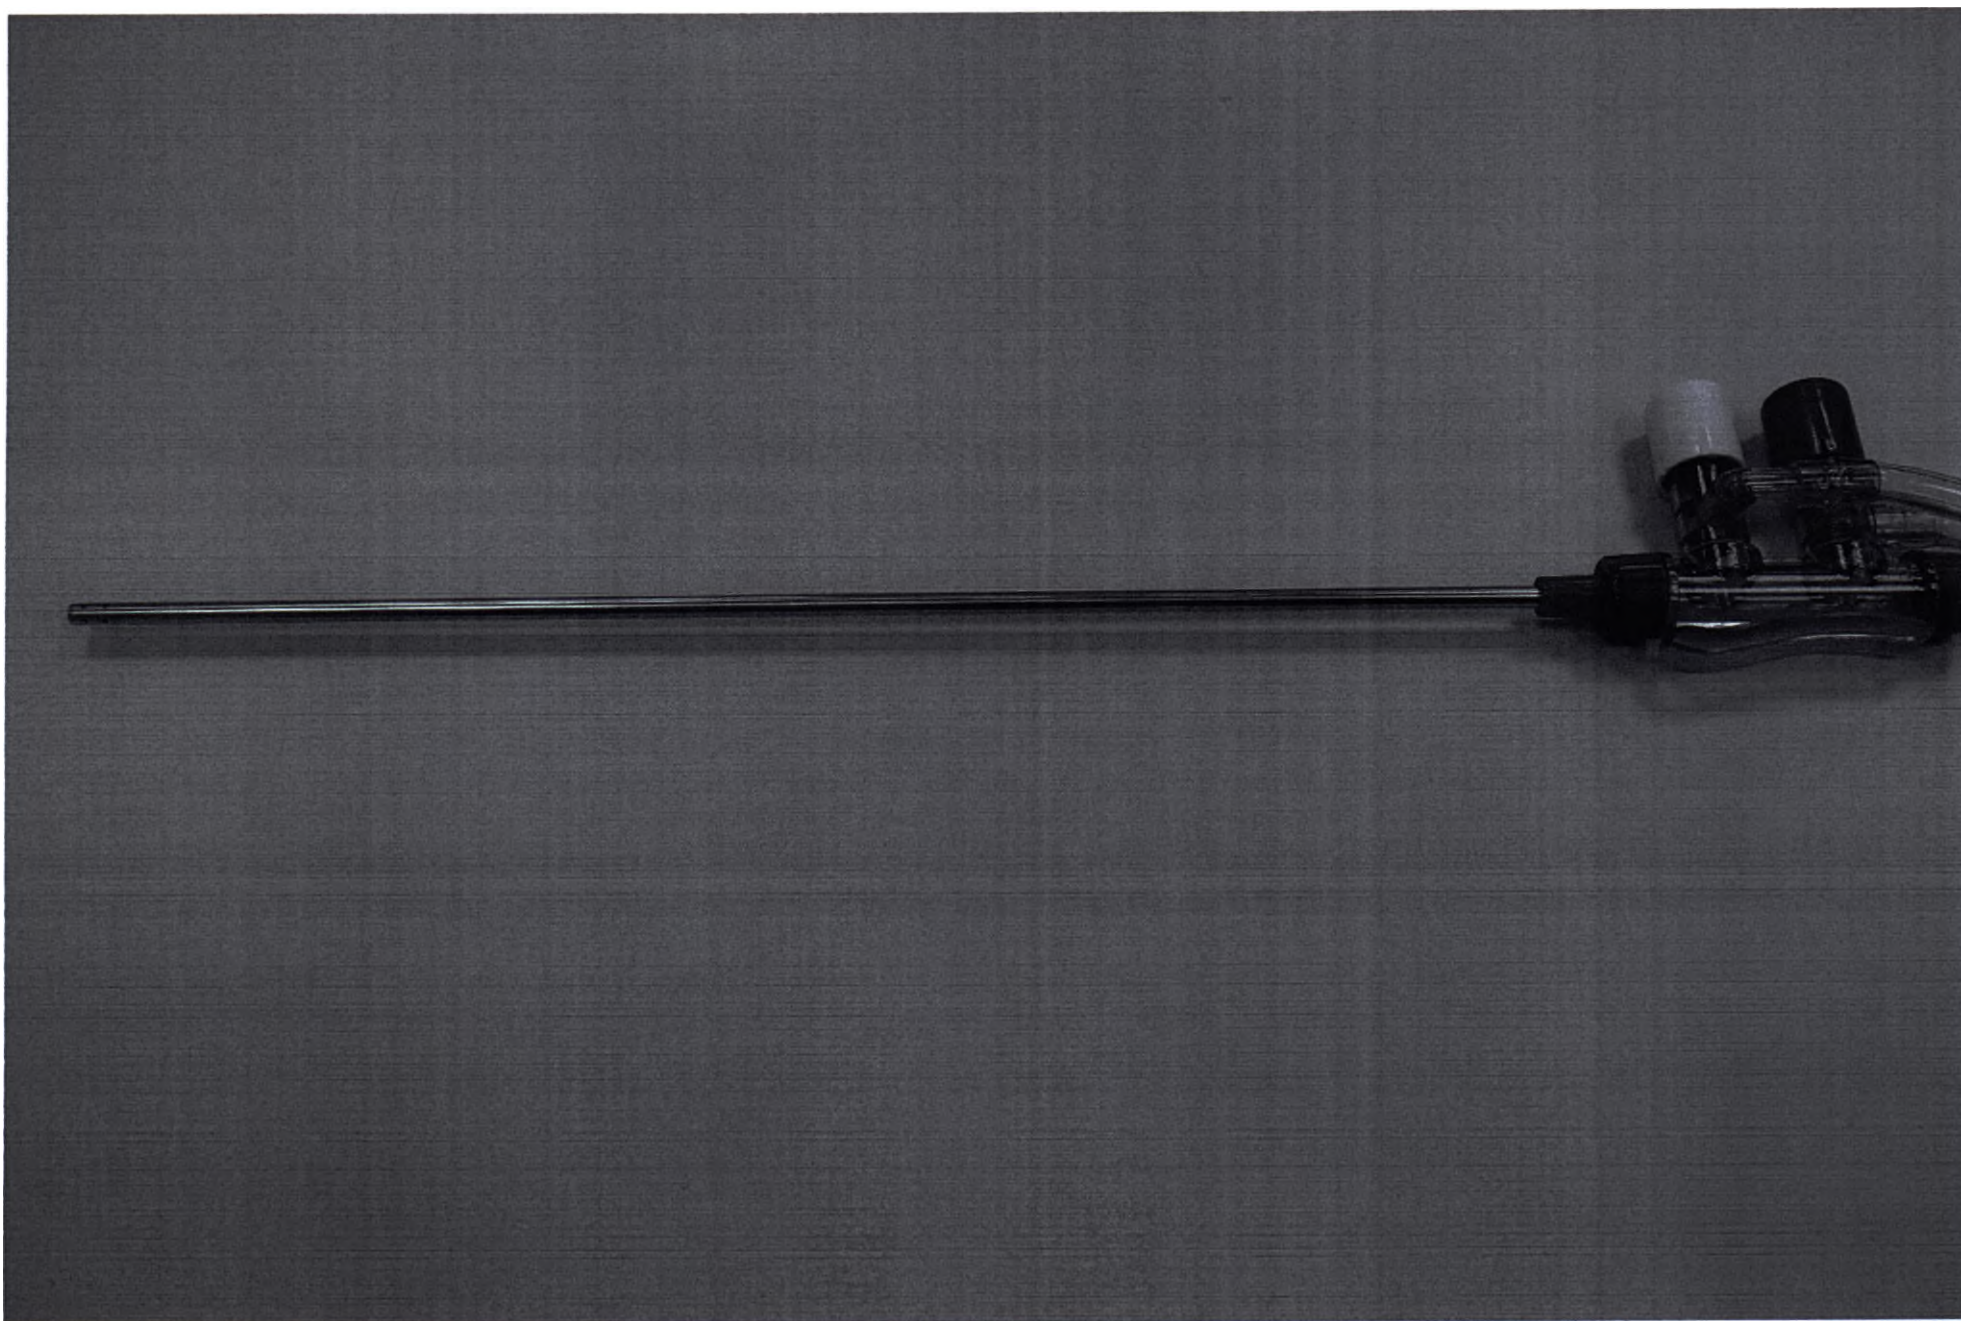
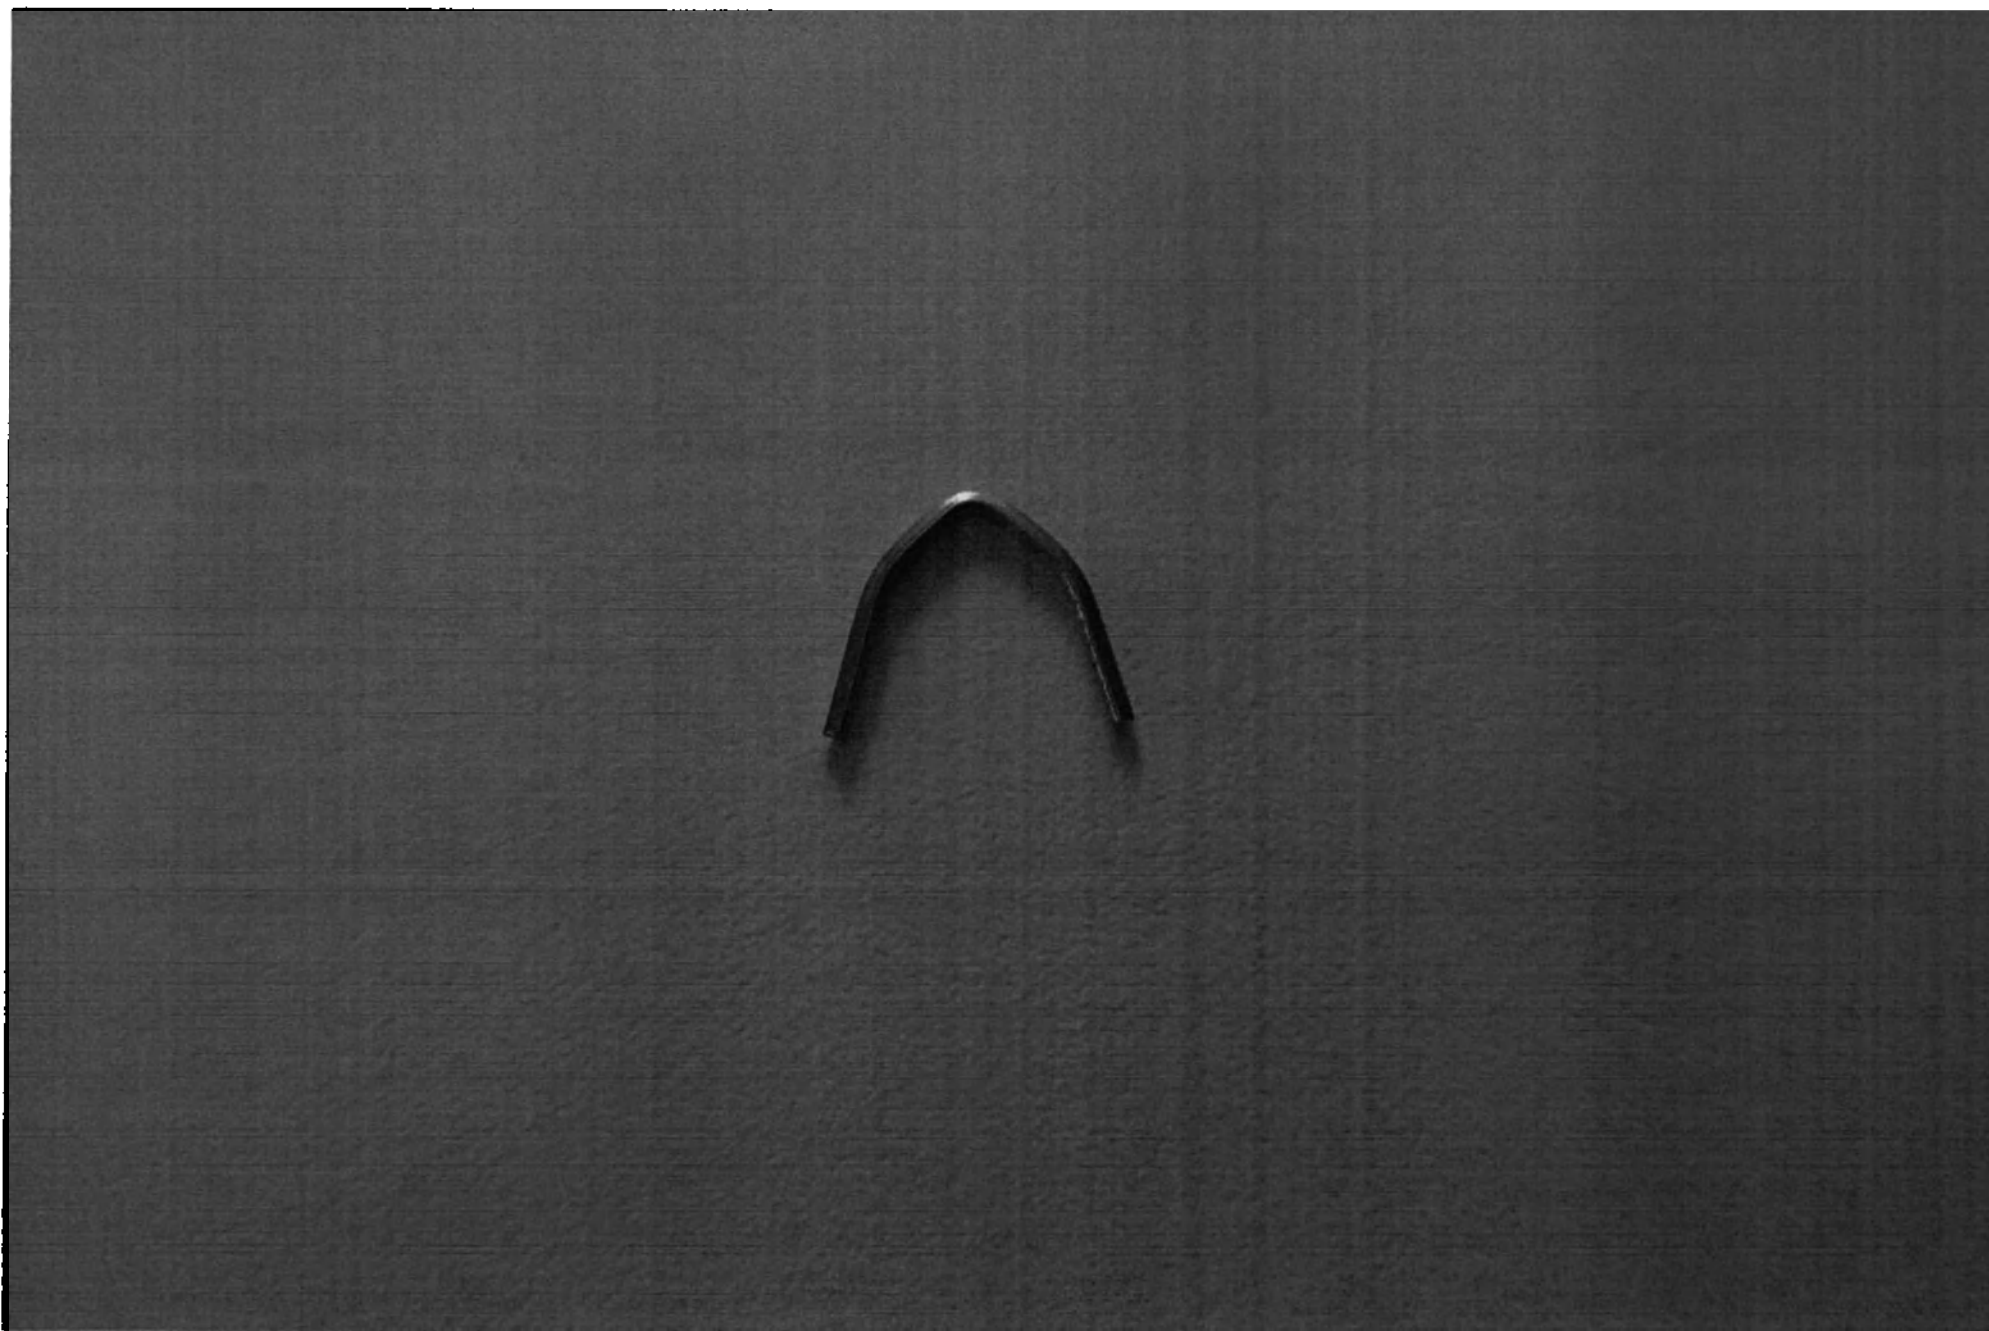


Рис.30 Электрод-шар монополярный стерильный (без упаковки)





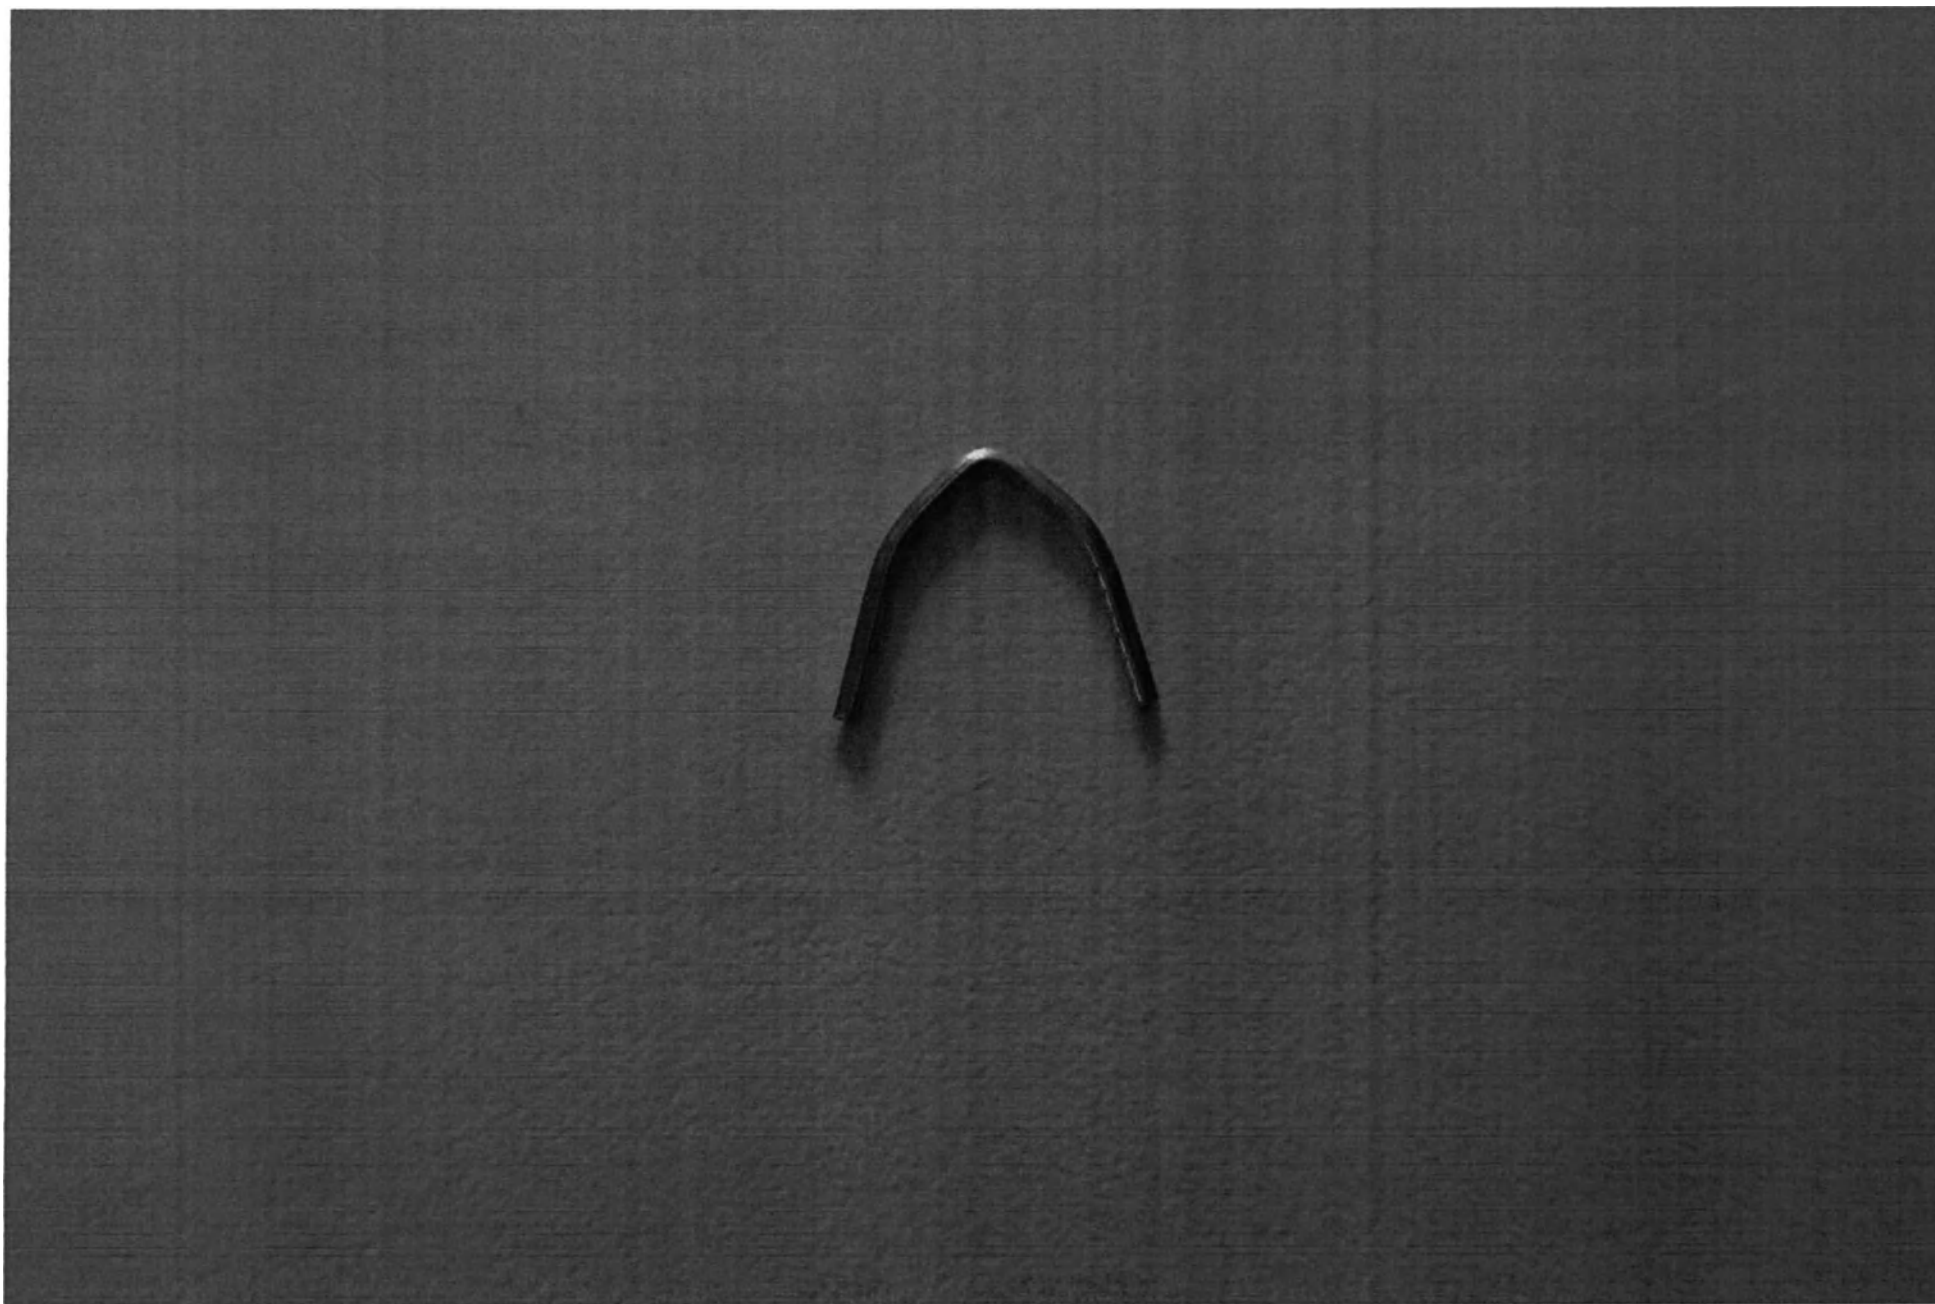


Рис. 33 Клипса малая стерильная (вне картриджа, без упаковки, увеличено)



Рис. 24 Клипса средне-малая стерильная (вне картриджа, без упаковки, увеличено)

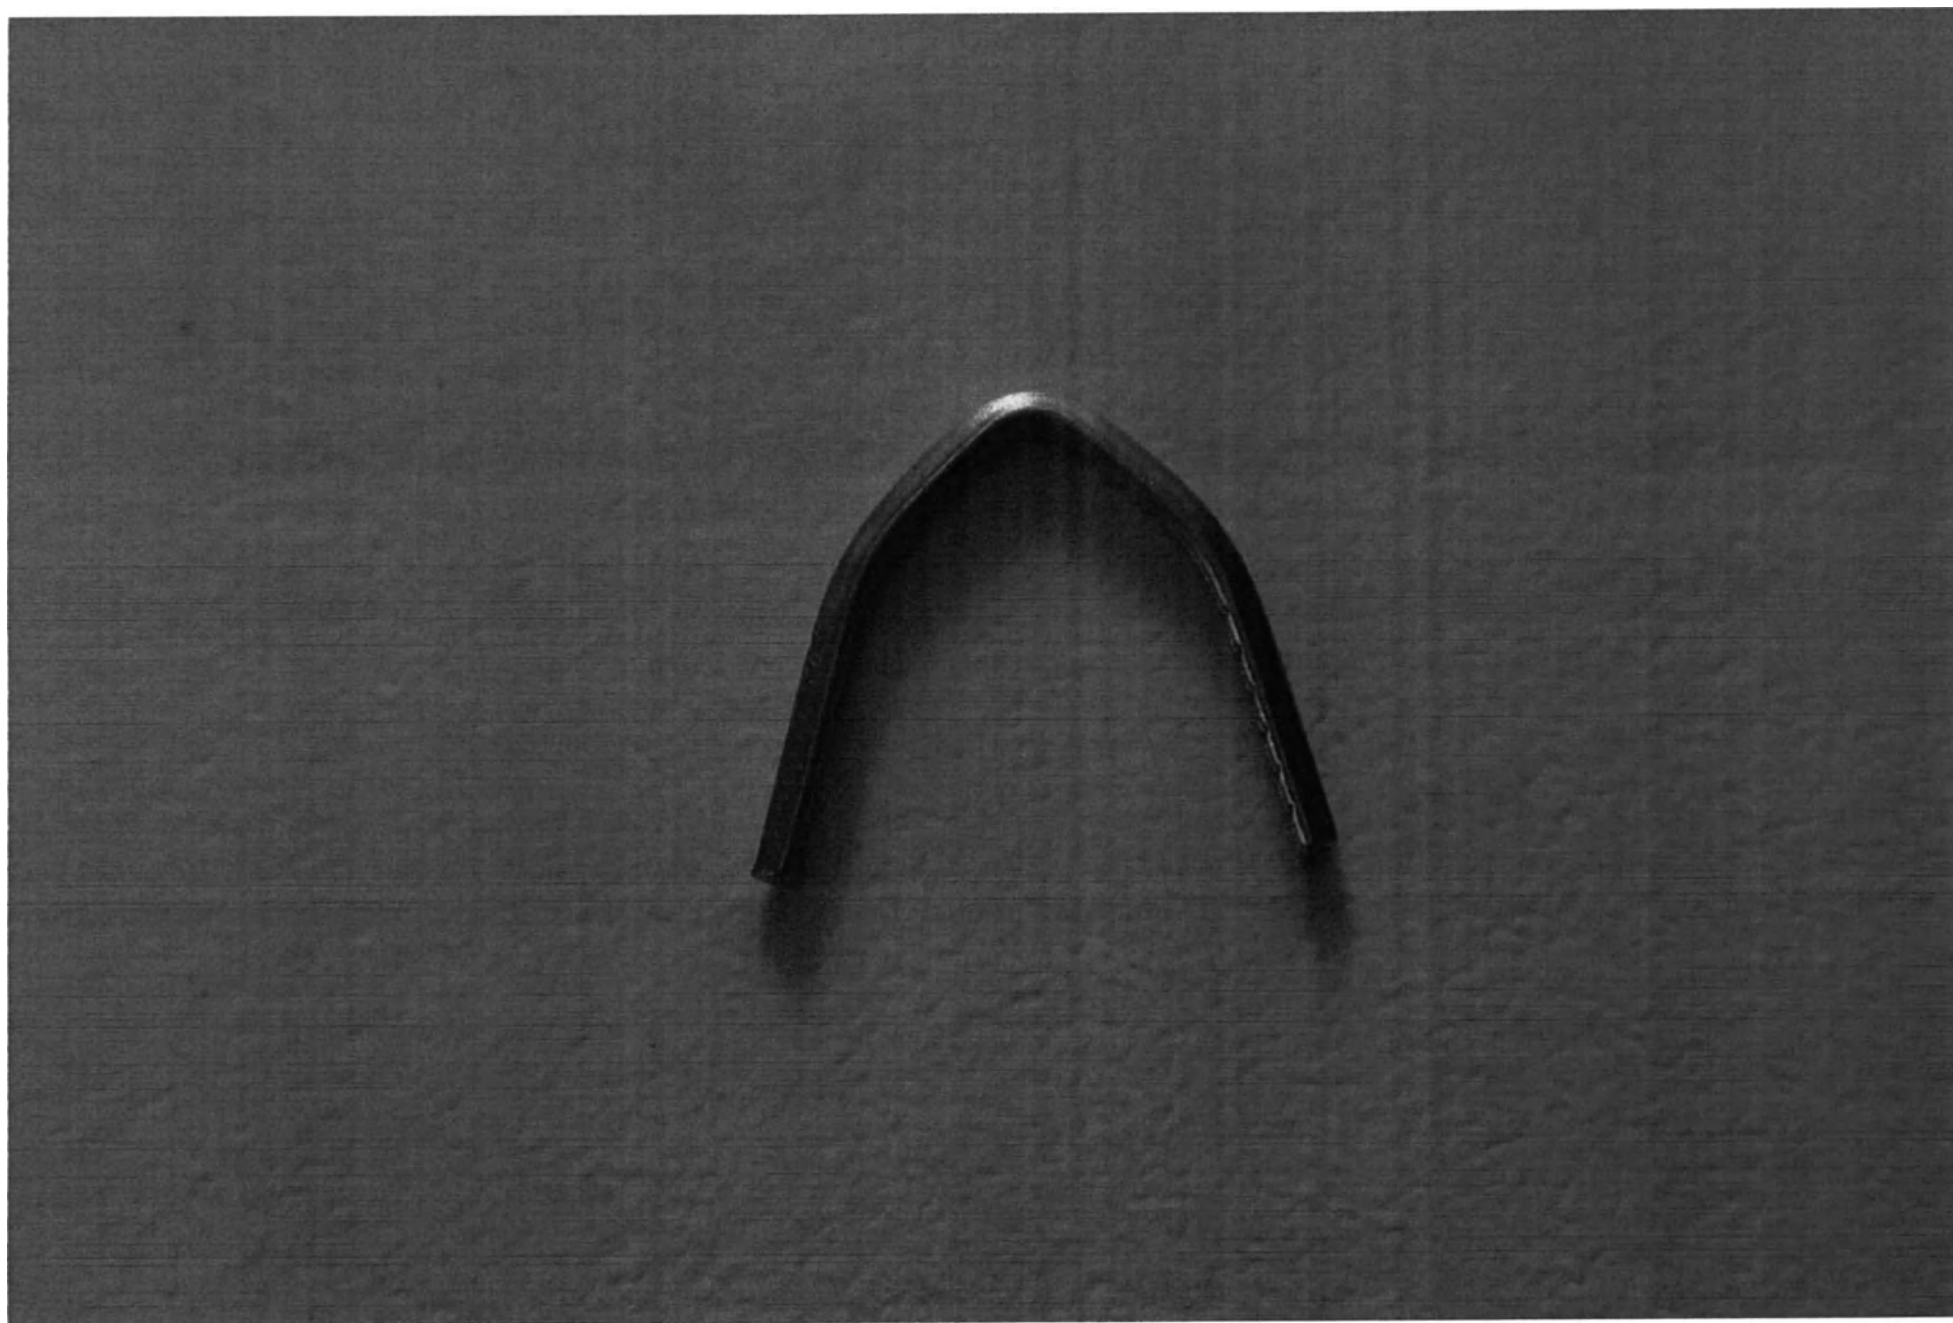


Рис. 35 Клипса средняя стерильная (вне картриджа, без упаковки, увеличено)

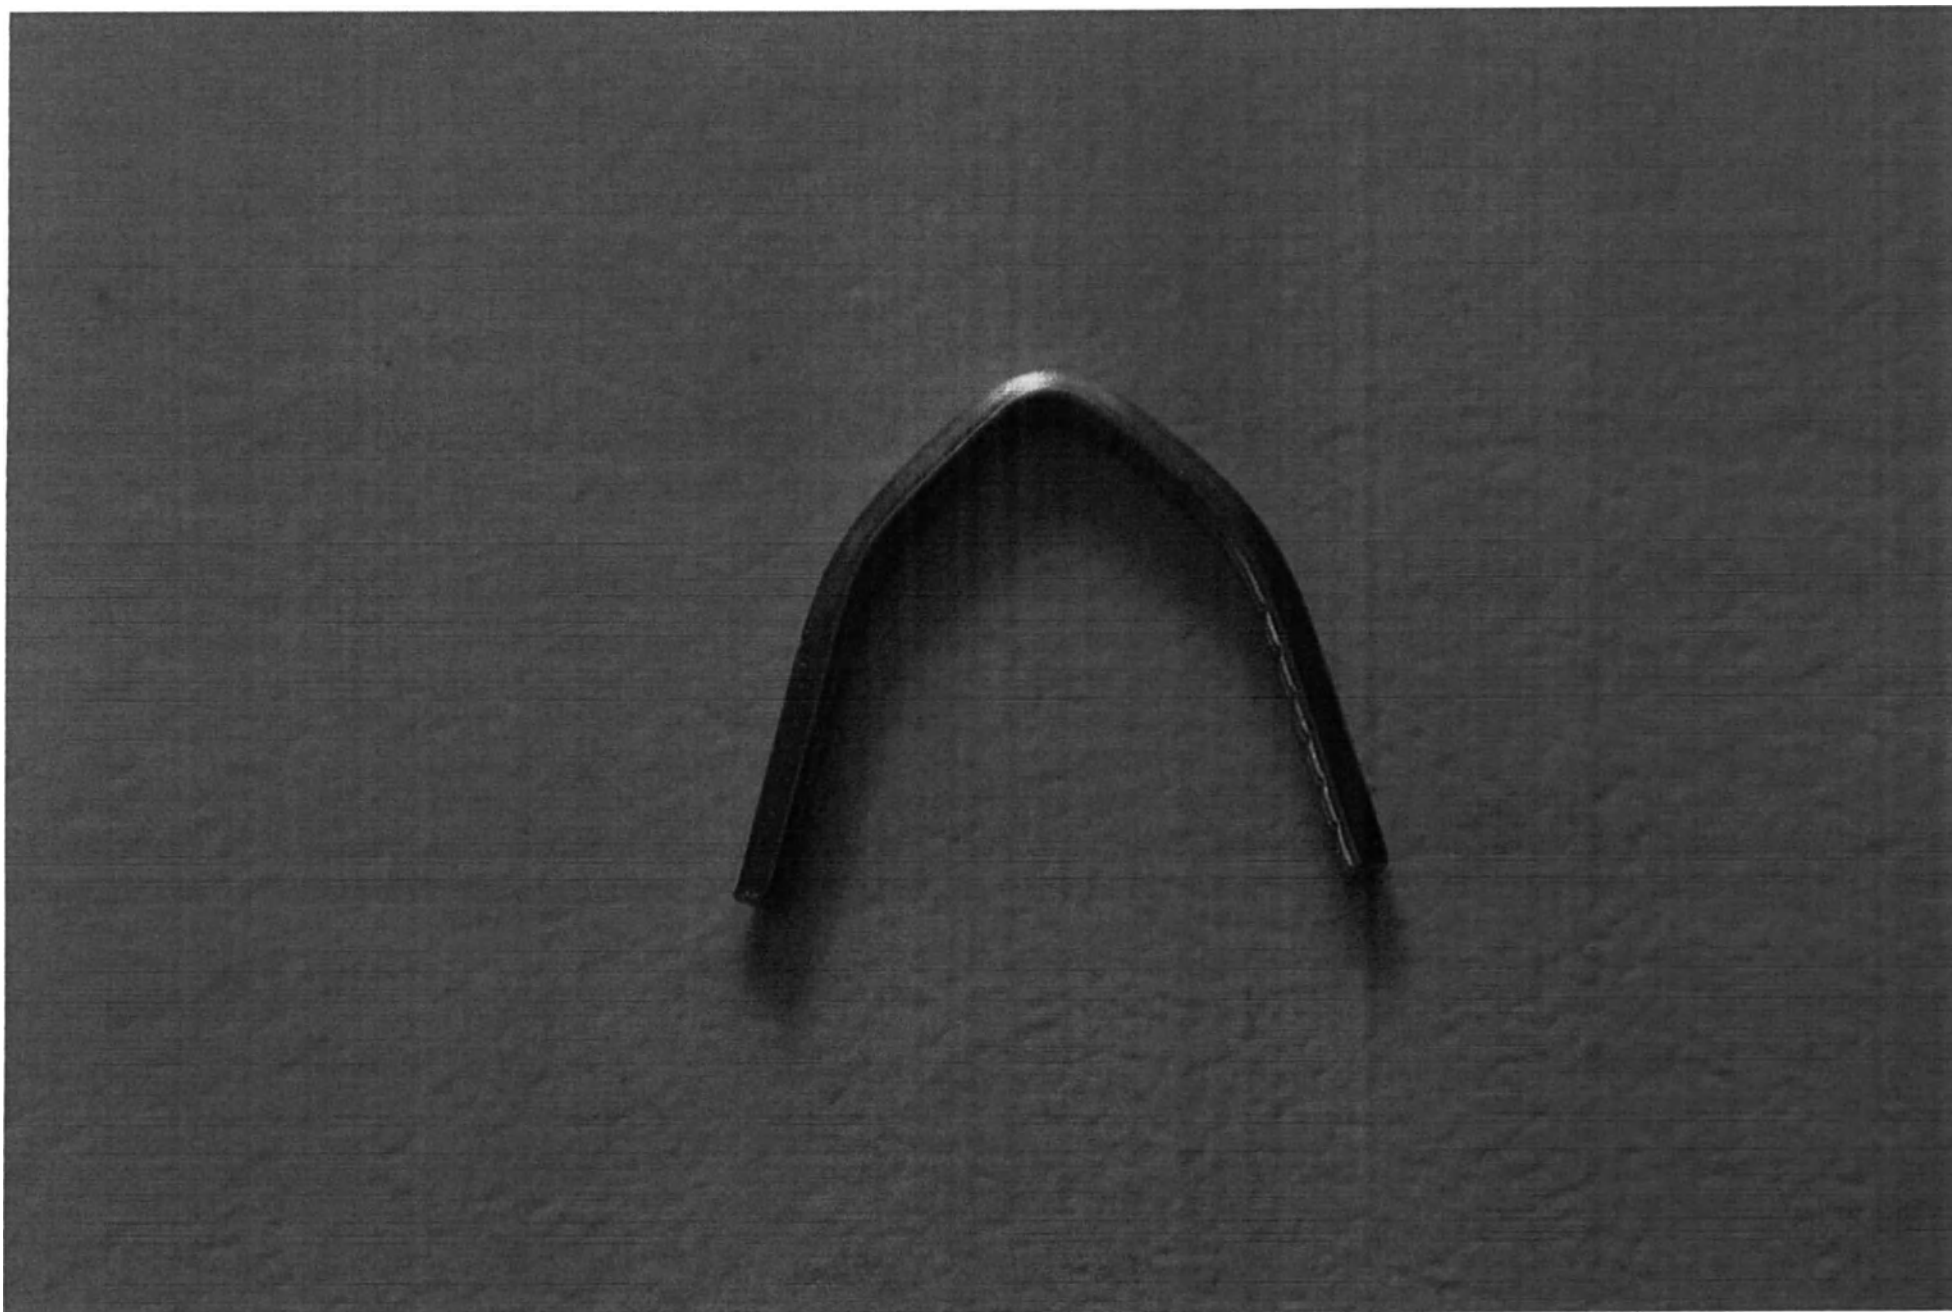


Рис. 36 Клипса средне-большая (вне картриджа, без упаковки, увеличено)

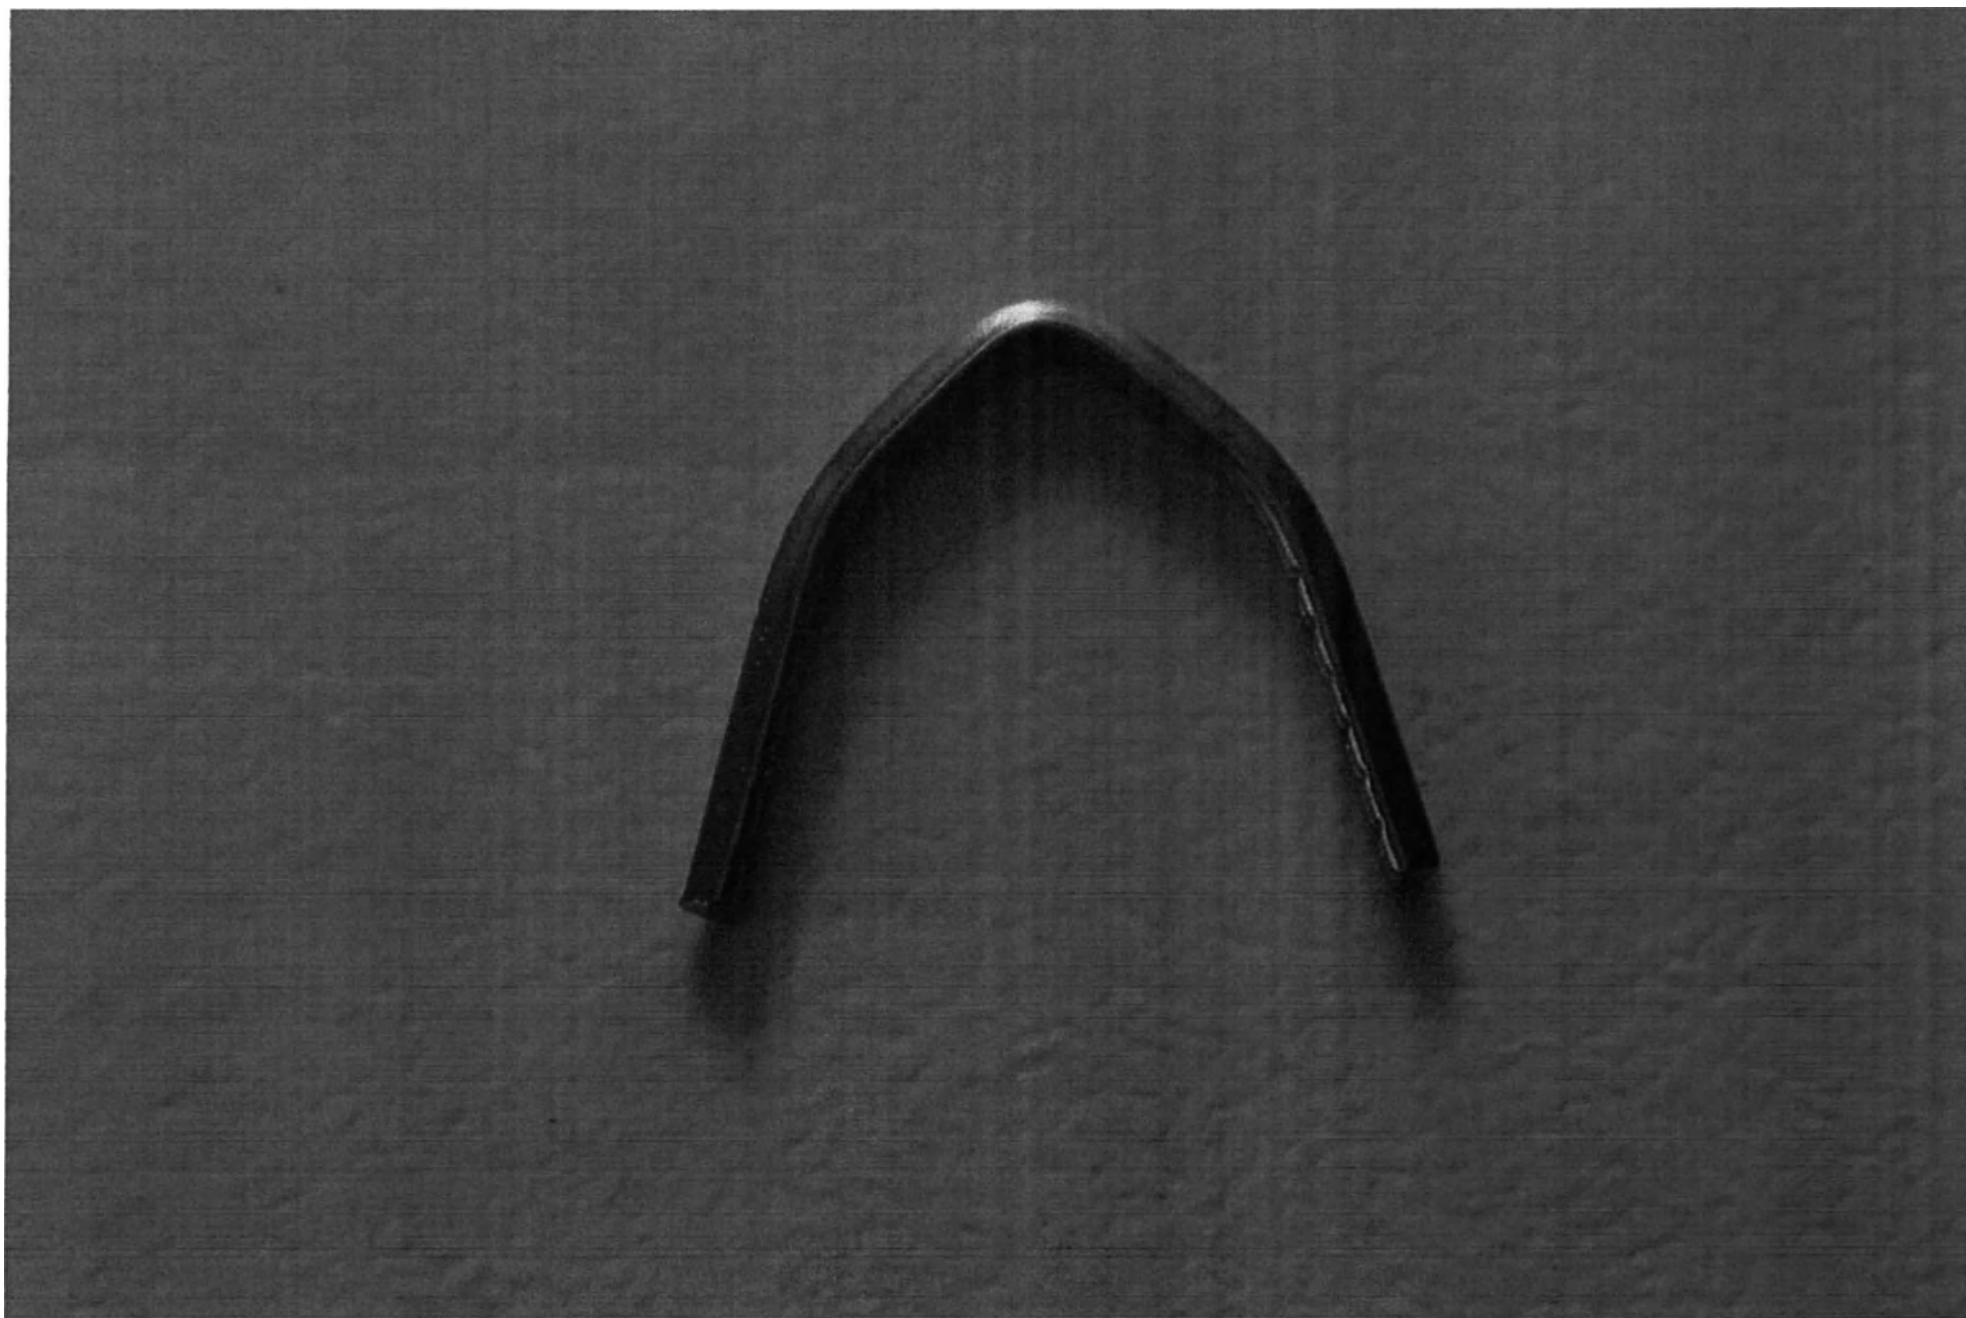


Рис.37 Клипса большая (вне картриджа, без упаковки, увеличено)

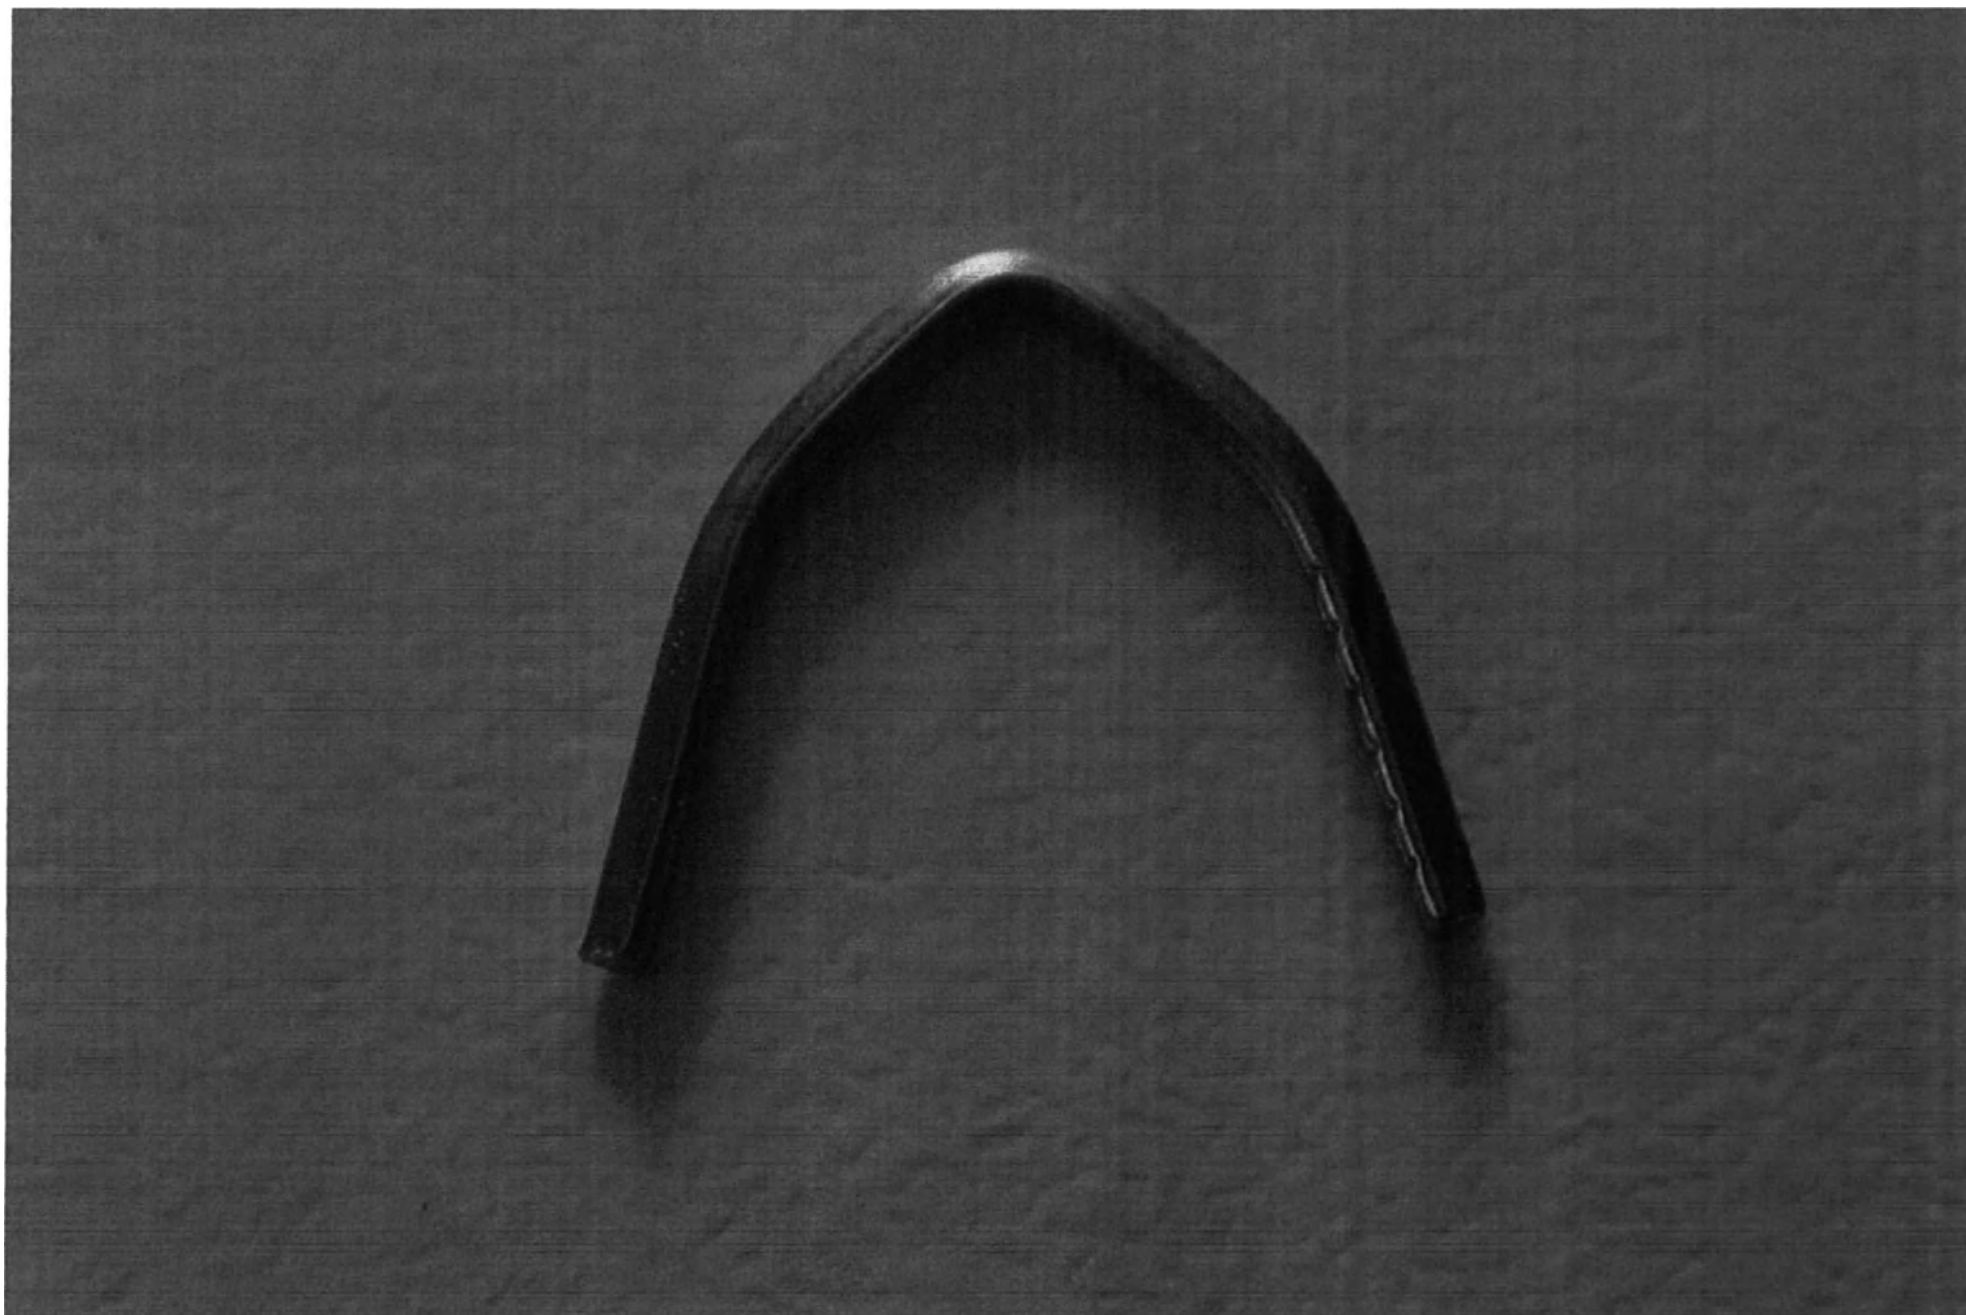
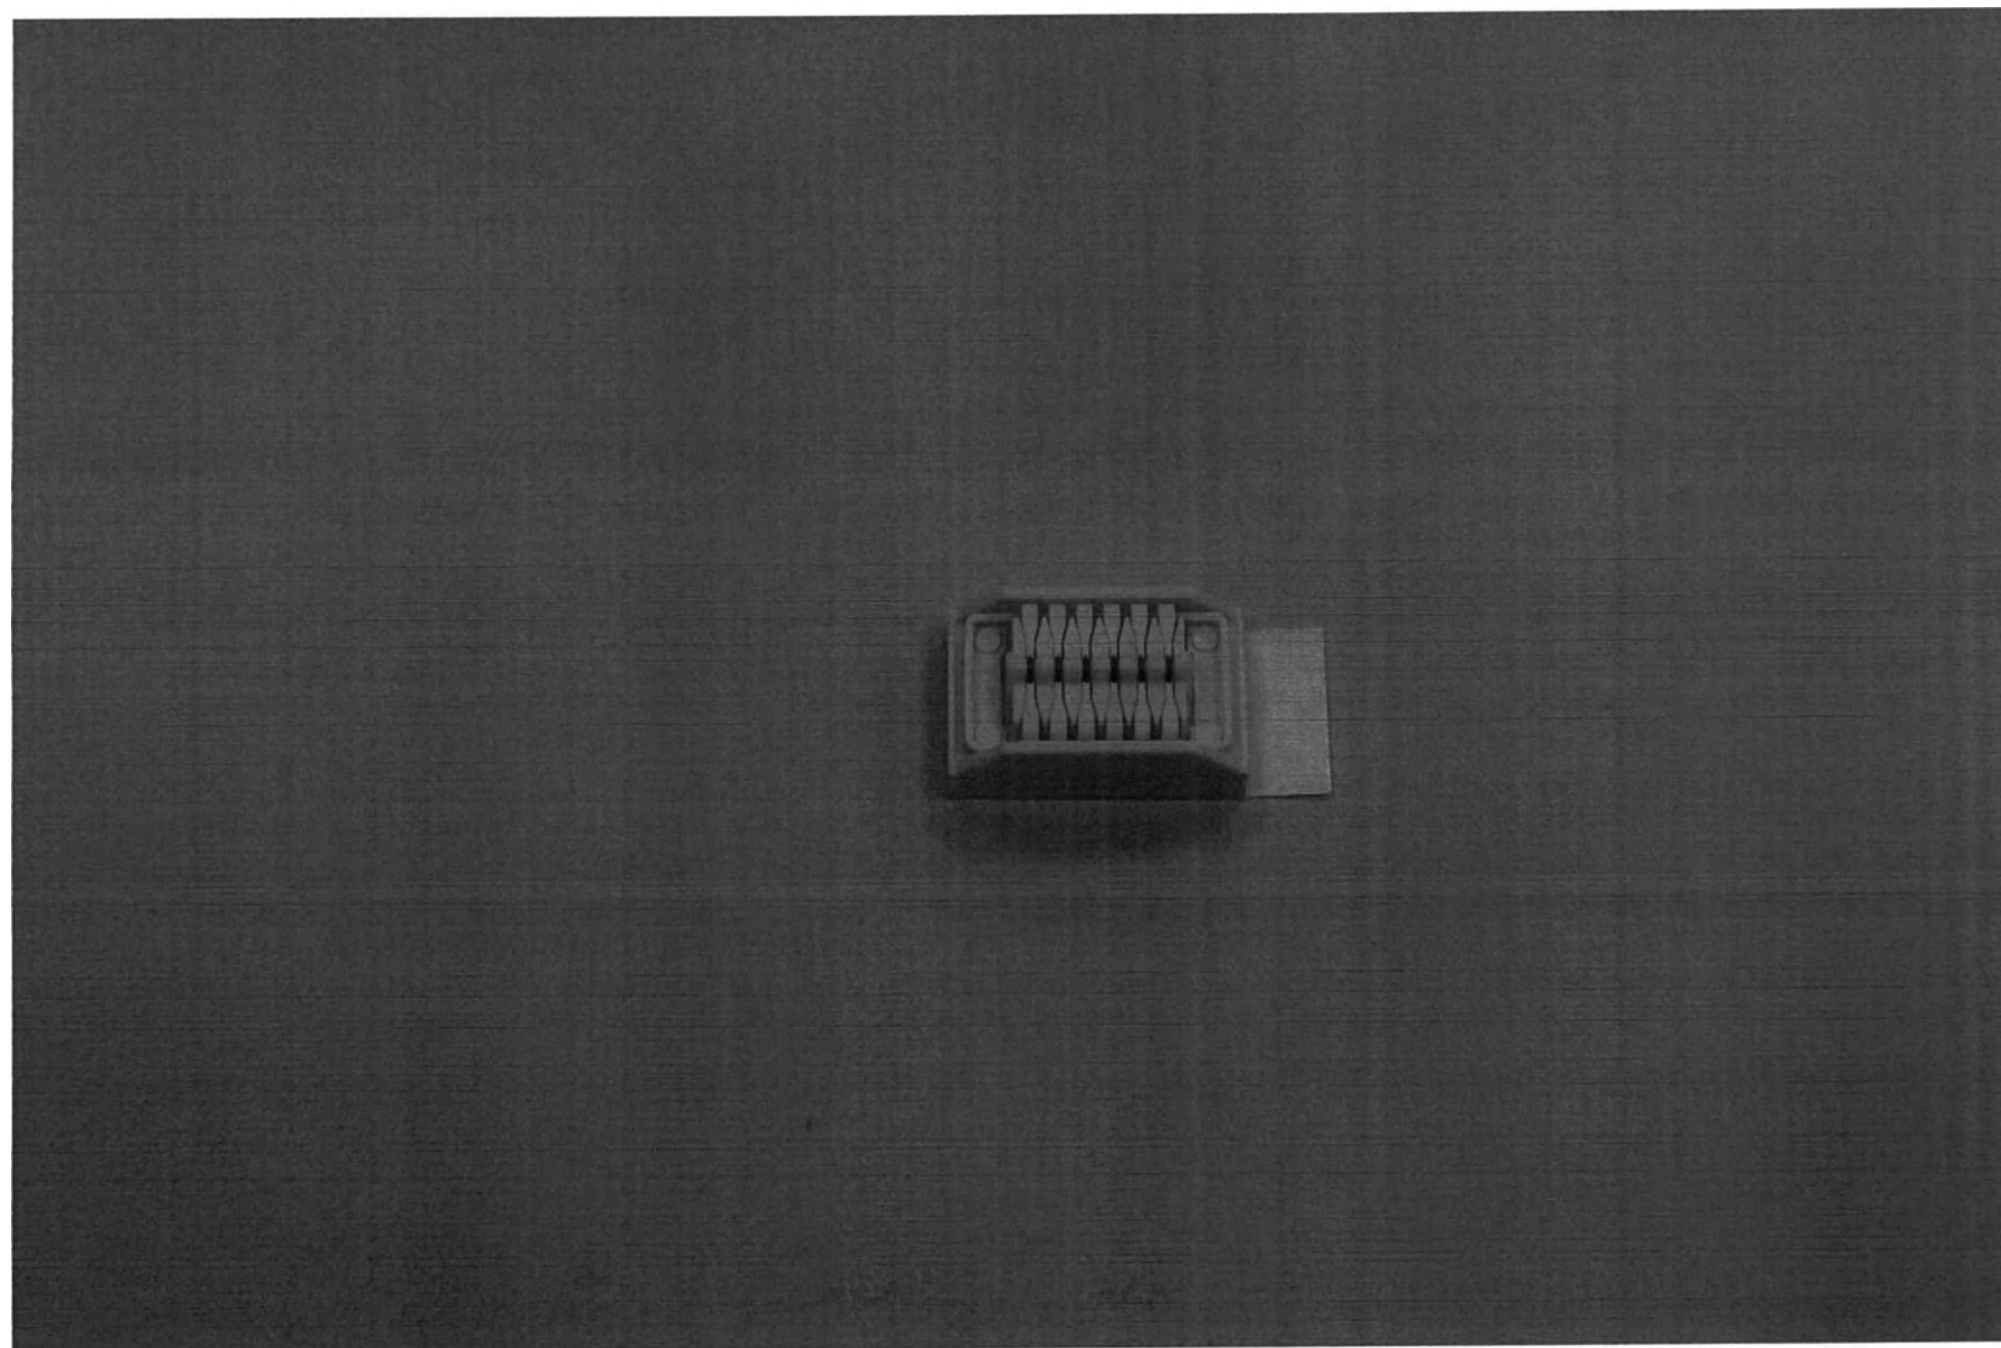
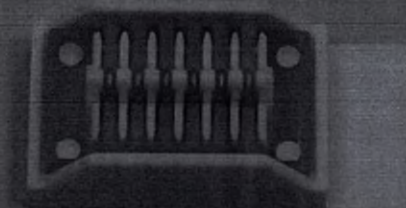
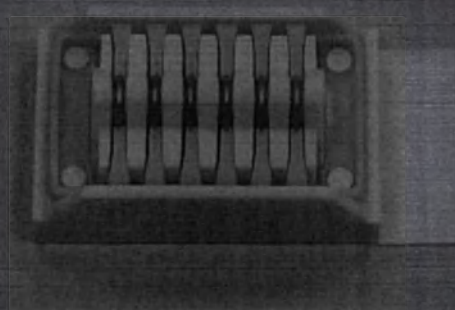



Рис. 38 Клипса экстра-большая (вне картриджа, без упаковки, увеличено)












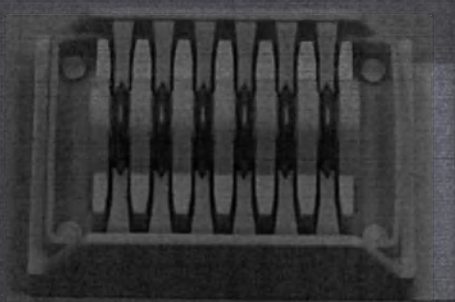

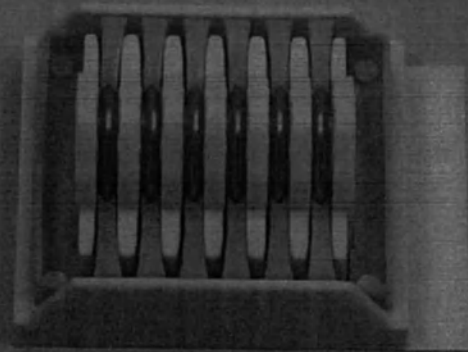

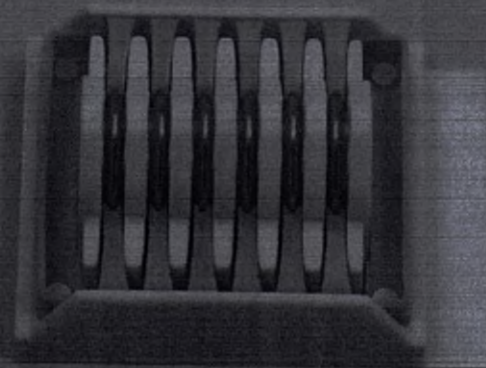

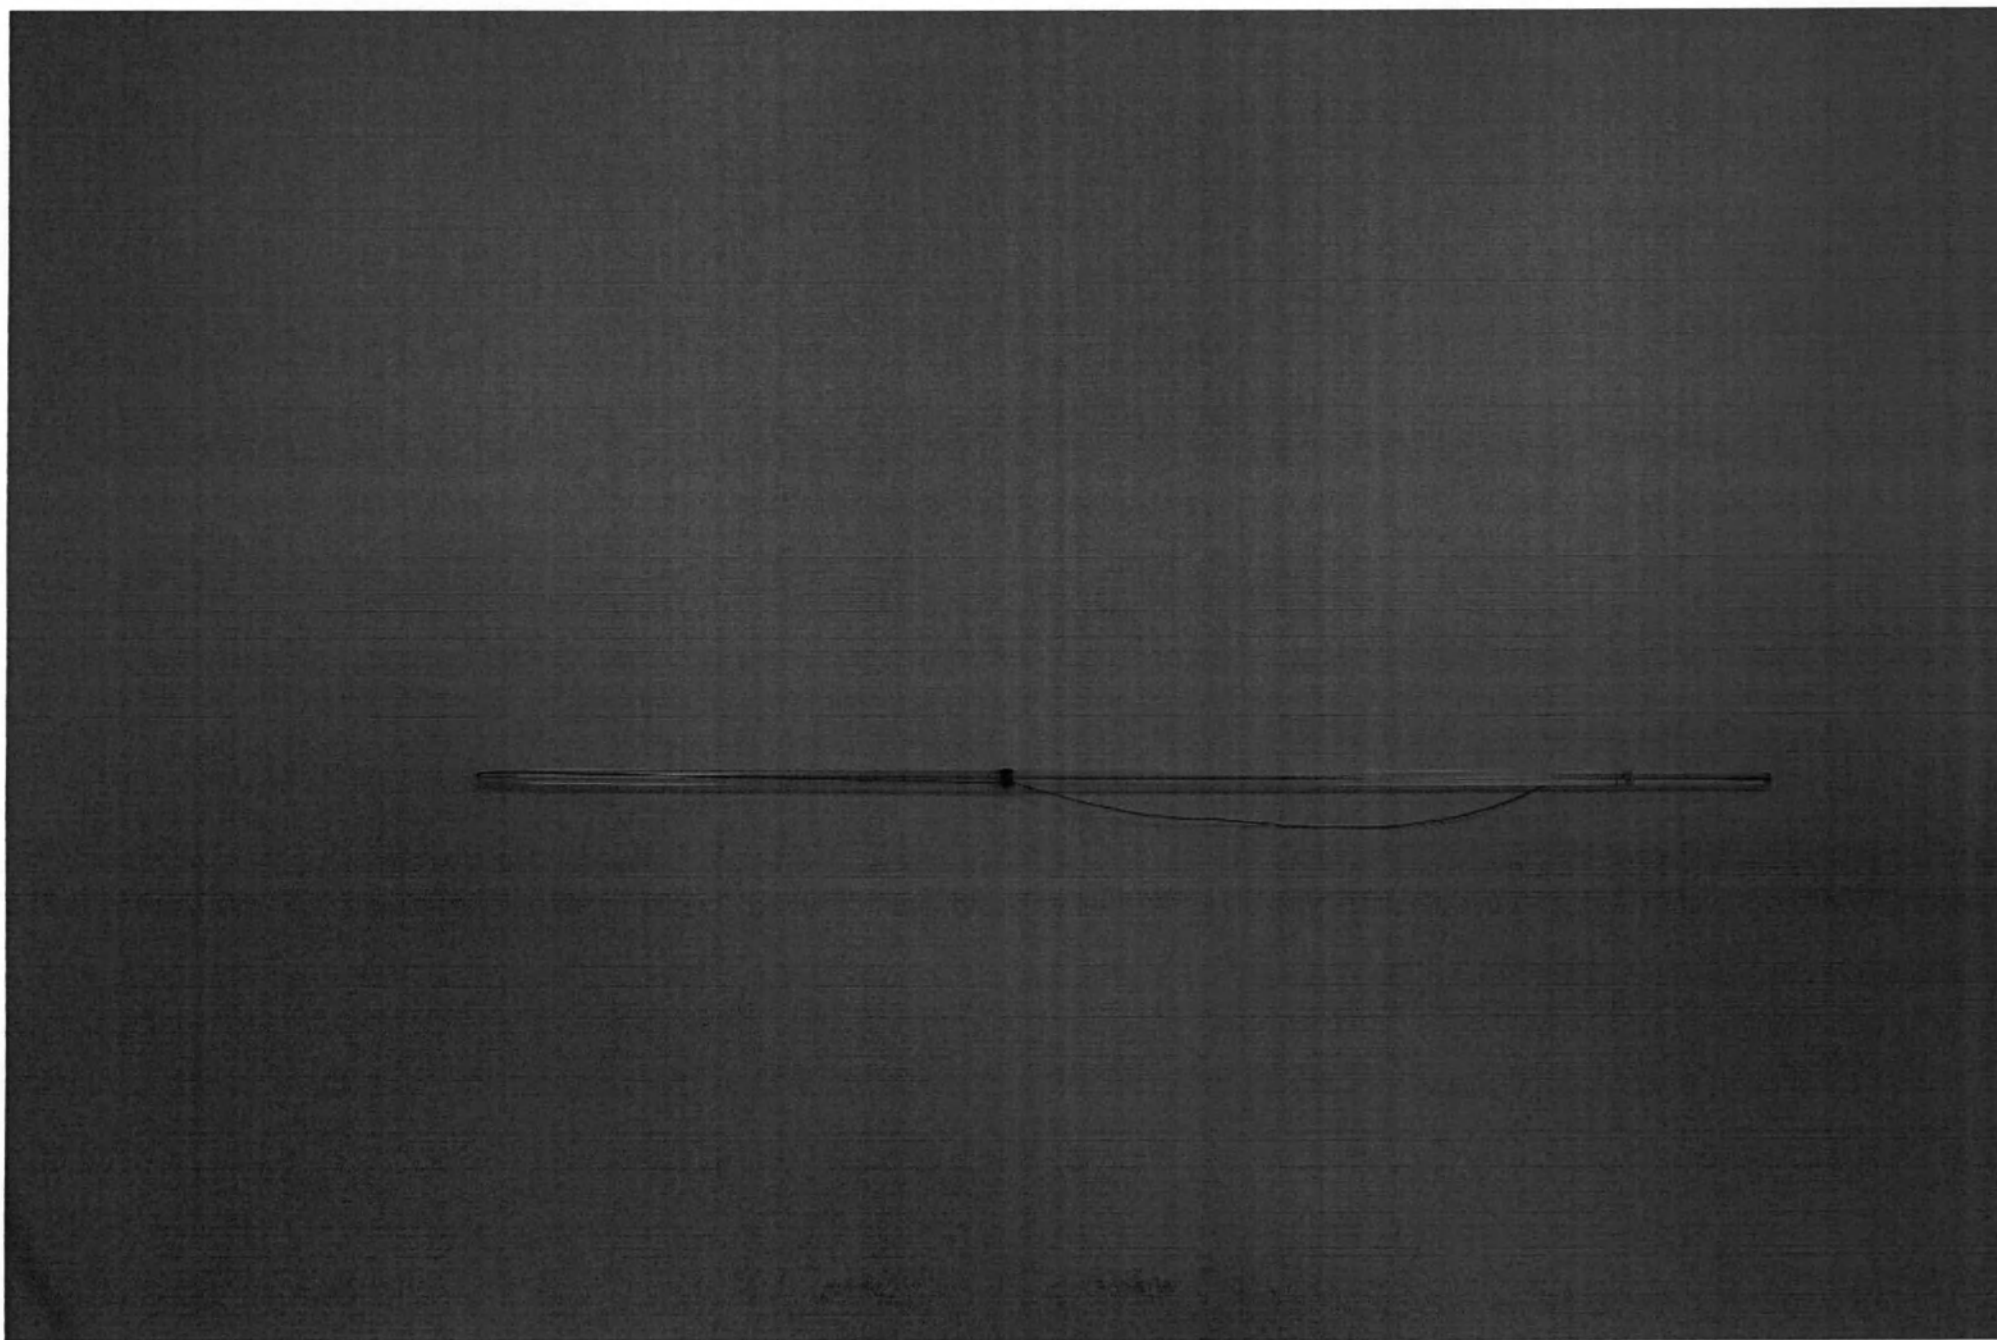

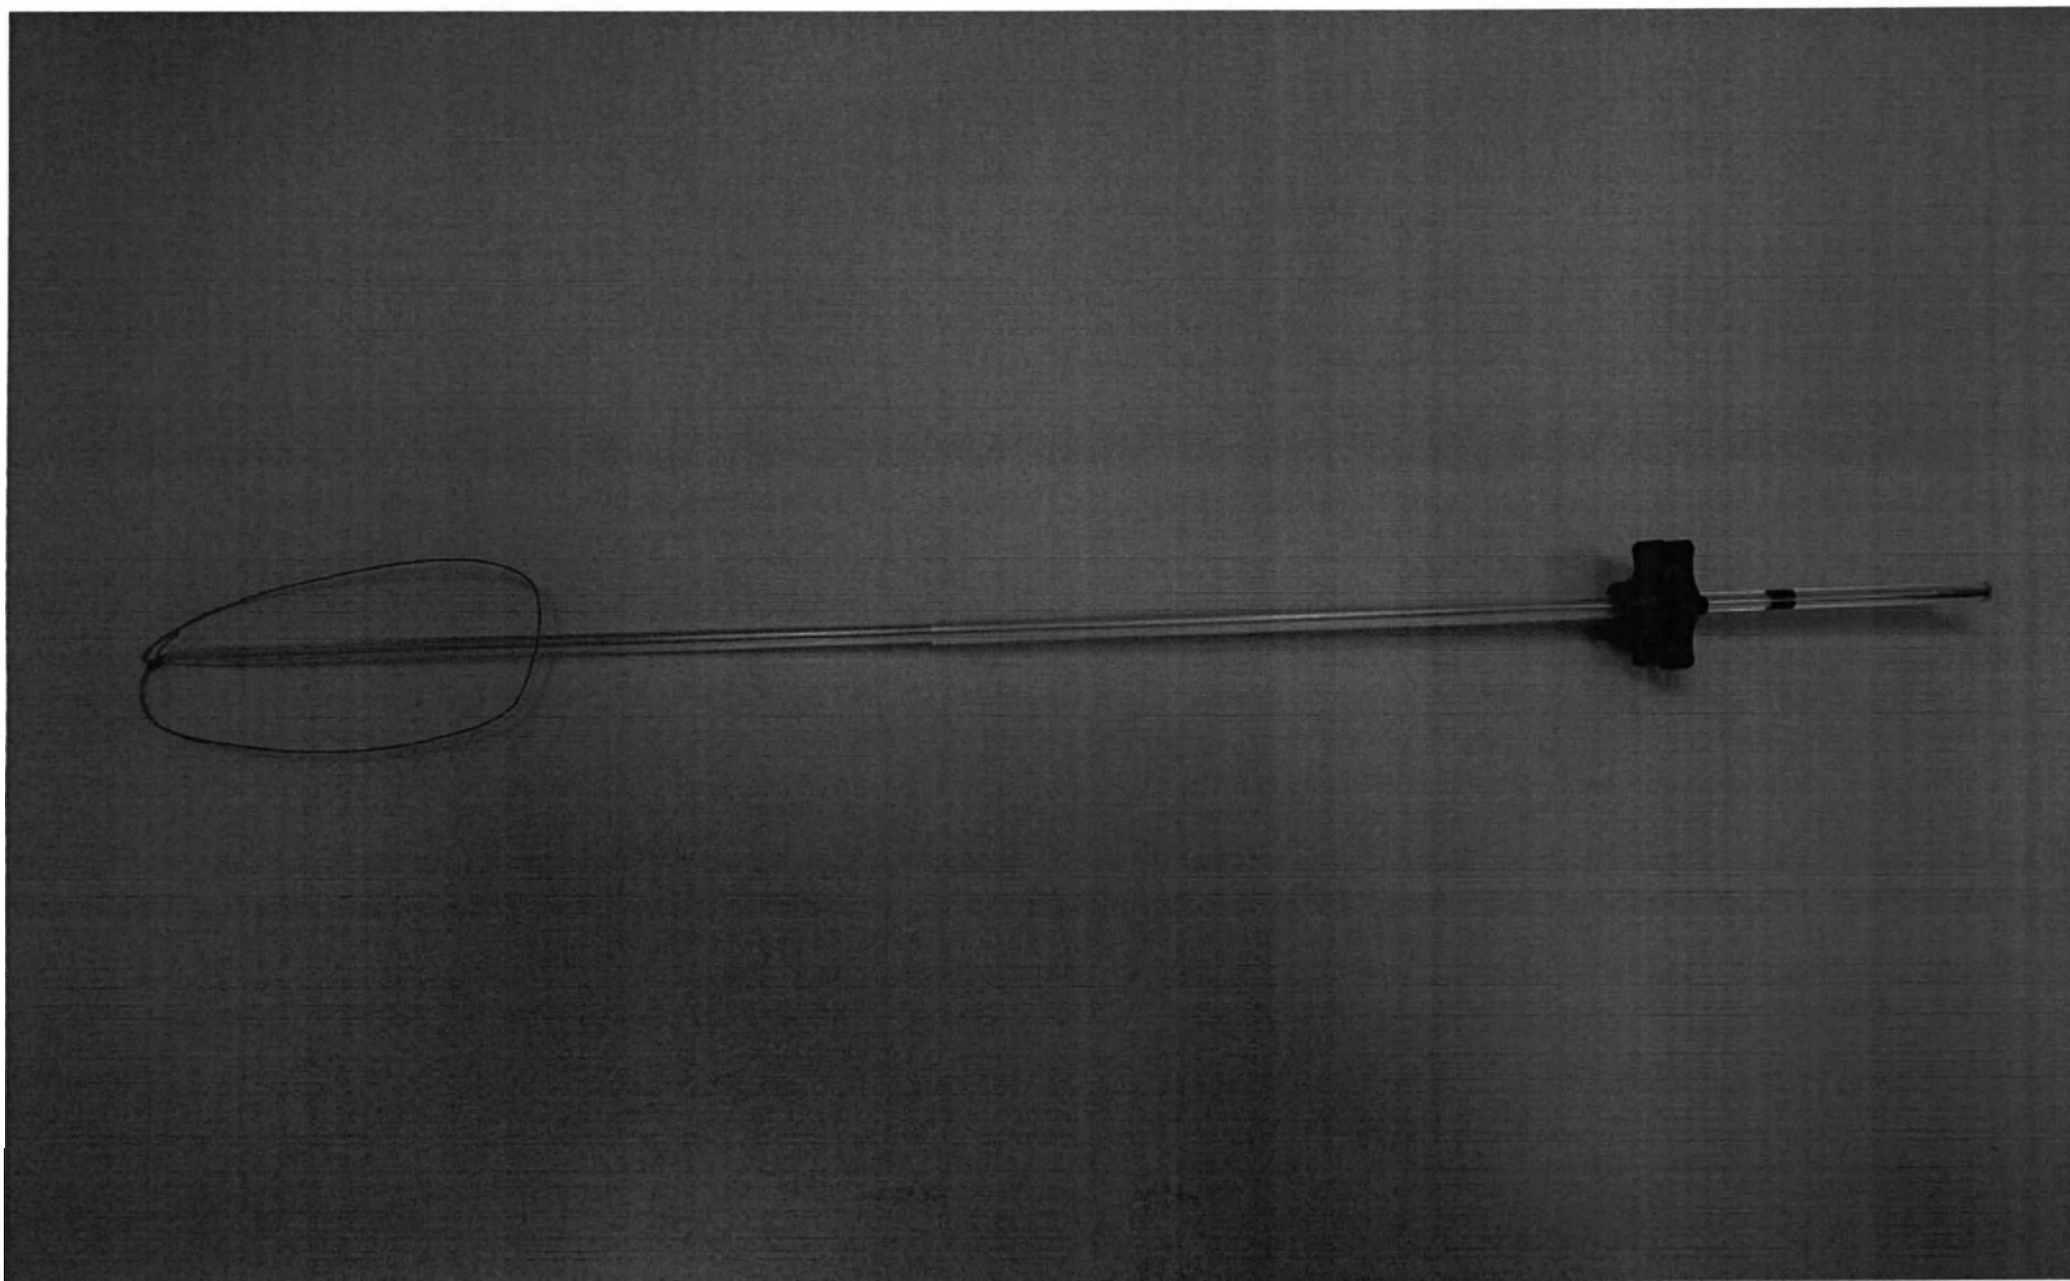


Рис.47 Эндолигатура с петлей типа Редера стерильная (без упаковки)

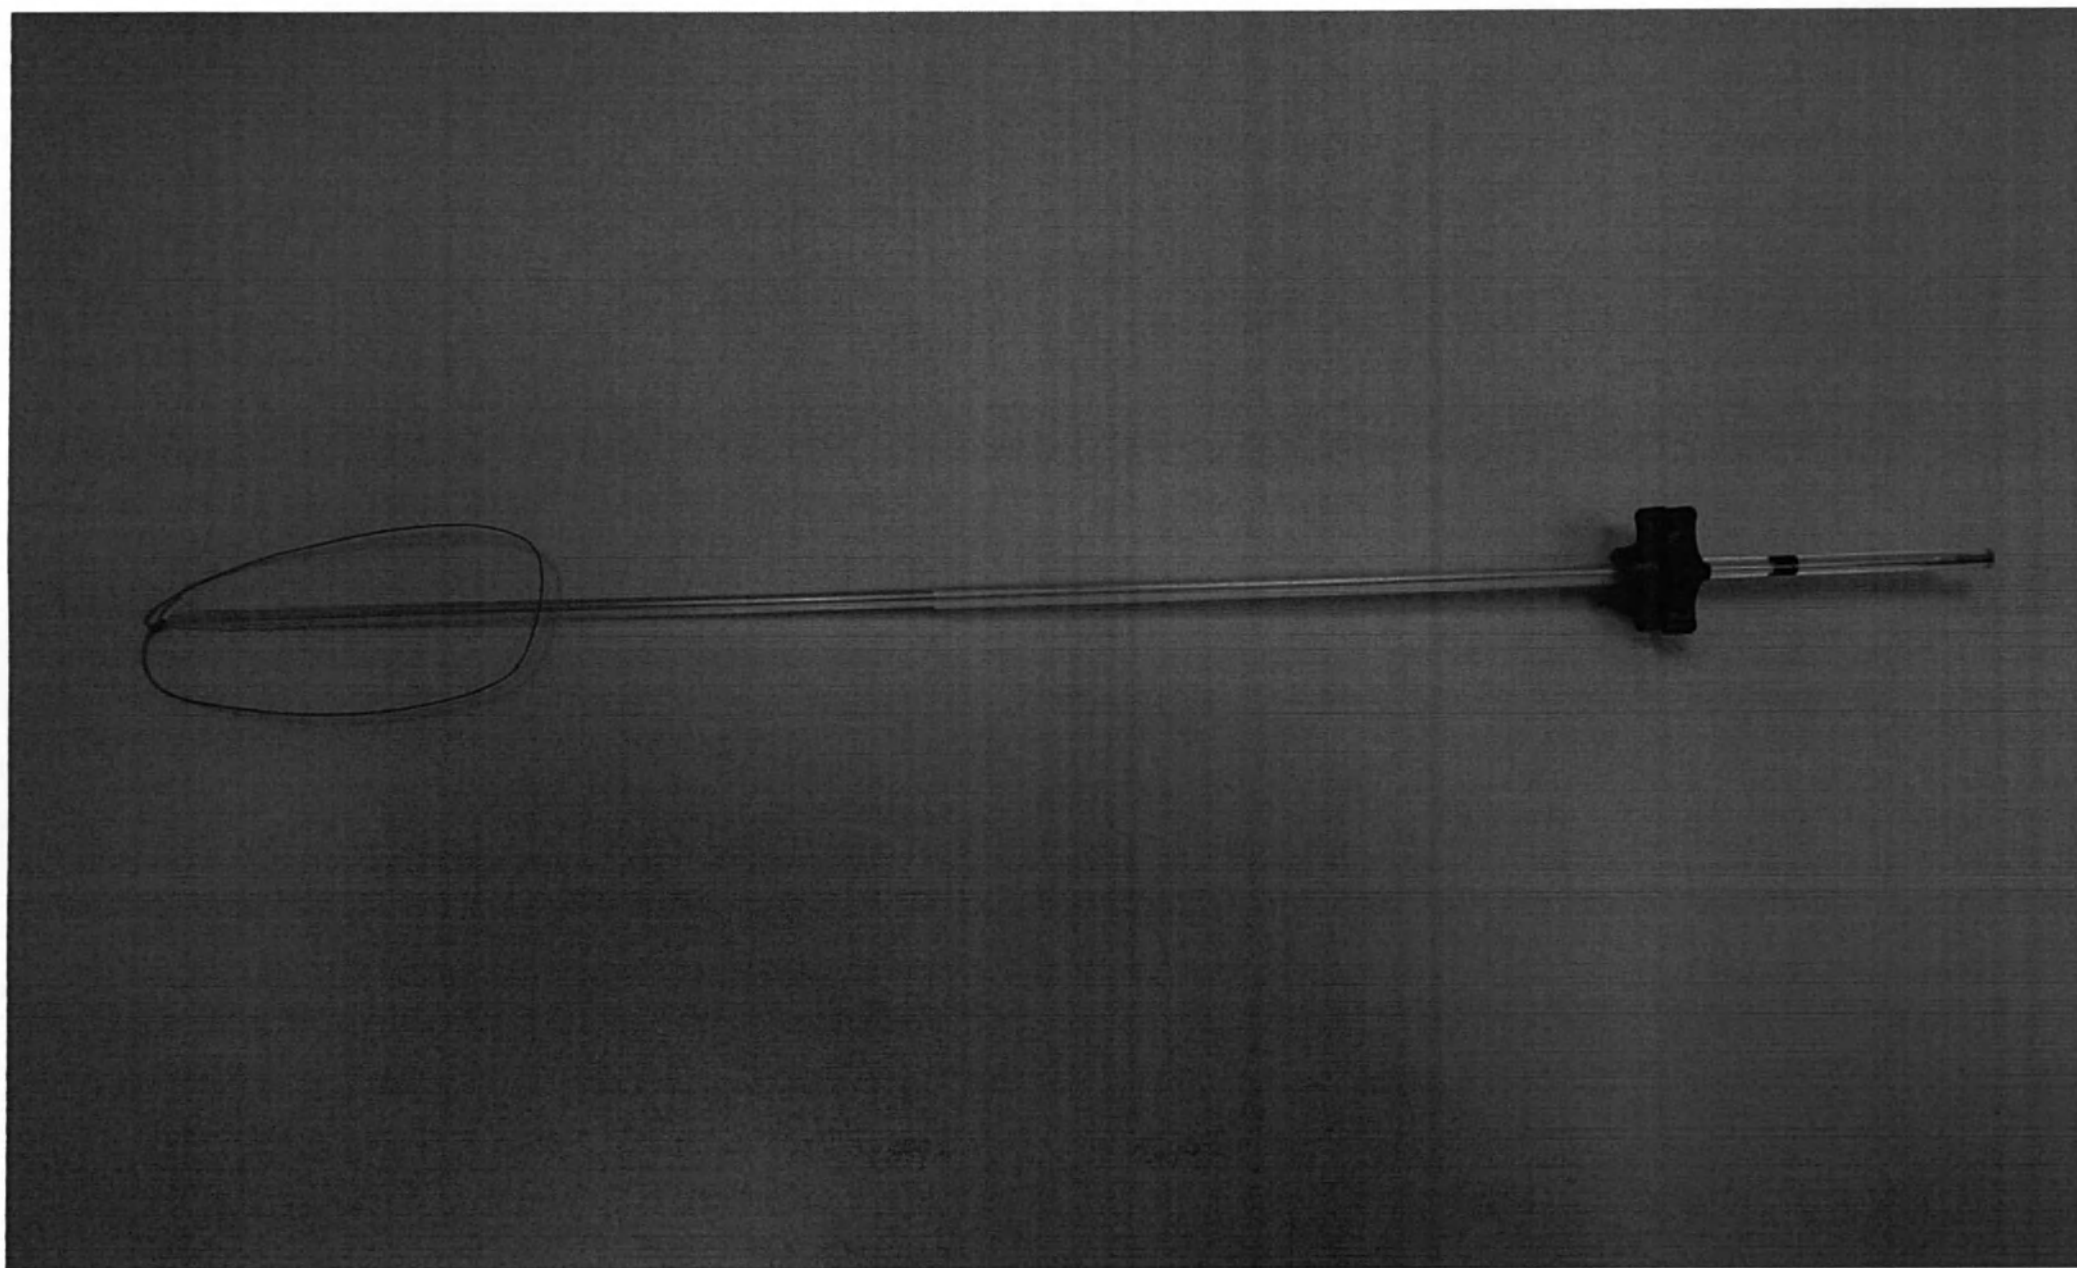
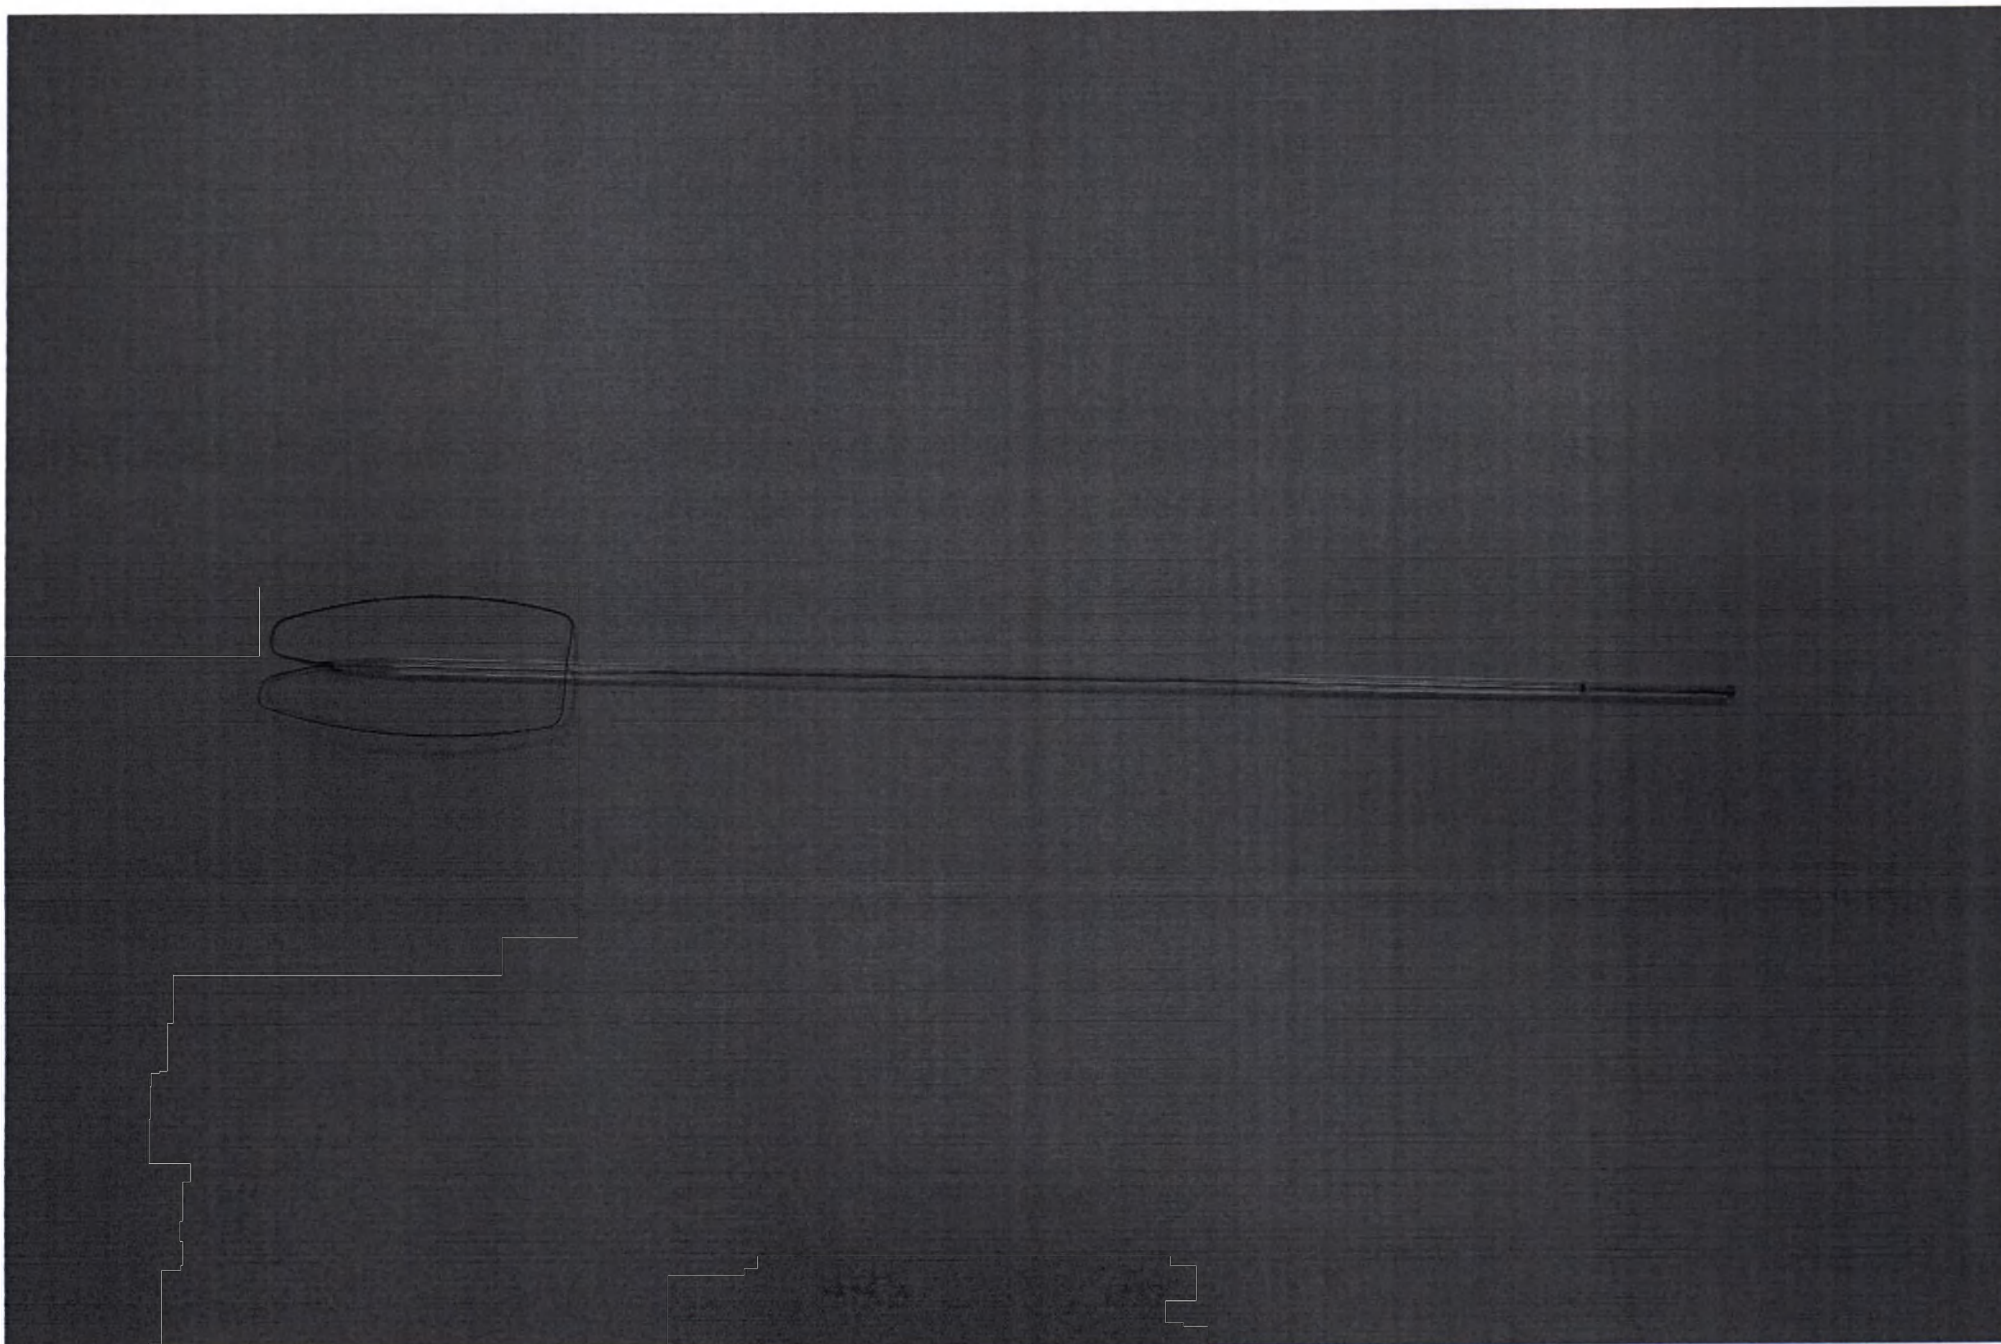
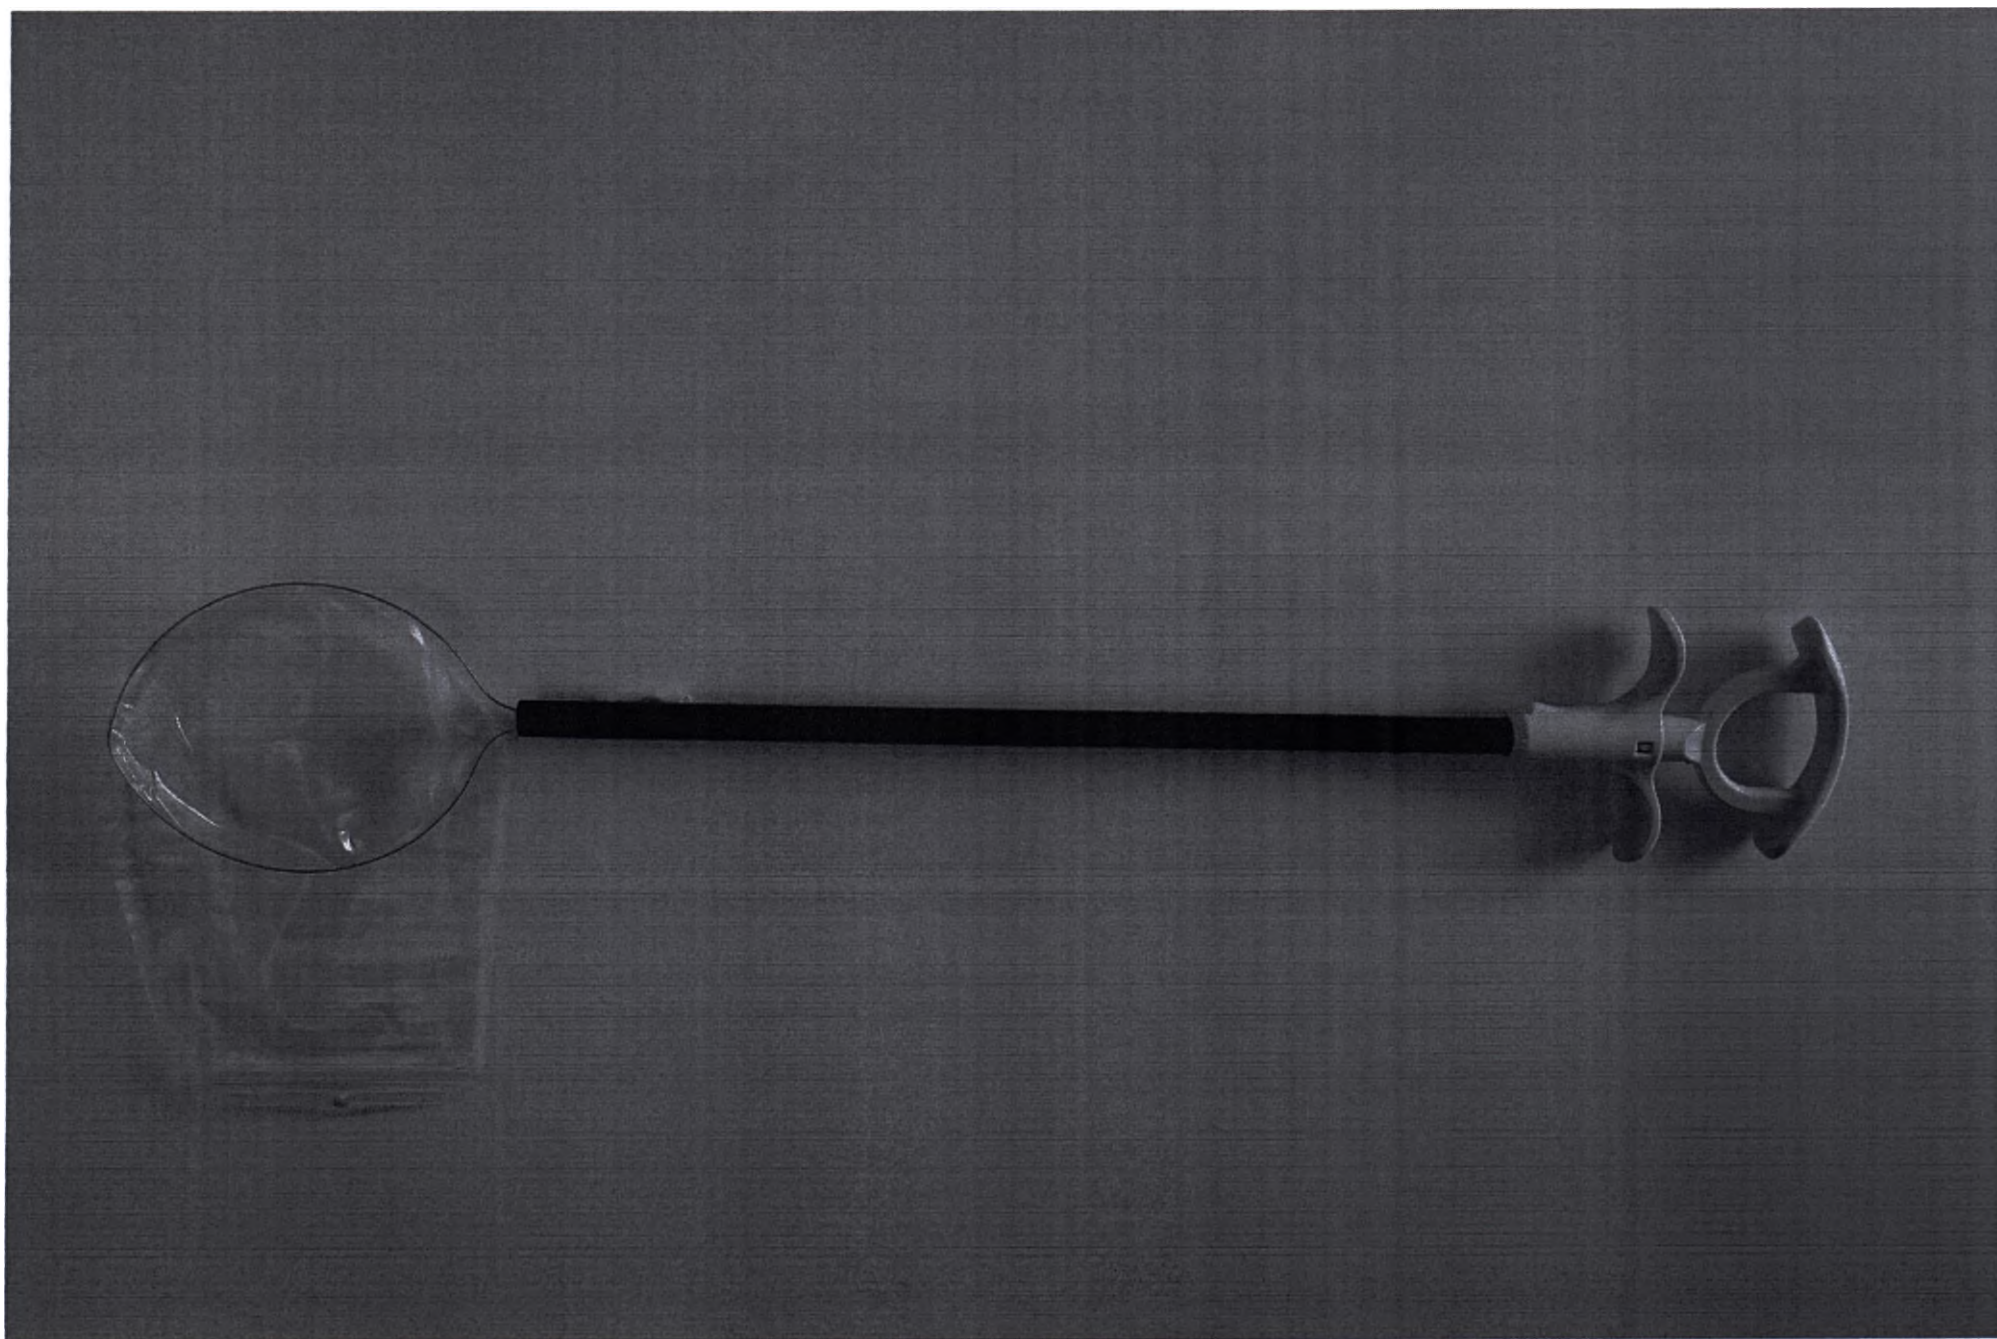
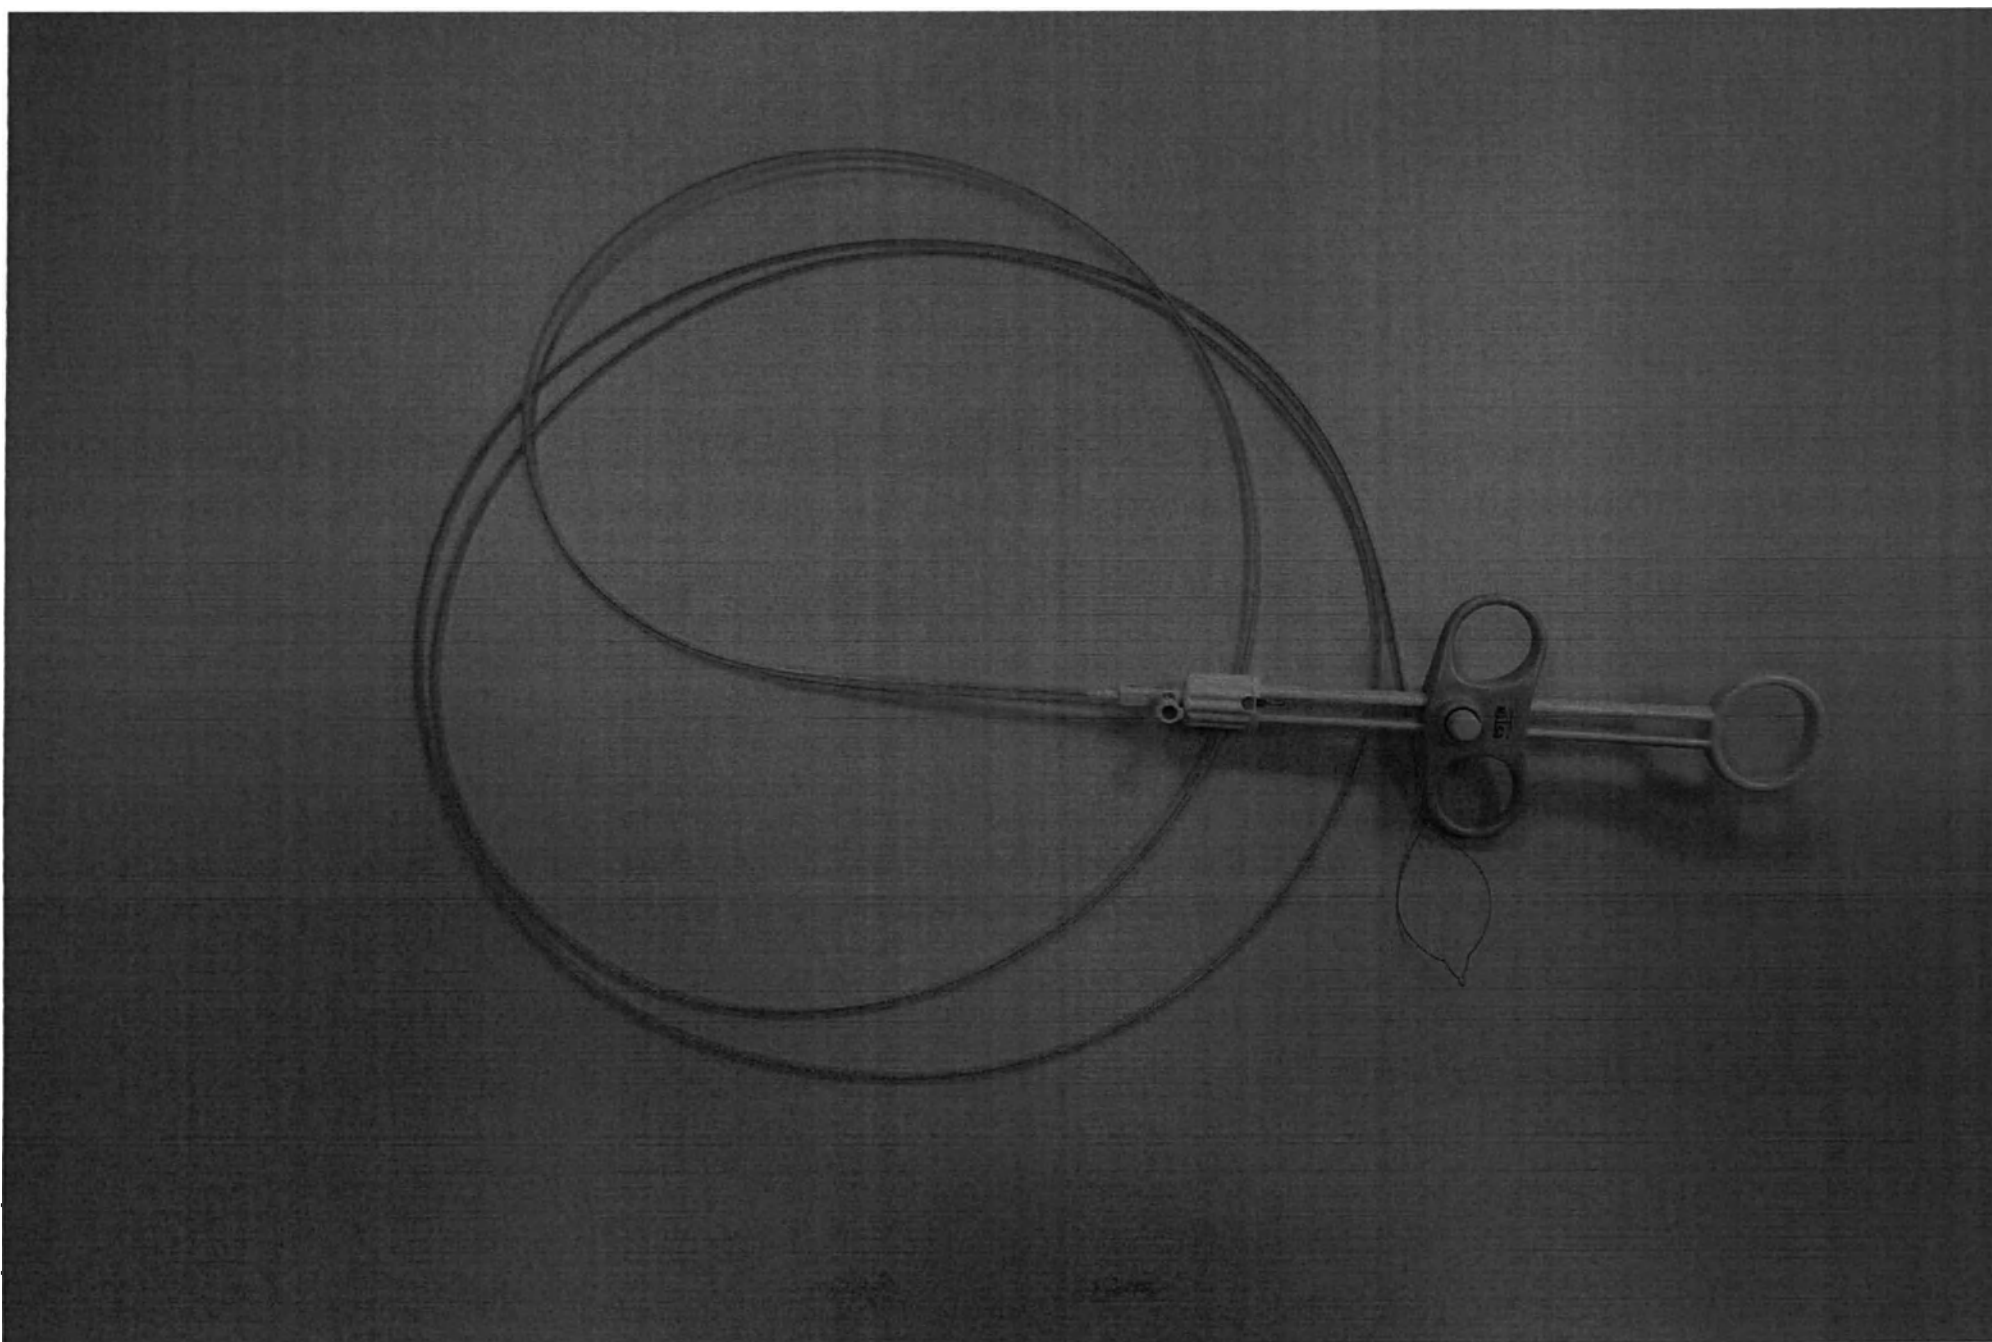
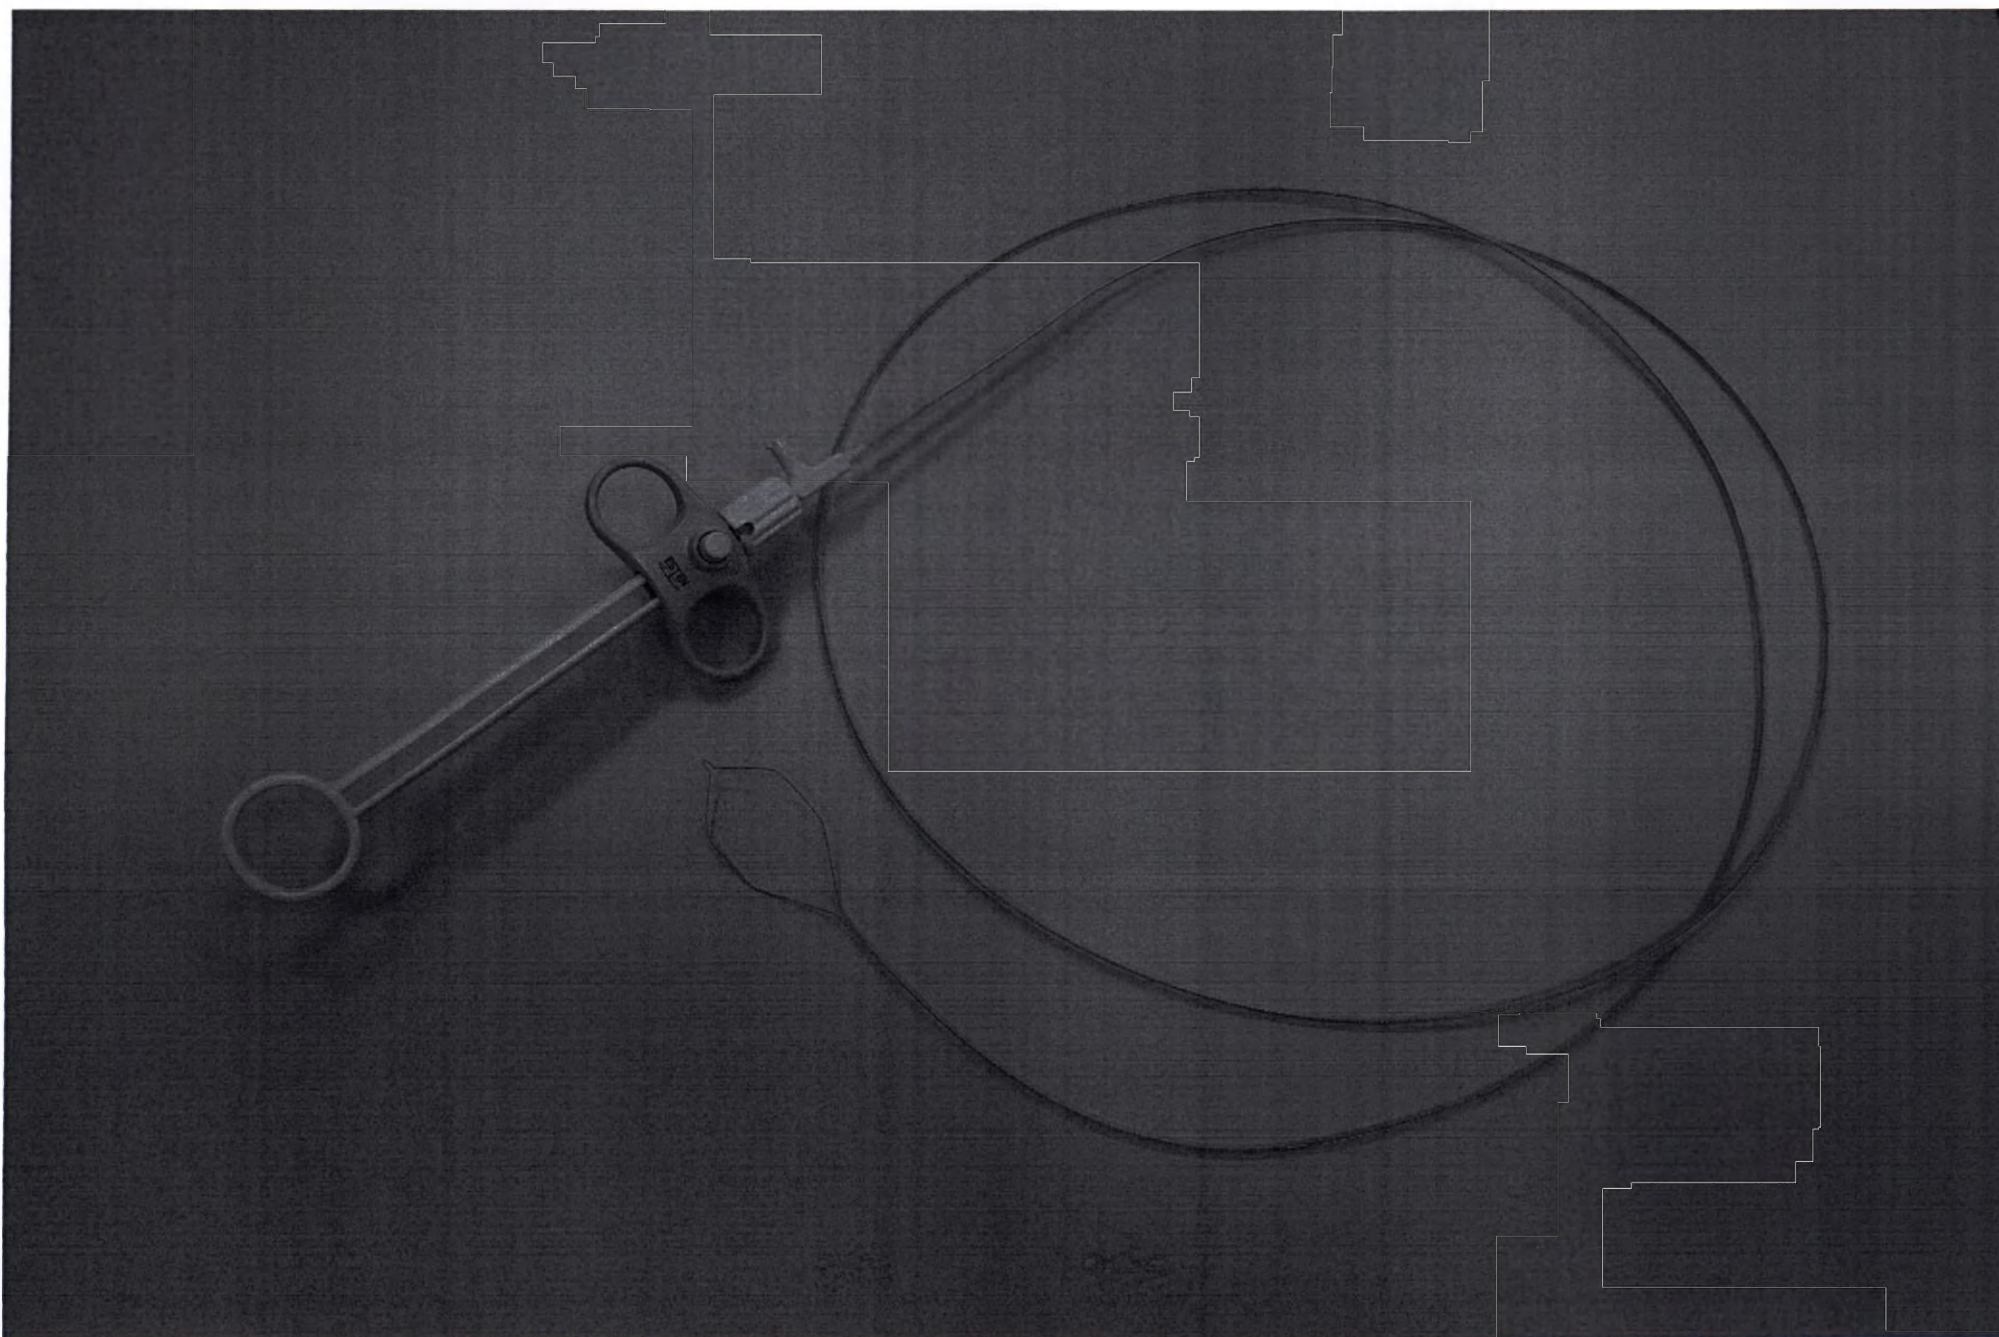



Рис.48 Эндолигатура с петлей типа Мельзе стерильная (без упаковки)









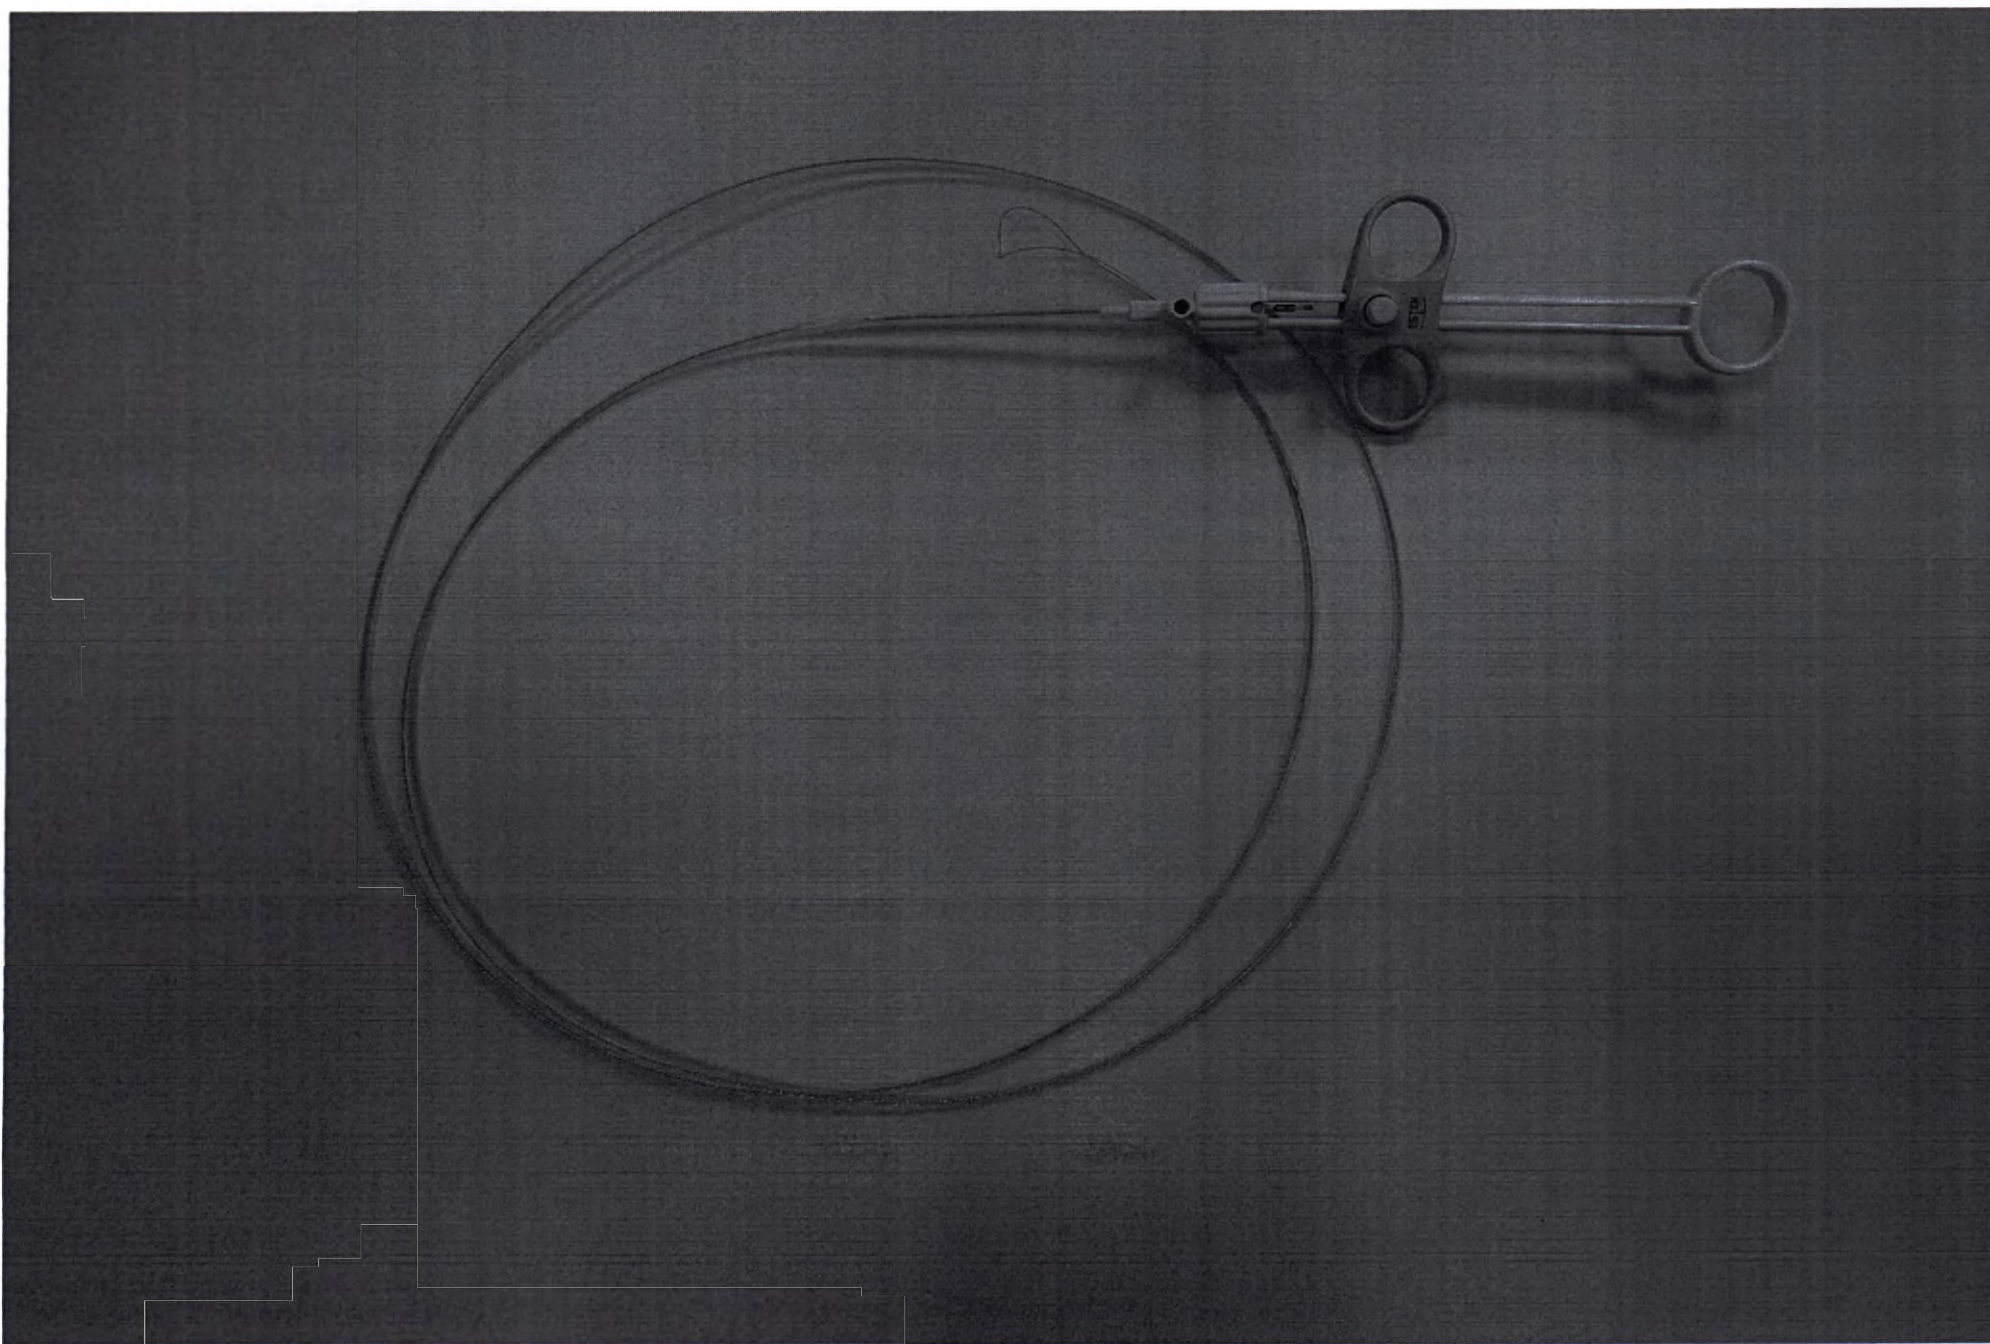


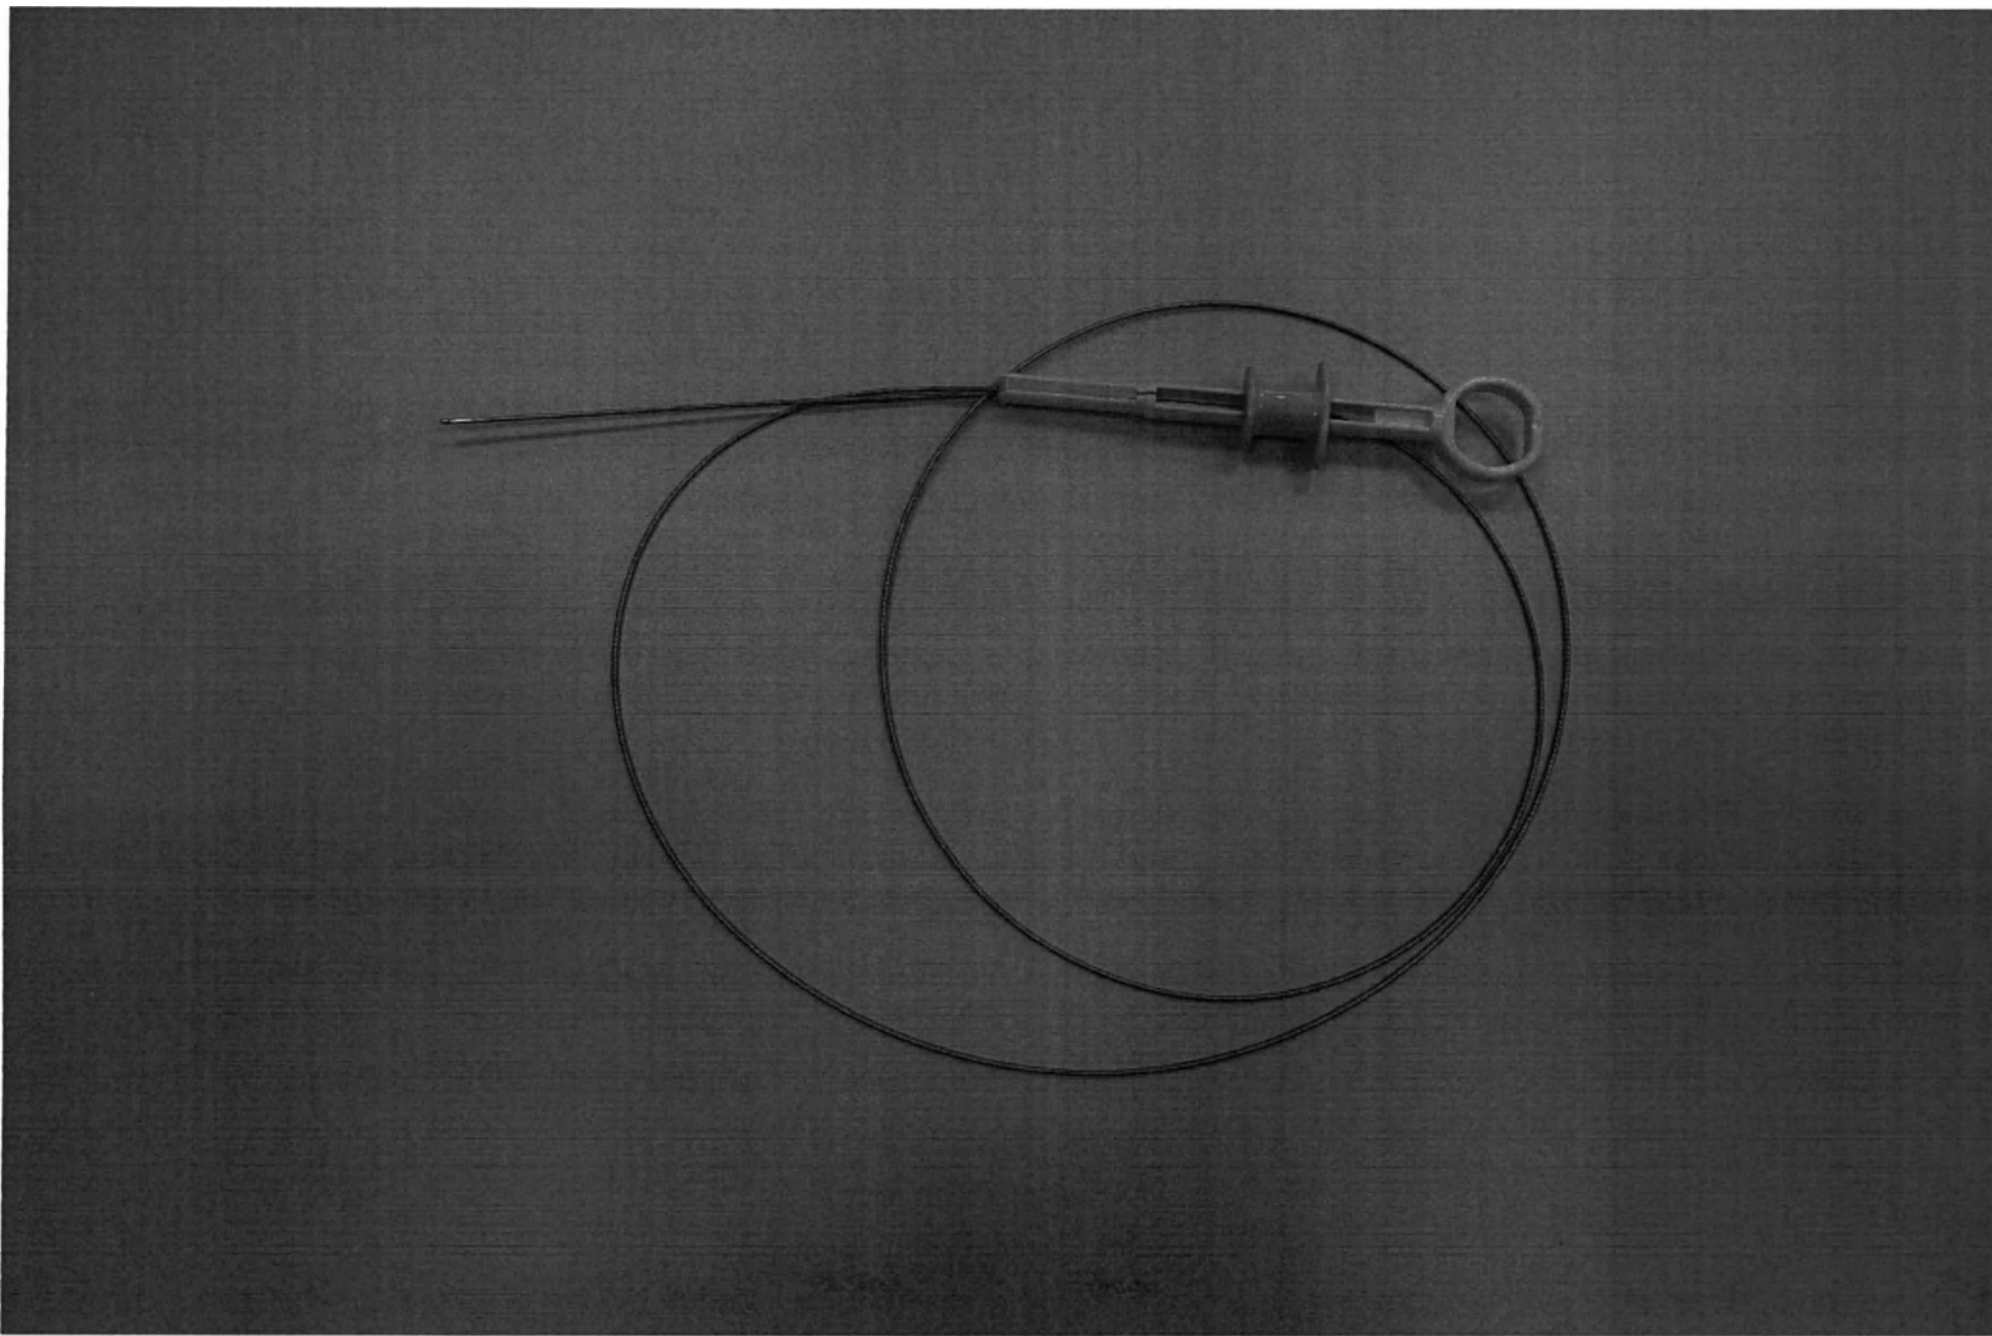


Рис. 54 Щипцы биопсийные с круглыми чашками стерильные (без упаковки)

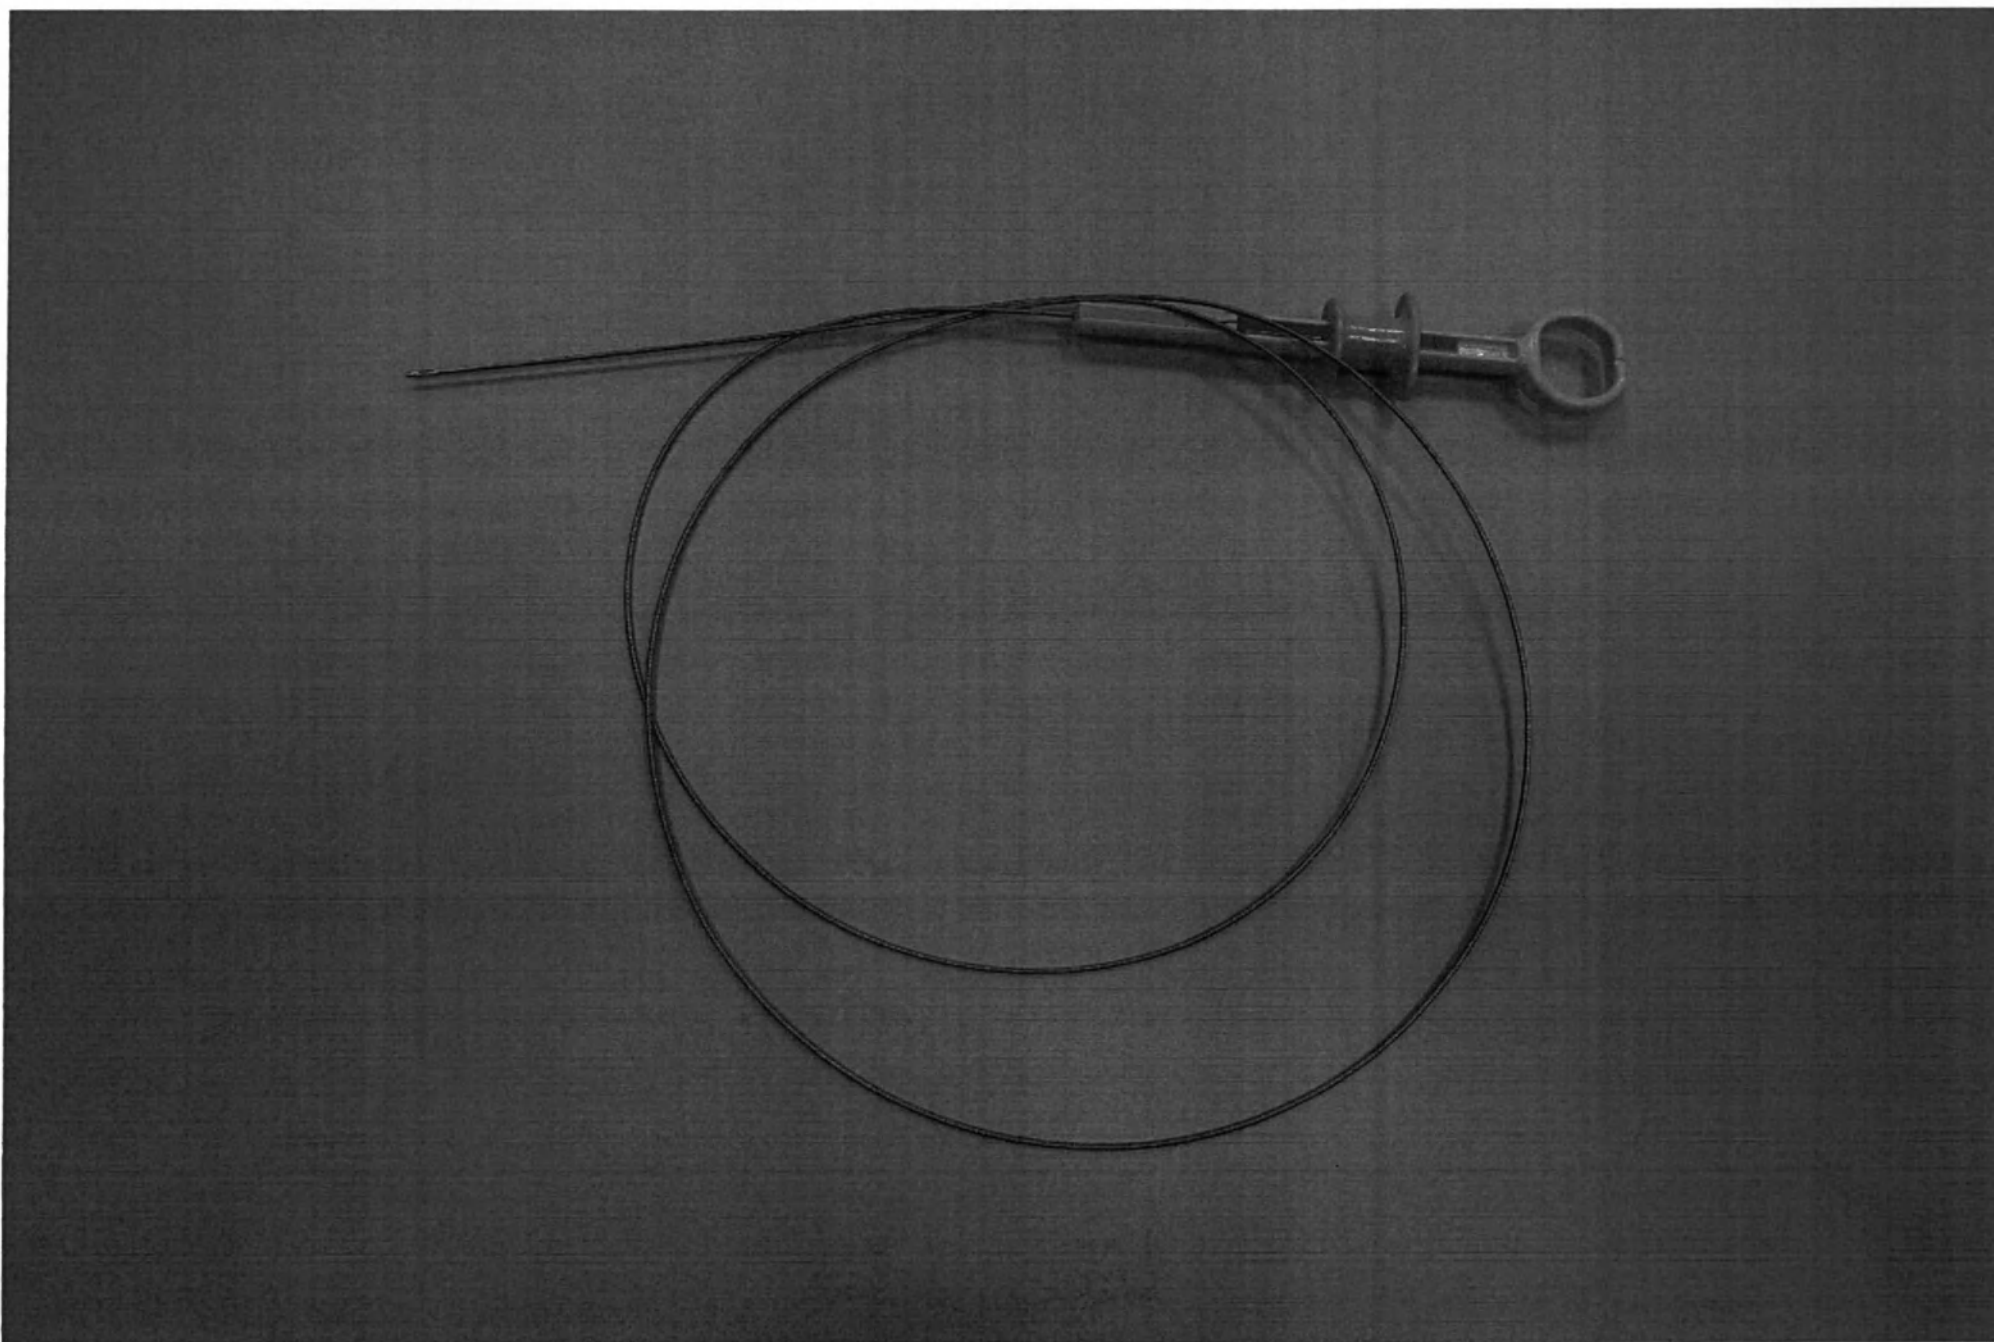

Вид 55 ПЦипцы биопсийные с круглыми чашками с иглой стерильные (без упаковки)




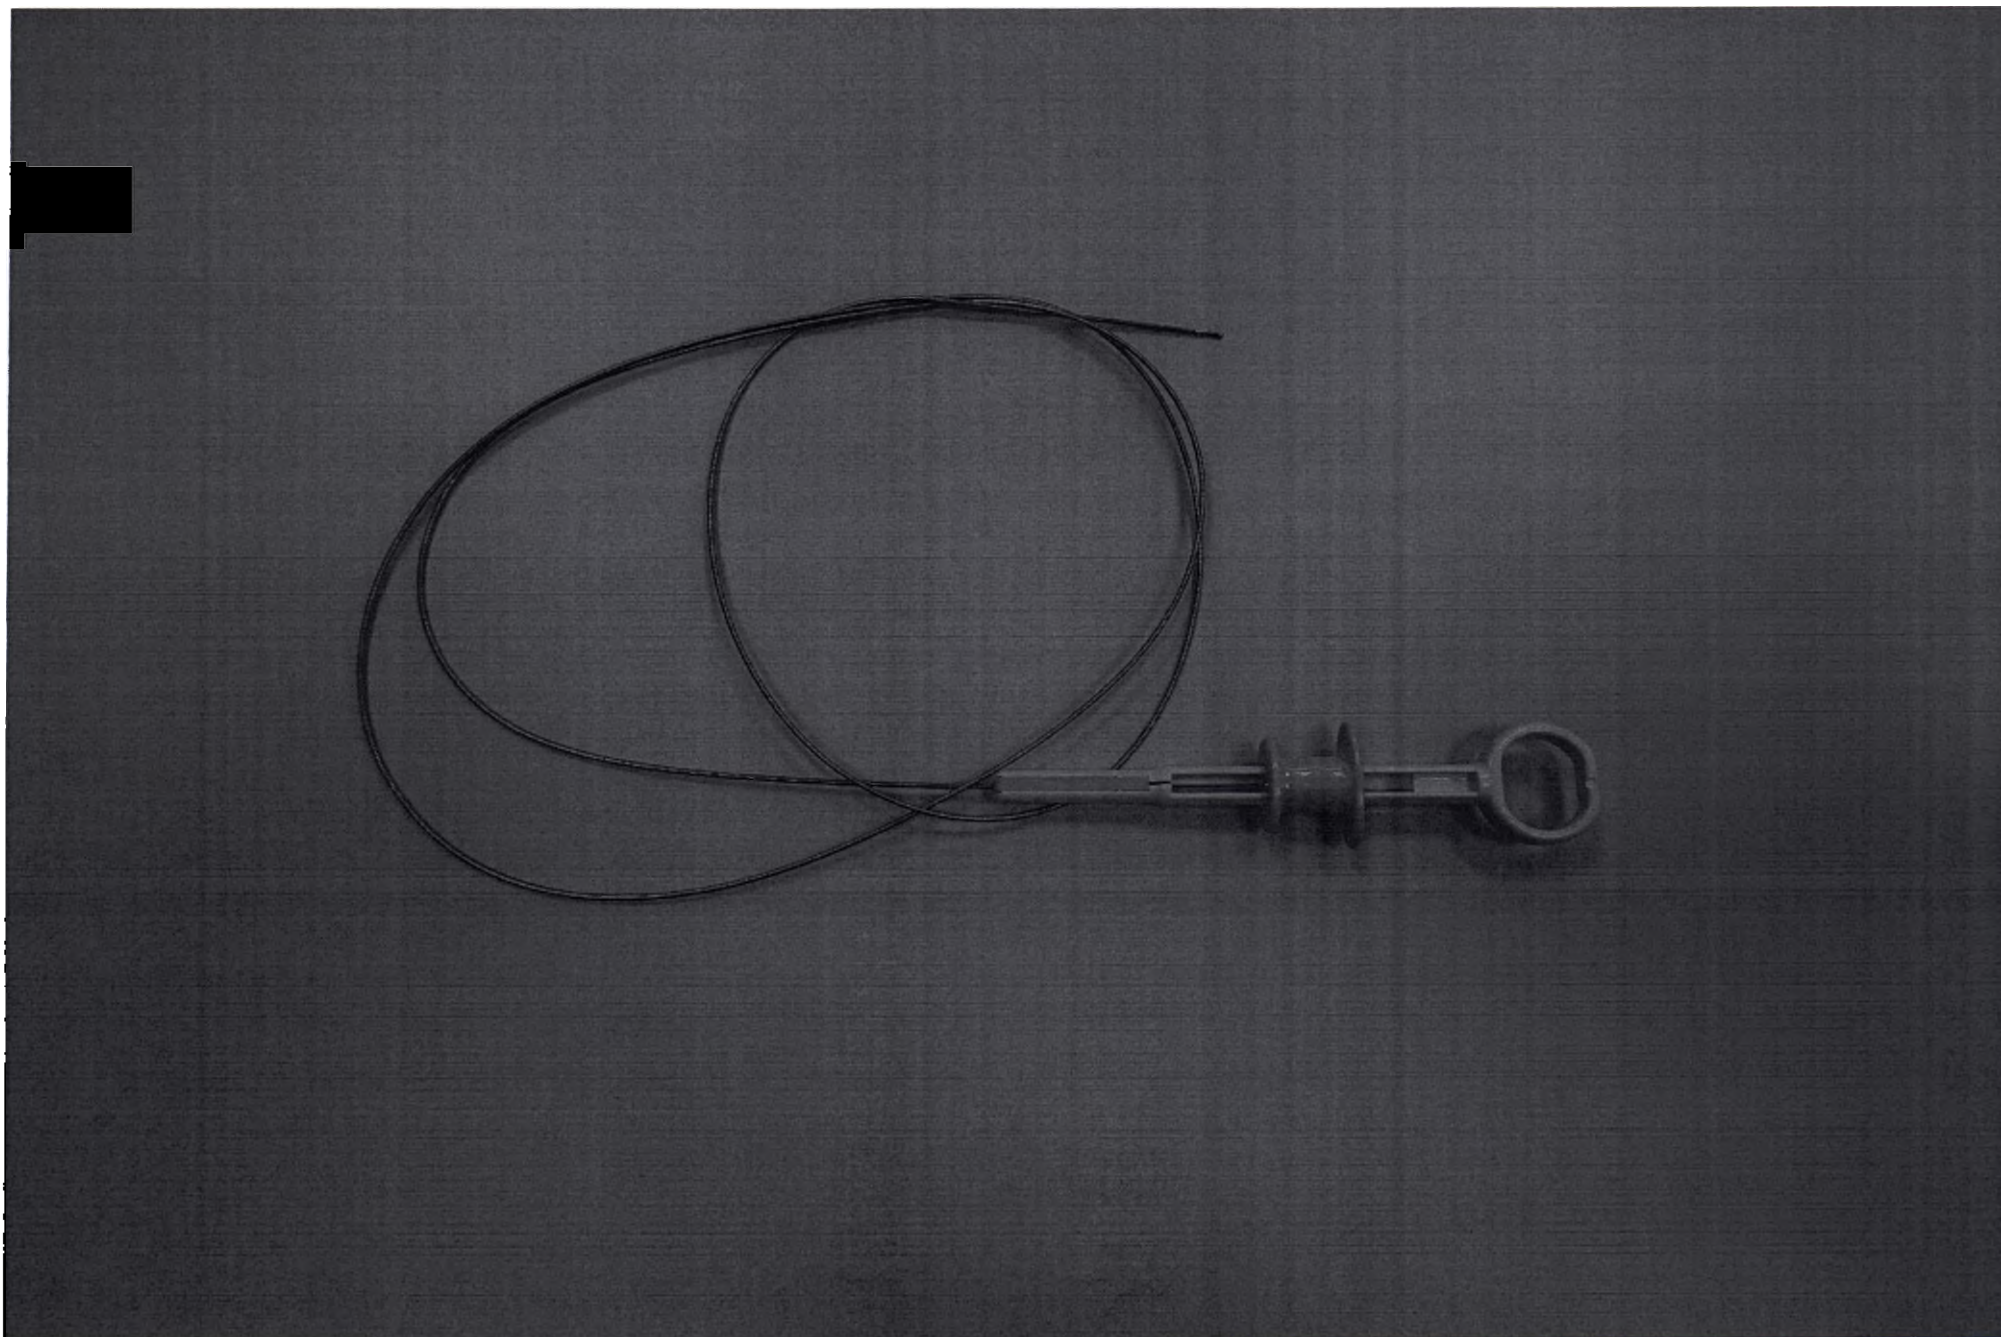


Рис. 56 Щипцы биопсийные с овальными чашками стерильные (без упаковки)

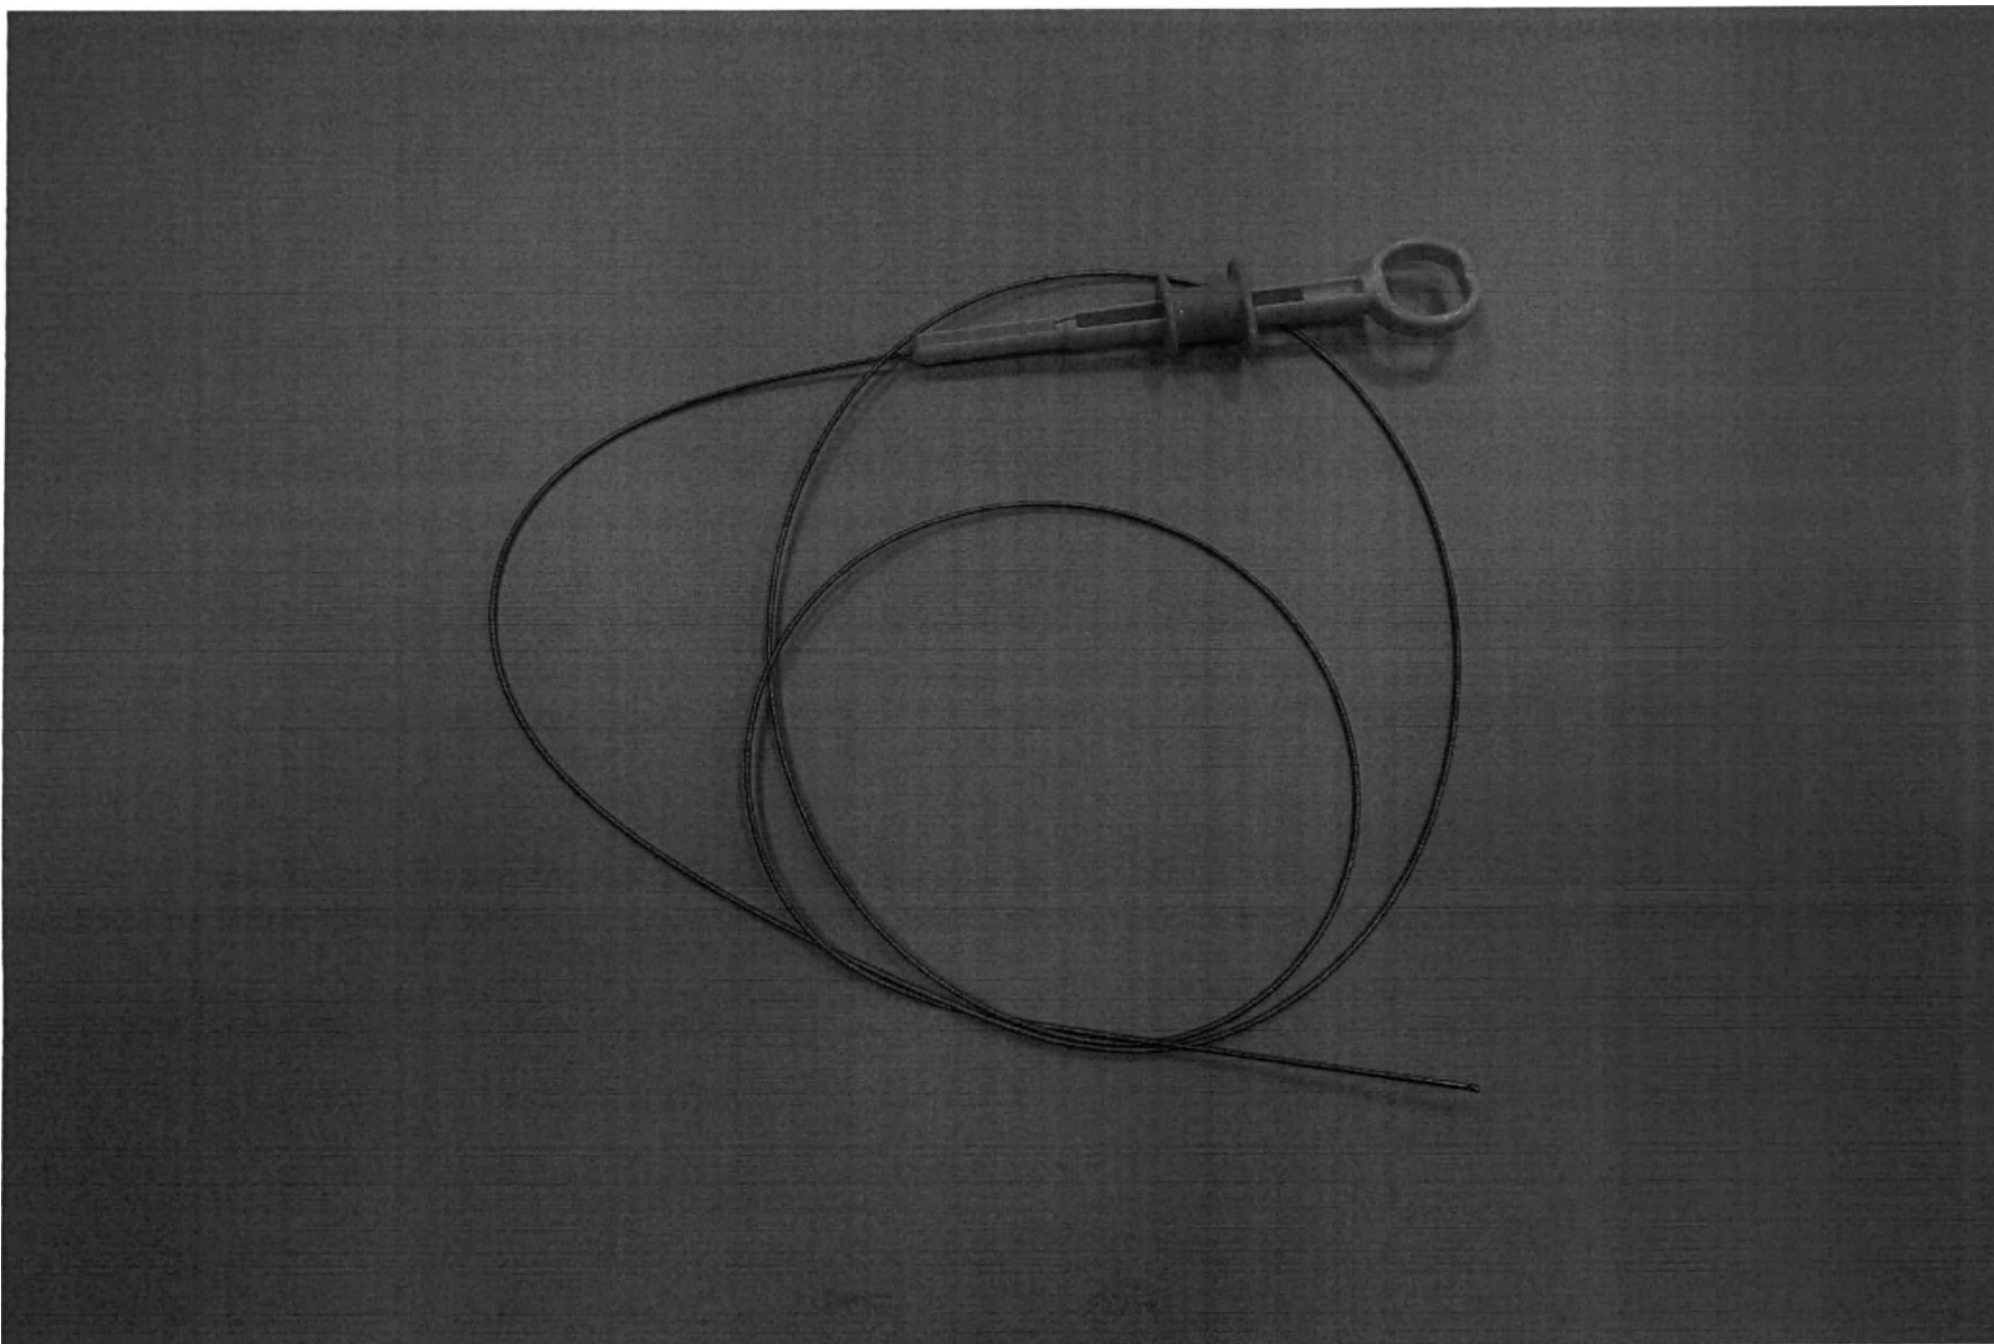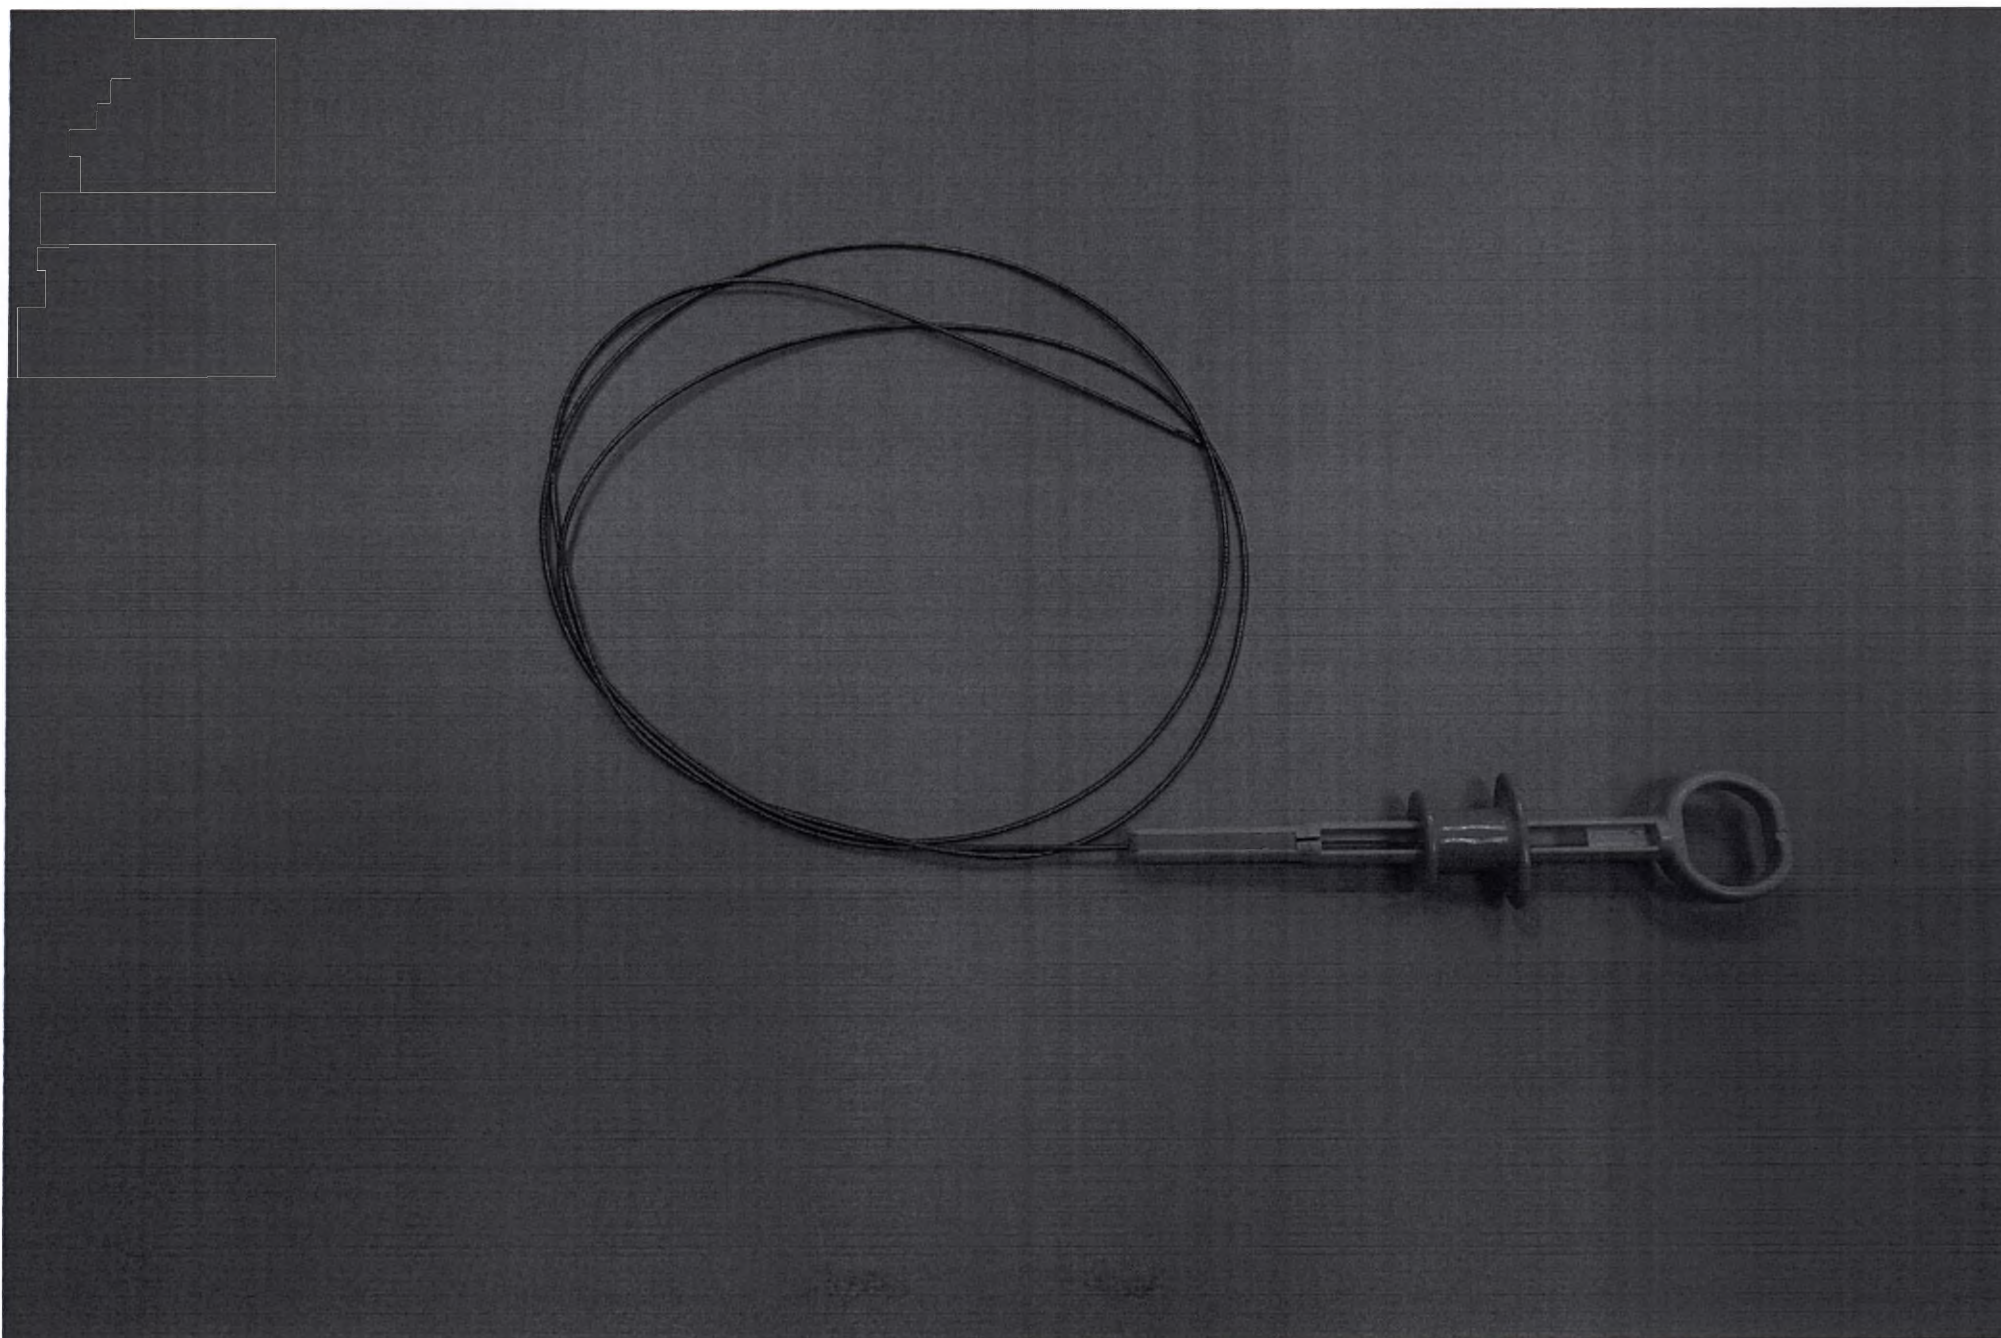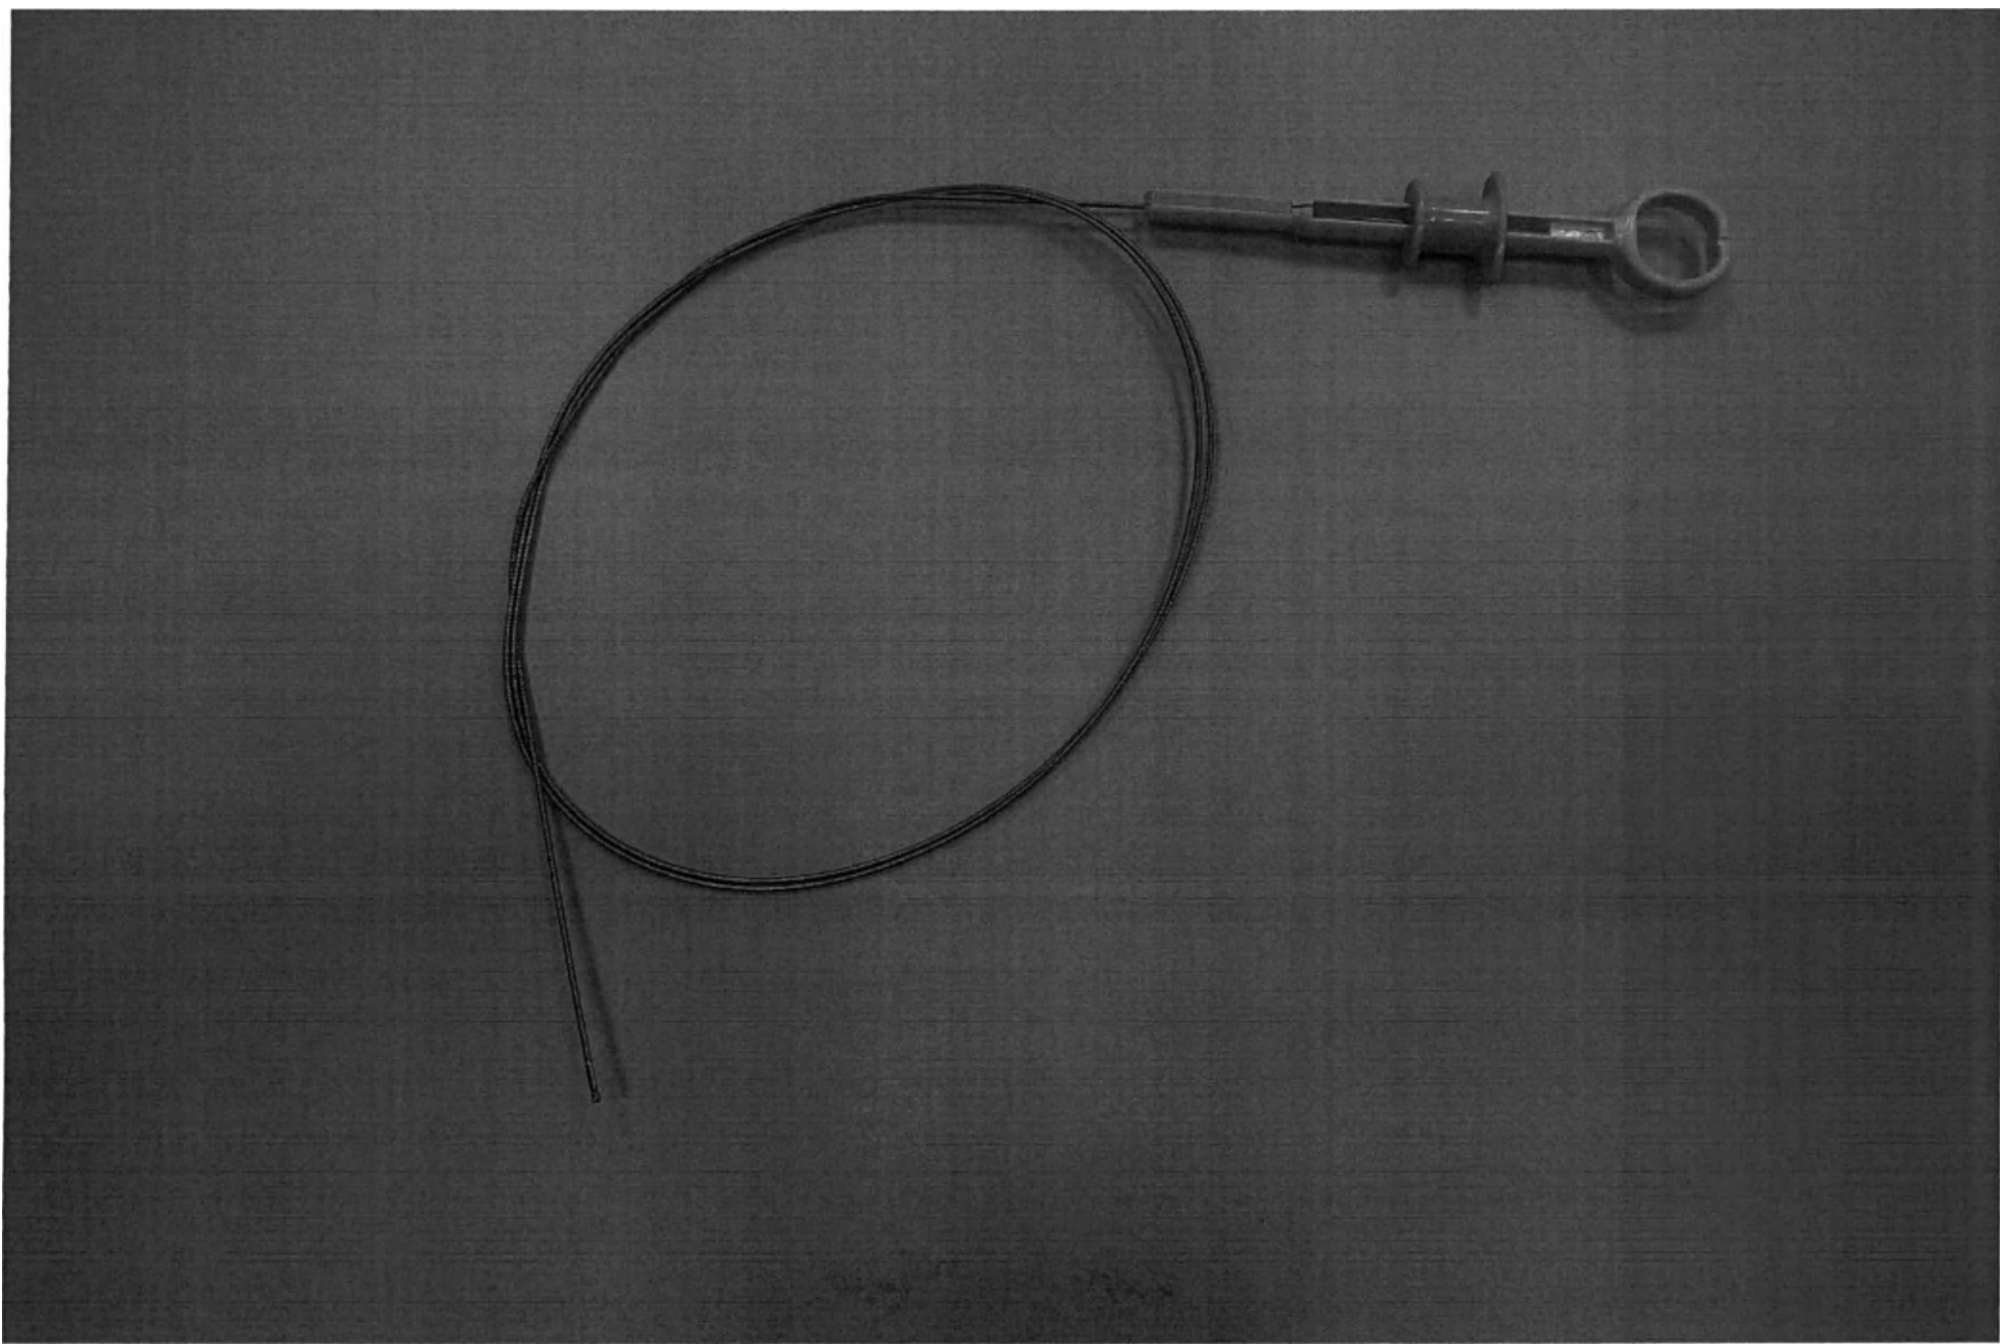

В-12 57 III щипцы биопсийные с овальными чашками с иглой стерильные (без упаковки)







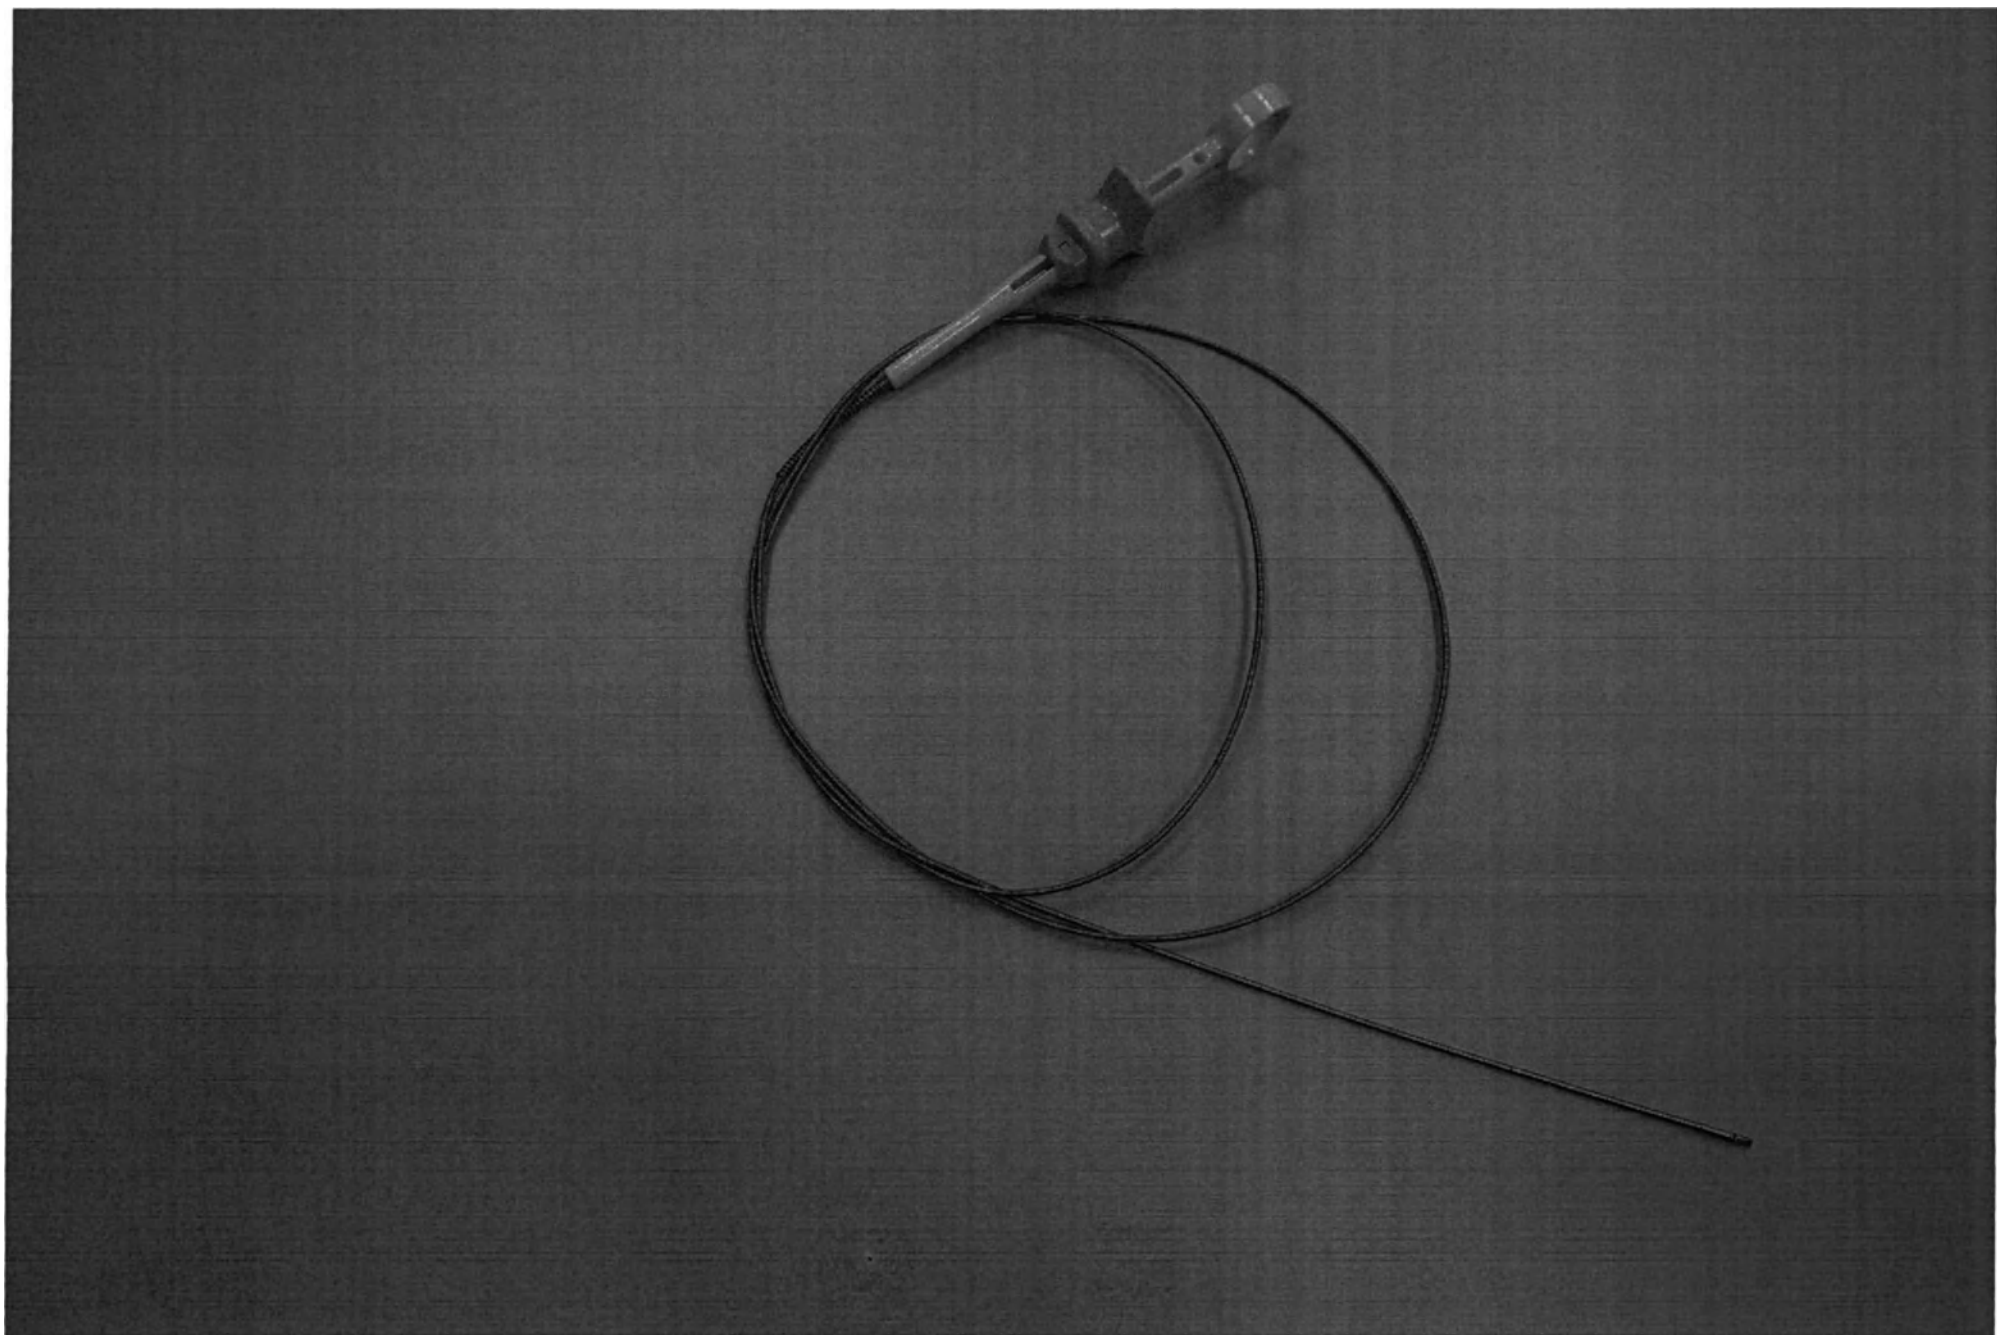


Рис 61 Шпатель для удаления инородных тел типа «крысиный зуб» стерильные (без упаковки)

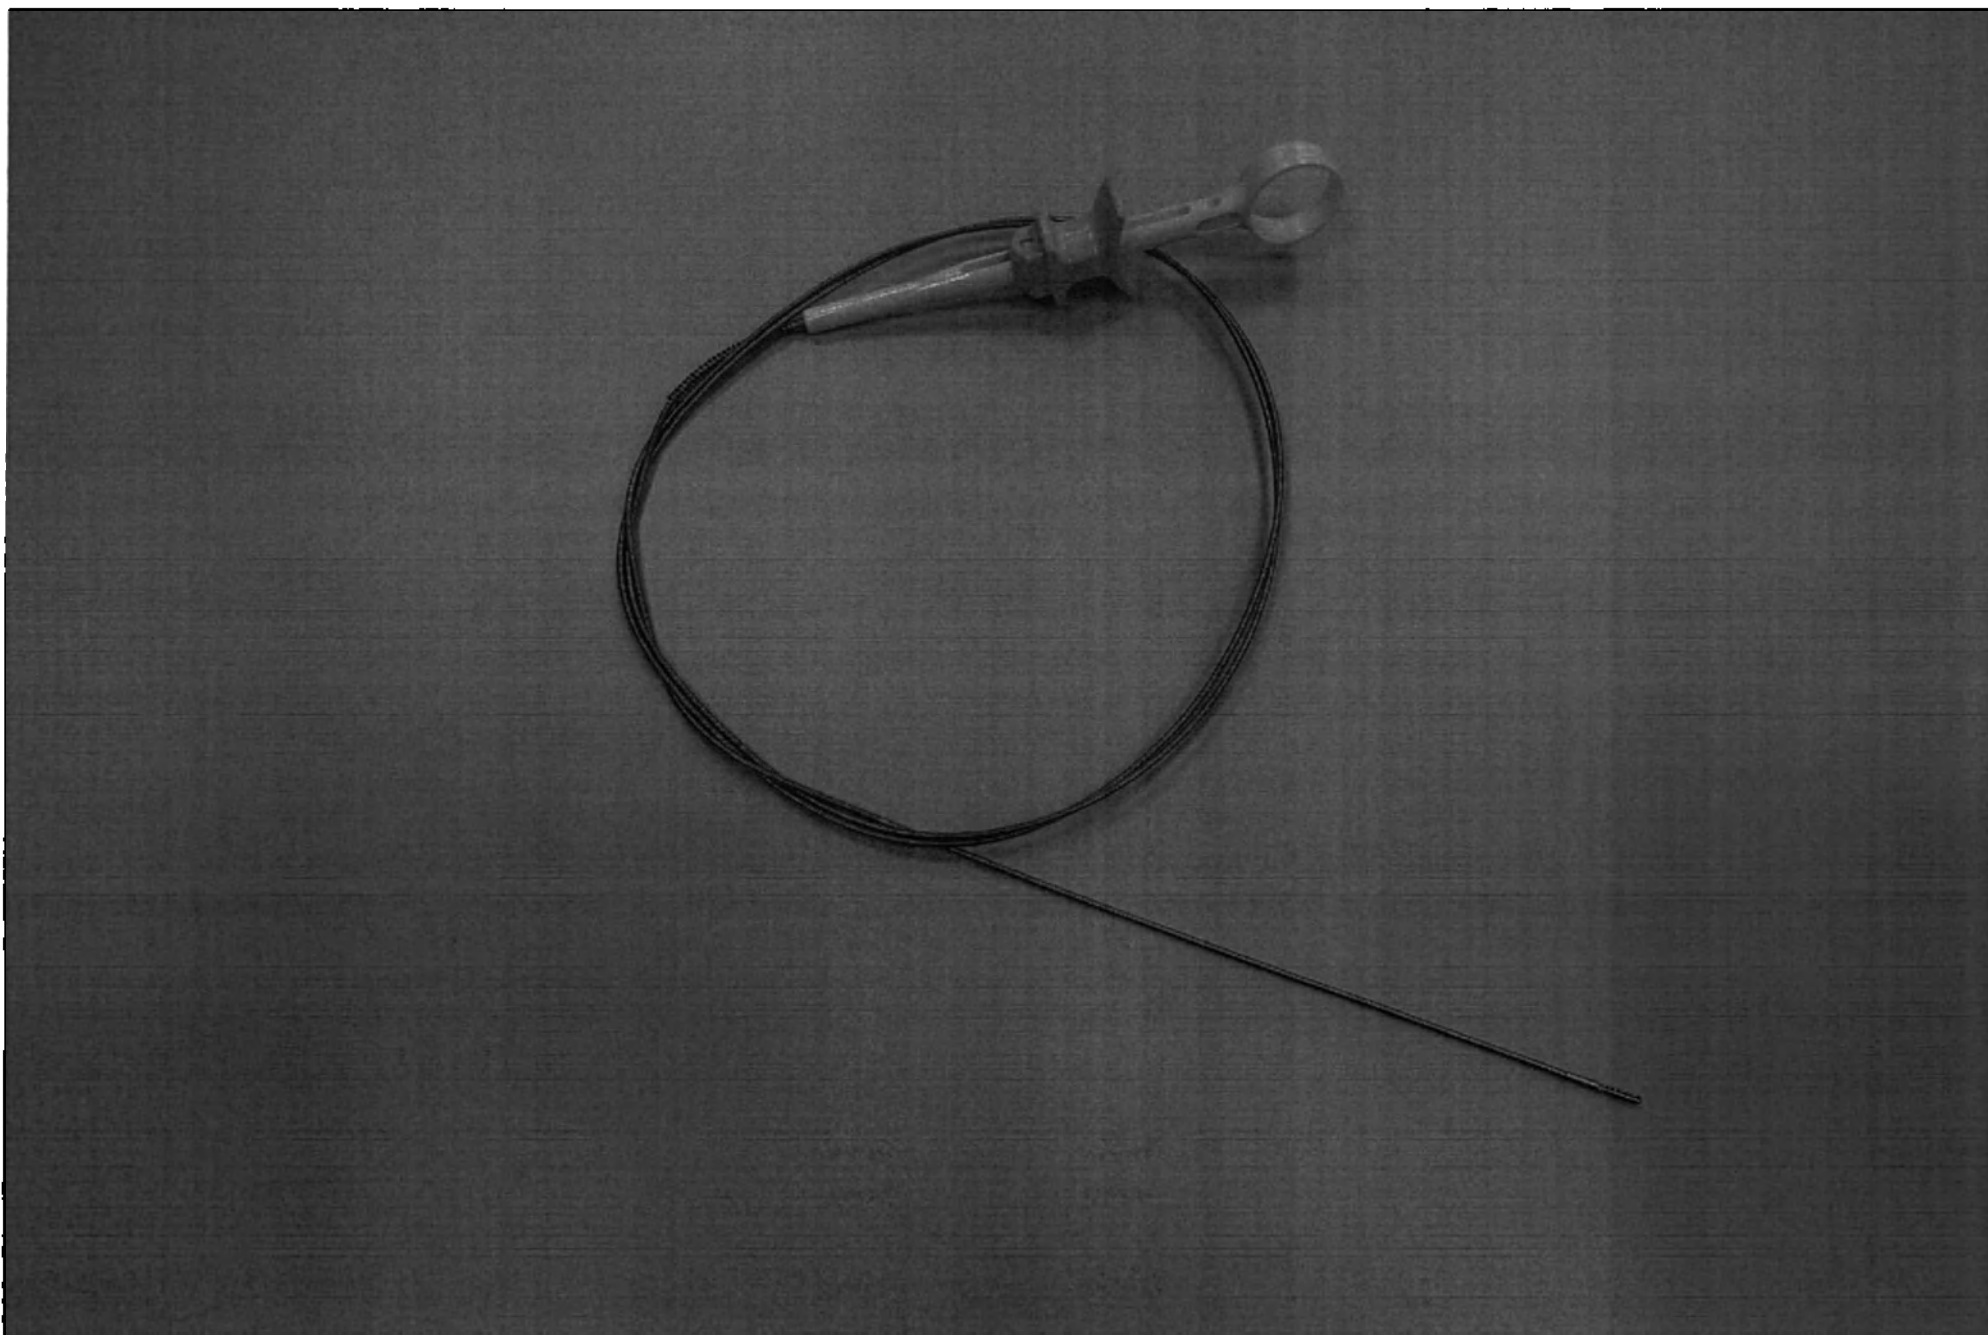


Рис 62 Шланг для удаления инородных тел типа «длинный аллигатор» стерильные (без упаковки)

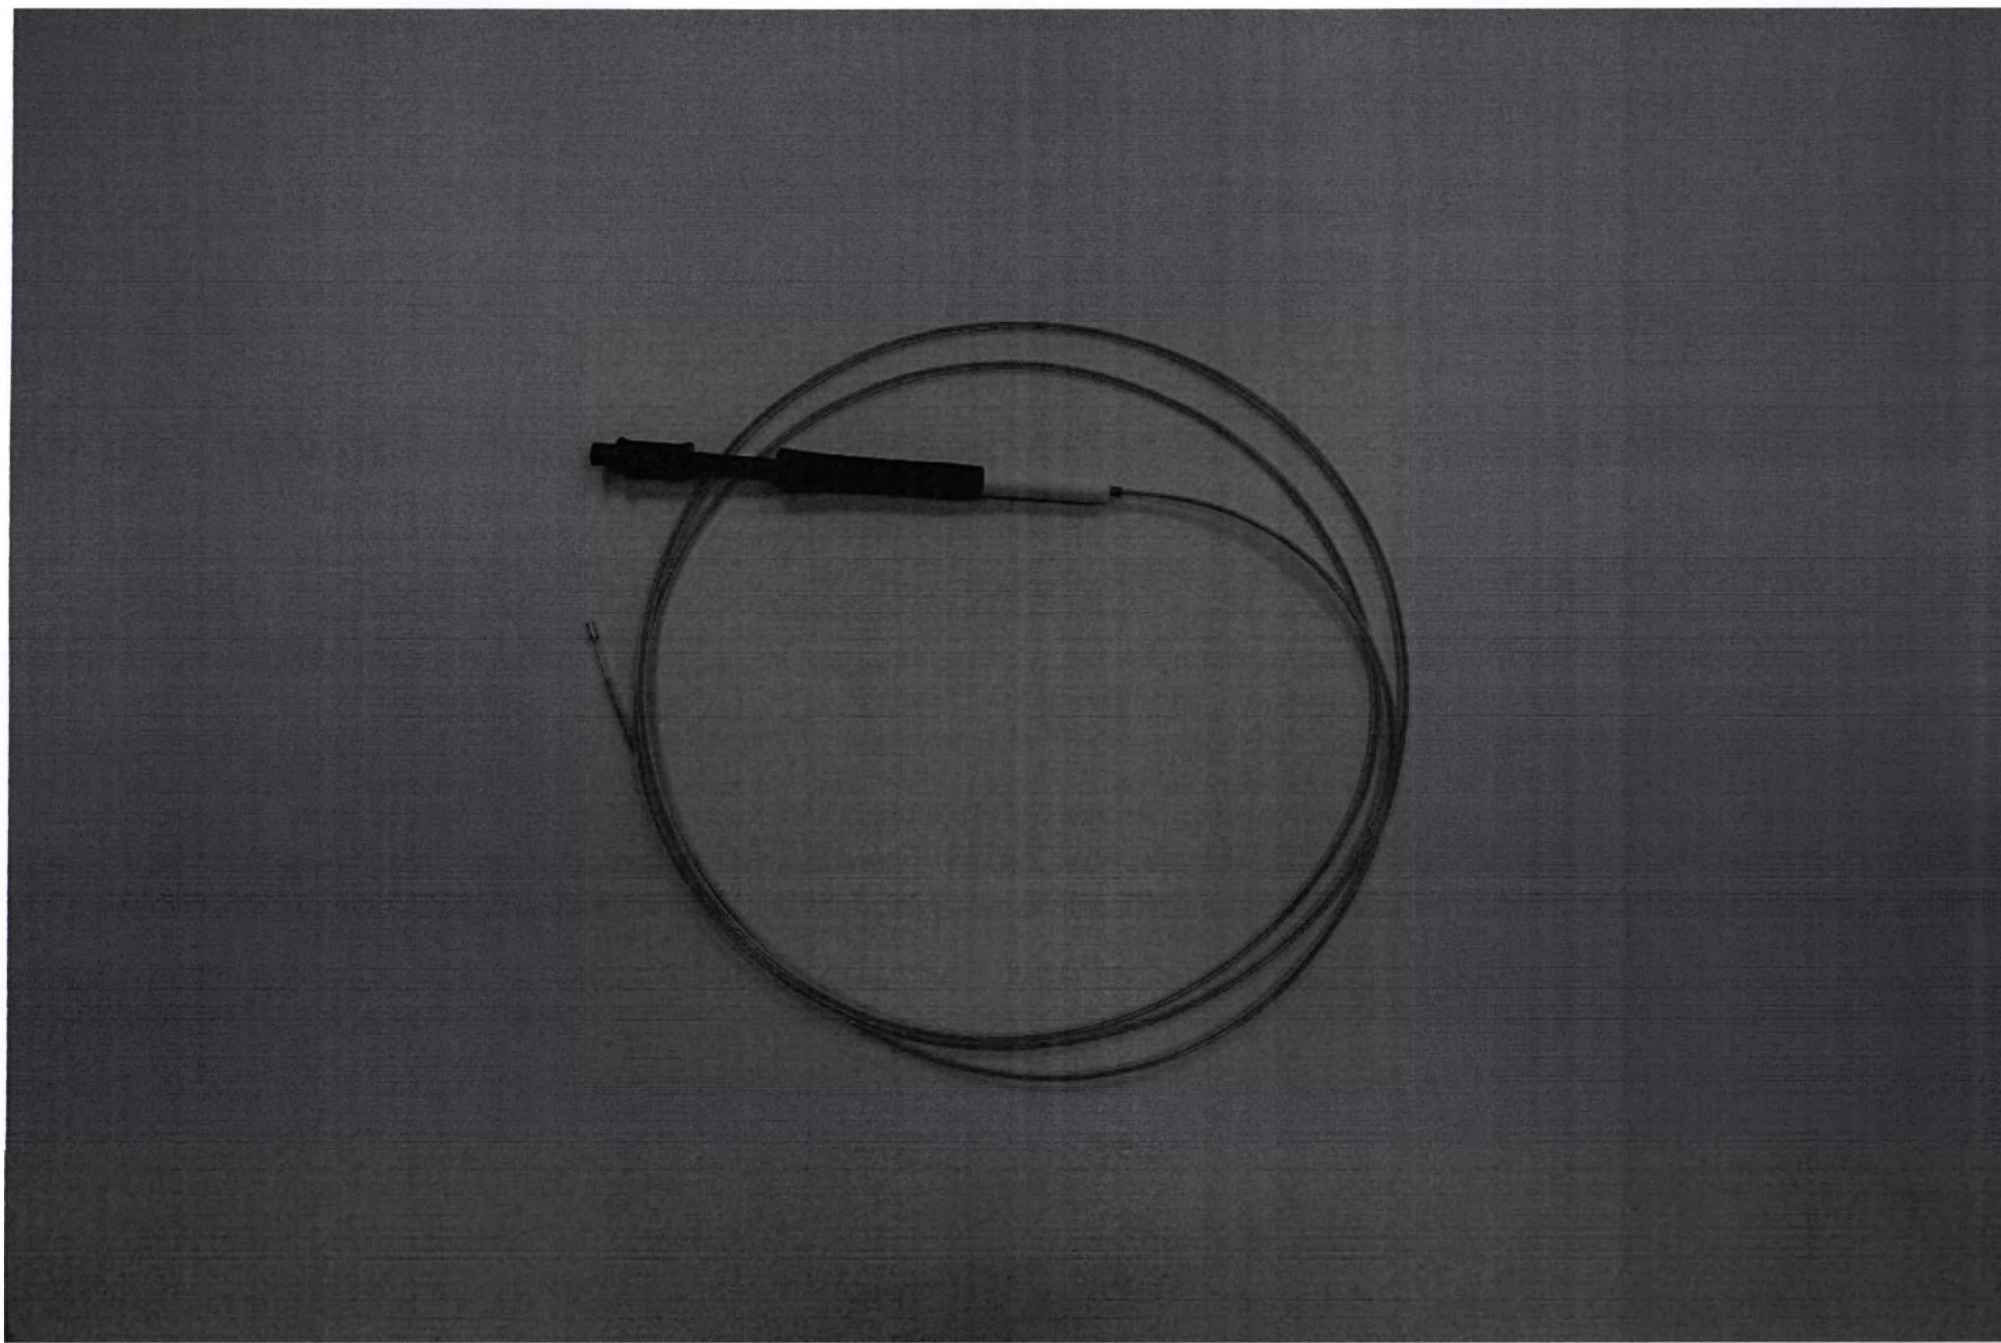


Рис.63 Игла инъекционная стерильная (без упаковки)

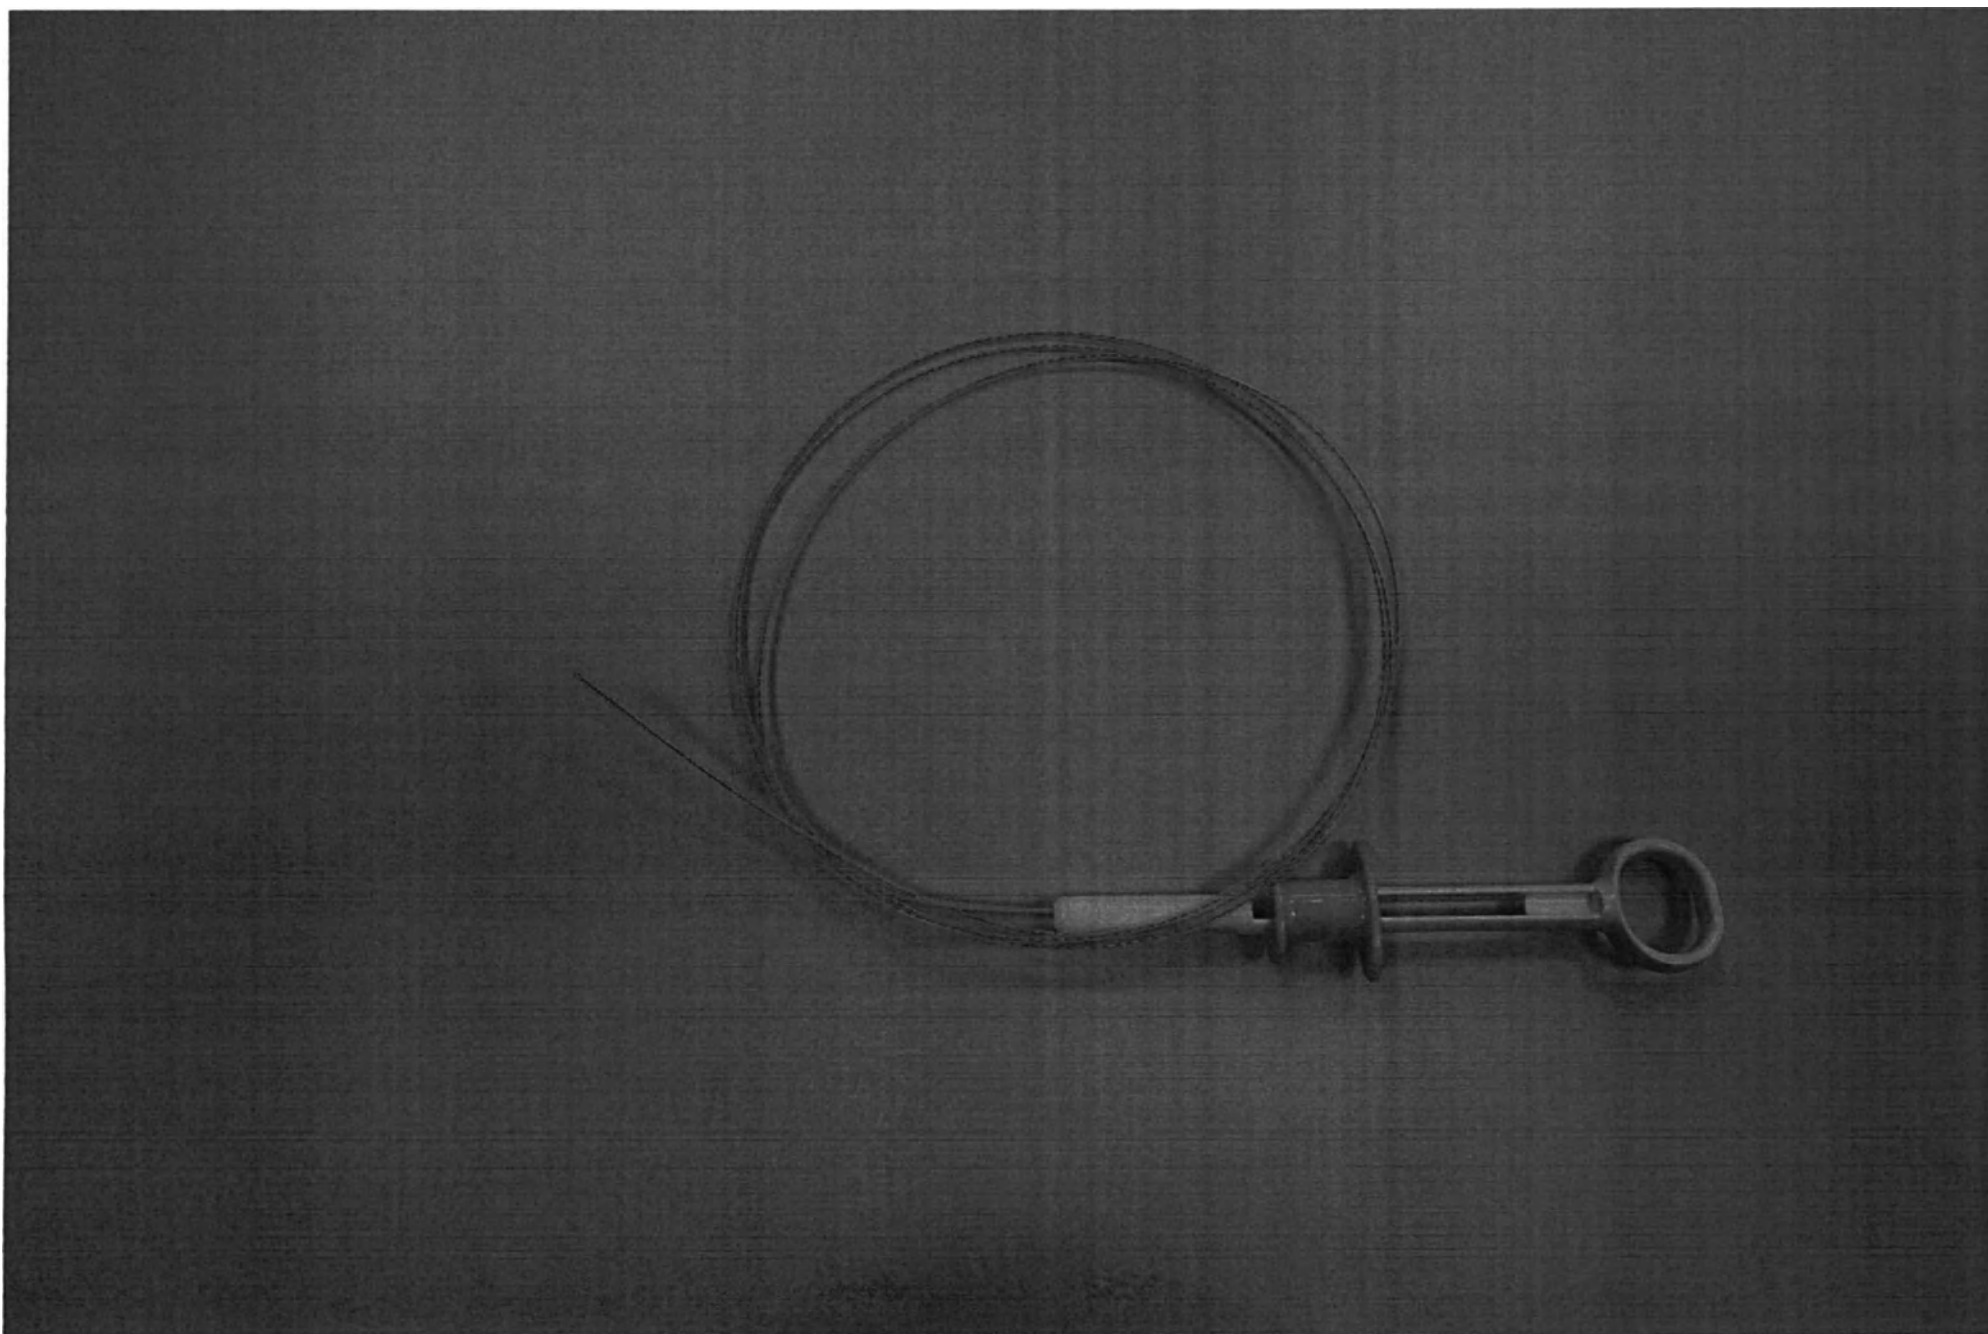


Рис.64 Ёрш цитологический стерильный (без упаковки)

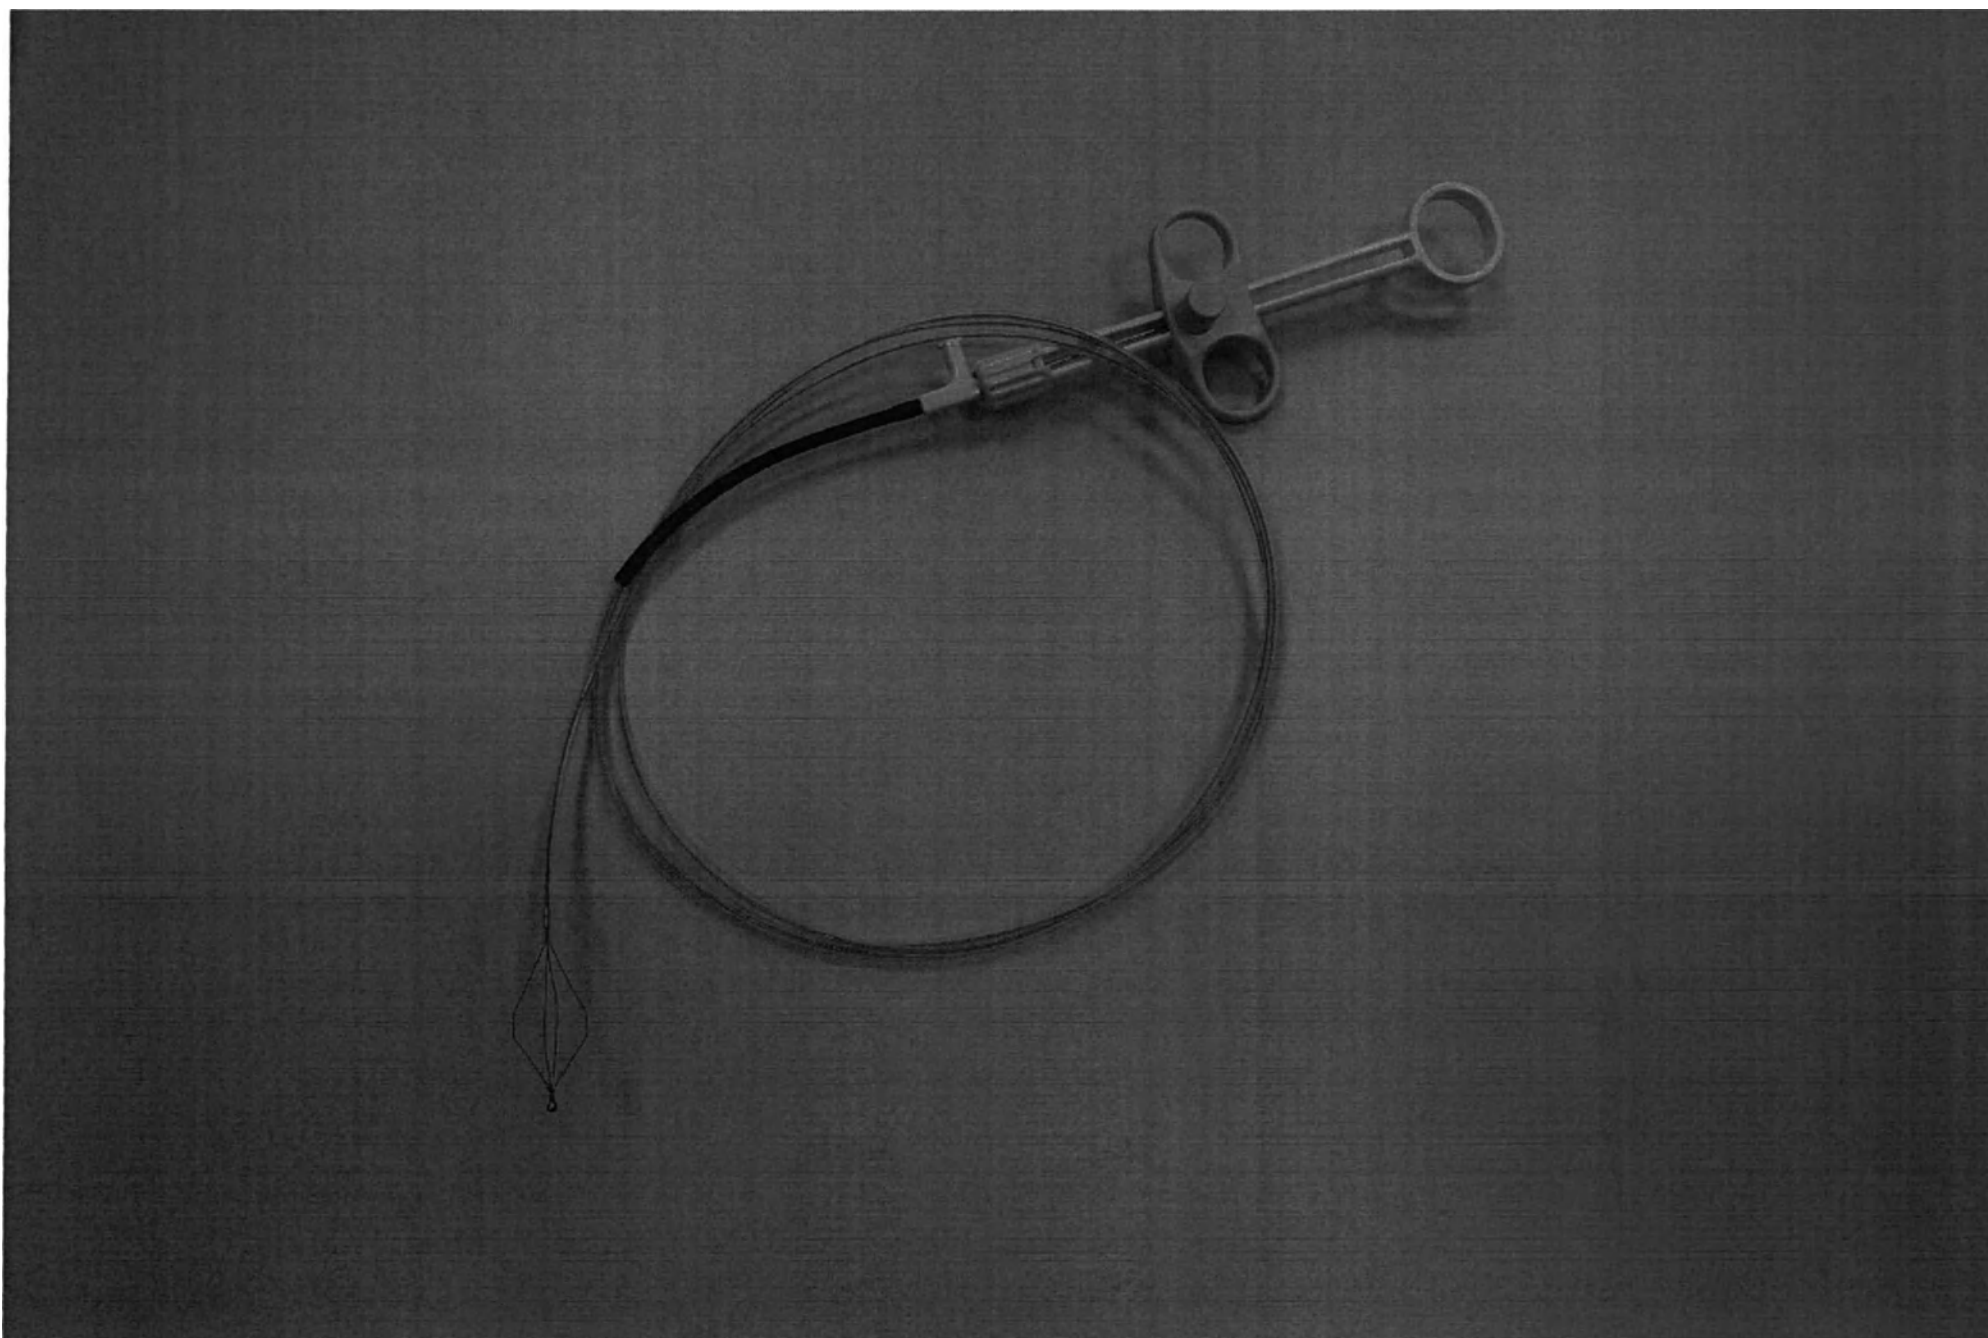


Рис.65 Корзинка литотомическая стерильная (без упаковки)

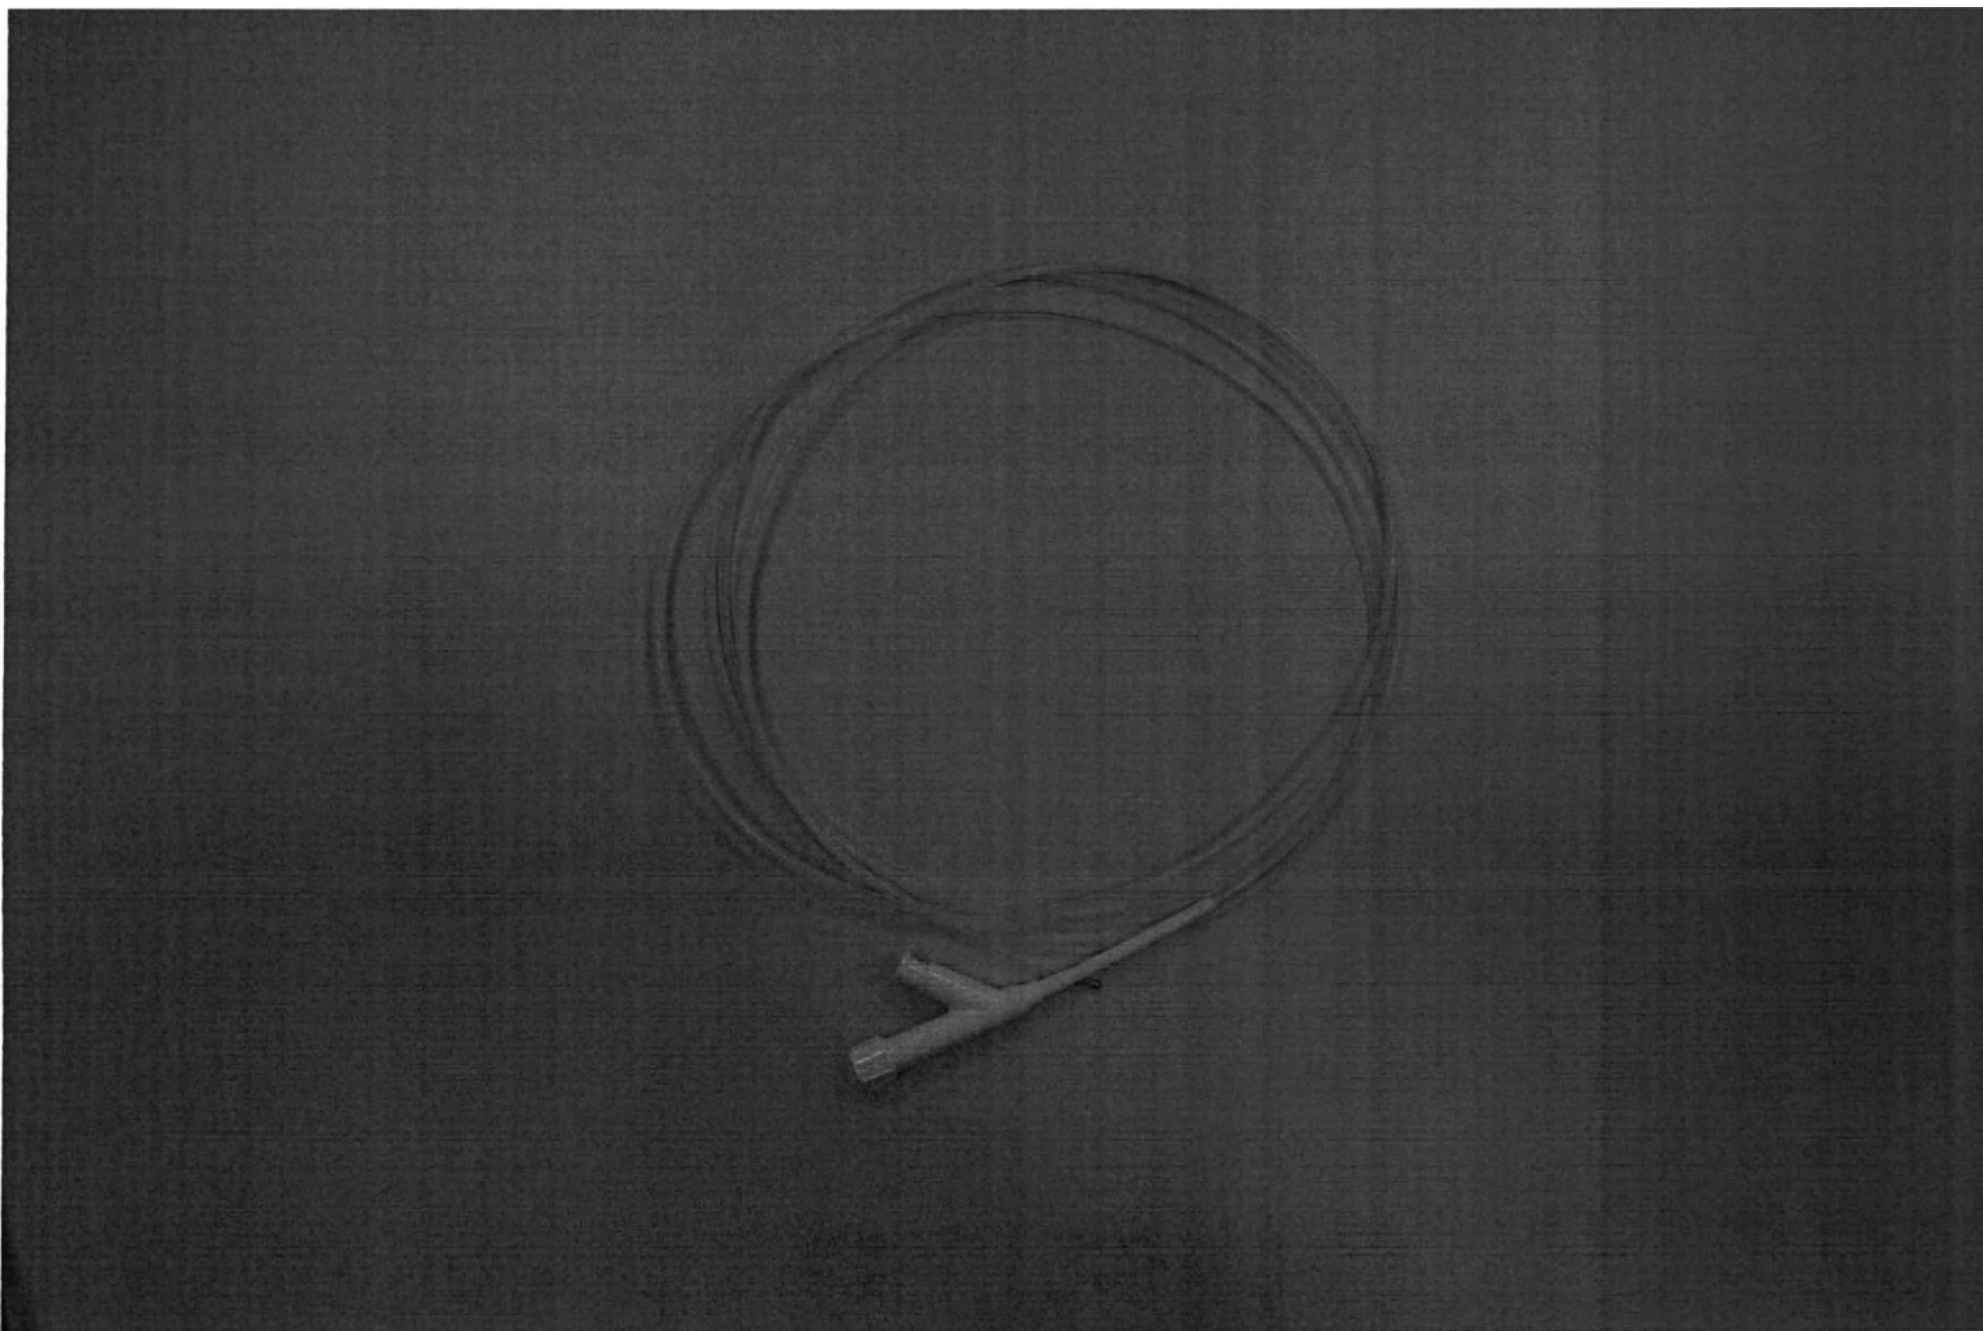


Рис.66 Катетер смывной стерильный (без упаковки)

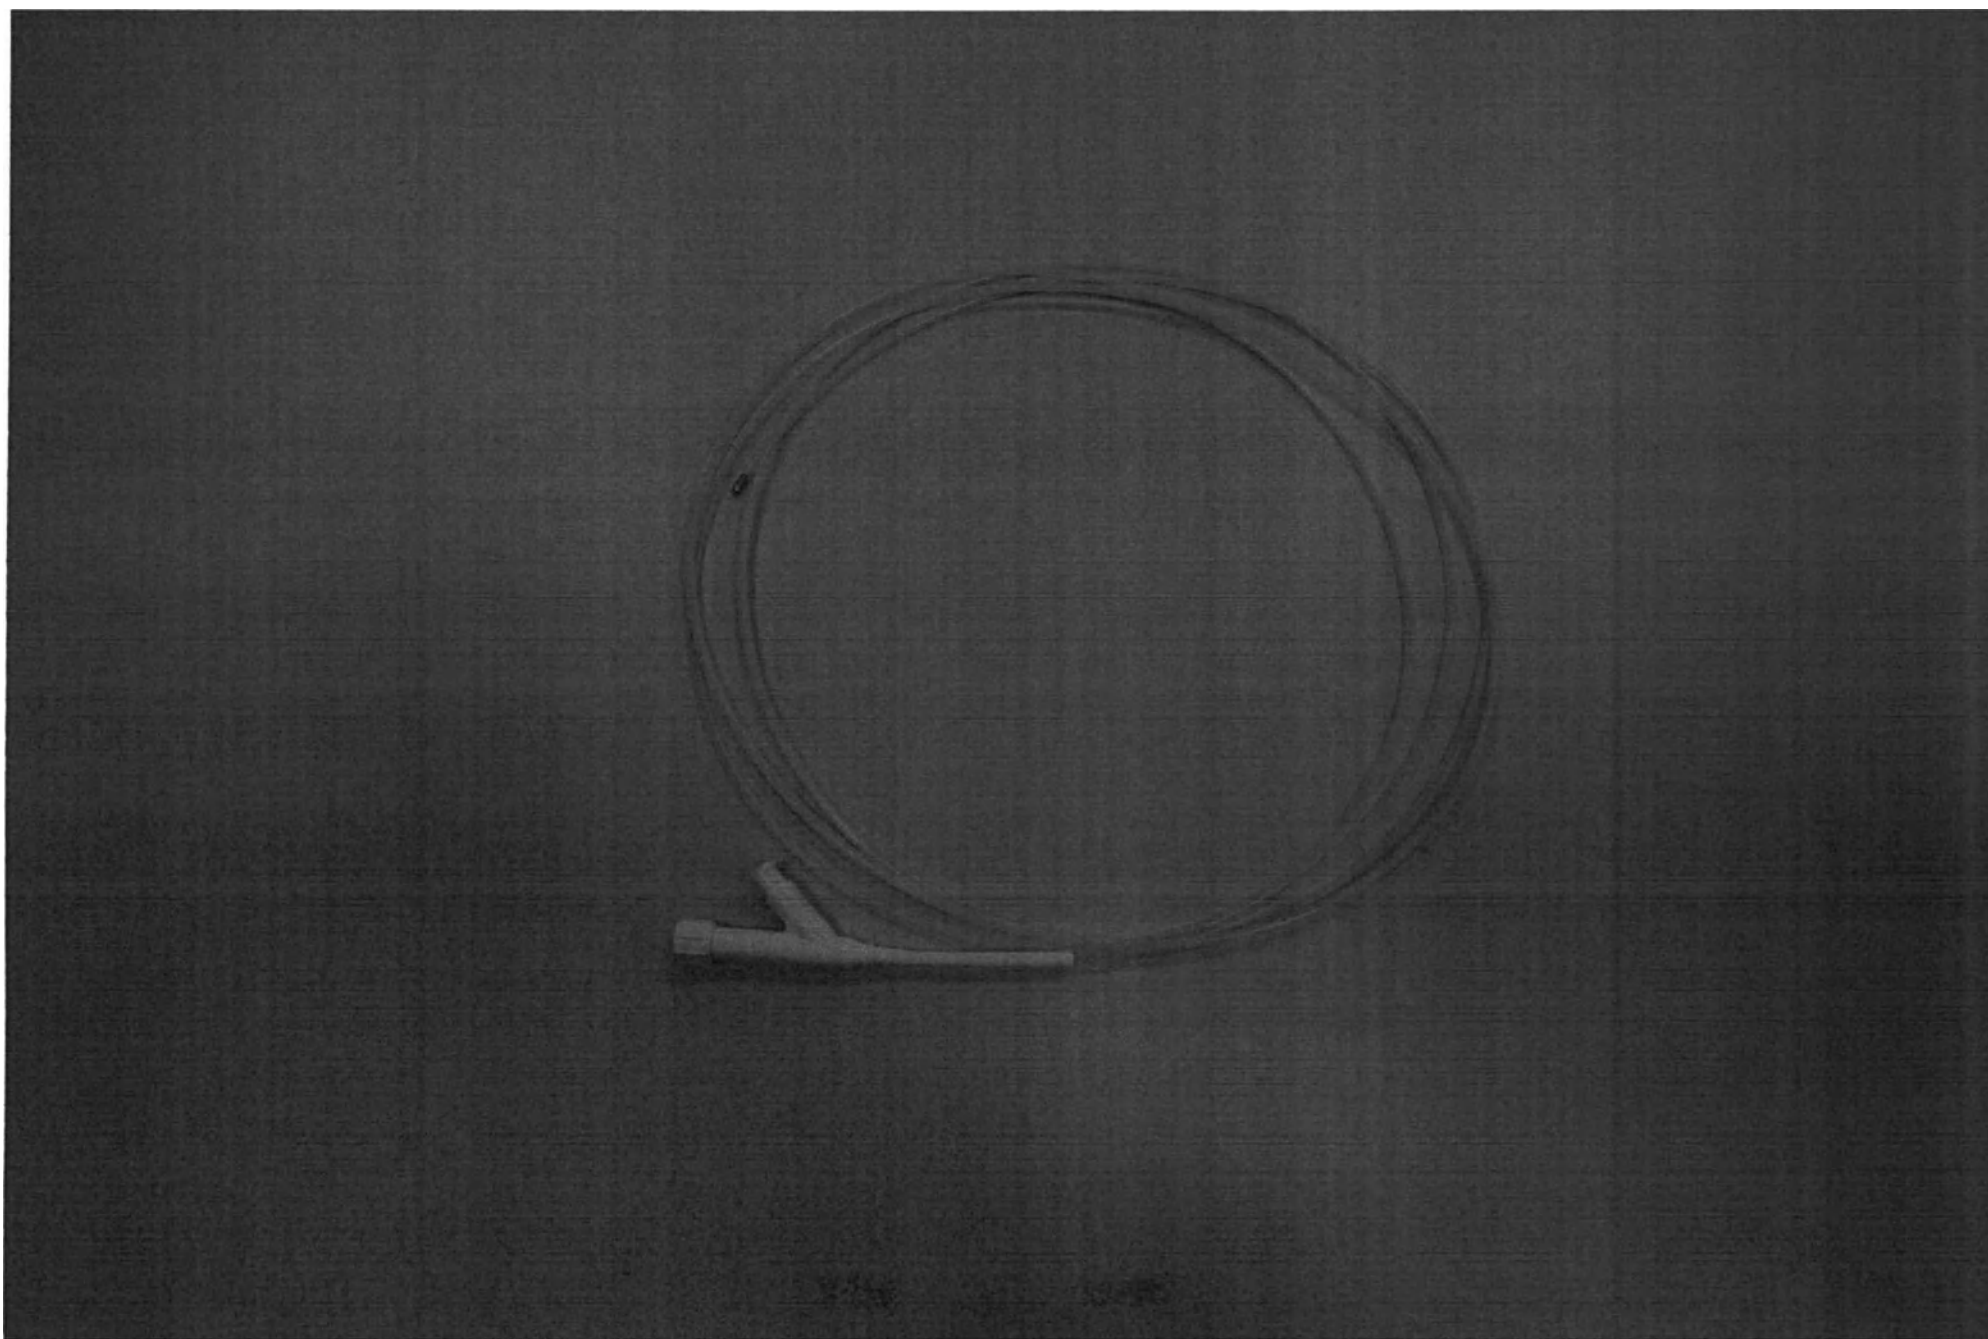


Рис.67 Катетер для ЭРХПГ стандартный стерильный (без упаковки)

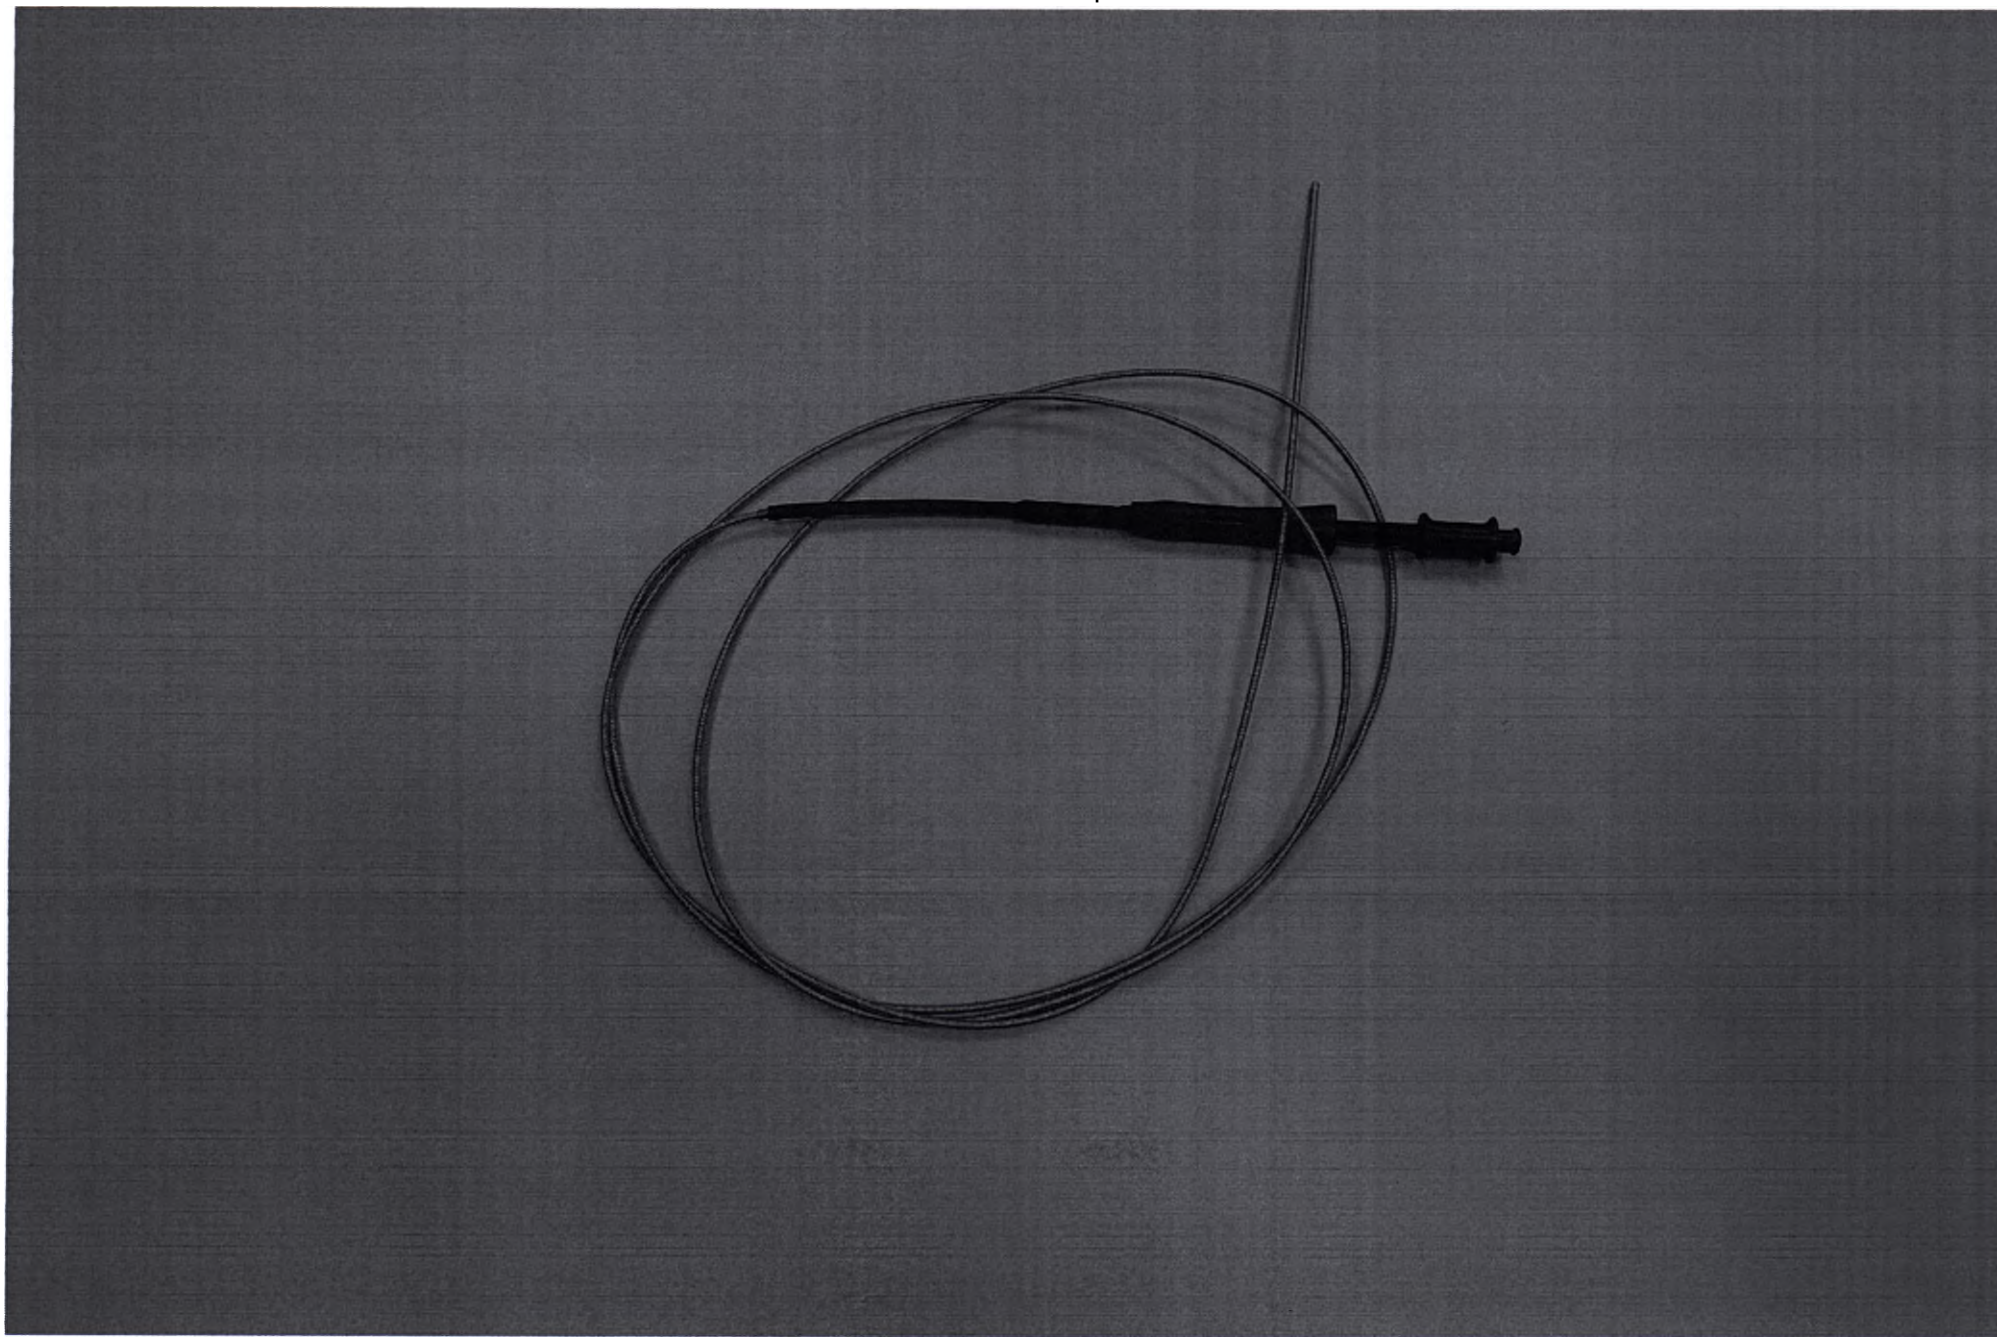


Рис.68 Игла-зонд (по Белоногову) стерильная (без упаковки)

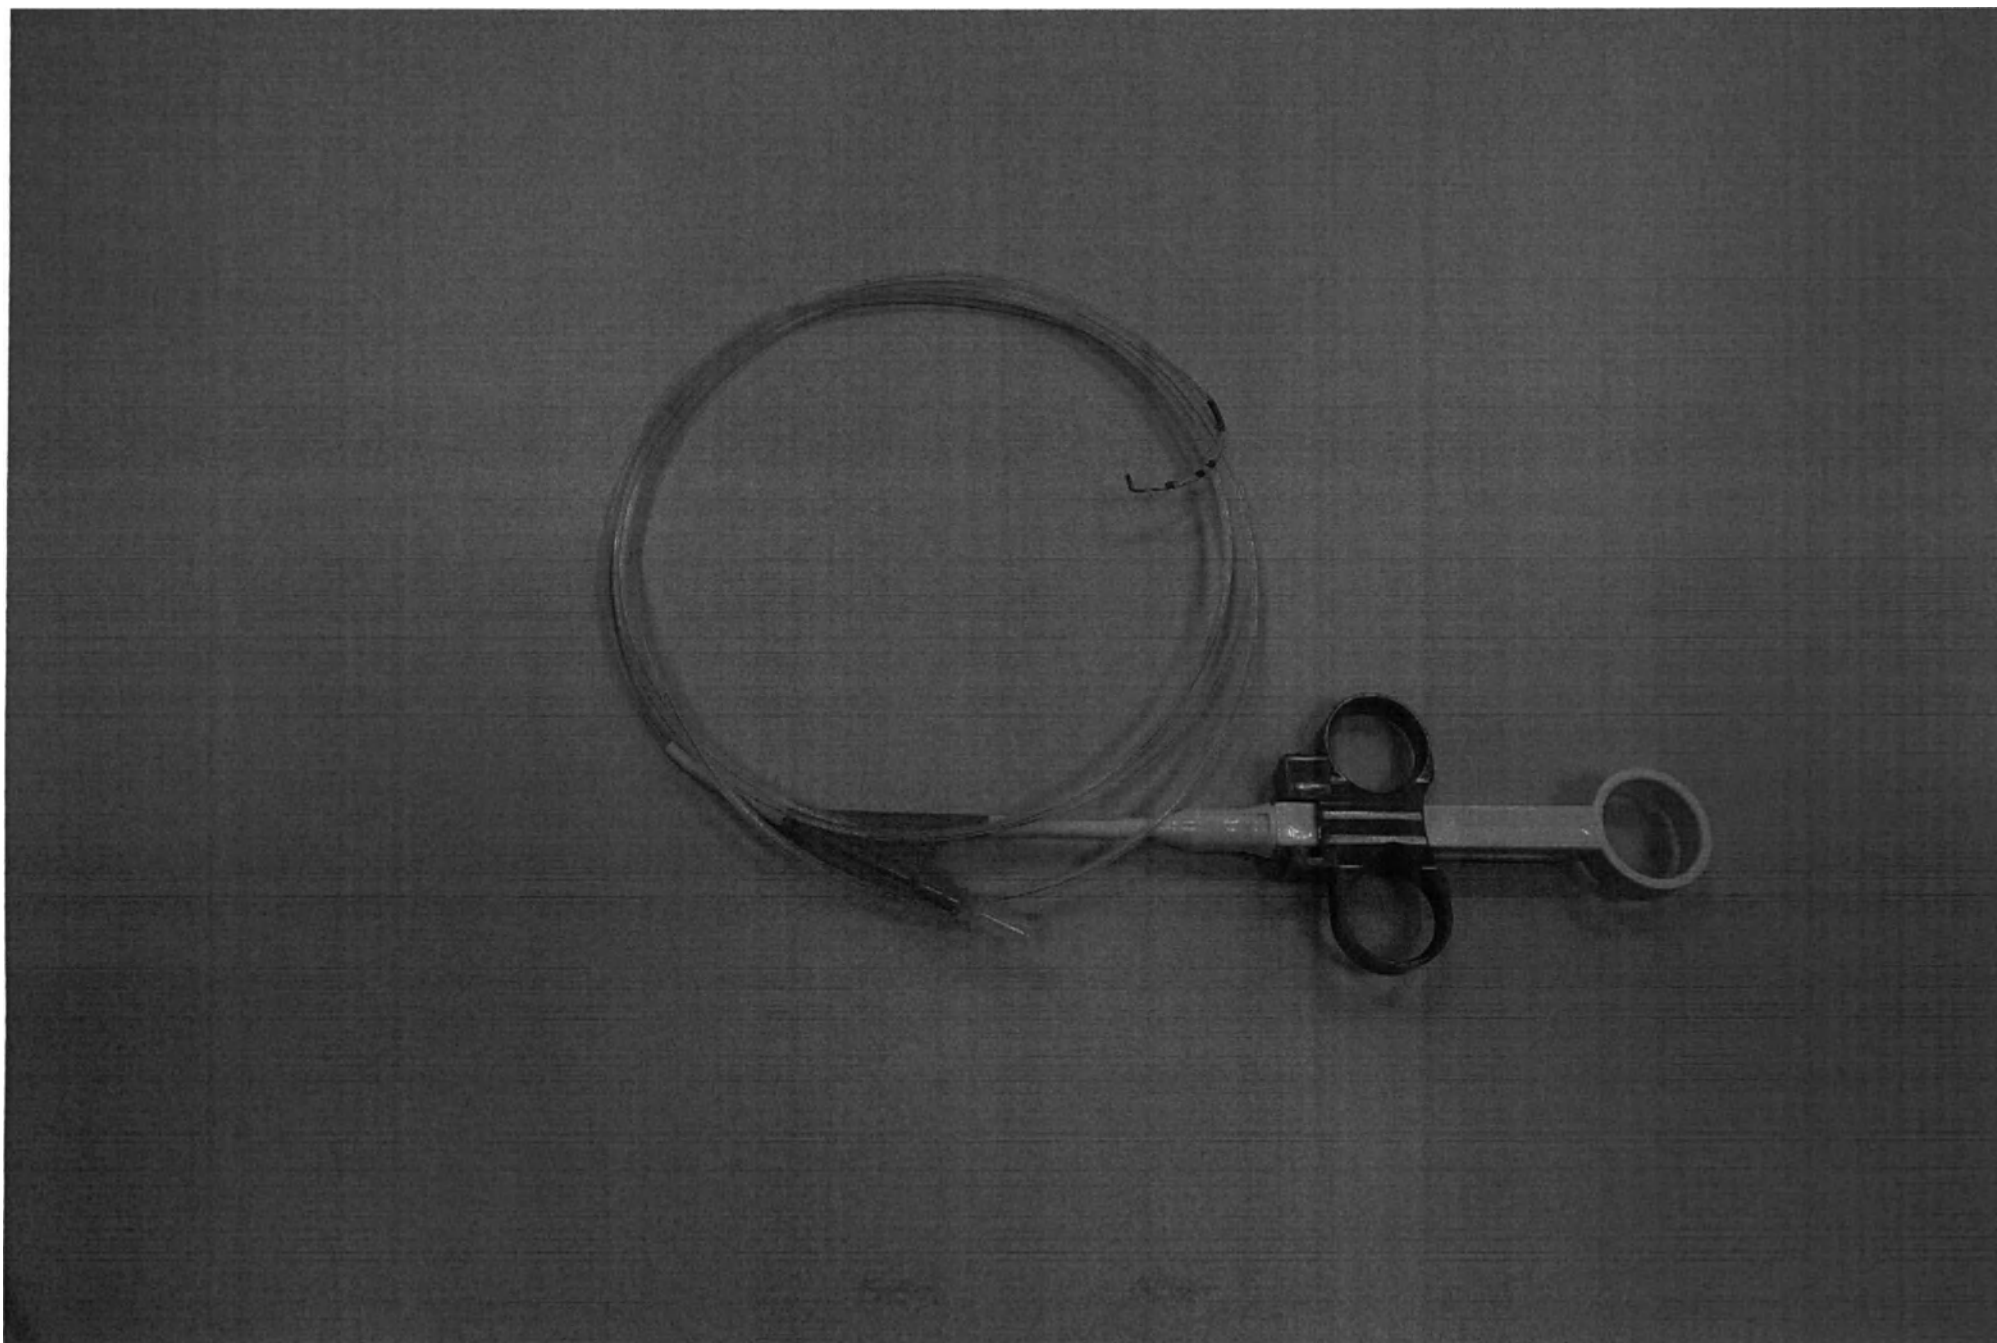


Рис.69 Папиллотом гибкий стерильный (без упаковки)

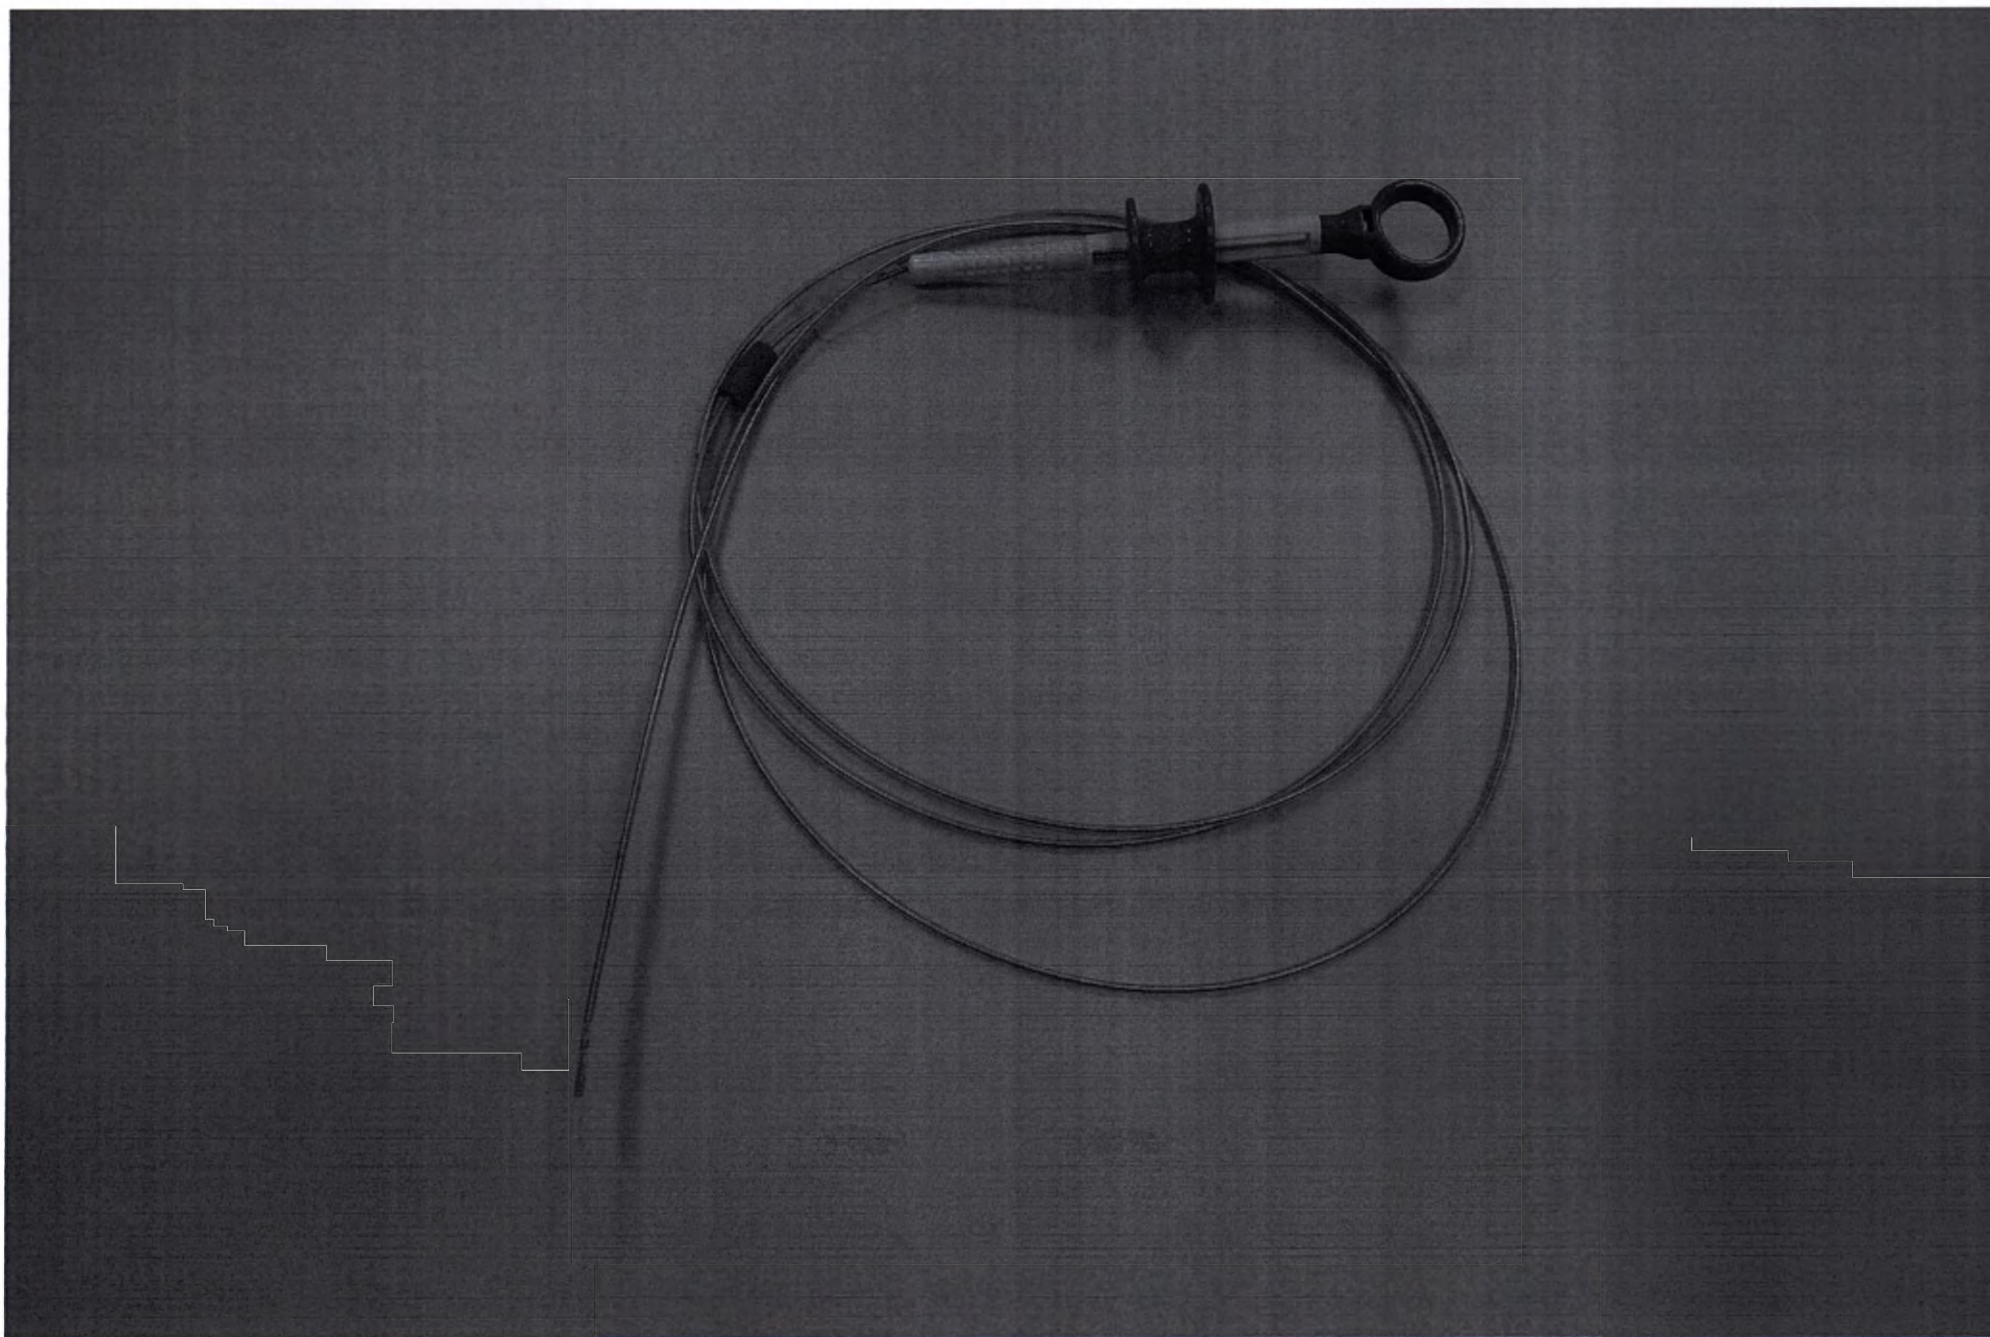


Рис.70 Клип-аппликатор стерильный (без упаковки)

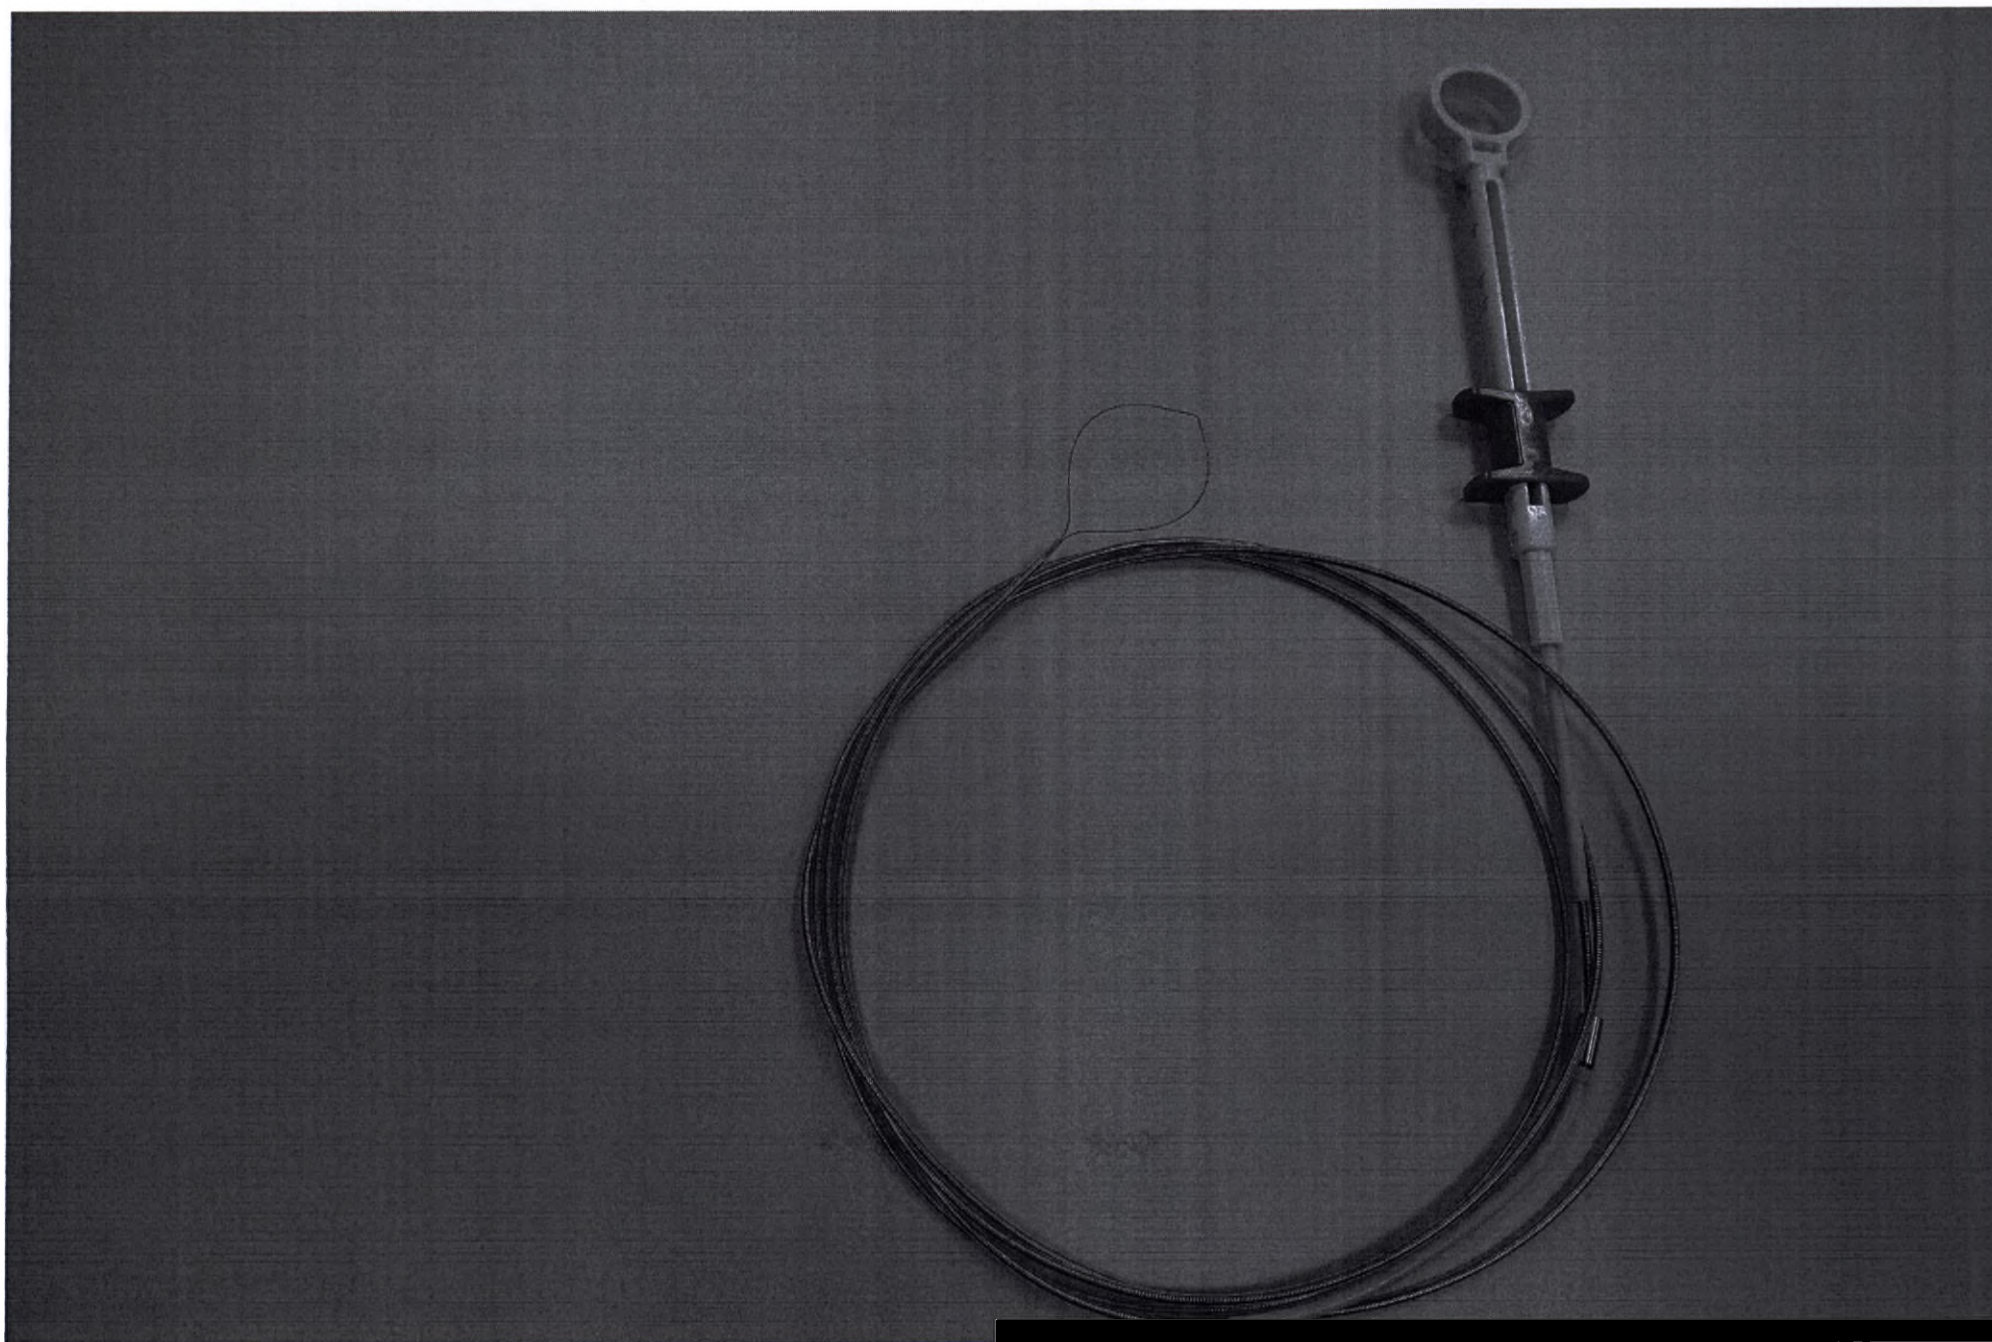


Рис.71 Устройство для наложения лигатур стерильное (без упаковки)



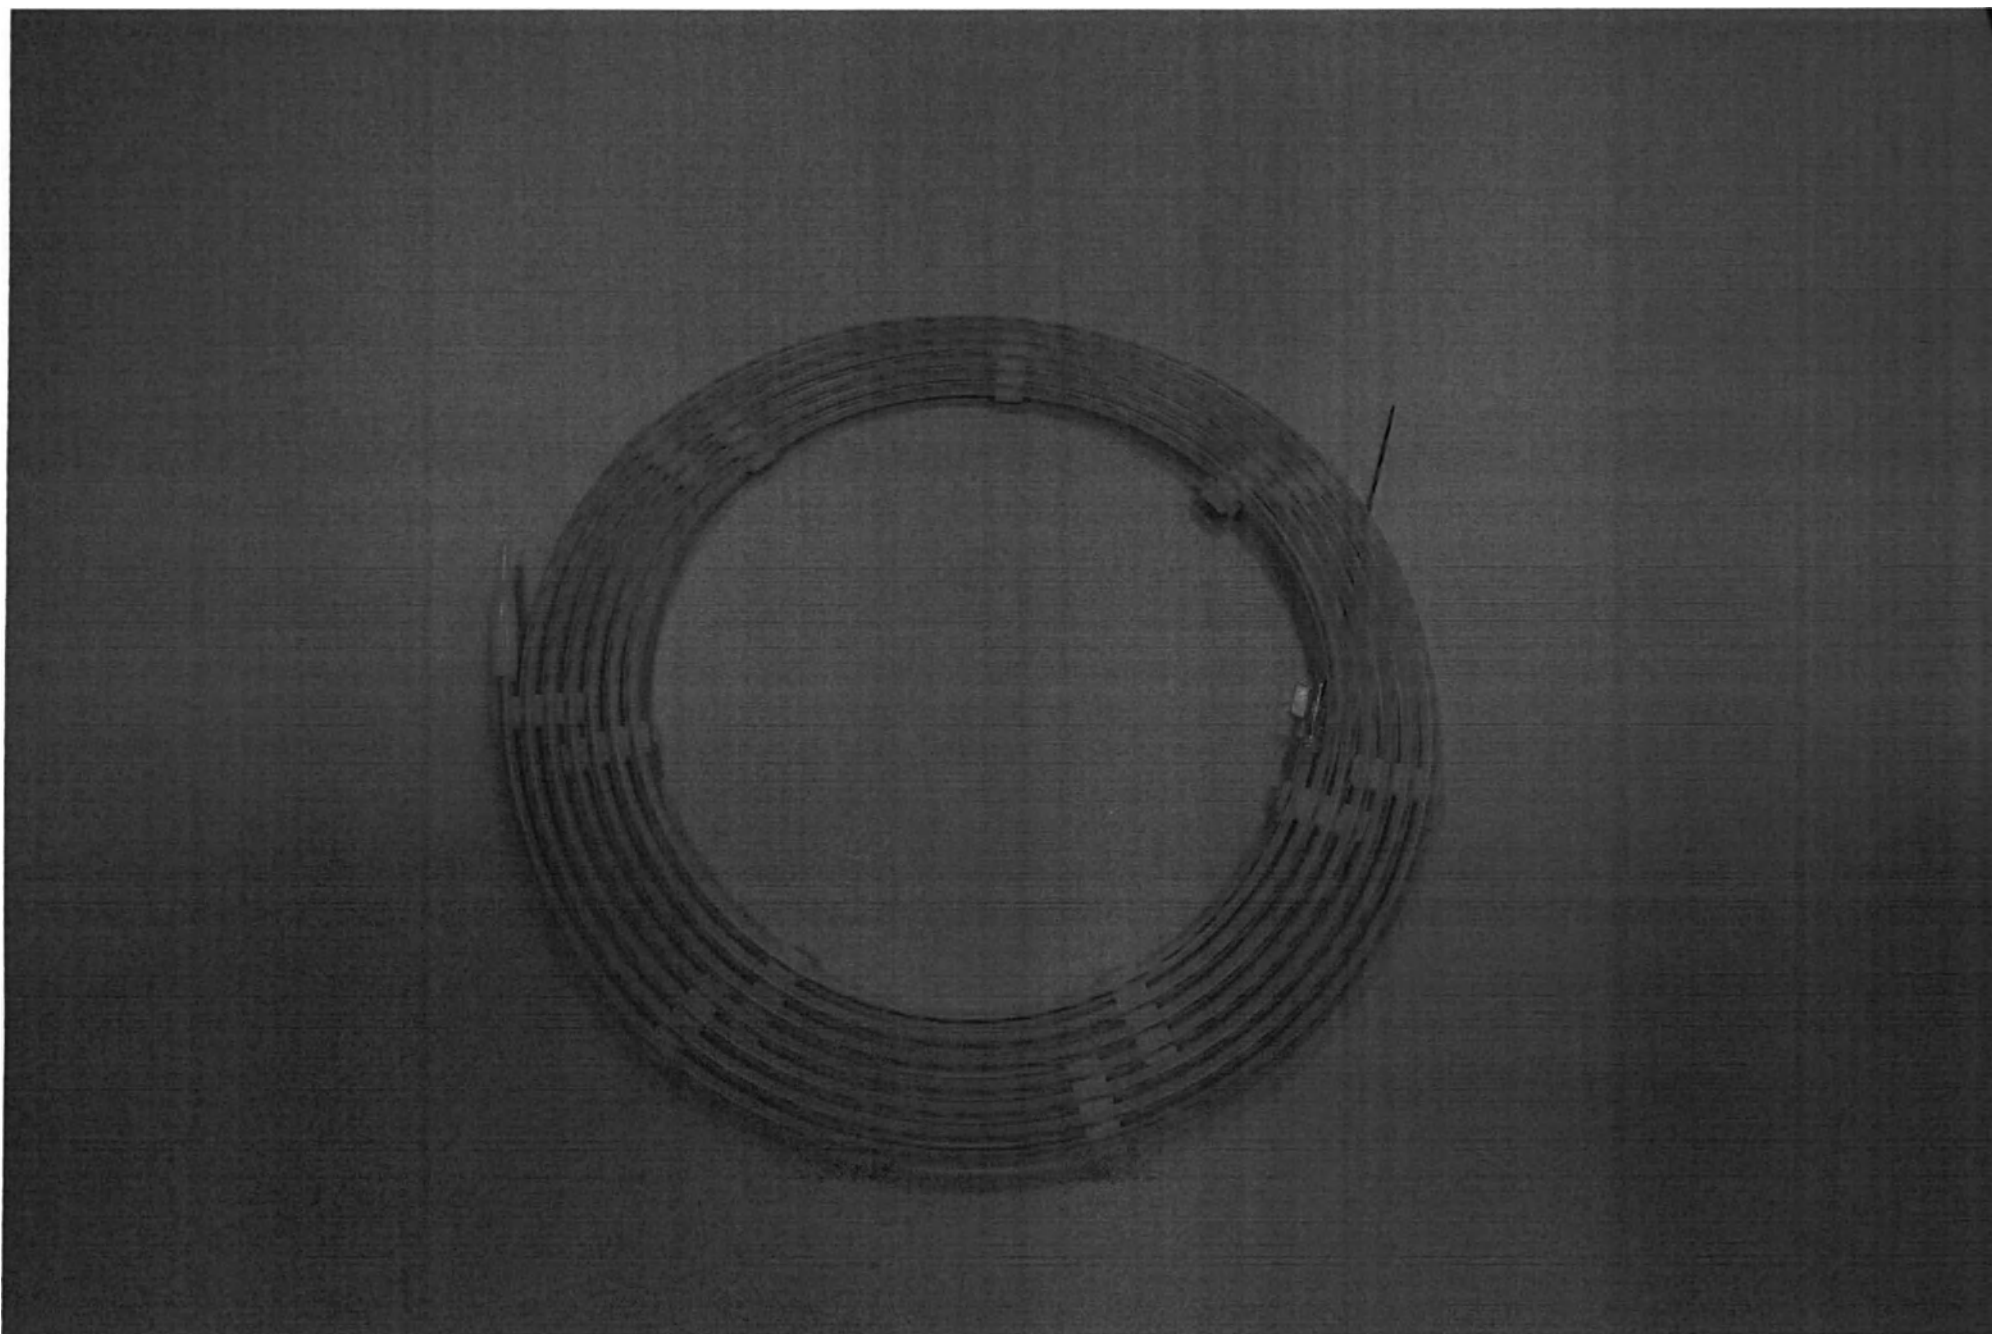


Рис.72 Проводник стерильный (без упаковки)



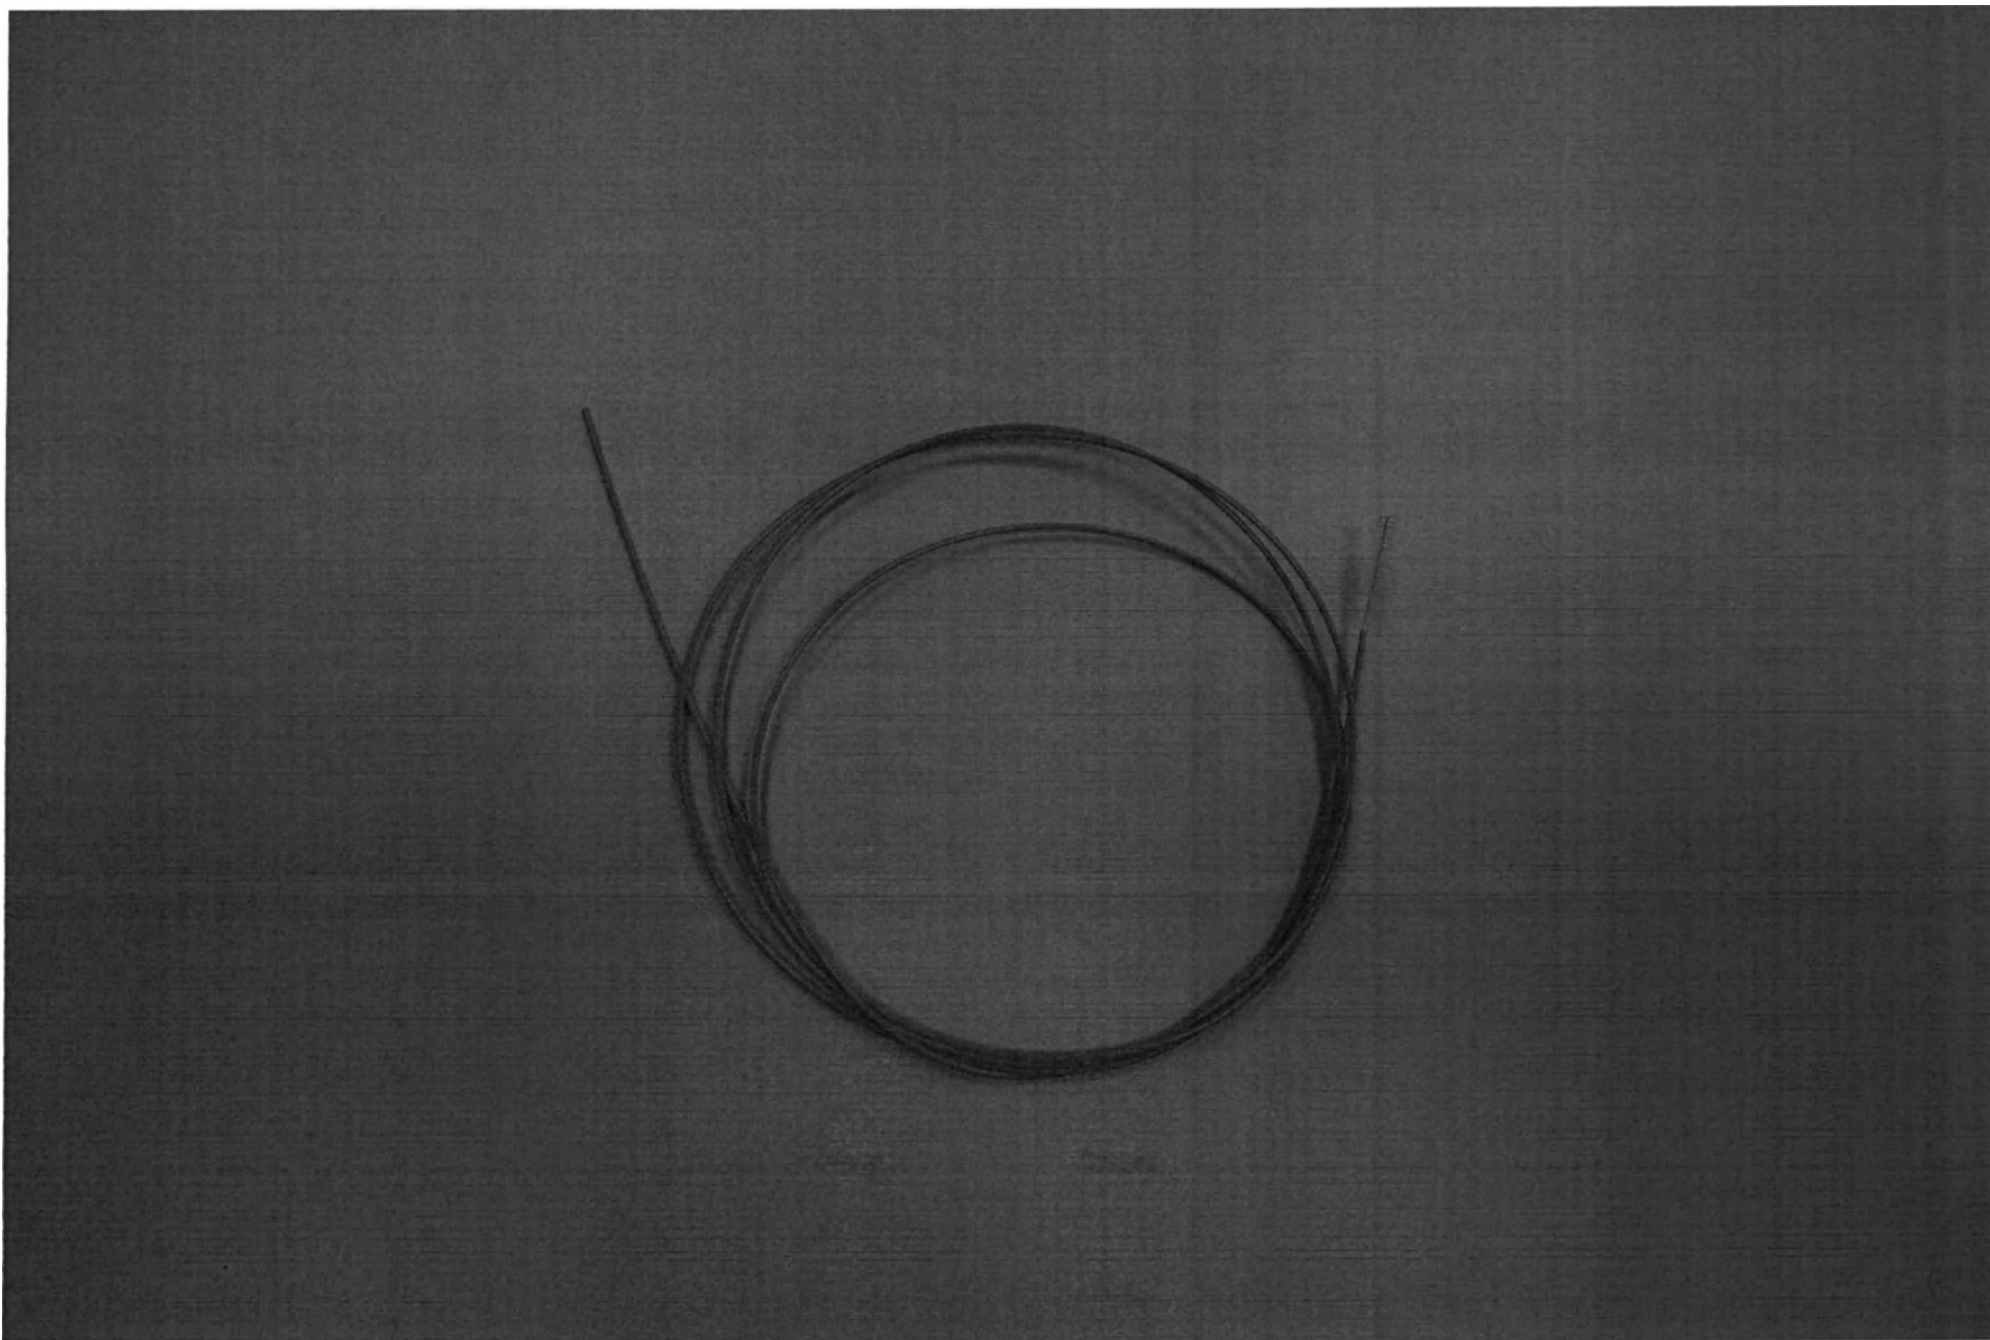

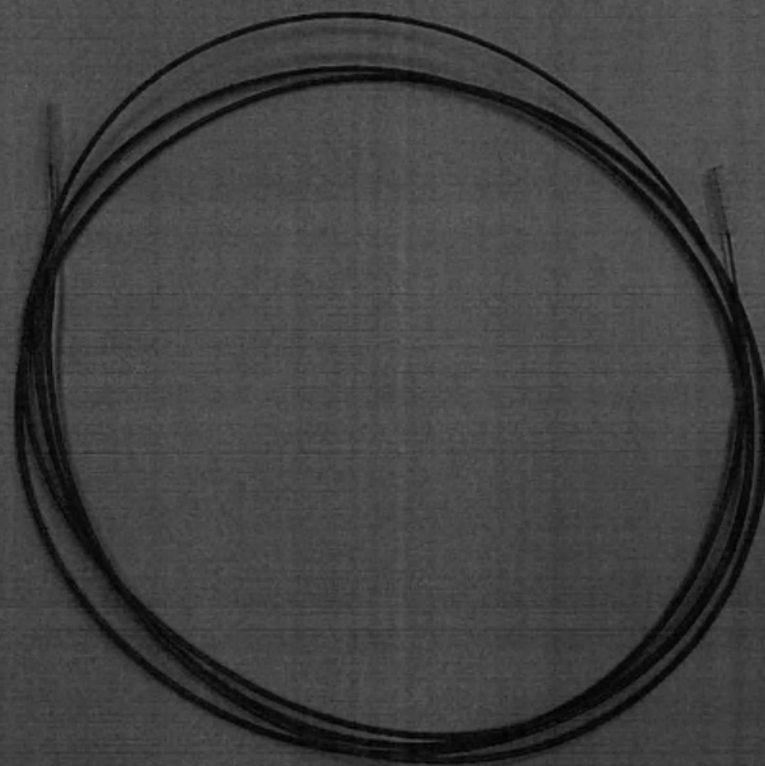

Всего в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 76 листов.

Директор ООО «ГСТН»
Т. В. Ромашин

