



УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации и качеству
ООО "Зиммер СНГ"

А.С. Семунина

"10" марта 2017 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

**«Инструменты хирургические для ортопедии и травматологии режущие и ударные с острой (режущей) кромкой
с принадлежностями»**

Инструменты хирургические для ортопедии и травматологии режущие и ударные с острой (режущей) кромкой:

1. Бур малый.



2. Долото гленоидное Bigliani/Flatow.




3. Долото коробчатое большое/малое.




4. Метчик Trilogy, диаметр 4.5 мм, 6.5 мм.




5. Отсекатель MIS.

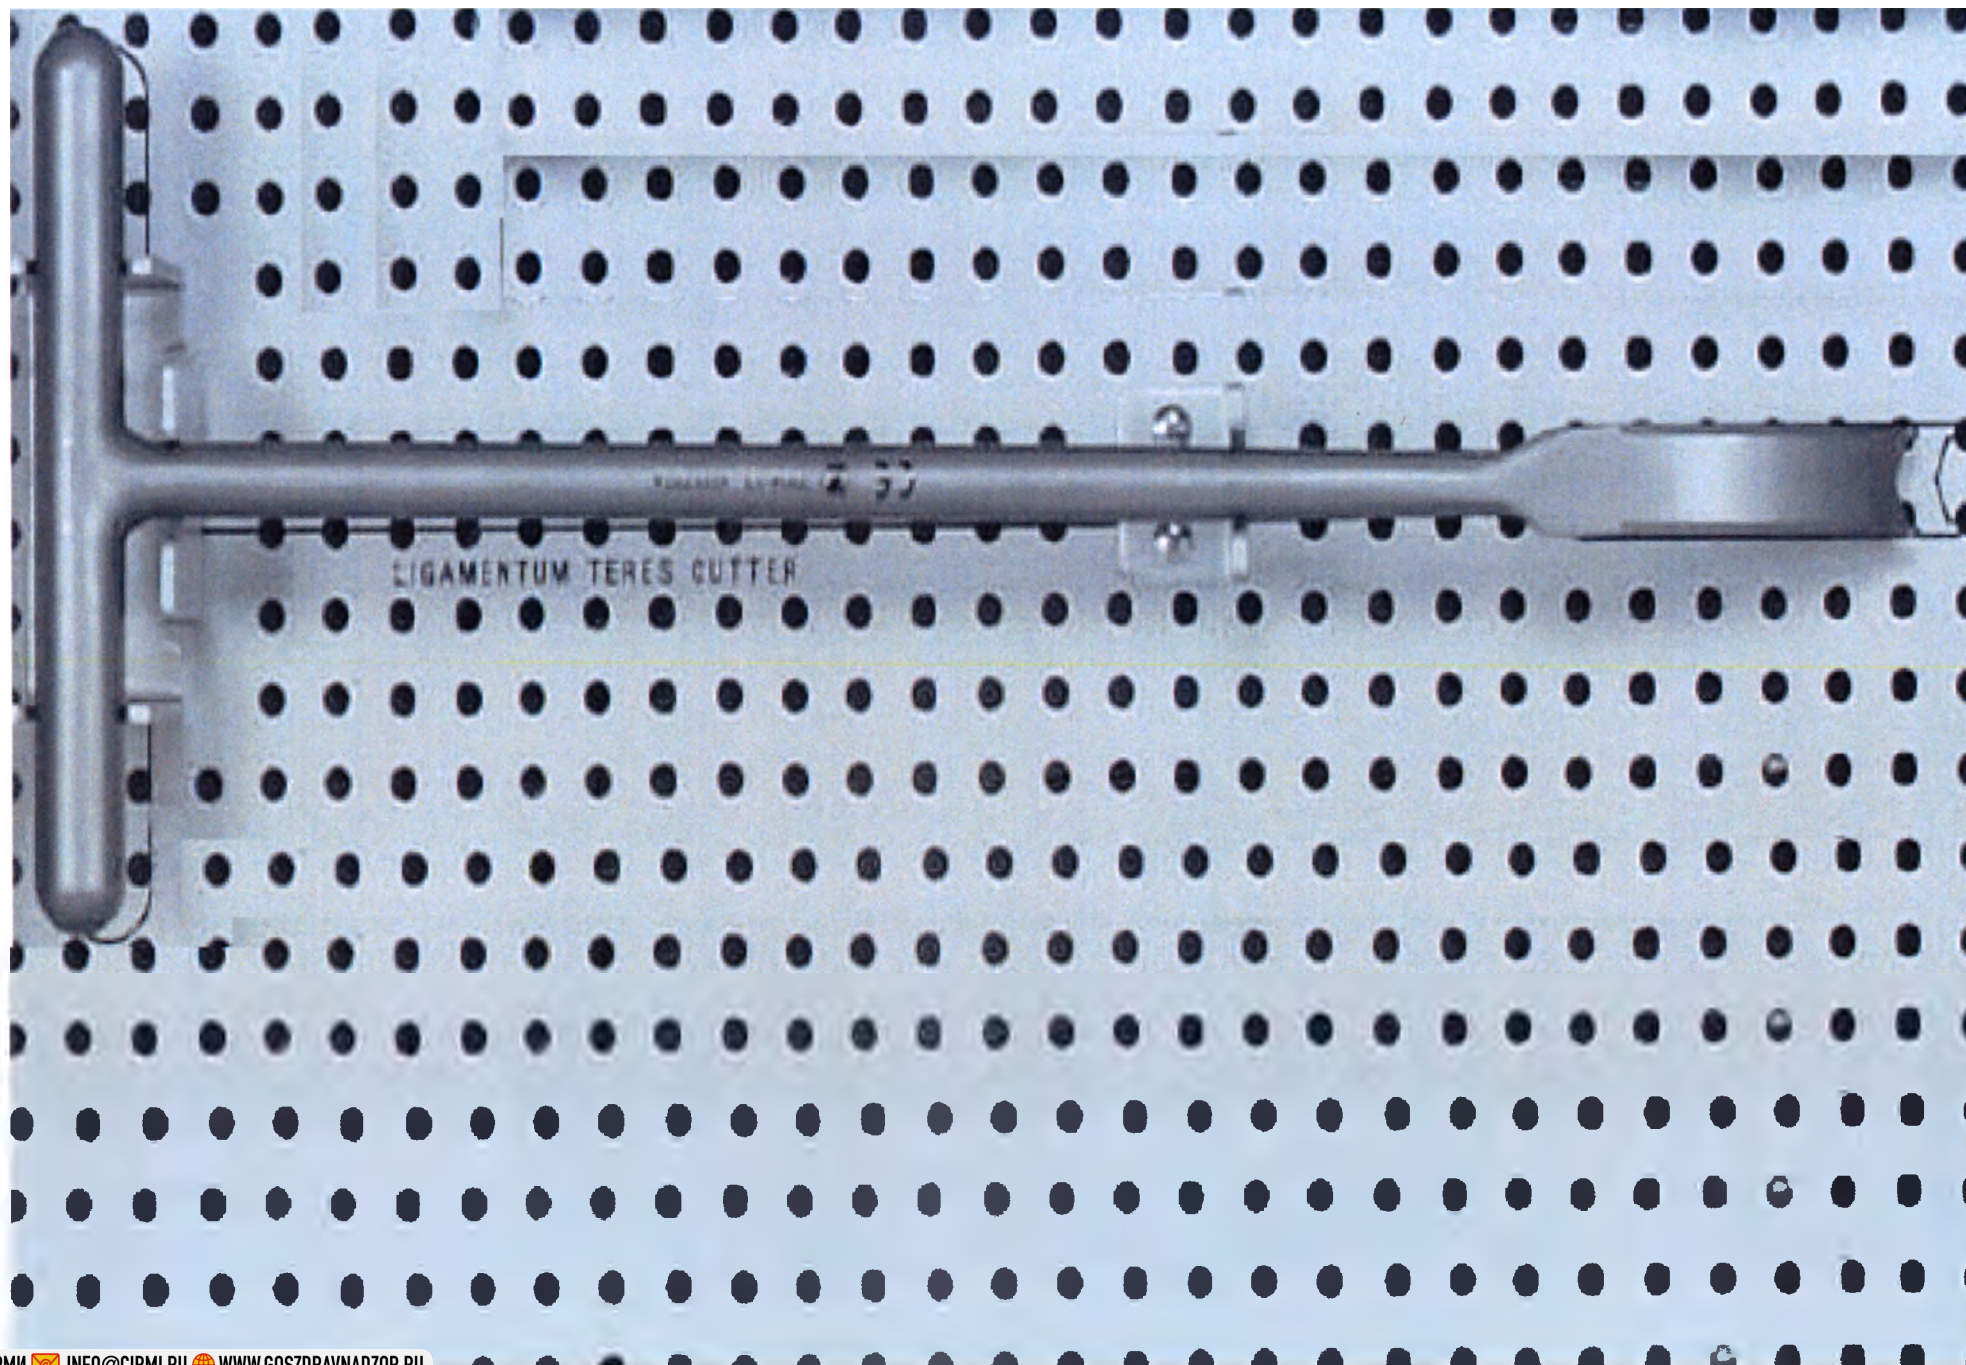


6. Напильник универсальный А.О.Р.

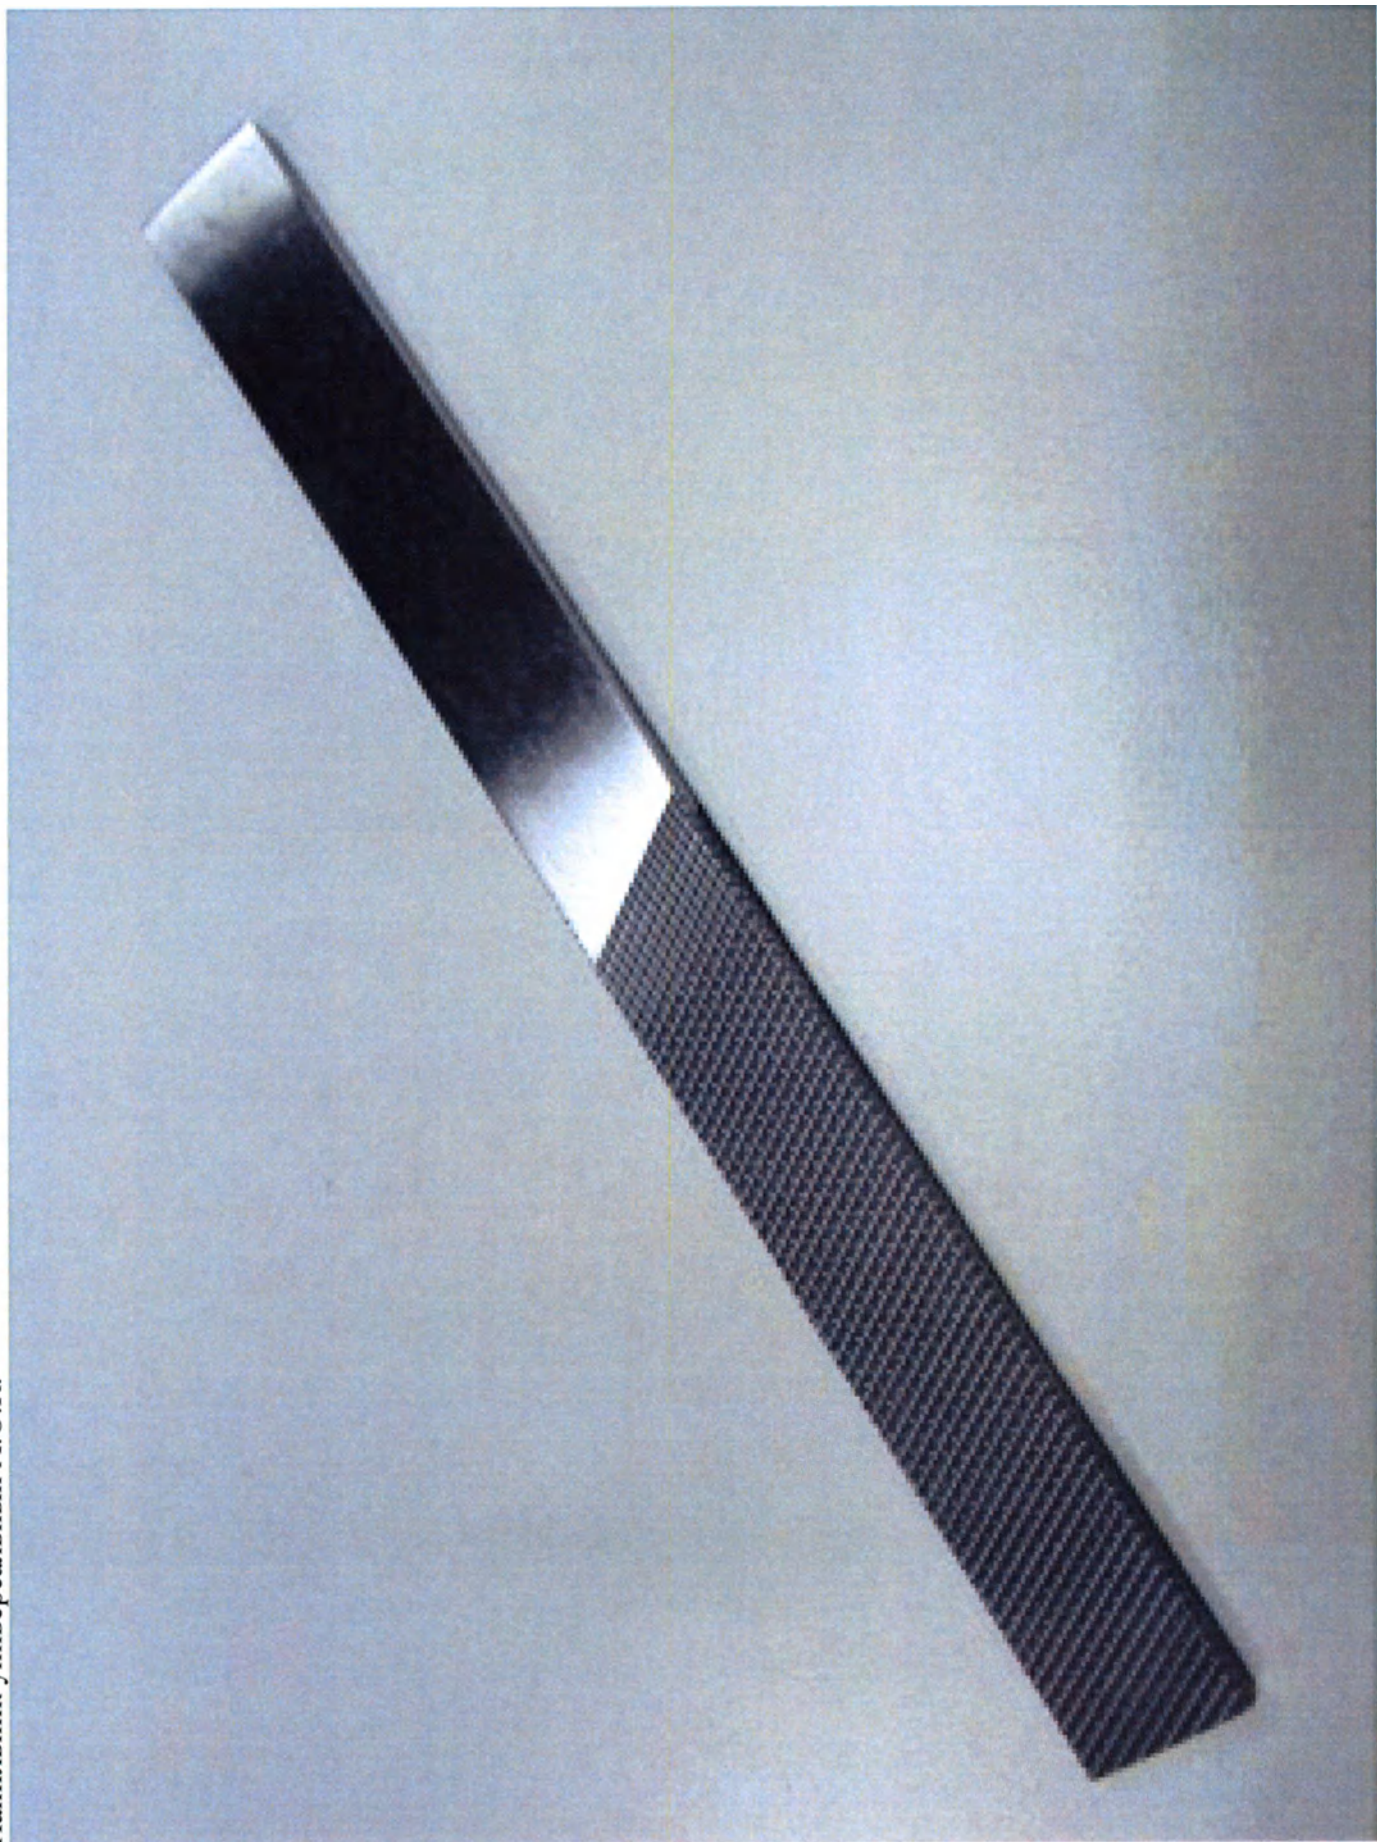


7. Развертка бедренная.

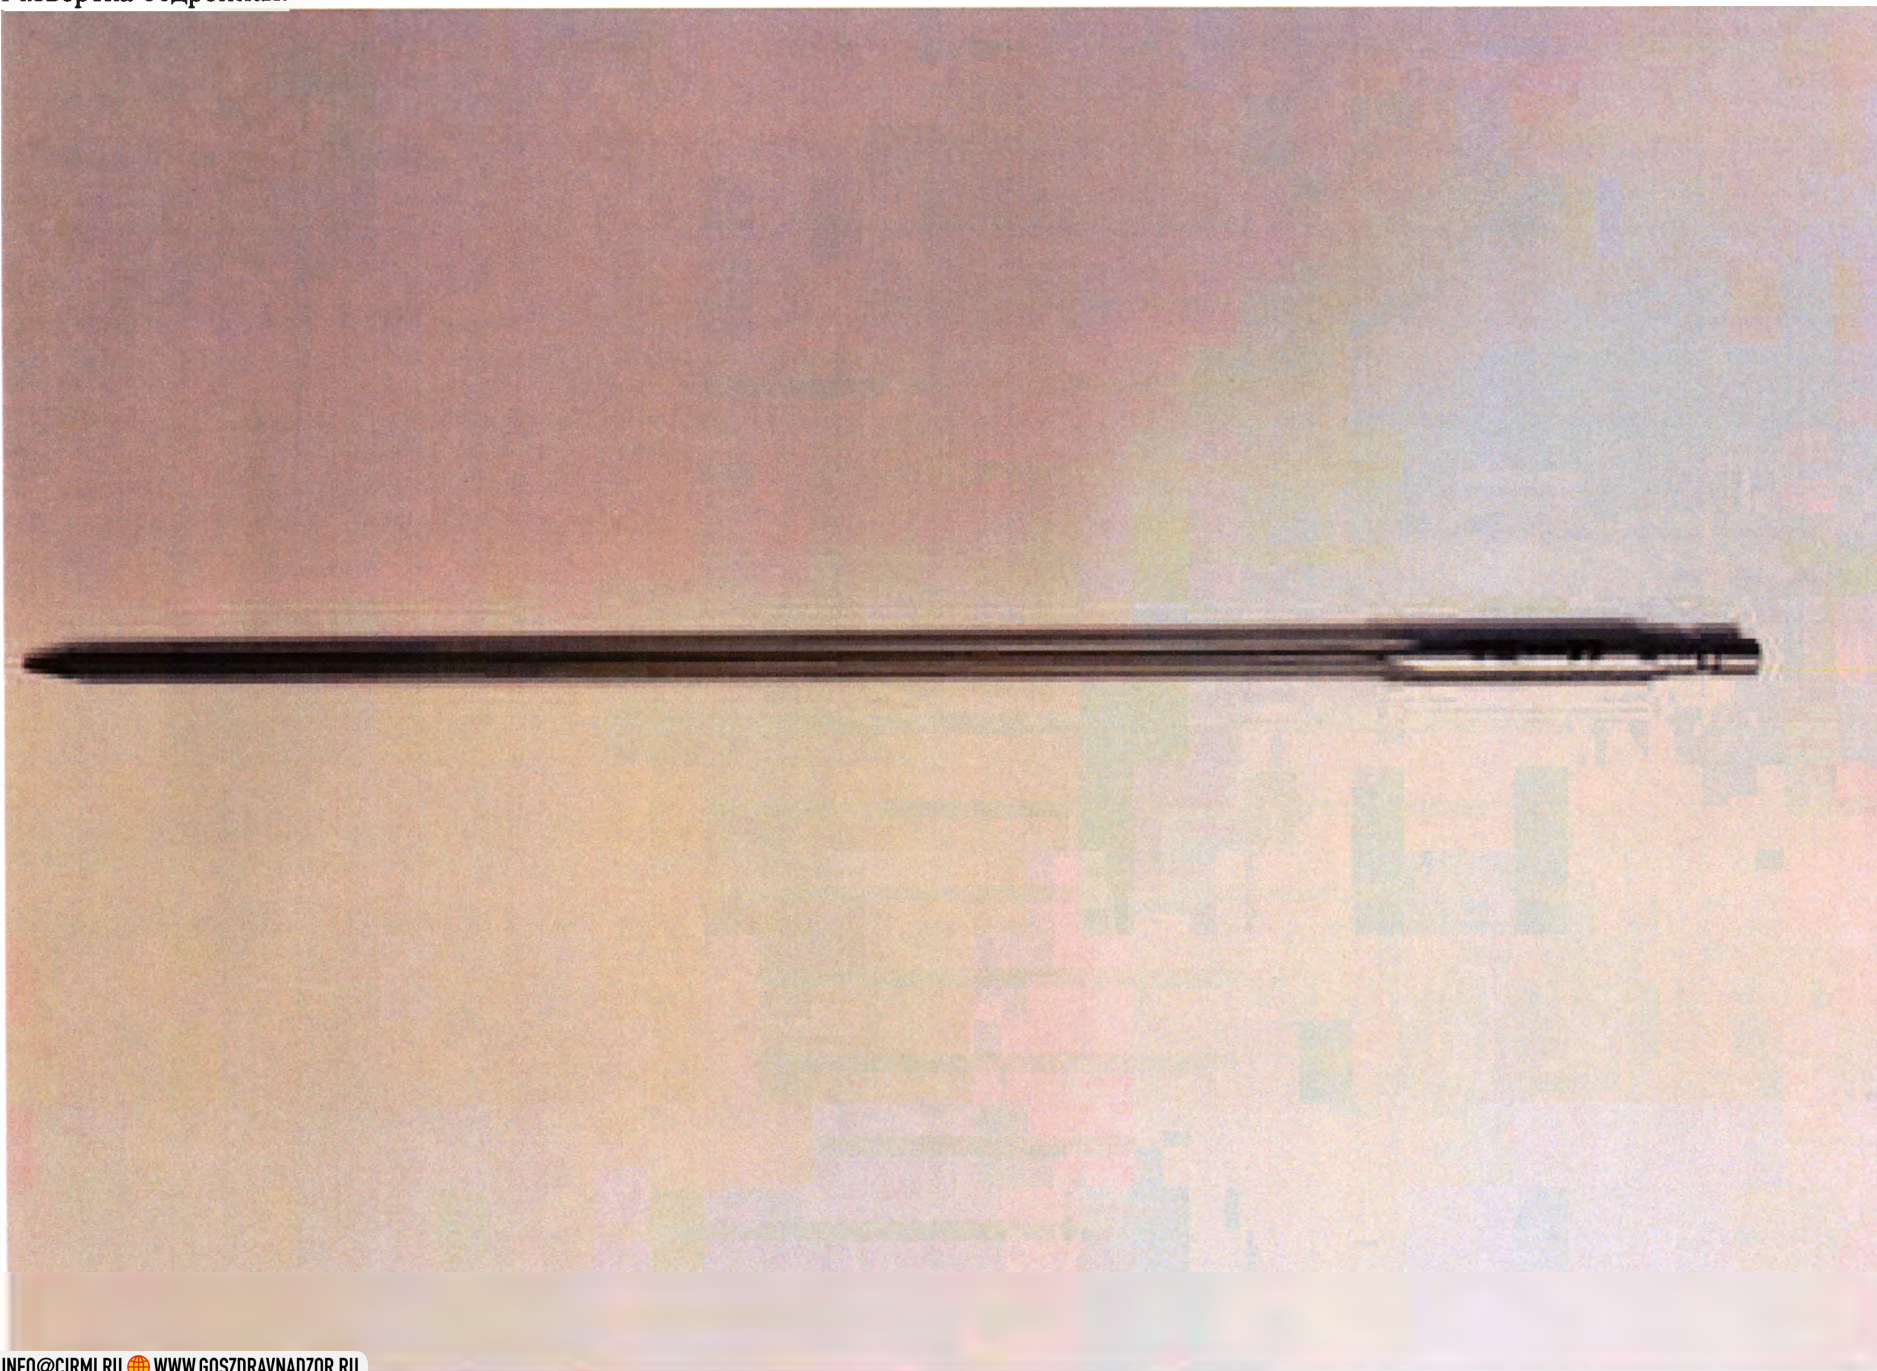

8. Развертка бедренного канала стартовая.

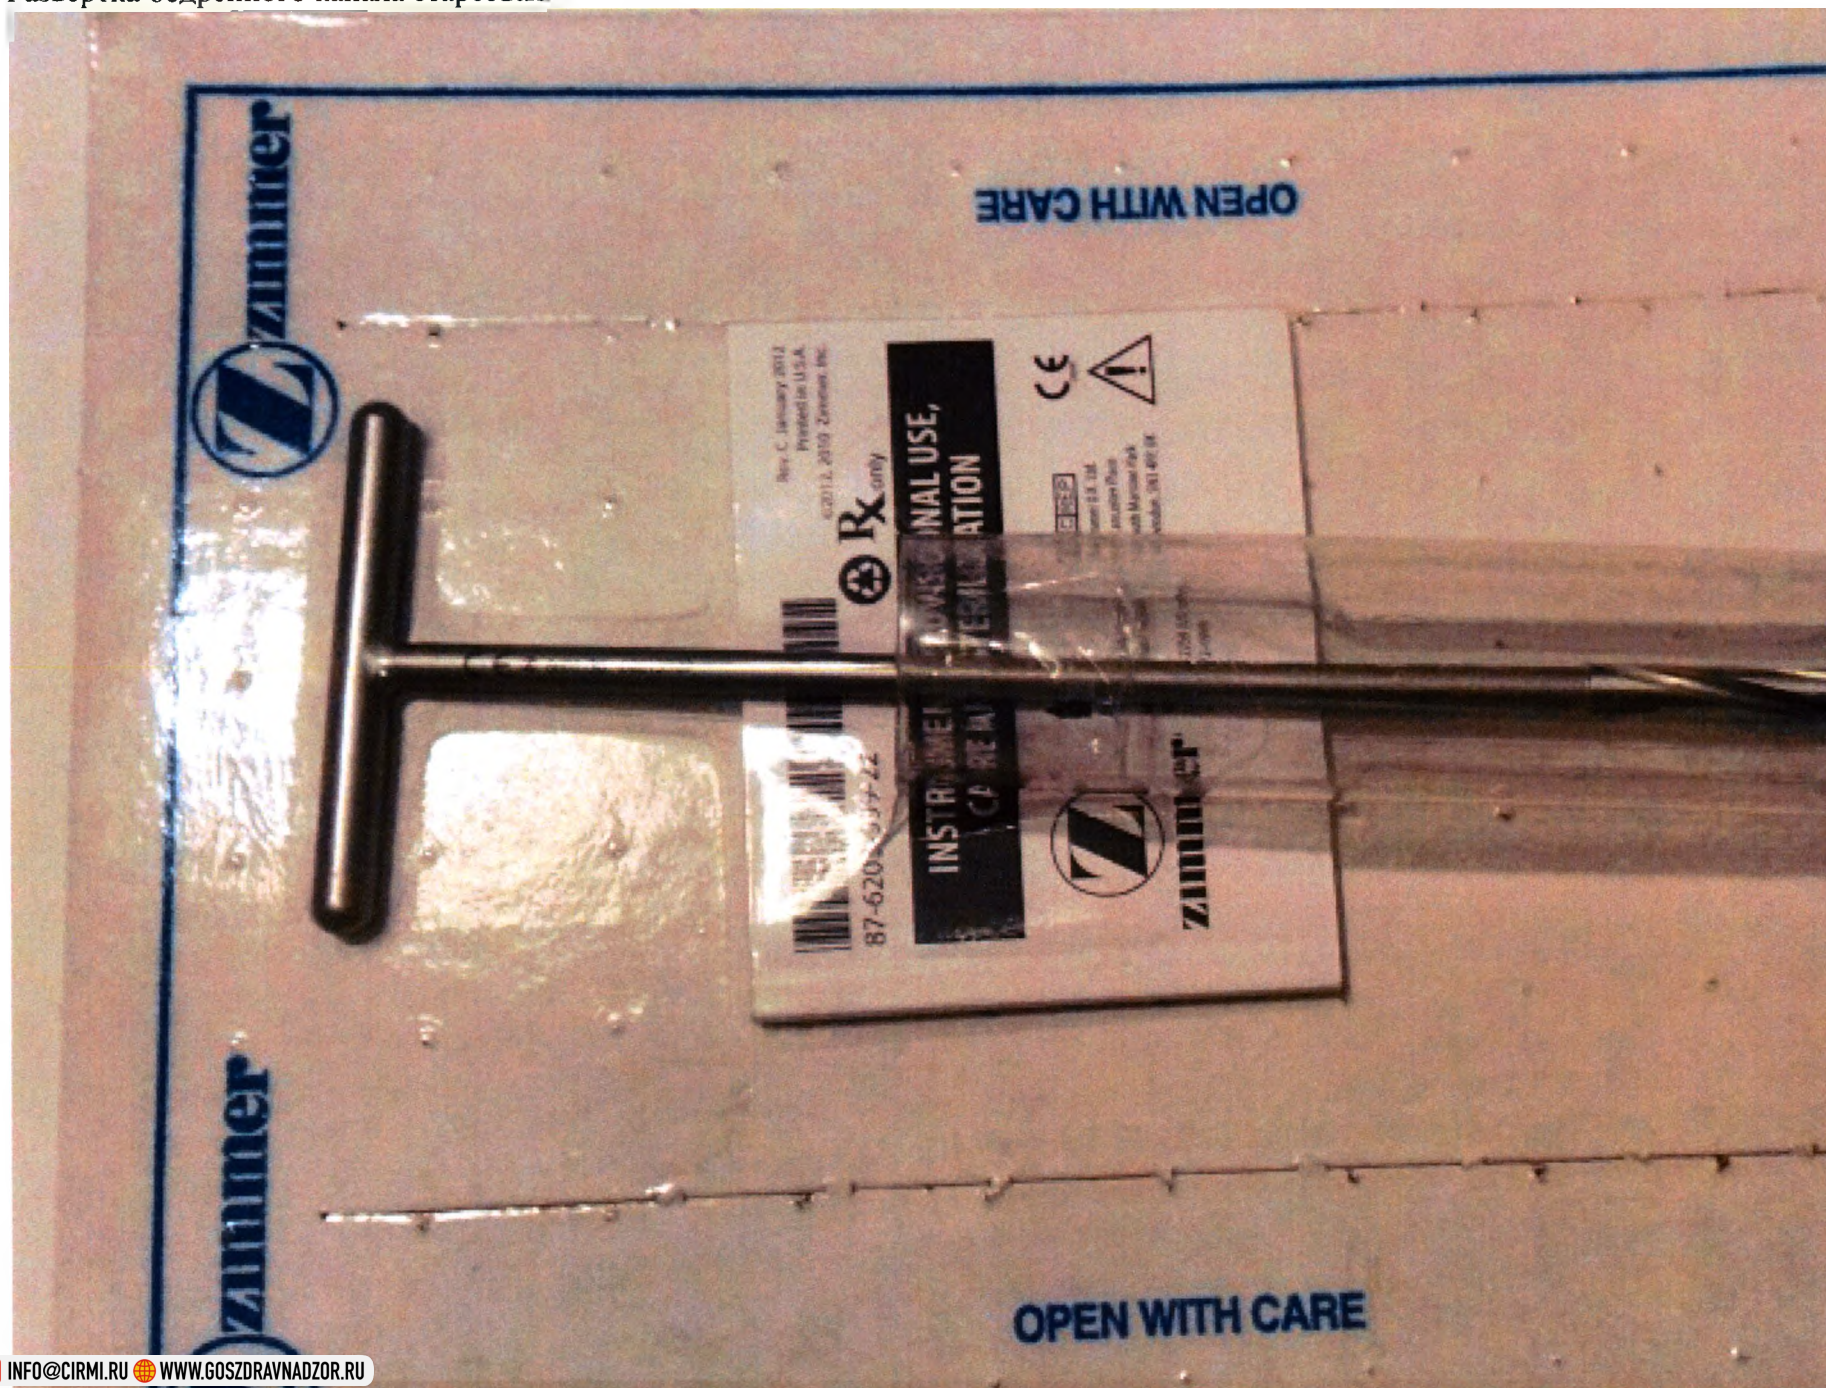


9. Рашпиль бедренный изогнутый.

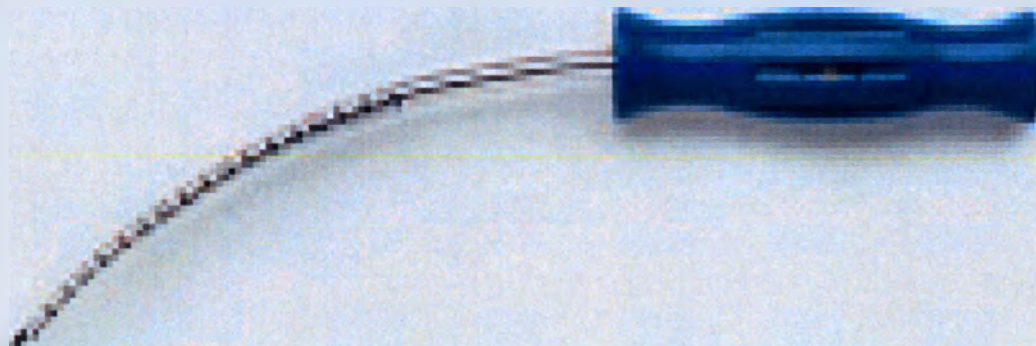

10. Рашпиль бедренный 30 правый/левый, малый/средний/большой.




11. Рашпиль бедренный СРТ, размер 0 – 5.

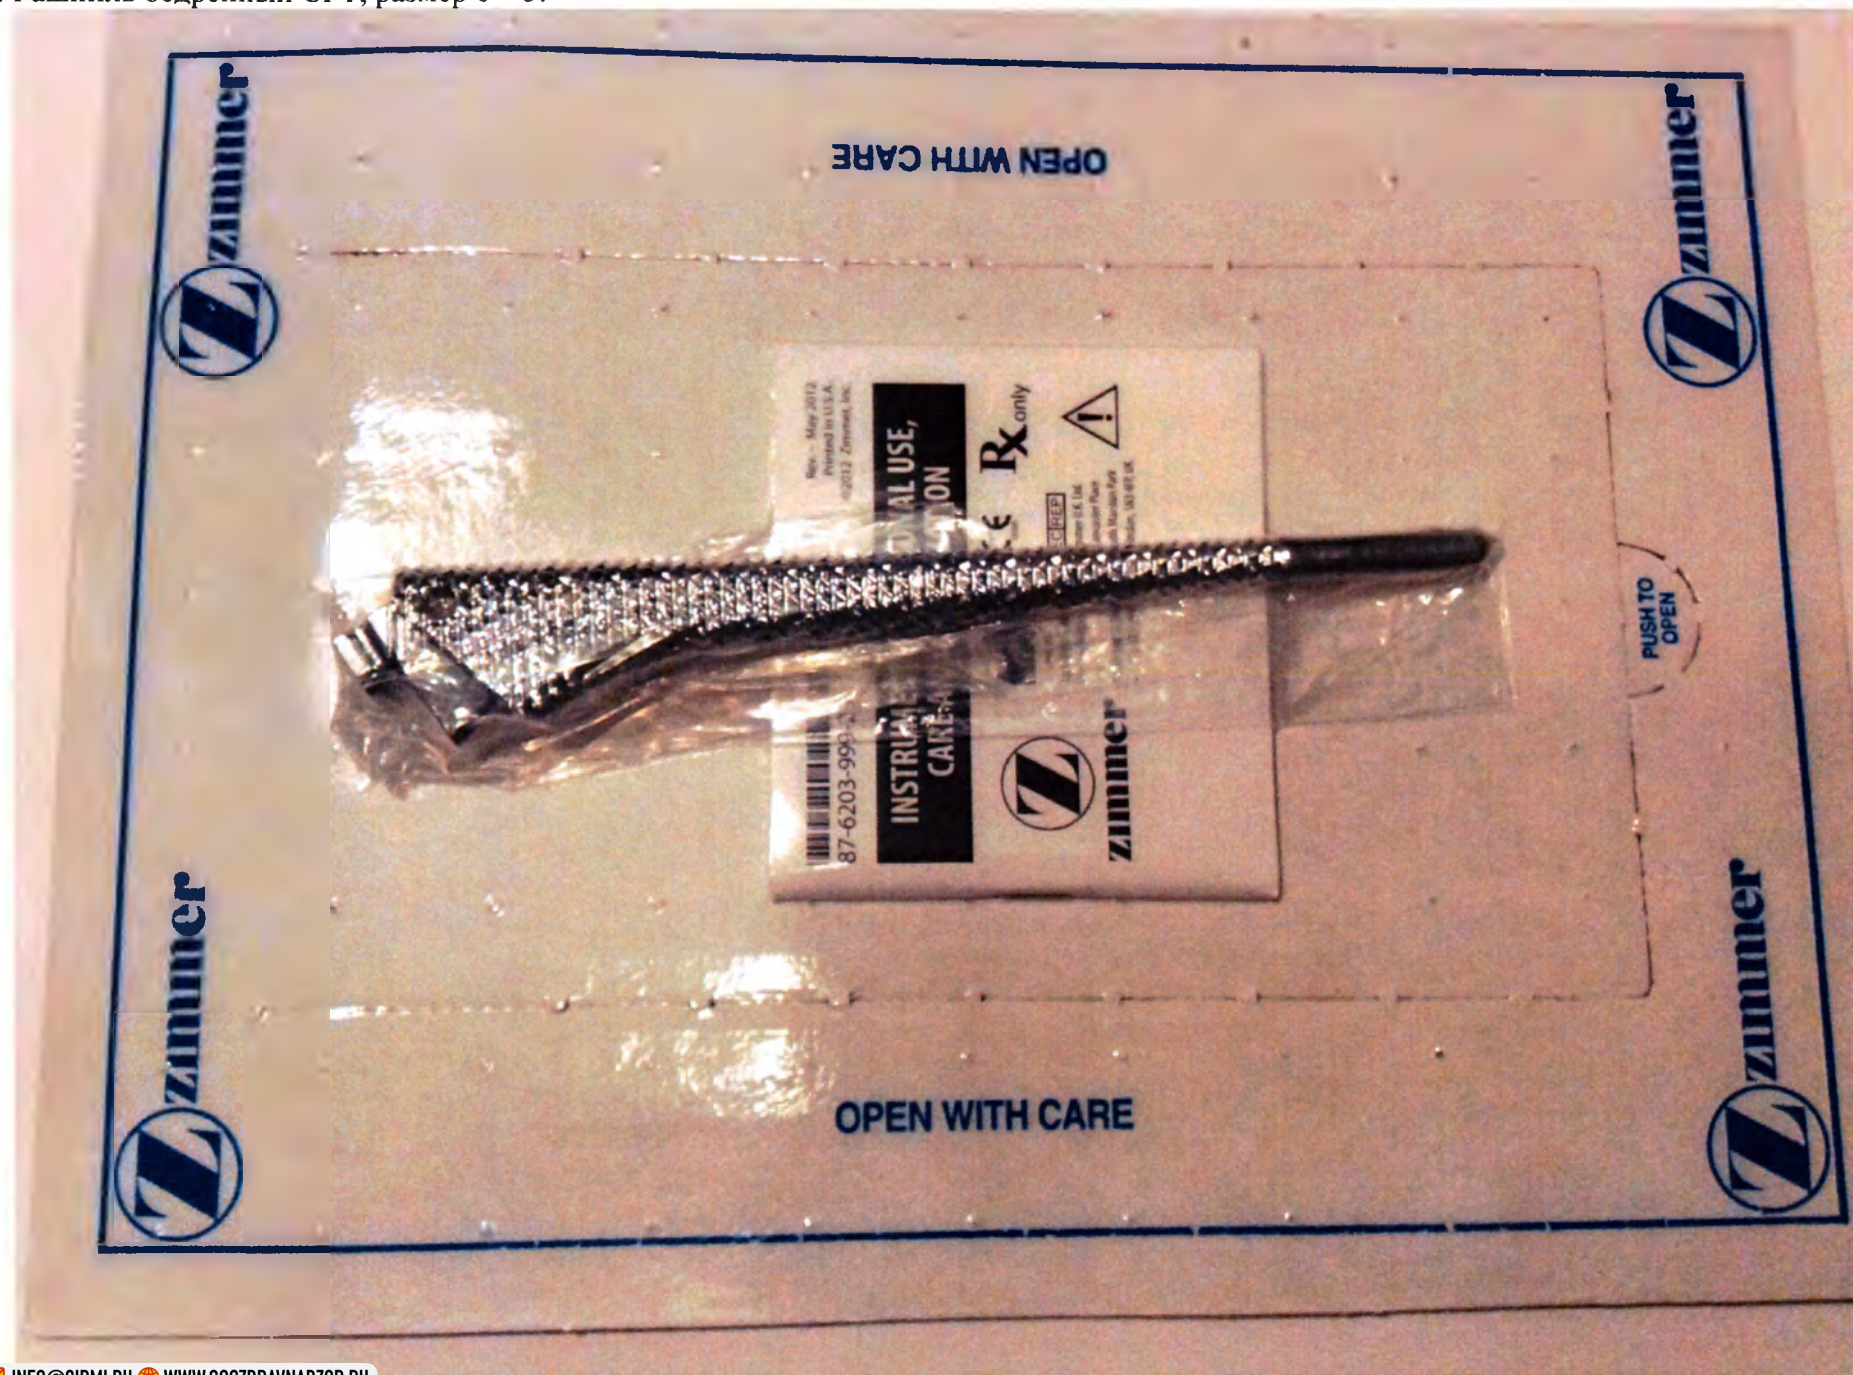

12. Рашпиль длинный опорный M/L Taper, размер 4.0 - 22.5.



13. Рашпиль локтевой пилотный Coonrad/Morrey.

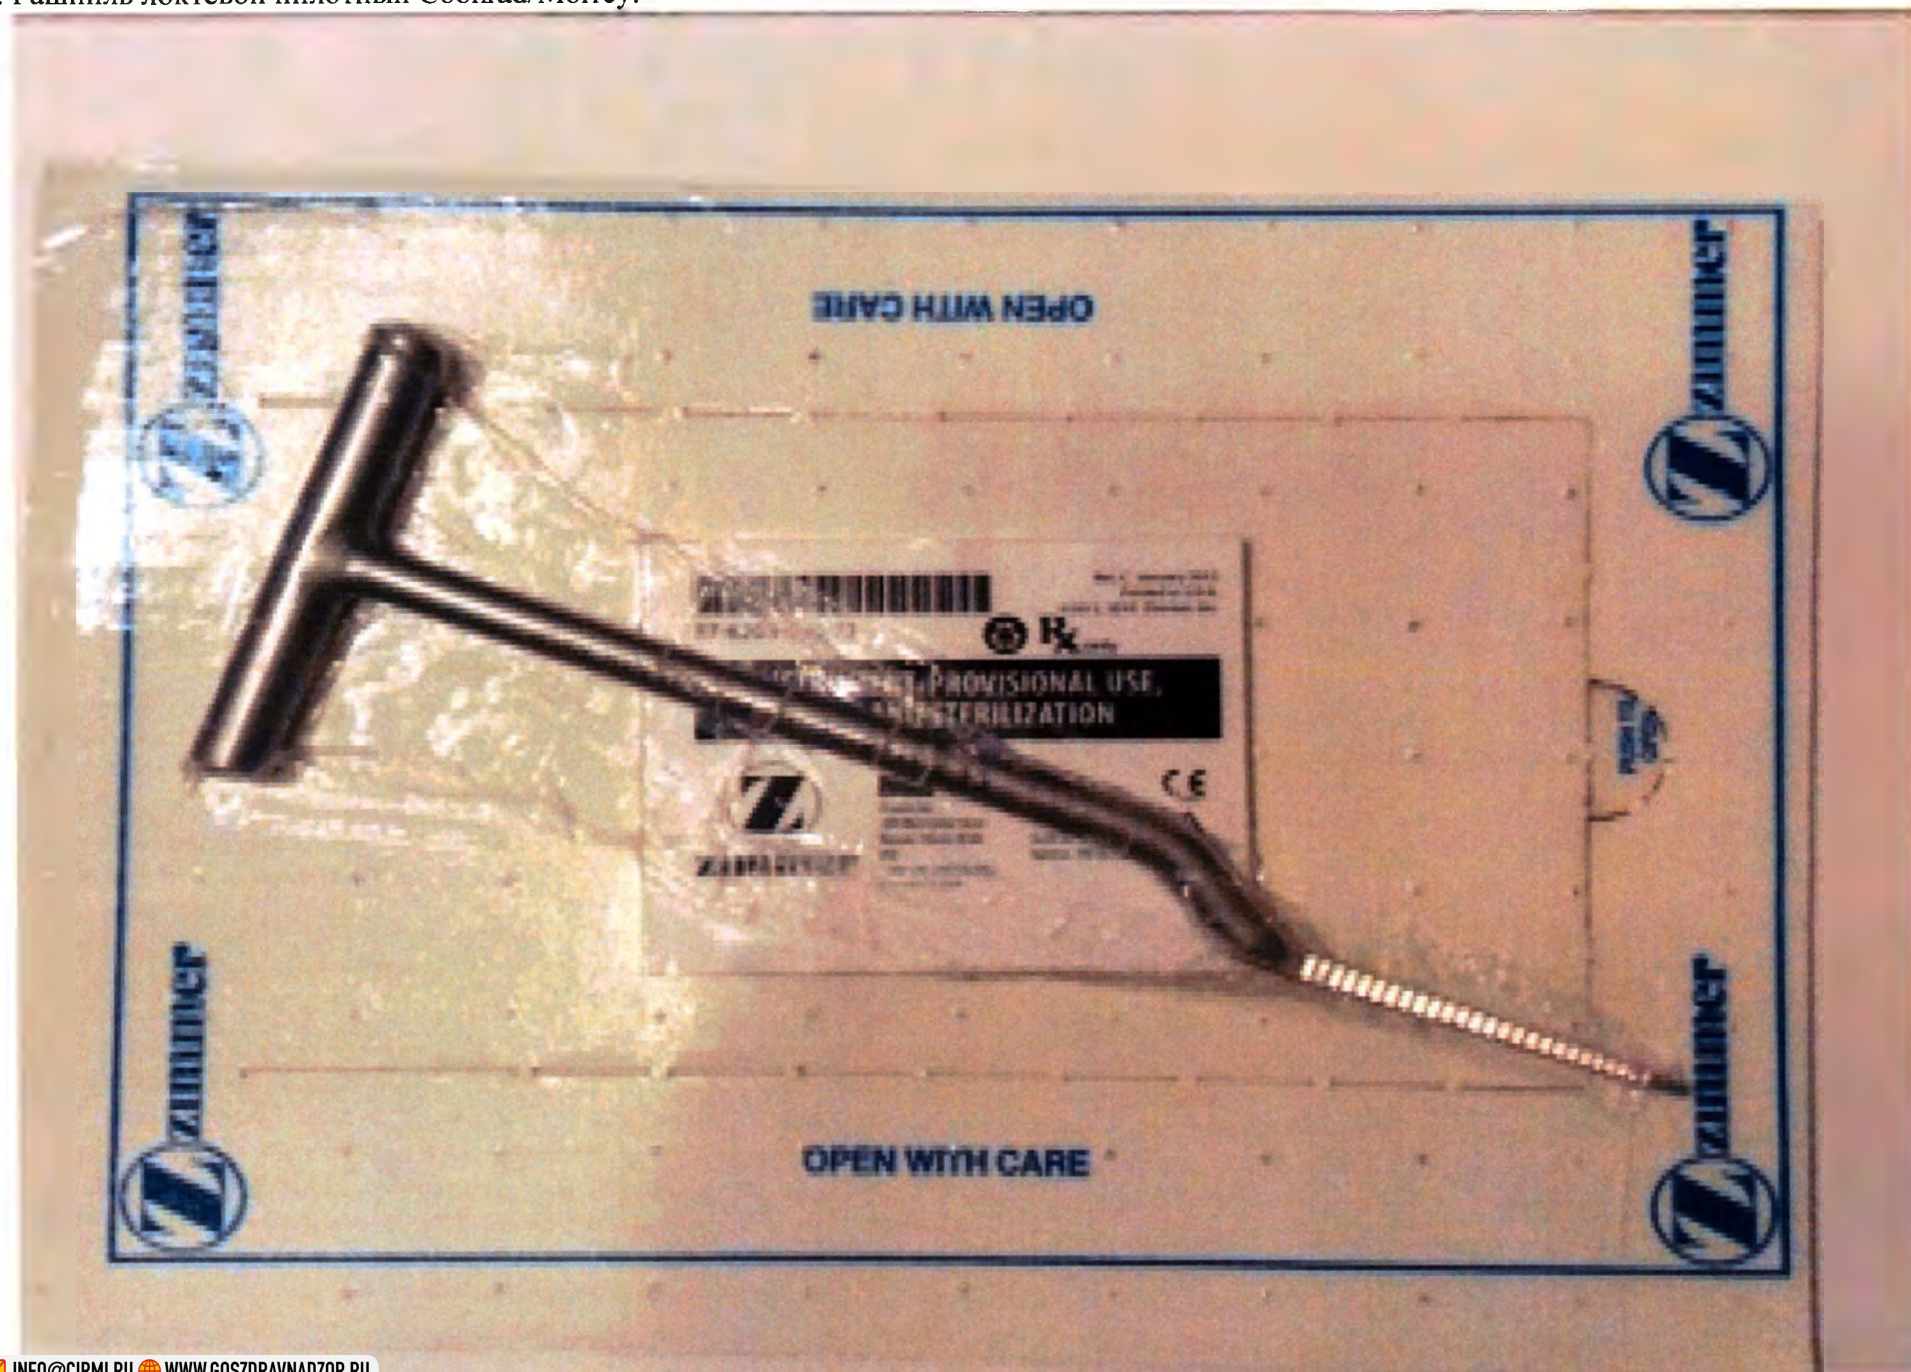

14. Рашпиль локтевой стартовый Coonrad/Morreу левый/правый.



15. Рашпиль локтевой Coonrad/Mottey левый/правый, малый/стандартный.



16. Рашпиль плечевой стартовый Coonrad/Morrey 102 мм (4 дюйма) – 152 мм (6 дюймов).




17. Рашпиль плечевой Coonrad/Morrey длина 102 мм (4 дюйма) малый/стандартный.



18. Рашпиль плечевой Coonrad/Morreу длина 152 мм (6 дюймов) малый/стандартный.



19. Рашпиль тибиаьный NexGen, размер 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10.

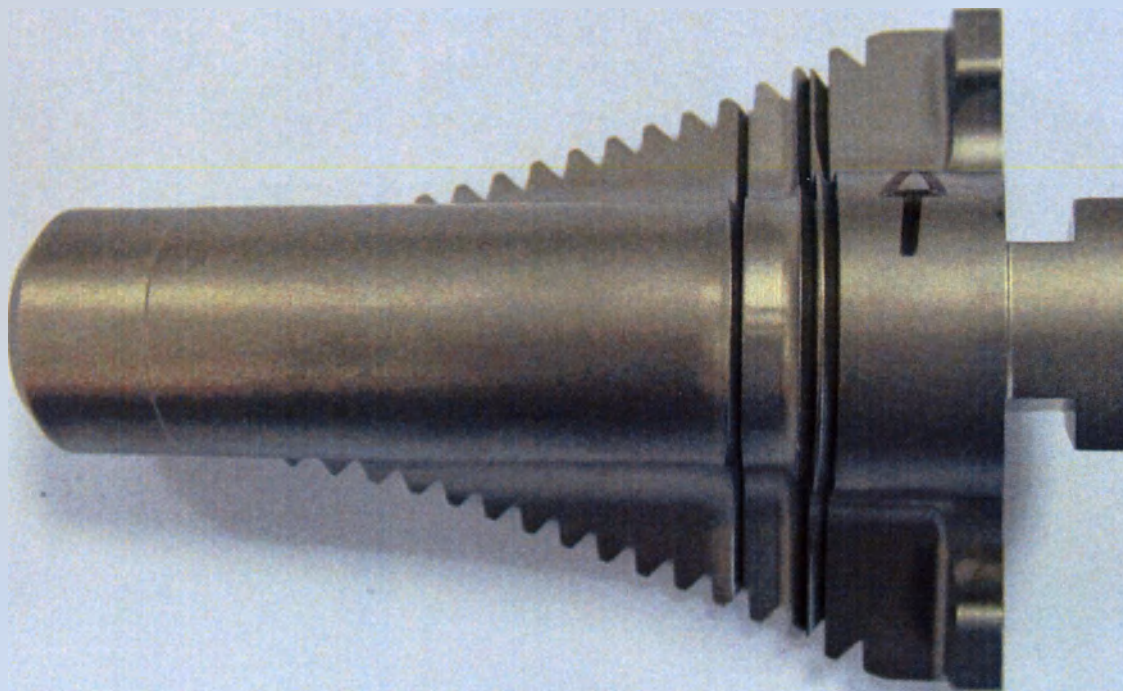


20. Рашпиль тибидальный полый NexGen, размер 3-4, 5-6, 7-8.



21. Рашпиль тибиаьный рифлений NexGen, размер 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.




22. Рашпиль тибиаьный средний ТМ 31х31 мм, 36х31 мм, 41х34 мм, 46х34 мм.

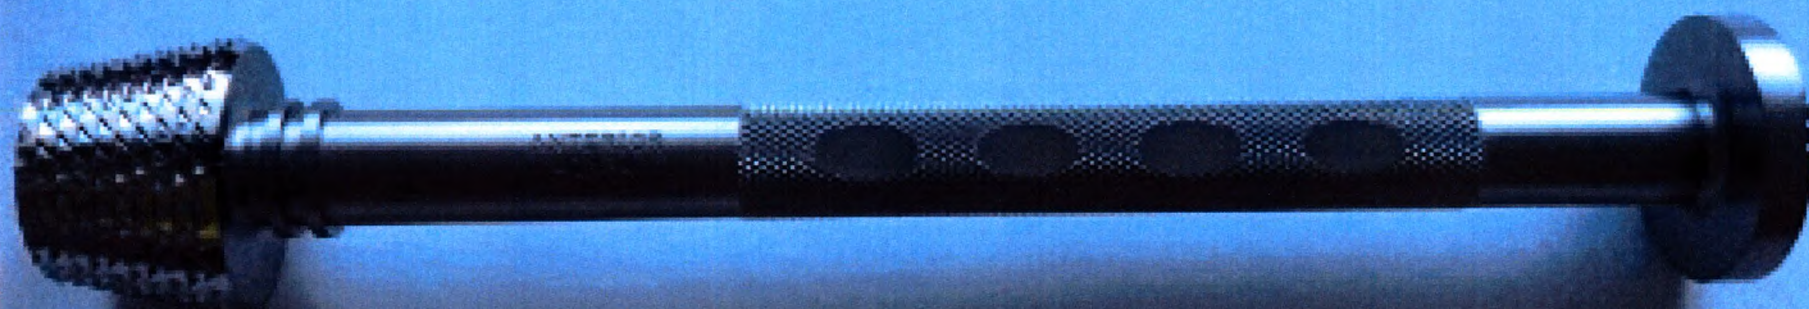

23. Ример вертлужный 36 мм - 80 мм.



24. Пример гибкий Pressure Sentinel, диаметр 5.0 мм - 27.0 мм.

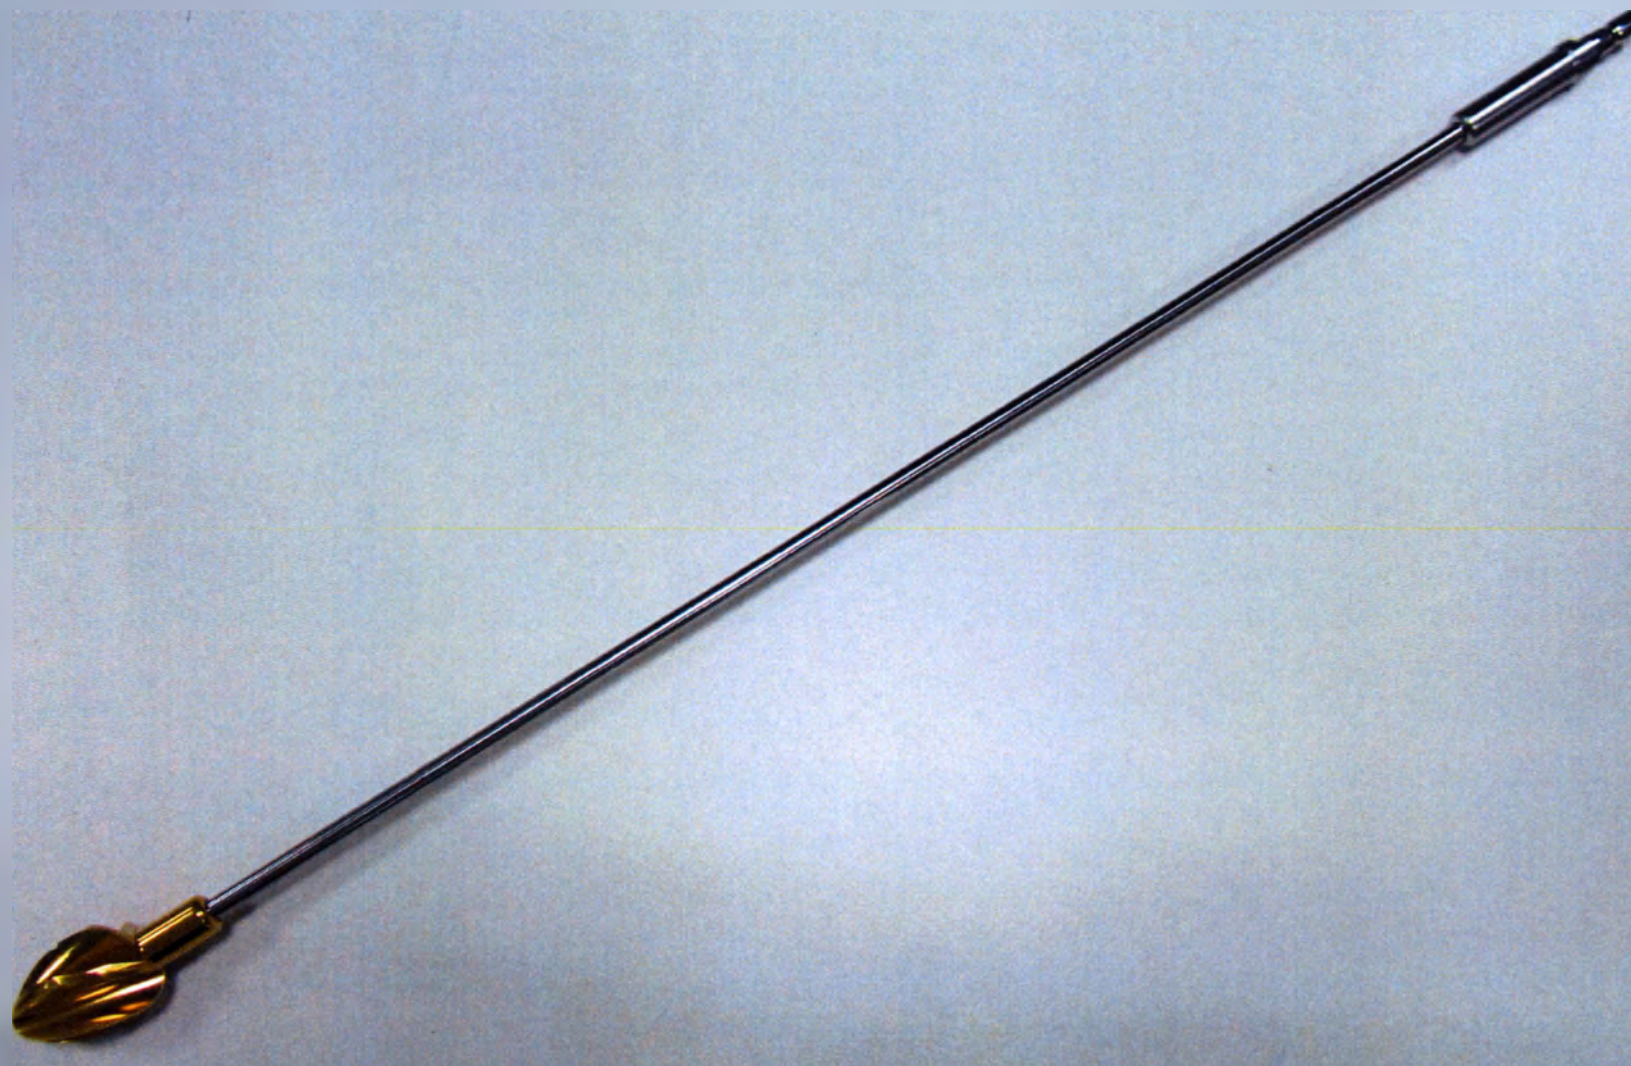


25. Ример основания гленовидного 1.



26. Ример основания гленоидного 2 36 мм-40 мм.



27. Ример гленоидный Bigliani/Flatow 40 мм - 52 мм.

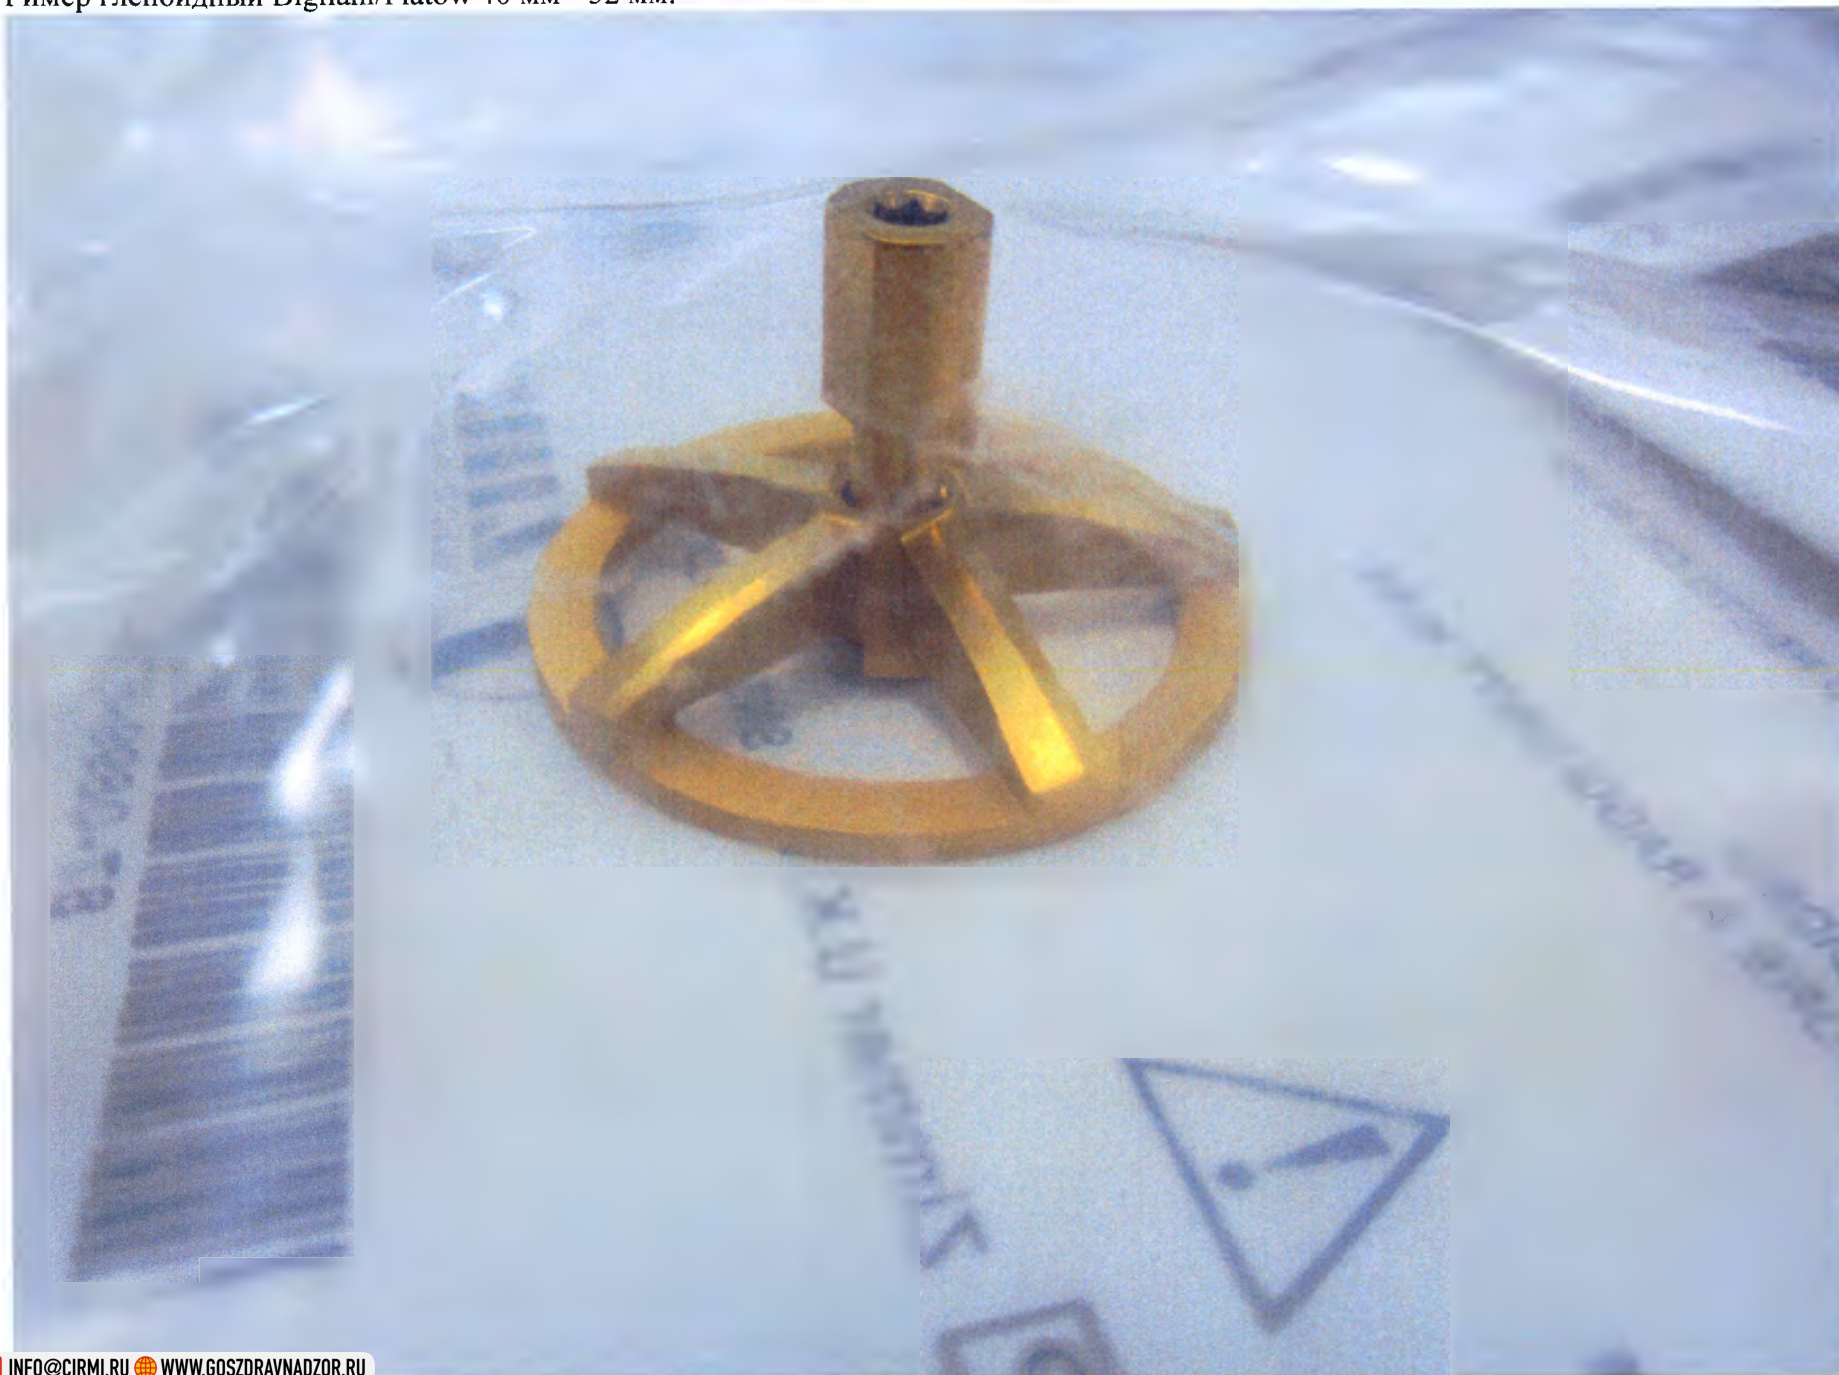

28. Ример гленоидный канюлированный Bigliani/Flatow 40 мм - 52 мм.



29. Ример для чашки ревизионной, размер 40 мм-70 мм.



30. Ример тибиаьный MG II, диаметр 9 мм - 24 мм.




31. Сверло бедренное NexGen.



32. Сверло бедренное NexGen, диаметр 18 мм.




33. Сверло бедренное NexGen, размер A,B.

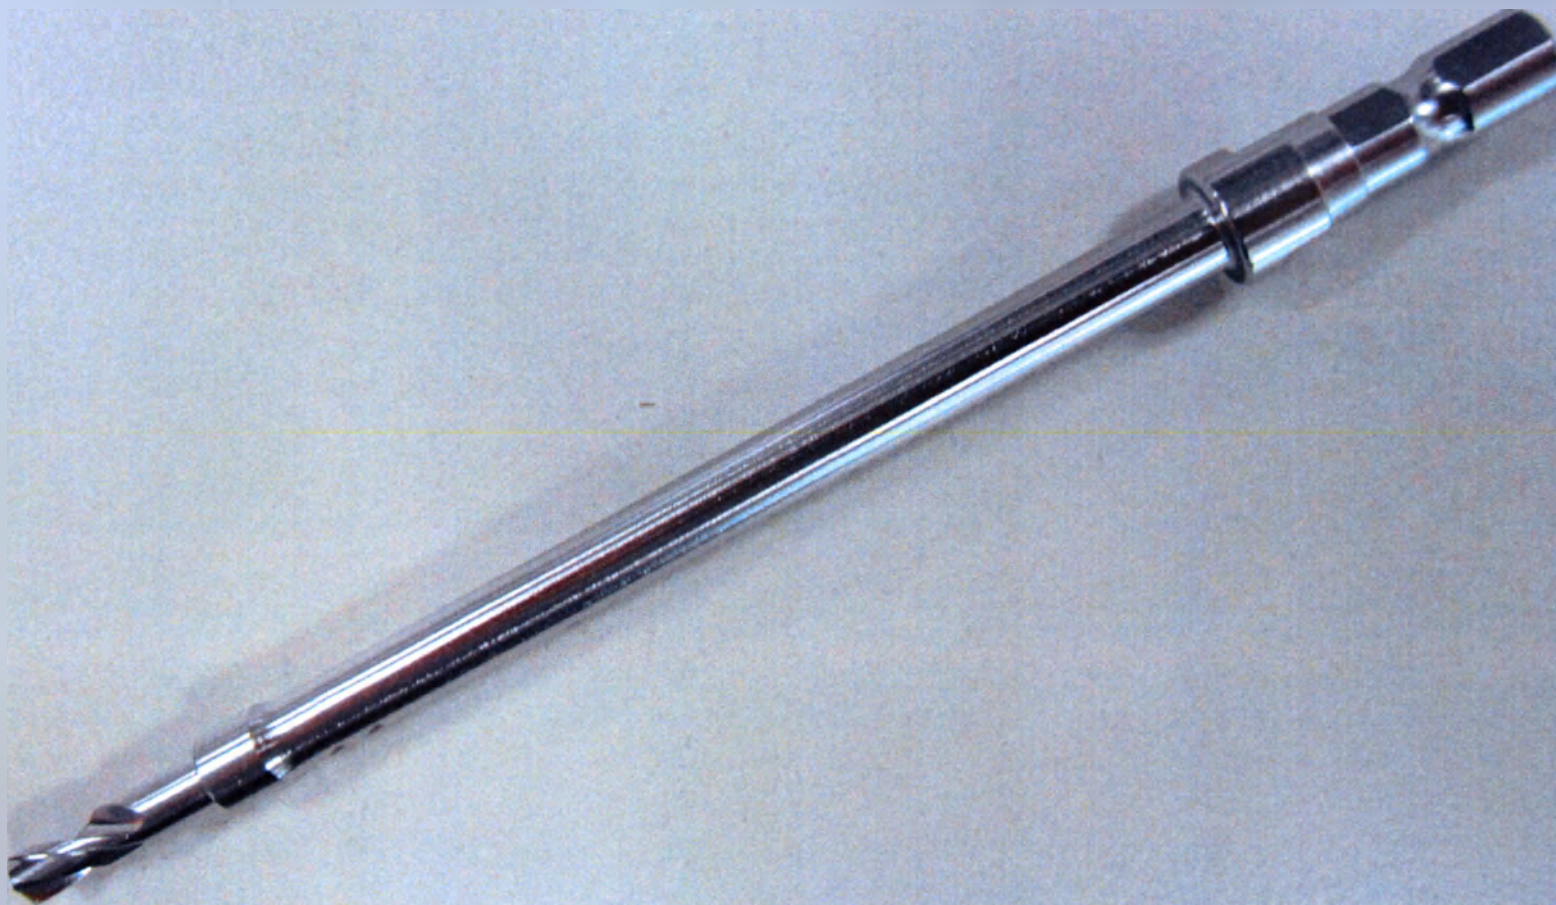

34. Сверло вертлужное самоцентрирующееся ZCA 6 мм -13 мм.




35. Сверло, диаметр 2.5 мм.

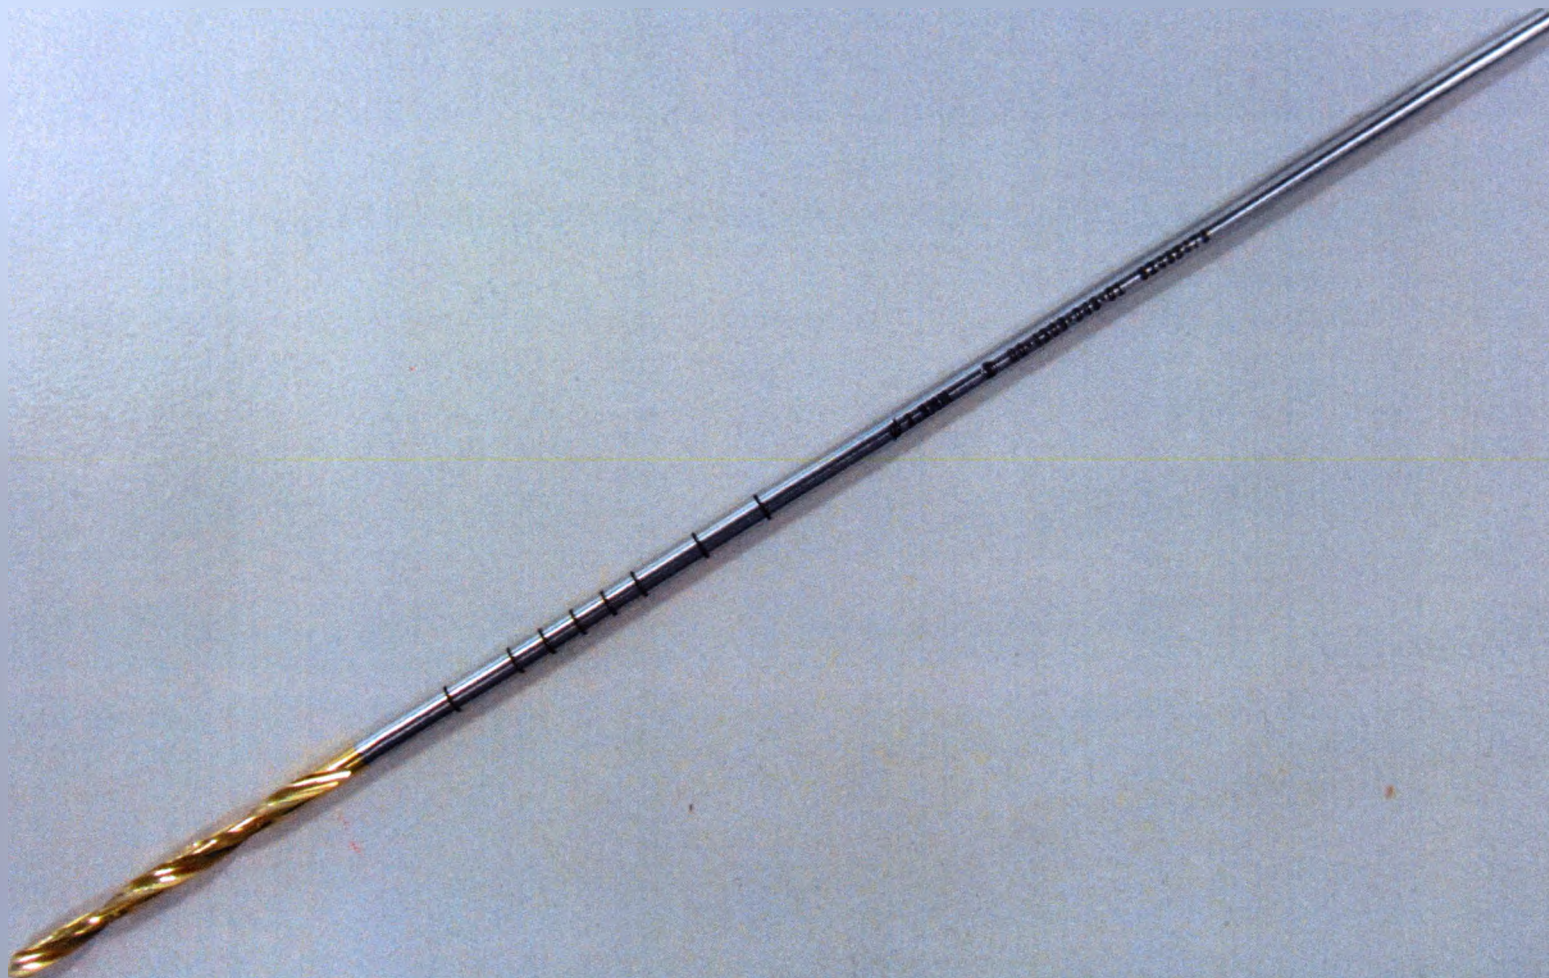

36. Сверло для основания гленоидного, диаметр 7.5 мм.



37. Сверло для отверстий под винты, диаметр 3.2 мм.

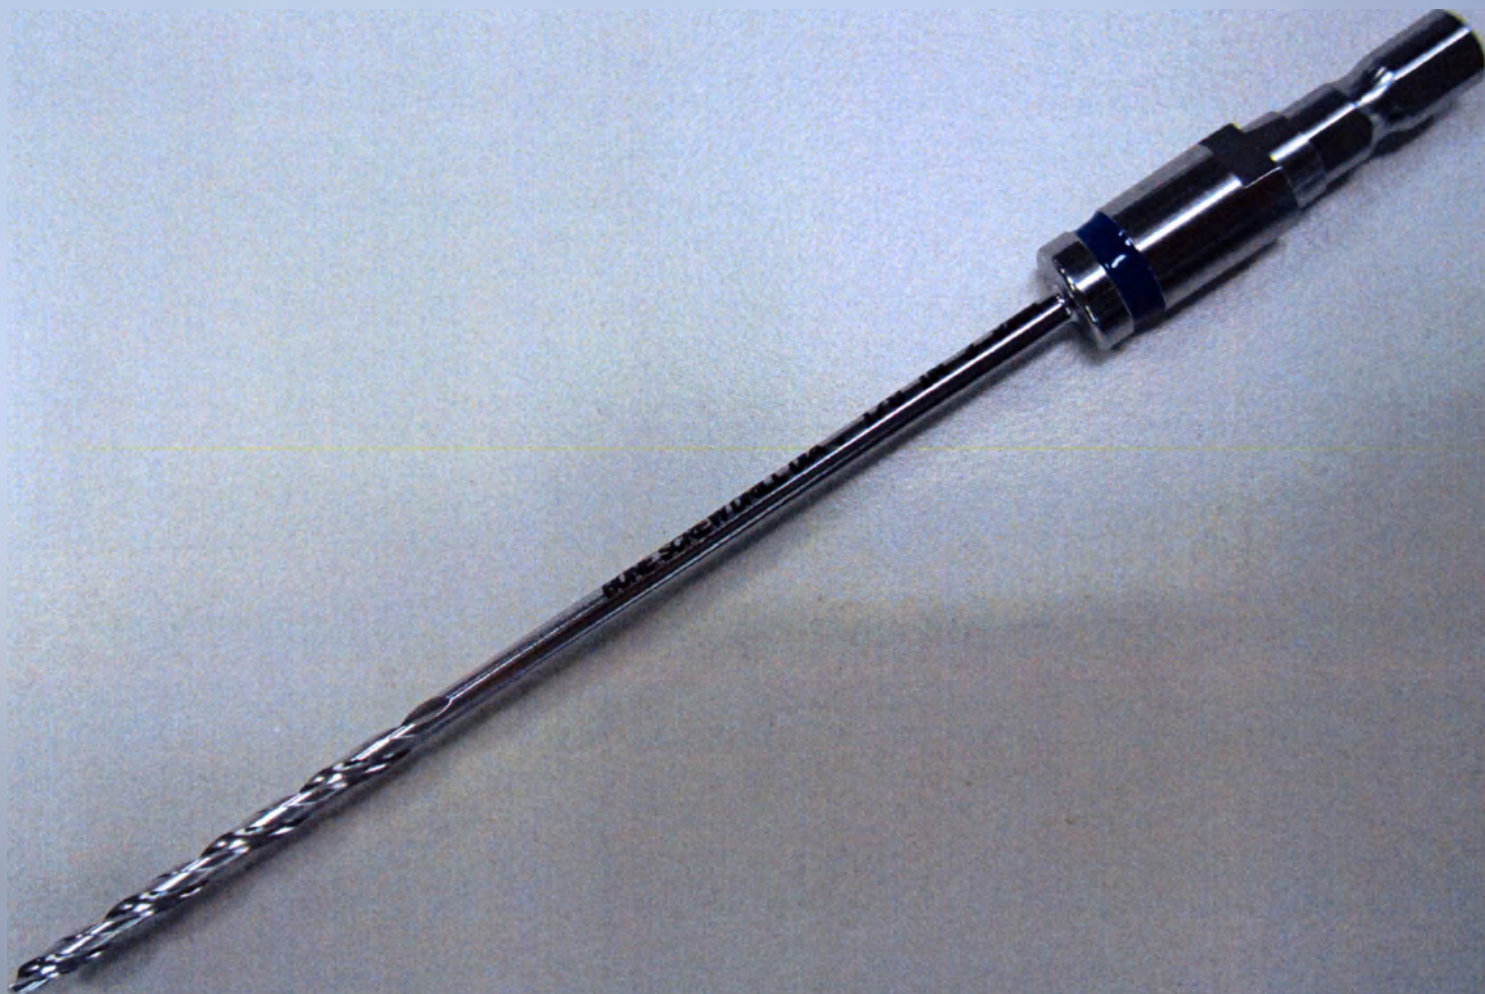

38. Сверло гибкое, диаметр 3.2 мм длина 15-45 мм.



39. Сверло интрамедуллярное, диаметр 8 мм.



40. Сверло интрамедуллярное с разметкой NexGen, диаметр 8 мм.




41. Сверло кортикальное, диаметр 7.5 мм.




42. Сверло пателло-фemorальное MG II, диаметр 6.4 мм.



43. Сверло стартовое 19 мм (0.75 дюйма) для чашки 22 мм/ 28 мм (1 дюйм) для чашки 28 мм.

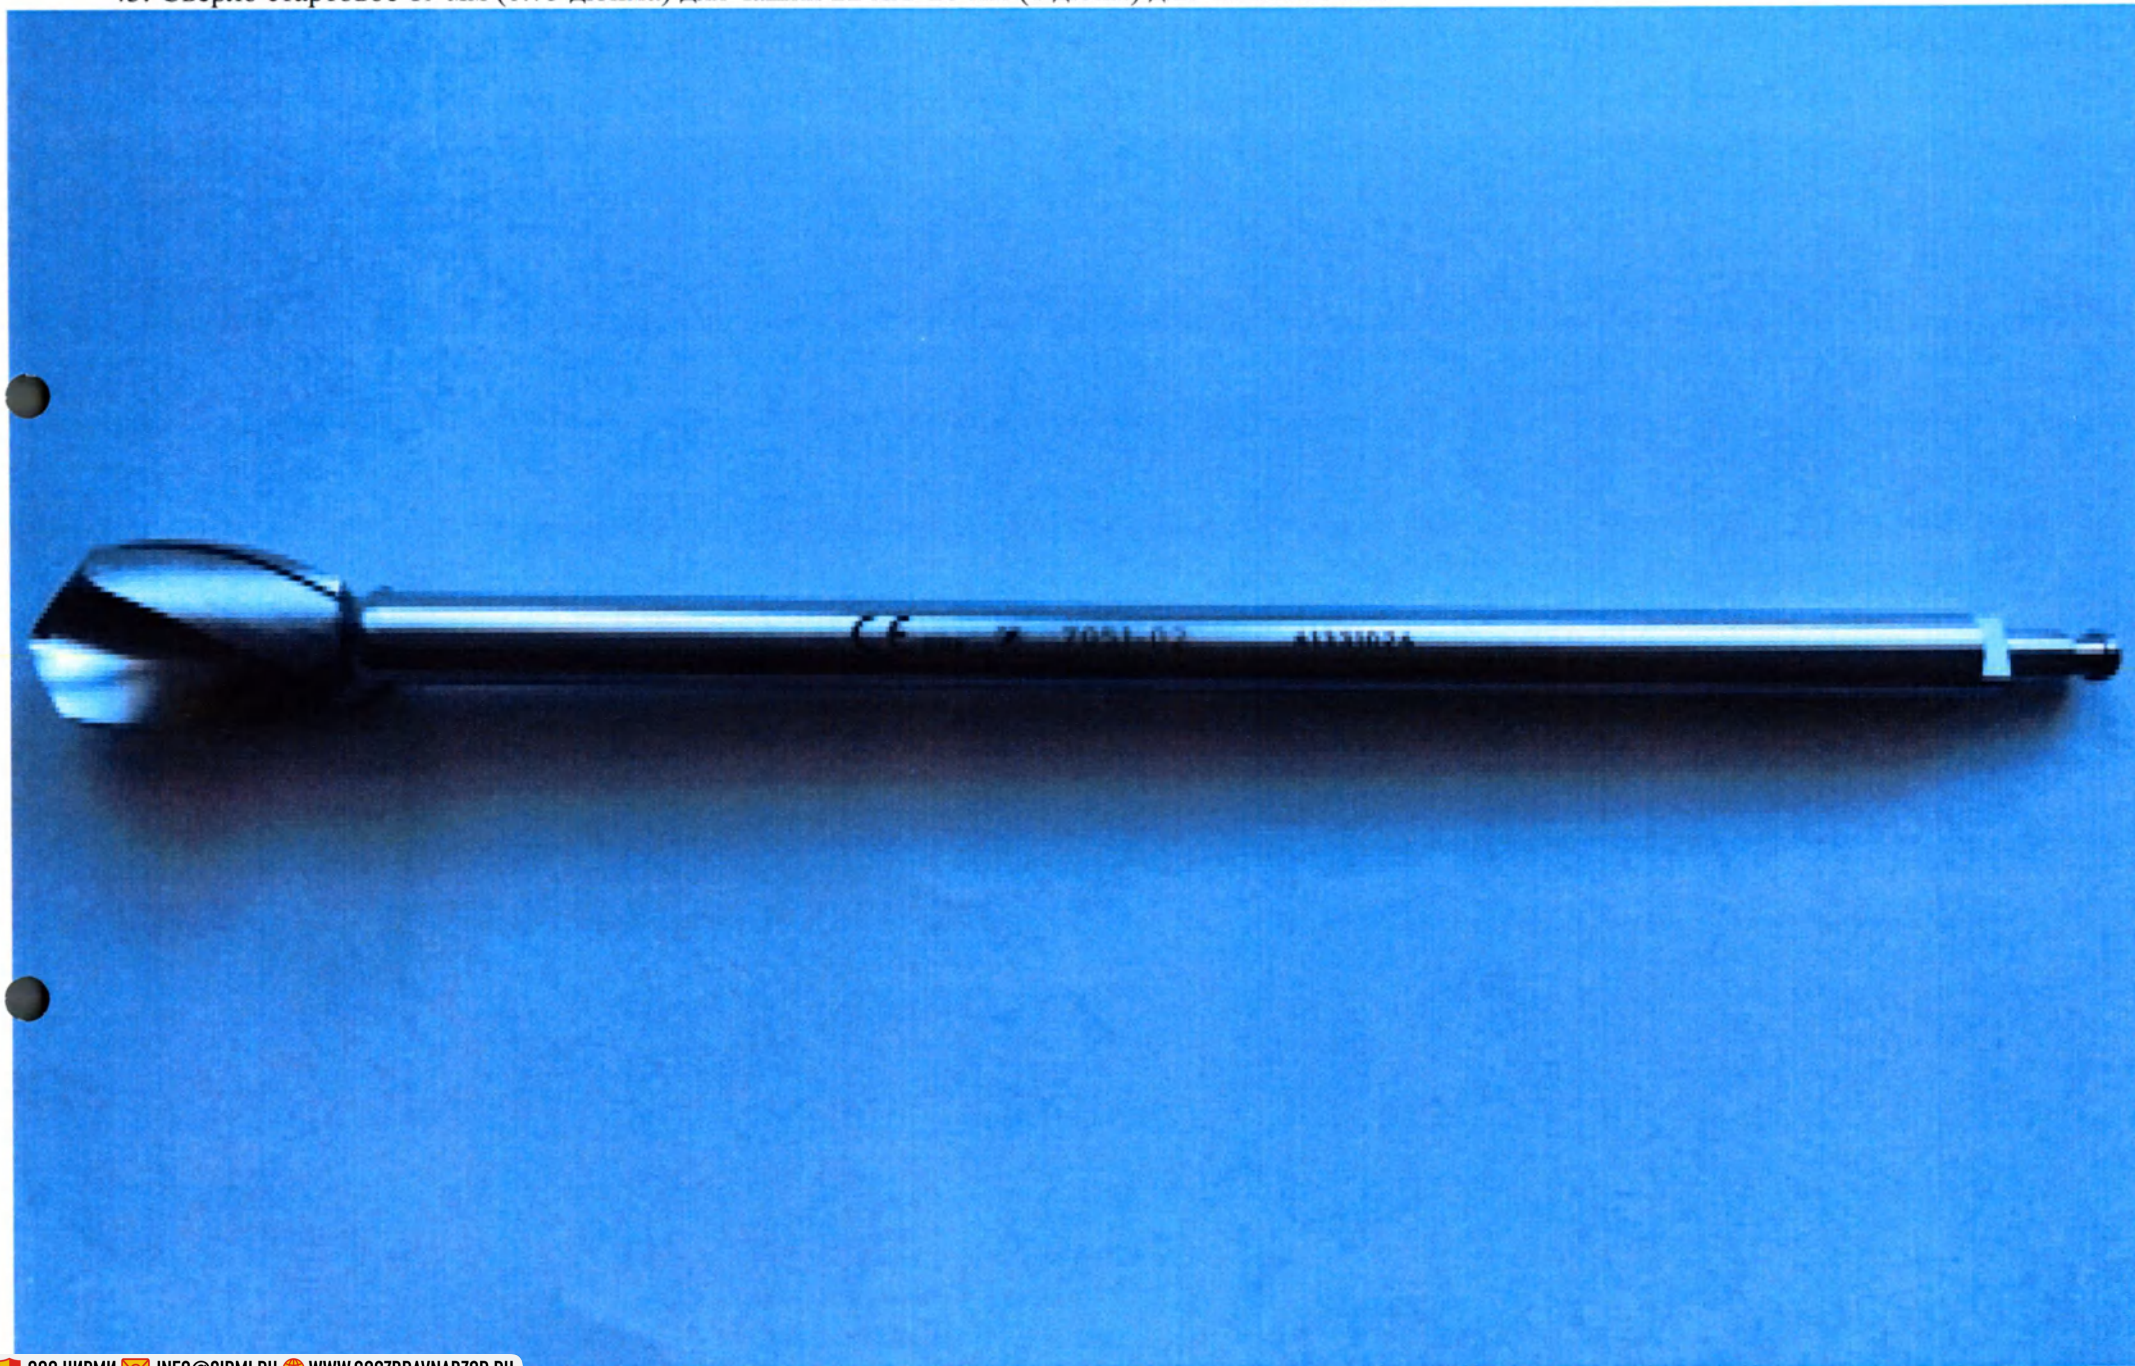

44. Сверло тибральное 29 мм.

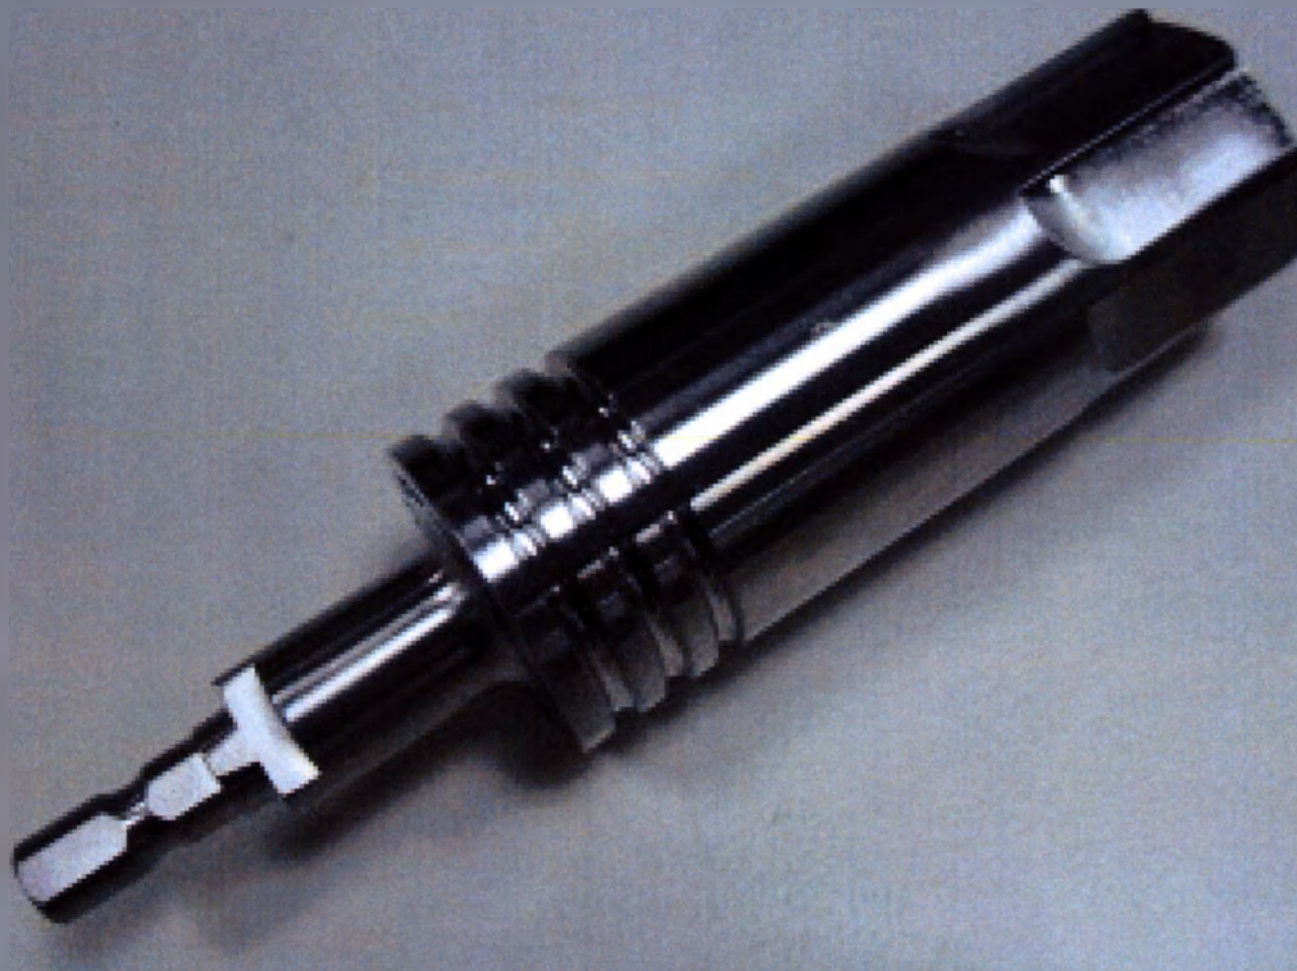

45. Сверло тибальное со стопором, диаметр 10.7 мм.



46. Сверло тibiaльное NexGen.



47. Сверло тиббиальное NexGen для ножки рифленой, диаметр 15 мм.



48. Сверло тибальное NexGen для ножки цементной, диаметр 16.7 мм.



49. Сверло тибальное NexGen для немодульной тибии.



50. Сверло MG II, диаметр 3.2 мм.



51. Сверло NexGen для ножки тибальной, диаметр 12.7 мм.




52. Сверло Trilogy, диаметр 3.2 мм длина 15-45 мм.





54. Фреза полная для ревизии чашки, размер 42 мм – 72 мм.

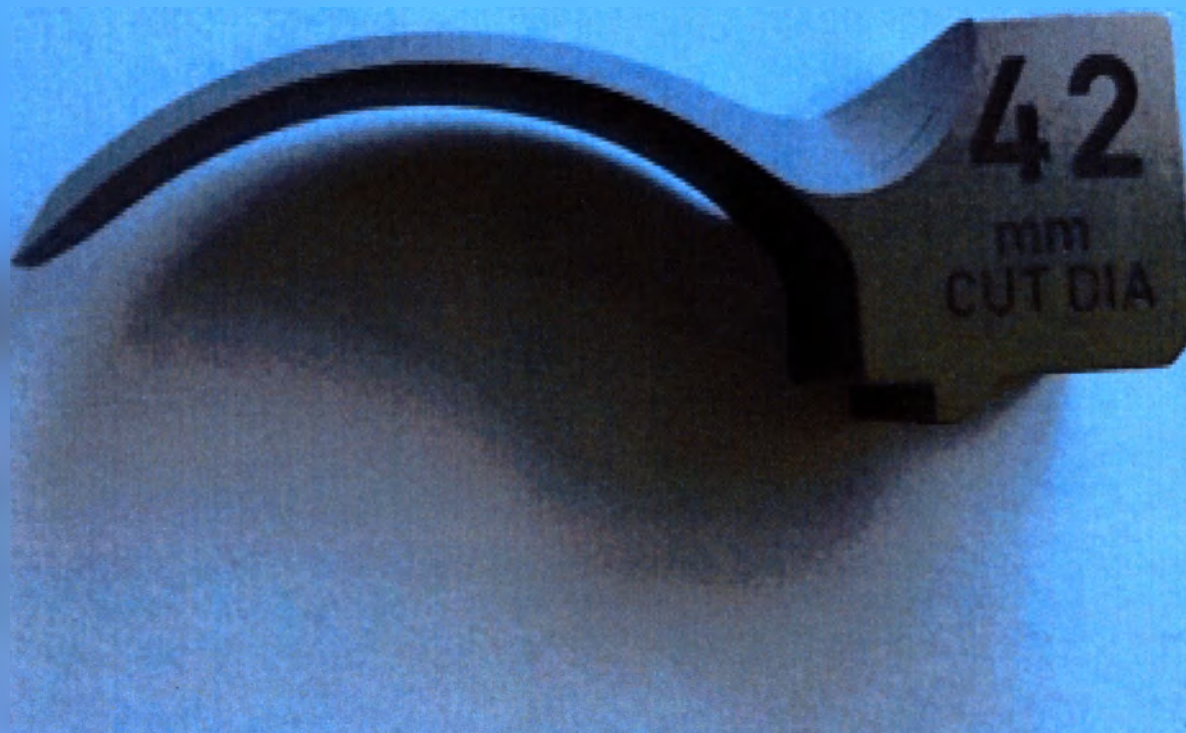

55. Фреза усеченная для ревизии чашки, размер 42 мм – 72 мм.




56. Фреза шаровая усеченная 42 мм - 64 мм.




Принадлежности:

1. Контейнер для инструментов.

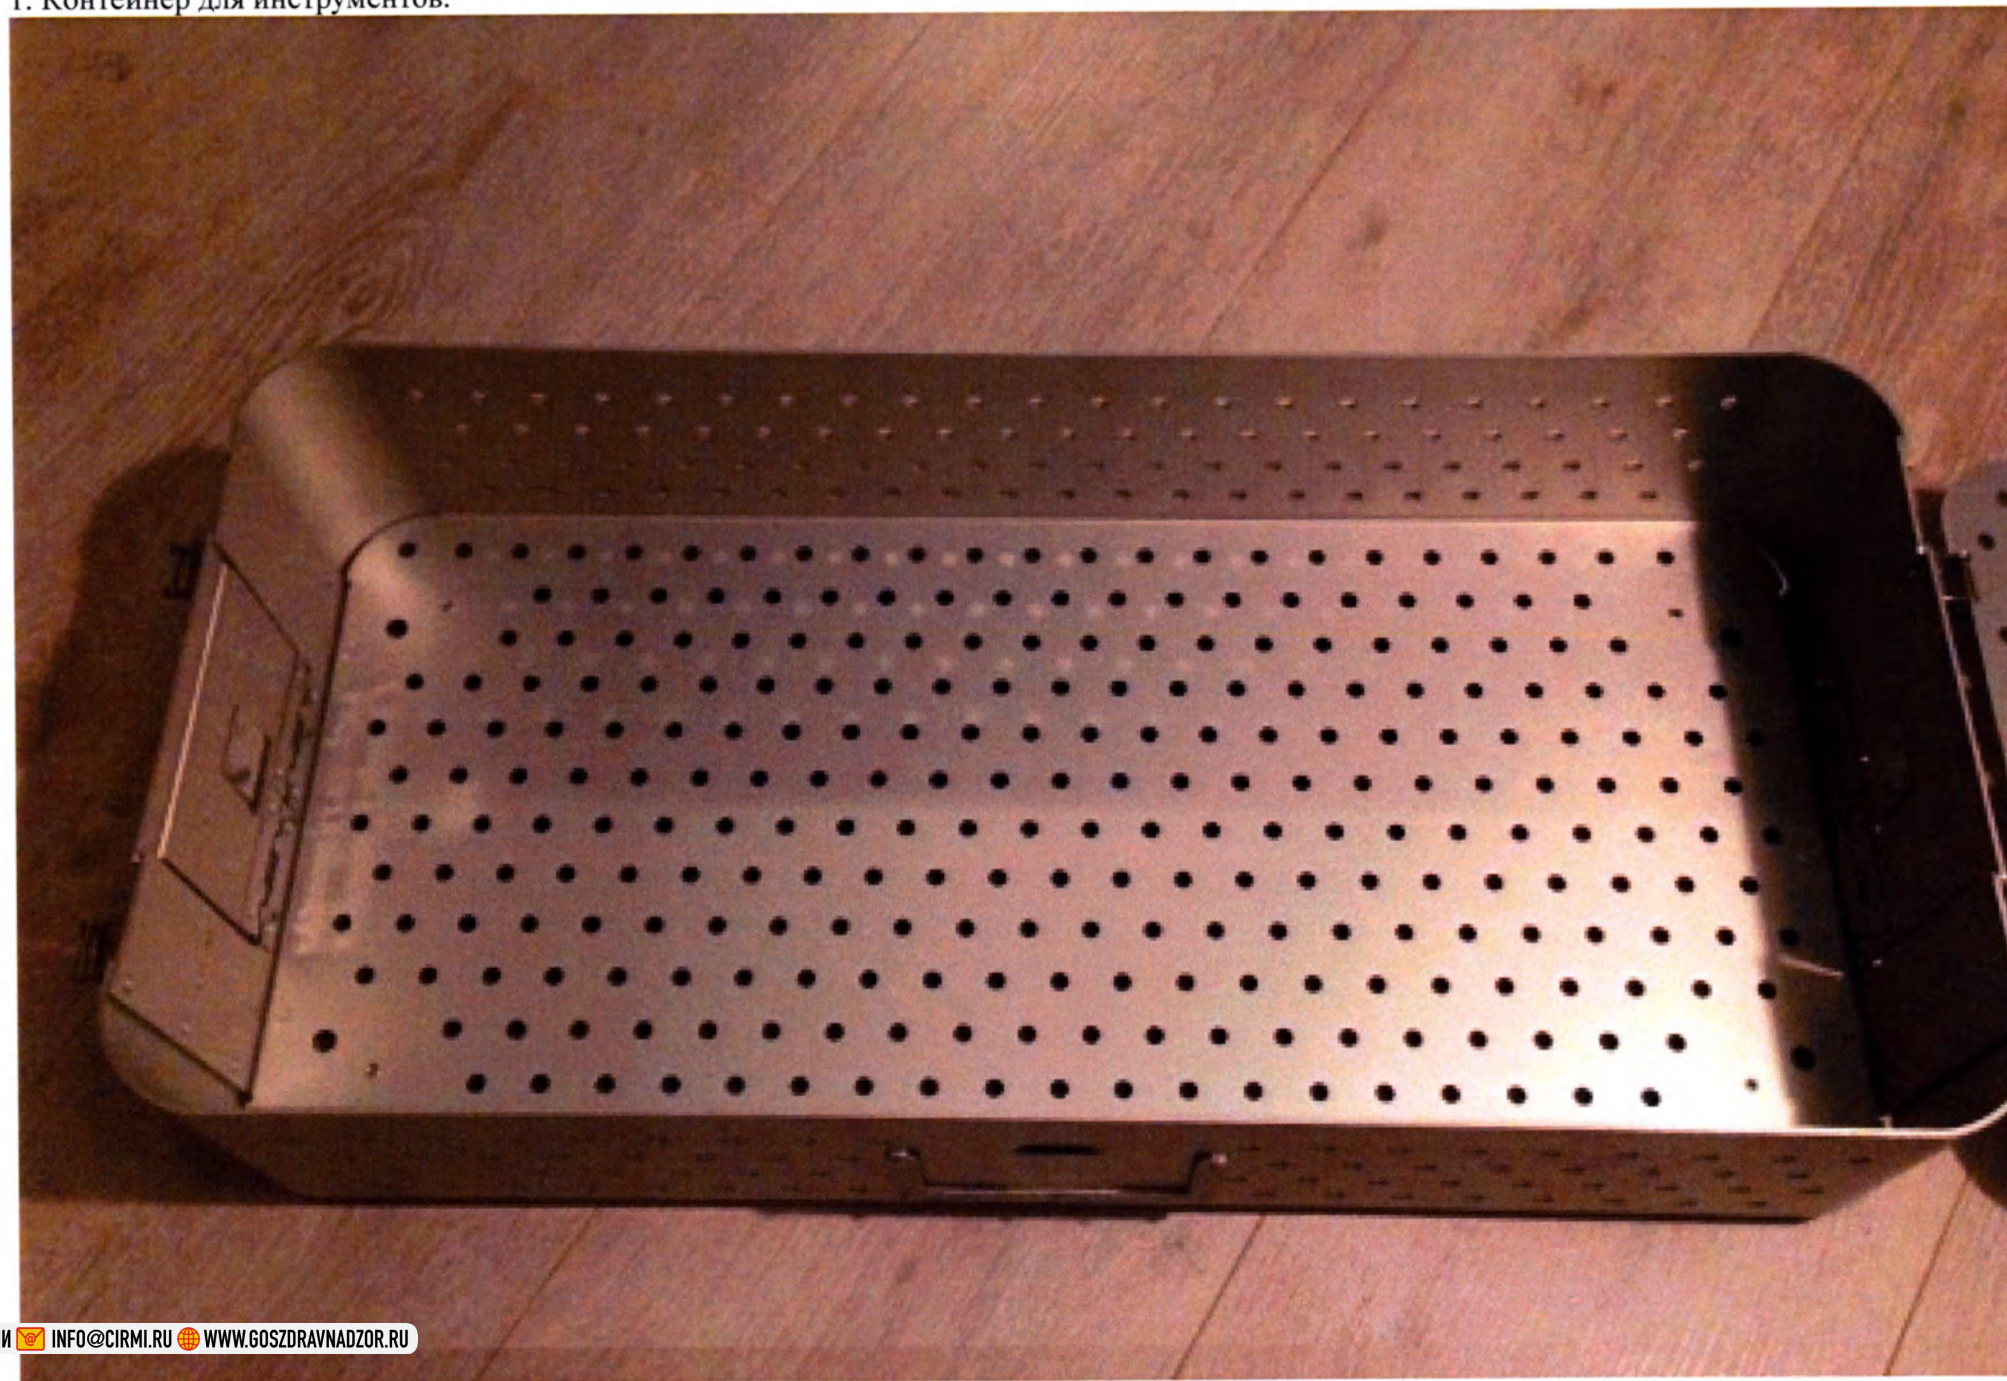


1. Контейнер для инструментов.

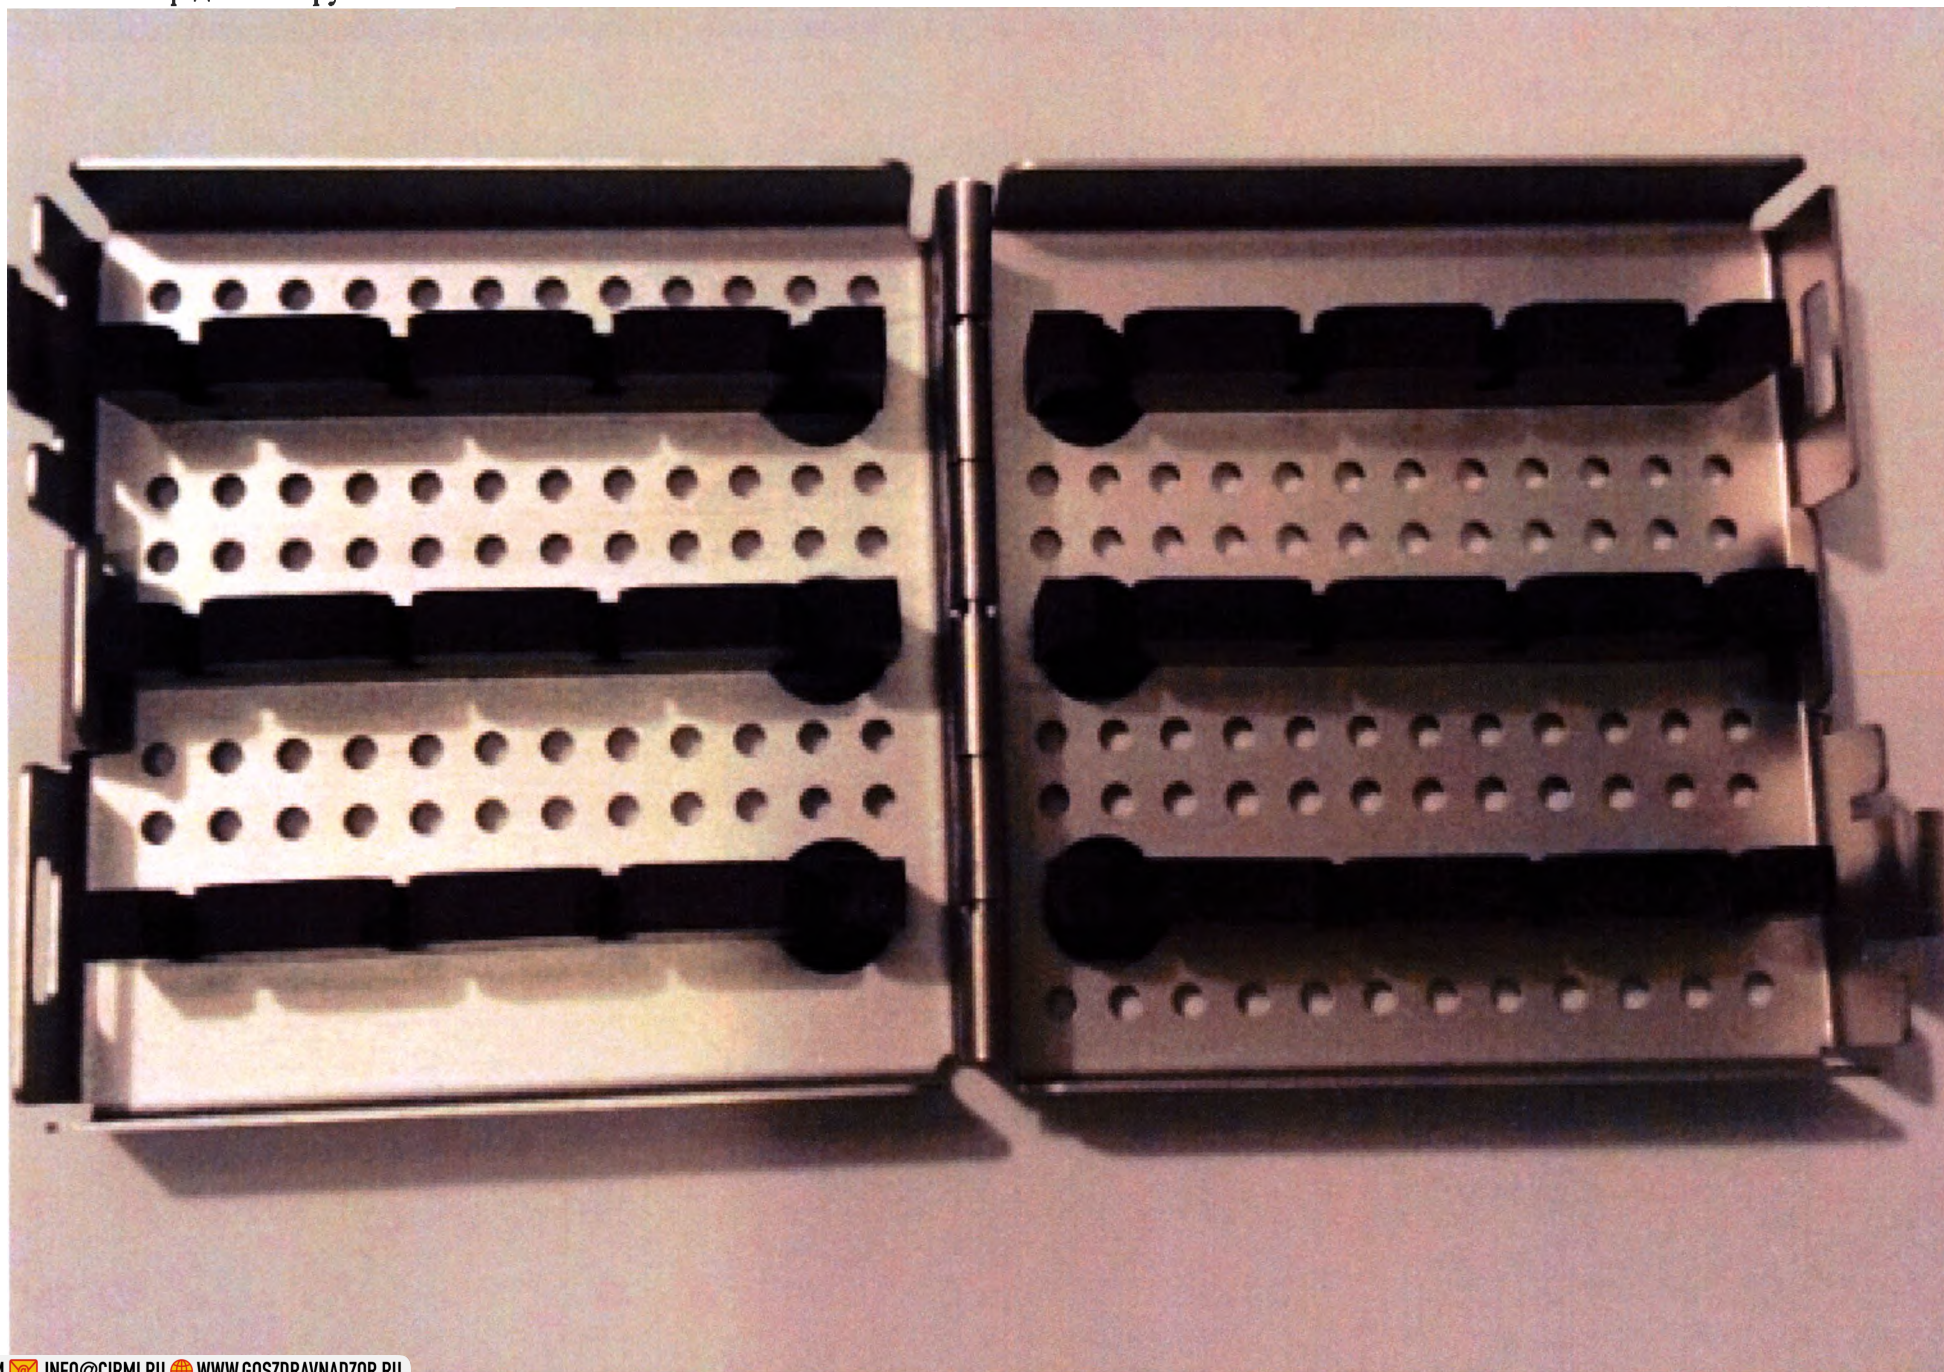


1. Контейнер для инструментов.




1. Контейнер для инструментов.

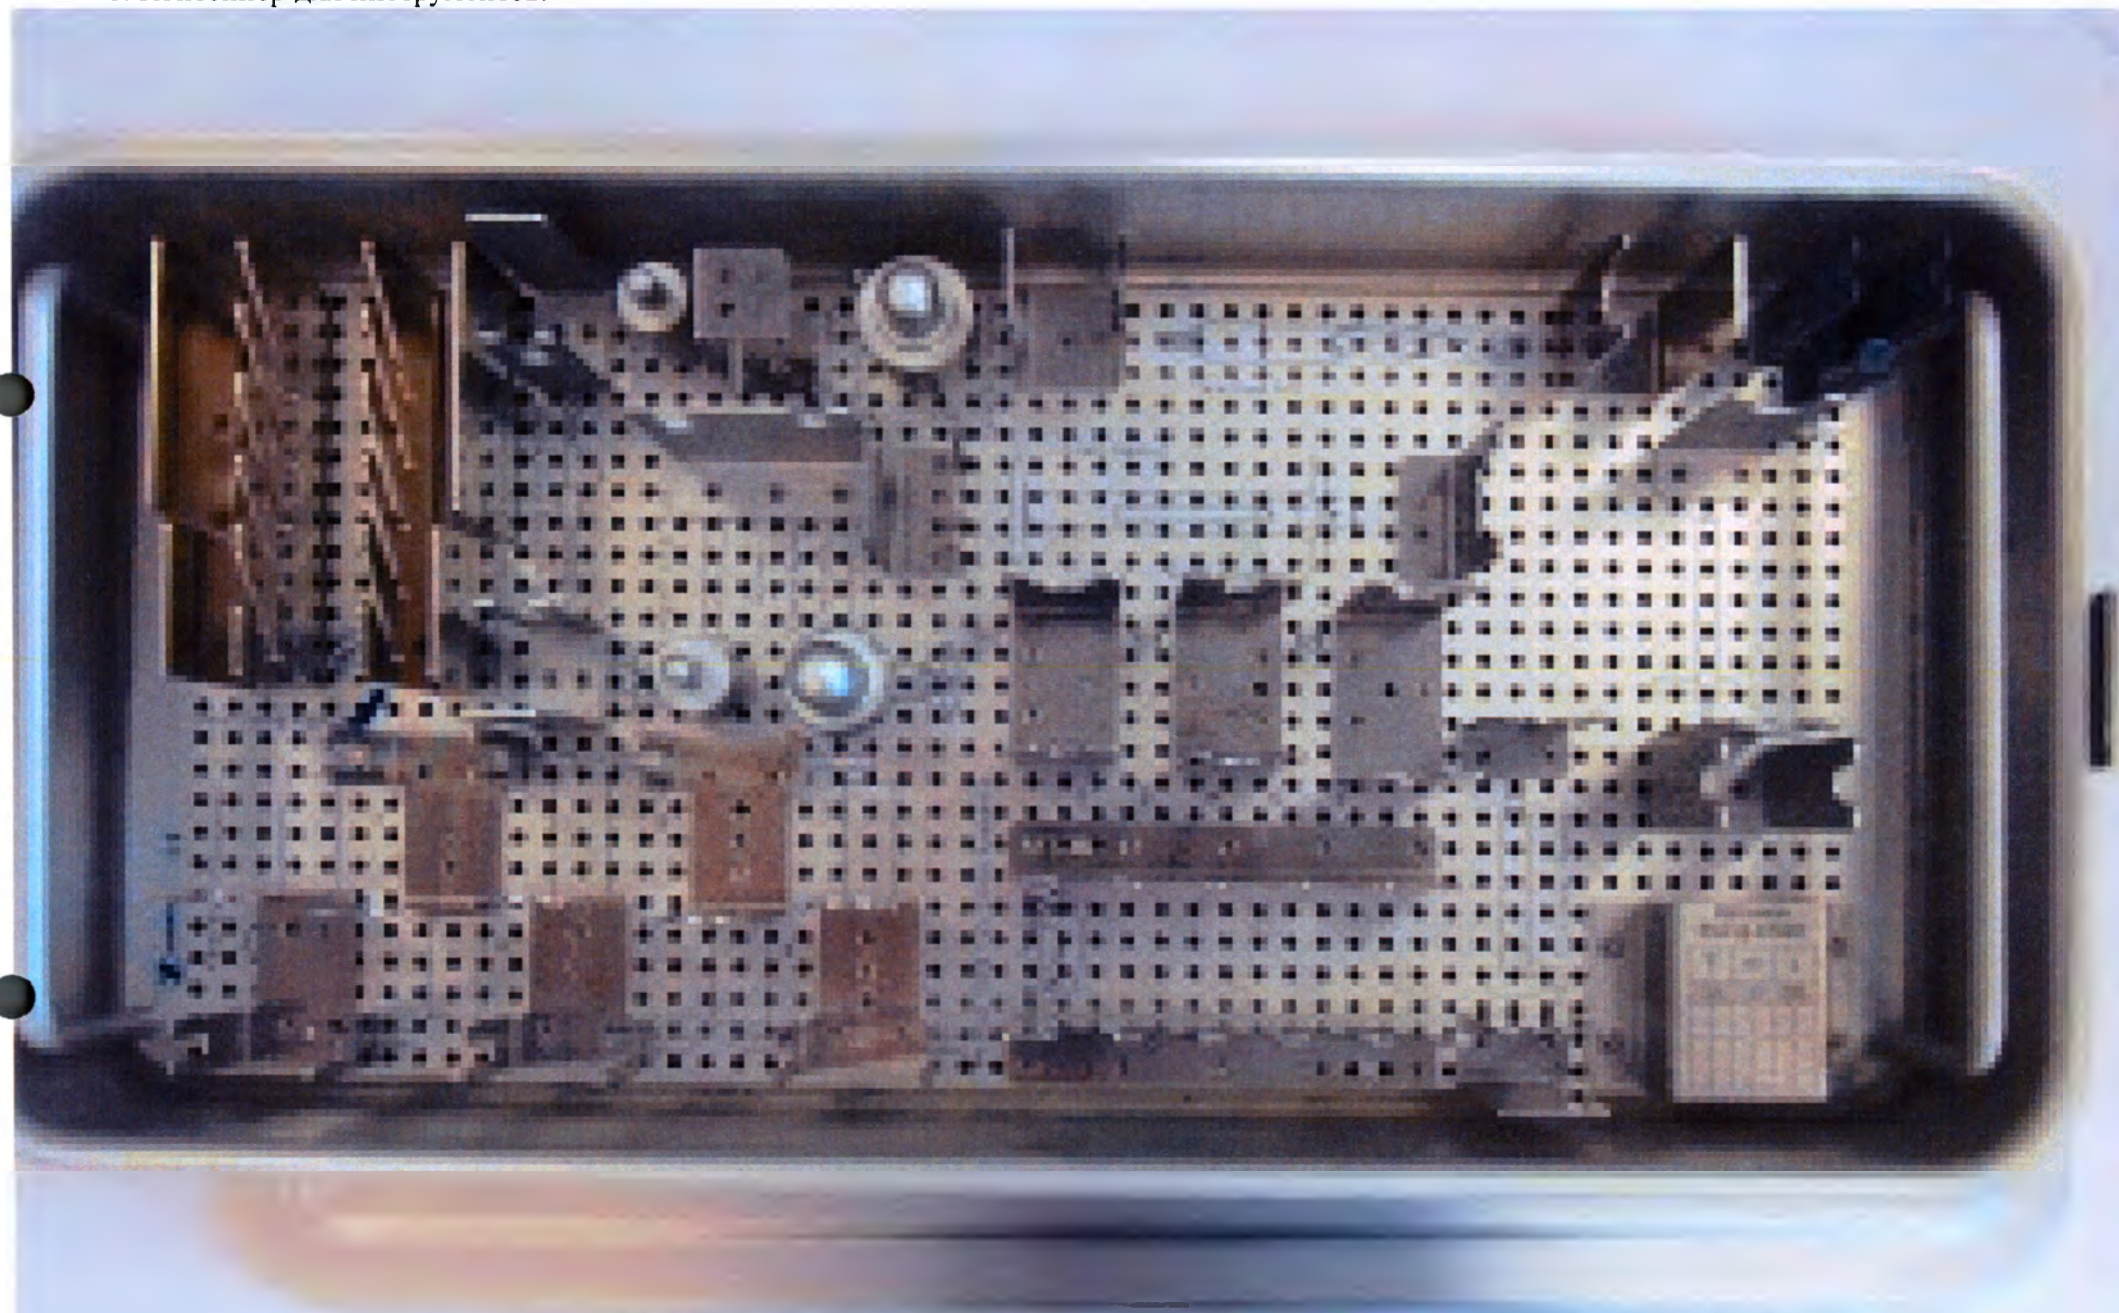


1. Контейнер для инструментов.

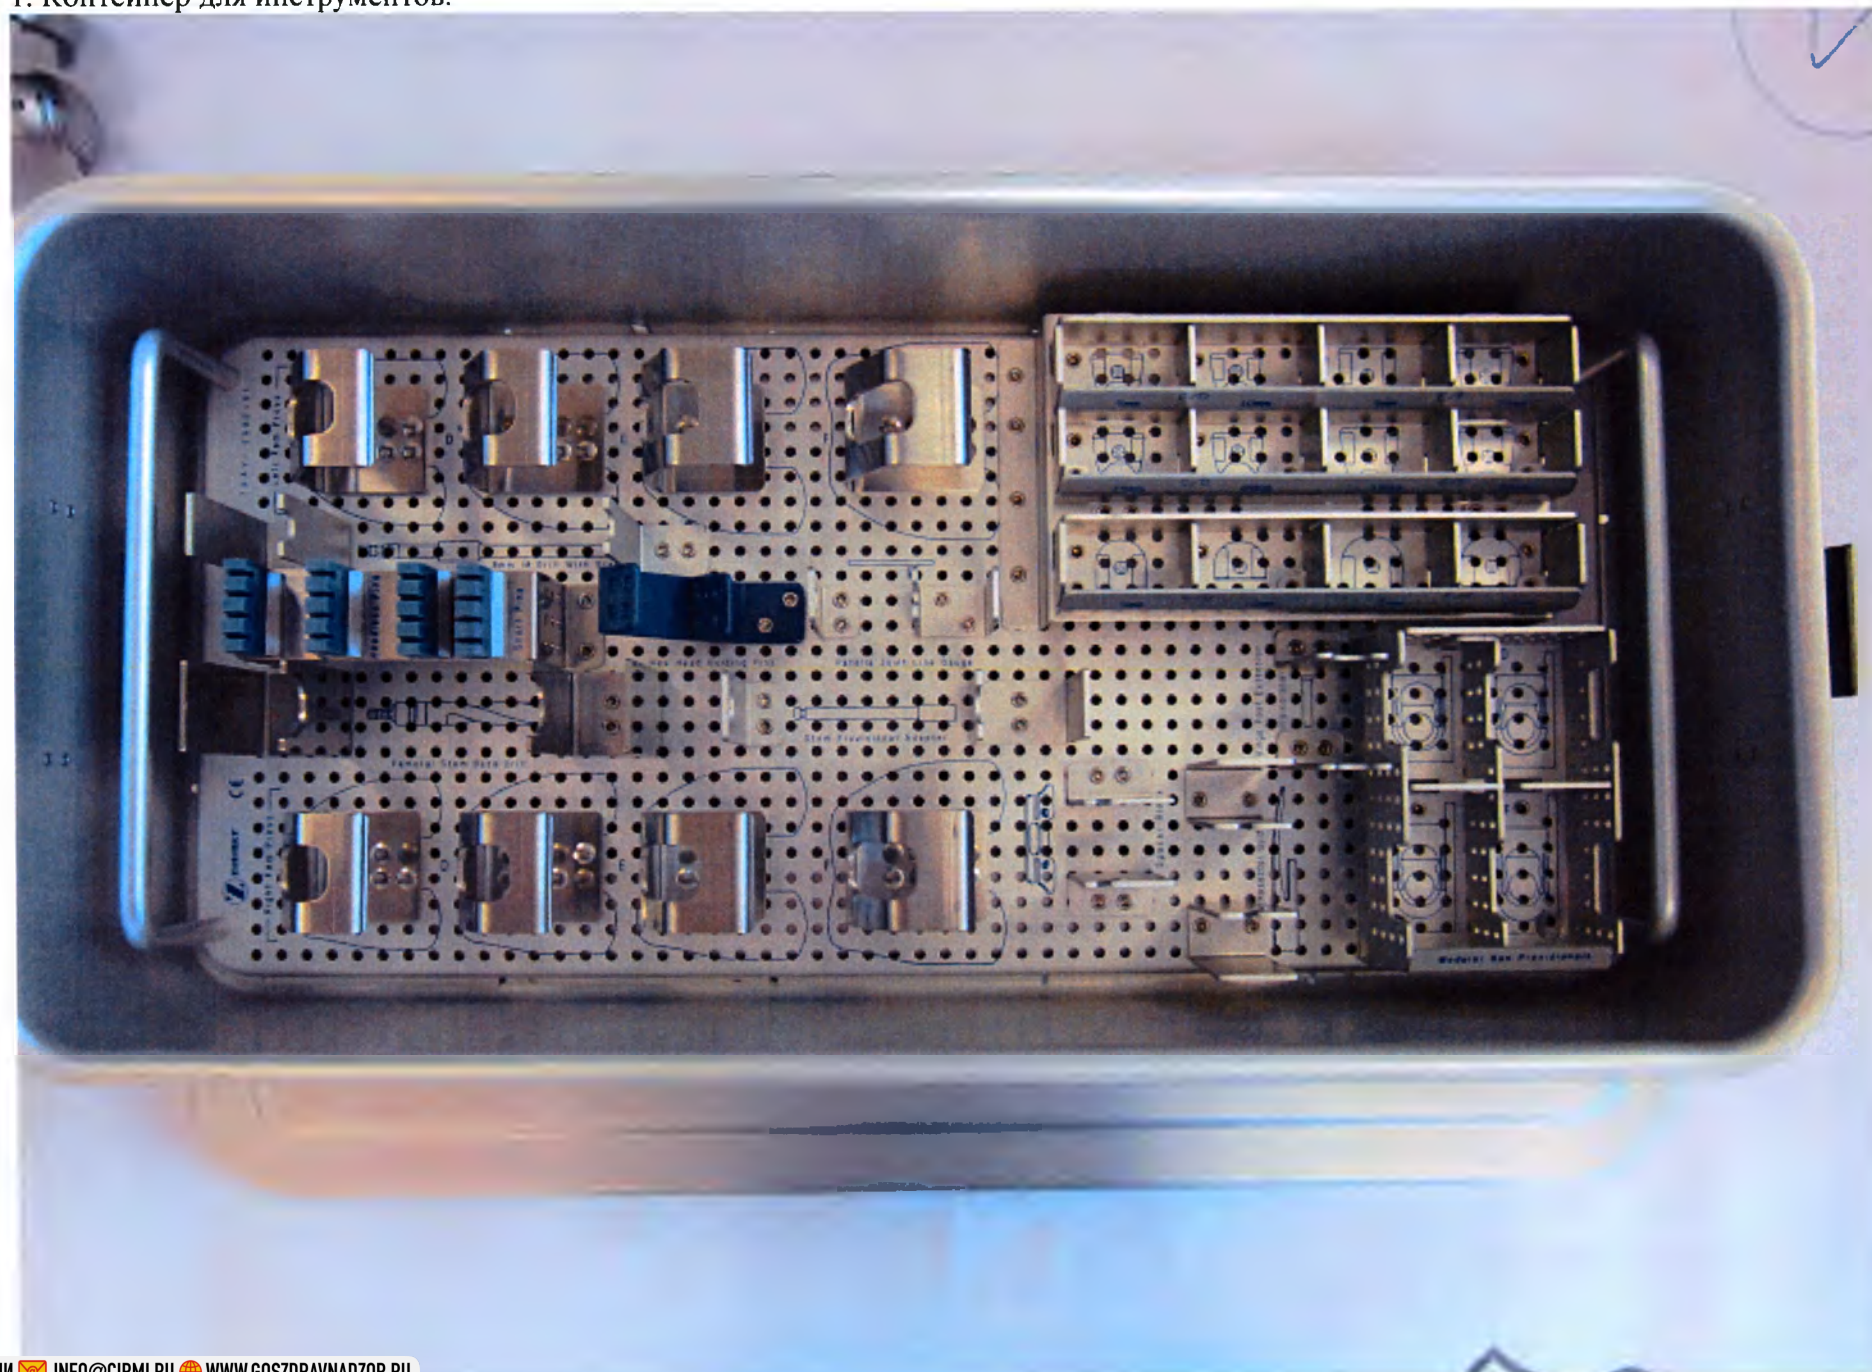

1. Контейнер для инструментов.

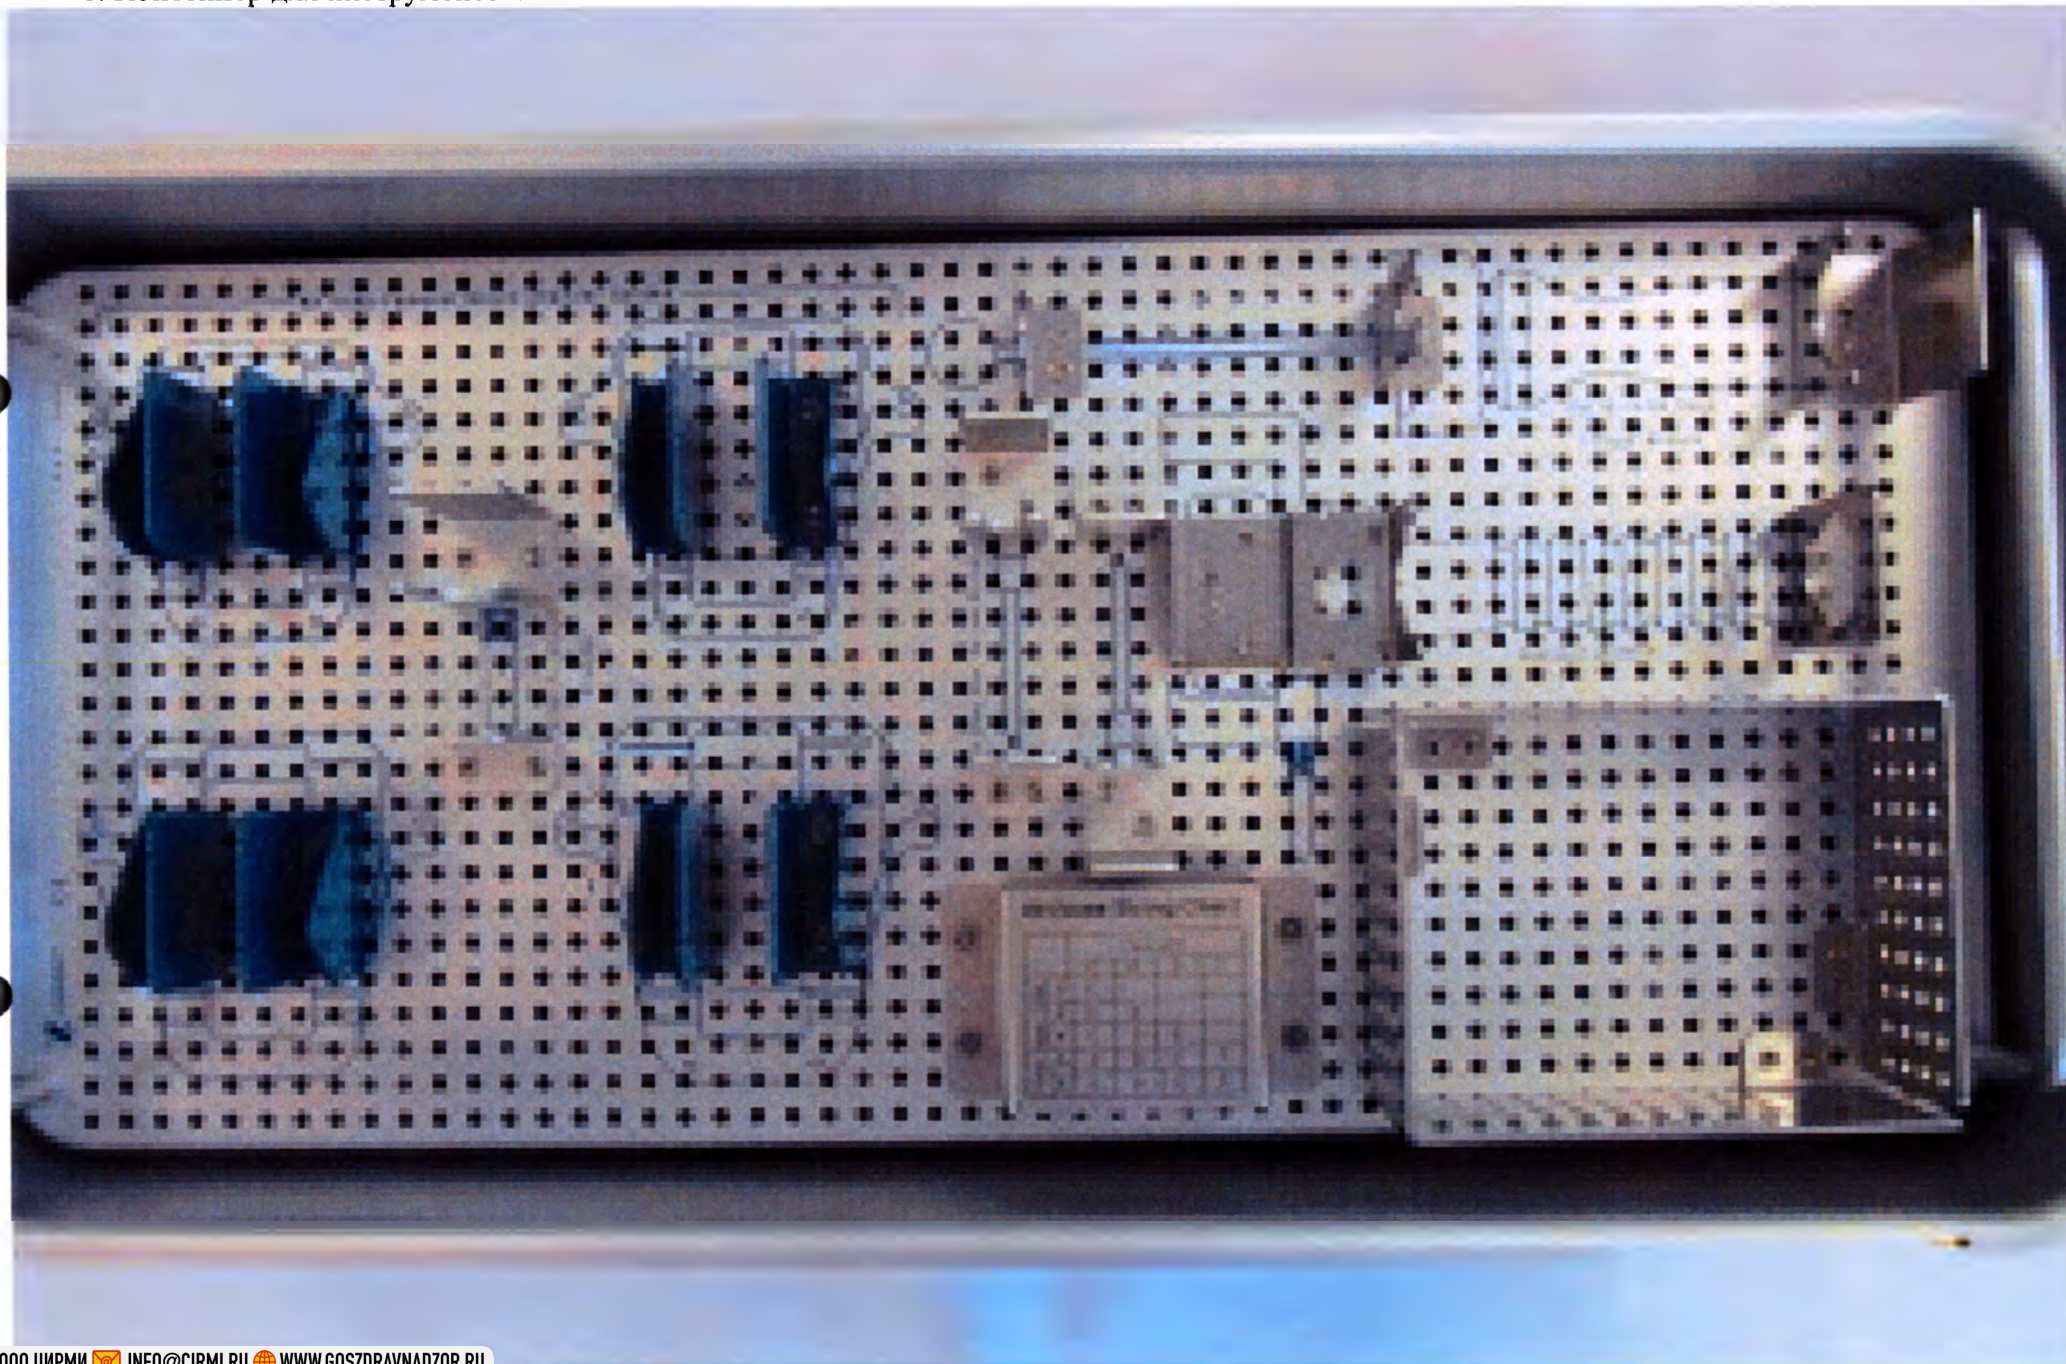

2. Поддон для инструментов.

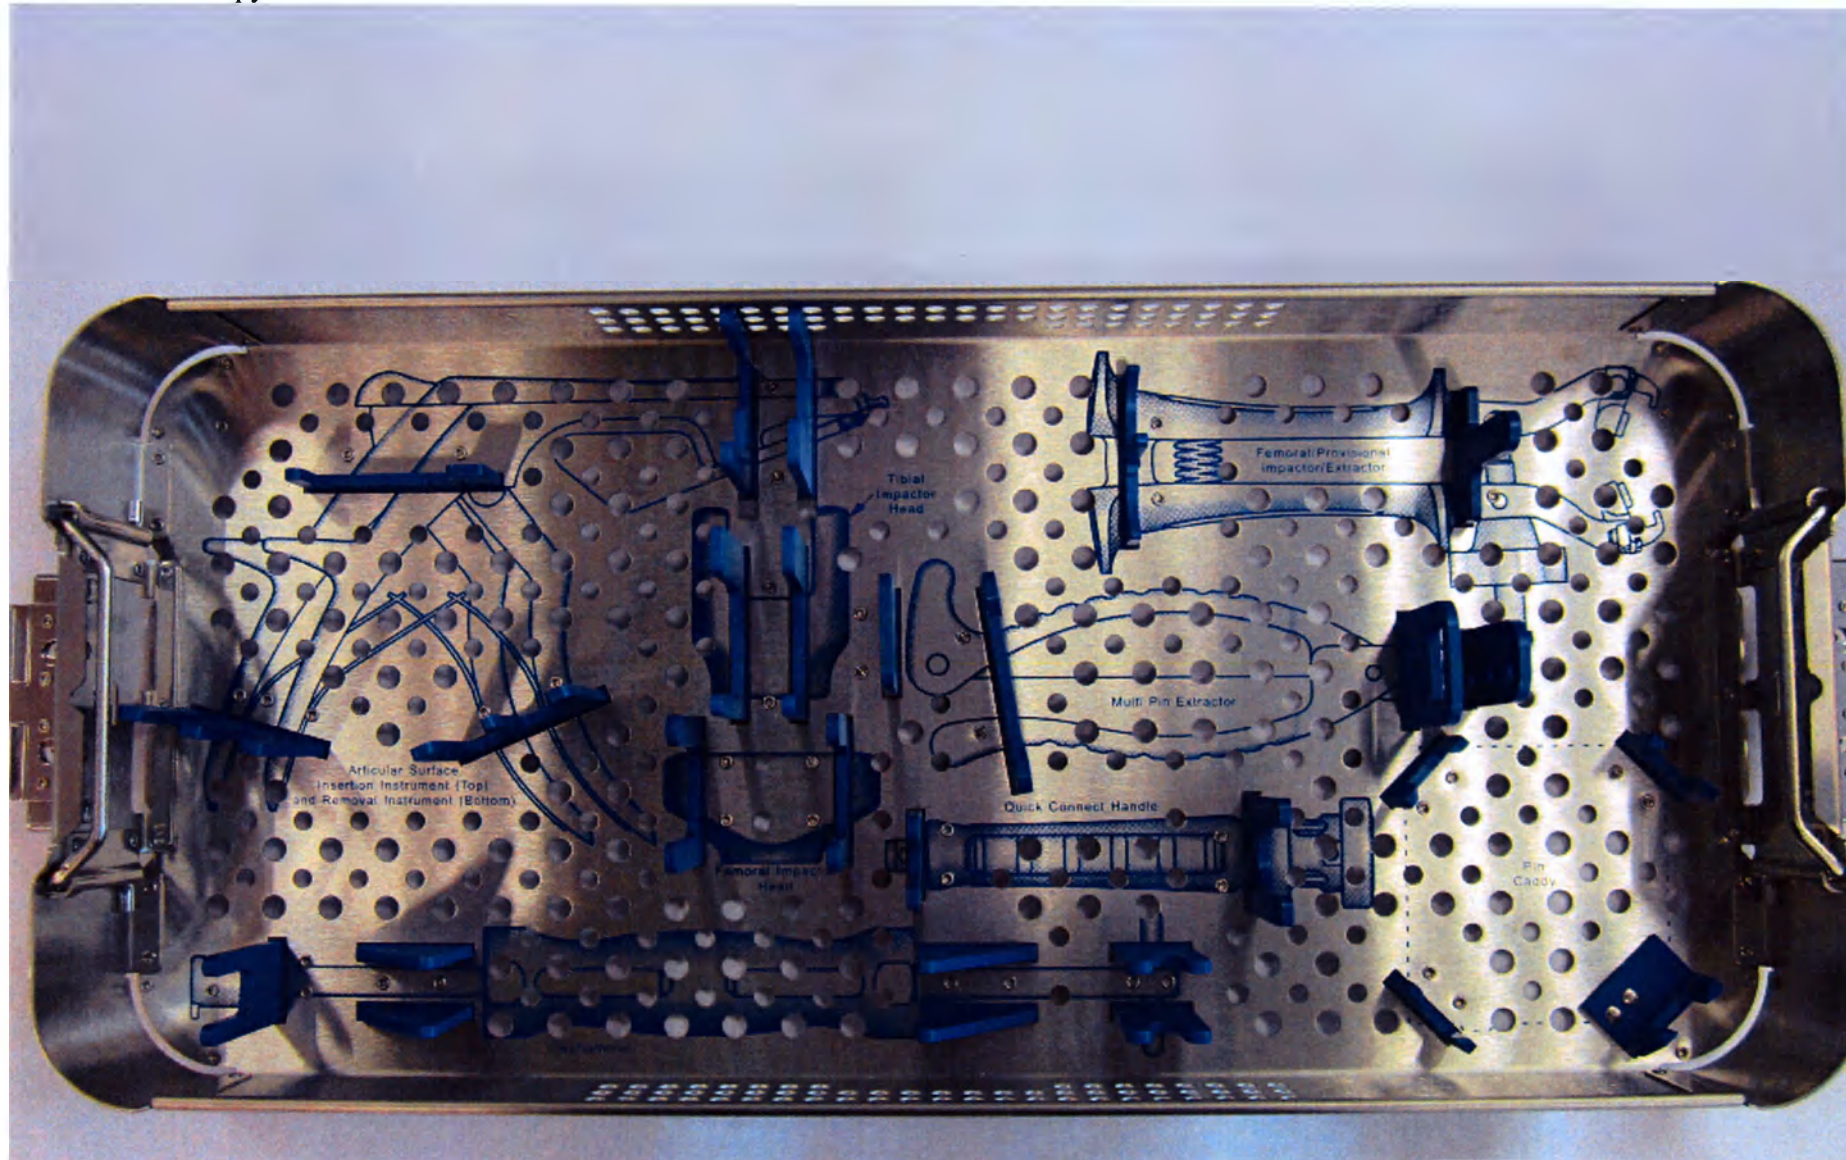

3. Крышка контейнера для инструментов.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

65 (шестьдесят пять) листа (ов)

Менеджер по регистрации и качеству
Семунина А.С. А.С.

10 марта 201 7 г.

