

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие:

Калибратор для обеспечения правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Rubella антитела IgM Калибратор (Alinity i Rubella IgM Calibrator)"

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Фотографические изображения Калибратор для обеспечения правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Rubella антитела IgM Калибратор (Alinity i Rubella IgM Calibrator)"

Alinity i Rubella IgM Calibrator




CONC

CONC

INDEX

S/CO



CONTAINS: AZIDE

CAL 1 1 x 3.0 mL 1.00 0.63



www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF

08P4701



Exp.

2018-09-26


LOT

81425FN00



G70803R02


R01




(01) 00380740131197 (17) 180926

(10) 81425FN00 (240) 08P4701 (91) RubellaIgM

Фотографические изображения Калибратор для обеспечения правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Rubella антитела IgM Калибратор (Alinity i Rubella IgM Calibrator)"

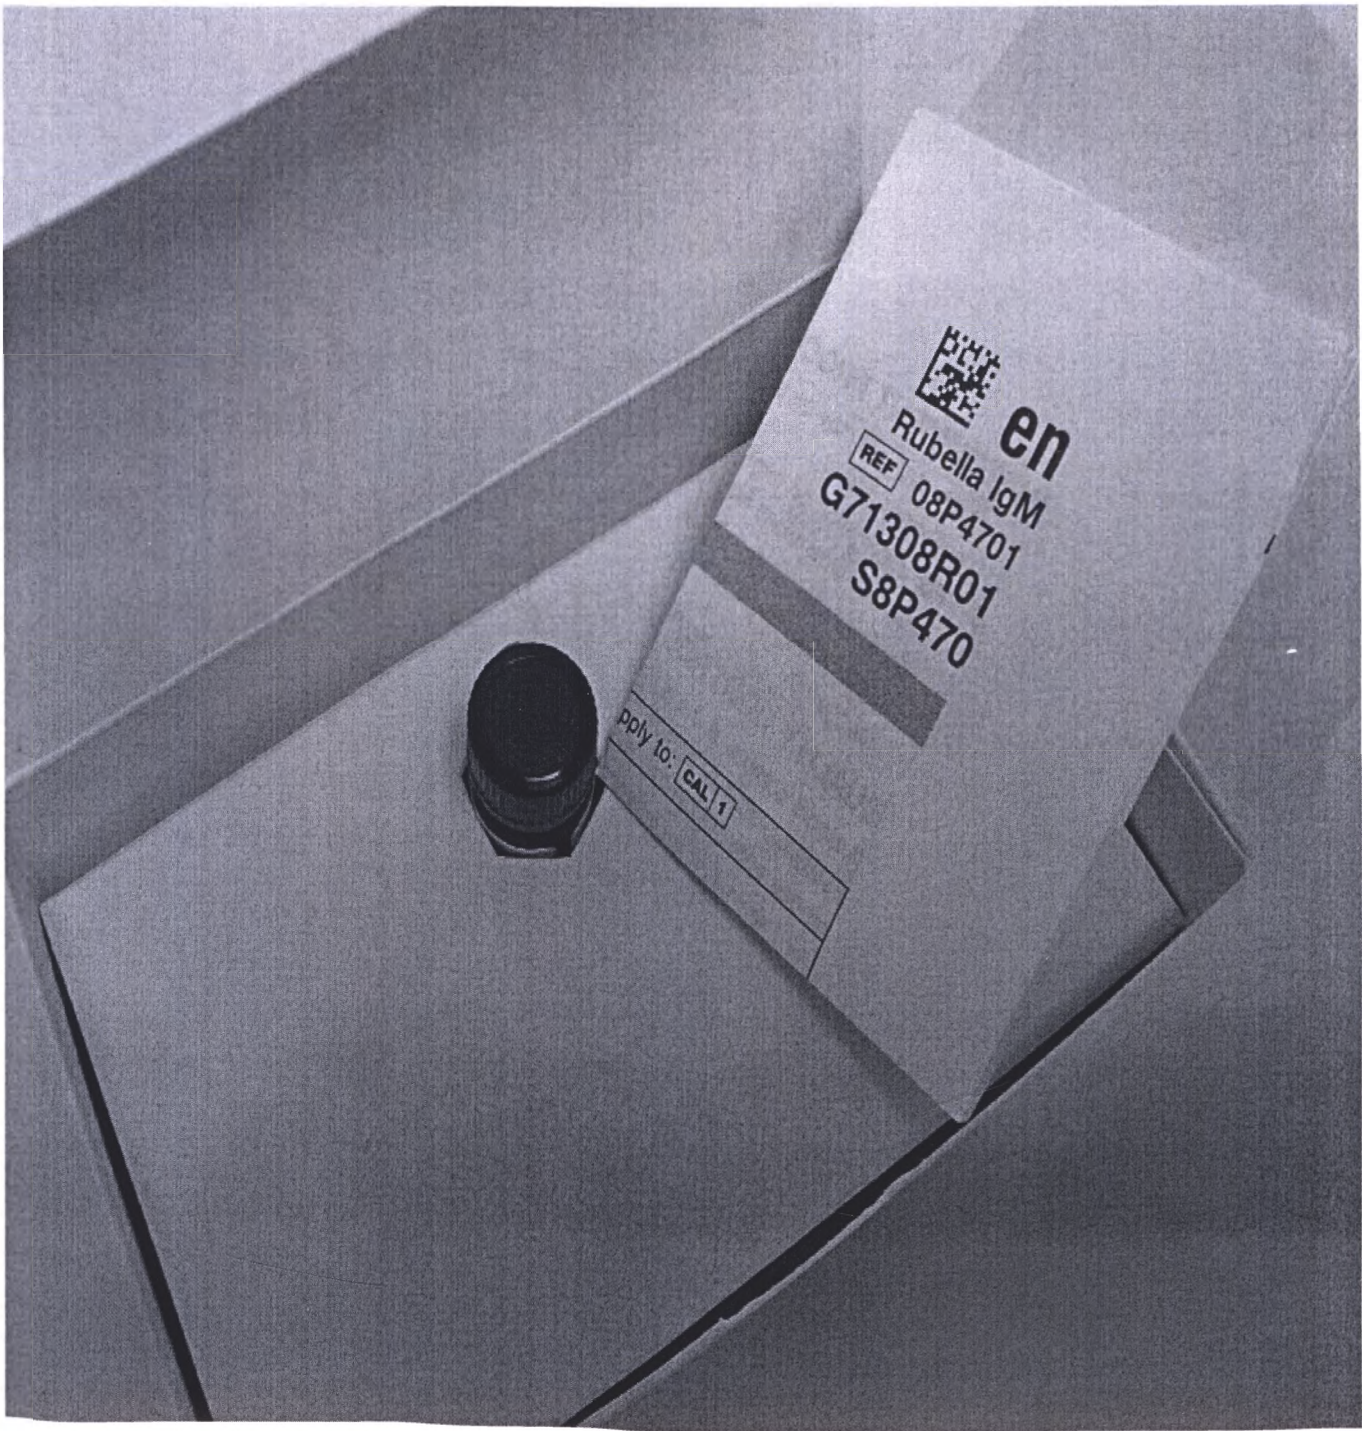

Фотографические изображения Калибратор для обеспечения правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Rubella антитела IgM Калибратор (Alinity i Rubella IgM Calibrator)"

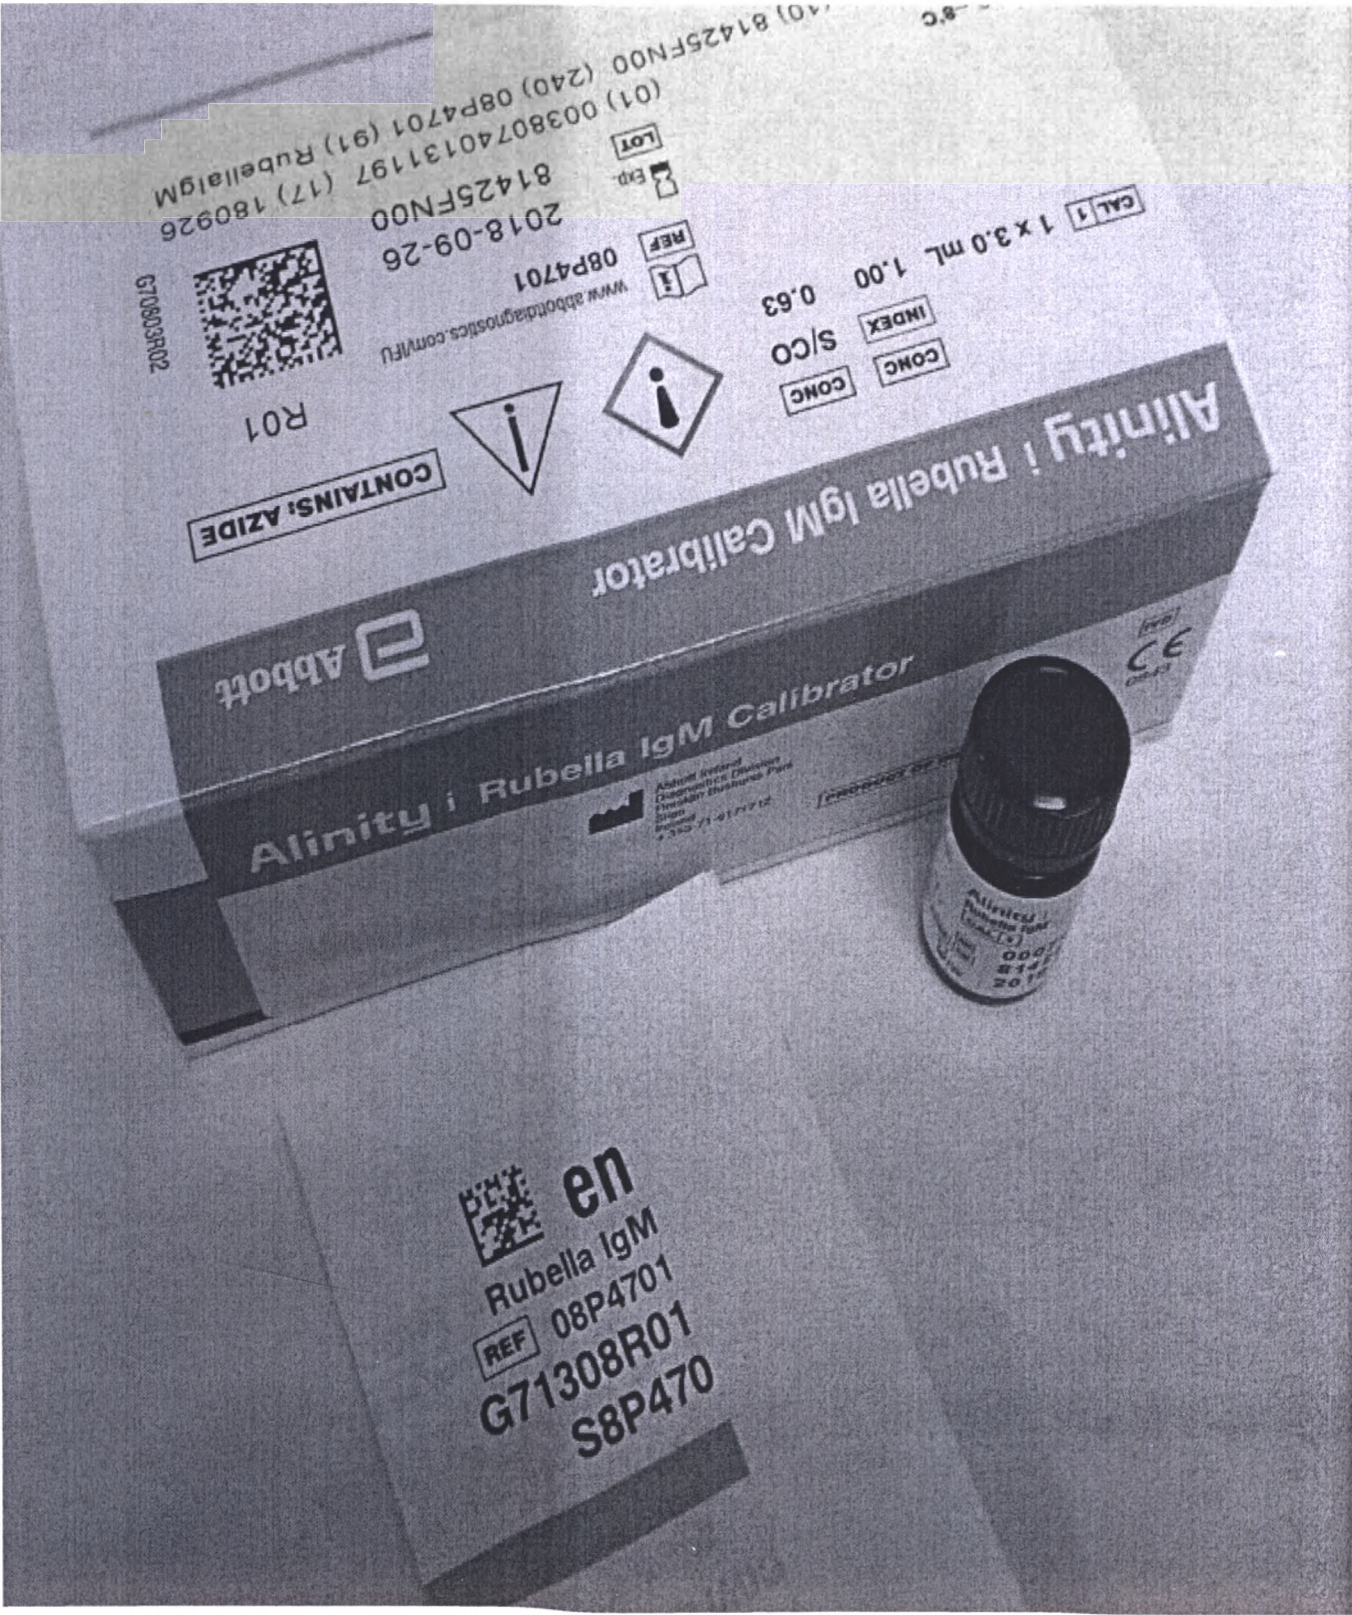

Фотографические изображения Калибратор для обеспечения правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Rubella антитела IgM Калибратор (Alinity i Rubella IgM Calibrator)"



Пронумеровано, прошито
скреплено печатью на _____

_____ лист

