

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения и качественного обнаружения антител класса IgG к вирусу краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Rubella антитела IgG Калибраторы (Alinity i Rubella IgG Calibrators)"

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i Rubella IgG Calibrators

 Abbott

CONTAINS AZIDE



CONC
IU/mL

CAL A	1 x 3.0 mL	0
CAL B	1 x 3.0 mL	5
CAL C	1 x 3.0 mL	15
CAL D	1 x 3.0 mL	75
CAL E	1 x 3.0 mL	250
CAL F	1 x 3.0 mL	500



REF

www.abbottdiagnostics.com/IFU

08P4601



Exp.

2017-11-10


LOT

71027FN00

R01




G70785R02



(01) 00380740131272 (17) 171110
(10) 71027FN00 (240) 08P4601 (91) RubellaIgG



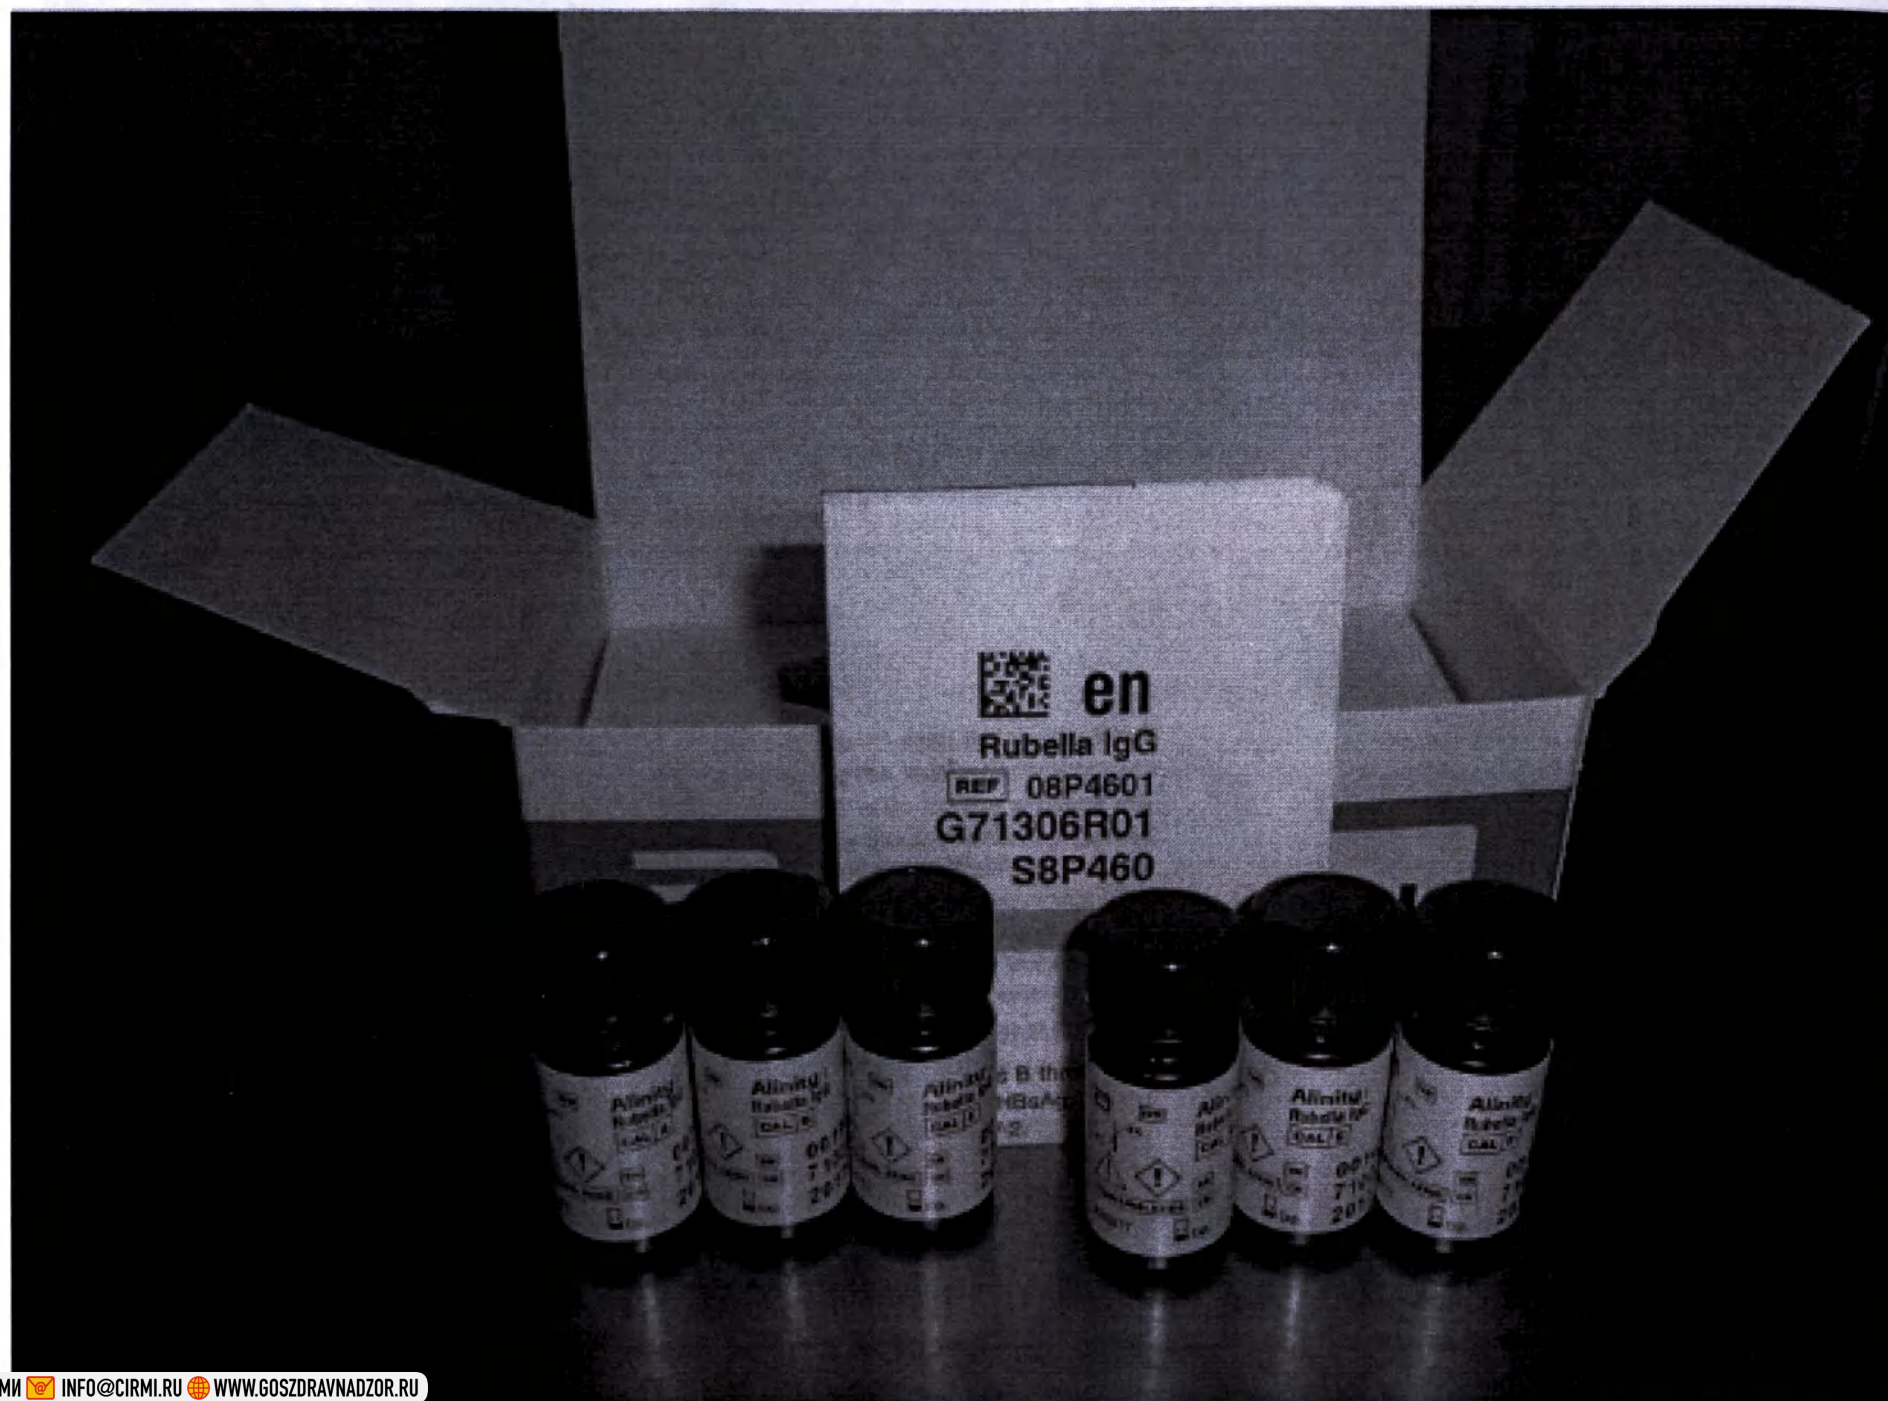

Е Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
— 4 — листов

Подпись 
