



«УТВЕРЖДАЮ»

Старший специалист по регистрации

ООО «Страйкер»

По доверенности от 04.07.2019




Моисеева А. В.

« » 2019 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
медицинского изделия
«Имплантаты для остеосинтеза позвоночника Serrato»

Имплантаты для остеосинтеза позвоночника Serrato, варианты исполнения:


1. Винт полиаксиальный, диаметр 4.0 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45 мм.

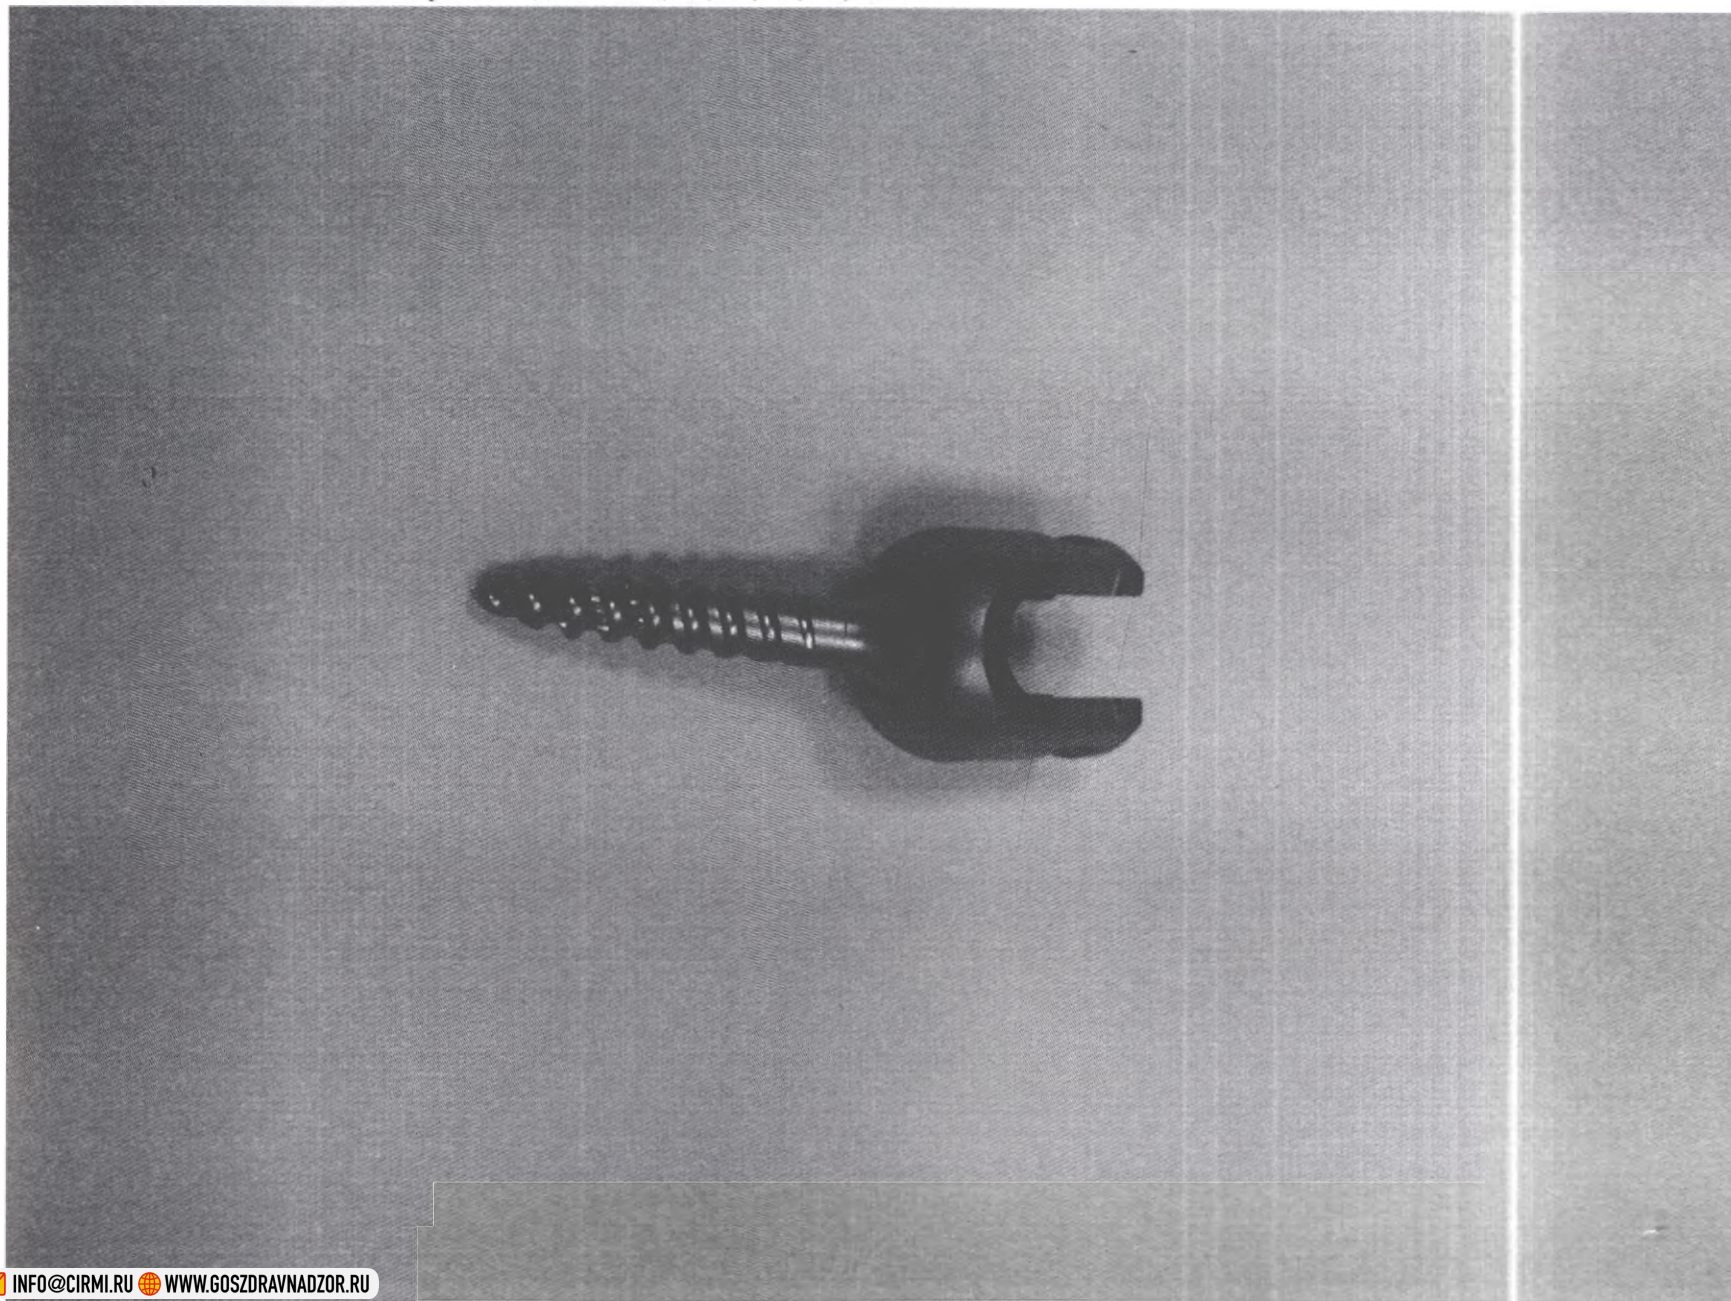


2. Винт полиаксиальный, диаметр 4.5 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45 мм.

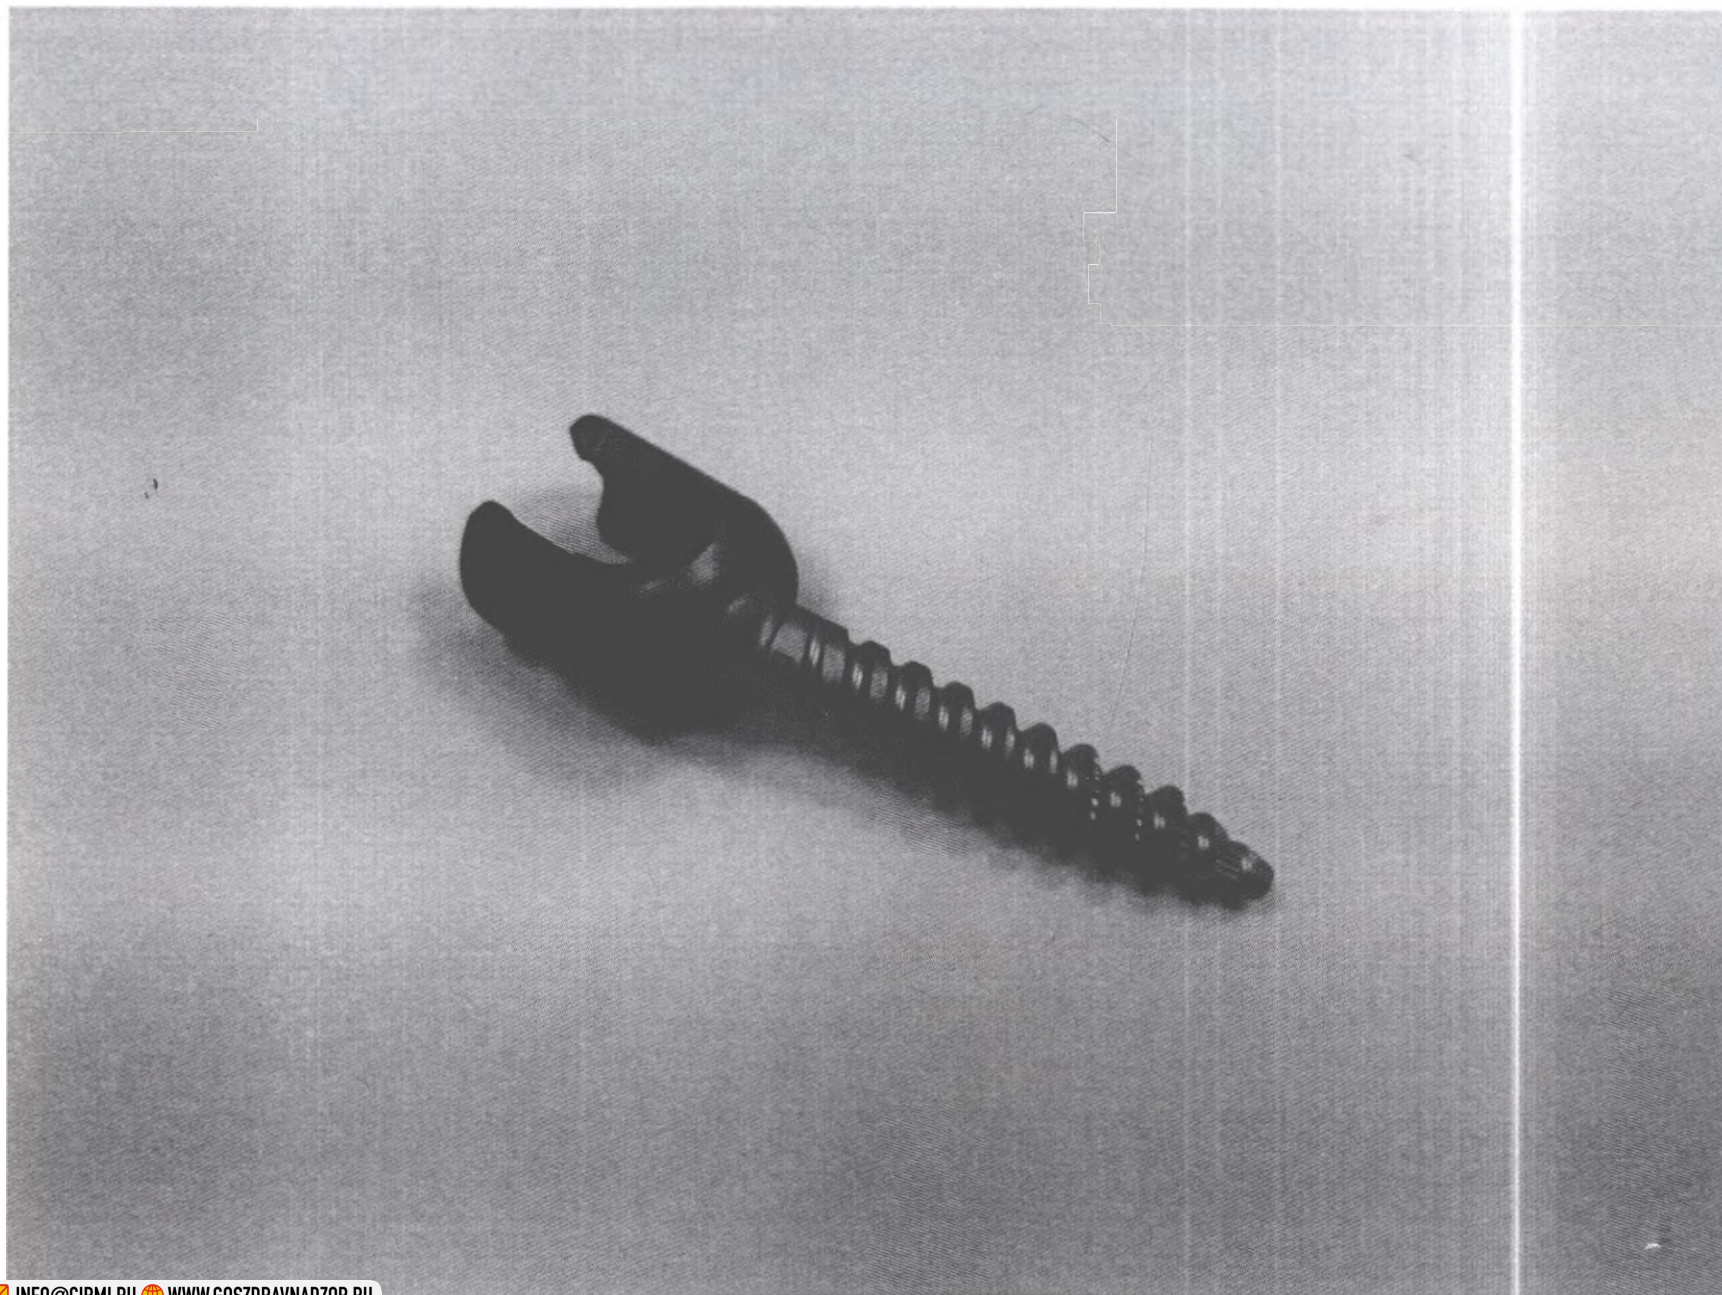


3. Винт полиаксиальный, диаметр 5.0 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм.

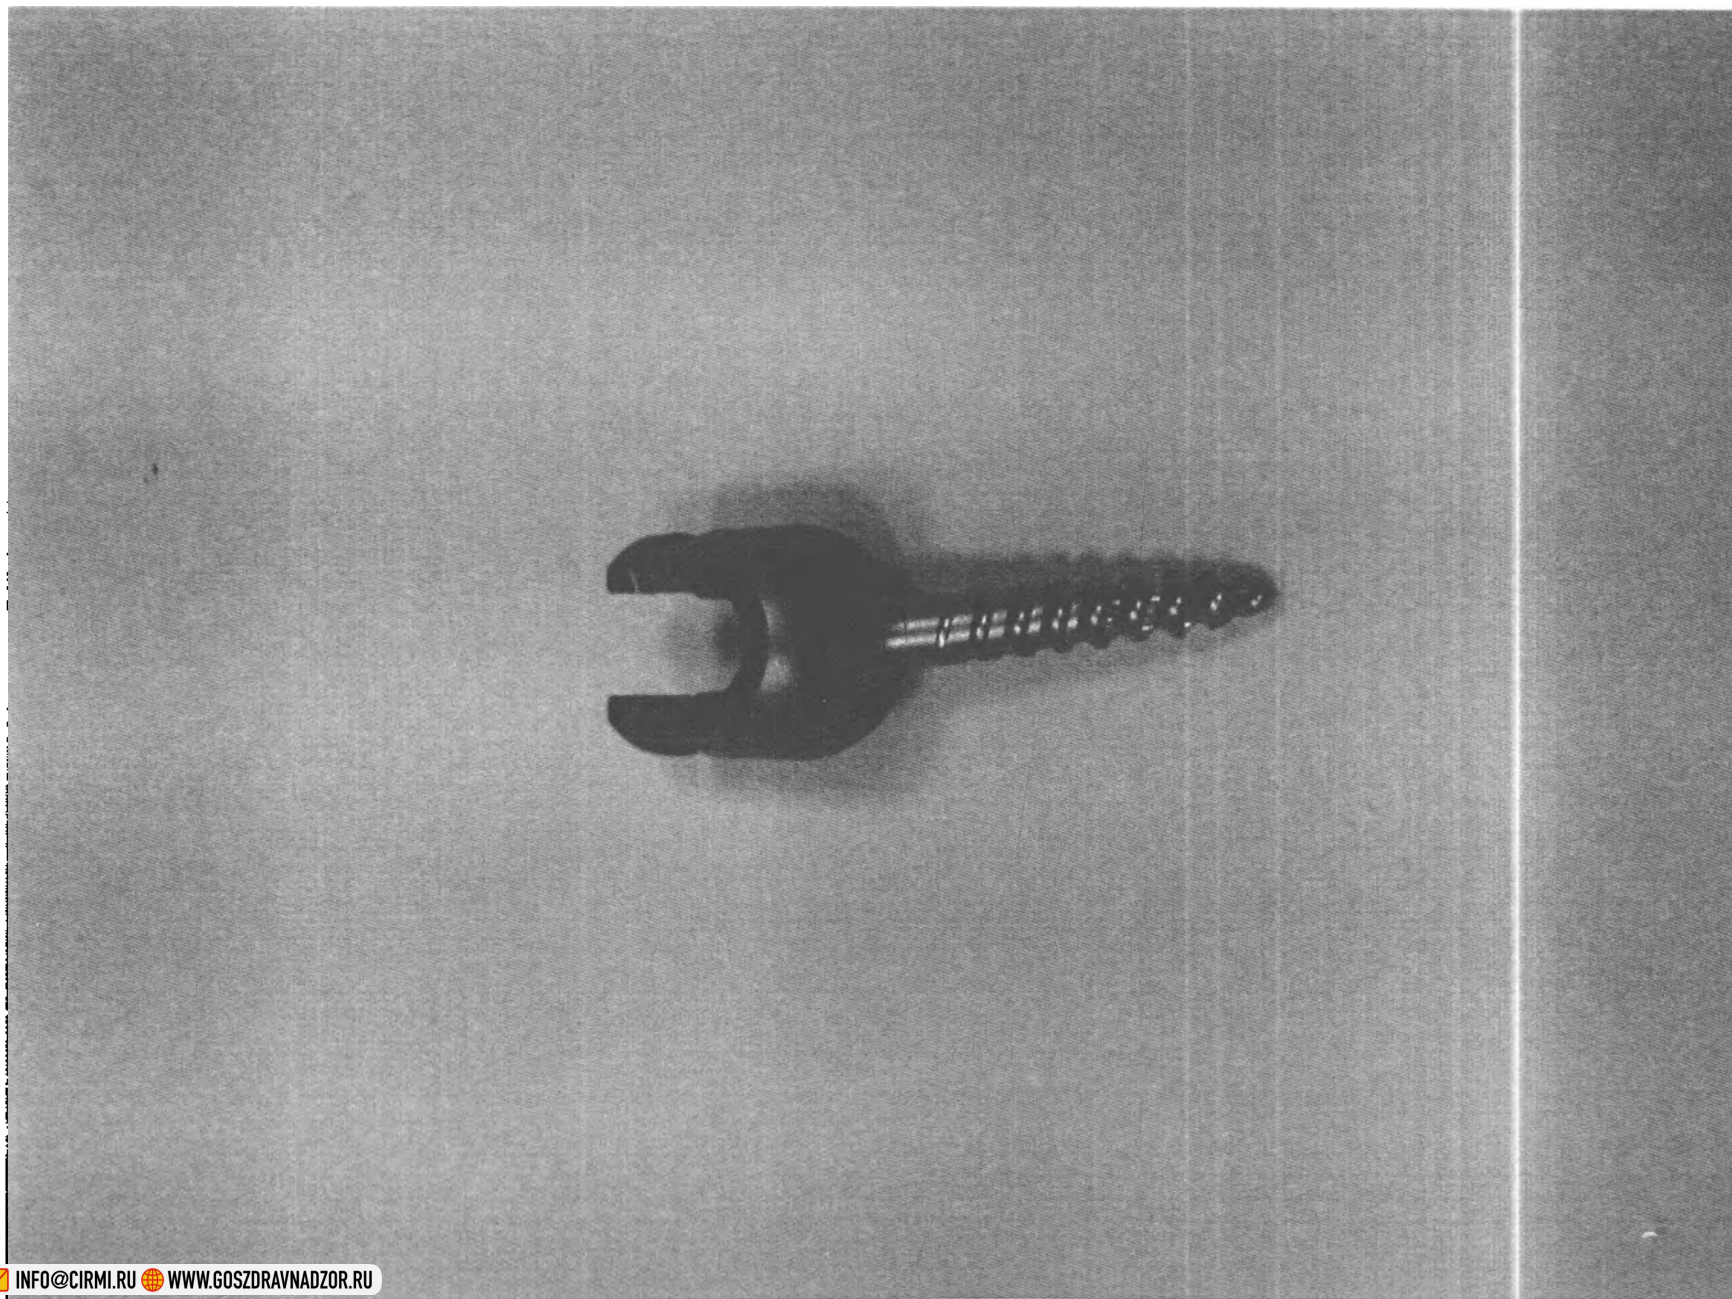

4. Винт полиаксиальный, диаметр 5.5 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.

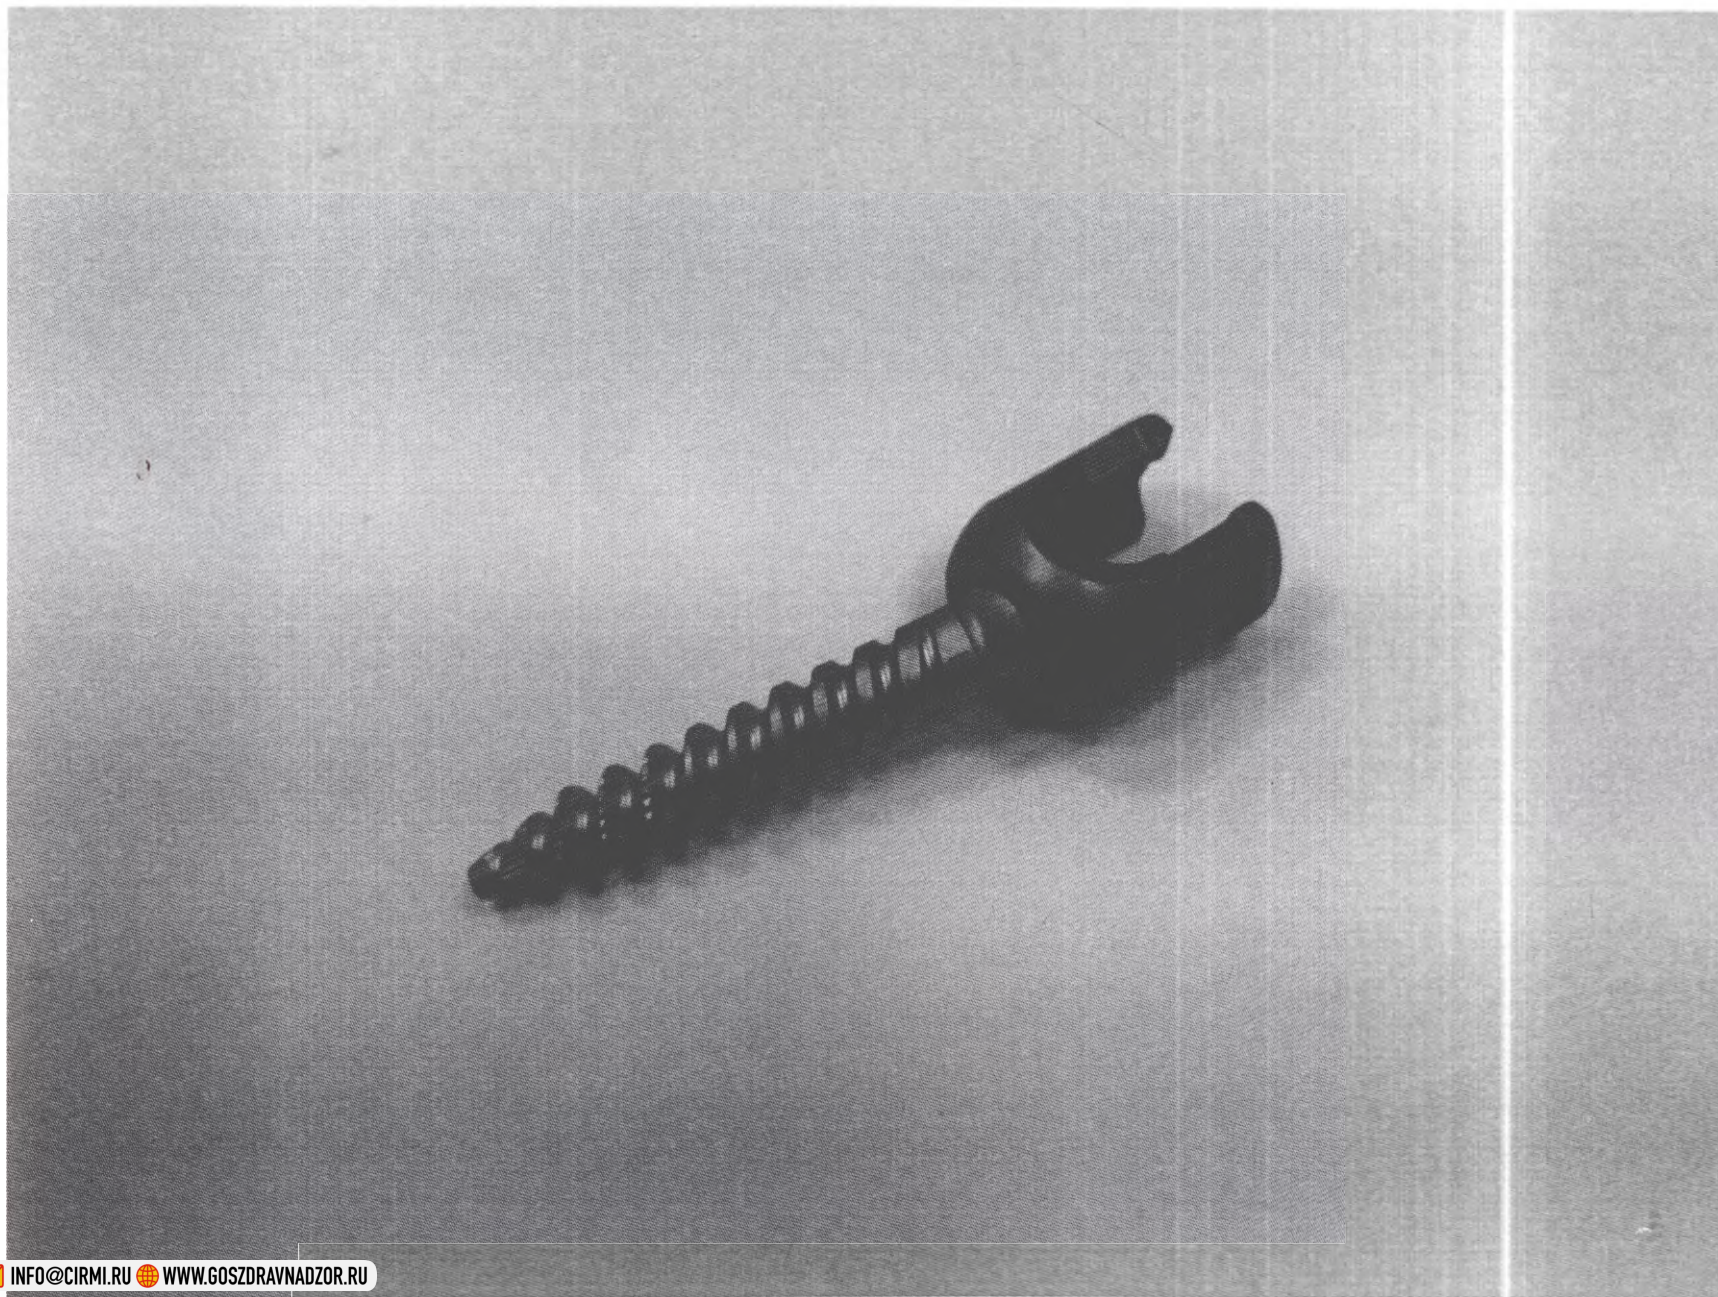


5. Винт полиаксиальный, диаметр 6.0 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм.

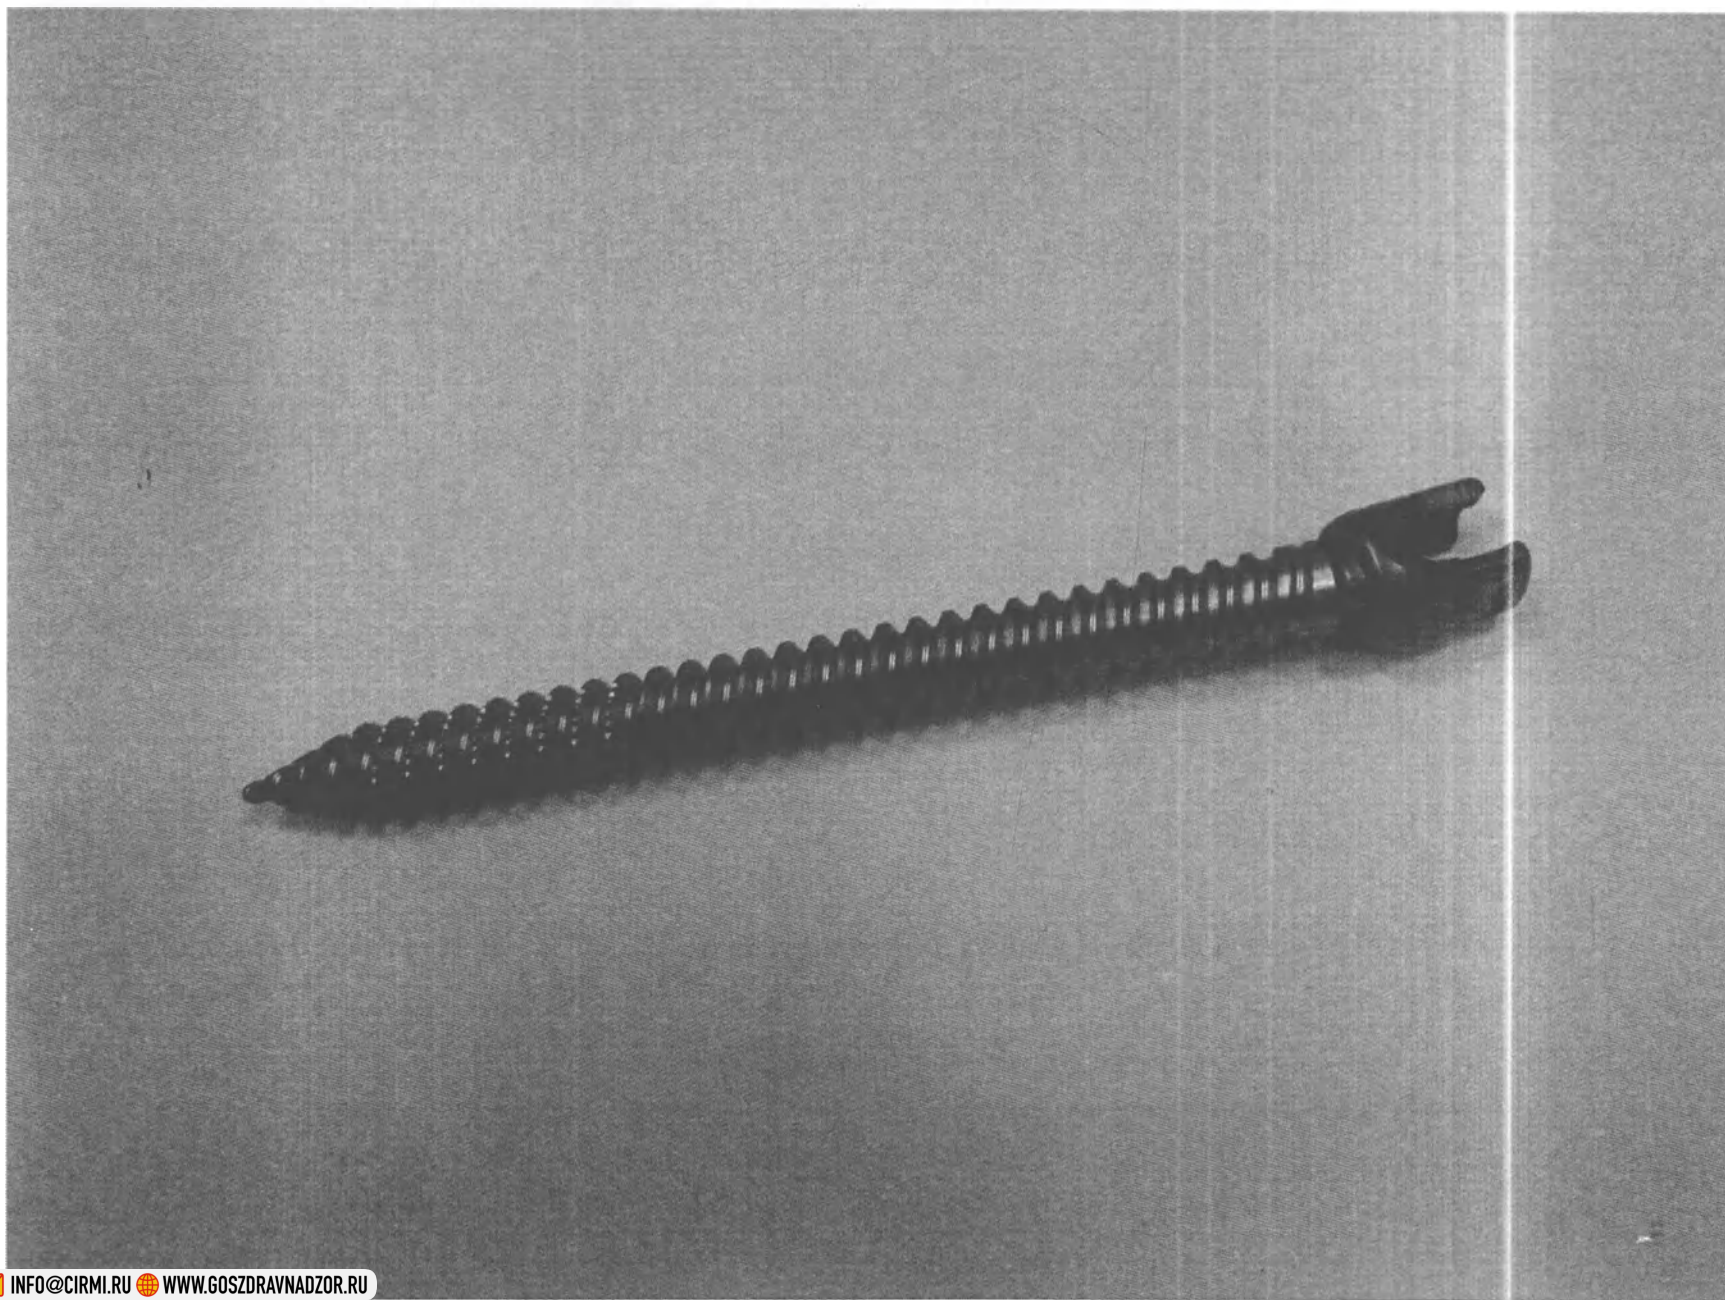


6. Винт полиаксиальный, диаметр 6.5 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм.




7. Винт полиаксиальный, диаметр 7.0 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм.

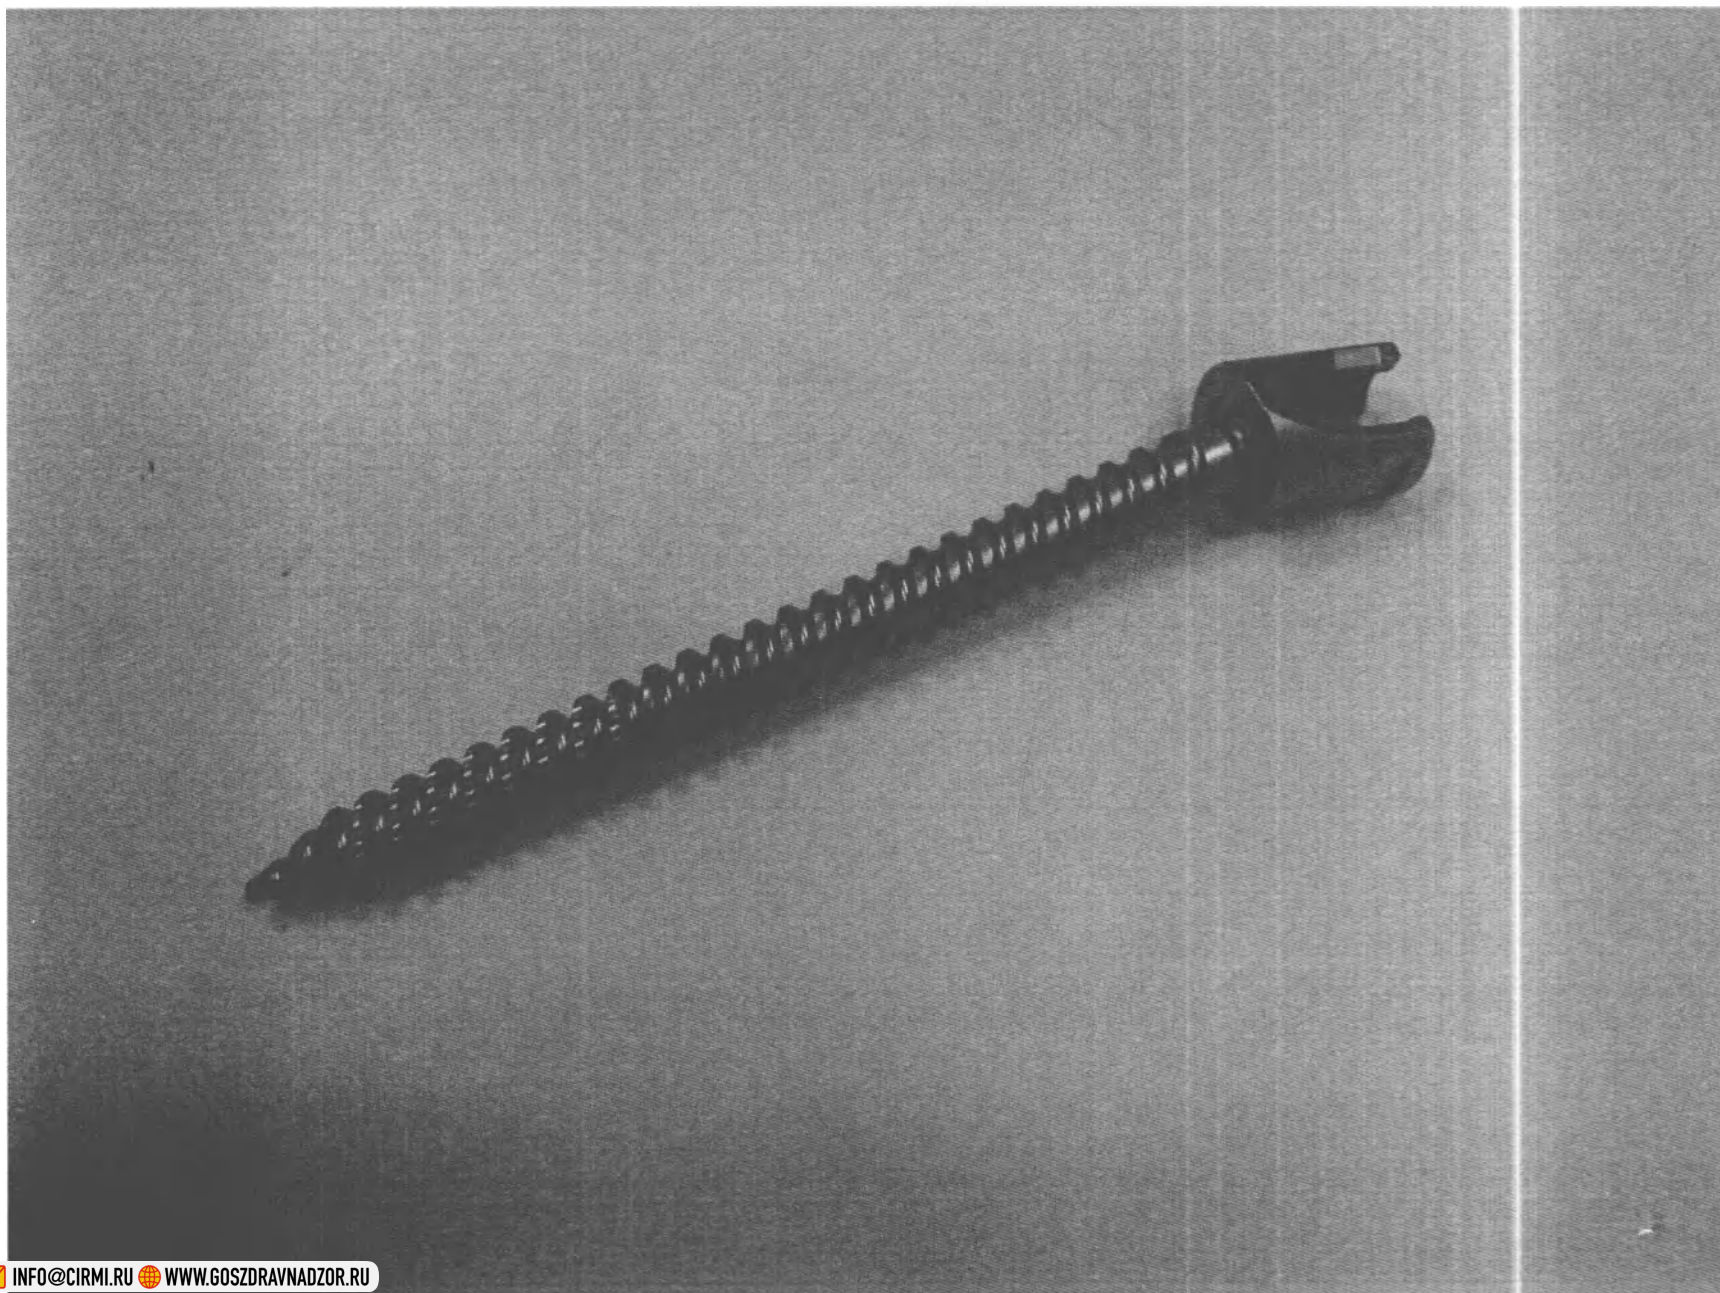


8. Винт полиаксиальный, диаметр 7.5 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм.

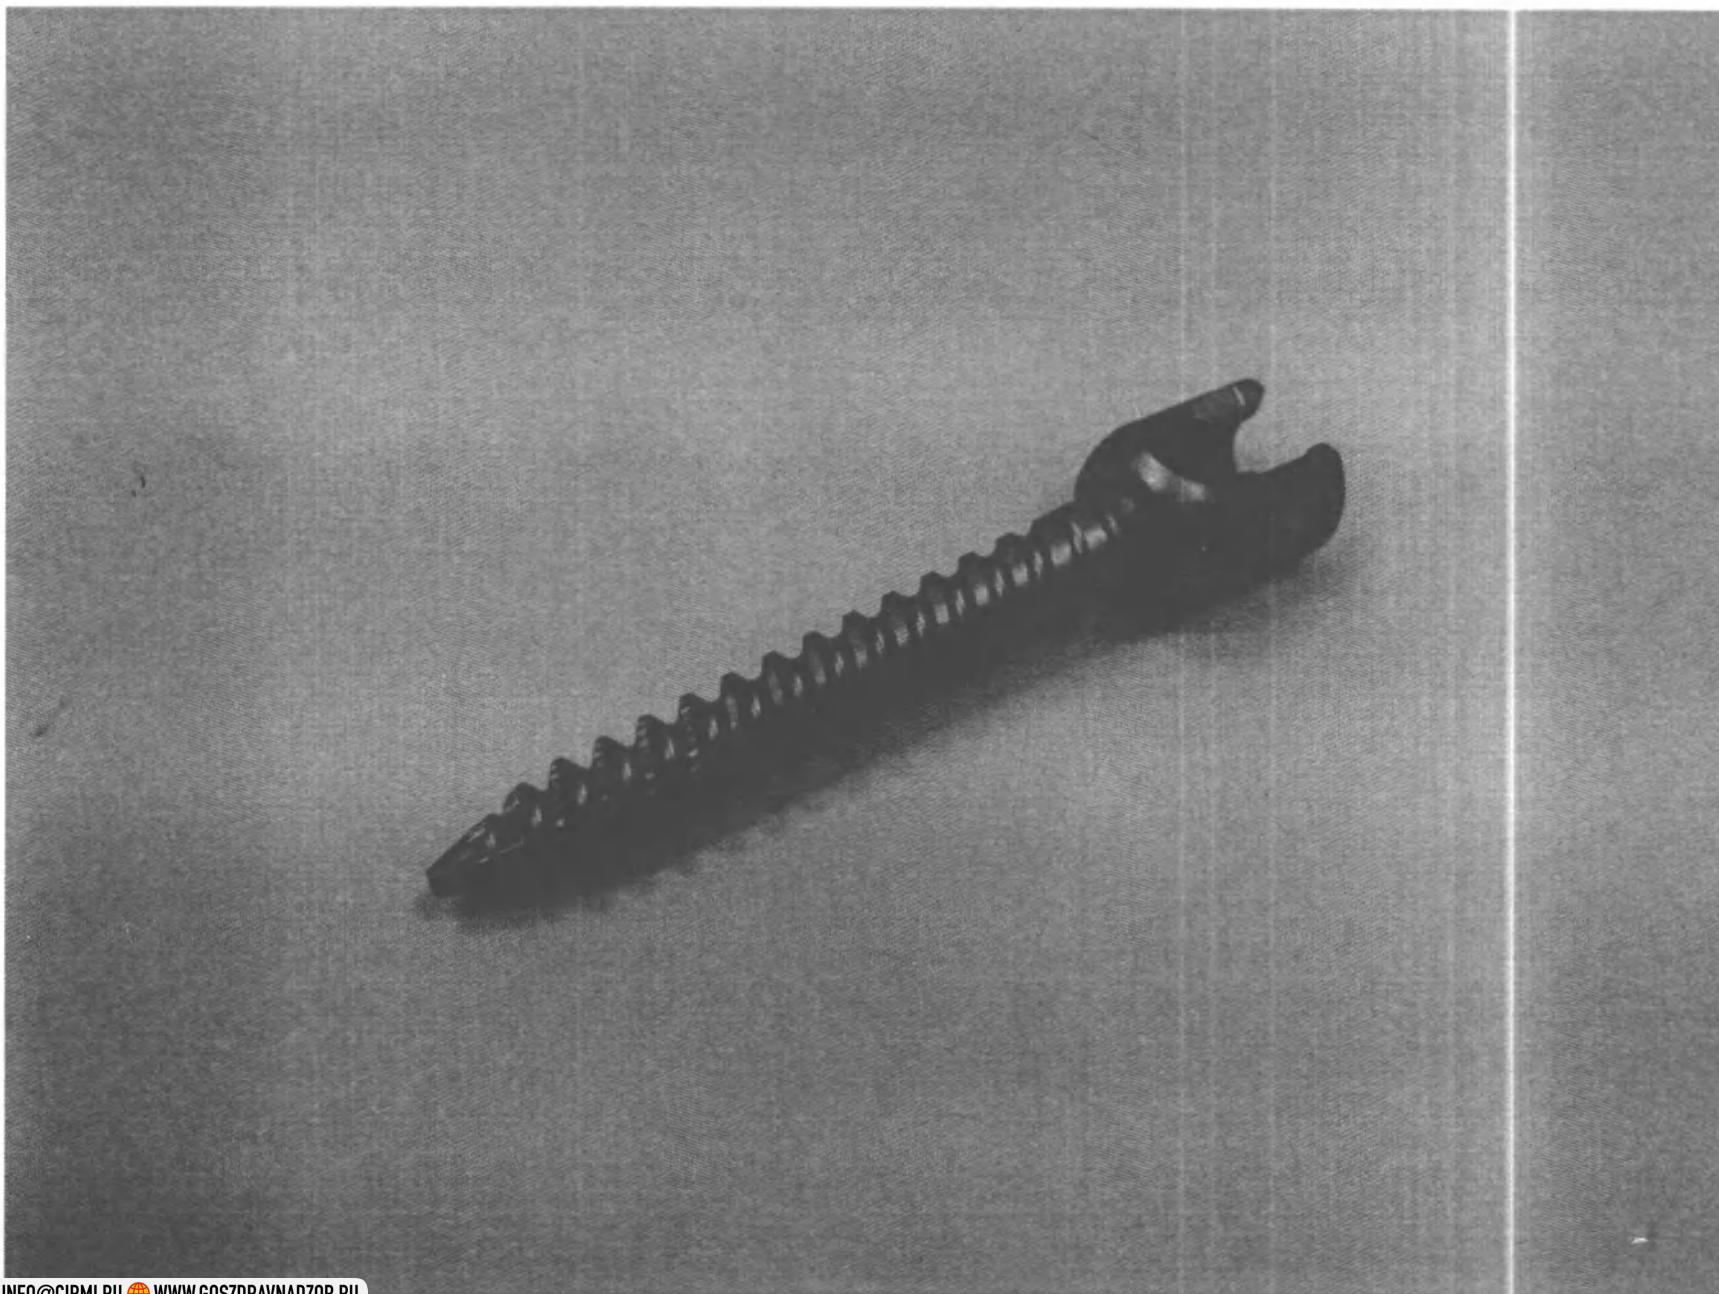


9. Винт полиаксиальный, диаметр 8.5 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм.

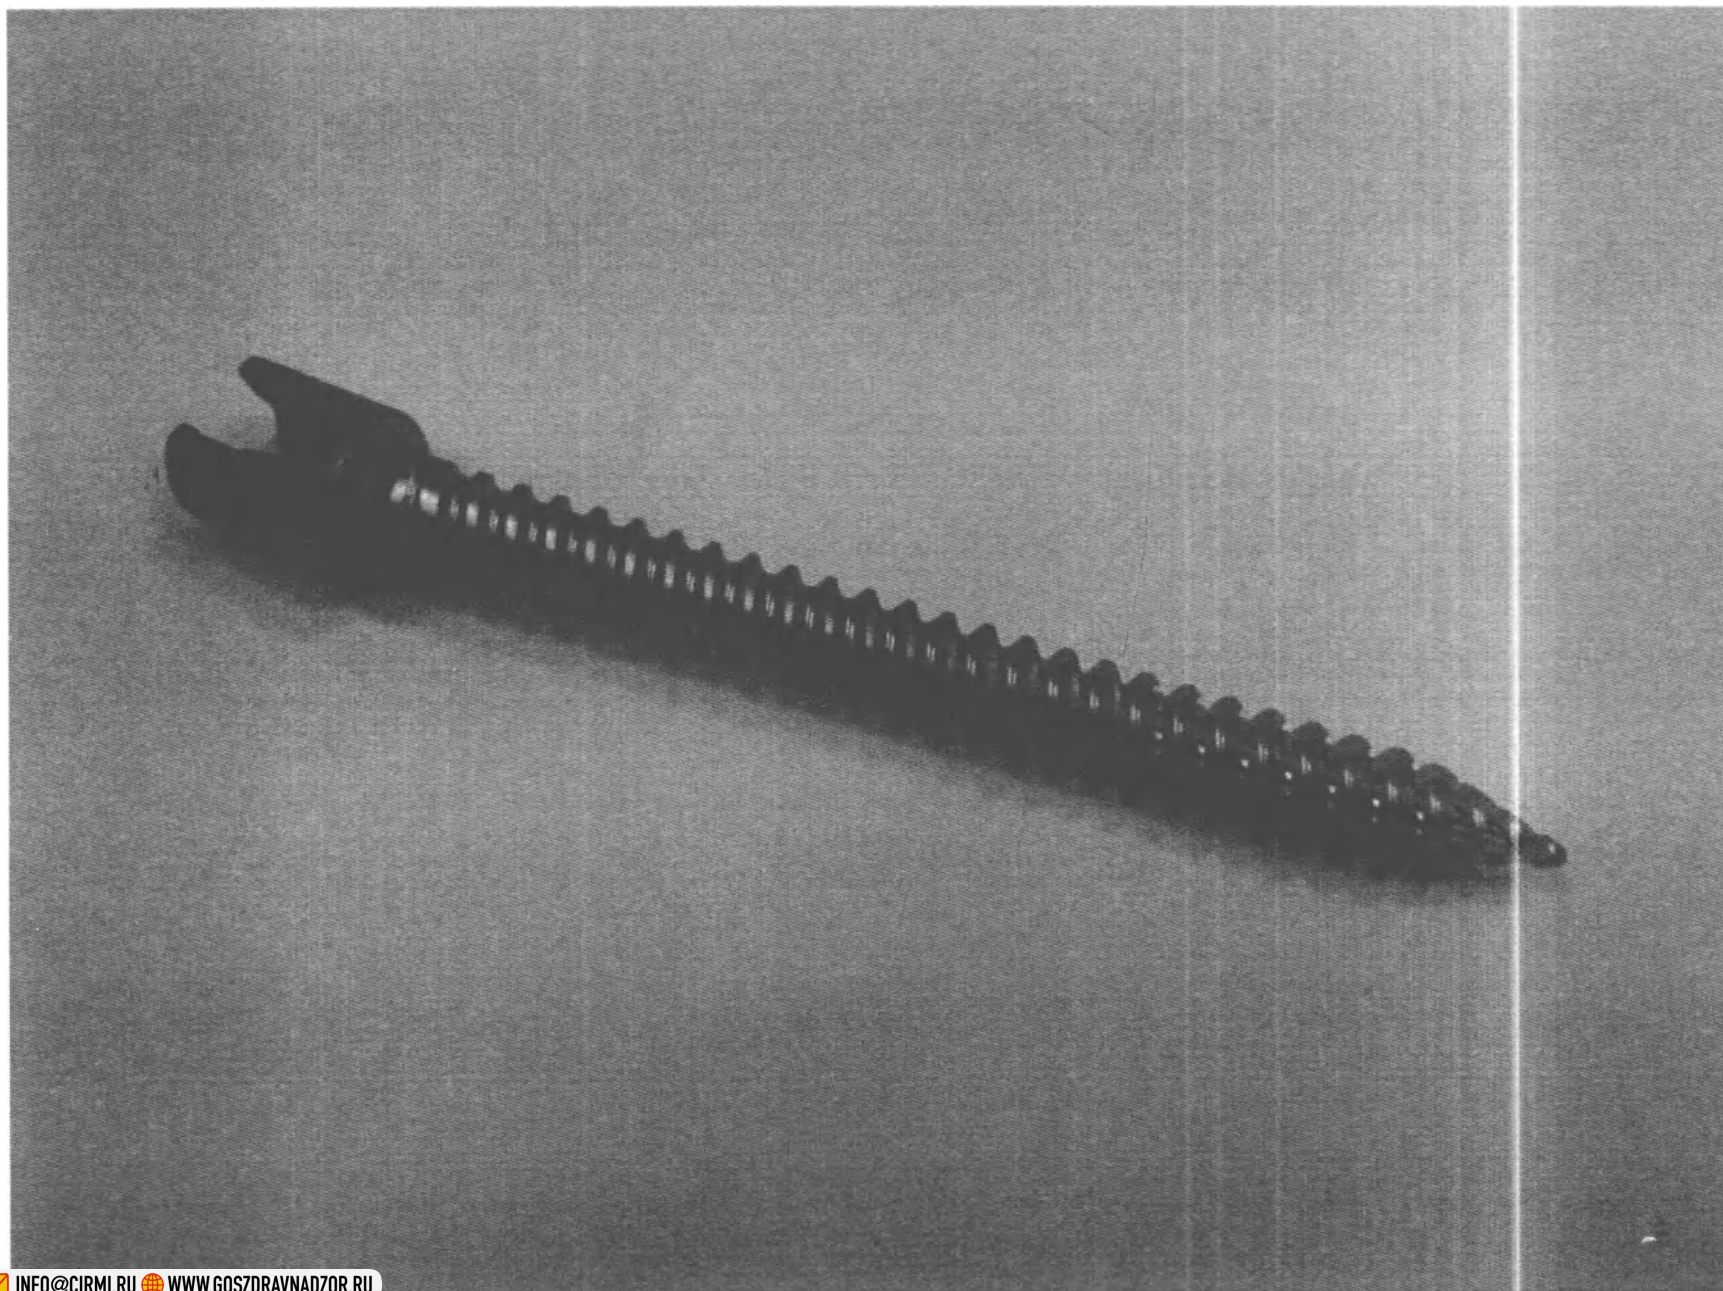


10. Винт полиаксиальный, диаметр 9.5 мм, длина 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм.

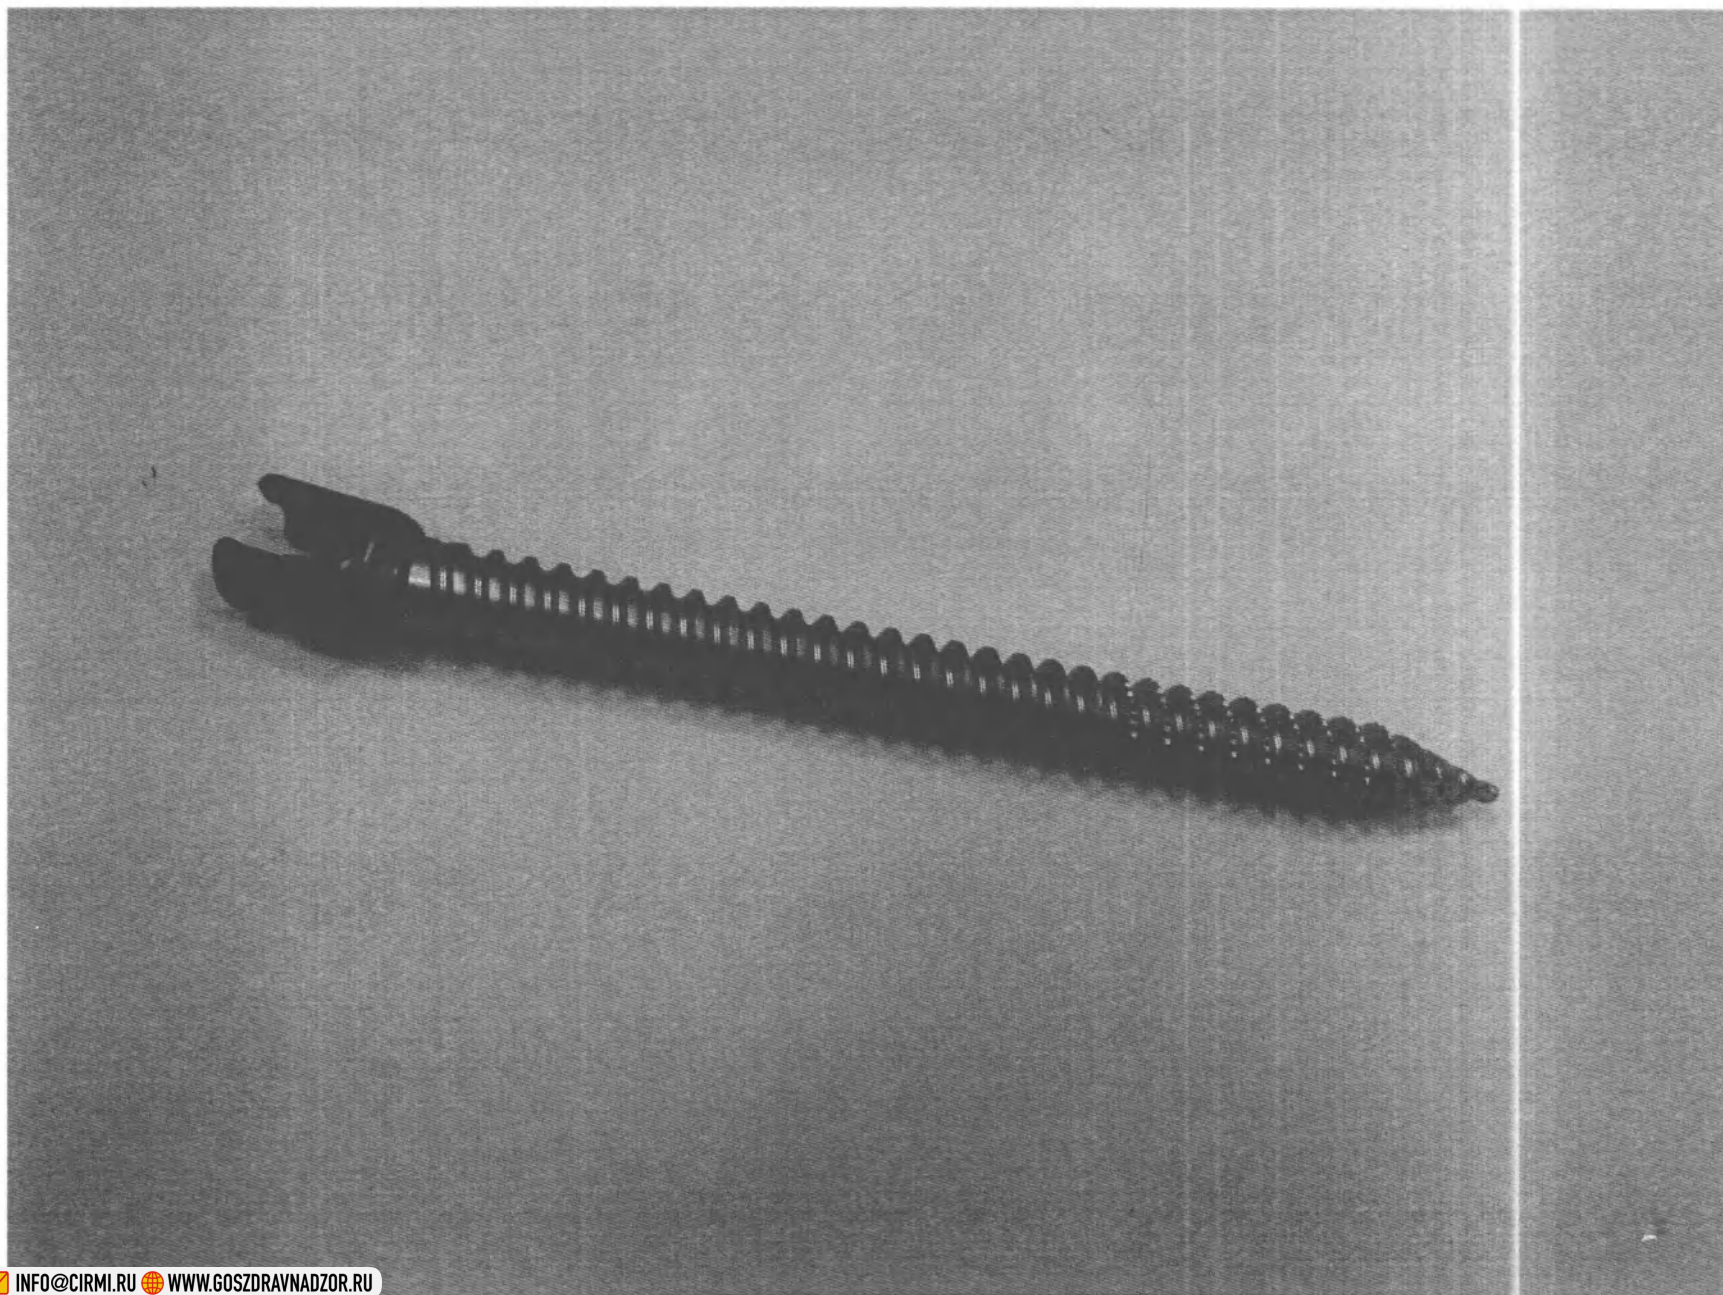


11. Винт полиаксиальный, диаметр 10.5 мм, длина 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм.

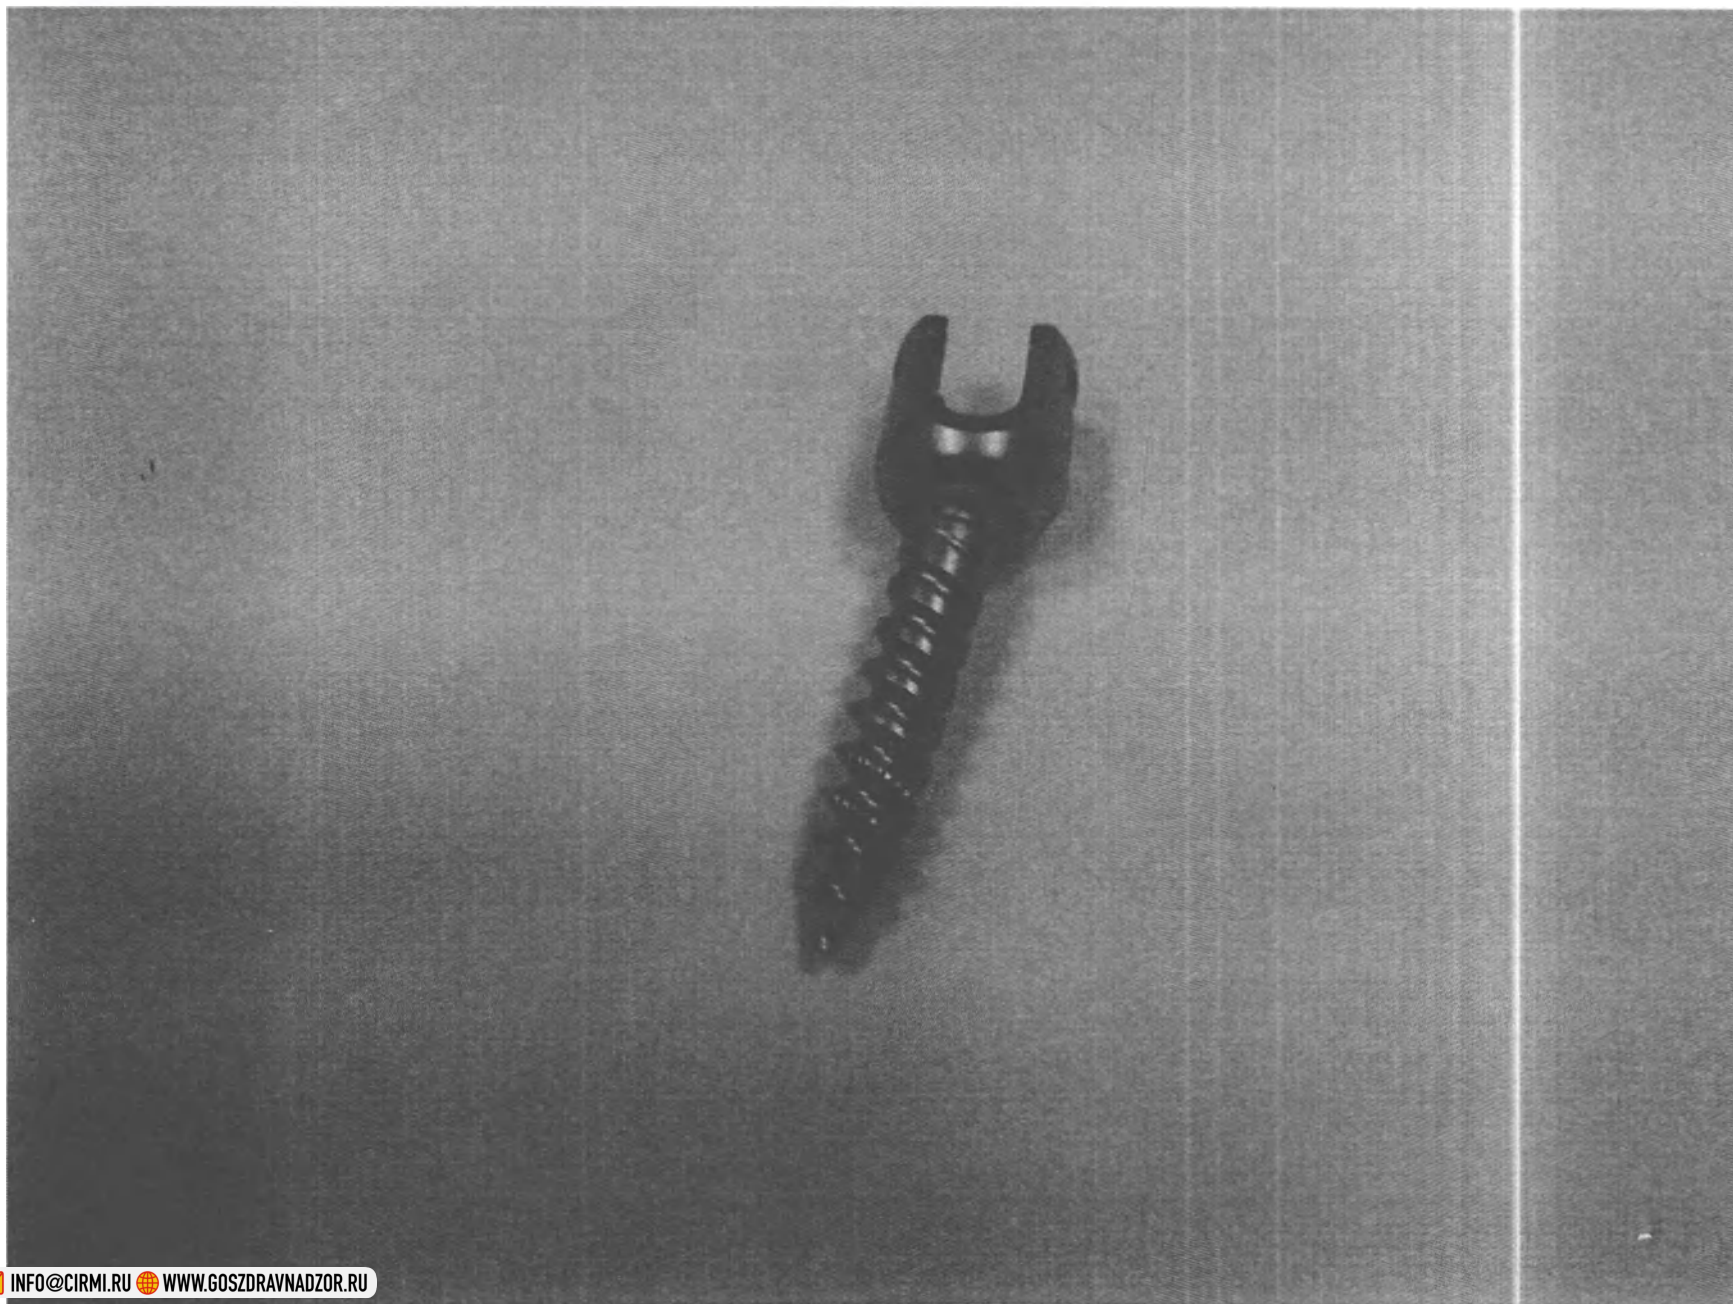


12. Винт полиаксиальный, редукционный, диаметр 5.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.

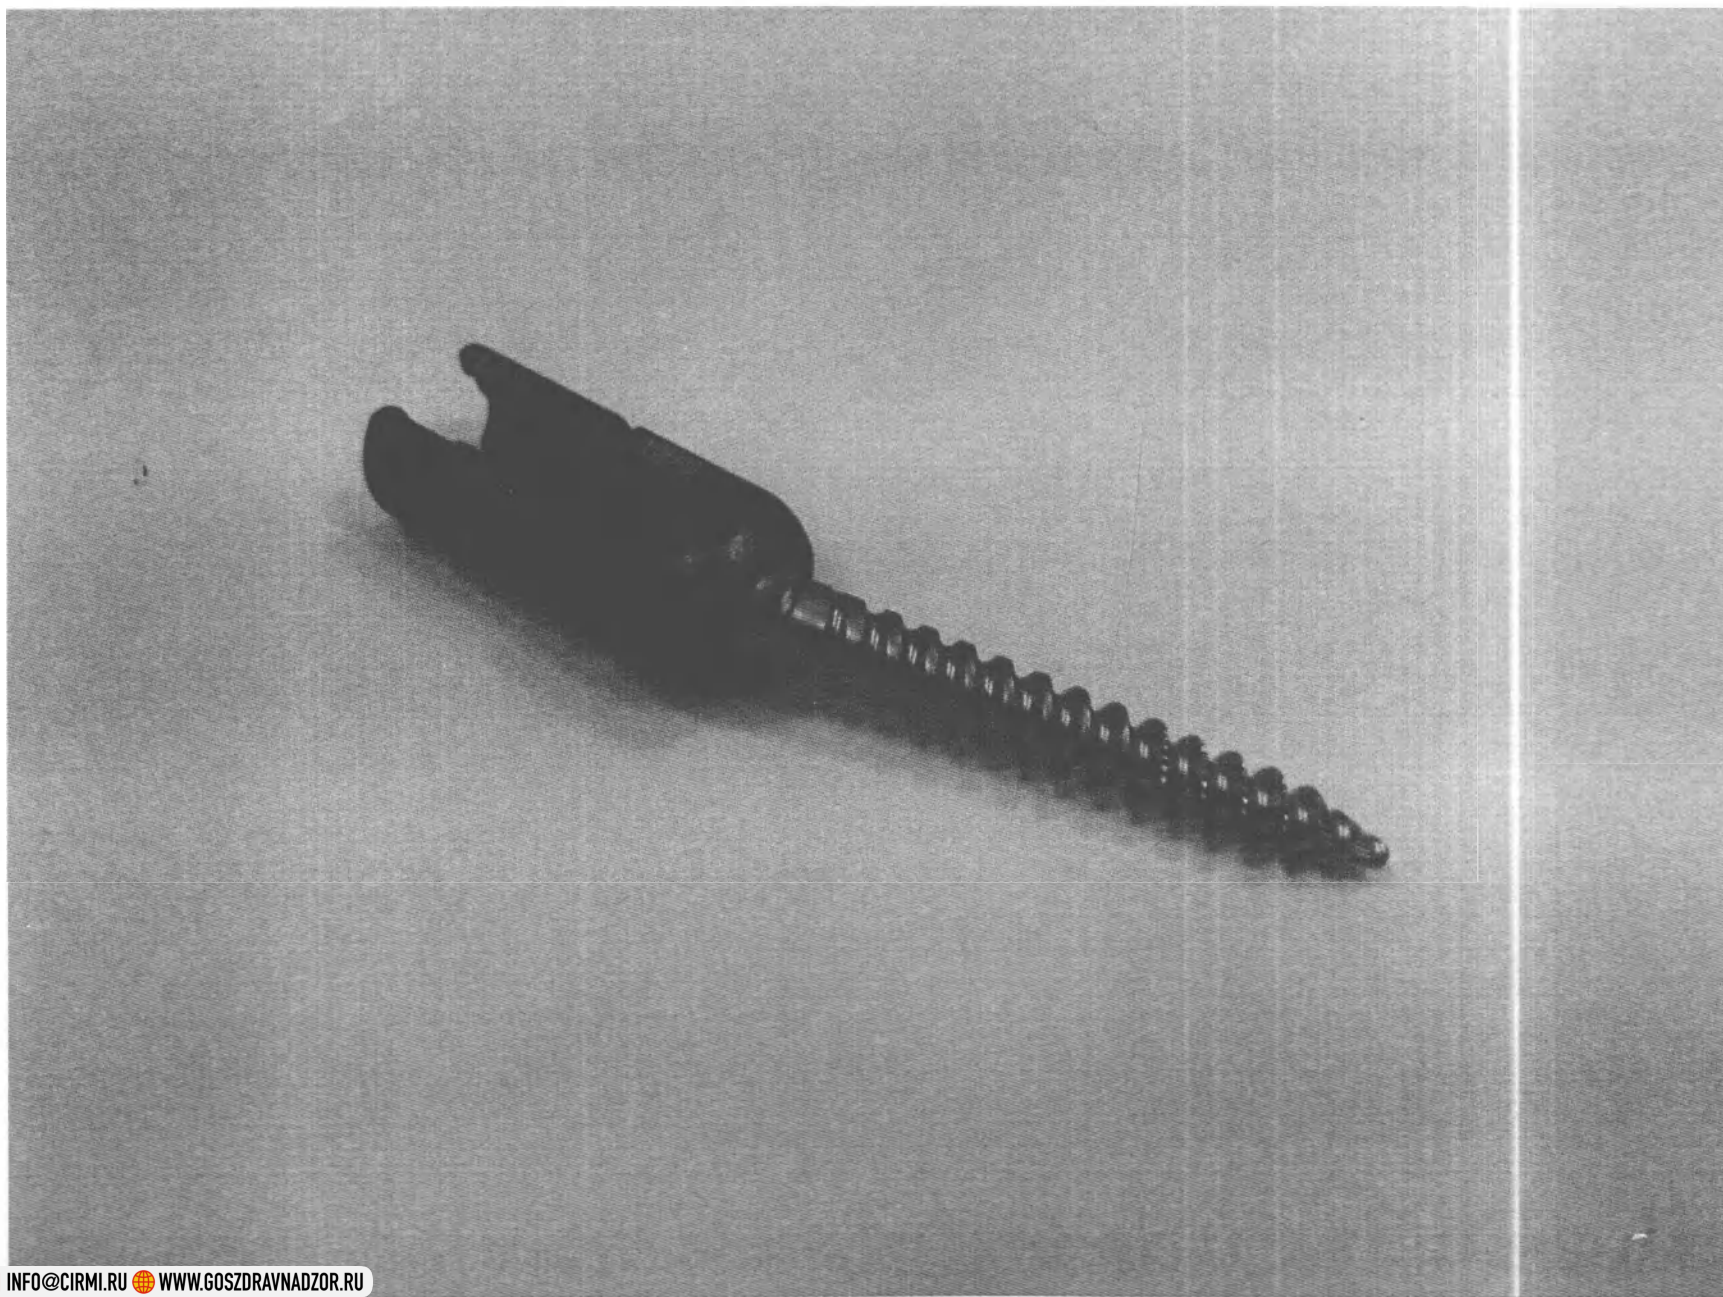


13. Винт полиаксиальный, редукционный, диаметр 6.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.

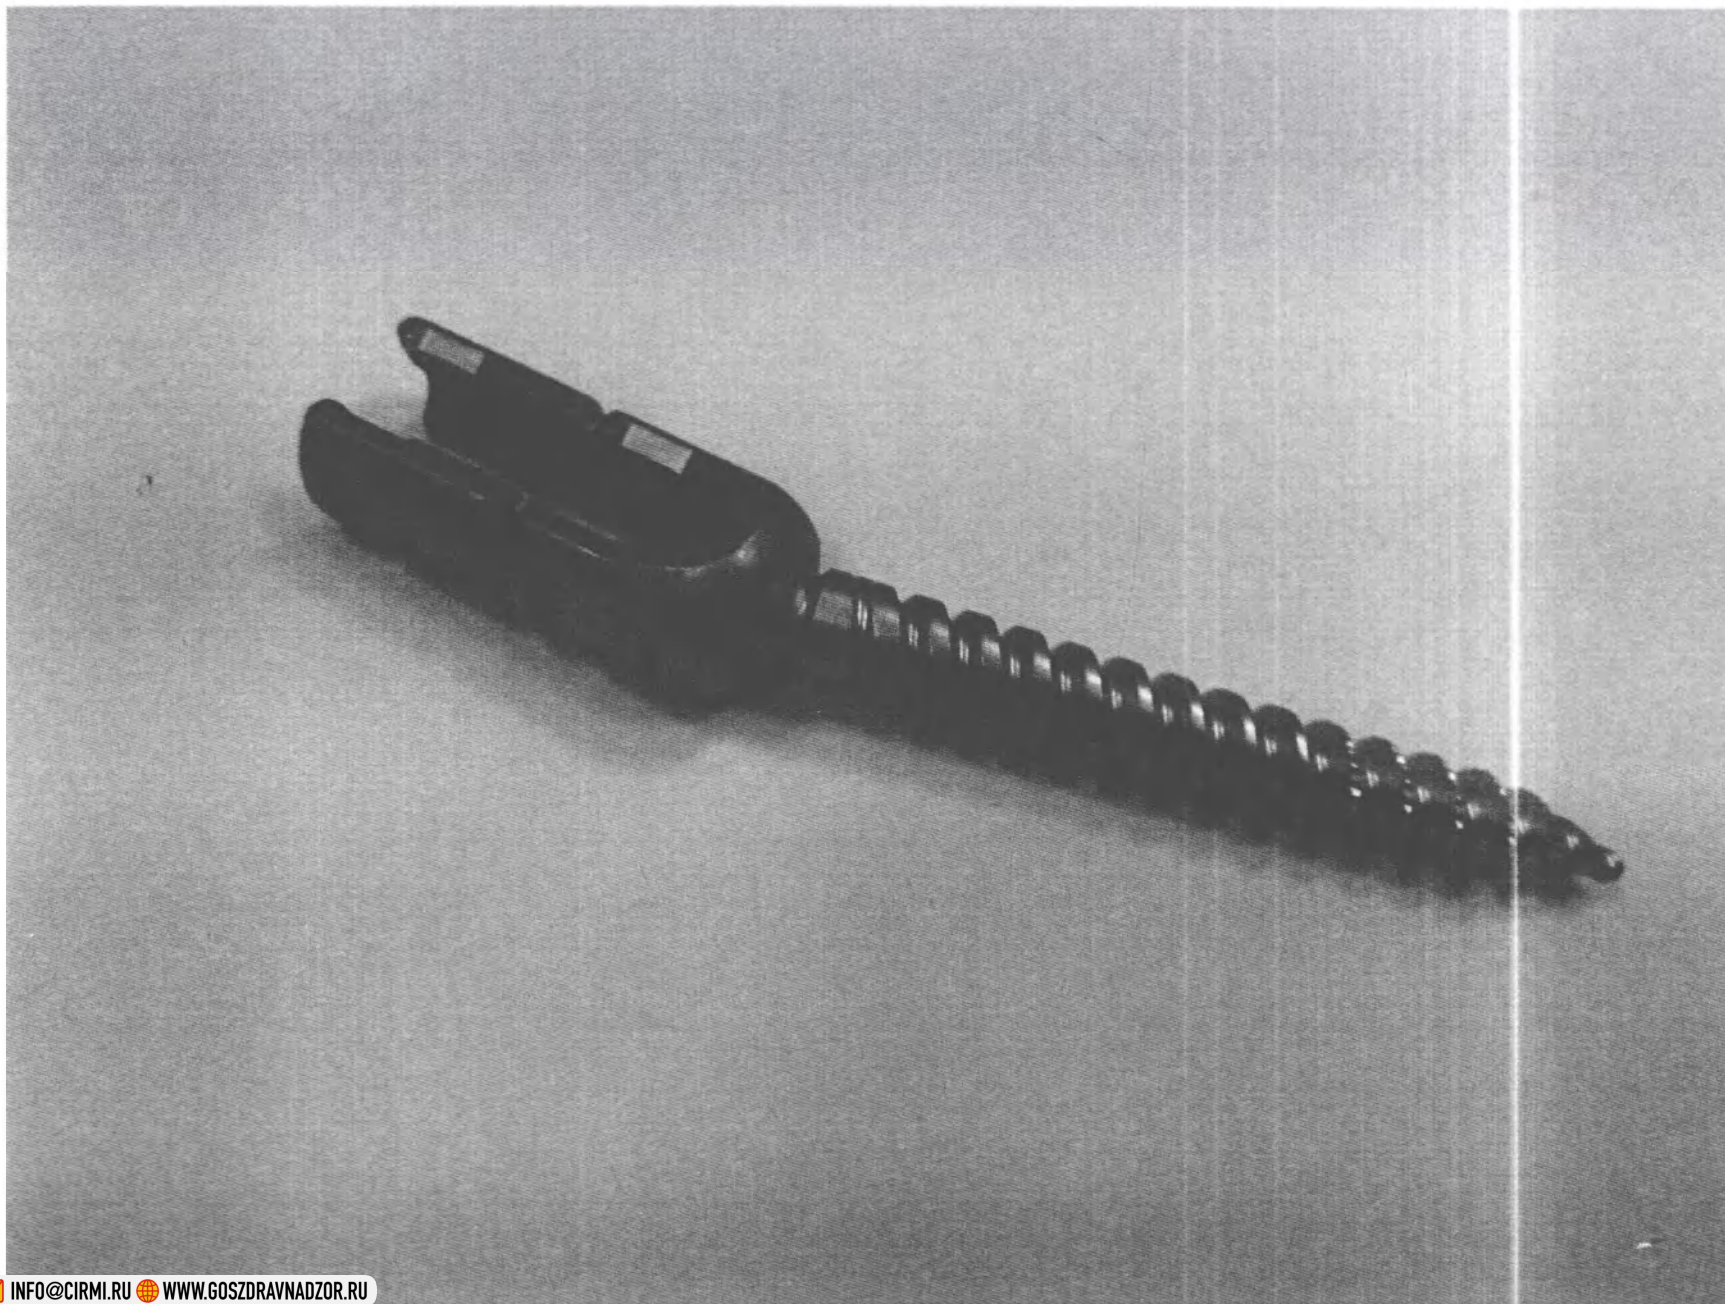


14. Винт полиаксиальный, редукционный, диаметр 7.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.

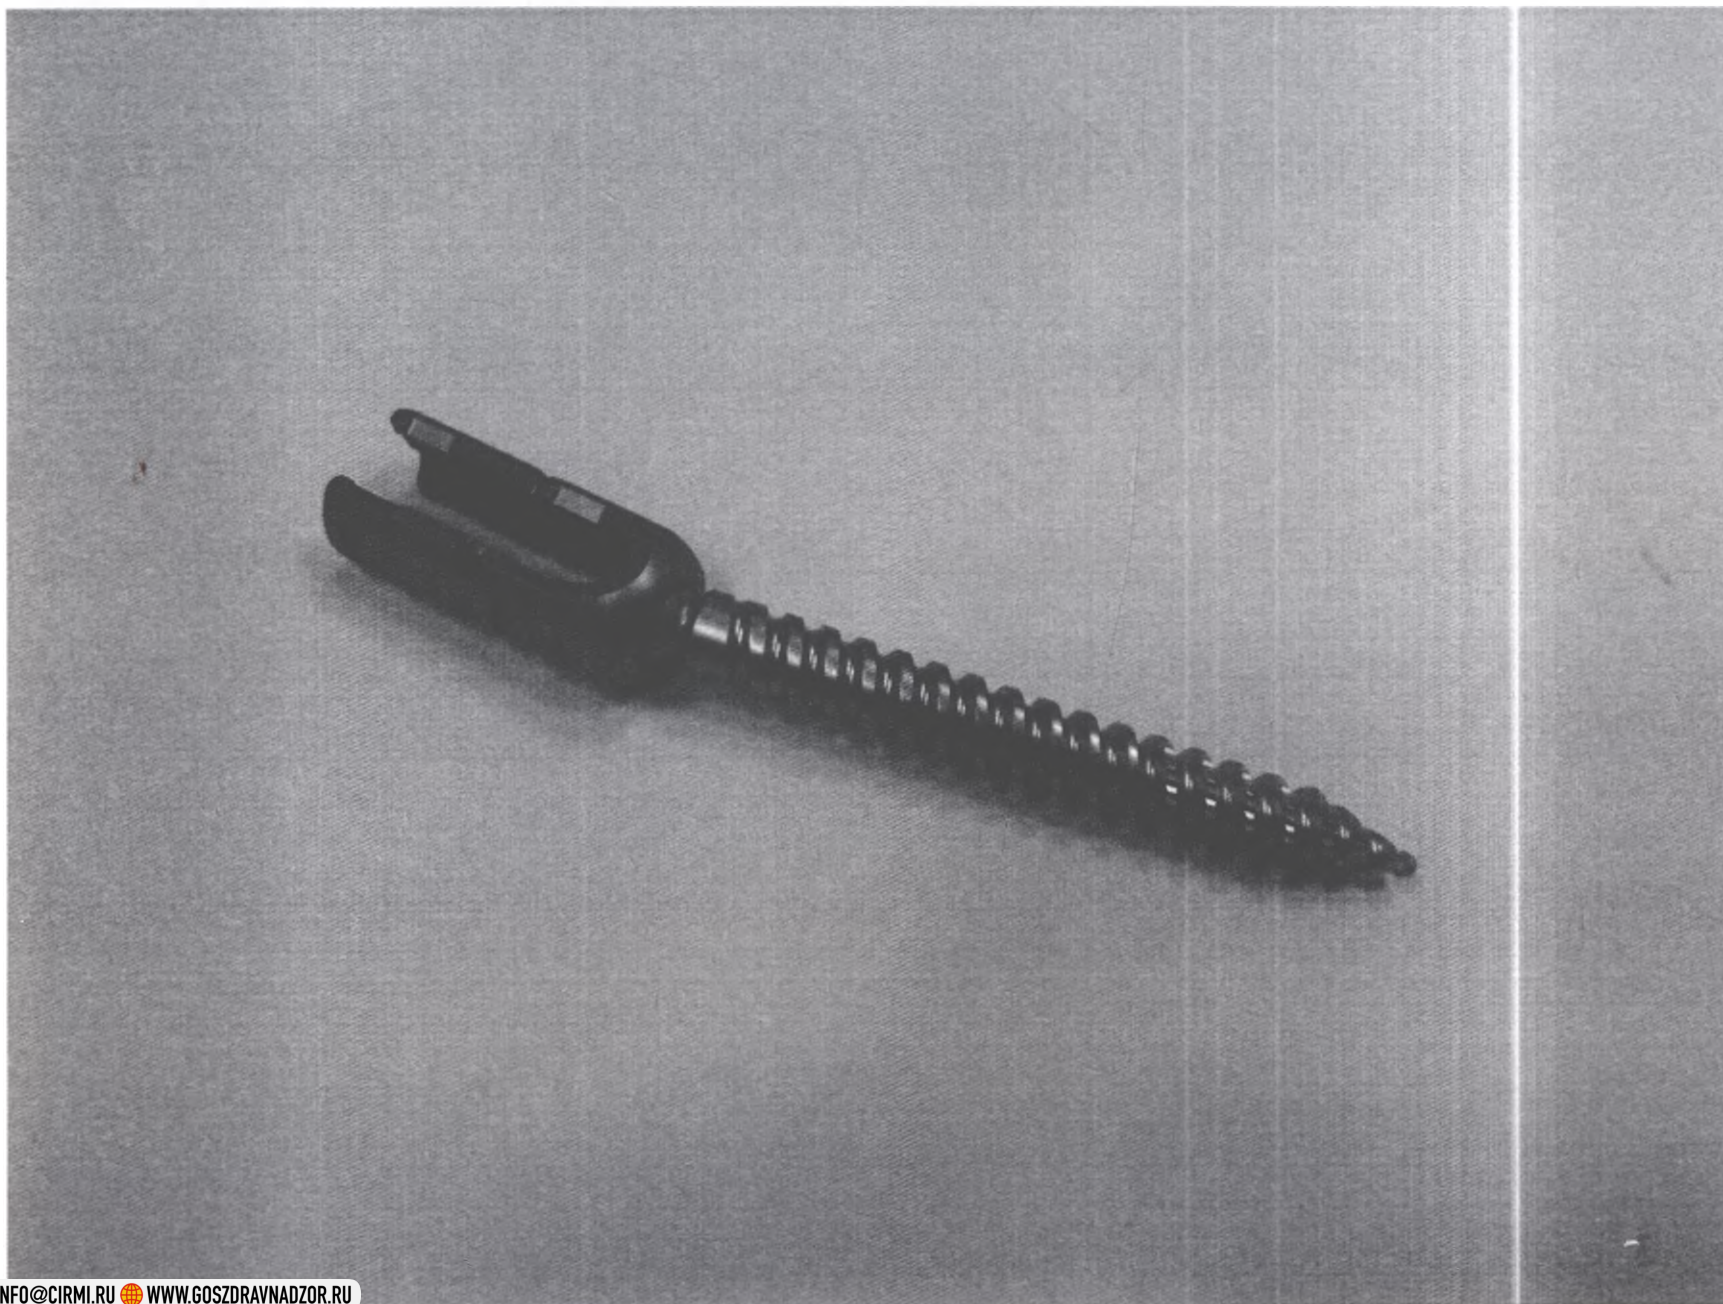

15. Винт офсетный, медиальный, диаметр 7.5 мм, длина 70, 80, 90 мм.

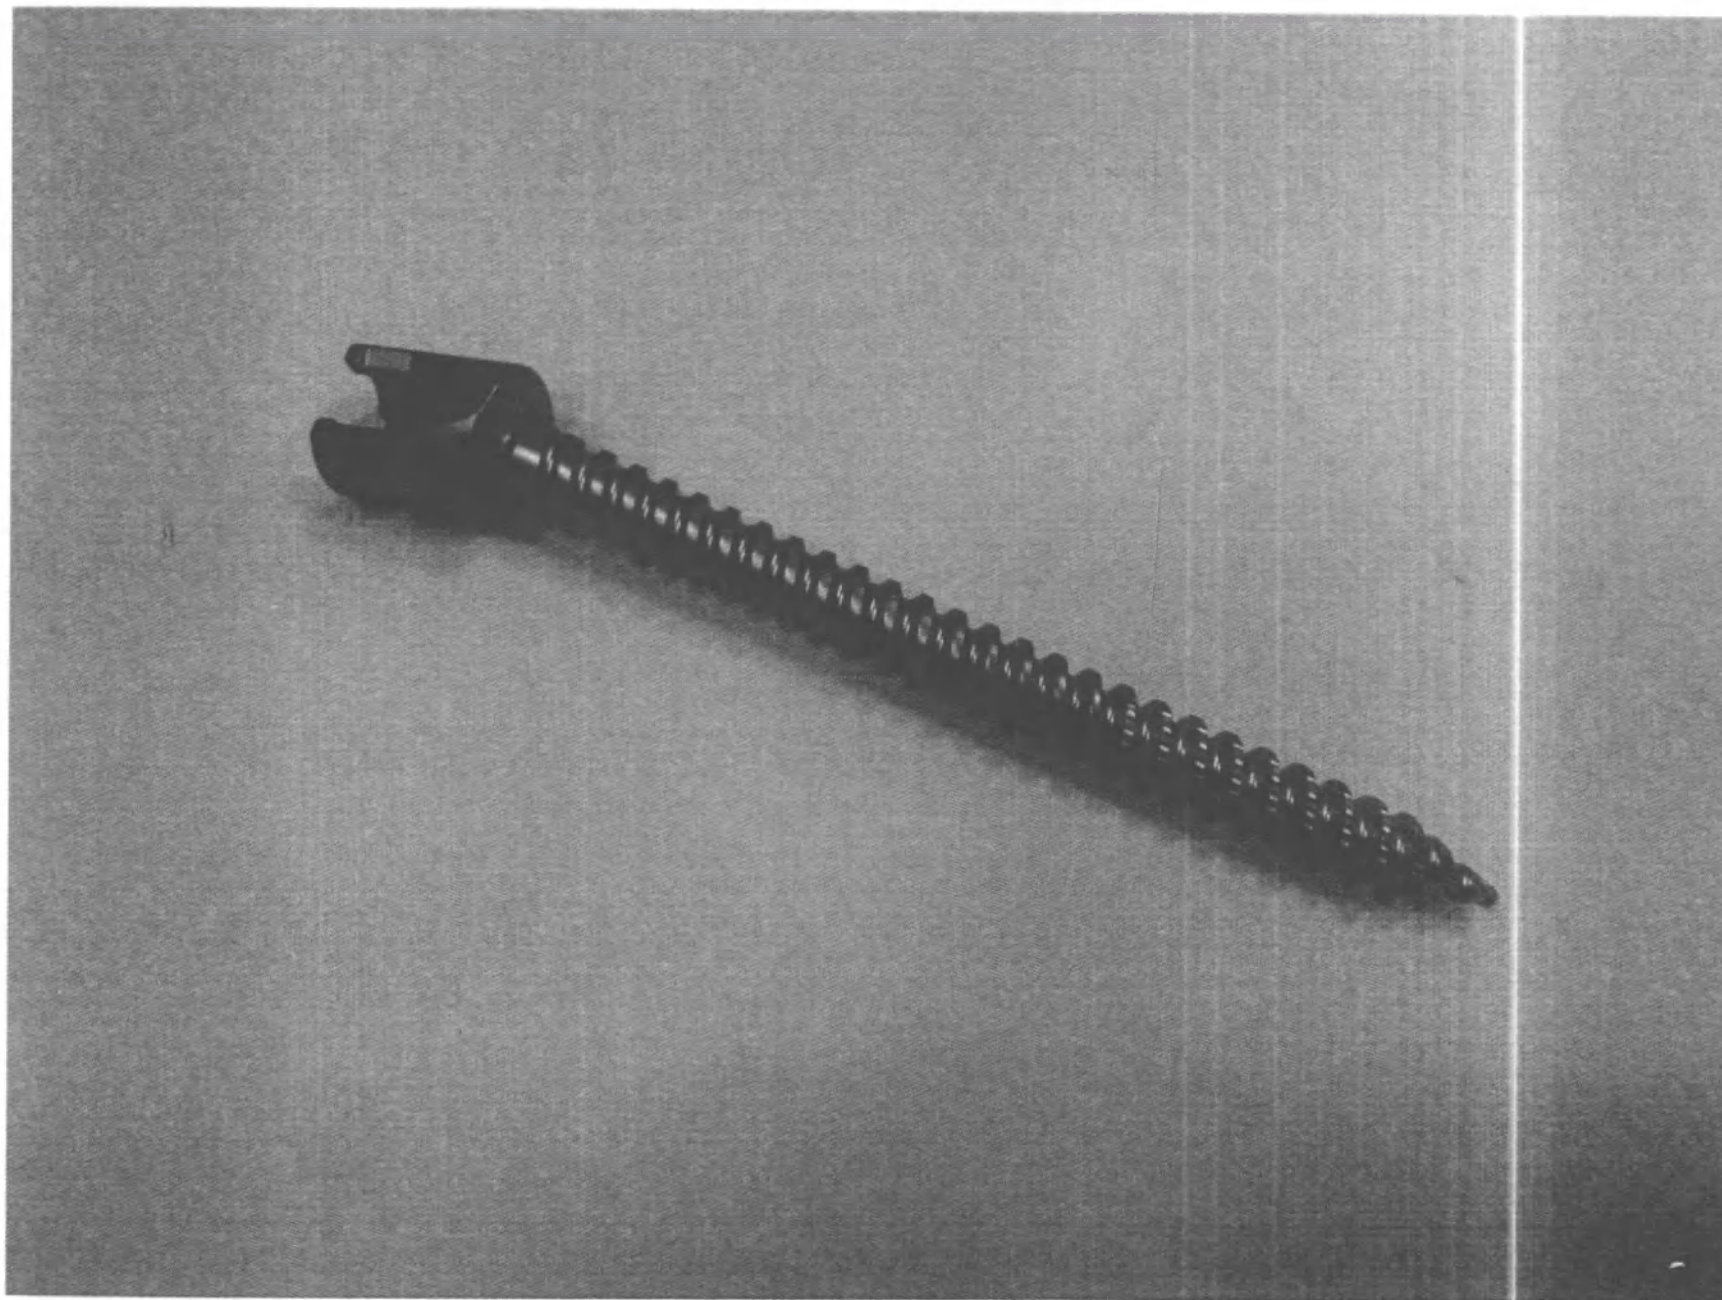


16. Винт офсетный, медиальный, диаметр 8.5 мм, длина 70, 80, 90 мм.

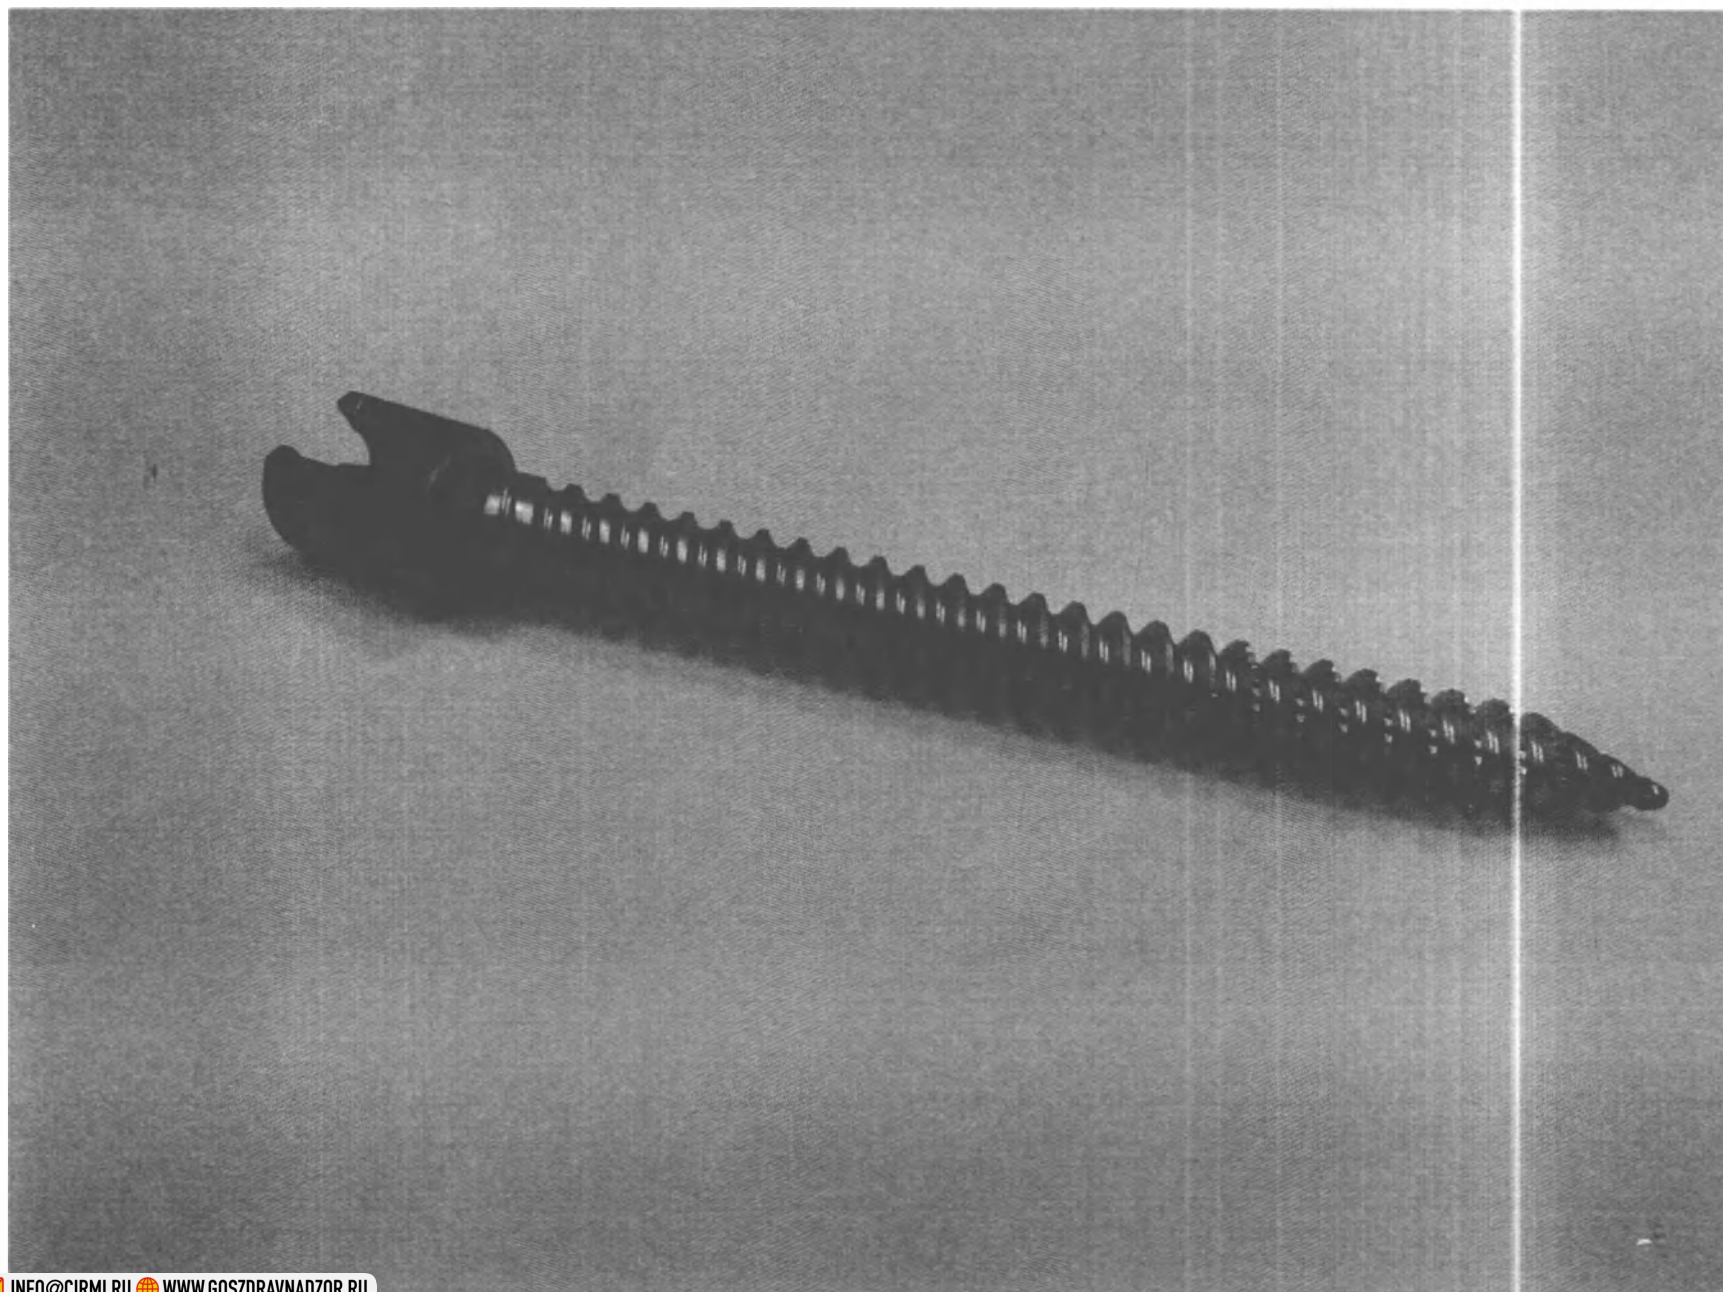


17. Винт полиаксиальный, канюлированный, диаметр 5.5 мм. Длина




17. Винт полиаксиальный, канолированный, диаметр 5.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.

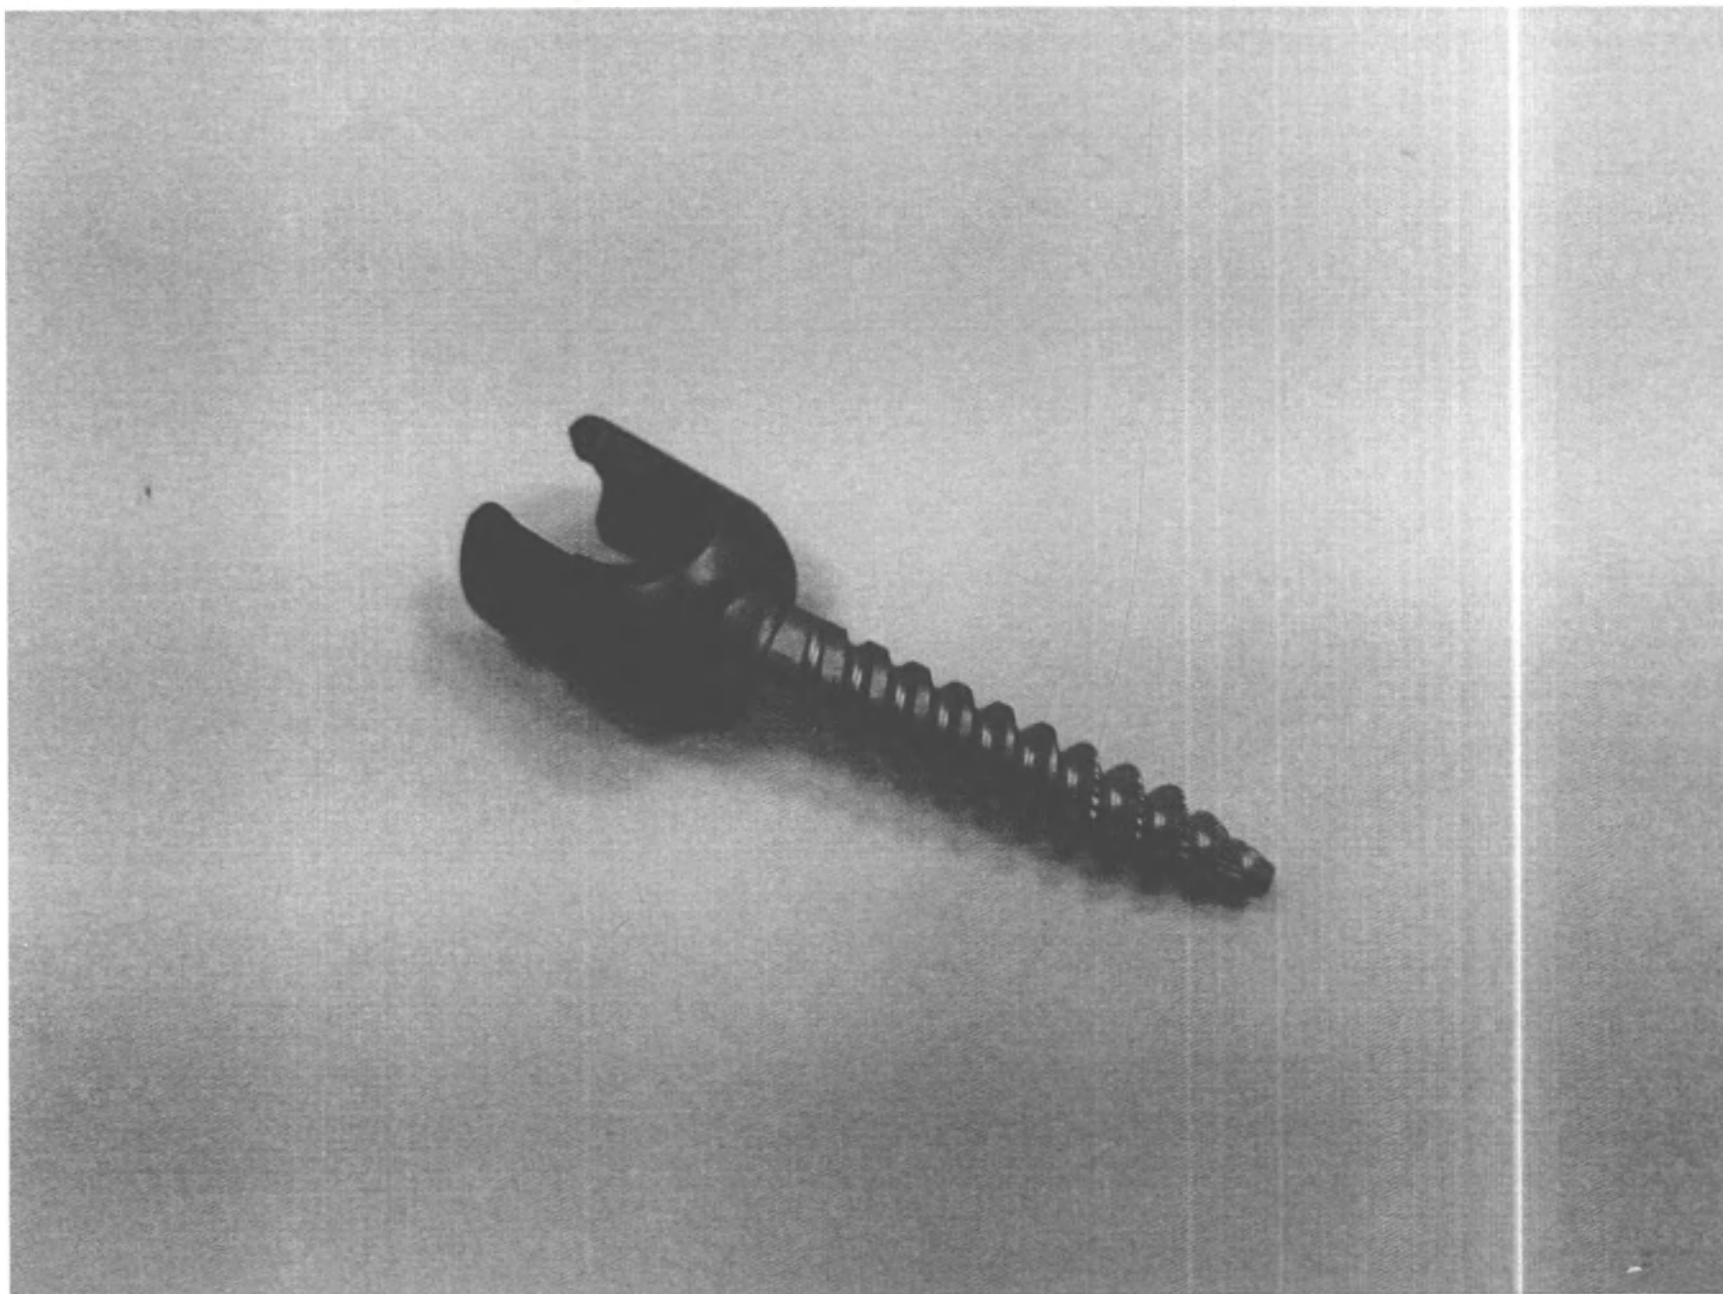


18. Винт полиаксиальный, канюлированный, диаметр 6.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.

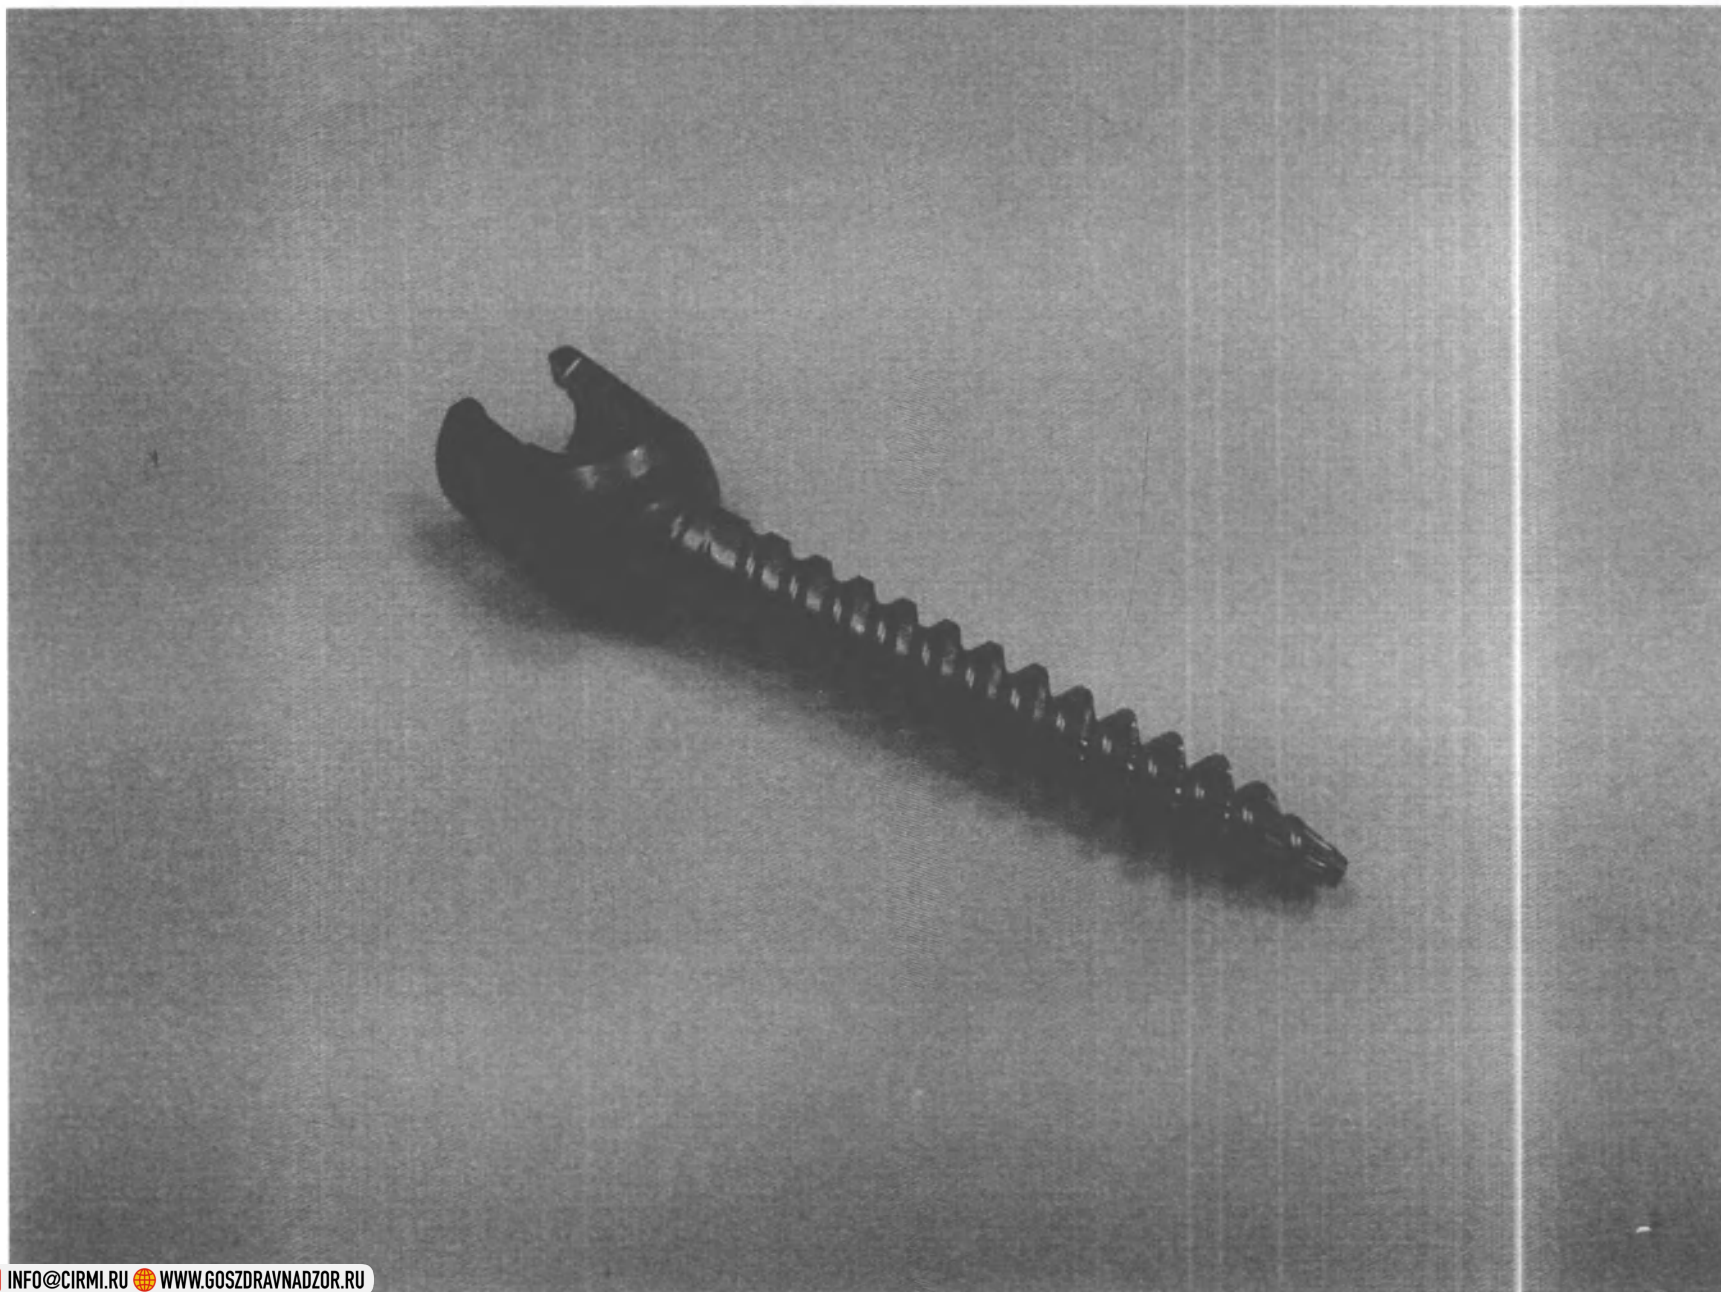

19. Винт полиаксиальный, канюлированный, диаметр 7.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.

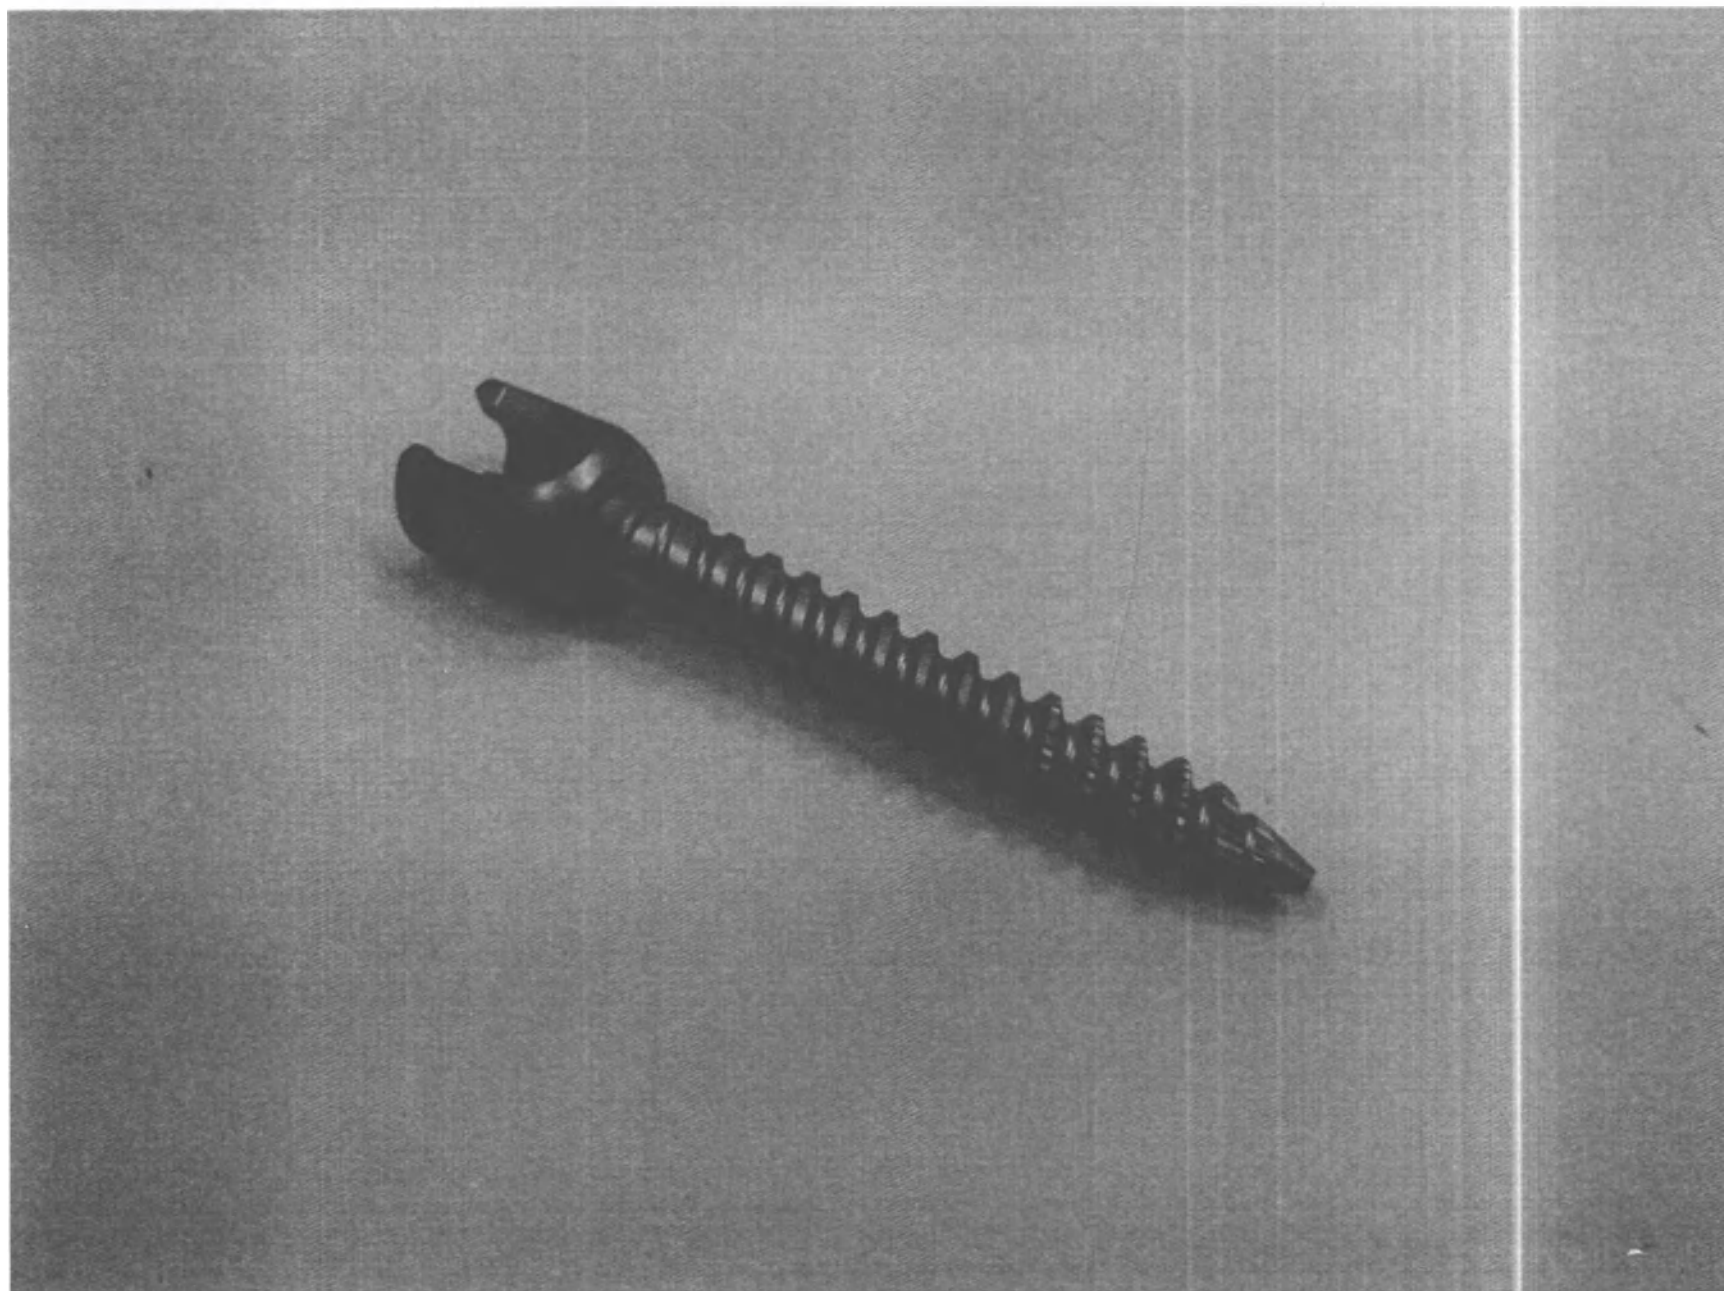

Упаковка изделий.

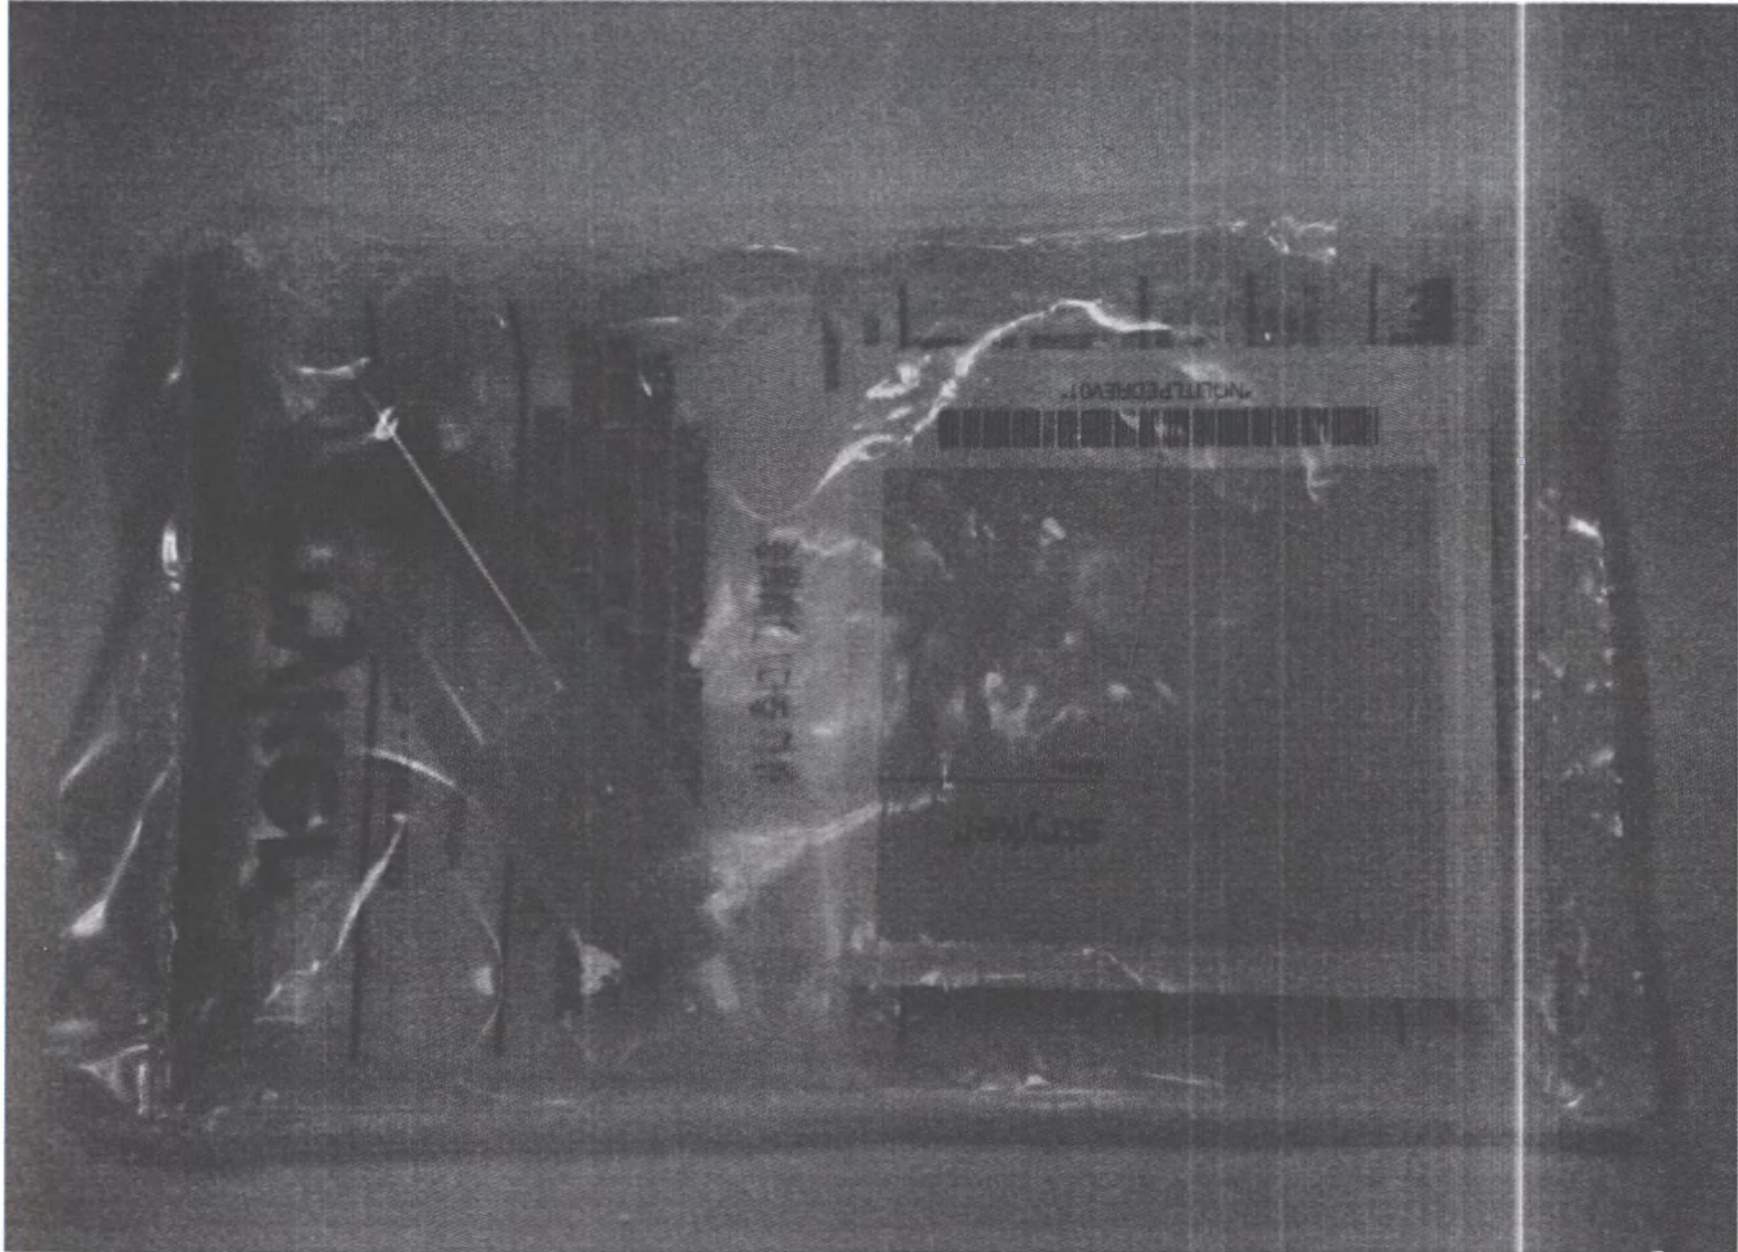

stryker

Xia 3 System - Serrato

Ø4.0mm x 20mm Polyaxial Screw

POLYAXIAL SCREW / VIS POLIAXIALE / TORNILLO POLIAXIAL /
POLIAXIAL SCHRAUBE / VITE POLIASSIALE / POLIAXIALE SCHROEF / PARAFUSO
POLIAXIAL / ПОВІСОНТИННІ ВІТА / POLIAXIAL SKRUE / POLIAXIAL VURUVA
POLIAXIAL SKRUV / POLIAXIAL SKRUE / ŠRUBA VIELDOSPONA / ŠRUB
POLIAXIAL / ПОЛІАКСІАЛНІ ВІТІ / POLIAXIAL VIDA

多轴螺钉 / 다축 나사

TECA IV

Patent(s): www.stryker.com/patents



REF
202014839

LOT
00000

2018-08-18
Manufacture date

CE 0459

THIS PRODUCT IS FOR MEDICAL USE ONLY. THESE DEVICES TO
BE USED BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN.


WARNING: ALWAYS REFER TO THE USER INSTRUCTIONS FOR
SAFETY INFORMATION.

NOT FOR USE IN CHILDREN. THIS PRODUCT IS NOT STERILE. NON STERILE.
NE PAS UTILISER CHEZ L'ENFANT. CE PRODUIT N'EST PAS STÉRILE. / IS STERILE.
NIE WYKORZYSTUJĆ W DZIECIACH. TEN PRODUKT NIE JEST STERYLIZOWANY. / IS STERILE.

Stryker GmbH
2 Place de l'Industrie
91001 Evry-Courcouronnes, France

EC REP

Stryker European Operations S.p.A.
Via S. Rocco 110 - 20139 Milano
Italy - Tel. +39 02 76061111
Fax +39 02 76061112
E-mail: info@stryker.com
Website: www.stryker.com

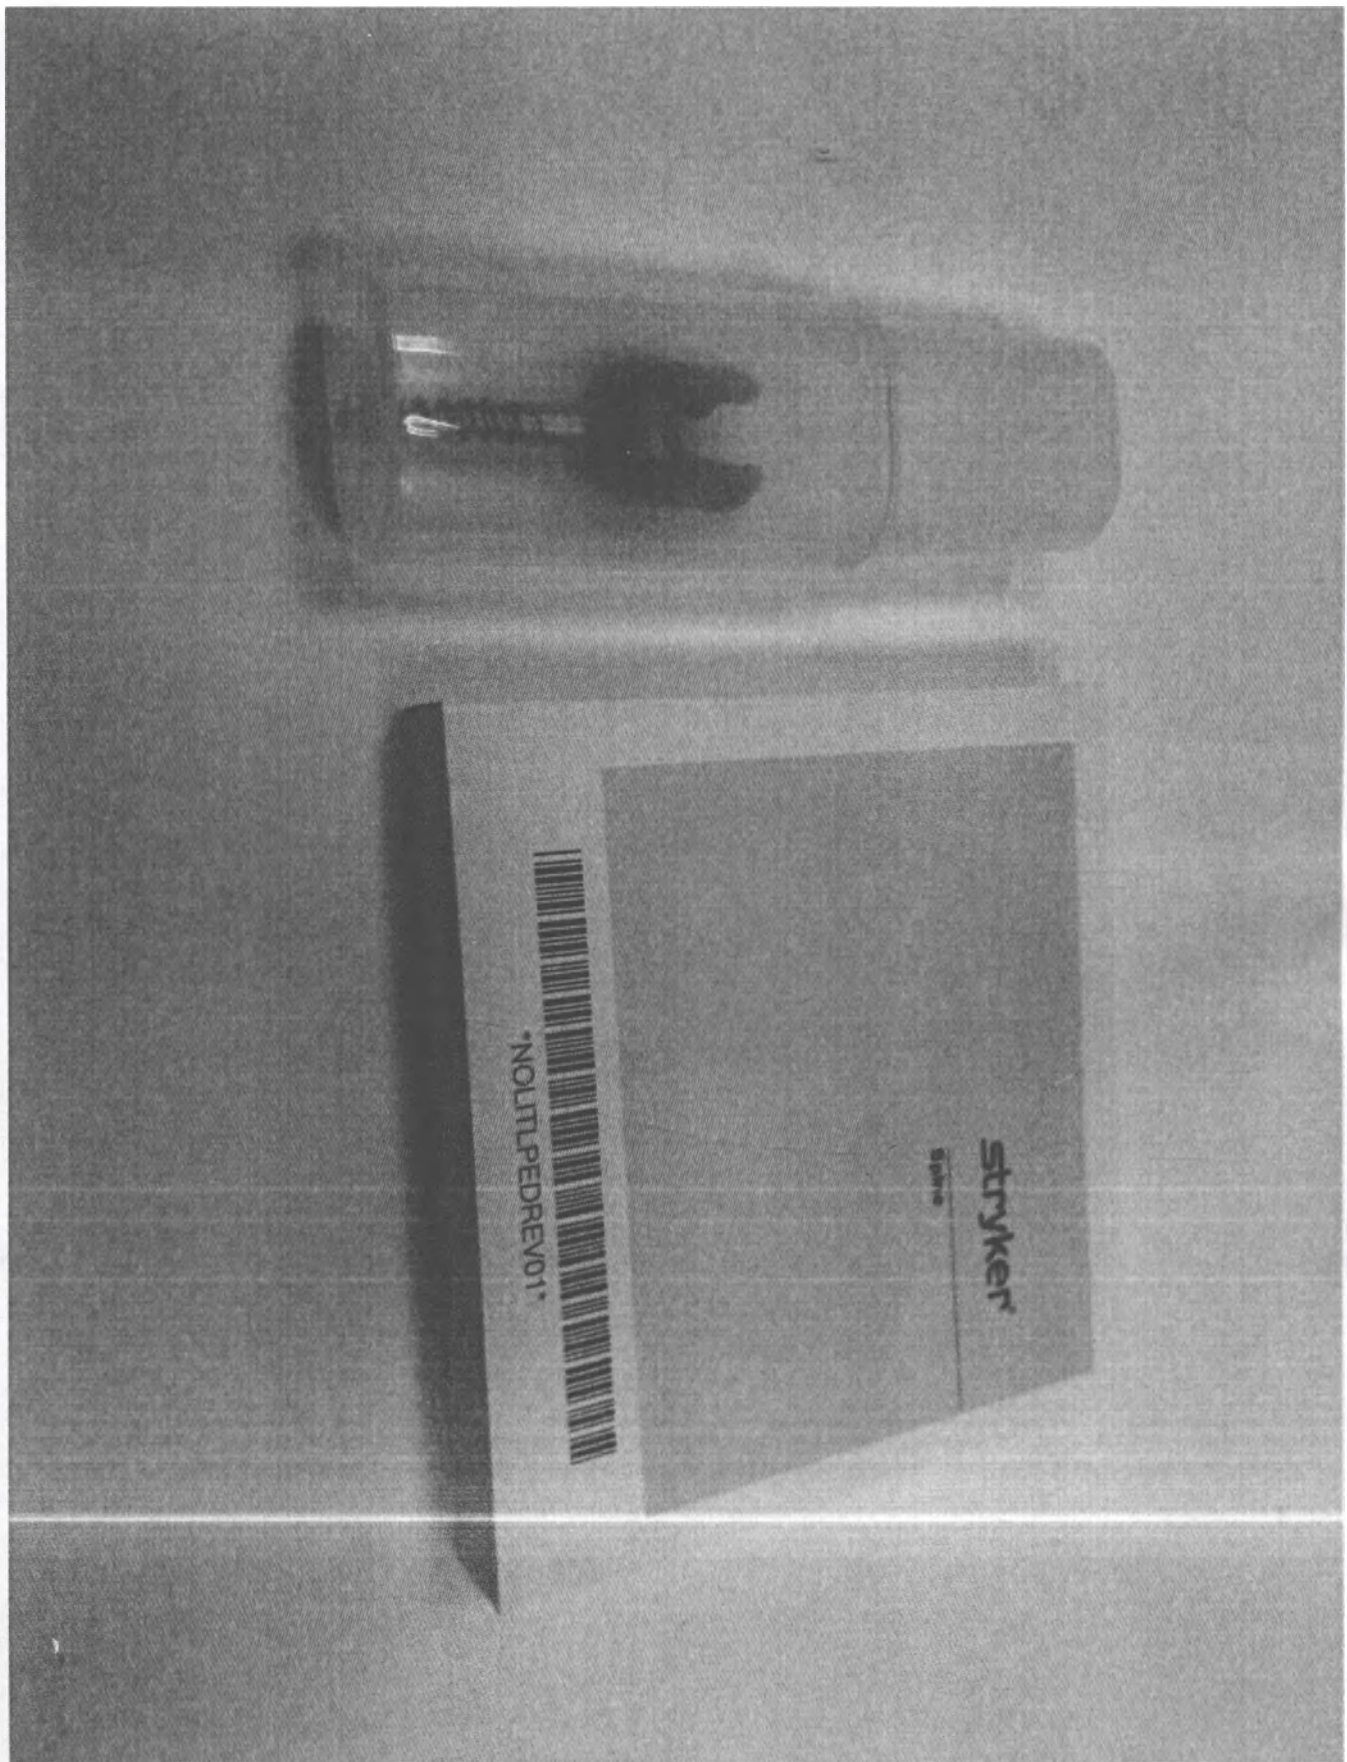

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 23 листа (ов)
Старший специалист по регистрации
ООО «Страйкер»

 А.В. Моисеева
По доверенности б/н от 4.07.2019 г

