

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МТО «Стормовь»



Брукс Е.В.

« »

2019 г.

Фотографические изображения маркировки медицинского изделия

Офтальмоскопы не прямые медицинские, в вариантах исполнения с принадлежностями

Макет маркировки на офтальмоскоп непрямой медицинский **Vantage Plus Led Digital**

Макет маркировки на офтальмоскоп
непрямой медицинский
Vantage Plus Led Digital

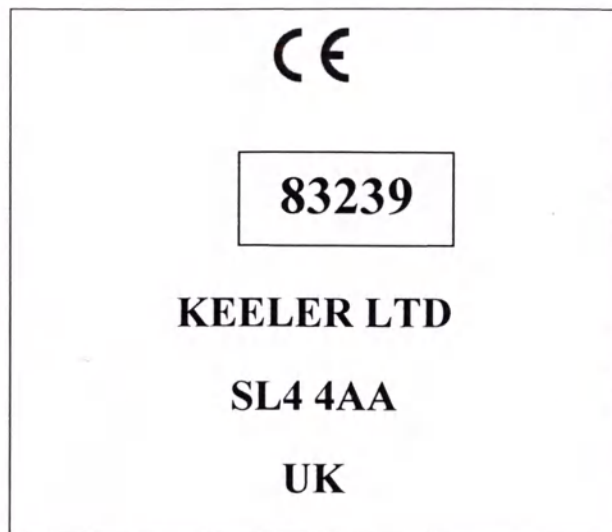


Таблица расшифровки знаков маркировки на
офтальмоскоп непрямой медицинский
Vantage Plus Led Digital

CE	Символ CE на данном продукте указывает на то, что он прошел проверку и соответствует положениям Директивы 93/42/ЕЕС «О медицинских приборах»
83239	Серийный номер
KEELER LTD	Наименование производителя
SL4 4AA	Место производства медицинского изделия
UK	Страна производства медицинского изделия

Макет маркировки на офтальмоскоп
непрямой медицинский
Vantage Plus Led Digital на русском языке



Макет маркировки на офтальмоскоп непрямой медицинский **Vantage Plus Led**

Макет маркировки на офтальмоскоп
непрямой медицинский **Vantage Plus Led**



Таблица расшифровки знаков маркировки на
офтальмоскоп непрямой медицинский
Vantage Plus Led

CE	Символ CE на данном продукте указывает на то, что он прошел проверку и соответствует положениям Директивы 93/42/ЕЕС «О медицинских приборах»
82839	Серийный номер
KEELER LTD	Наименование производителя
SL4 4AA	Место производства медицинского изделия
UK	Страна производства медицинского изделия

Макет маркировки на офтальмоскоп
непрямой медицинский
Vantage Plus Led на русском языке



Офтальмоскоп не прямой медицинский Vantage Plus Led (проводной)

Макет маркировки на офтальмоскоп
не прямой медицинский Vantage Plus Led
(проводной)

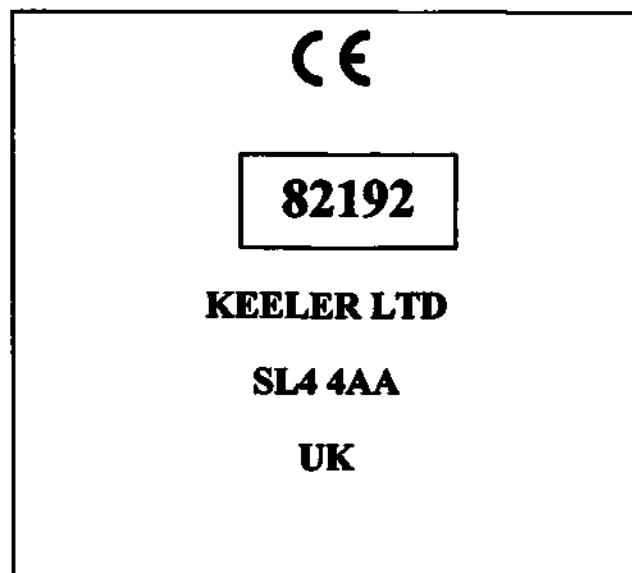


Таблица расшифровки знаков маркировки на
офтальмоскоп не прямой медицинский
Vantage Plus Led (проводной)

CE	Символ CE на данном продукте указывает на то, что он прошел проверку и соответствует положениям Директивы 93/42/ЕЕС «О медицинских приборах»
82192	Серийный номер
KEELER LTD	Наименование производителя
SL4 4AA	Место производства медицинского изделия
UK	Страна производства медицинского изделия

Макет маркировки на офтальмоскоп
не прямой медицинский
Vantage Plus Led (проводной) на русском
языке




Макет маркировки на офтальмоскоп непрямой медицинский Spectra Iris

Макет маркировки на офтальмоскоп
непрямой медицинский Spectra Iris

Таблица расшифровки знаков маркировки
на офтальмоскоп непрямой медицинский
Spectra Iris

Макет маркировки на офтальмоскоп
непрямой медицинский Spectra Iris
на русском языке

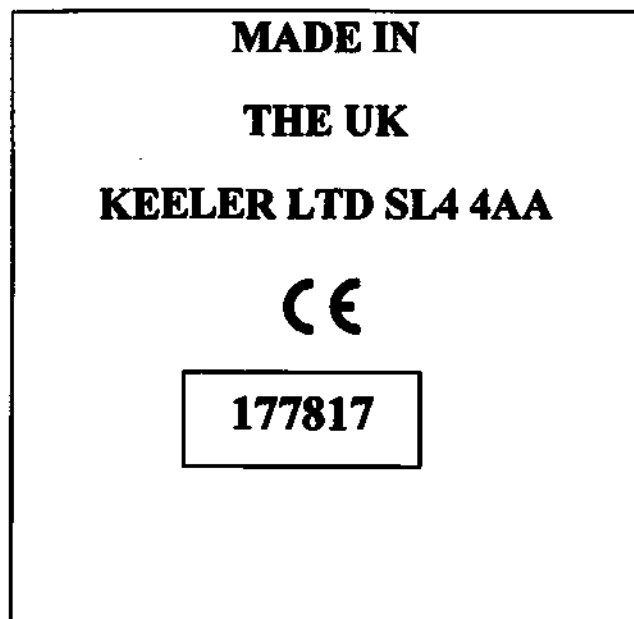

MADE IN THE UK	Страна производства медицинского изделия
KEELER LTD	Наименование производителя
SL4 4AA	Место производства медицинского изделия
CE	Символ CE на данном продукте указывает на то, что он прошел проверку и соответствует положениям Директивы 93/42/ЕЕС «О медицинских приборах»
177817	Серийный номер

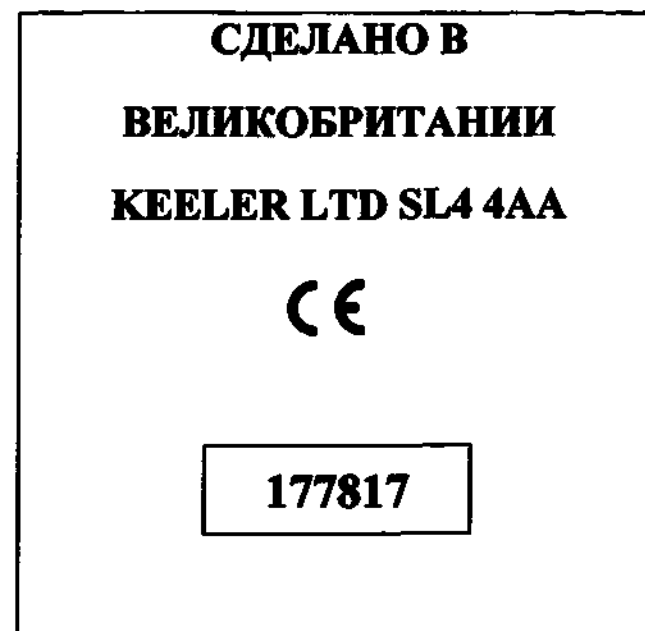


Таблица параметров упаковки на офтальмоскоп непрямой медицинский Vantage Plus Led Digital:

Модель	Vantage Plus Led Digital
Размер кейса транспортного, не более, мм	440(Ш)х580(Д)х250(В)(±10%)

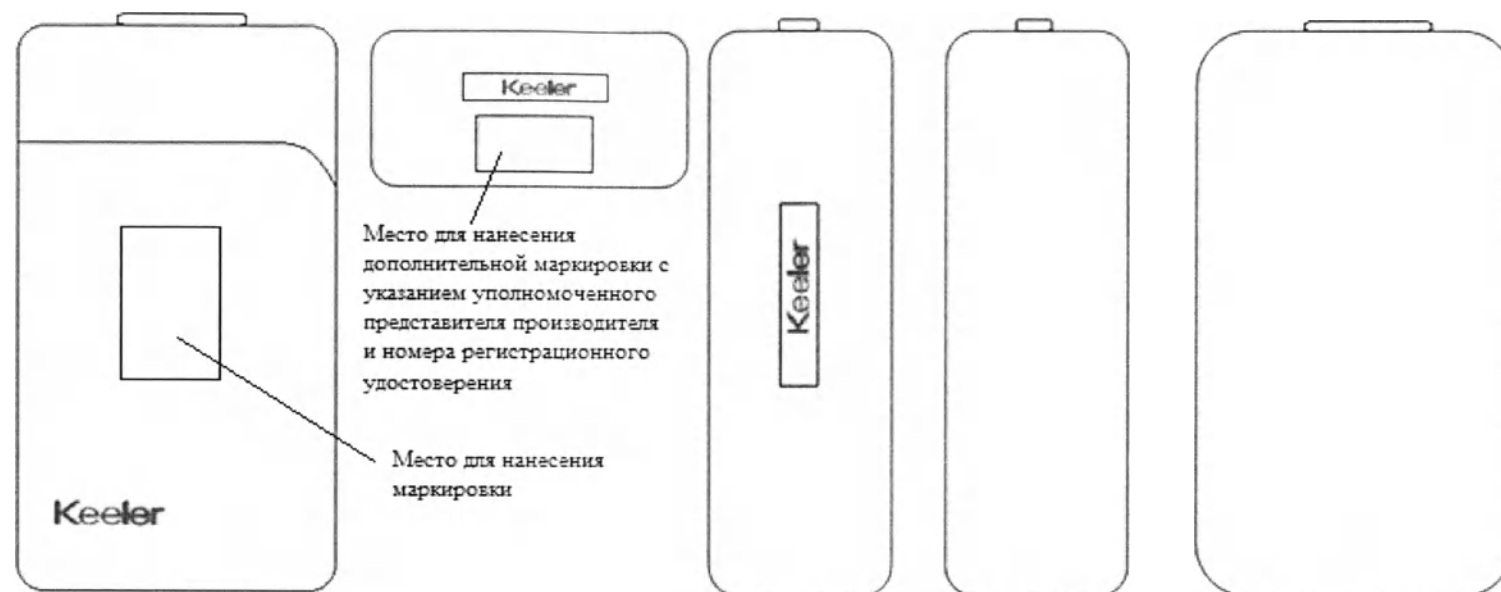


Таблица расшифровки знаков маркировки на упаковке офтальмоскопа непрямого медицинского Vantage Plus Led Digital

Keeler	Логотип компании производителя
--------	--------------------------------

Таблица параметров упаковки на офтальмоскоп не прямой медицинский **Vantage Plus Led**

Модель	Vantage Plus Led
Размер транспортной упаковки, не более, мм	229(Ш) x 305(Д) x 152(В) (±10%)


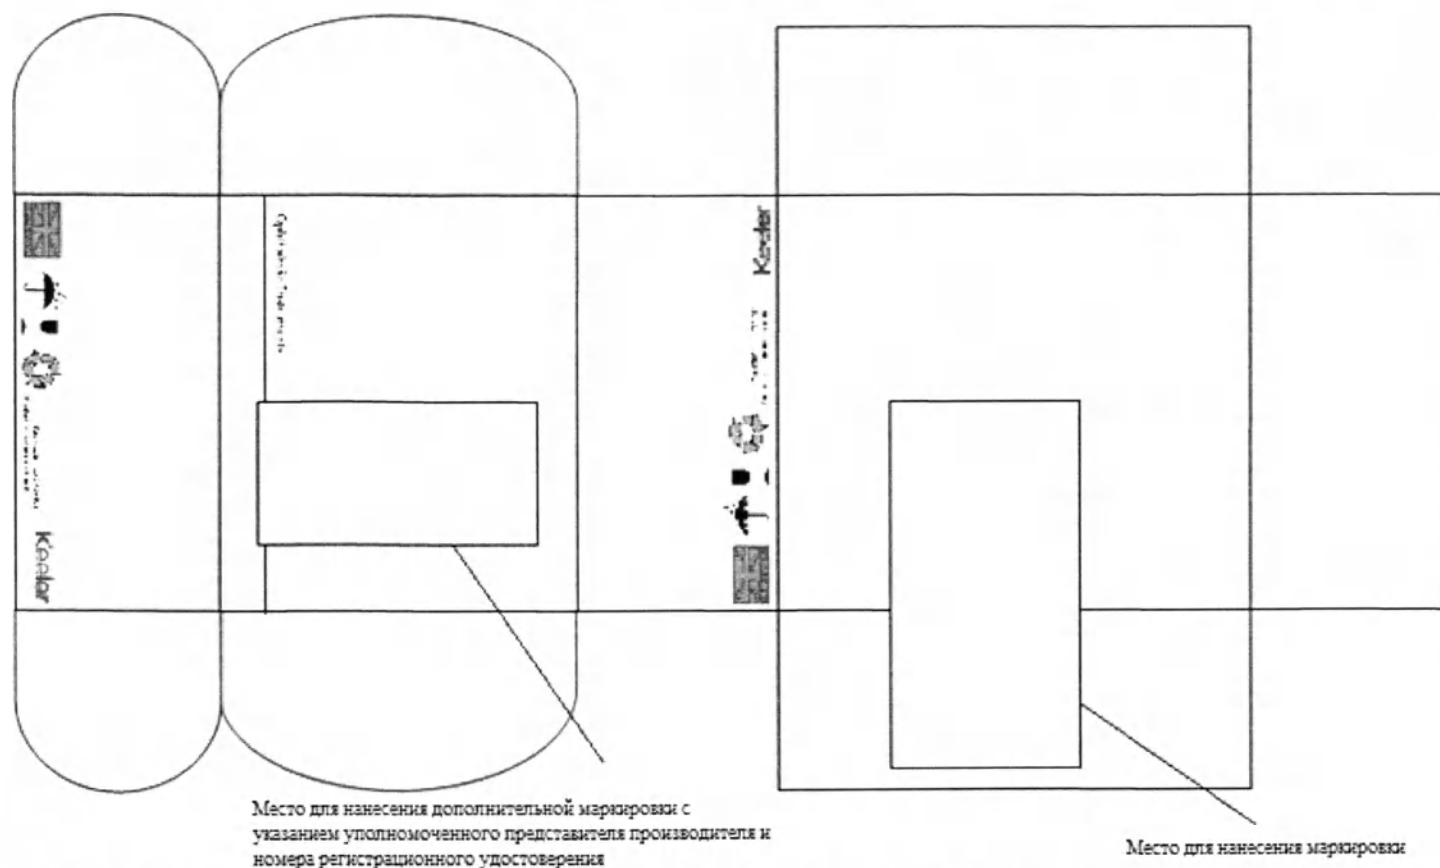


Таблица расшифровки знаков маркировки на упаковке офтальмоскопа не прямого медицинского **Vantage Plus Led**

				Recyclable EP59-56408 Product of sustainable Forests	Ophthalmic Instruments	Keeler
Сделано в Великобритании	Беречь от влаги	Хрупкий груз	Материал пригоден для повторной переработки; EP59-56408 – уникальный номер упаковки; упаковка из экологически безопасного материала		Офтальмологические инструменты	Логотип компании производителя

Таблица параметров упаковки на офтальмоскоп не прямой медицинский **Vantage Plus Led (проводной)**

Модель	Vantage Plus Led (проводной)
Размер транспортной коробки, не более, мм	229(Ш) x 305(Д) x 152(В) (±10%)

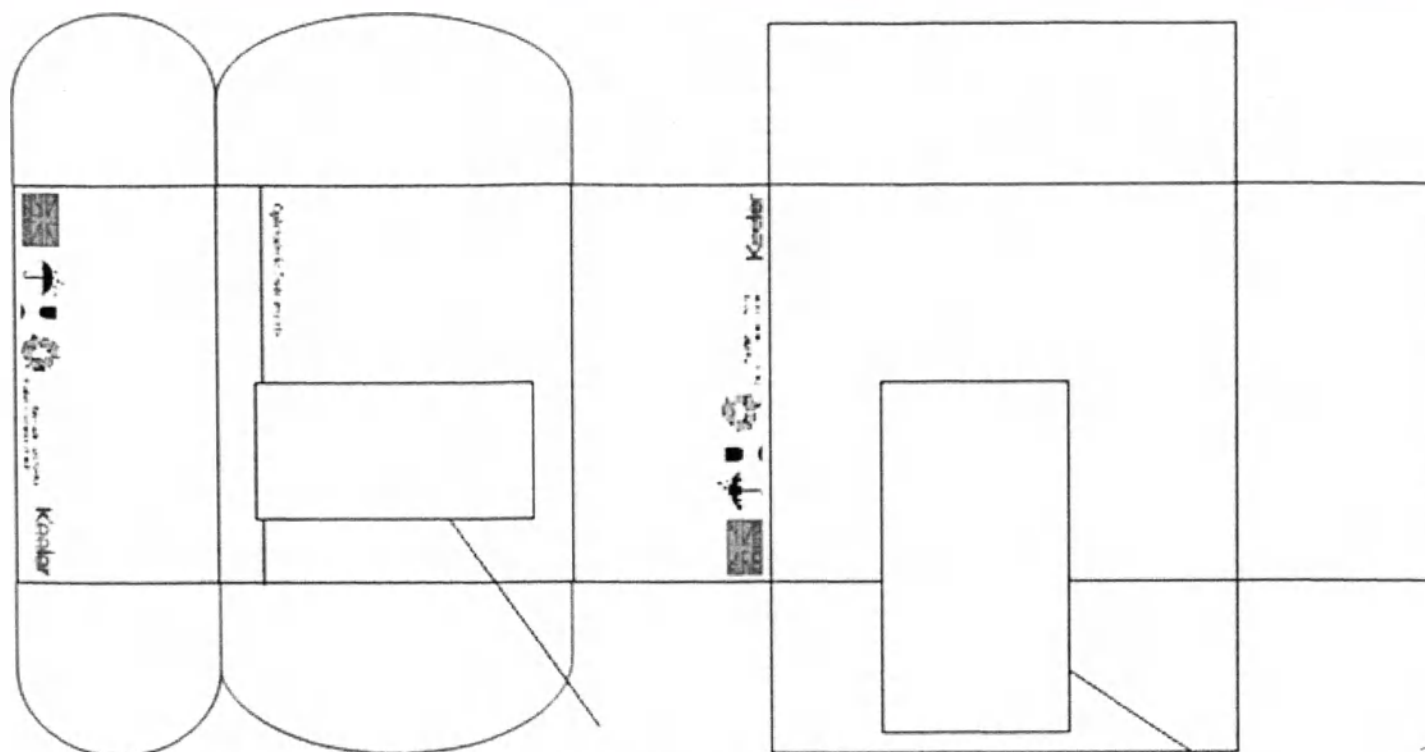

Место для нанесения дополнительной маркировки с указанием уполномоченного представителя производителя и номера регистрационного удостоверения

Место для нанесения маркировки

Таблица расшифровки знаков маркировки на упаковке офтальмоскопа не прямого медицинского **Vantage Plus Led (проводной)**

				Recyclable EP59-56408 Product of sustainable Forests	Ophthalmic Instruments	Keeler
Сделано в Великобритании	Бережь от влаги	Хрупкий груз	Материал пригоден для повторной переработки; EP59-56408 – уникальный номер упаковки; упаковка из экологически безопасного материала		Офтальмологические инструменты	Логотип компании производителя

Макет упаковки маркировки на офтальмоскоп не прямой медицинский Spectra Iris

Модель	Spectra Iris
Размер транспортной упаковки, не более, мм	229(Ш) x 305(Д) x 152(В) (±10%)

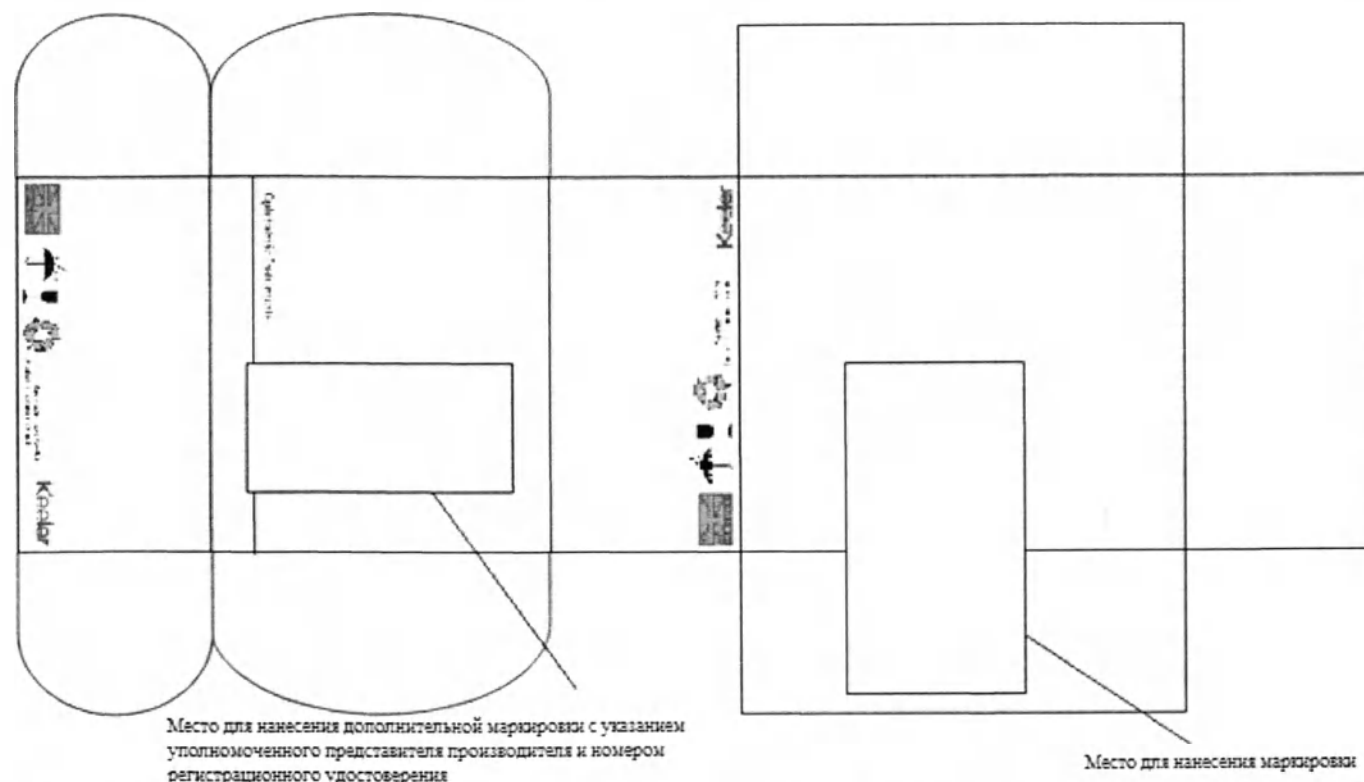


Таблица расшифровки знаков маркировки на упаковке офтальмоскопа не прямого медицинского Spectra Iris

				Recyclable EP59-56408 Product of sustainable Forests	Ophthalmic Instruments	Keeler
Сделано в Великобритании	Беречь от влаги	Хрупкий груз	Материал пригоден для повторной переработки; EP59-56408 – уникальный номер упаковки; упаковка из экологически безопасного материала		Офтальмологические инструменты	Логотип компании производителя

Макет маркировки на упаковке офтальмоскопов
непрямых медицинских


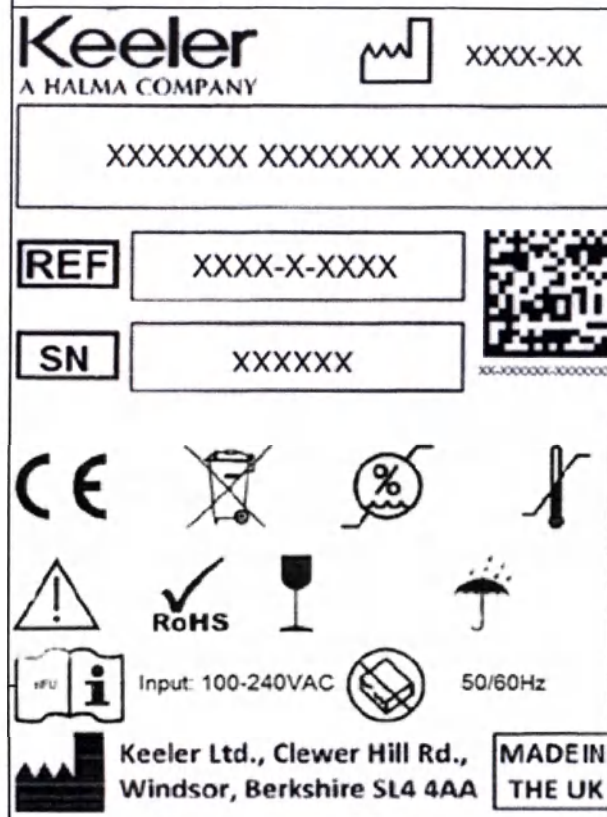


Таблица расшифровки знаков маркировки на
упаковке офтальмоскопов непрямых медицинских

1	Логотип компании производителя
2	Дата изготовления
3	Наименование медицинского изделия
4	Номер по каталогу
5	Серийный номер
6	QR-код
7	Символ CE на данном продукте указывает на то, что он прошел проверку и соответствует положениям Директивы 93/42/ЕЕС «О медицинских приборах»
8	Данный символ на продукте, его упаковке или в инструкции указывает, что его разместить на рынке после августа 2005 г. и что данный продукт нельзя перерабатывать как домашние отходы
9	Диапазон влажности при транспортировании
10	Температурный диапазон при транспортировании
11	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению.
12	Подтверждает ограничение применения опасных веществ, гарантирует защиту здоровья потребителя и окружающей среды
13	Хрупкий груз
14	Беречь от влаги
15	Обратитесь к инструкции по применению. iFU - Electronic instructions for use - руководства по эксплуатации в электронном виде
16	Питание
17	Не использовать при повреждении упаковки
18	Напряжение
19	Наименование и адрес производителя
20	Страна производства медицинского изделия

Макет маркировки на упаковке офтальмоскопов
непрямых медицинских на русском языке

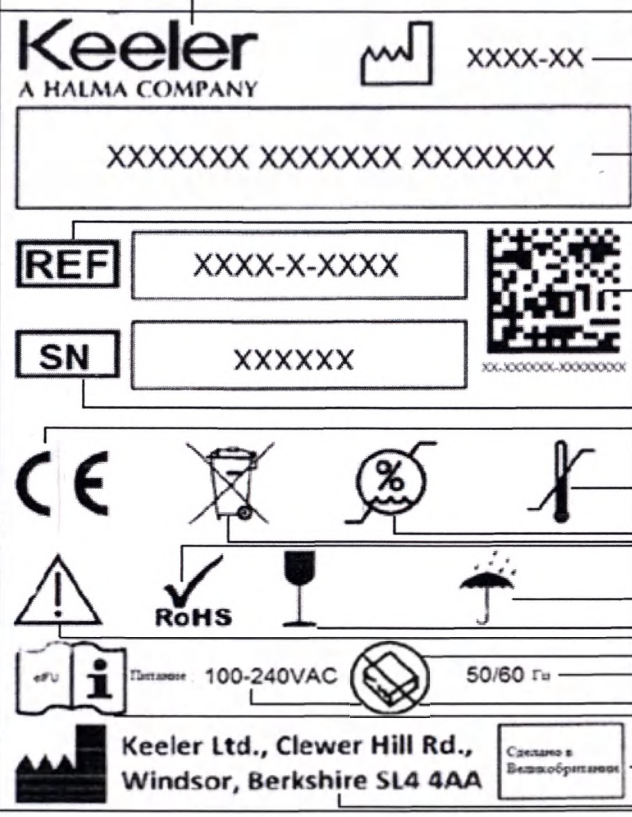

Уполномоченный представитель производителя
на территории РФ: ООО «МТО «Стормоз»
143401, Московская область, г. Красногорск,
бульвар
Строителей, д. 4, корпус 1, дом XX, этаж 8,
комната 7
Телефон/факс: +7 (495) 780-07-90
Регистрационное удостоверение №

Дополнительная маркировка с указанием
уполномоченного представителя производителя и
номером регистрационного удостоверения

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
_____ ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «МТО Сормовь»
Брукс Е.В.



Фотографические изображения медицинского изделия

Офтальмоскопы не прямые медицинские, в вариантах исполнения с принадлежностями

Производства

**CLEWER HILL ROAD, WINDSOR,
BERKSHIRE, SL4 4AA, United Kingdom,
Великобритания**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МТО» «Стормовь»




Брукс Е.В.

2019 г.

Офтальмоскоп не прямой медицинский Vantage Plus Led Digital в составе:

1. Офтальмоскоп с видеокамерой:


Общий вид.

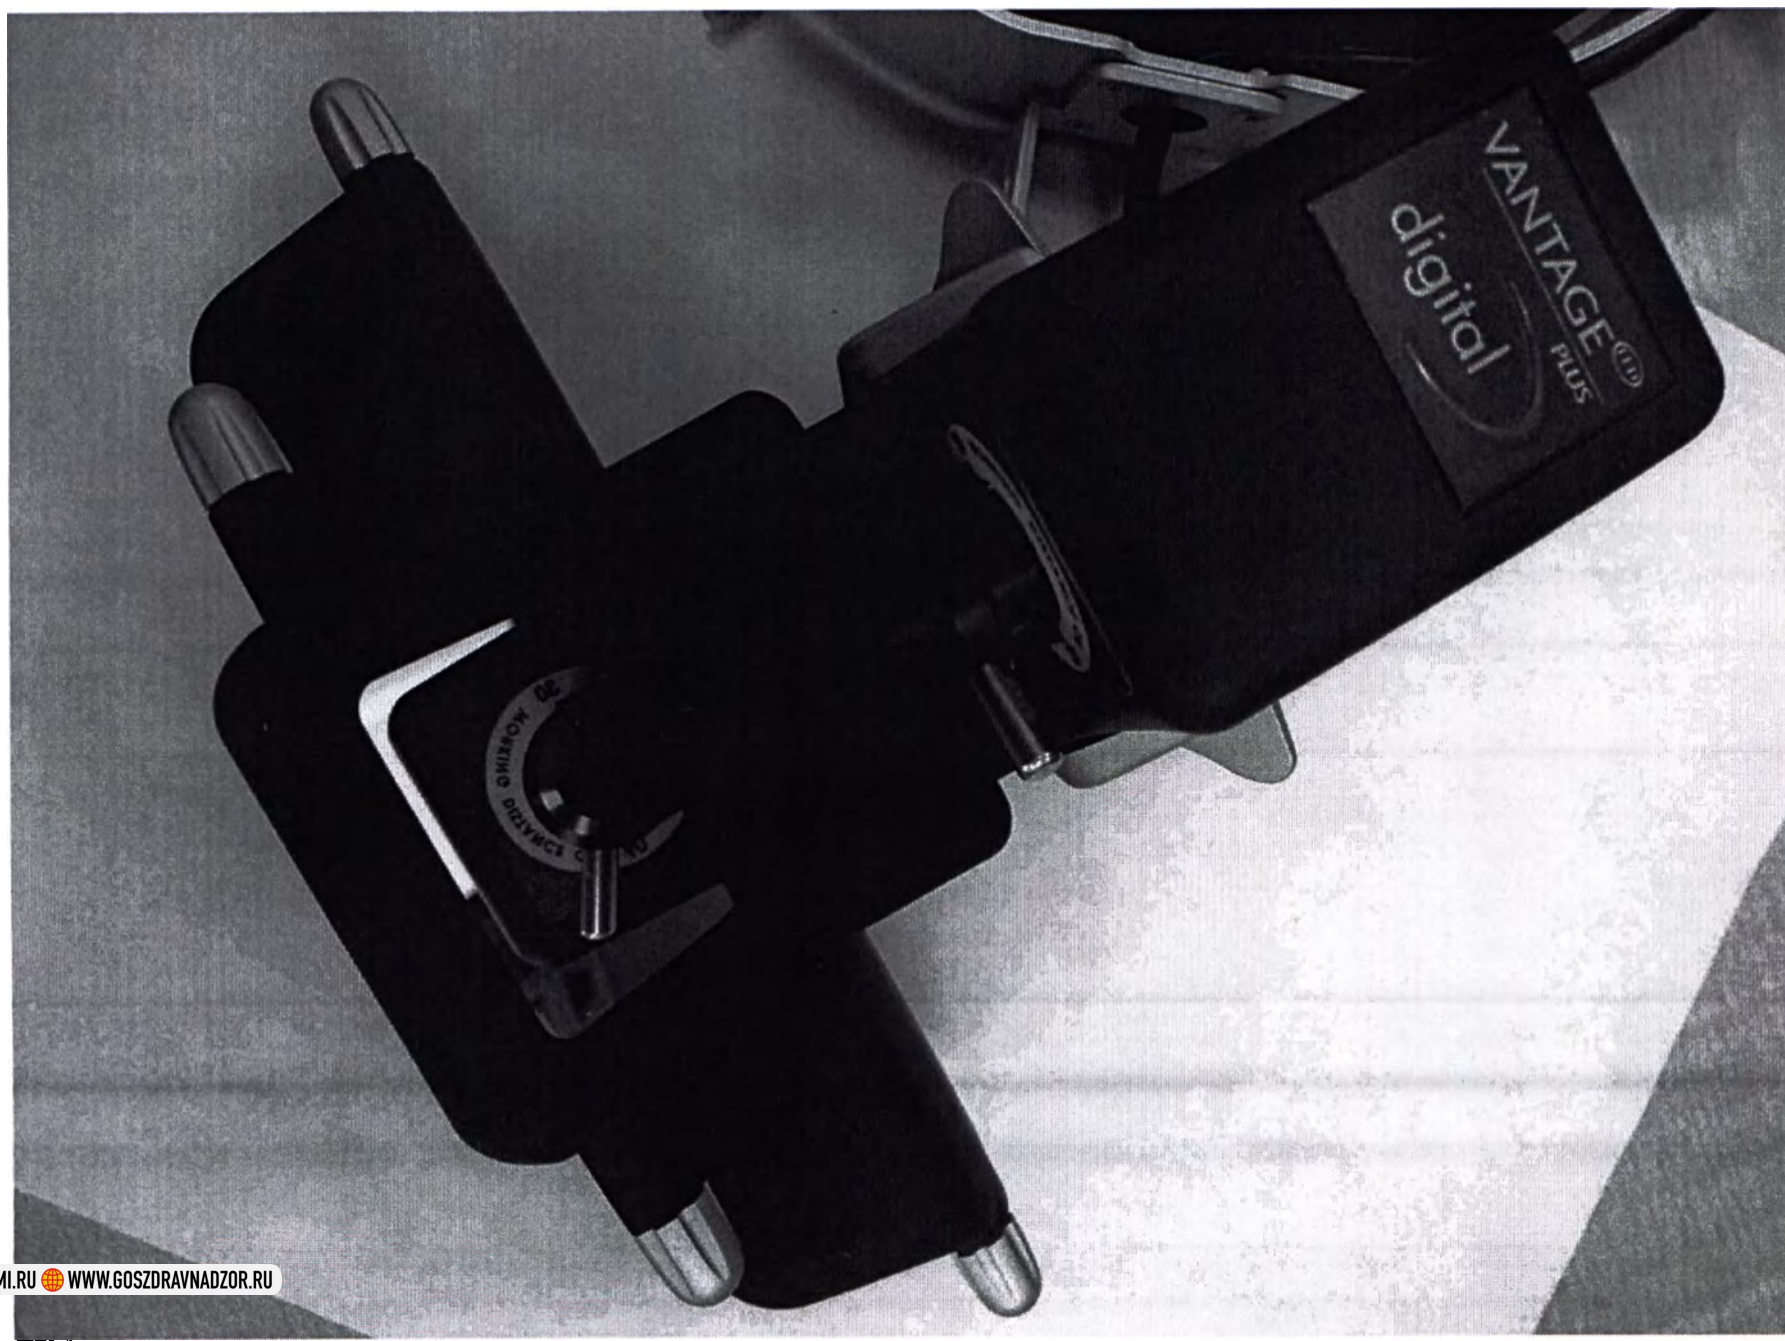

2. Обруч головной:

Общий вид.



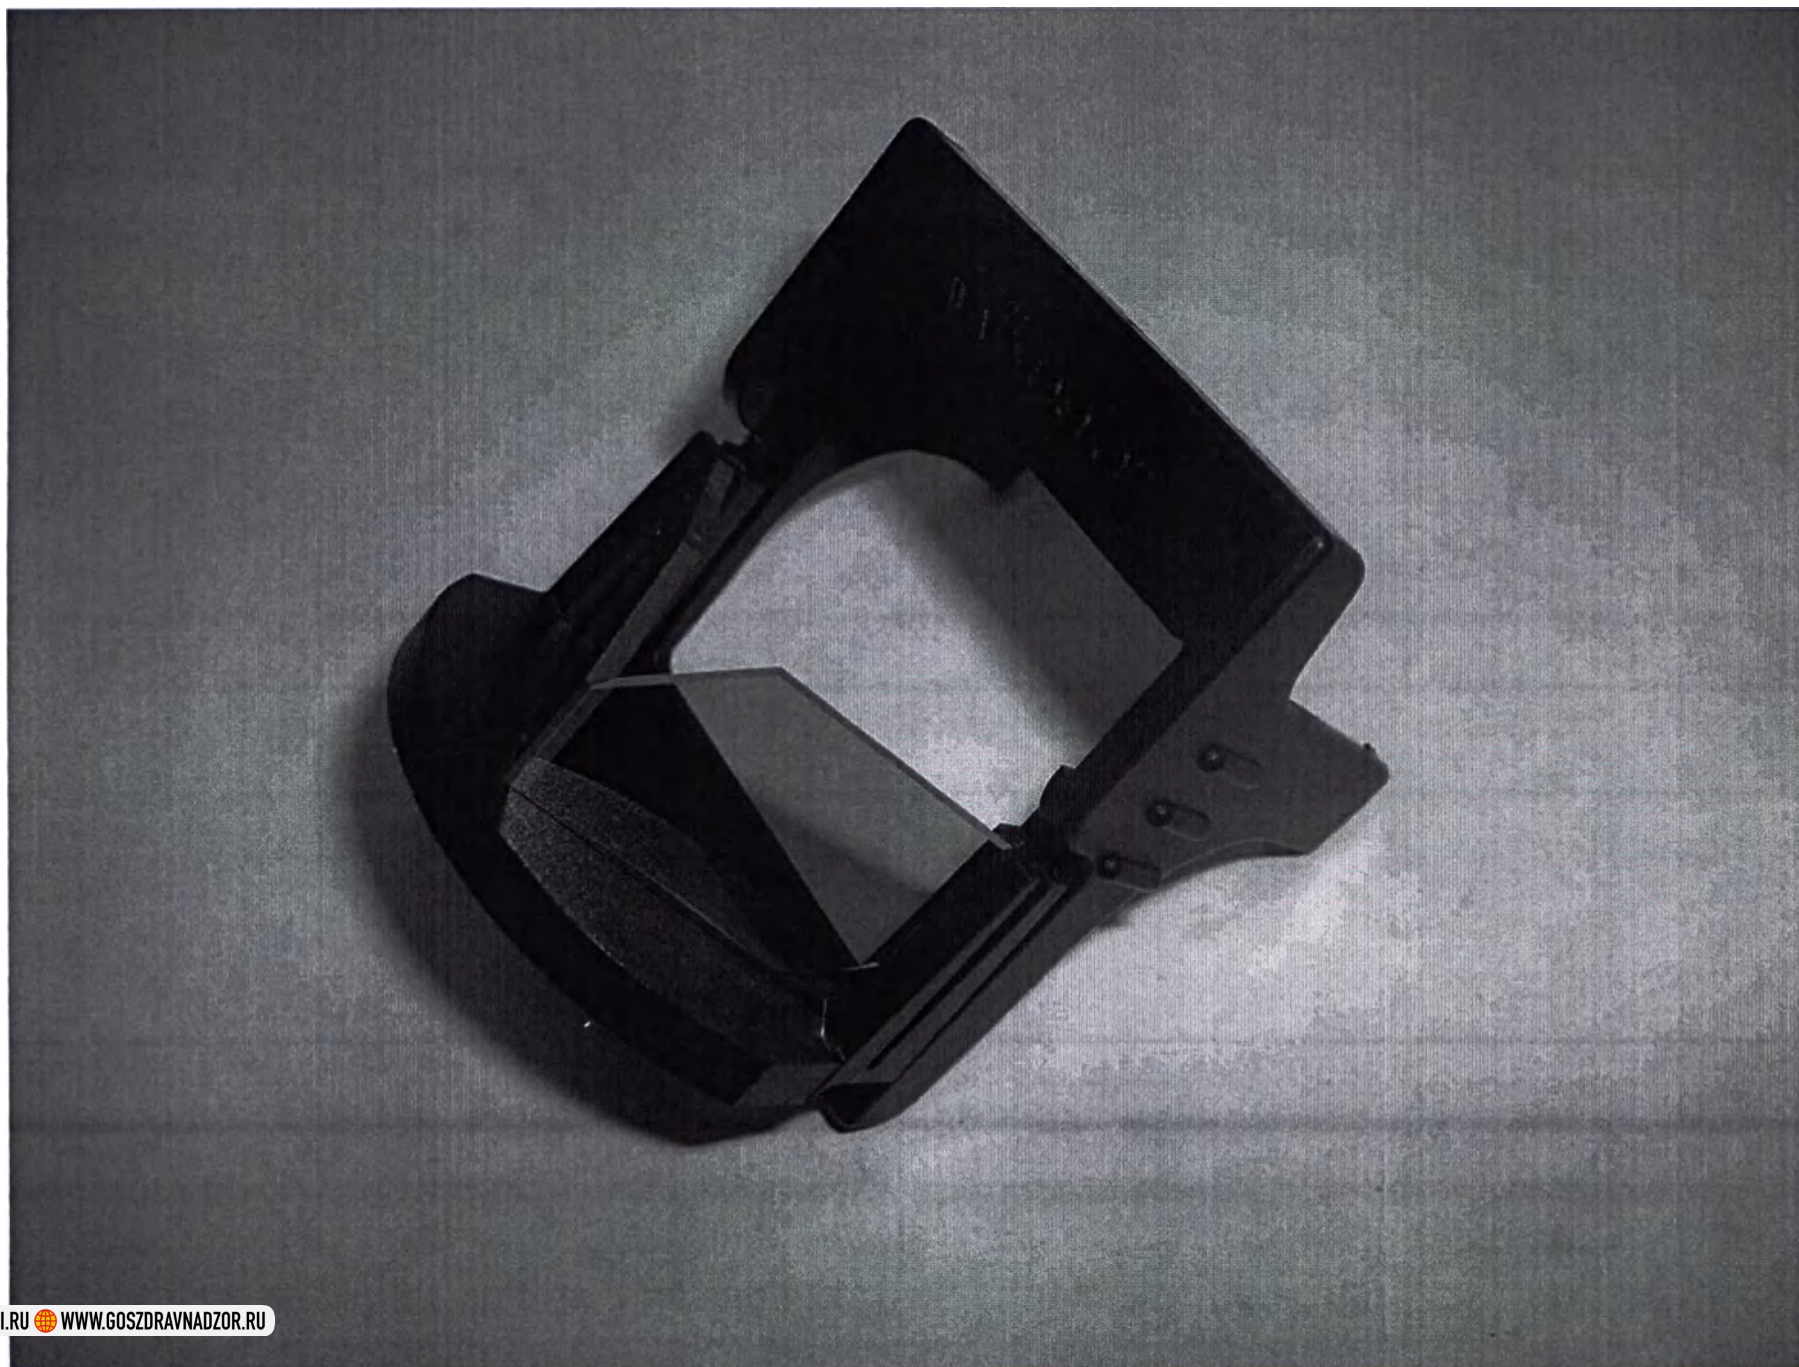

4. Руководство по эксплуатации:

Общий вид.



Принадлежности для офтальмоскопа непрямого медицинского Vantage Plus Led Digital


1. Линза HiMag Lens с 1,6 х увеличением:


Общий вид.



2. Источник света светодиодный:


Общий вид.

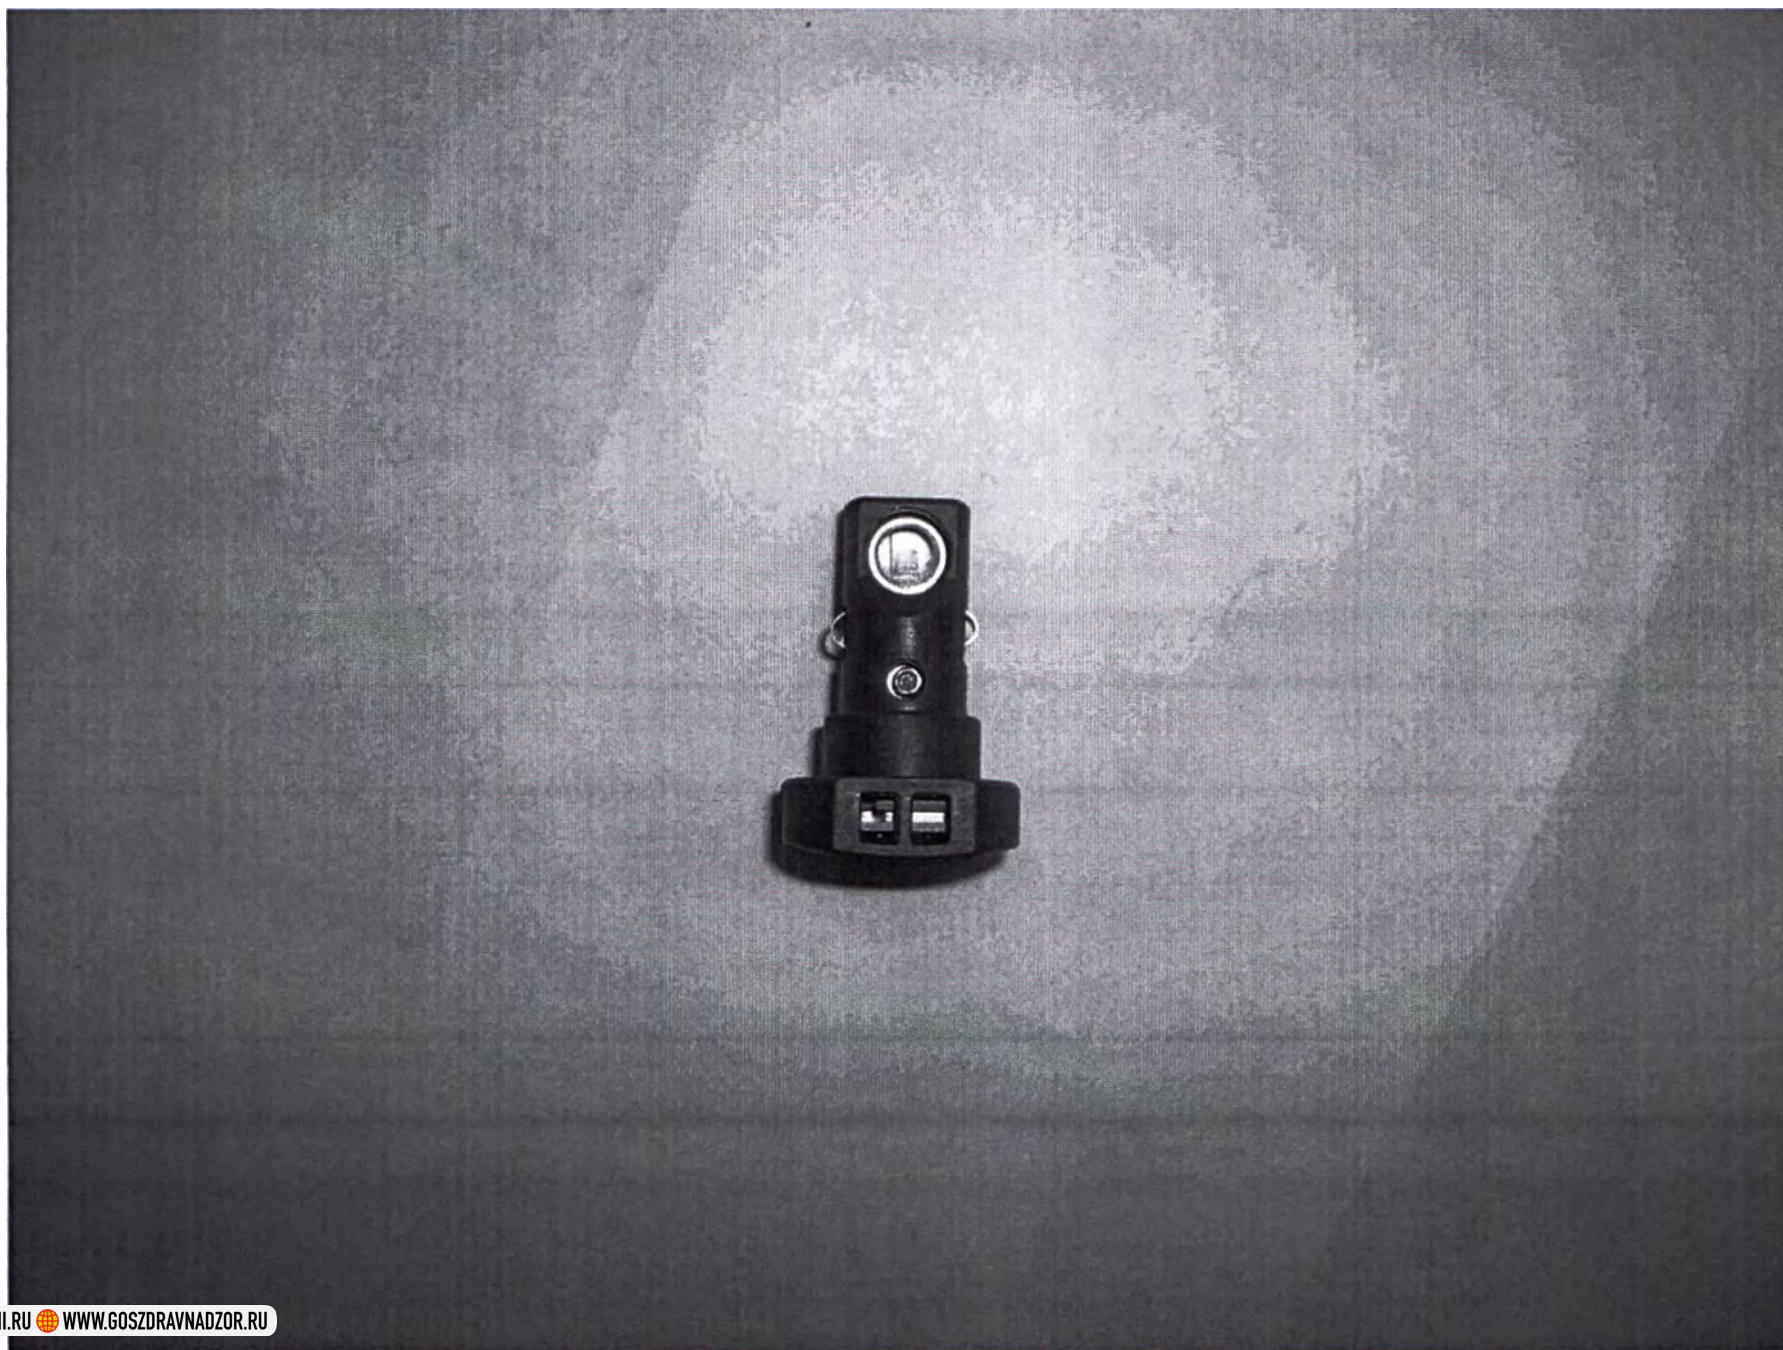

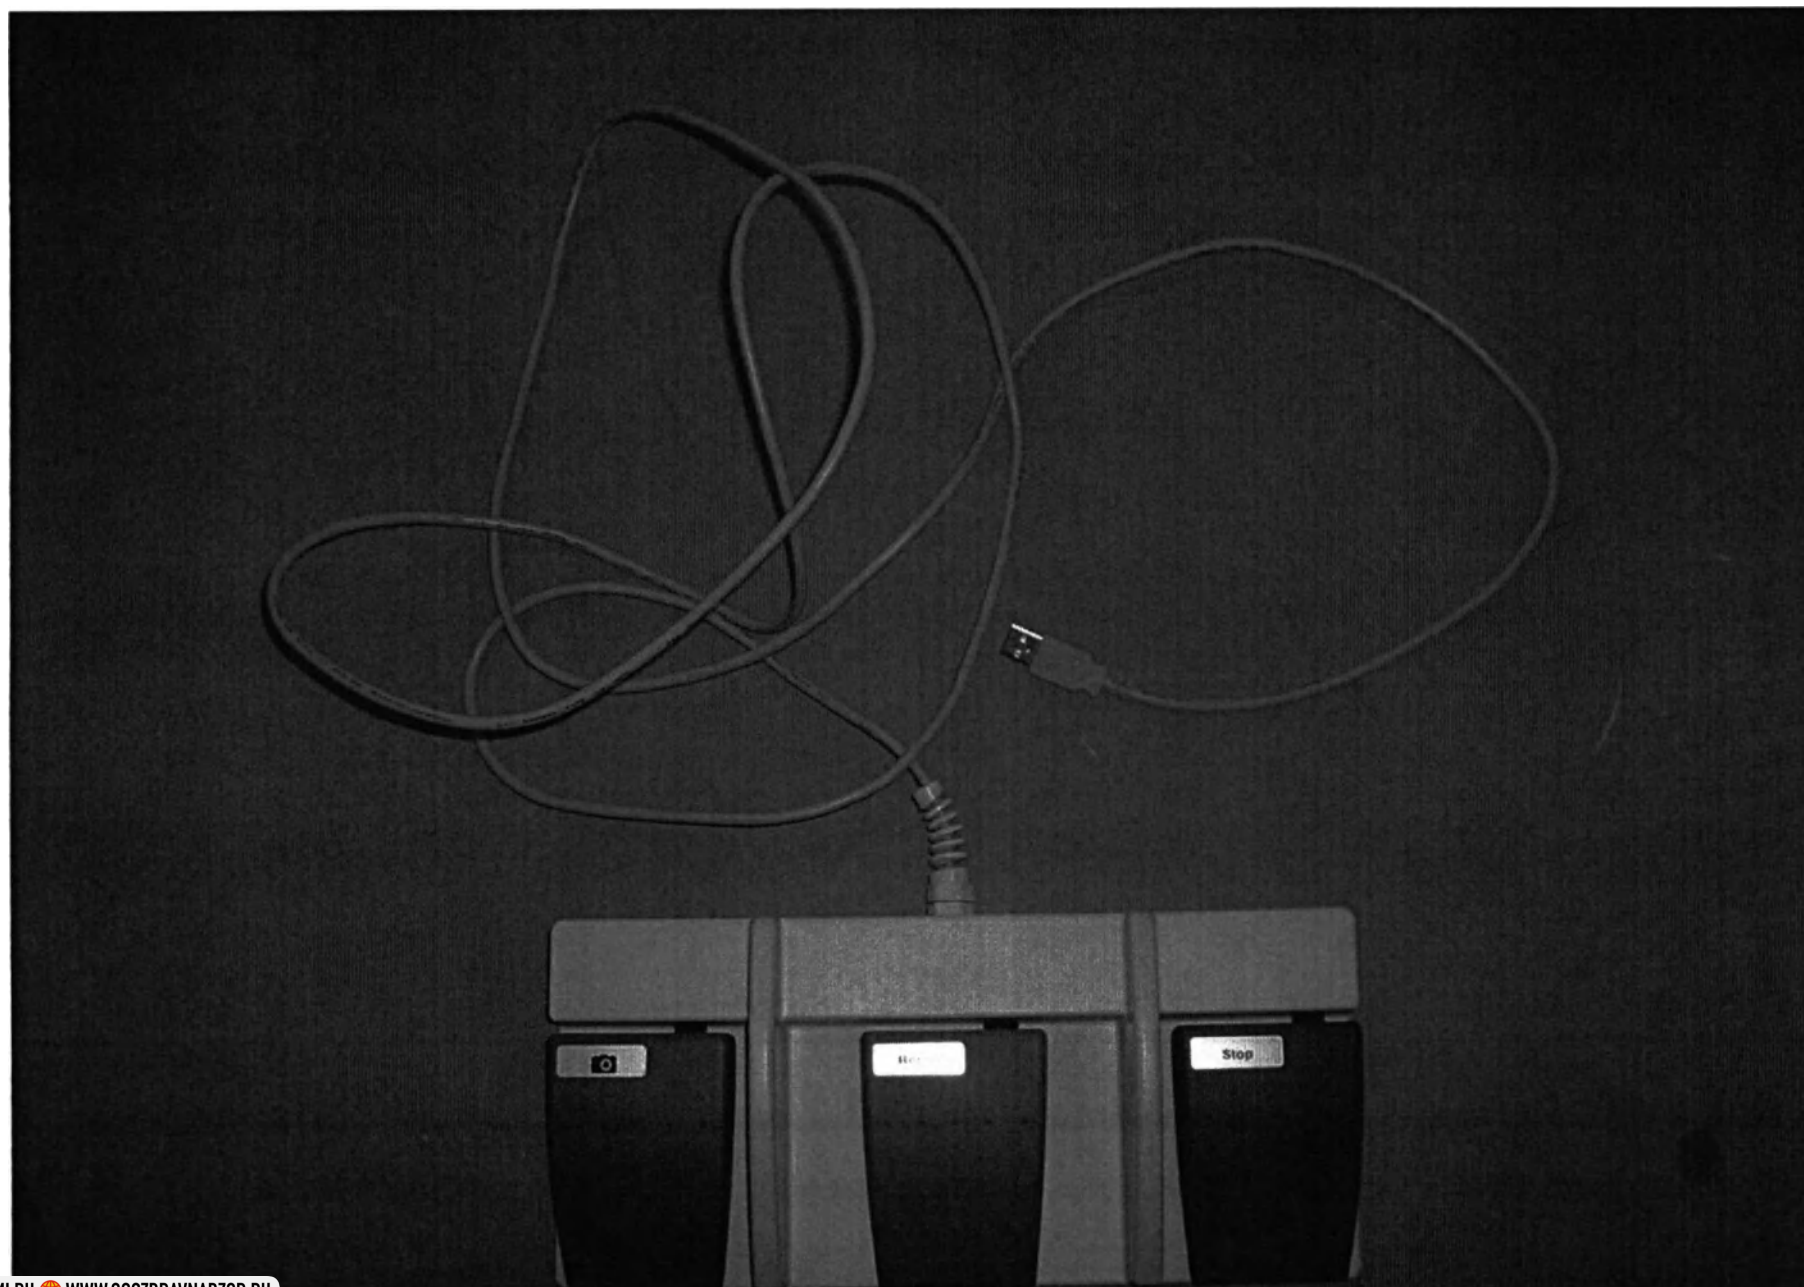

4. Депрессор склеральный малый:

Общий вид.

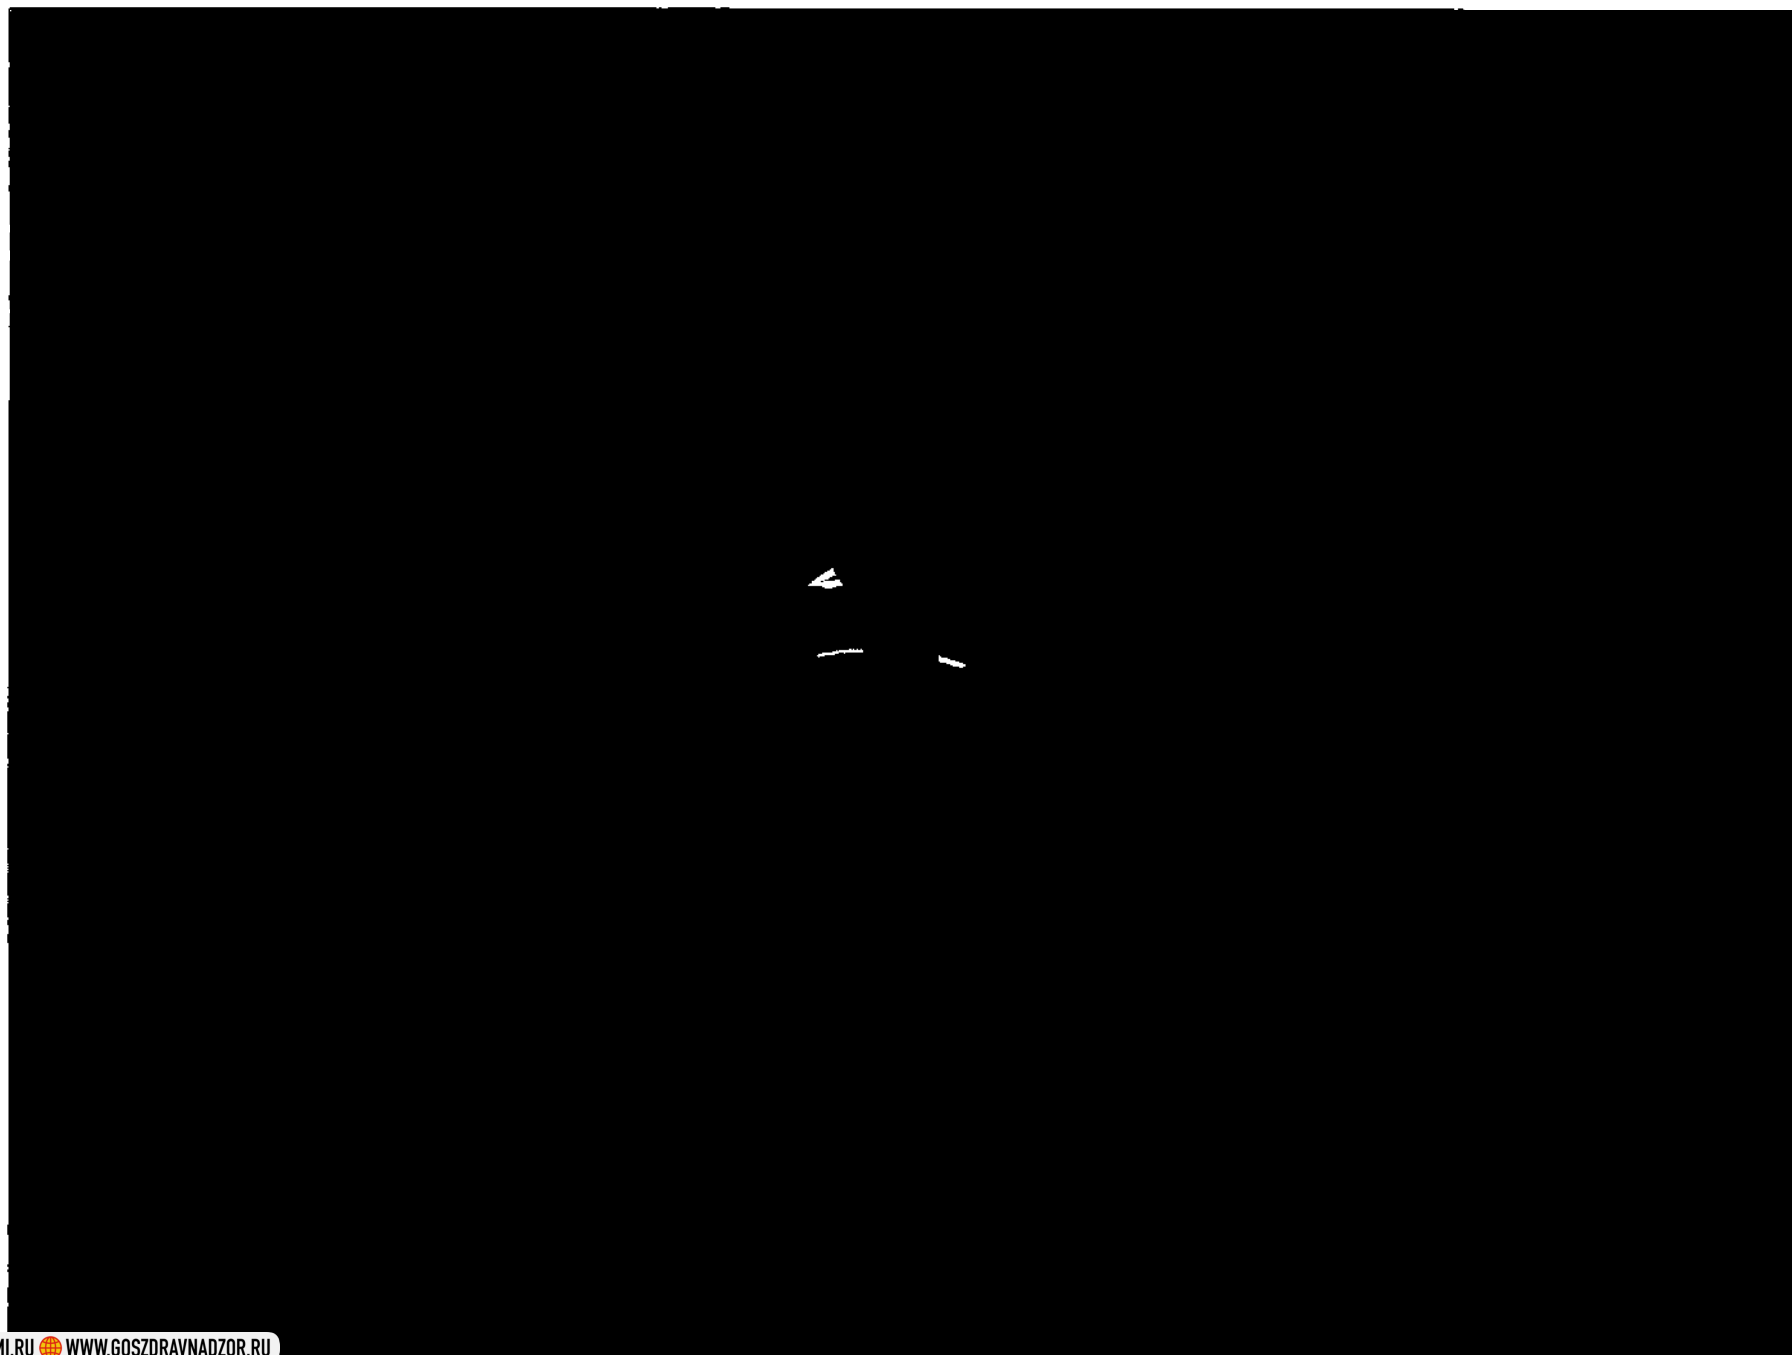

5. Депрессор склеральный большой:


Общий вид.






7. Резиновая оправа окуляров:

Общий вид.

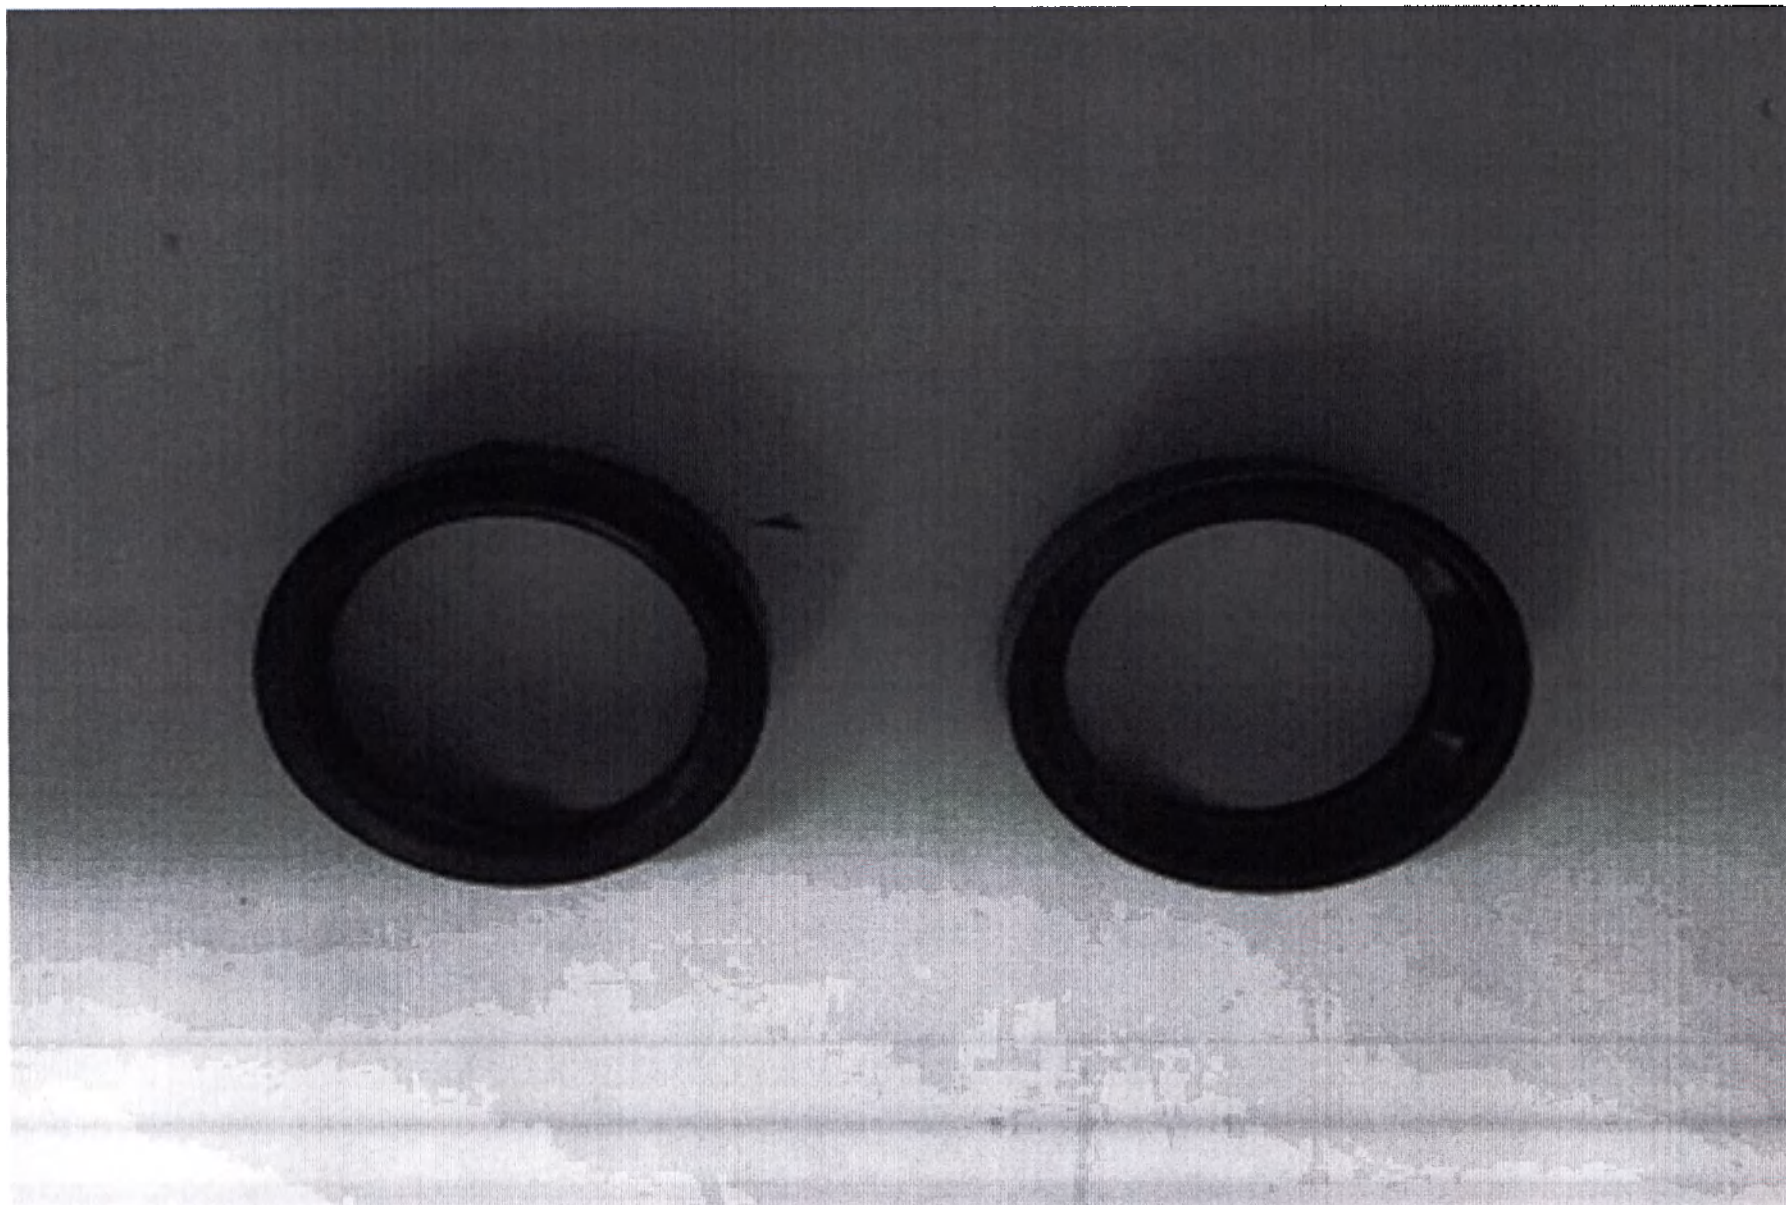

8. Пульт дистанционного управления:

Общий вид.

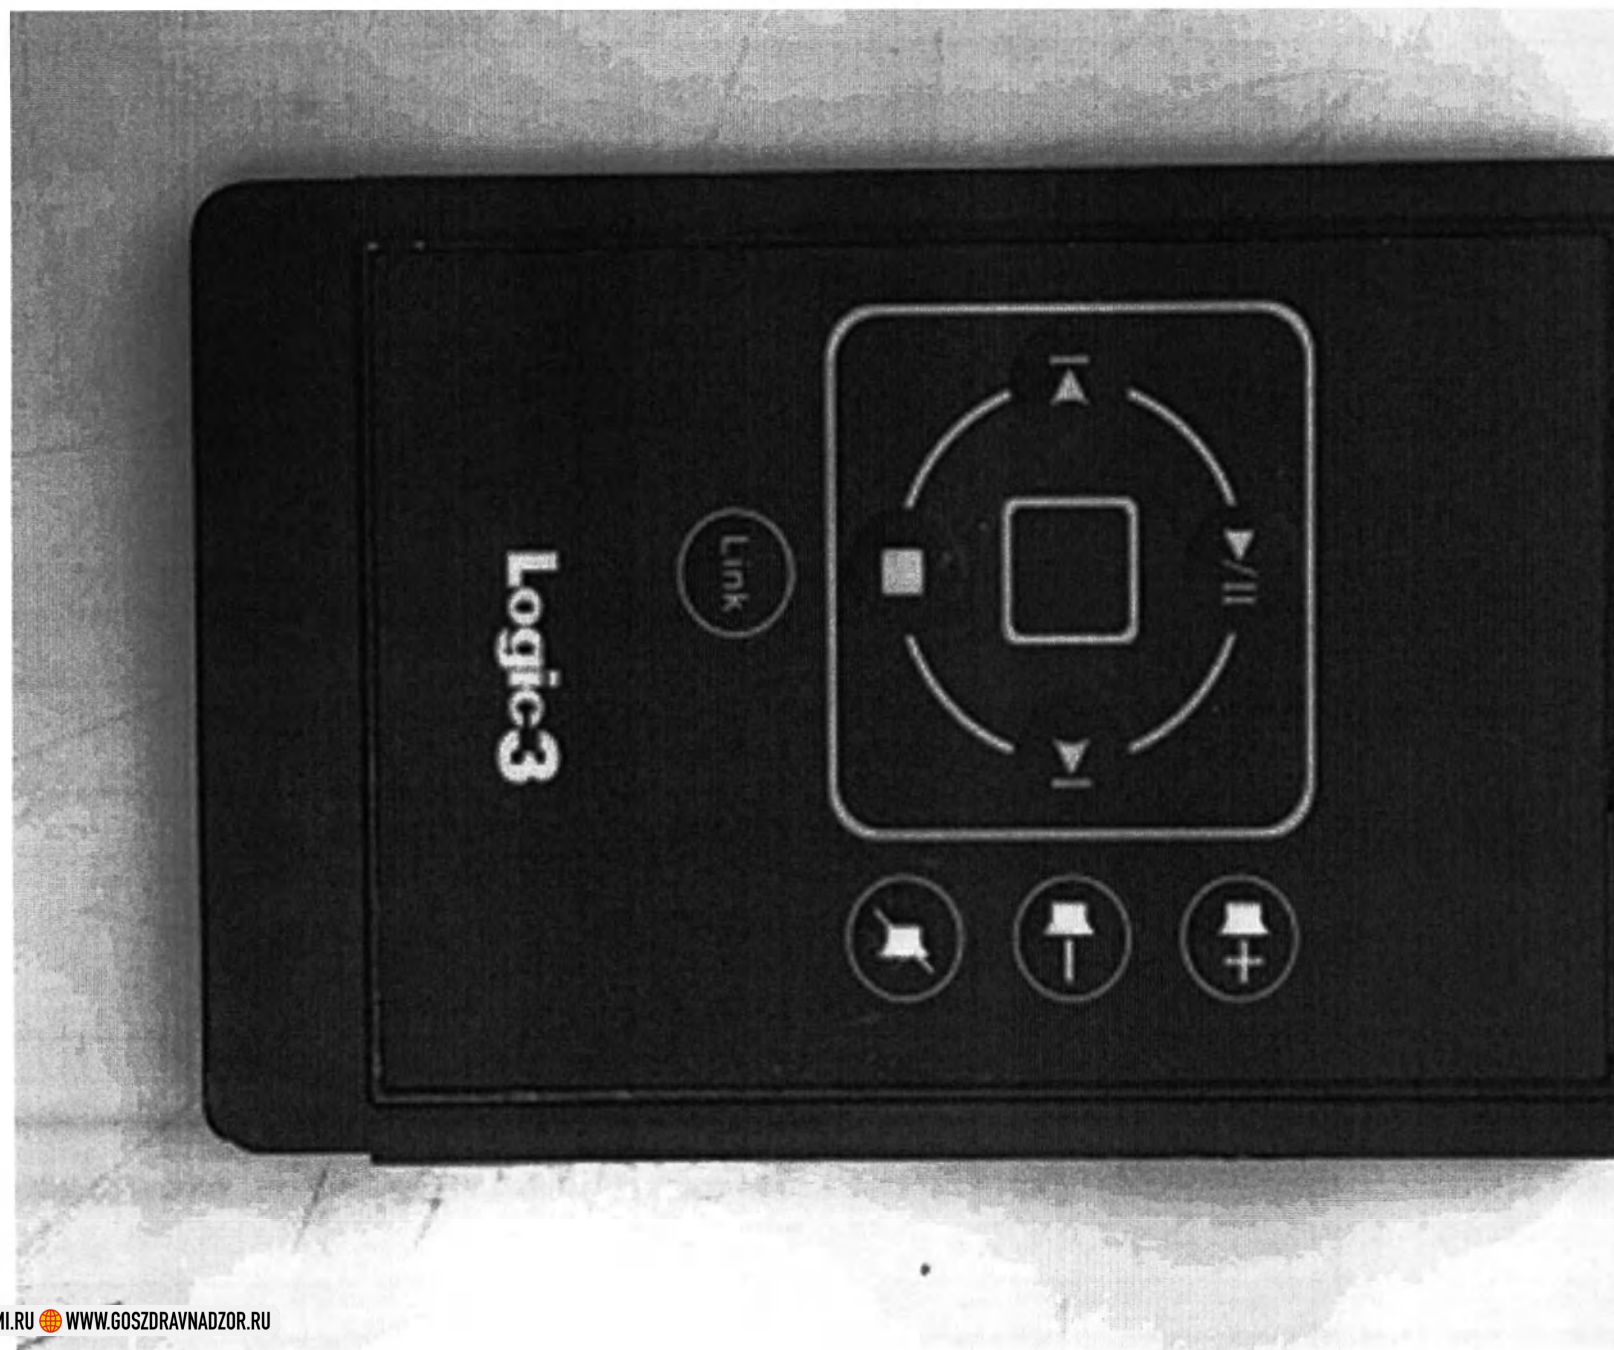



10. Блок зарядный:**Общий вид.**

11. Адаптер сетевой:

Общий вид.



12. Набор сетевых переходников: (вилка для Австралии – 1 шт.; вилка для США – 1 шт.; **Общий вид.**
вилка для Европы – 1 шт.; вилка для Великобритании – 1 шт.):



13. Набор для крепления блока питания (дюбель – 3 шт.; шуруп – 3 шт.;
самоклеящаяся накладка – 1 шт.):

Общий вид.



14. Кейс транспортный:

Общий вид.



15. Салфетка тканная для объектива:**Общий вид.**

16. Кабель передачи данных USB:

Общий вид.



17. Программное обеспечение для передачи и обработки данных

Общий вид.



18. Насадка трансиллюминаторная Finoff:


Общий вид.





20. Диск с руководством по эксплуатации:

Общий вид.

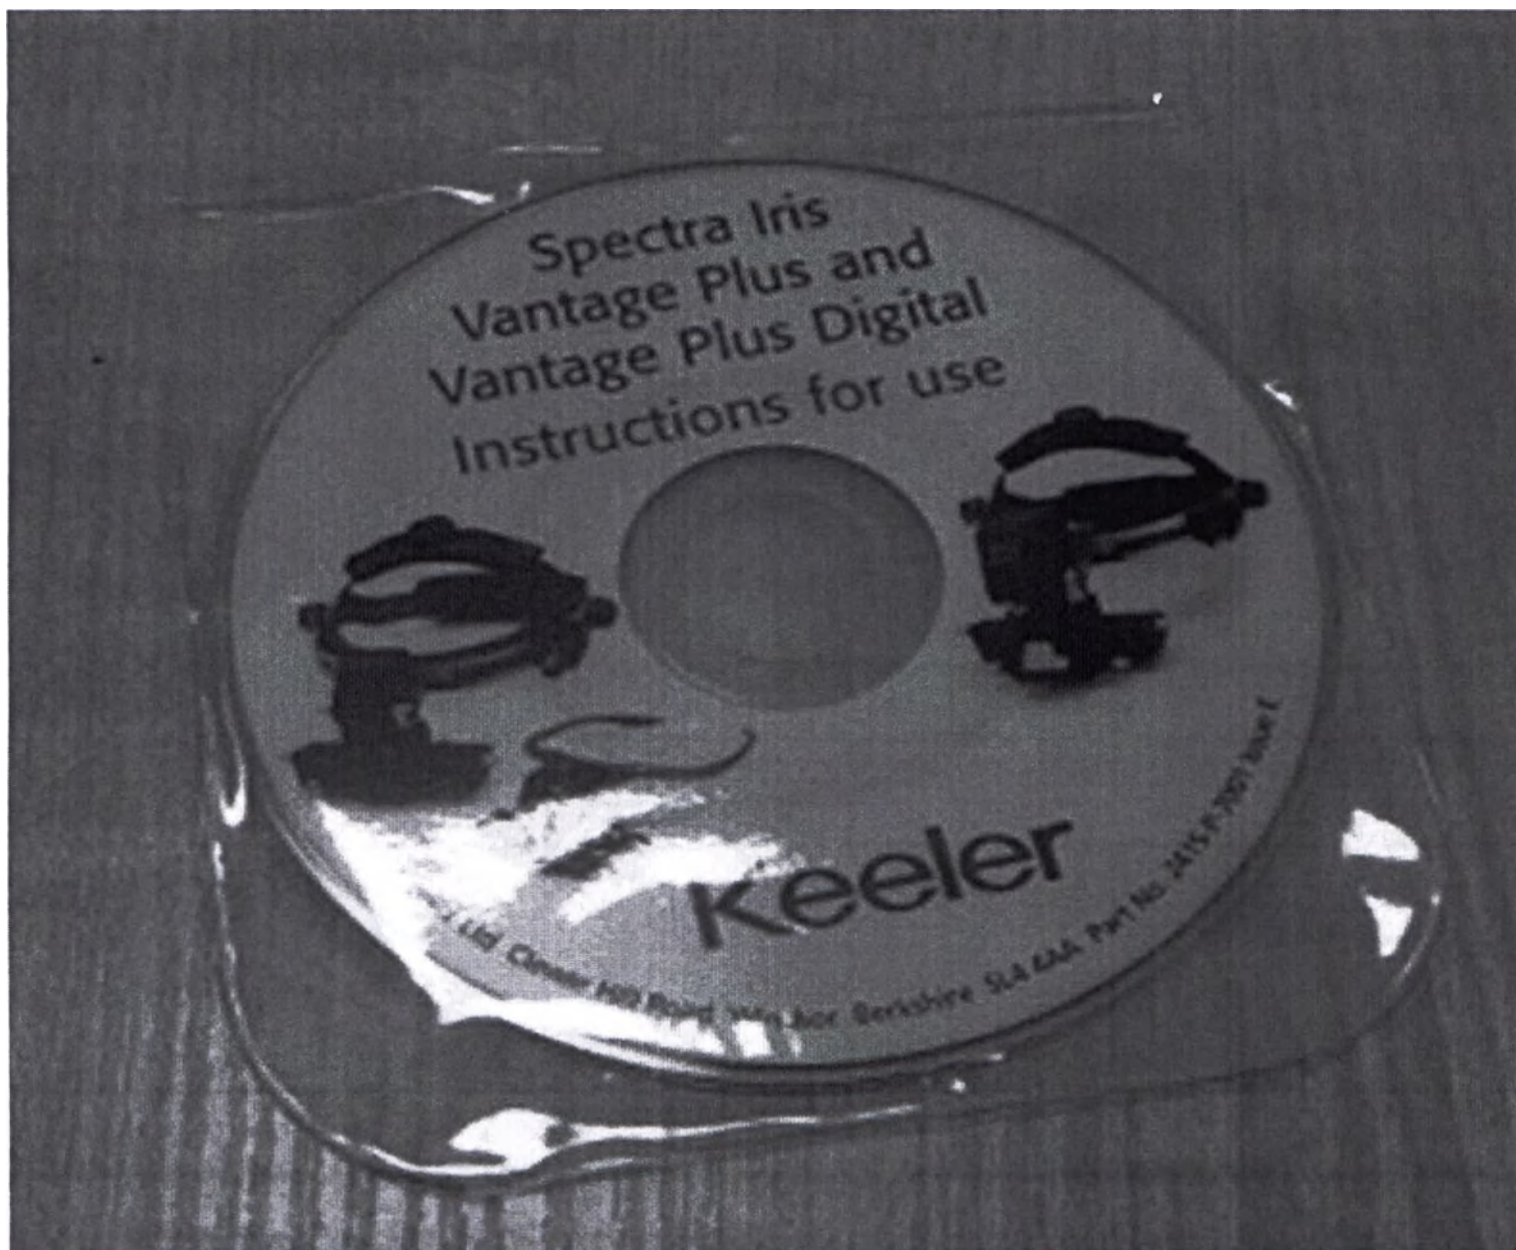

Офтальмоскоп не прямой медицинский Vantage Plus Led в составе:

1. Офтальмоскоп:

Общий вид.




2. Обруч головной:

Общий вид.



3. Обучающее зеркало:

Общий вид.

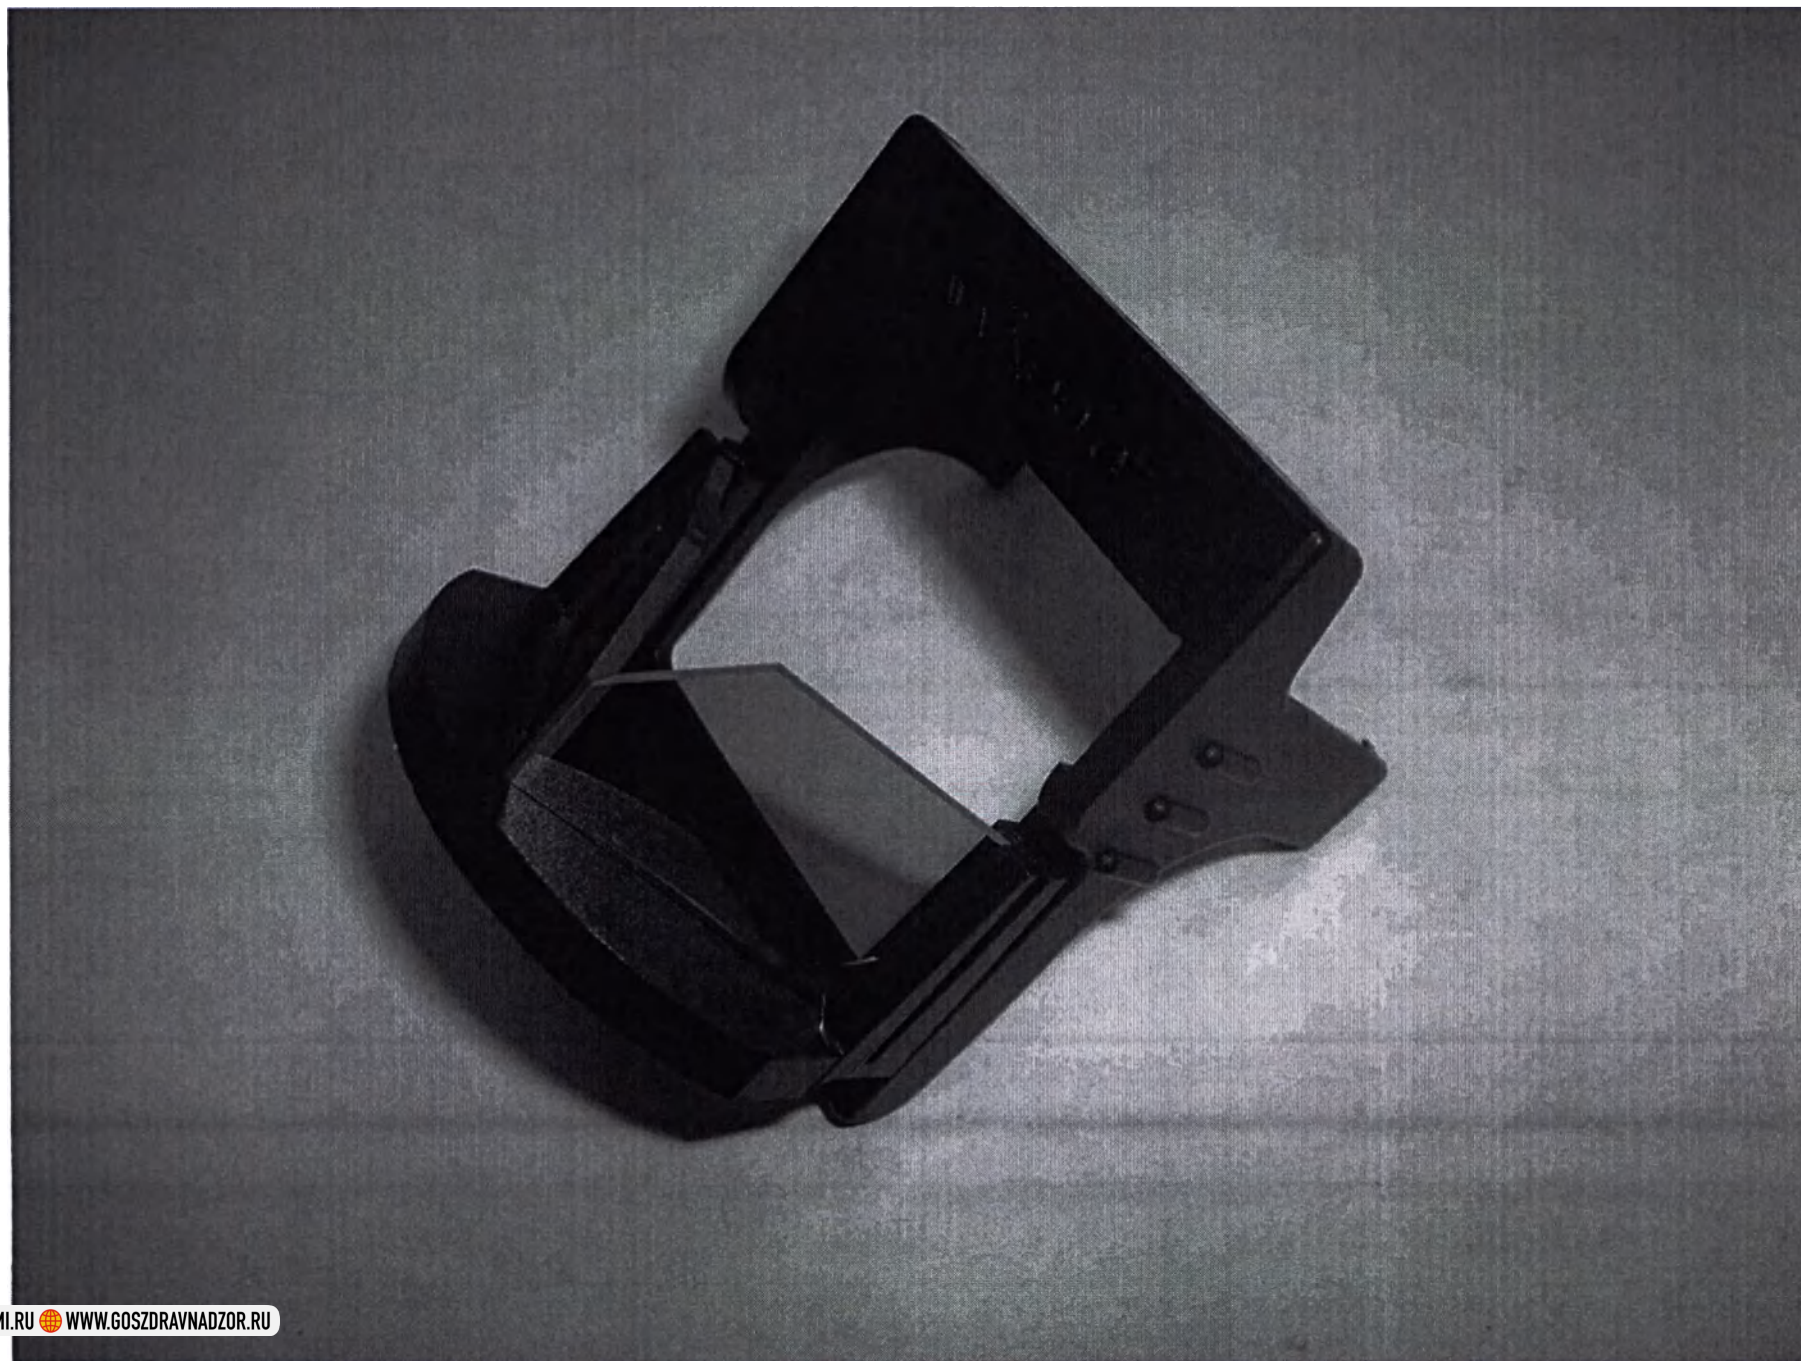

4. Руководство по эксплуатации

Общий вид.



Принадлежности для офтальмоскопа непрямого медицинского Vantage Plus Led:

1. Линза HiMag Lens с 1,6 х увеличением:


Общий вид.



2.Источник света светодиодный:**Общий вид.**

3. Депрессор склеральный малый:


Общий вид.

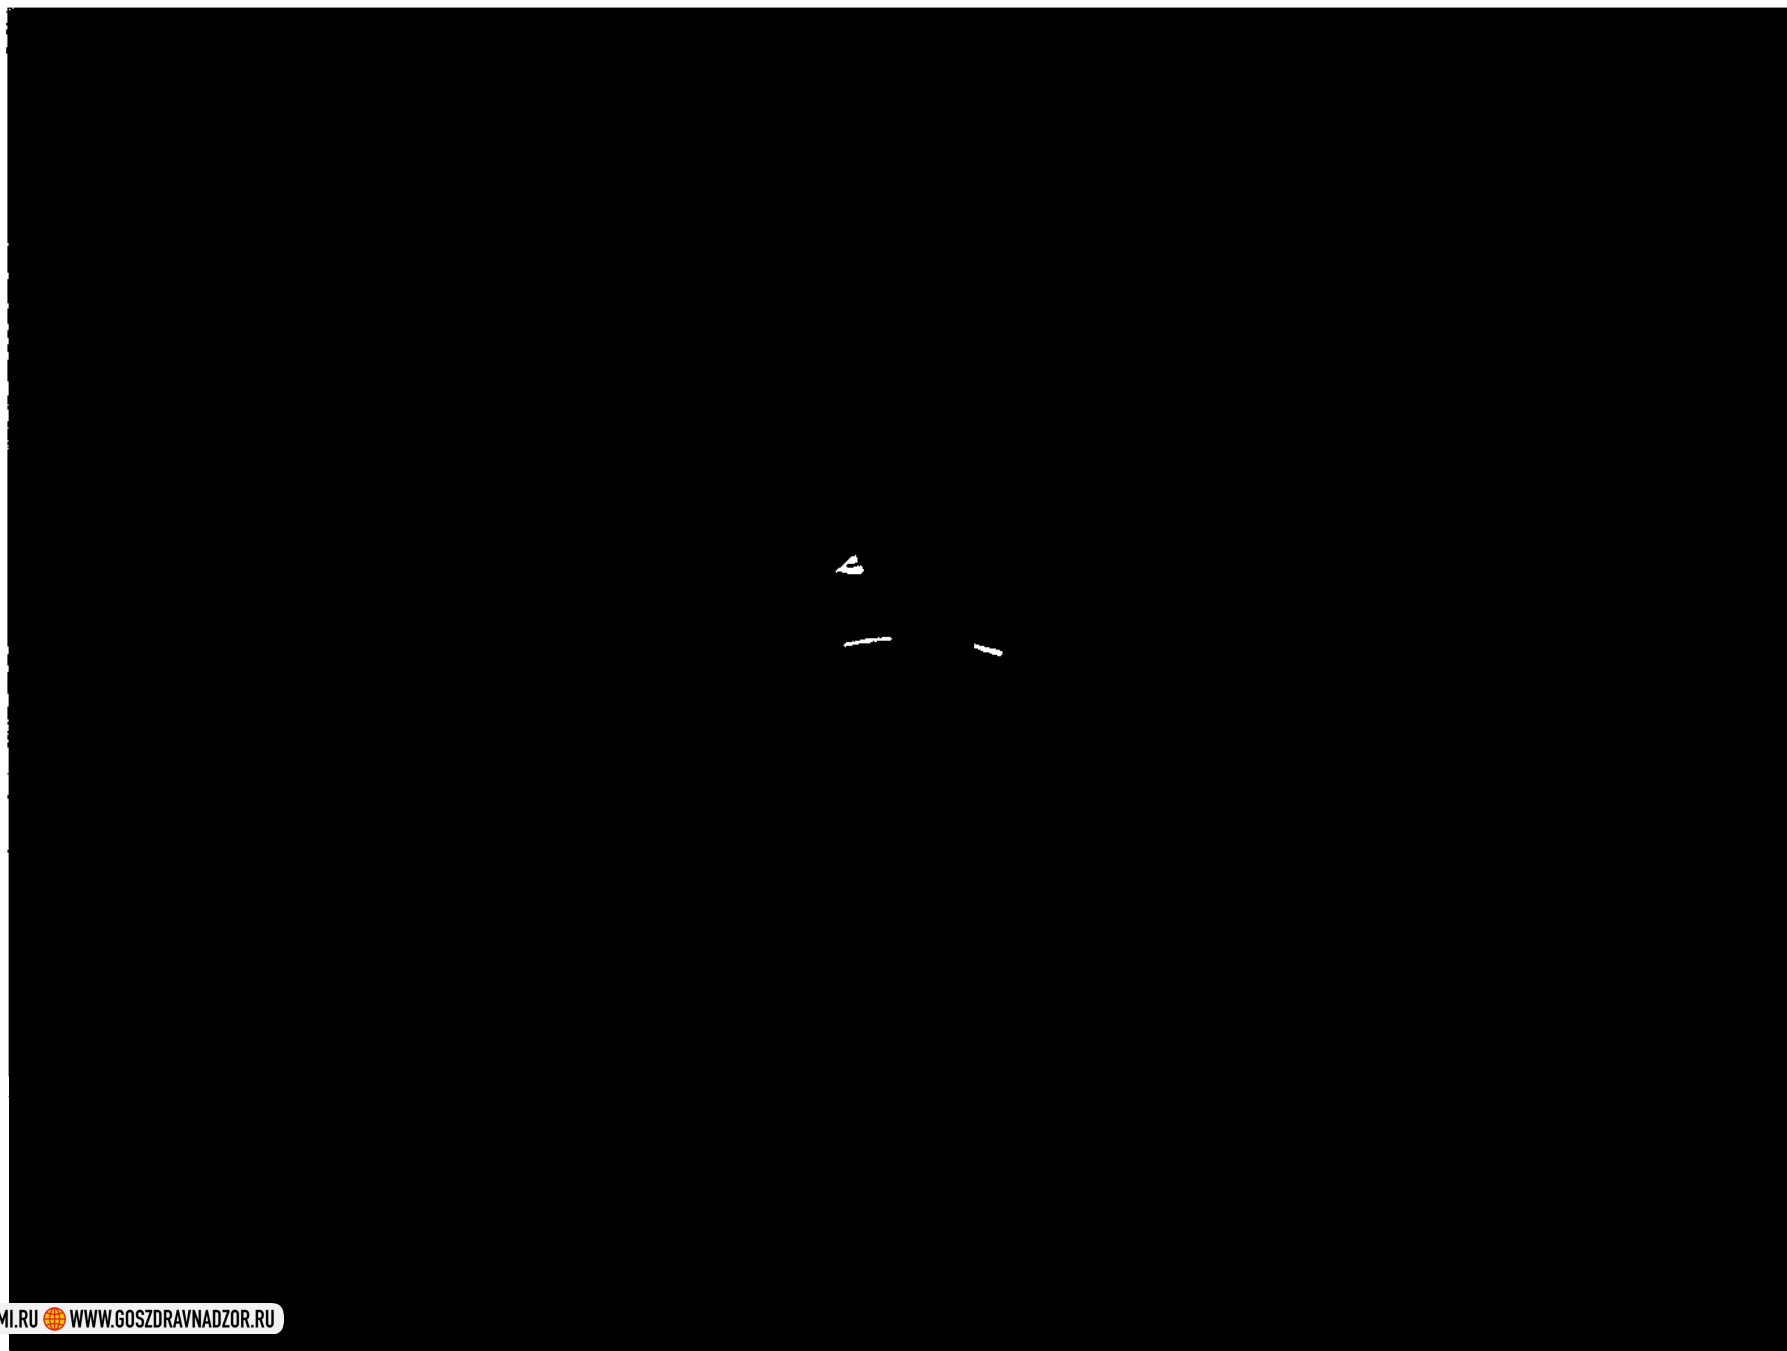

4. Депрессор склеральный большой:


Общий вид.



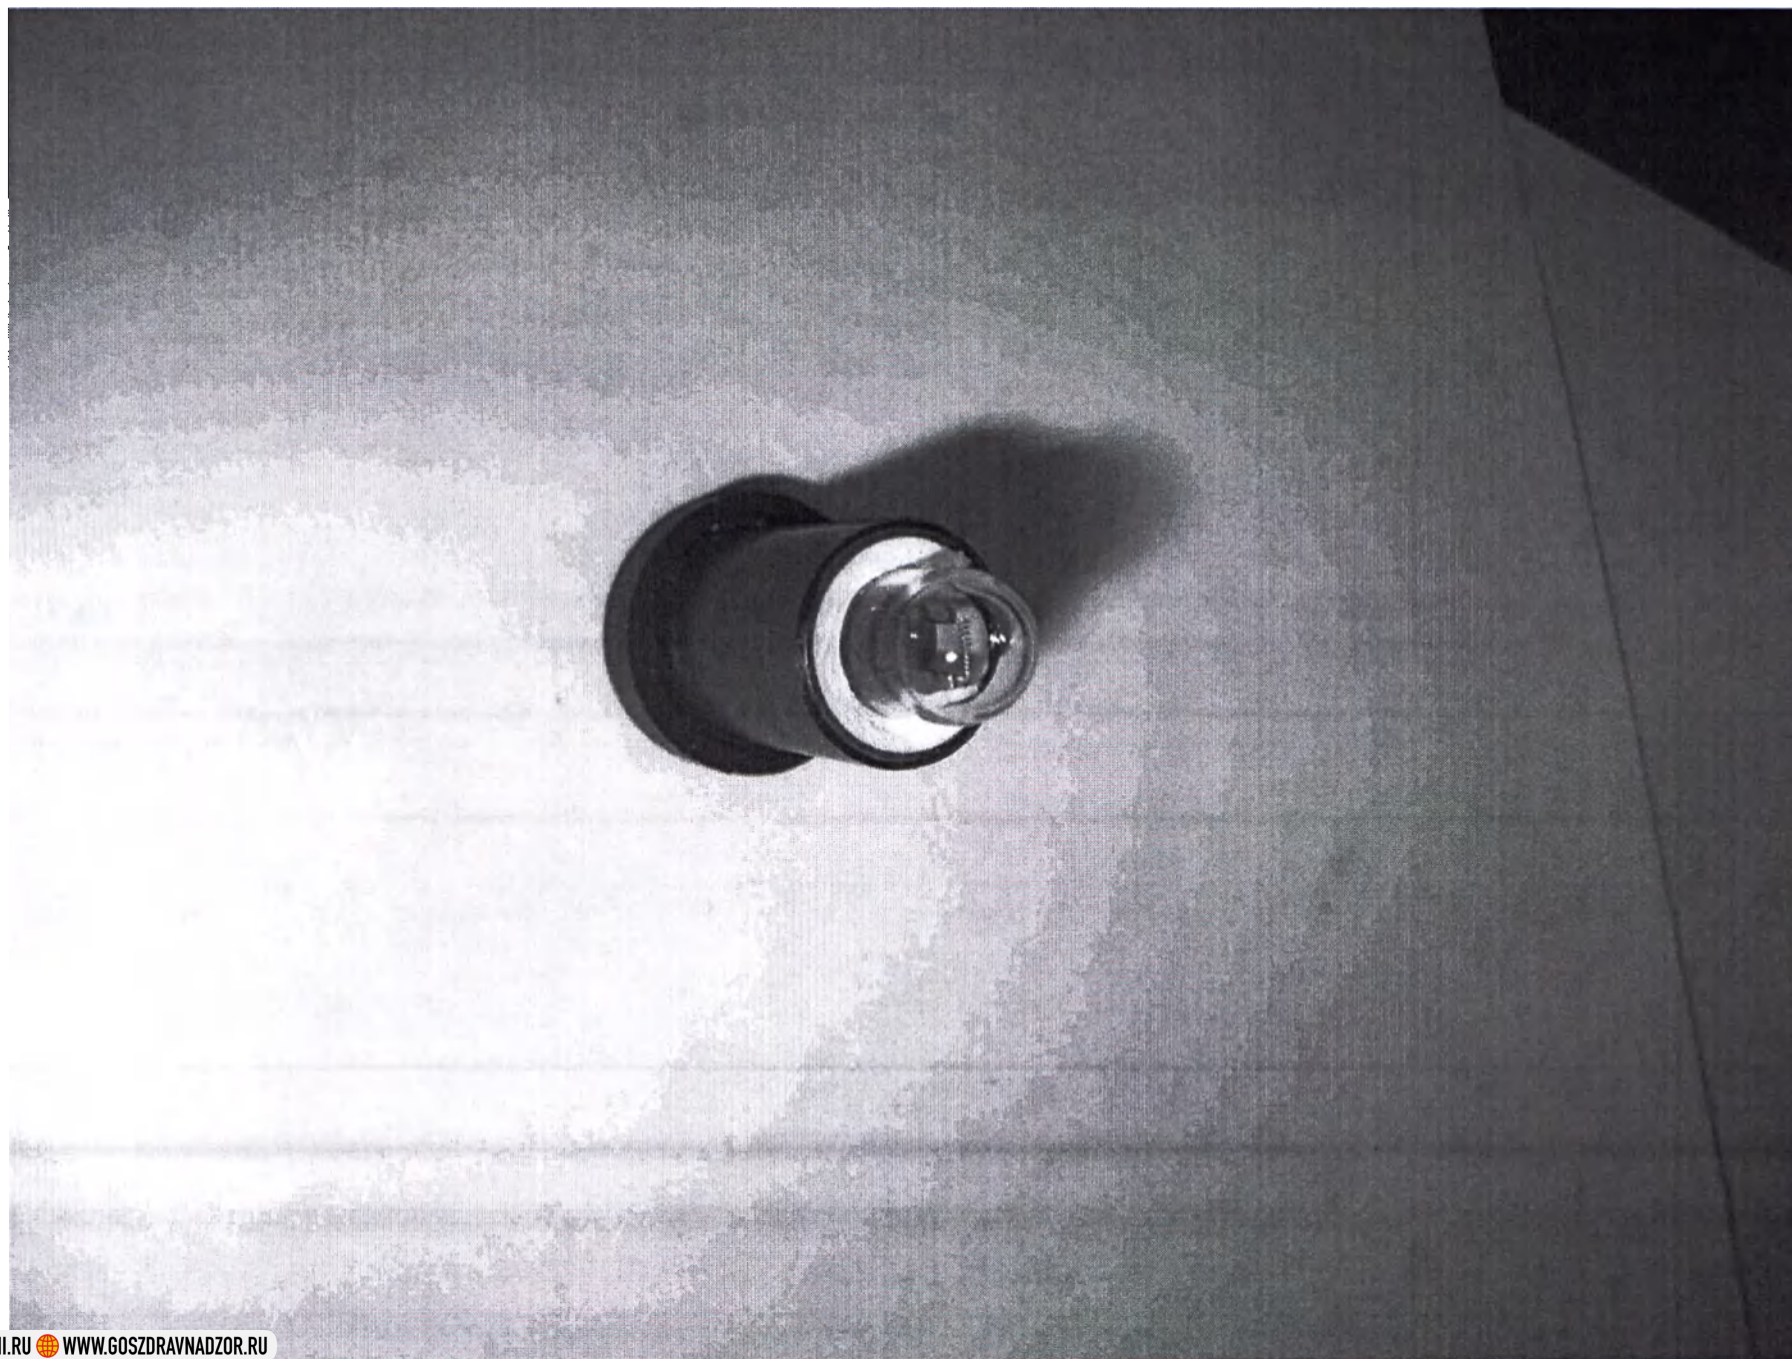

6.Резиновая оправа окуляров:

Общий вид.

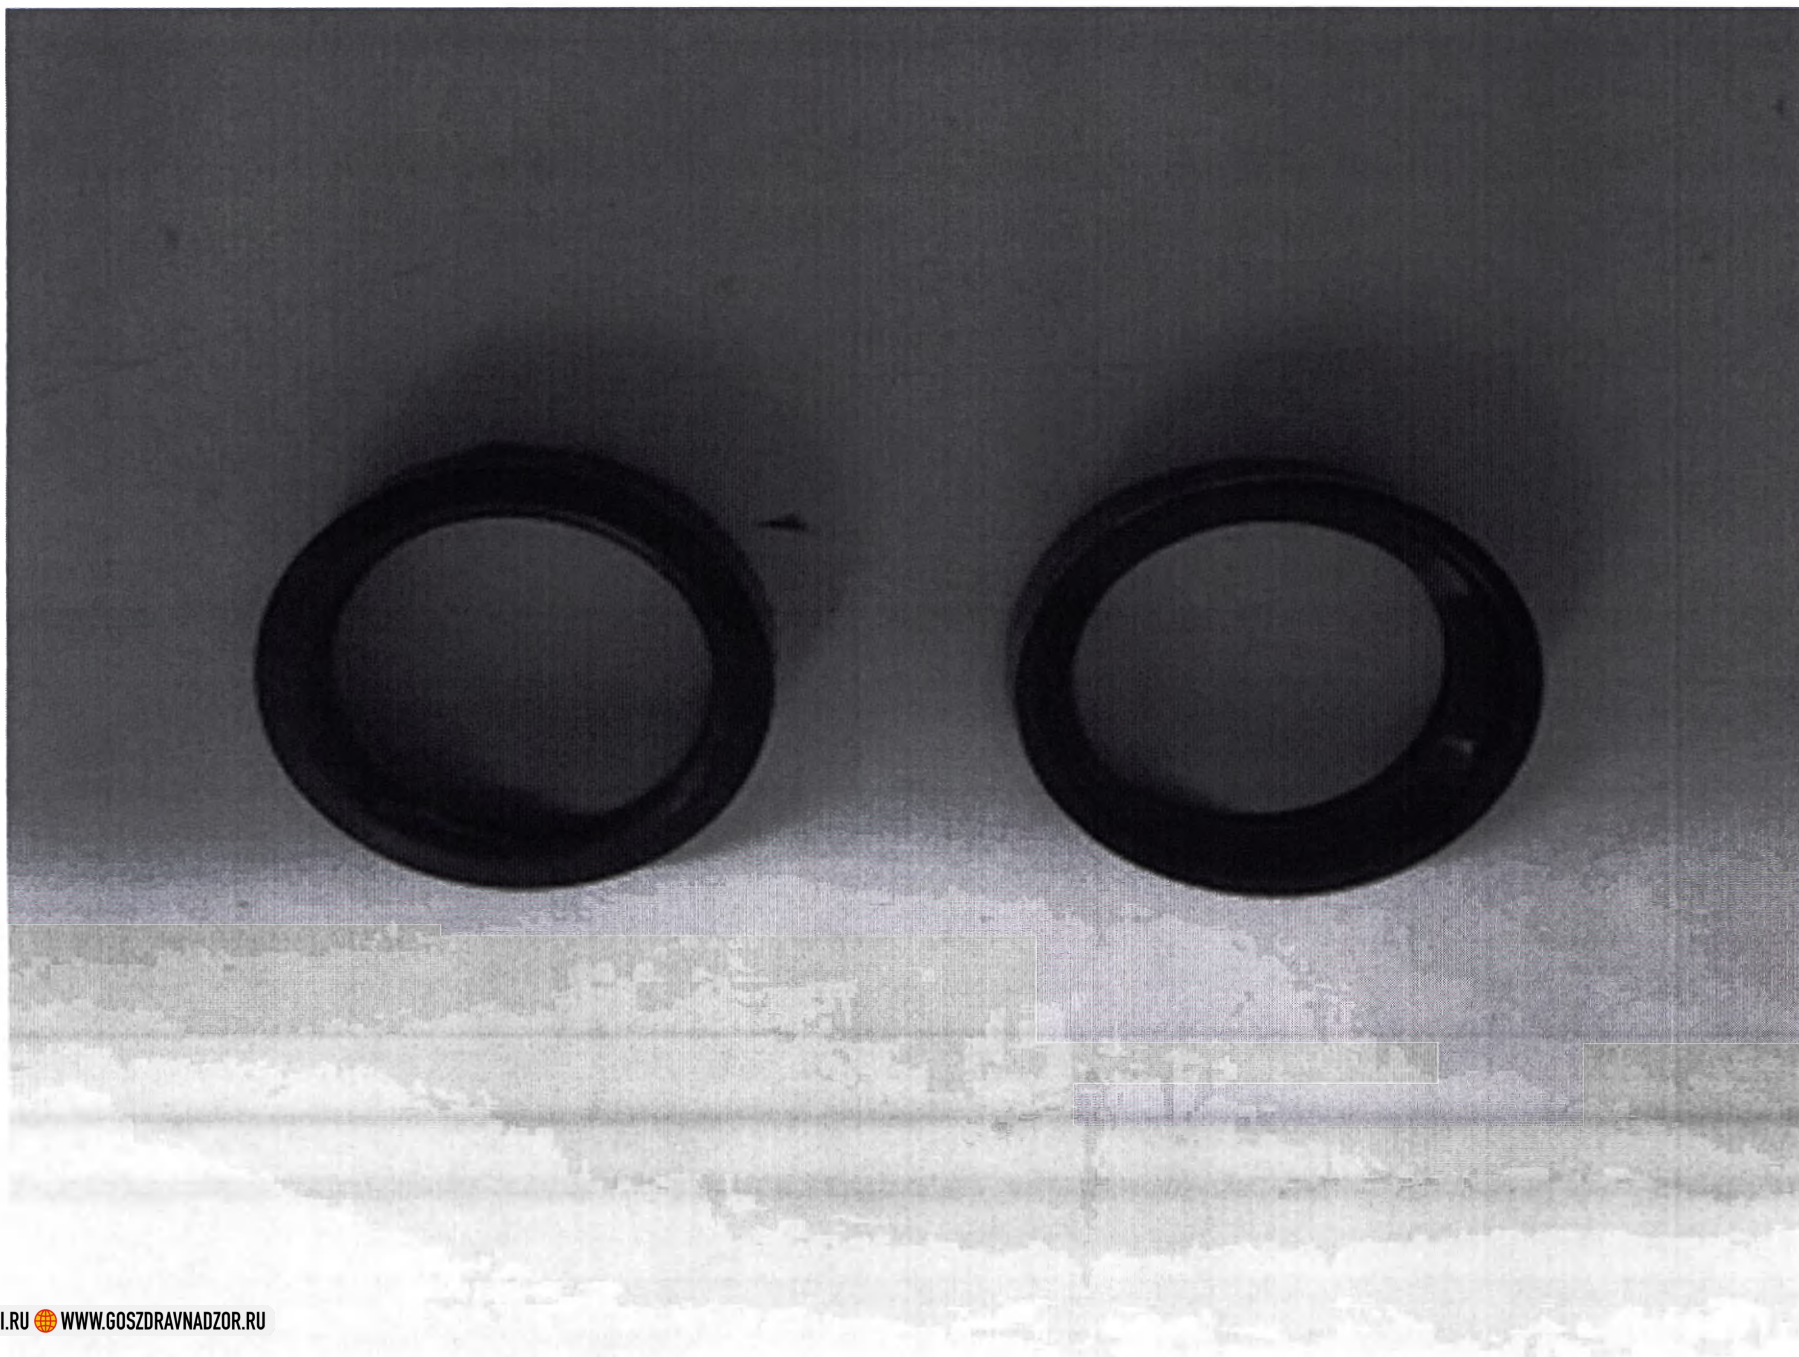







10.Набор сетевых переходников: (вилка для Австралии – 1 шт.; вилка для США – 1 шт.;
вилка для Европы – 1 шт.; вилка для Великобритании – 1 шт.):

Общий вид.



11. Набор для крепления блока питания (дюбель – 3 шт.; шуруп – 3 шт.;
самоклеящаяся накладка – 1 шт.)

Общий вид.



12. Кейс транспортный:

Общий вид.




13. Салфетка тканная для объектива:


Общий вид.



14. Насадка трансиллюминаторная Finoff:


Общий вид.

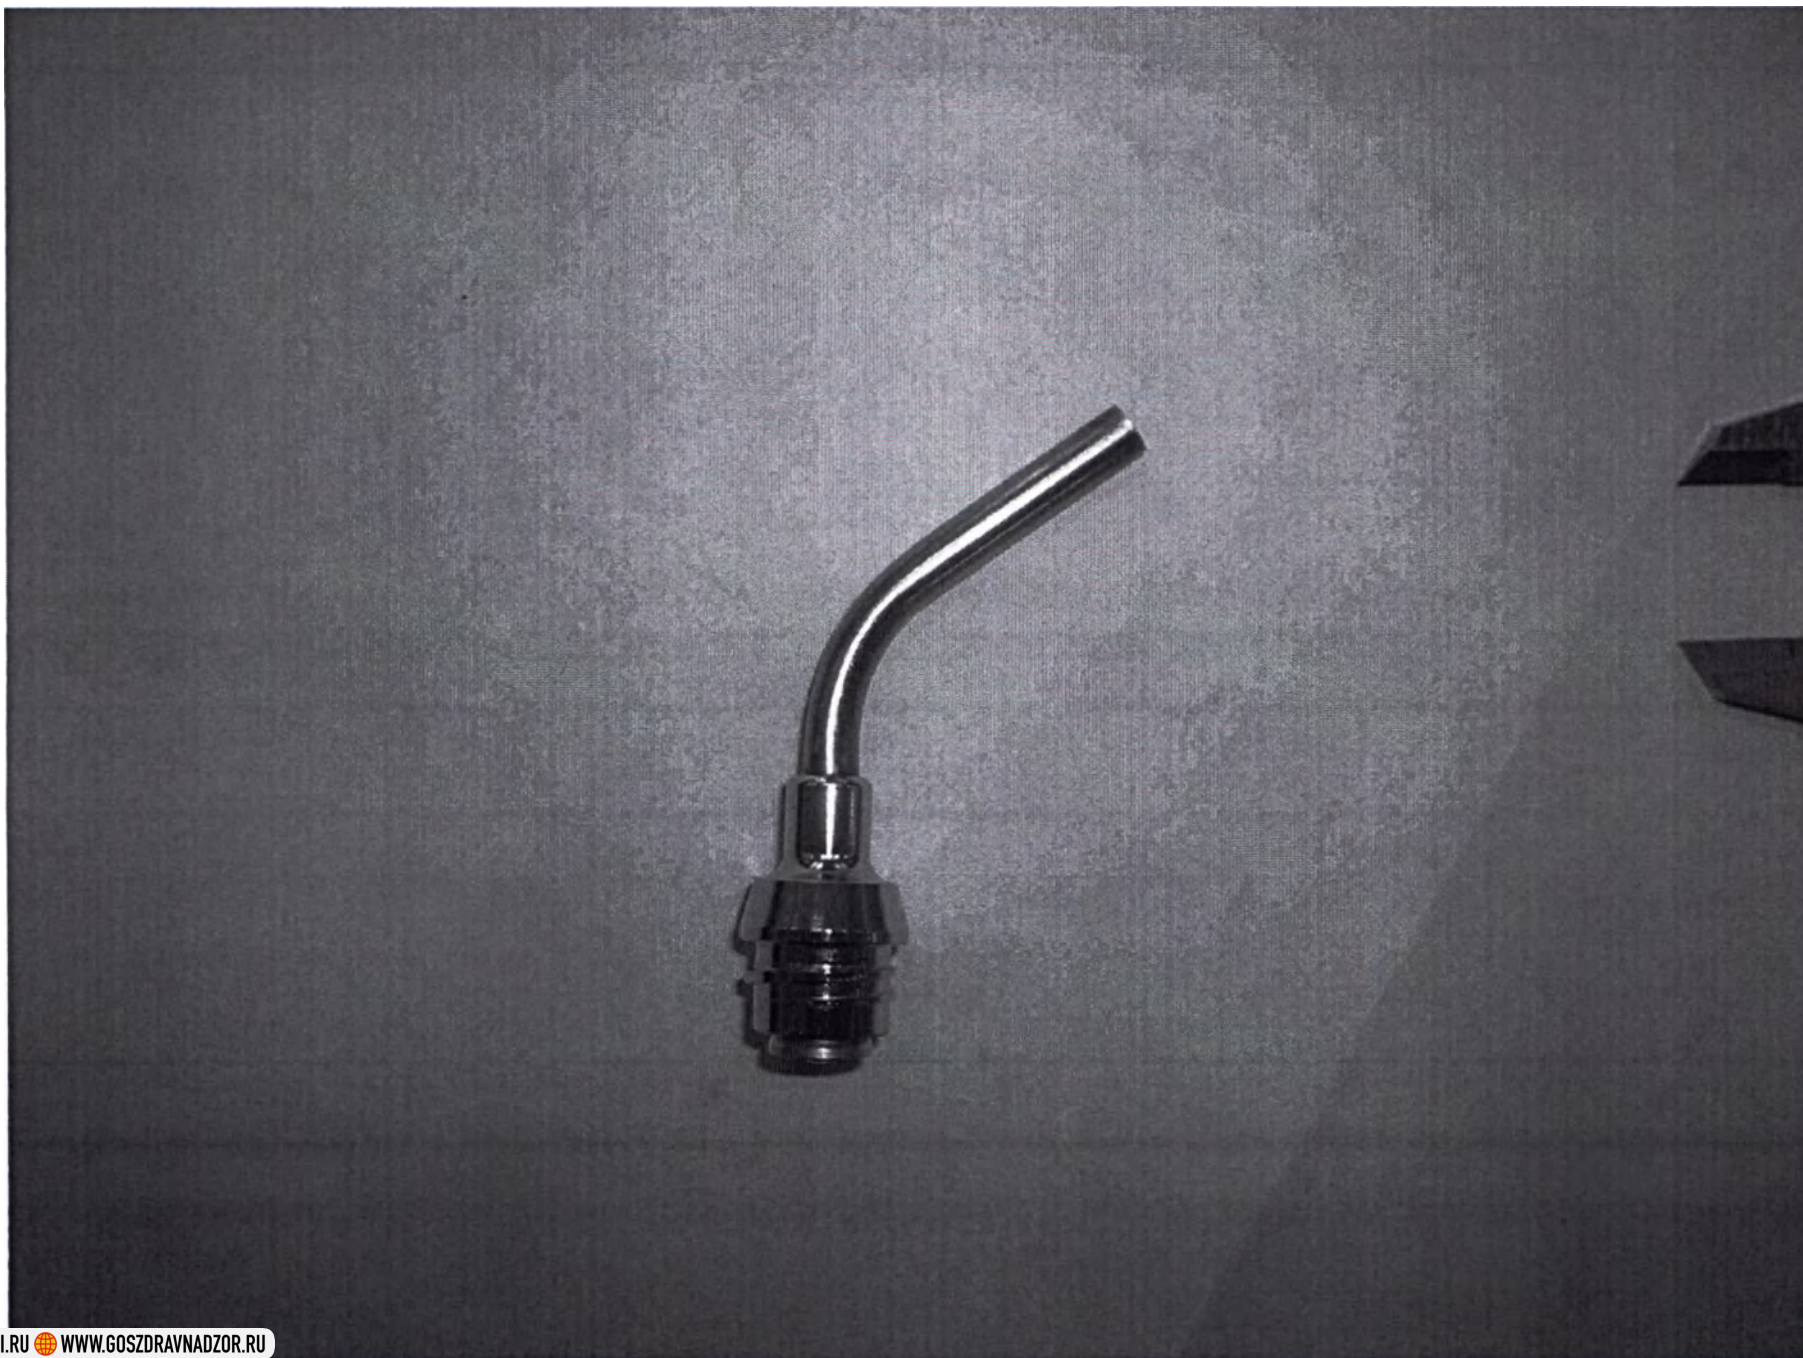

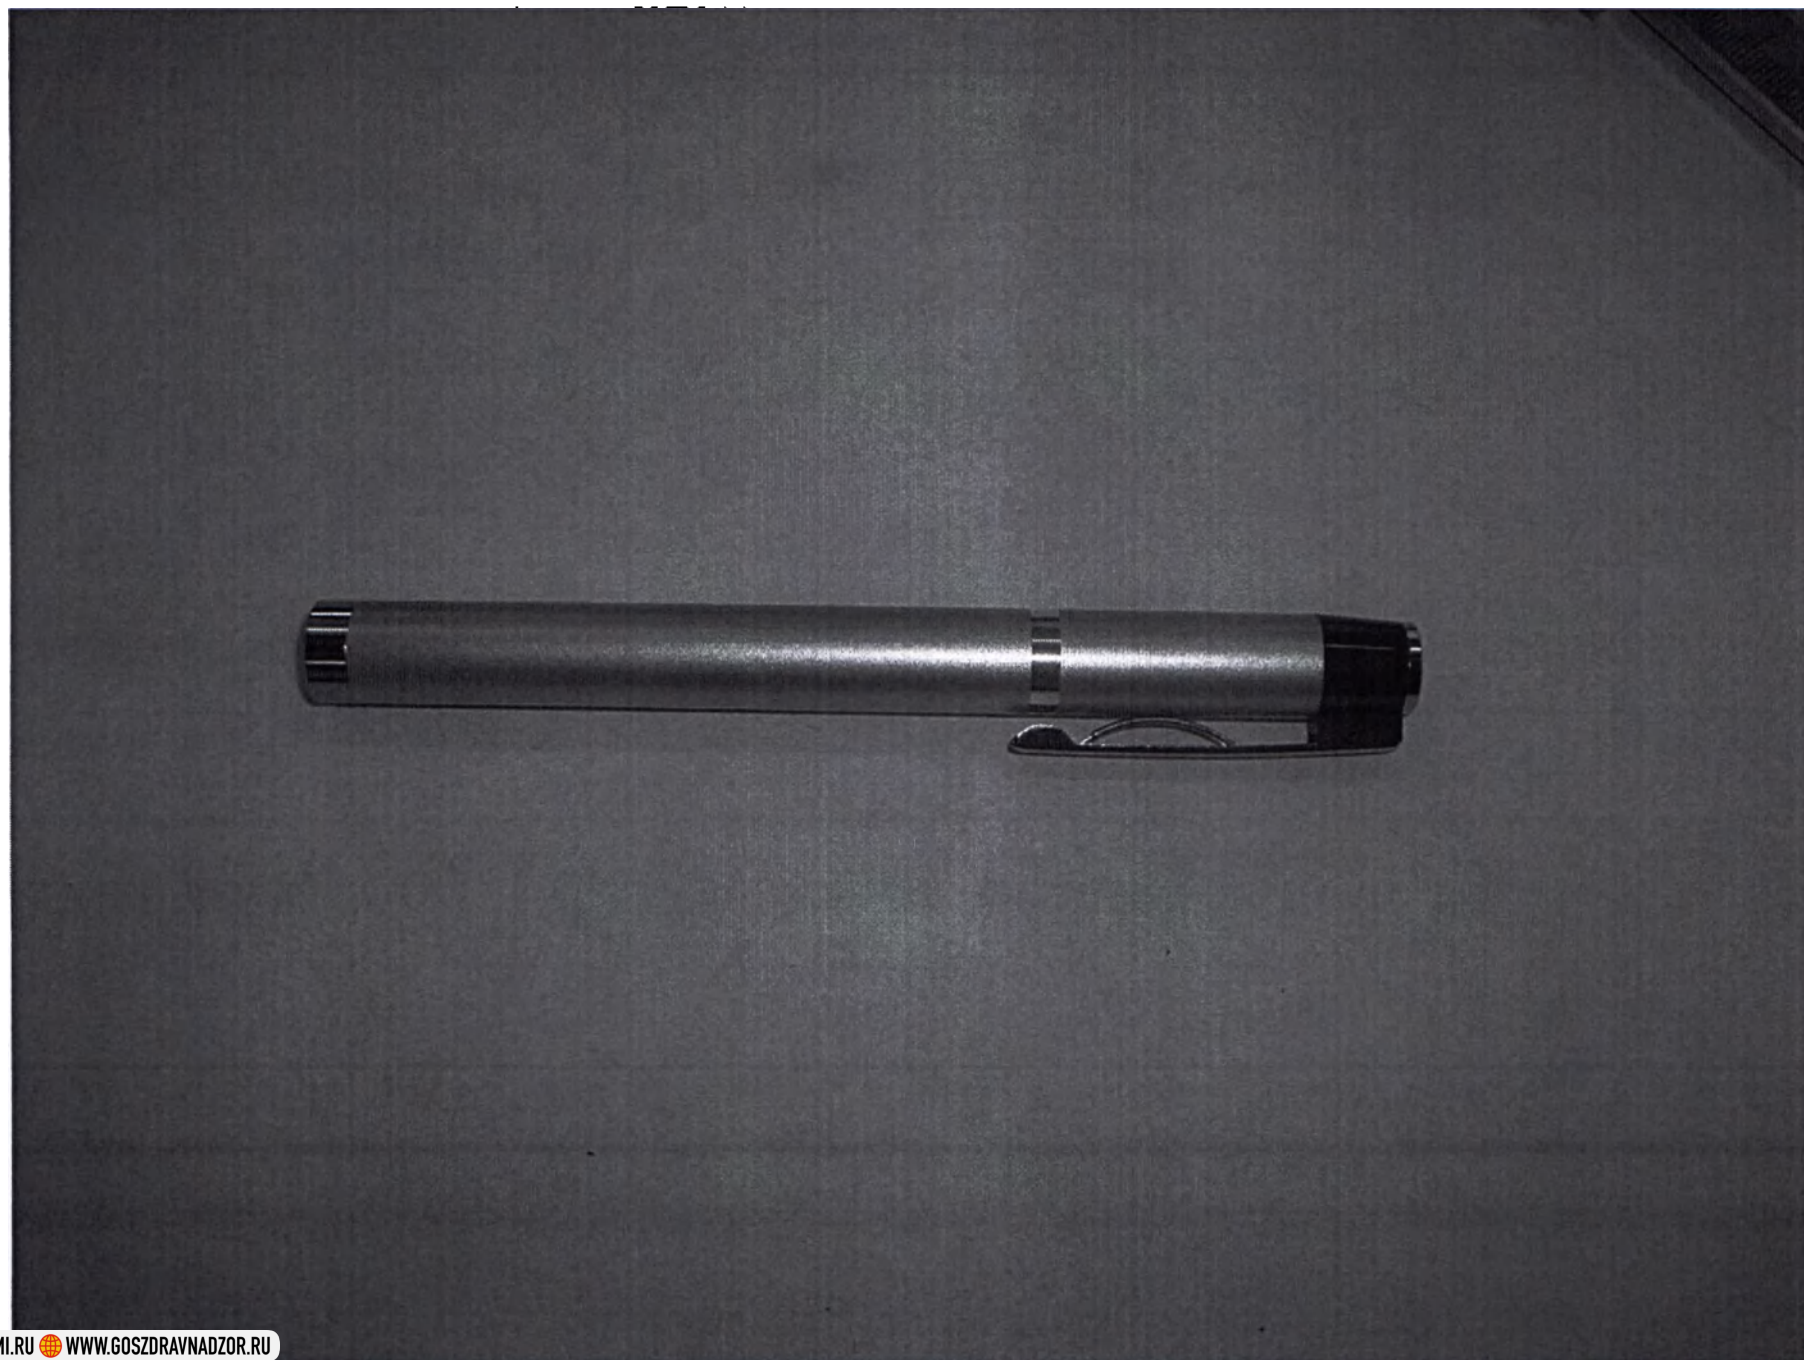

16. Диск с руководством по эксплуатации:

Общий вид.

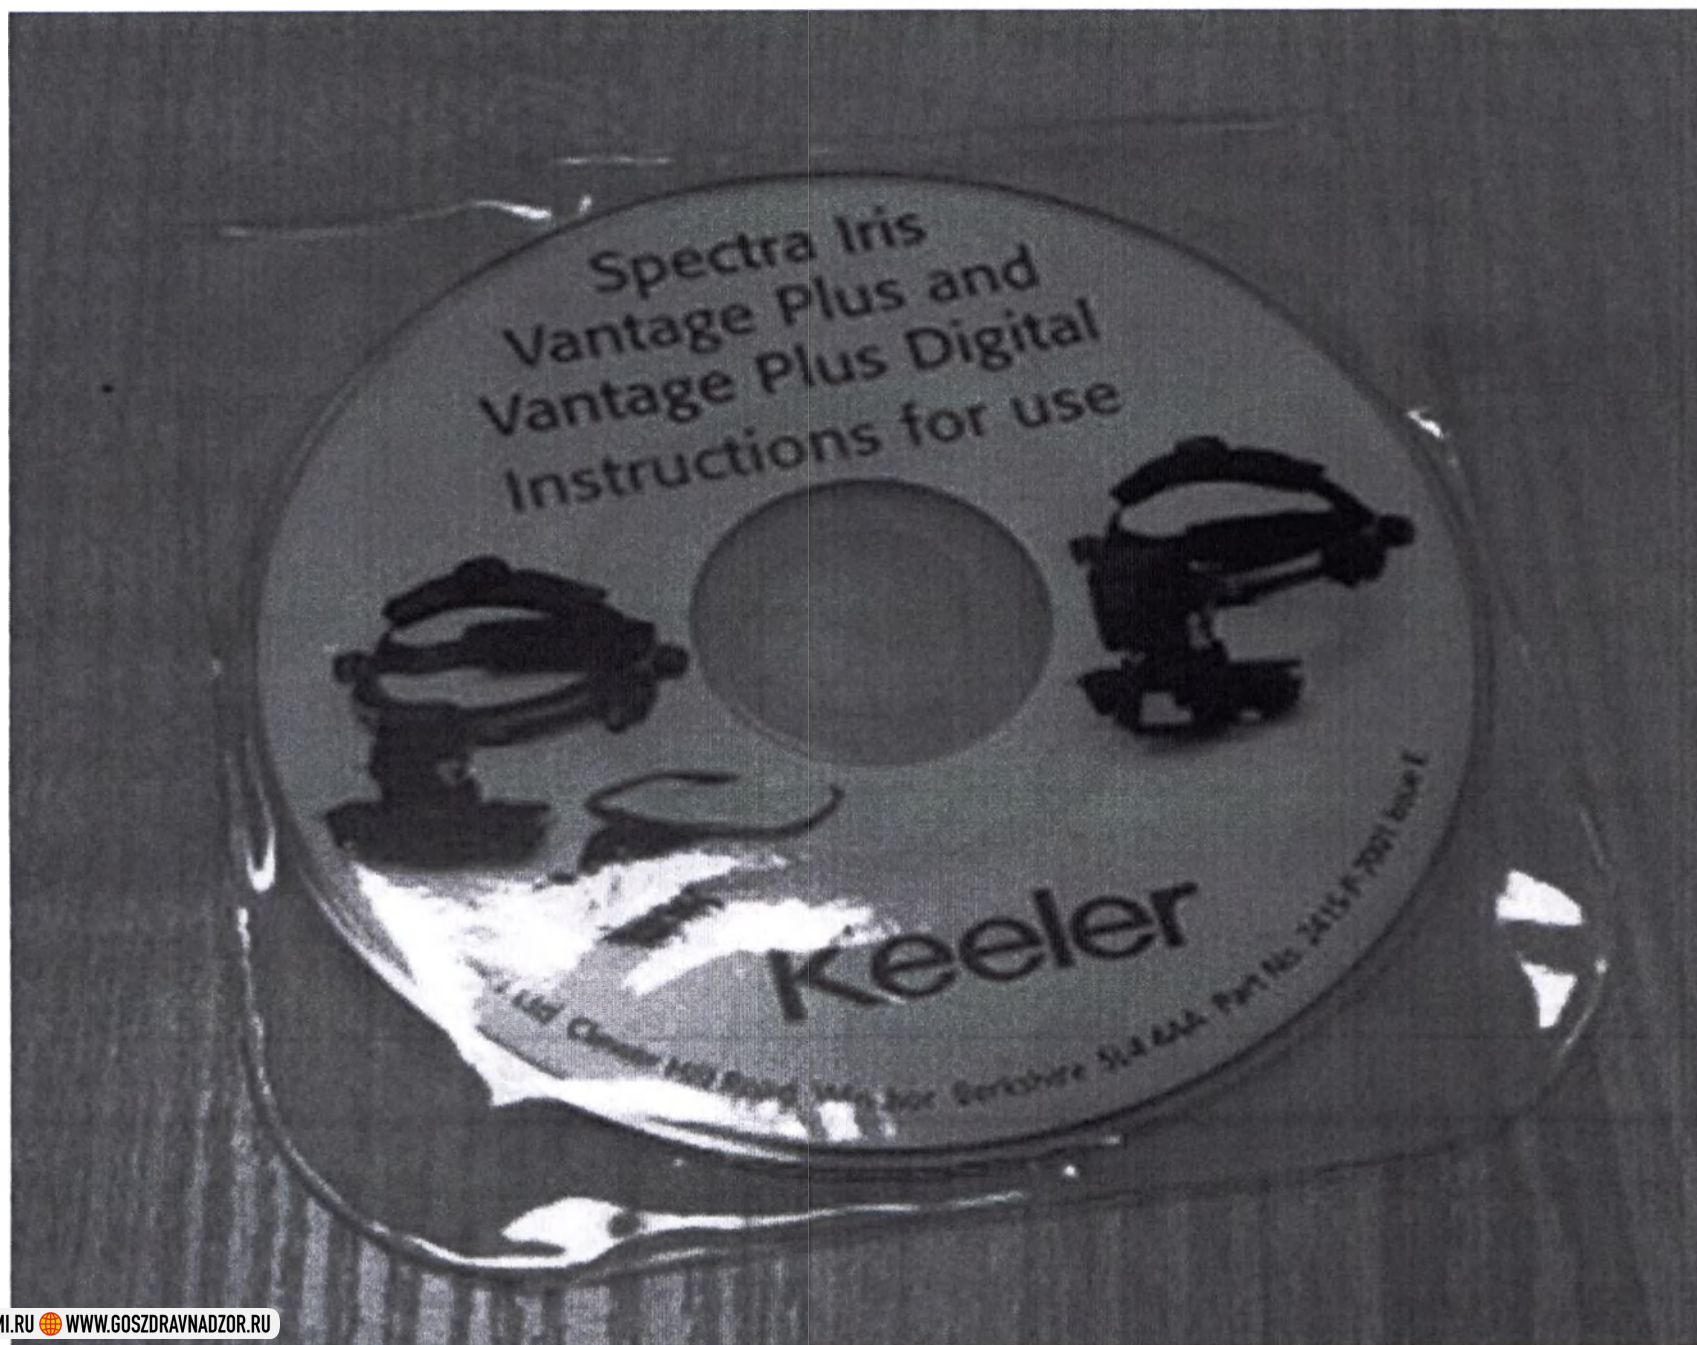

Офтальмоскоп не прямой медицинский Vantage Plus Led (проводной) в составе:


1.Офтальмоскоп:

Общий вид.




2. Обруч головной:

Общий вид.

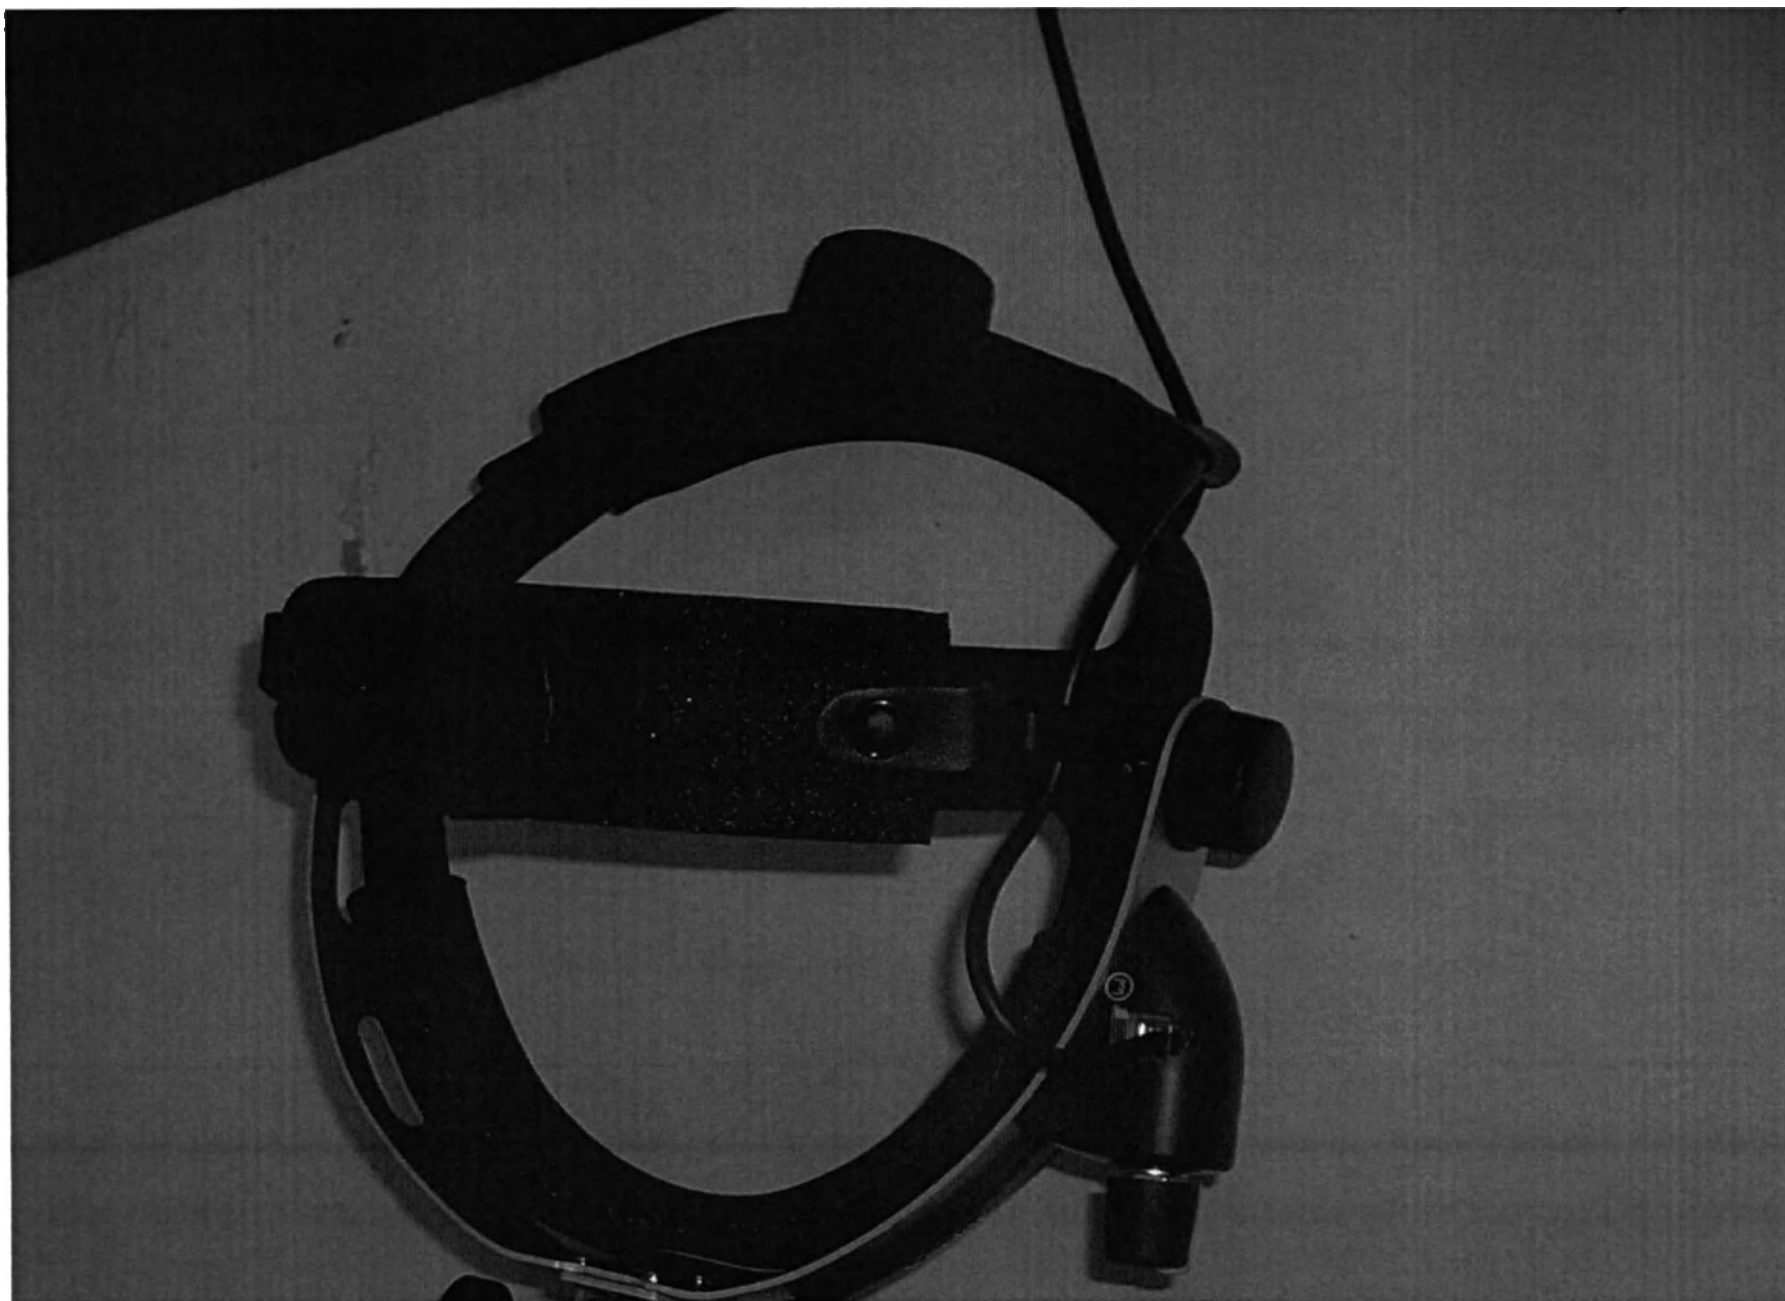

3.Обучающее зеркало:

Общий вид.

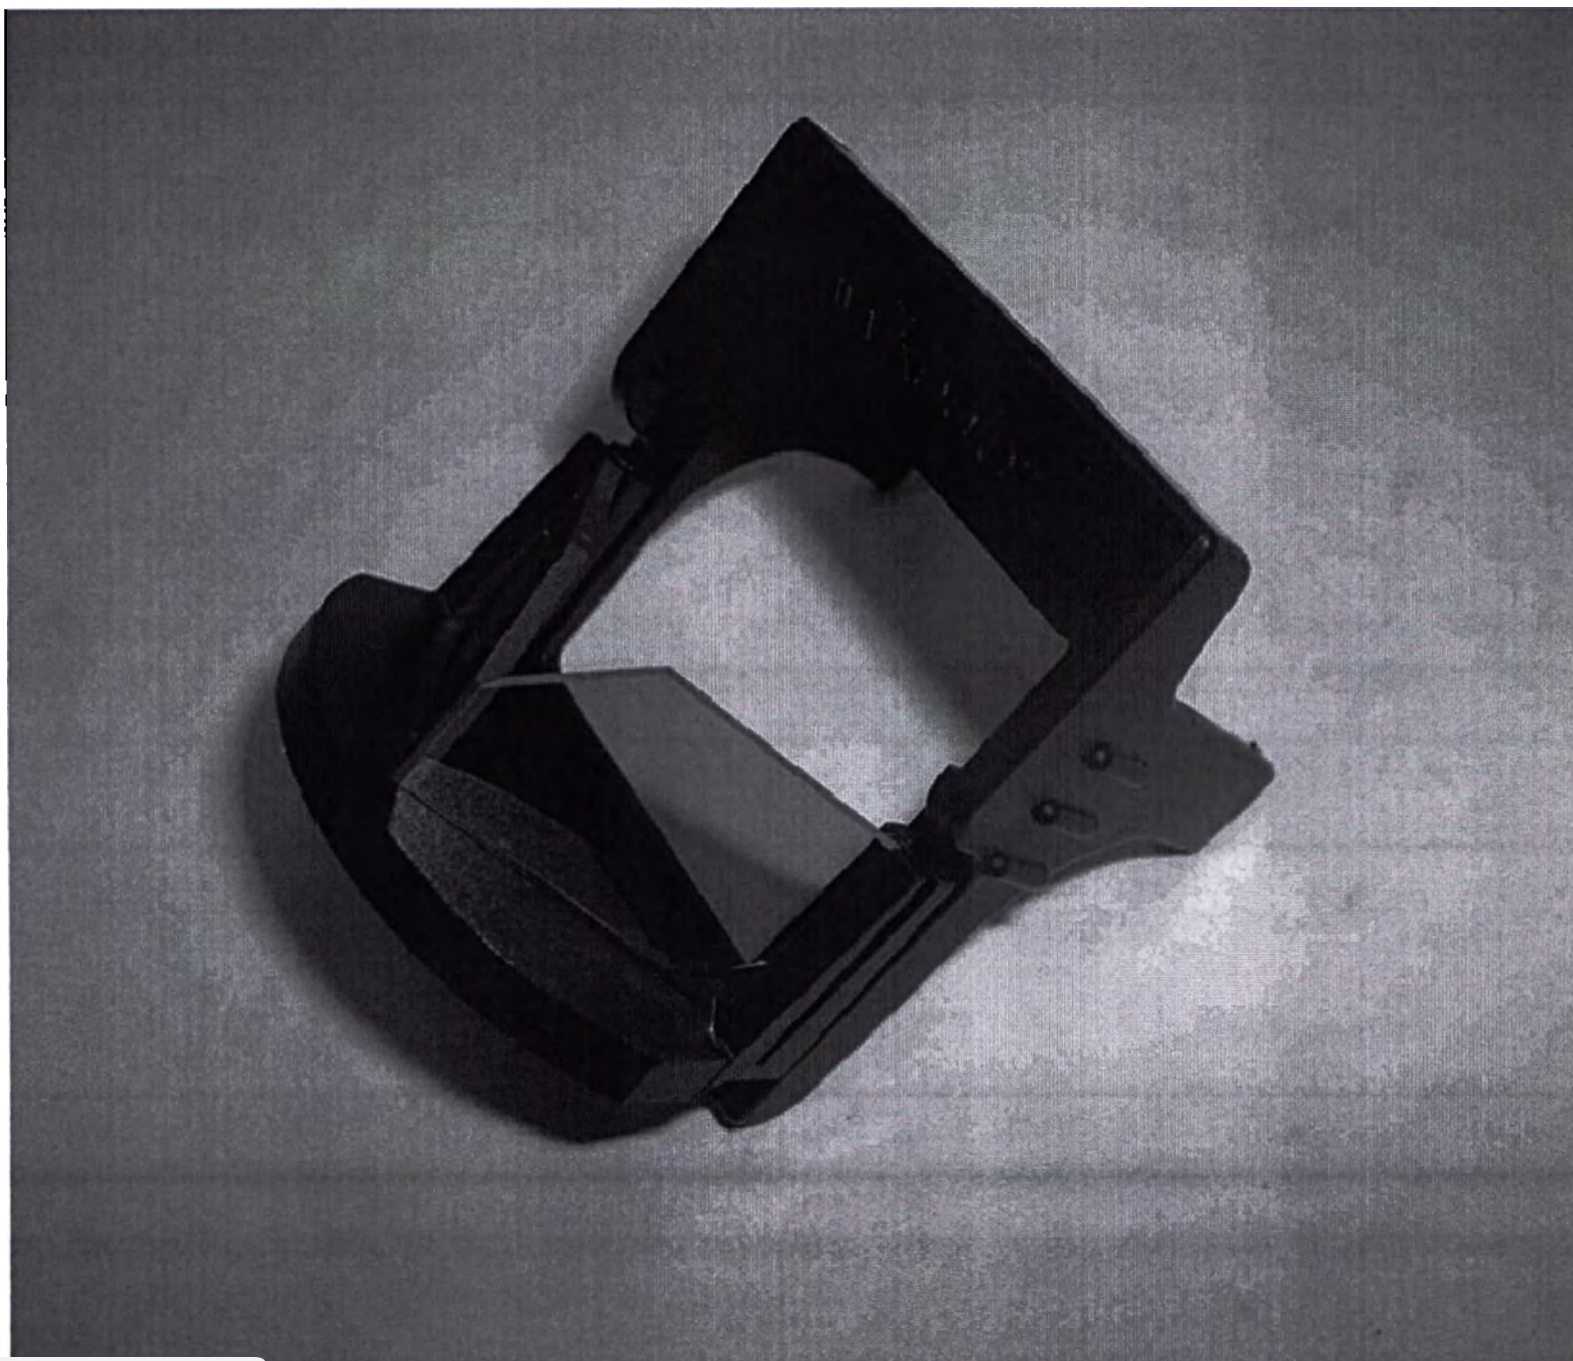

4. Руководство по эксплуатации

Общий вид.



Принадлежности для офтальмоскопа непрямого медицинского Vantage Plus Led (проводного)

1 Линза HiMag Lens с 1,6 x увеличением:

Общий вид.



2. Источник света светодиодный:

Общий вид.



3. Депрессор склеральный малый:

Общий вид.




4. Депрессор склеральный большой:

Общий вид.




5. Лампа галогеновая:

Общий вид.

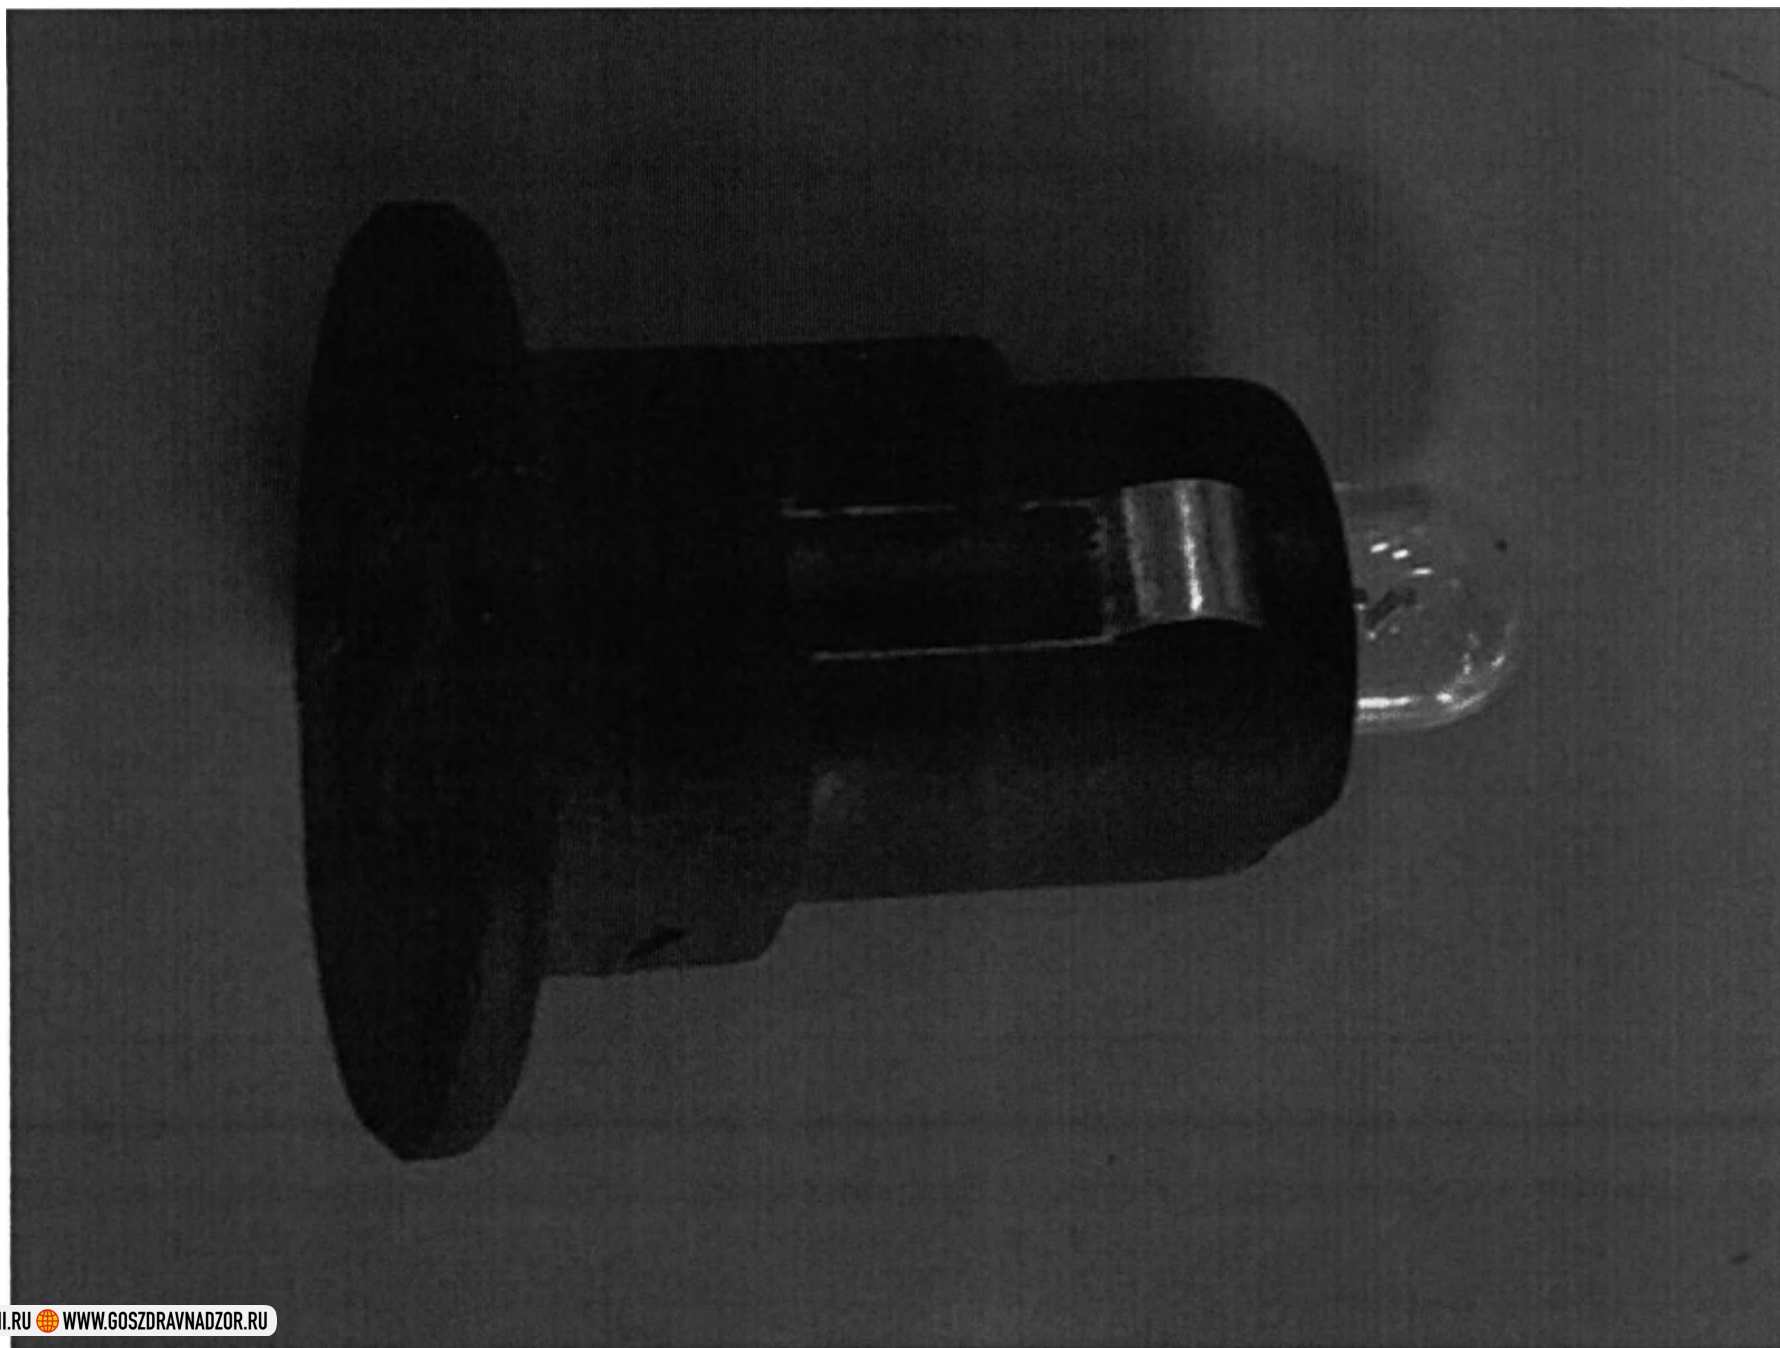

6. Резиновая оправа окуляров:

Общий вид.

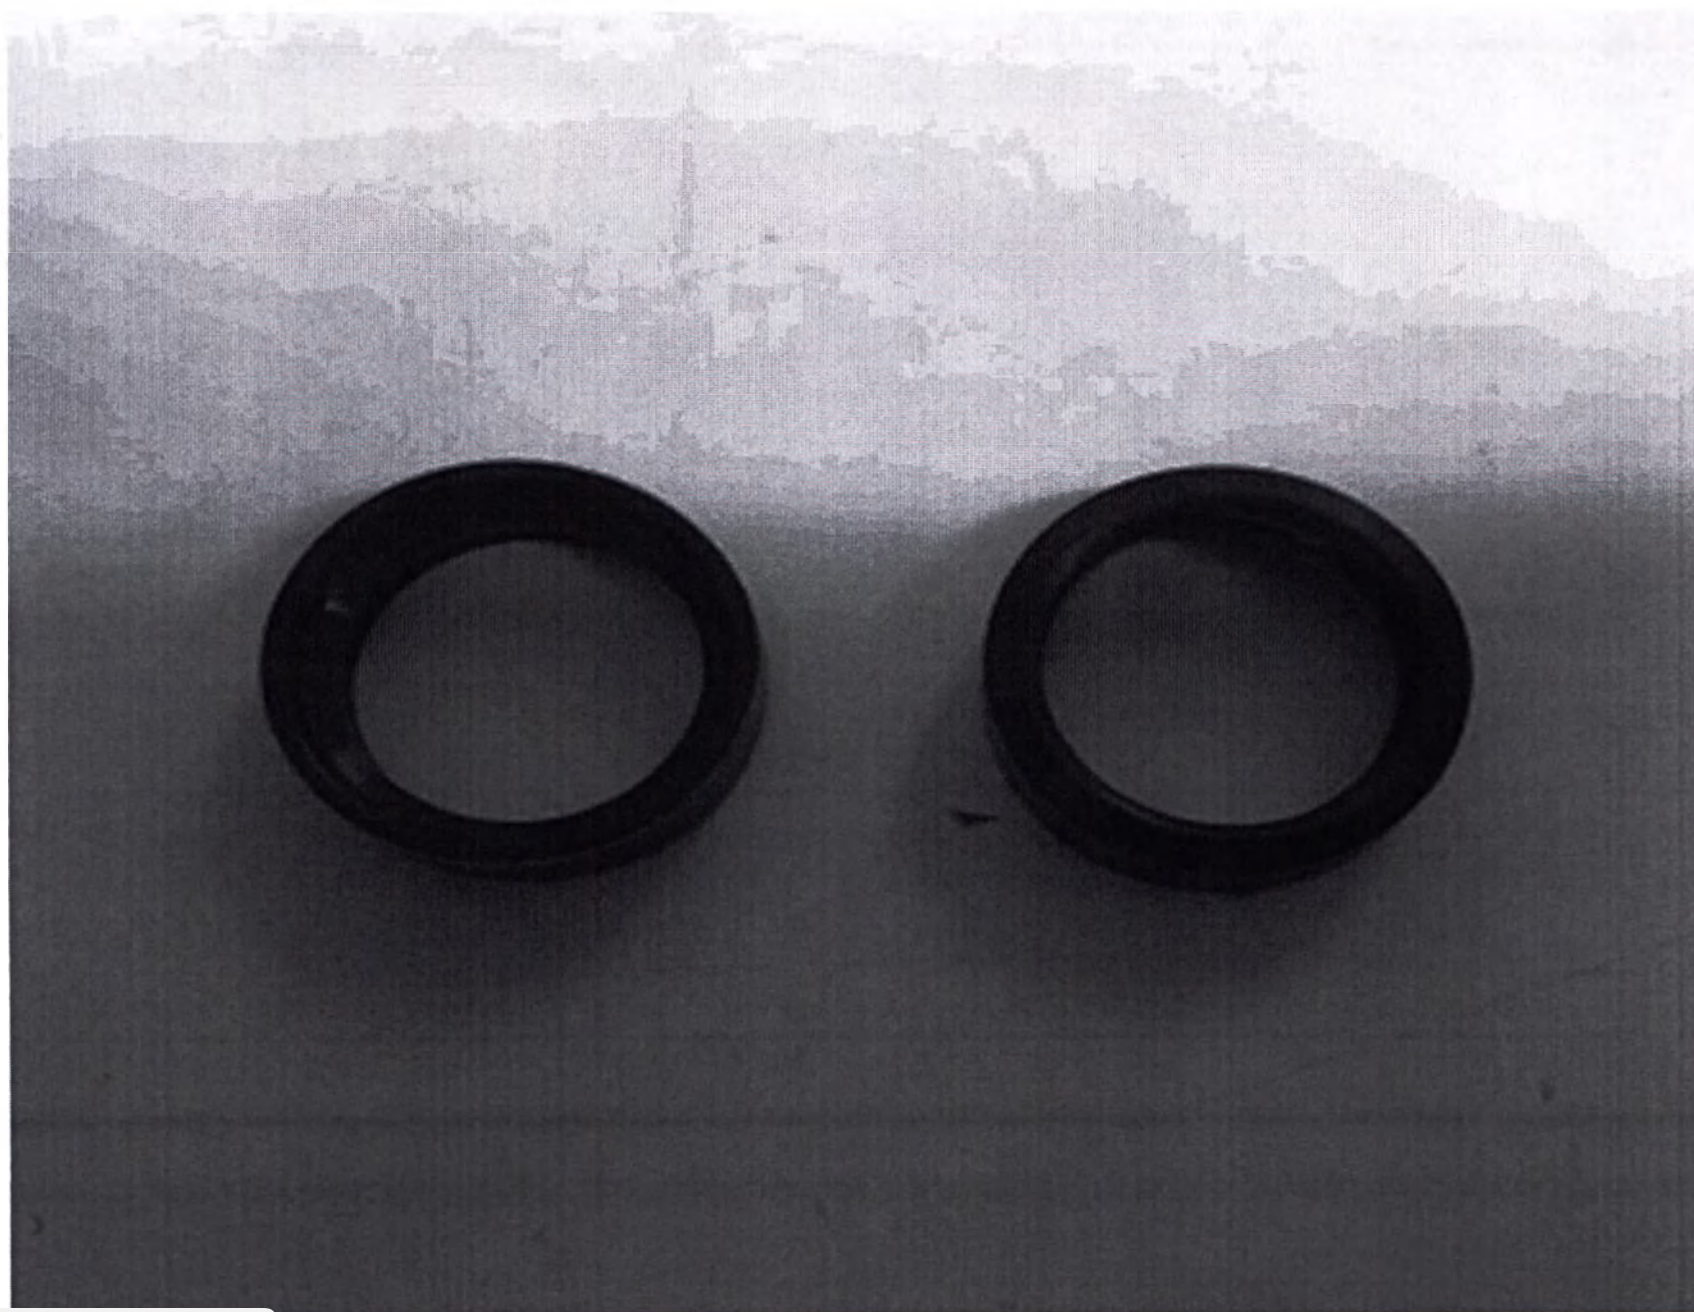



8. Набор для крепления аккумулятора портативного настенного WallPack (дюбель – 2 шт.; шуруп – 2 шт.; ключ для шурупа – 1 шт.): **Общий вид.**



9. Аккумулятор портативный настенный WallPack:

Общий вид.




10. Аккумулятор портативный карманный SmartPack:

Общий вид.



11. Набор сетевых переходников: (вилка для Австралии – 1 шт.; вилка для США – 1 шт.; вилка для Европы – 1 шт.; вилка для Великобритании – 1 шт.):

Общий вид.

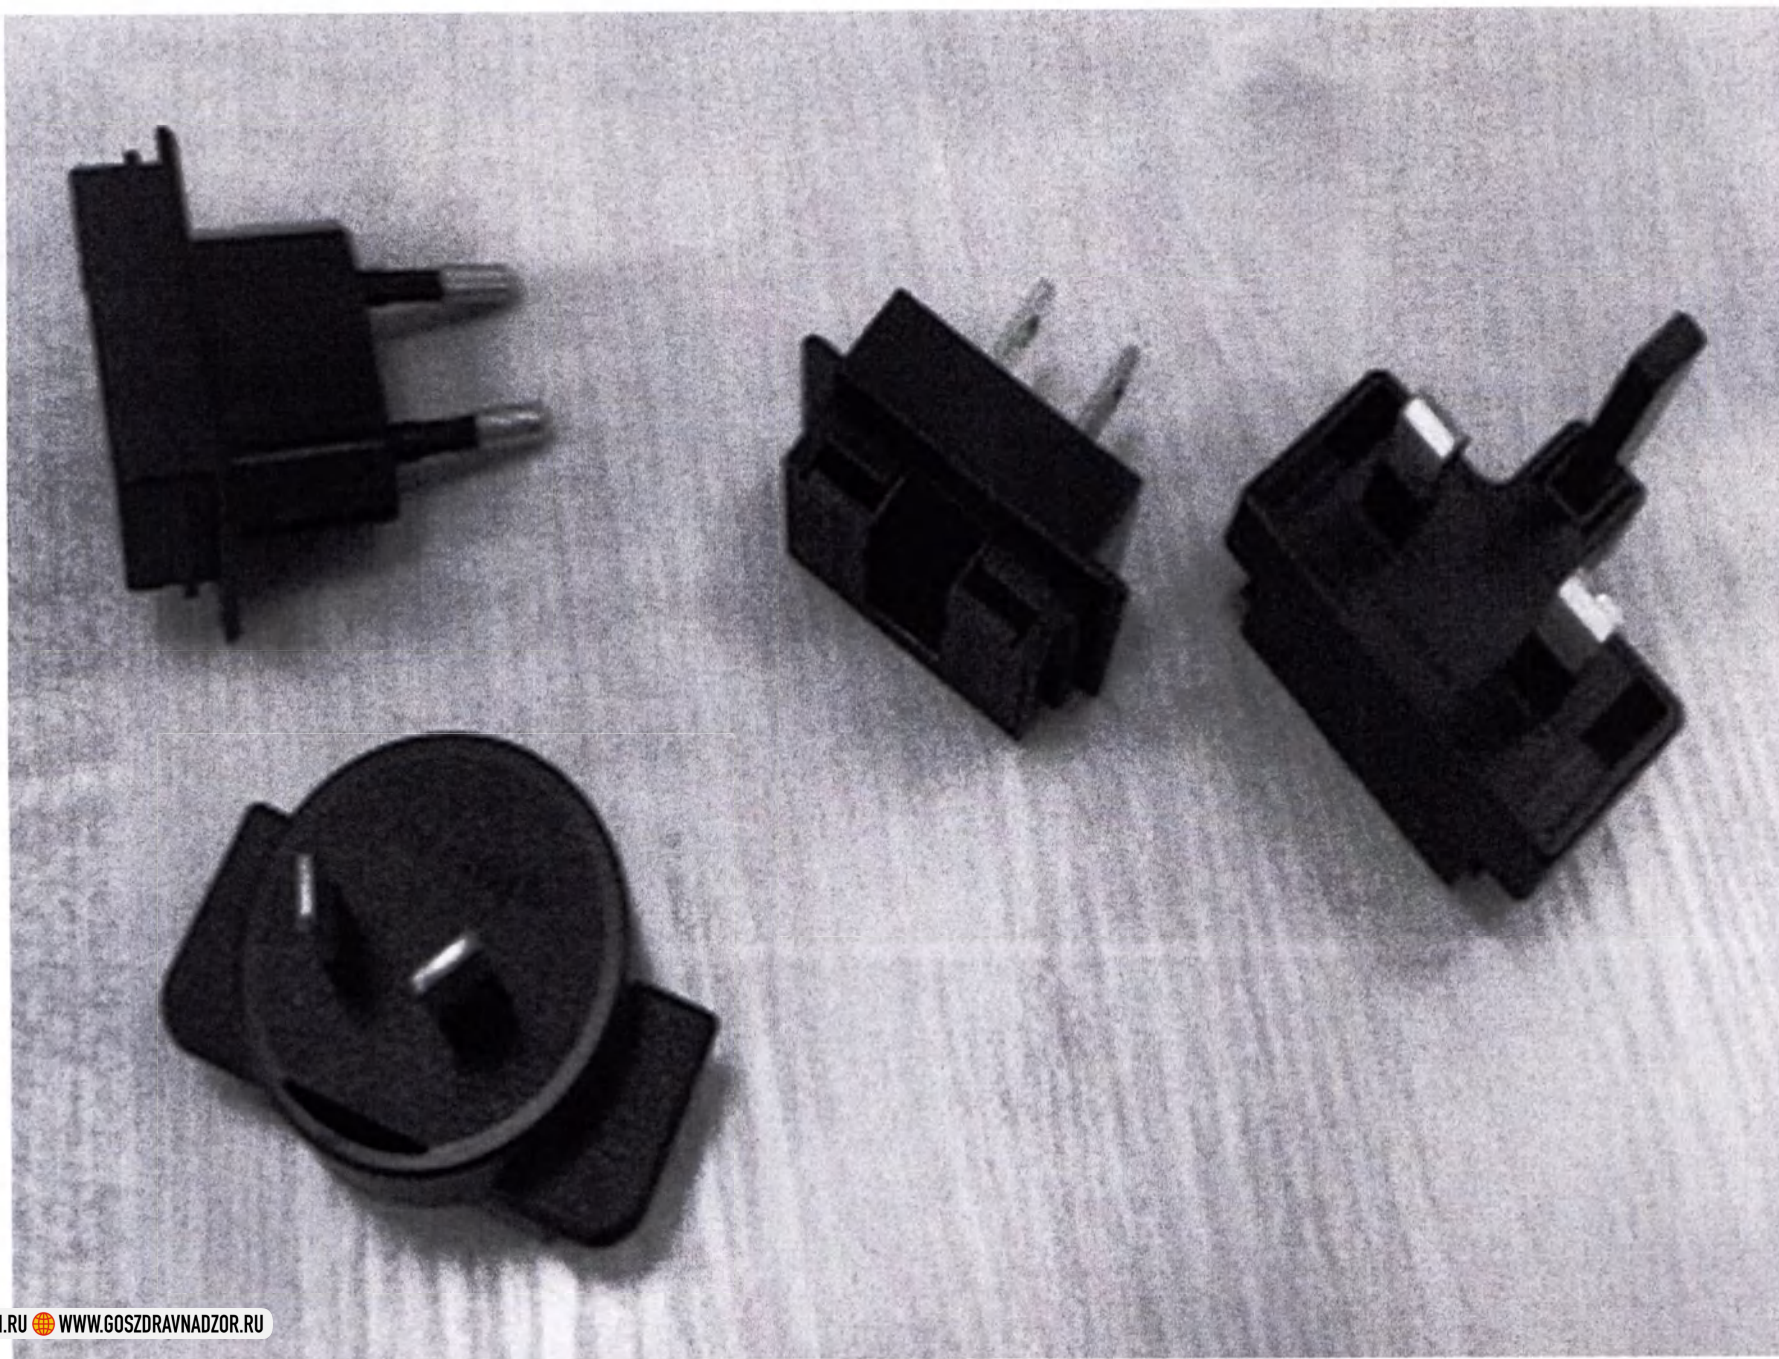


12. Кейс транспортный:

Общий вид.



13. Салфетка тканная для объектива:

Общий вид.

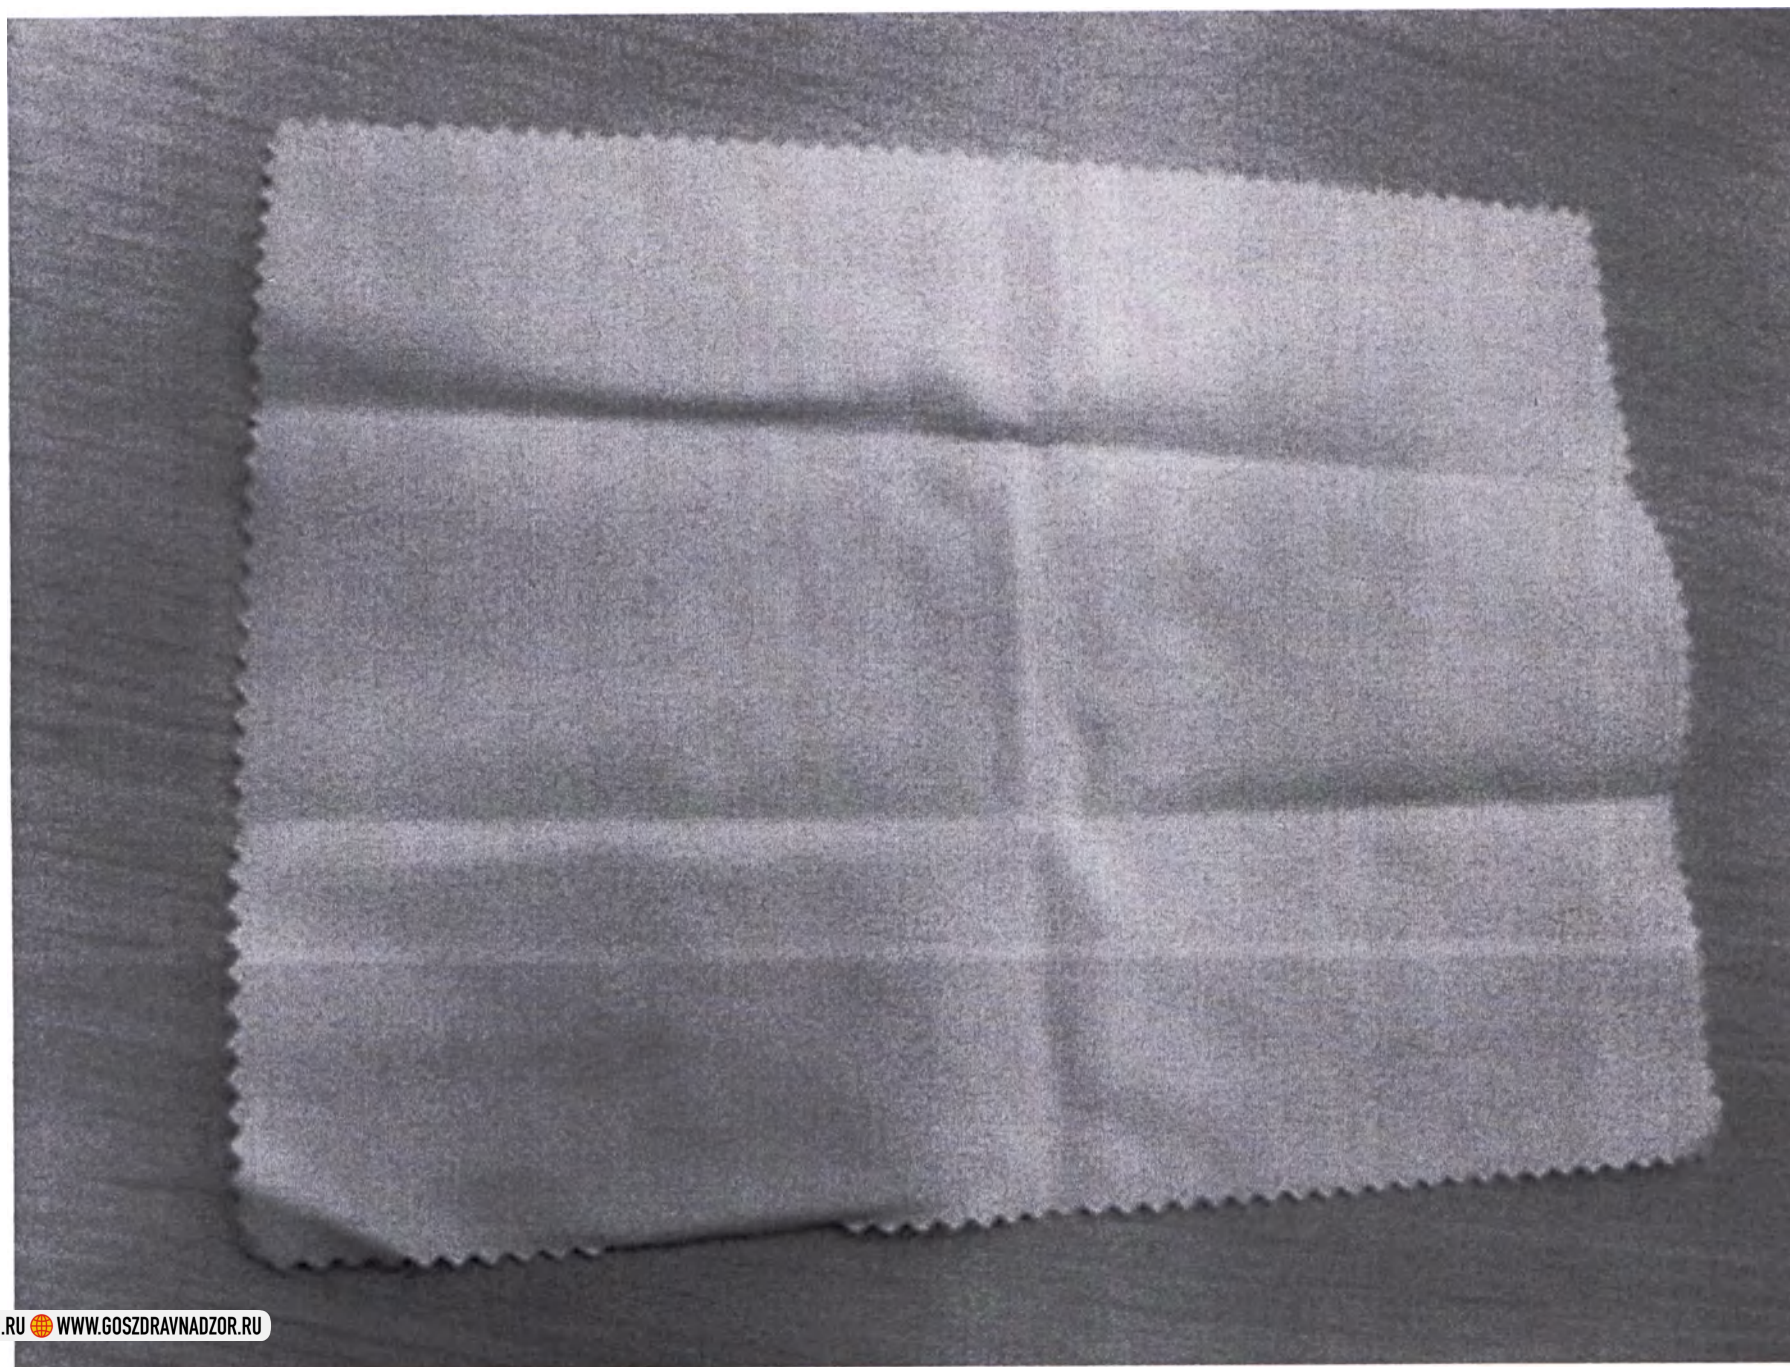

14. Насадка трансиллюминаторная Finoff:


Общий вид.





16. Диск с руководством по эксплуатации:

Общий вид.

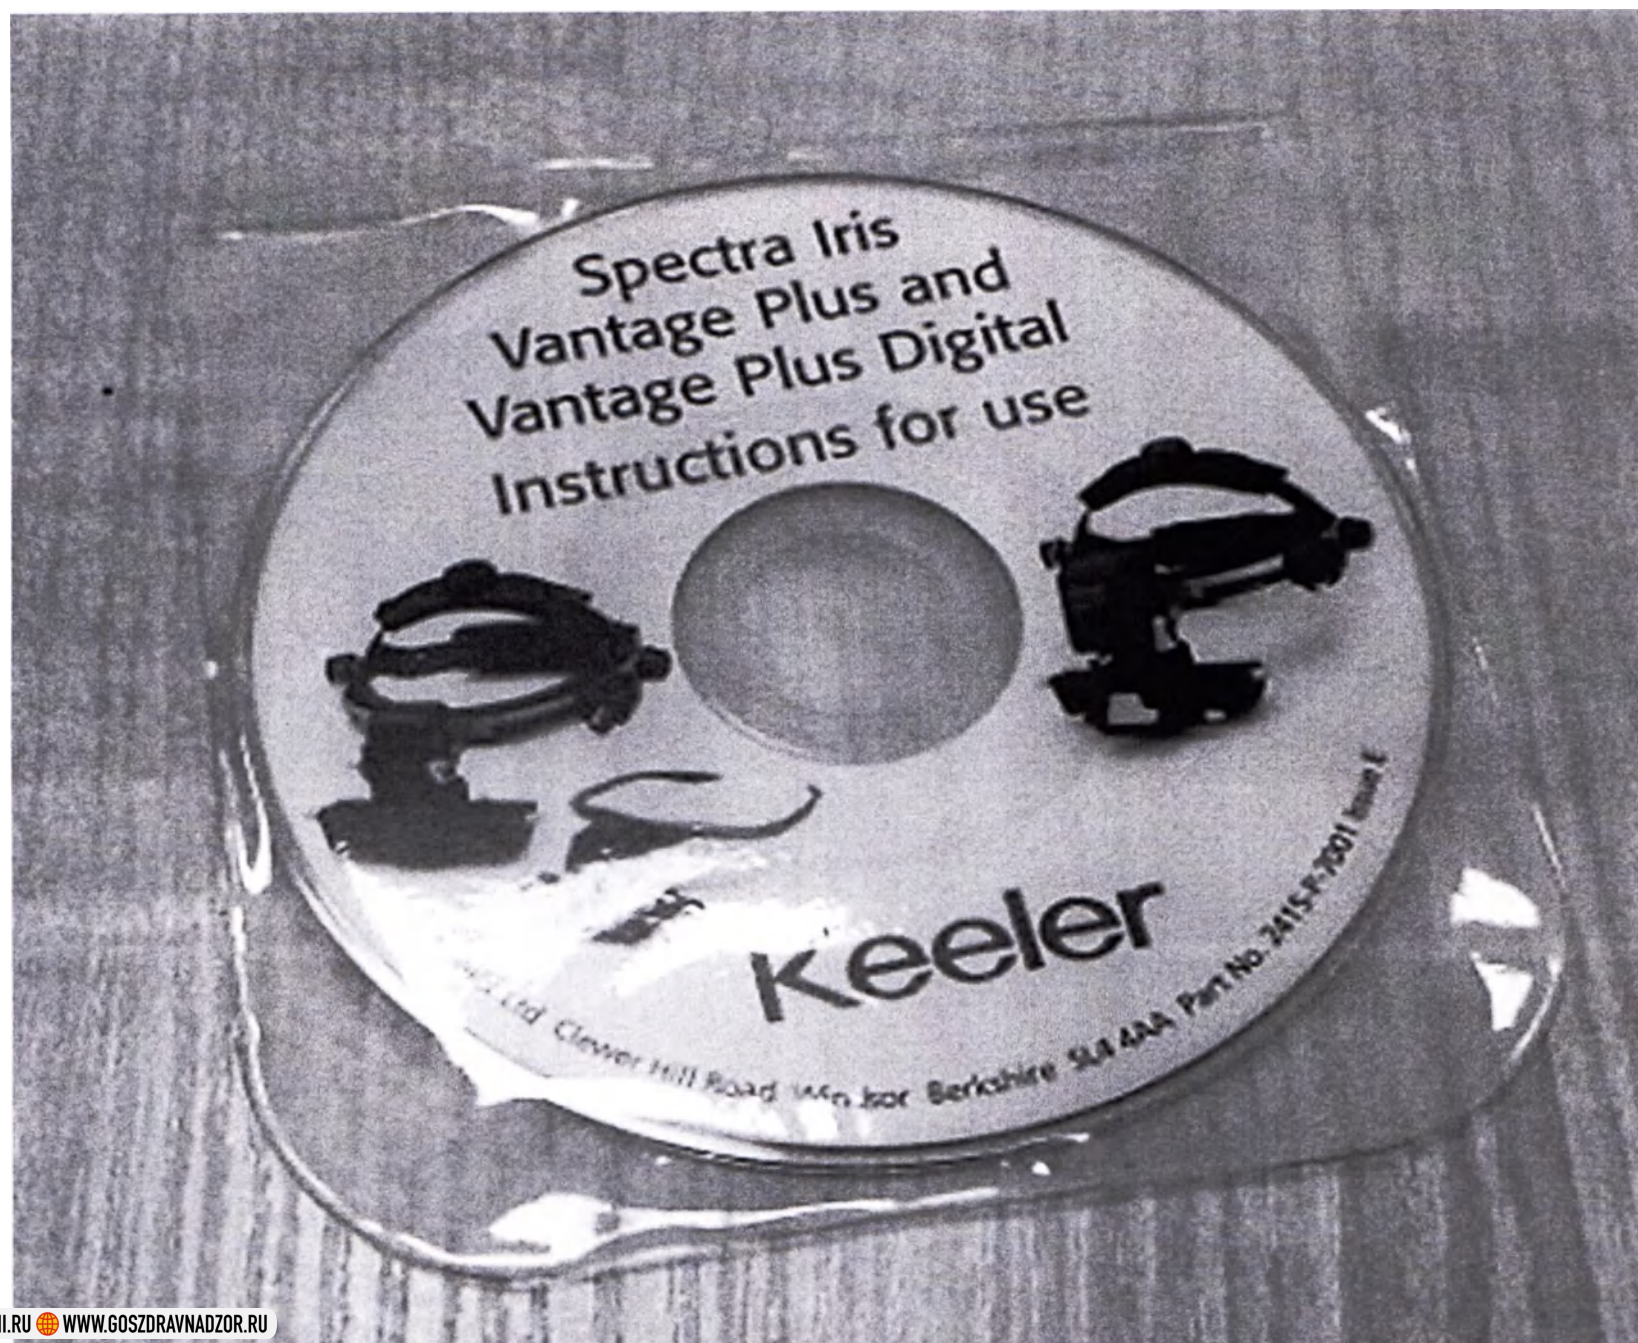

Офтальмоскоп не прямой медицинский Spectra Iris в составе:


1.Офтальмоскоп:

Общий вид.



2. Оправа удлиненная:

Общий вид.

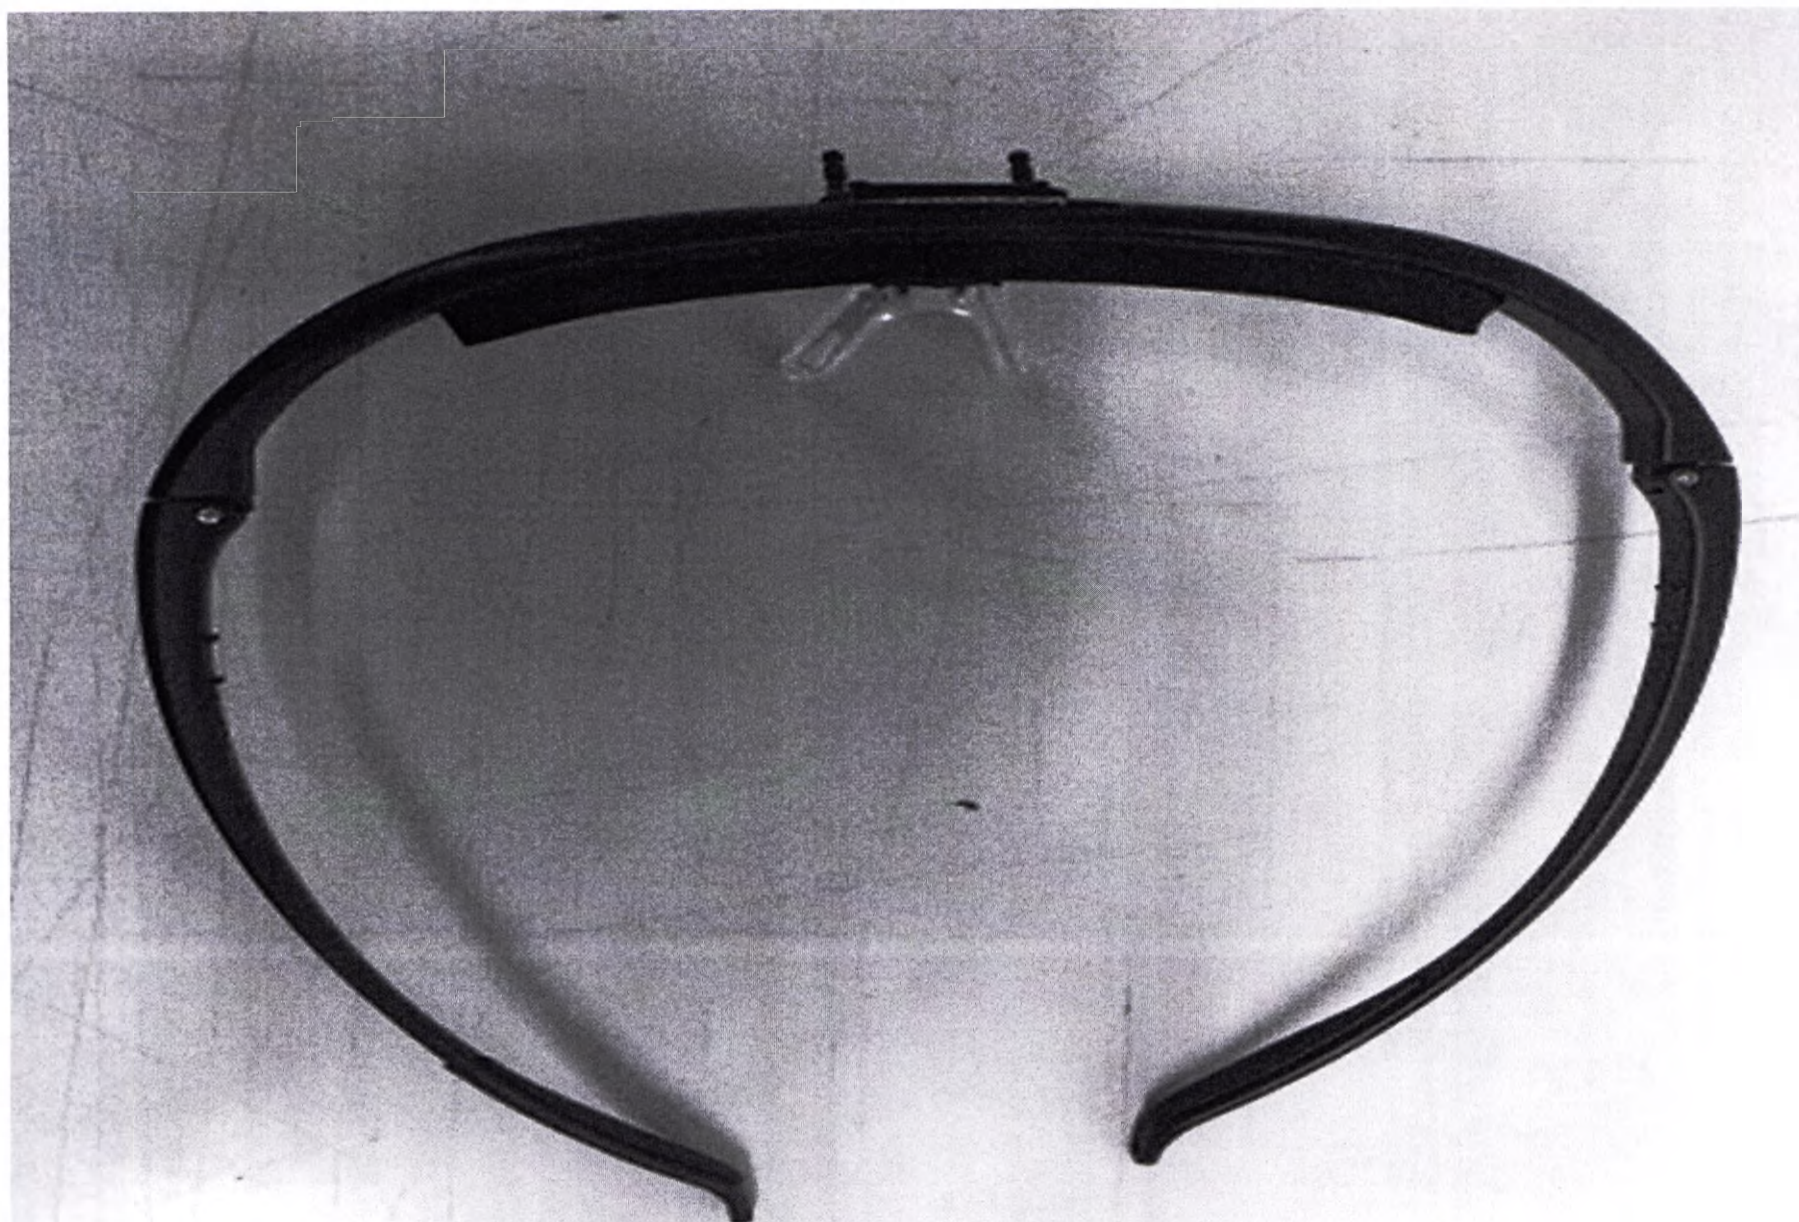

3.Оправа стандартная:

Общий вид.



4. Оправа укороченная:

Общий вид.



5. Упор носовой (широкий тип):

Общий вид.




6. Упор носовой (узкий тип):

Общий вид.



7. Обучающее зеркало:

Общий вид.

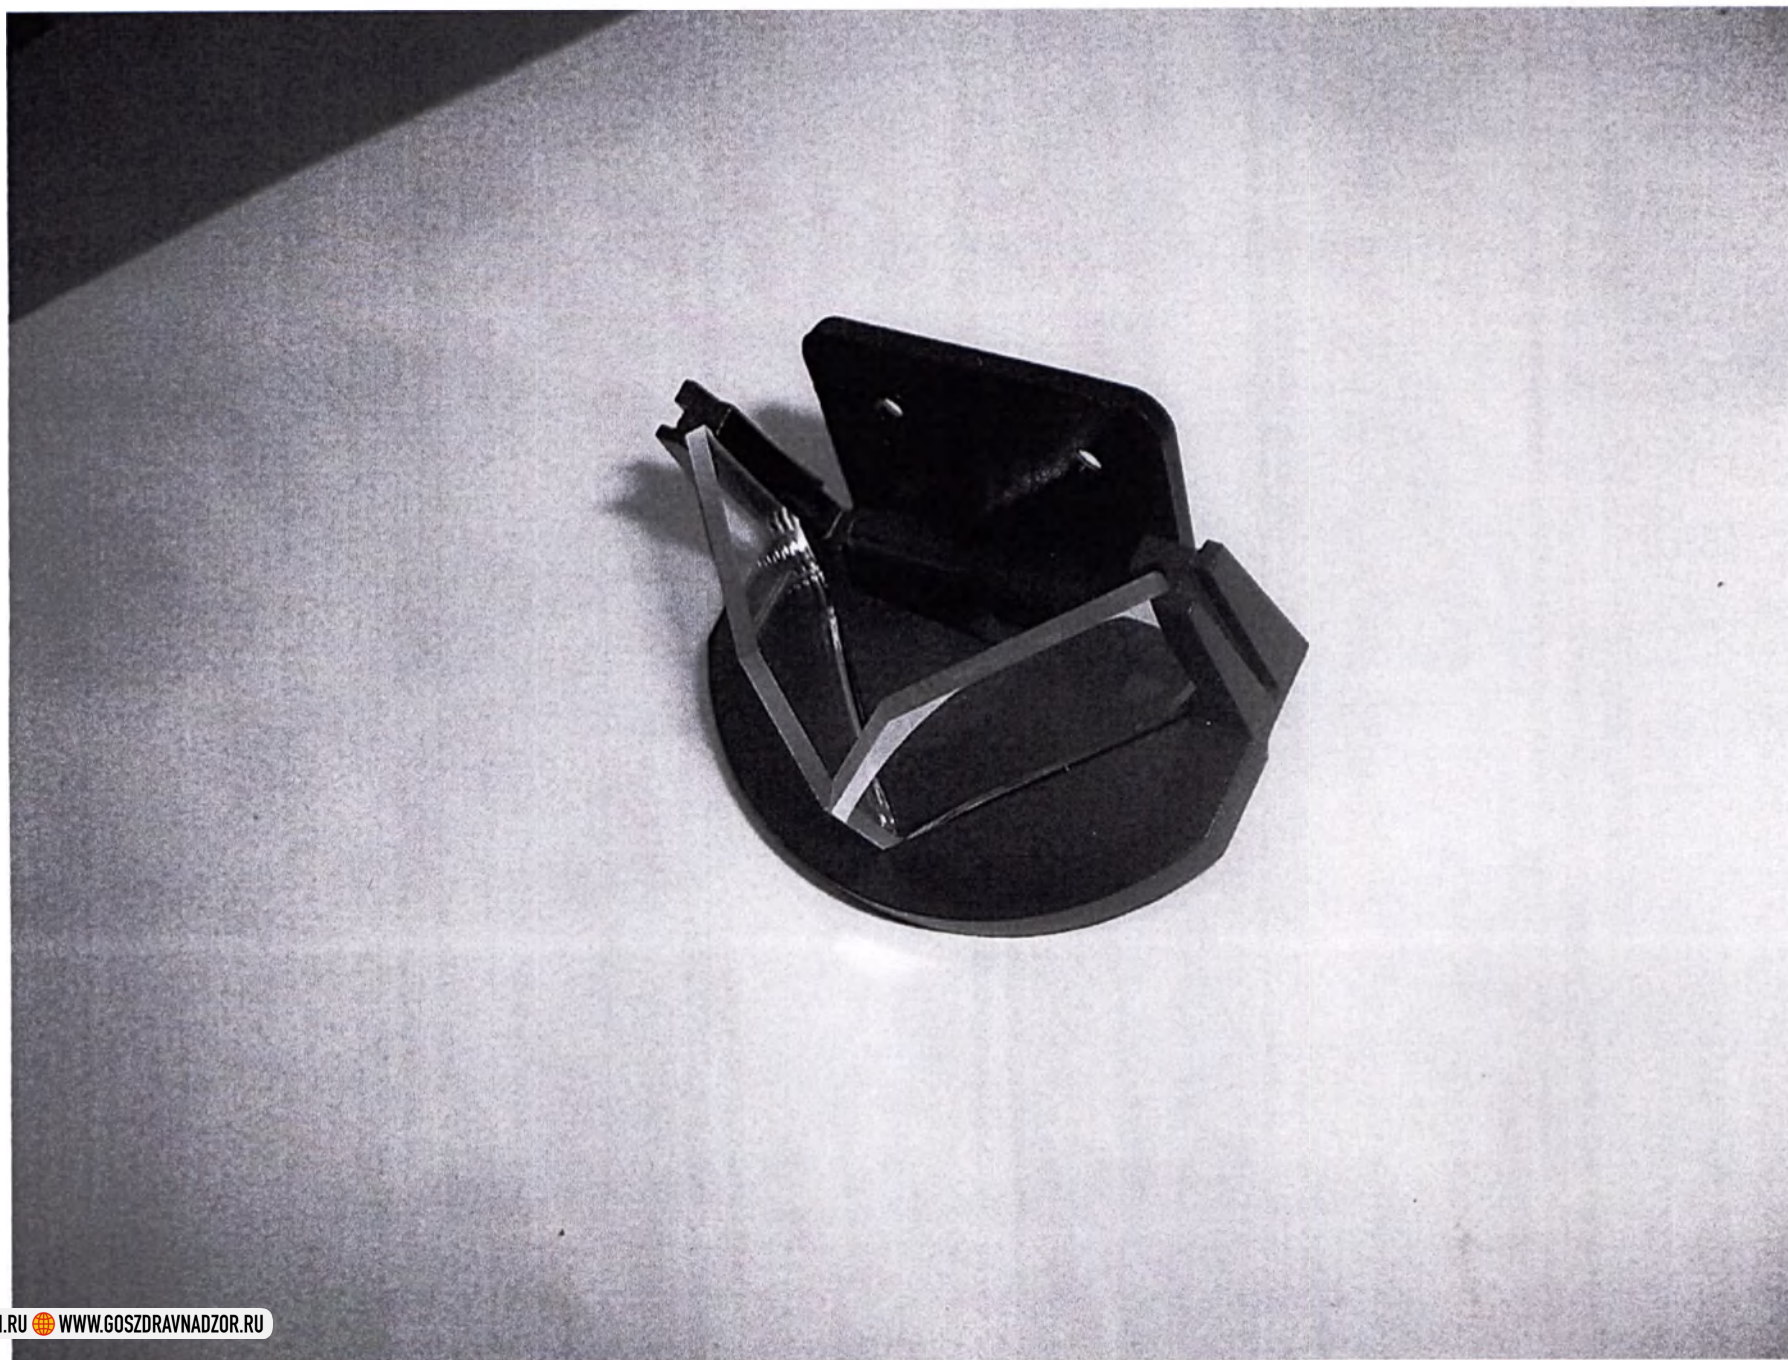



Принадлежности для офтальмоскопа непрямого медицинского Spectra Iris:


1. Источник света светодиодный:

Общий вид.




2. Депрессор склеральный малый:

Общий вид.

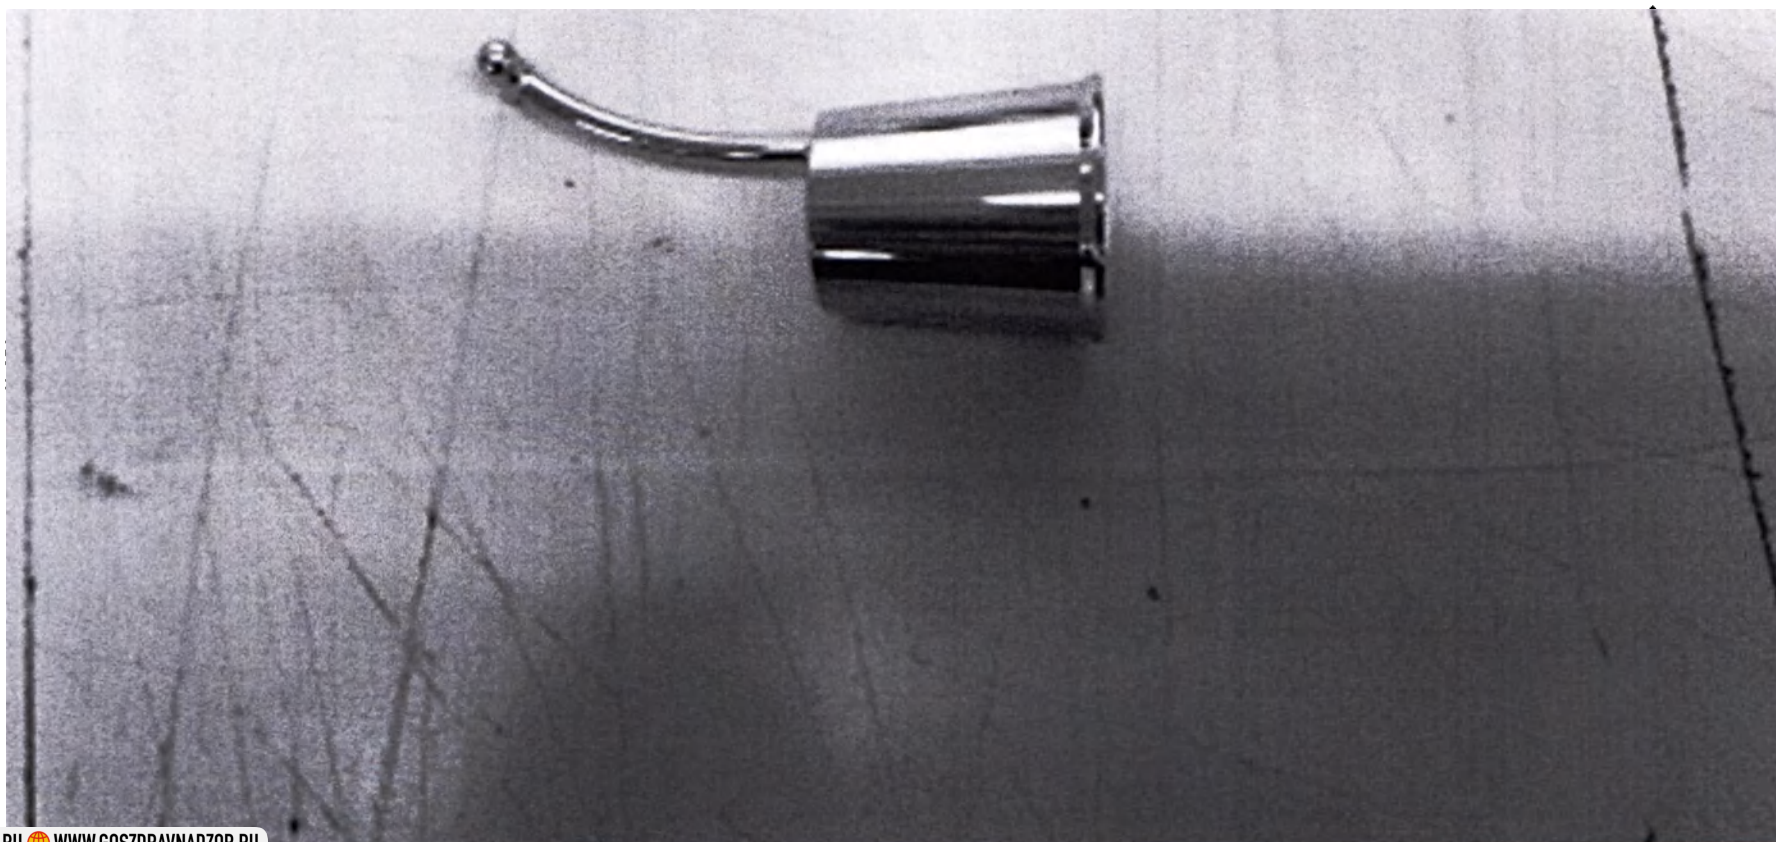

3. Депрессор склеральный большой:

Общий вид.

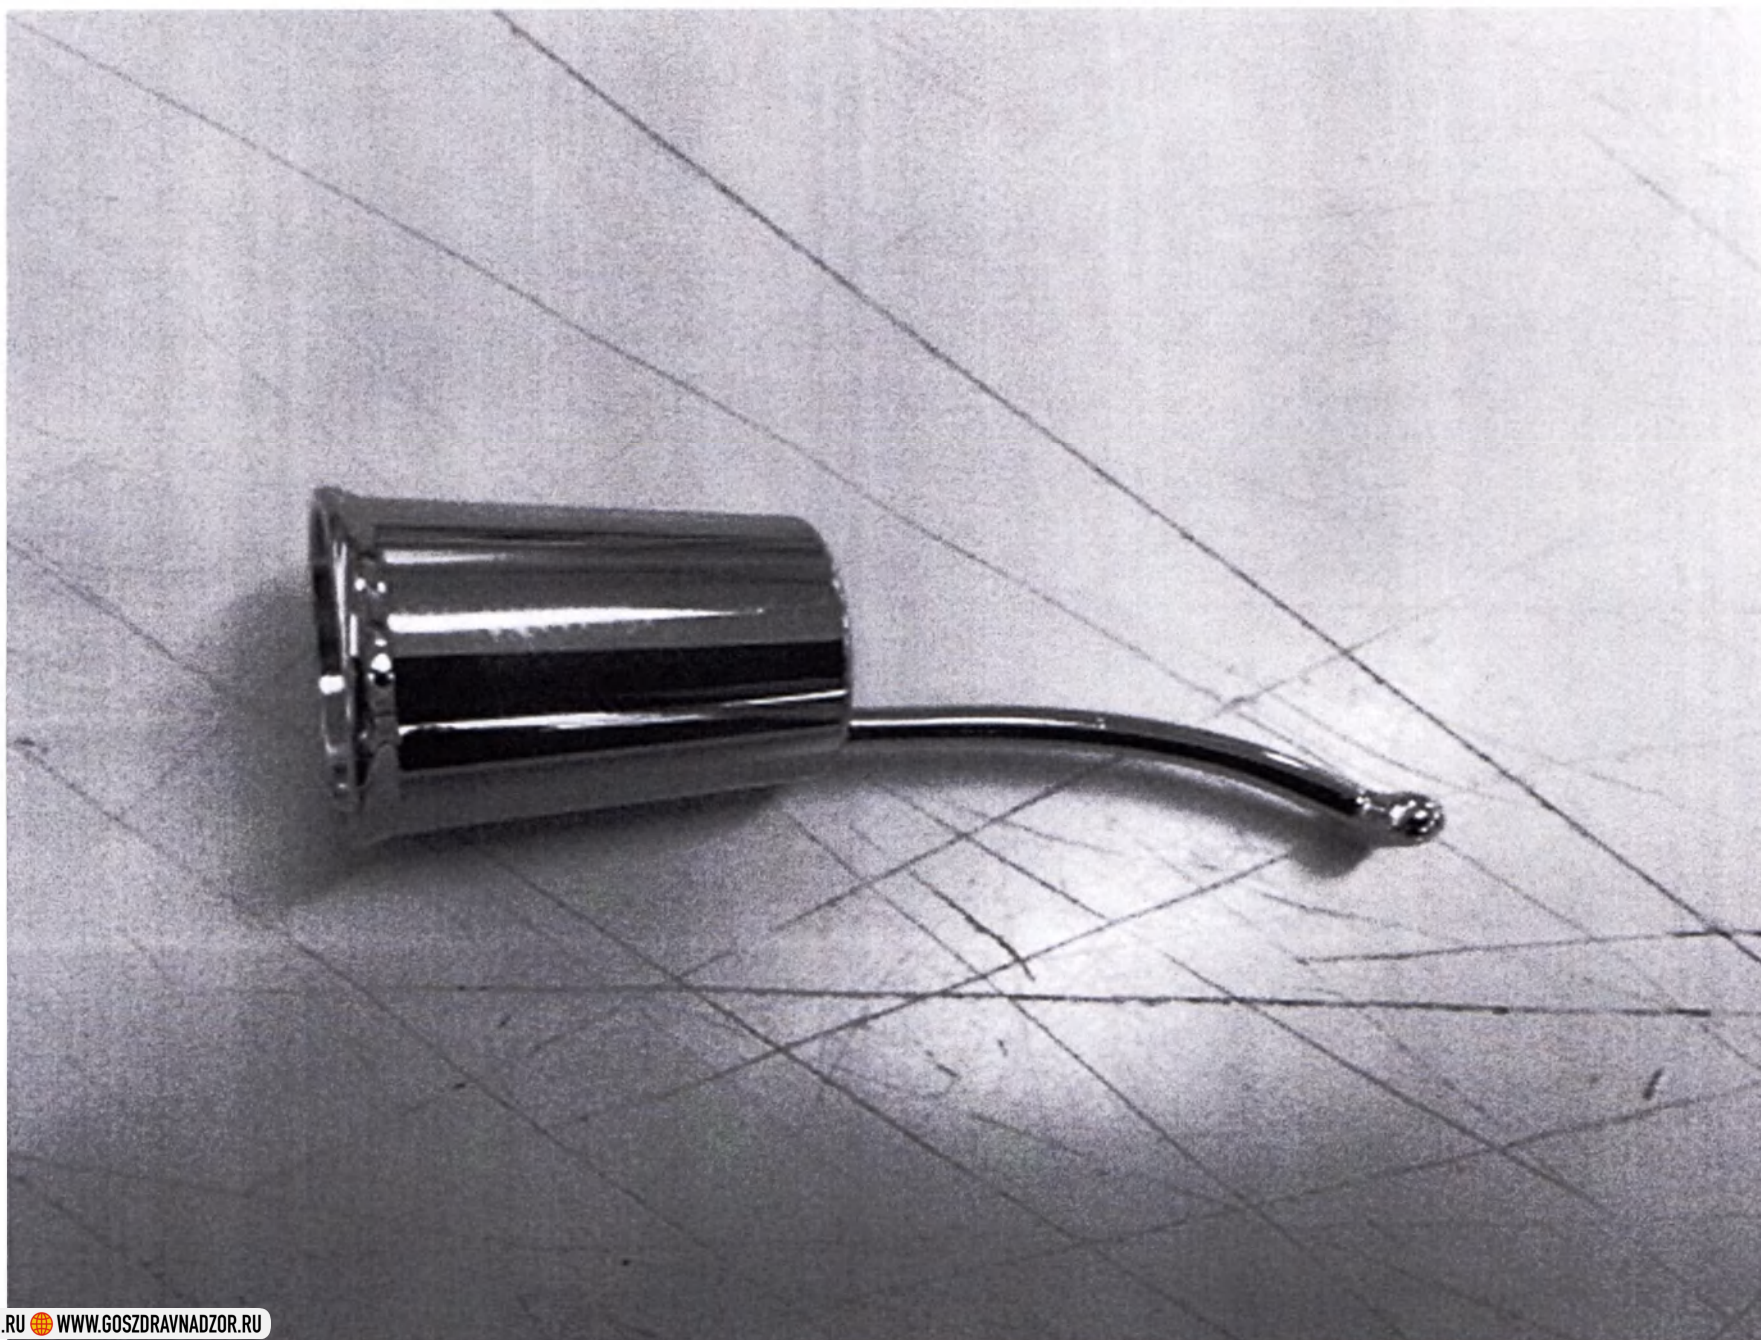


4. Лампа галогеновая:

Общий вид.



5. Резиновая оправа окуляров:

Общий вид.

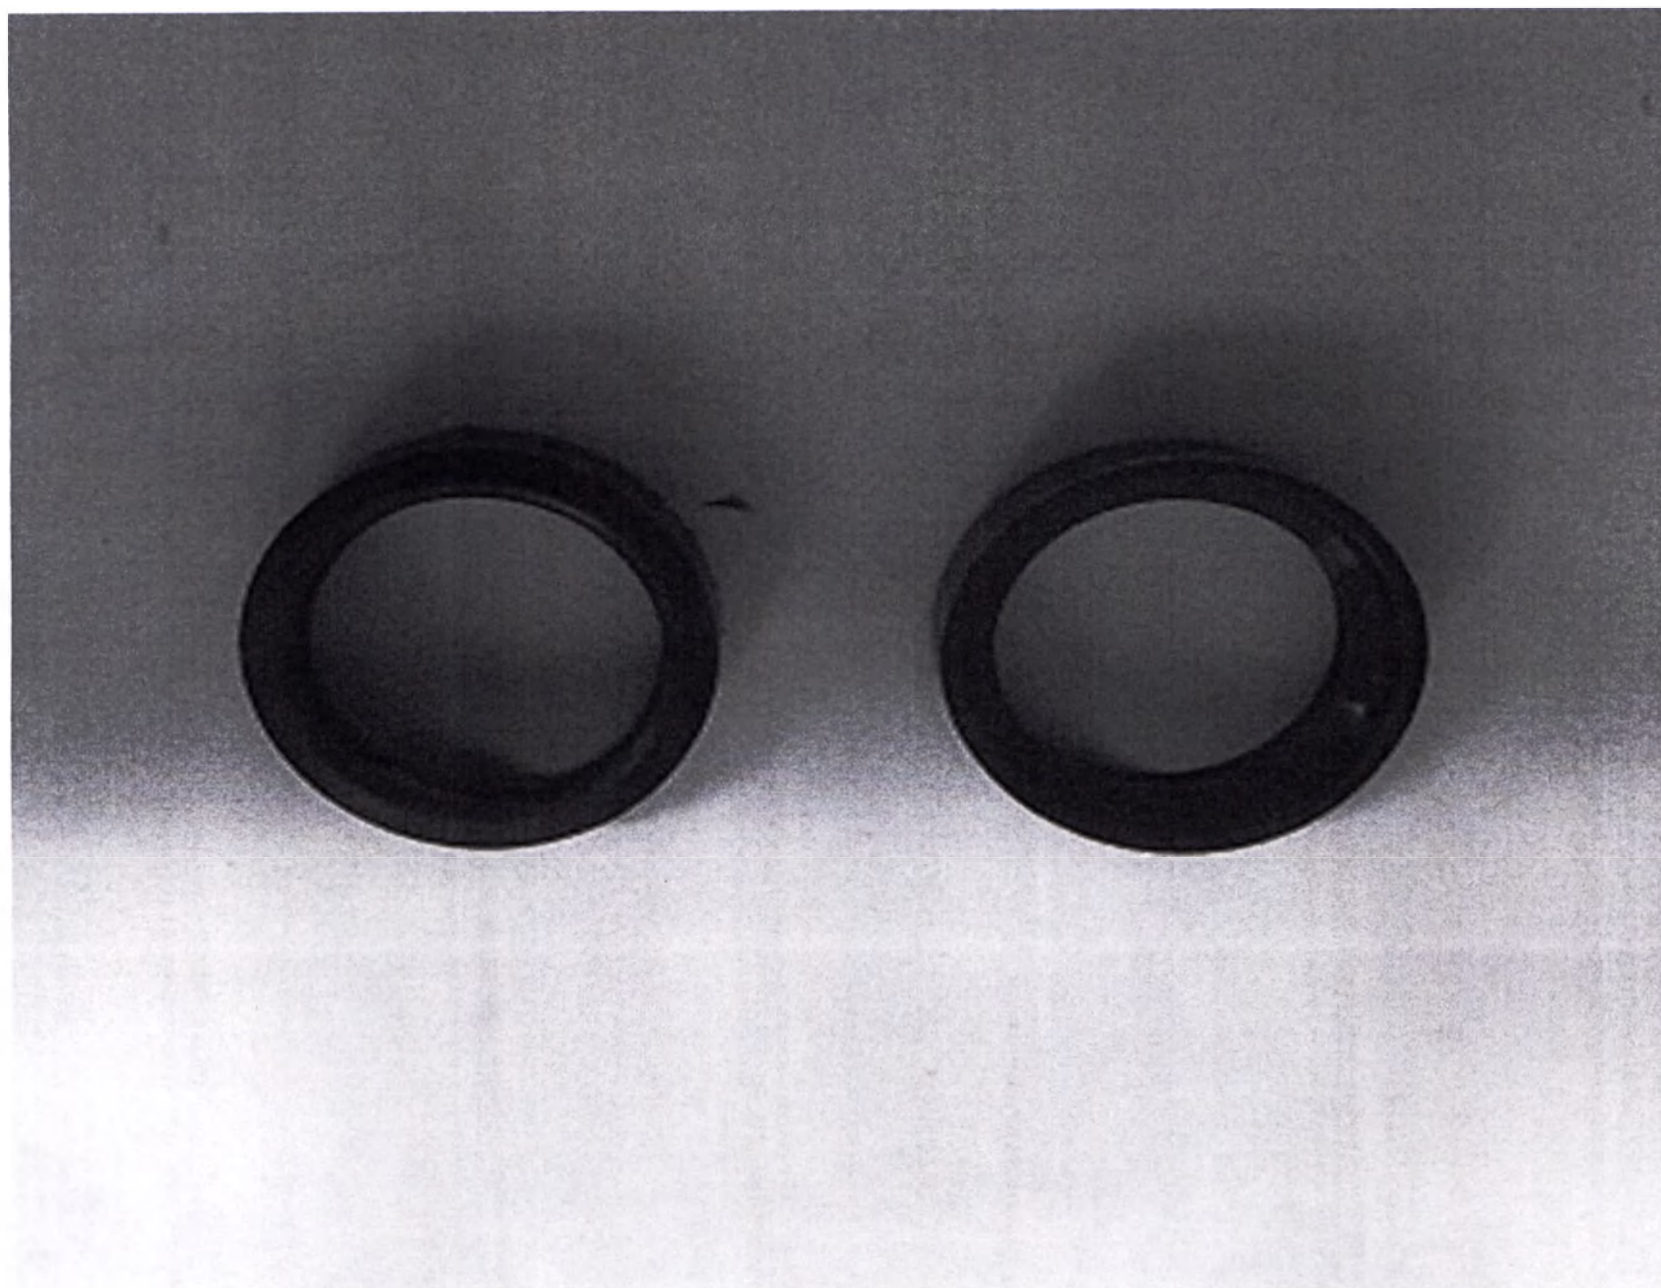


6. Шнурок для оправы:

Общий вид.



7. Защитный щиток в оправе:

Общий вид.

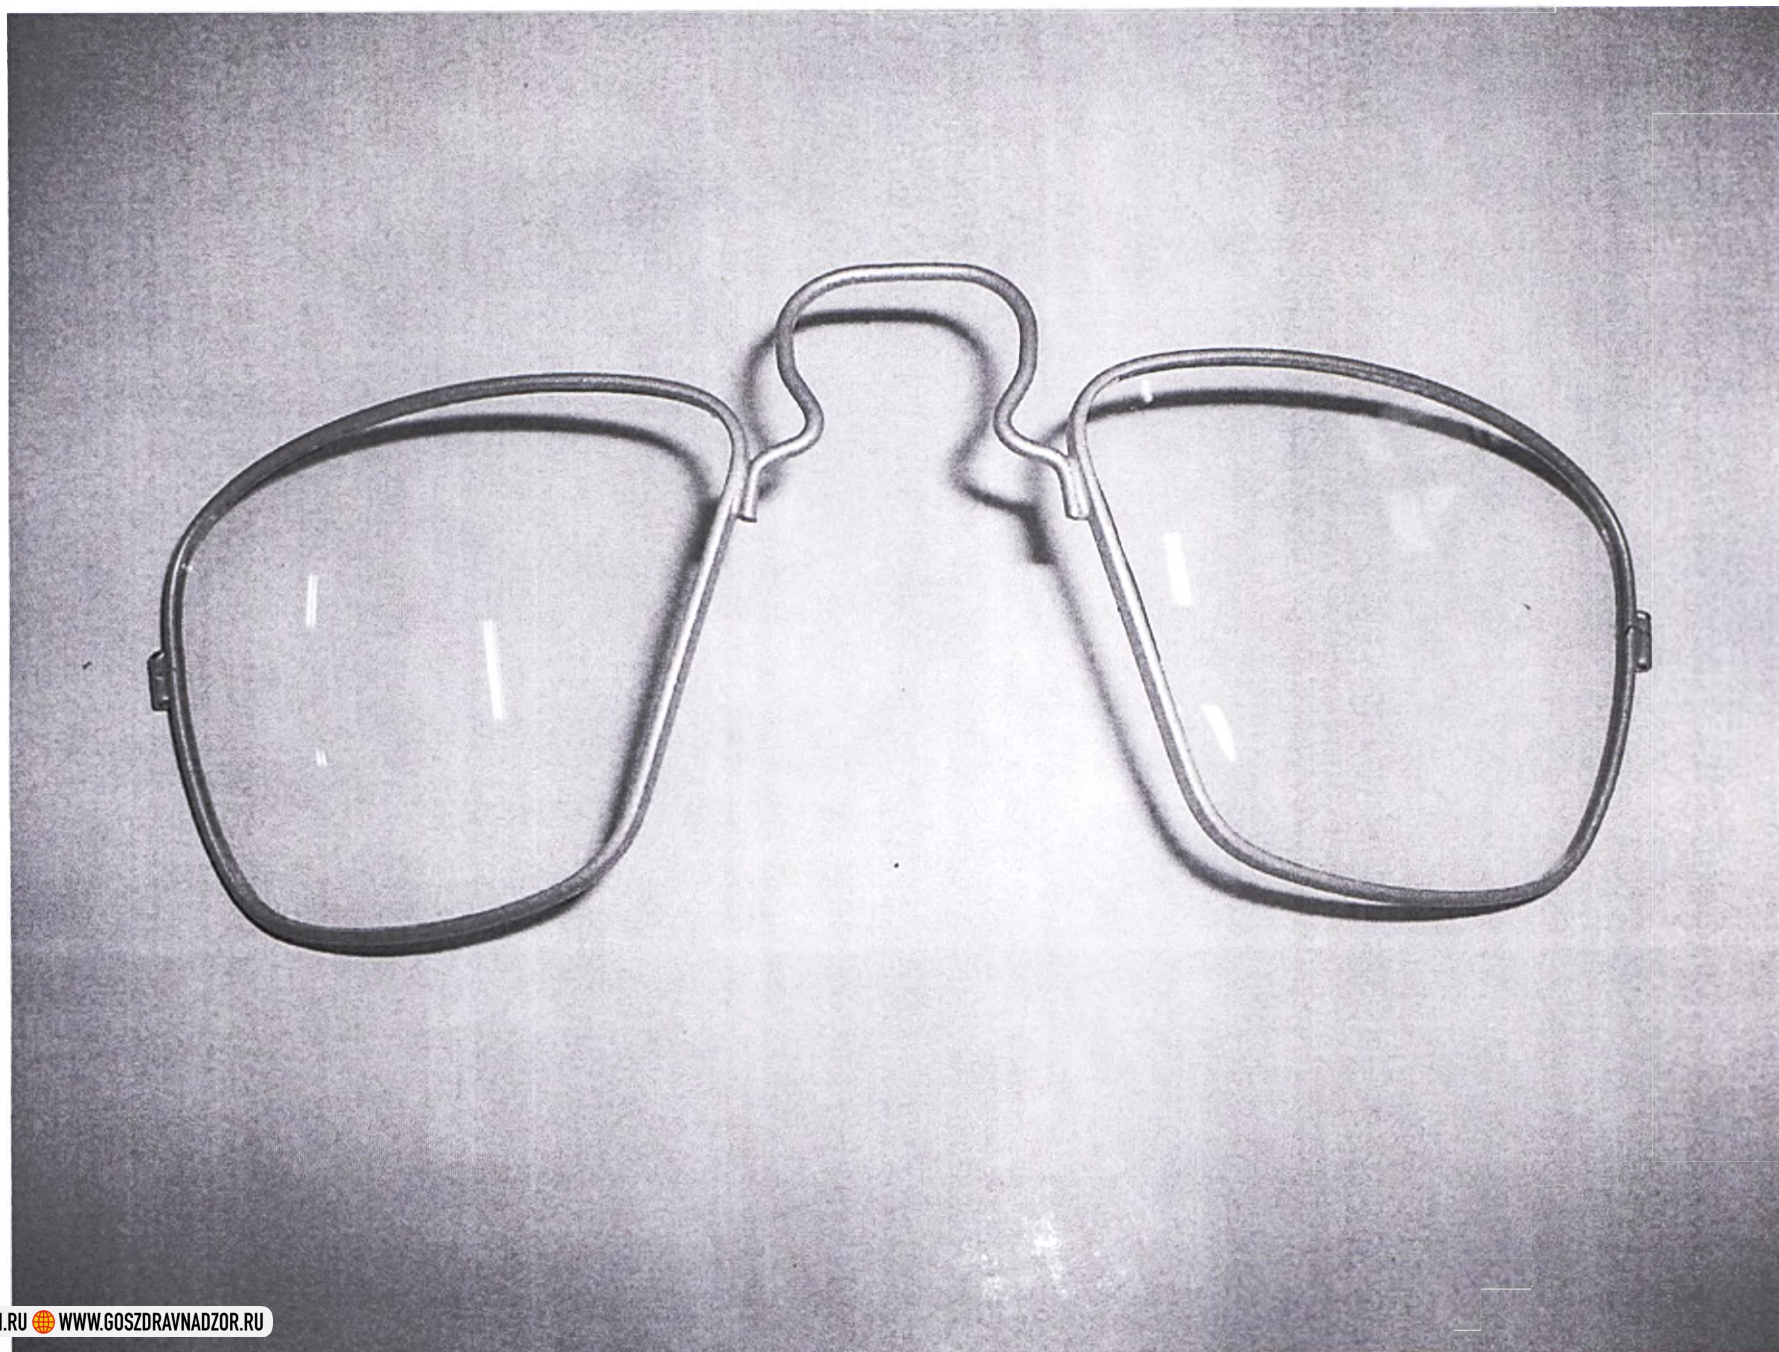

8. Аккумулятор портативный:

Общий вид.



9. Блок зарядный для аккумулятора портативного:

Общий вид.



10. Адаптер сетевой:

Общий вид.



11. Набор сетевых переходников: (вилка для Австралии – 1 шт.; вилка для США – 1 шт.; **Общий вид.**
вилка для Европы – 1 шт.; вилка для Великобритании – 1 шт.):




12. Кейс транспортный:

Общий вид.




13. Салфетка тканная для объектива:


Общий вид.

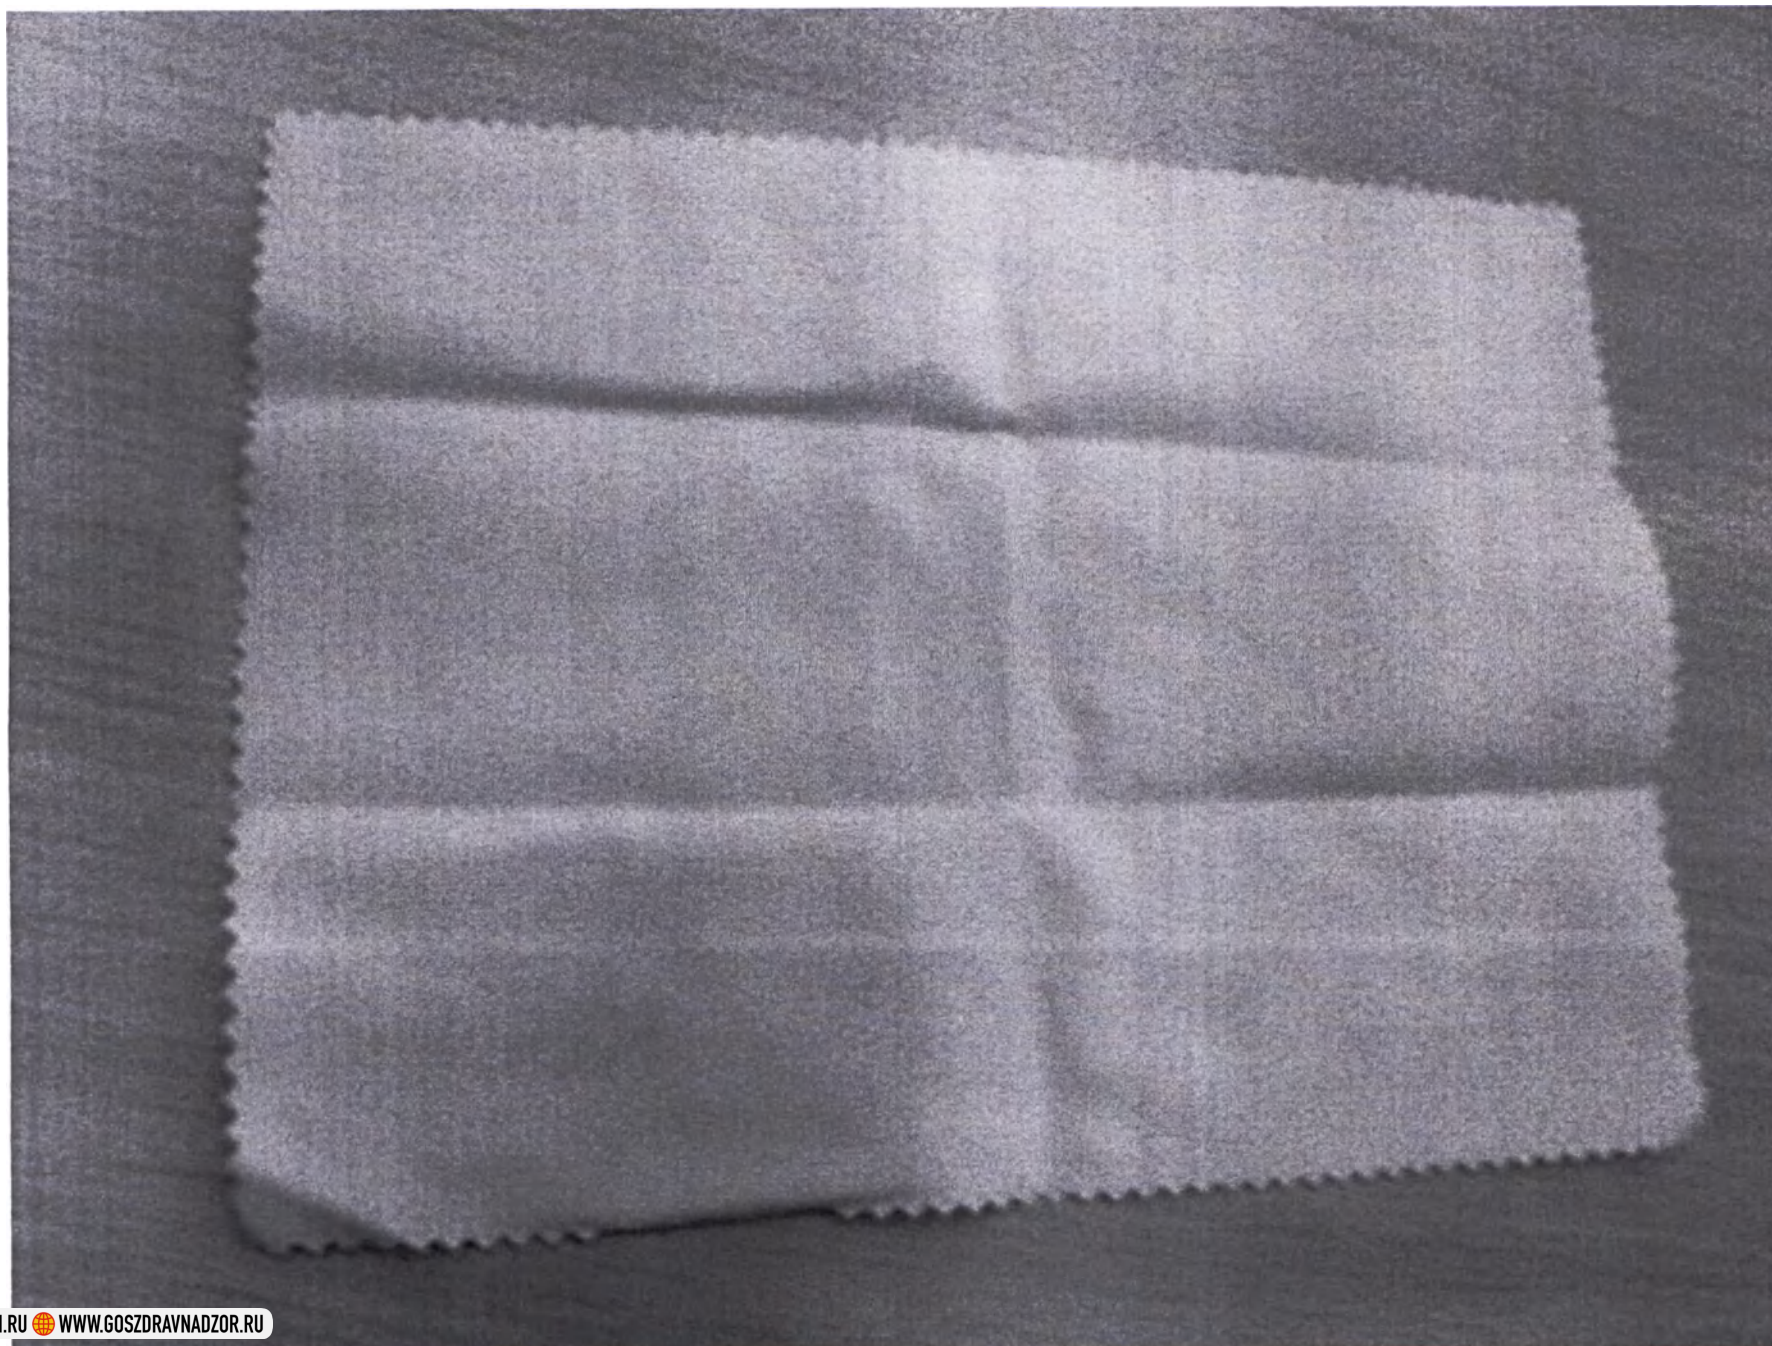

14. Насадка трансиллюминаторная Finoff:


Общий вид.

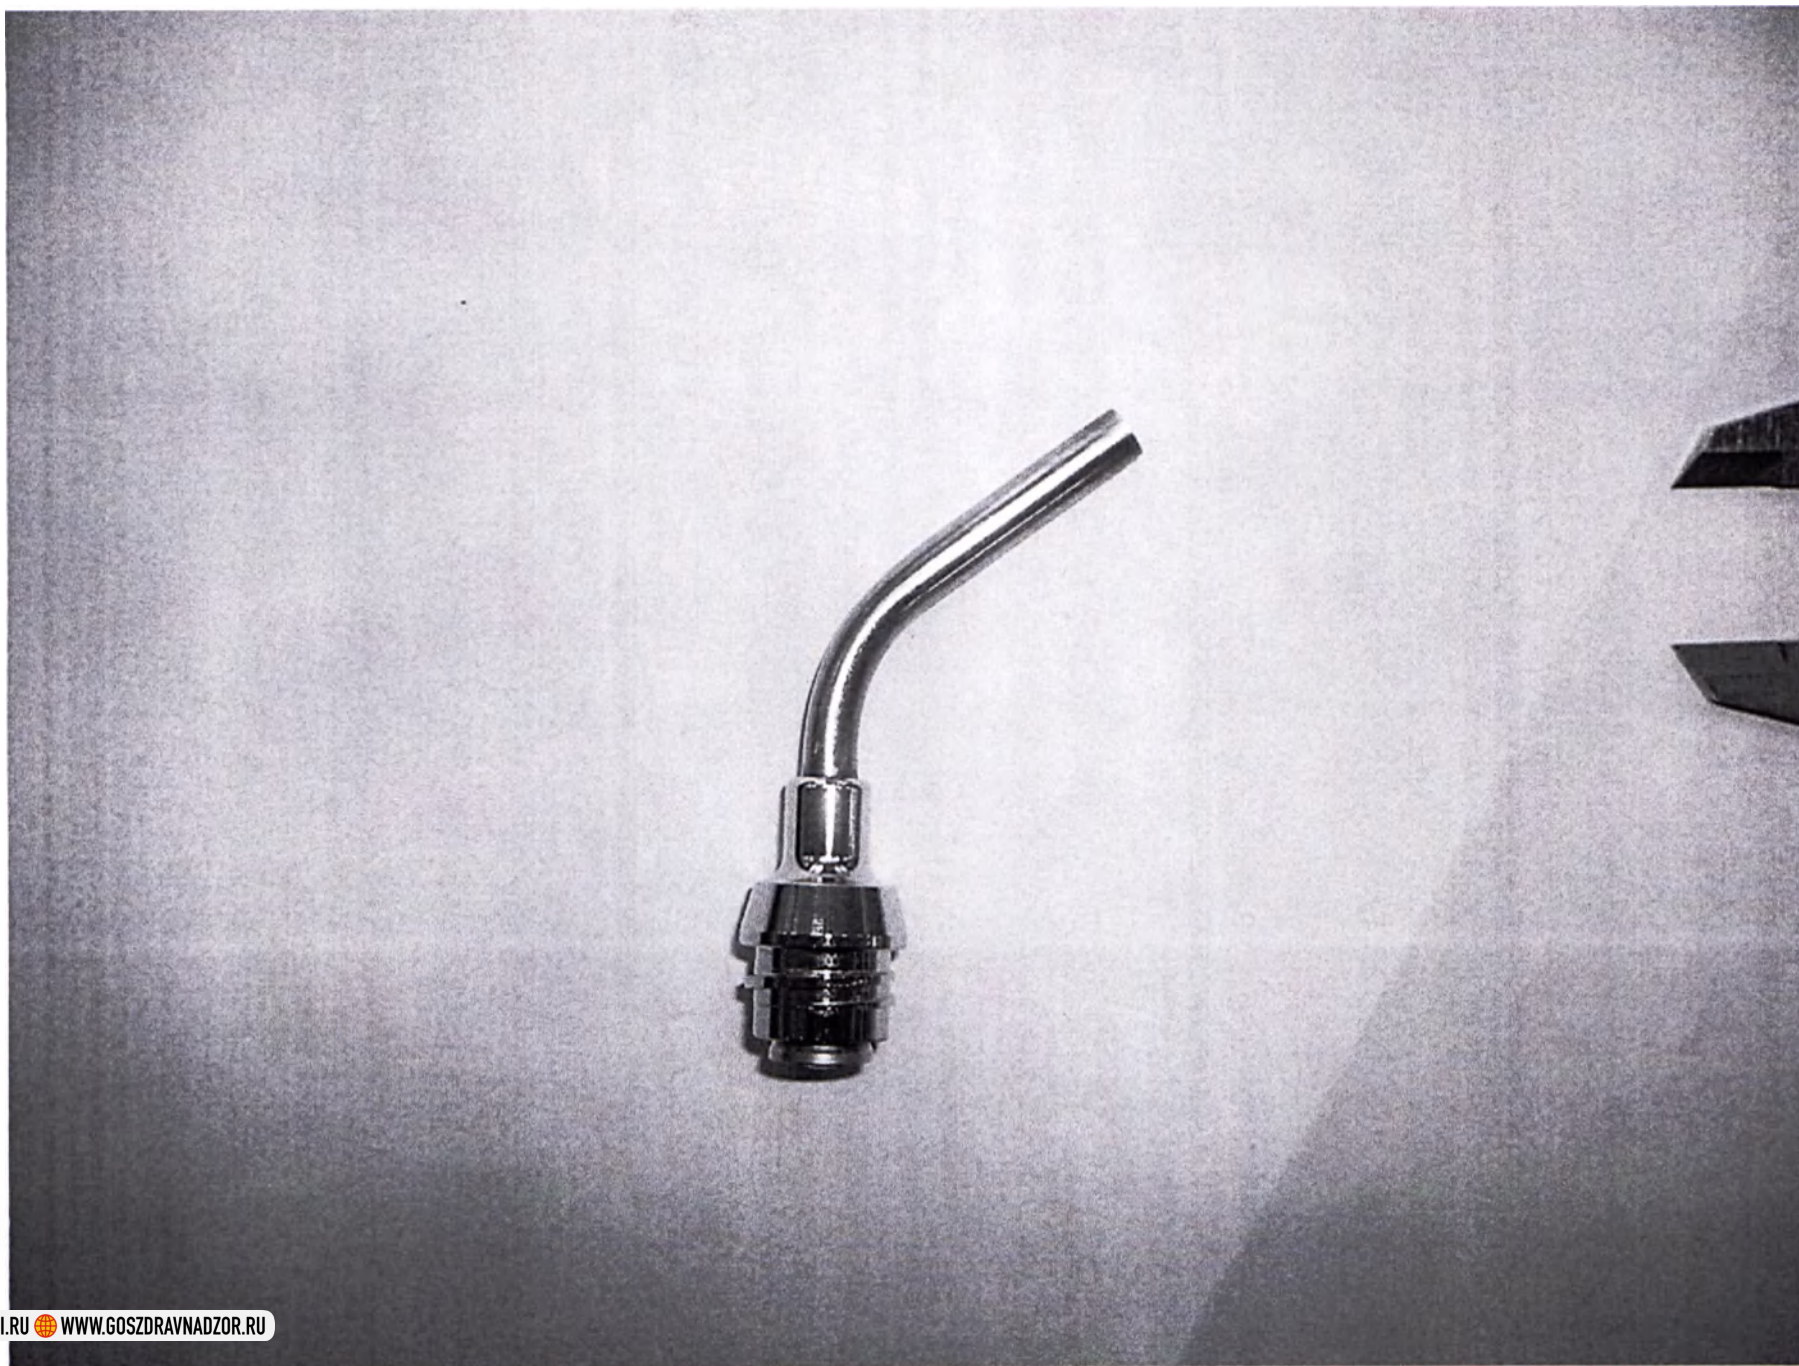

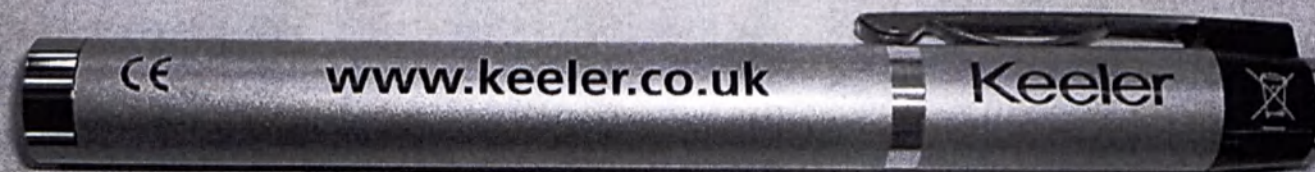

16. Диск с руководством по эксплуатации:

Общий вид.

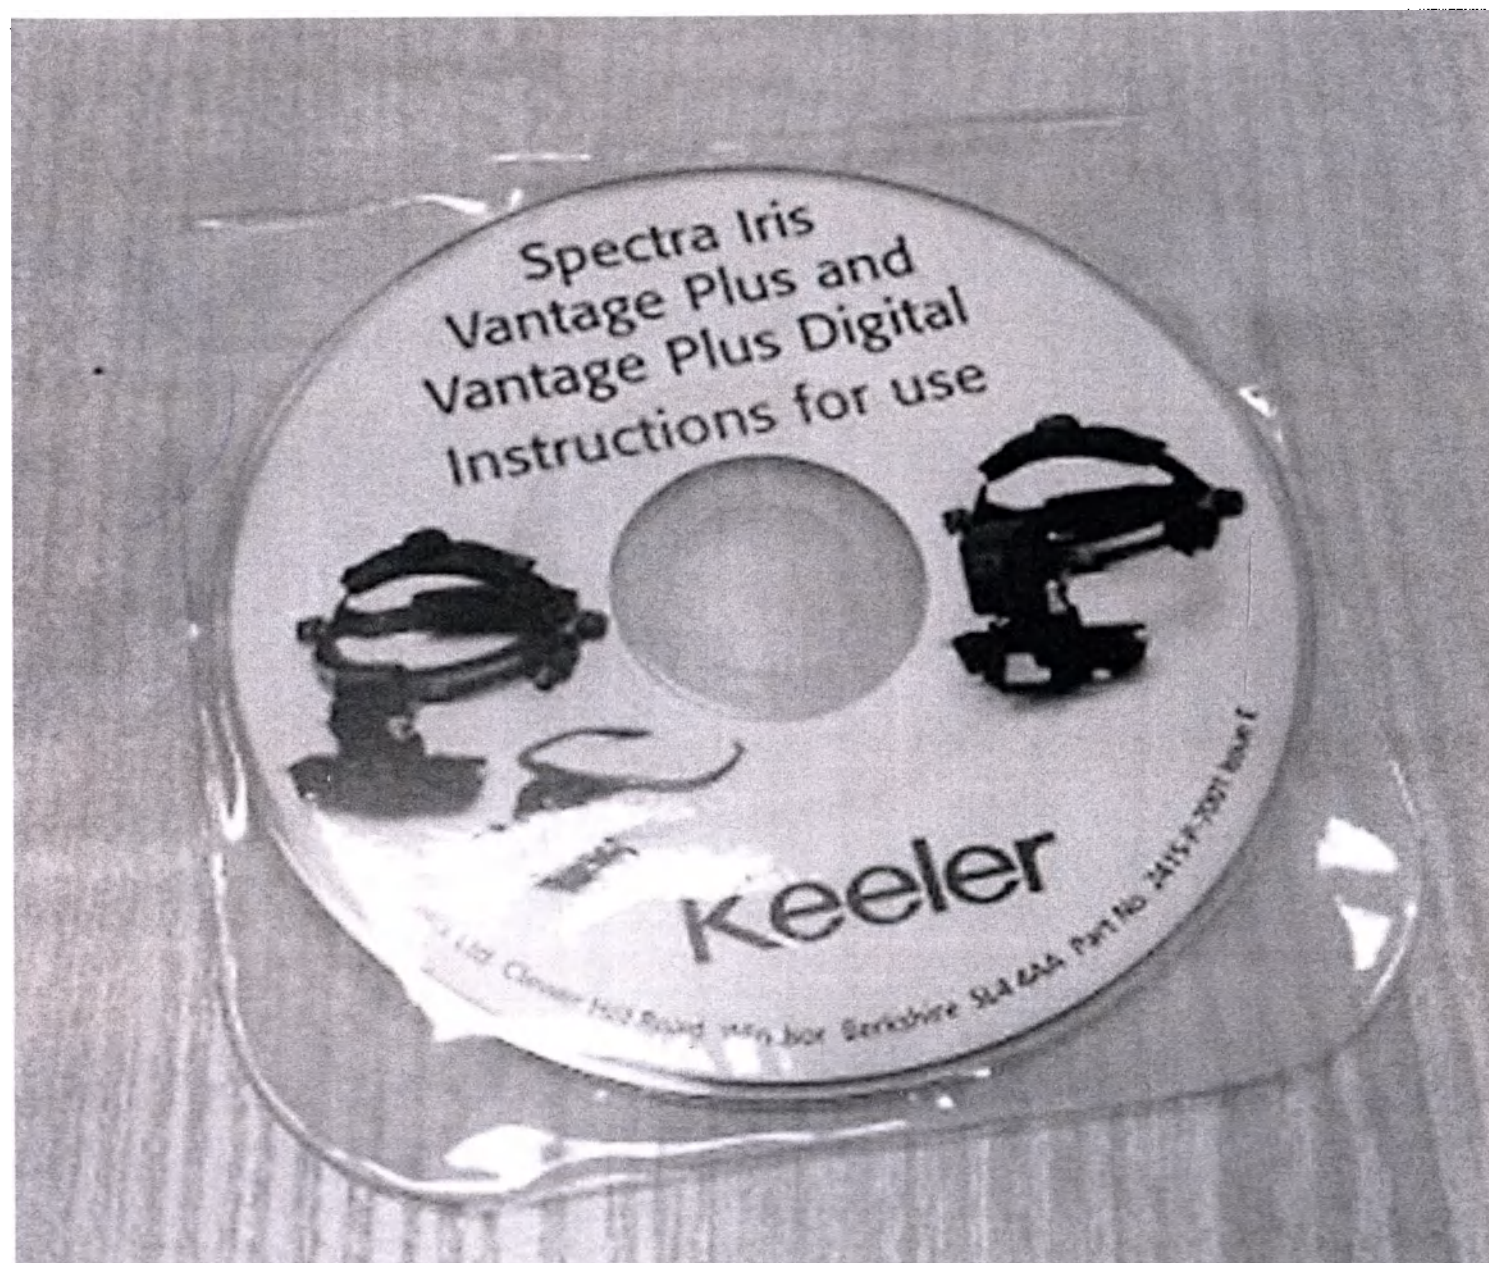

**Генеральный директор
ООО «МТО-Сторм»
Брук Е.В.**

