

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

25 (двадцать пять) листа(ов)
цифрами прописью Селевский КВ Ф.И.О.
заместитель начальника ЛЦ



Селевский КВ личная подпись
В.В. 19/

(ЗФ-01-СОП-03-03)

Руководитель отдела качества и корпоративных технологий

ООО «Сименс Здравоохранение»




И.Б. Медведева

2018 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Система рентгенографическая цифровая Multix Fusion Max в исполнениях с принадлежностями»

Система рентгенографическая цифровая Multix Fusion Max : Общий вид.

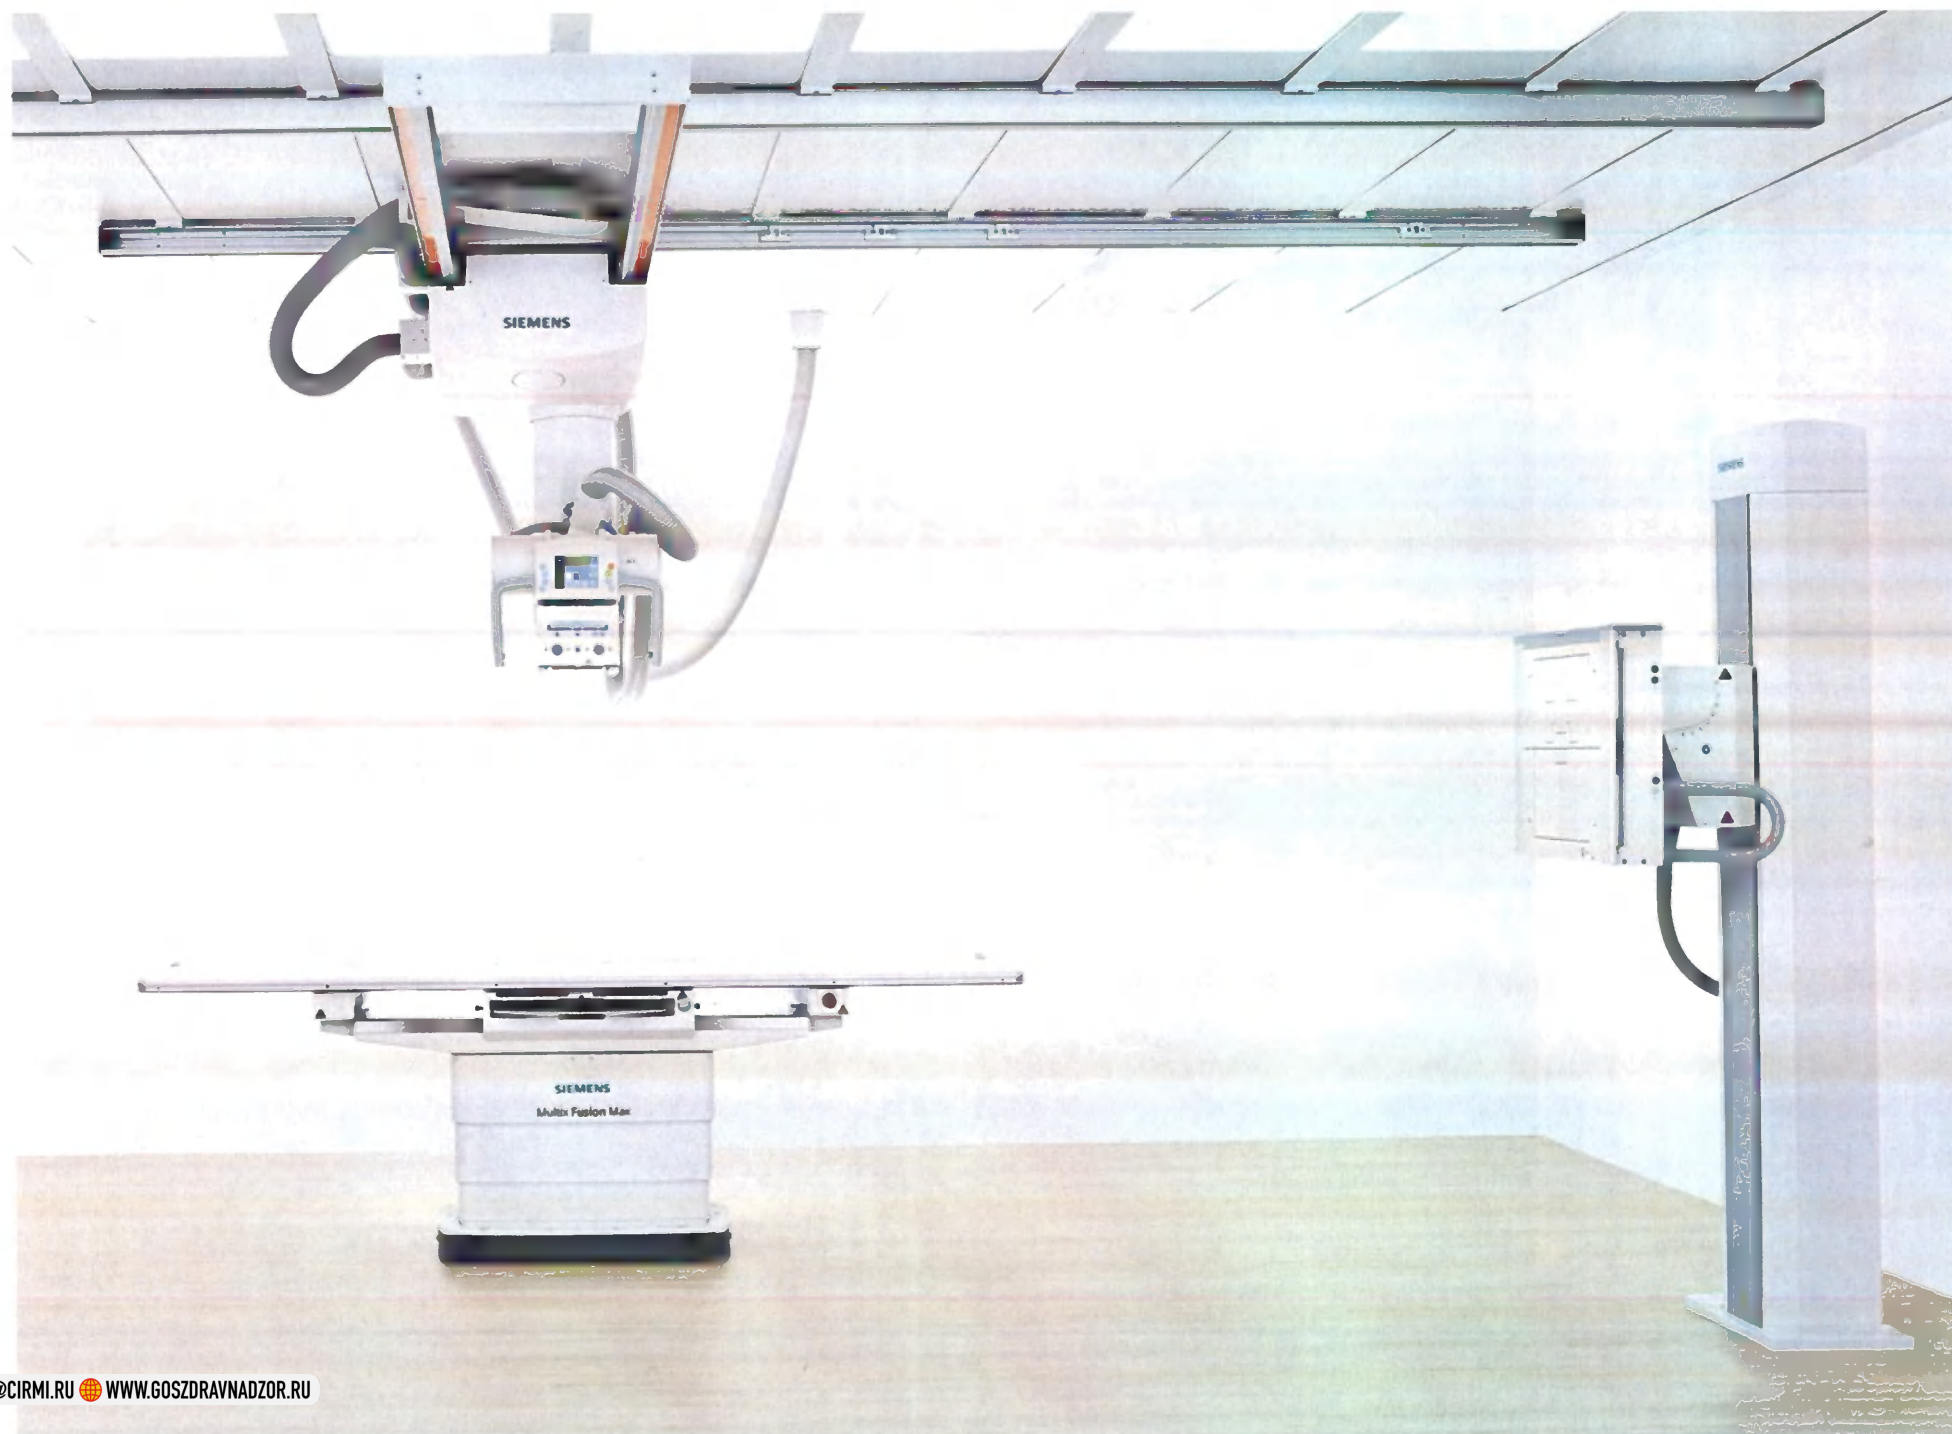

**Базовый состав 1: Штатив потолочный в составе: - штатив потолочный ; - блок рентгеновской трубки;
- коллиматор многолепестковый; - центратор лазерный с сенсорным интерфейсом,**

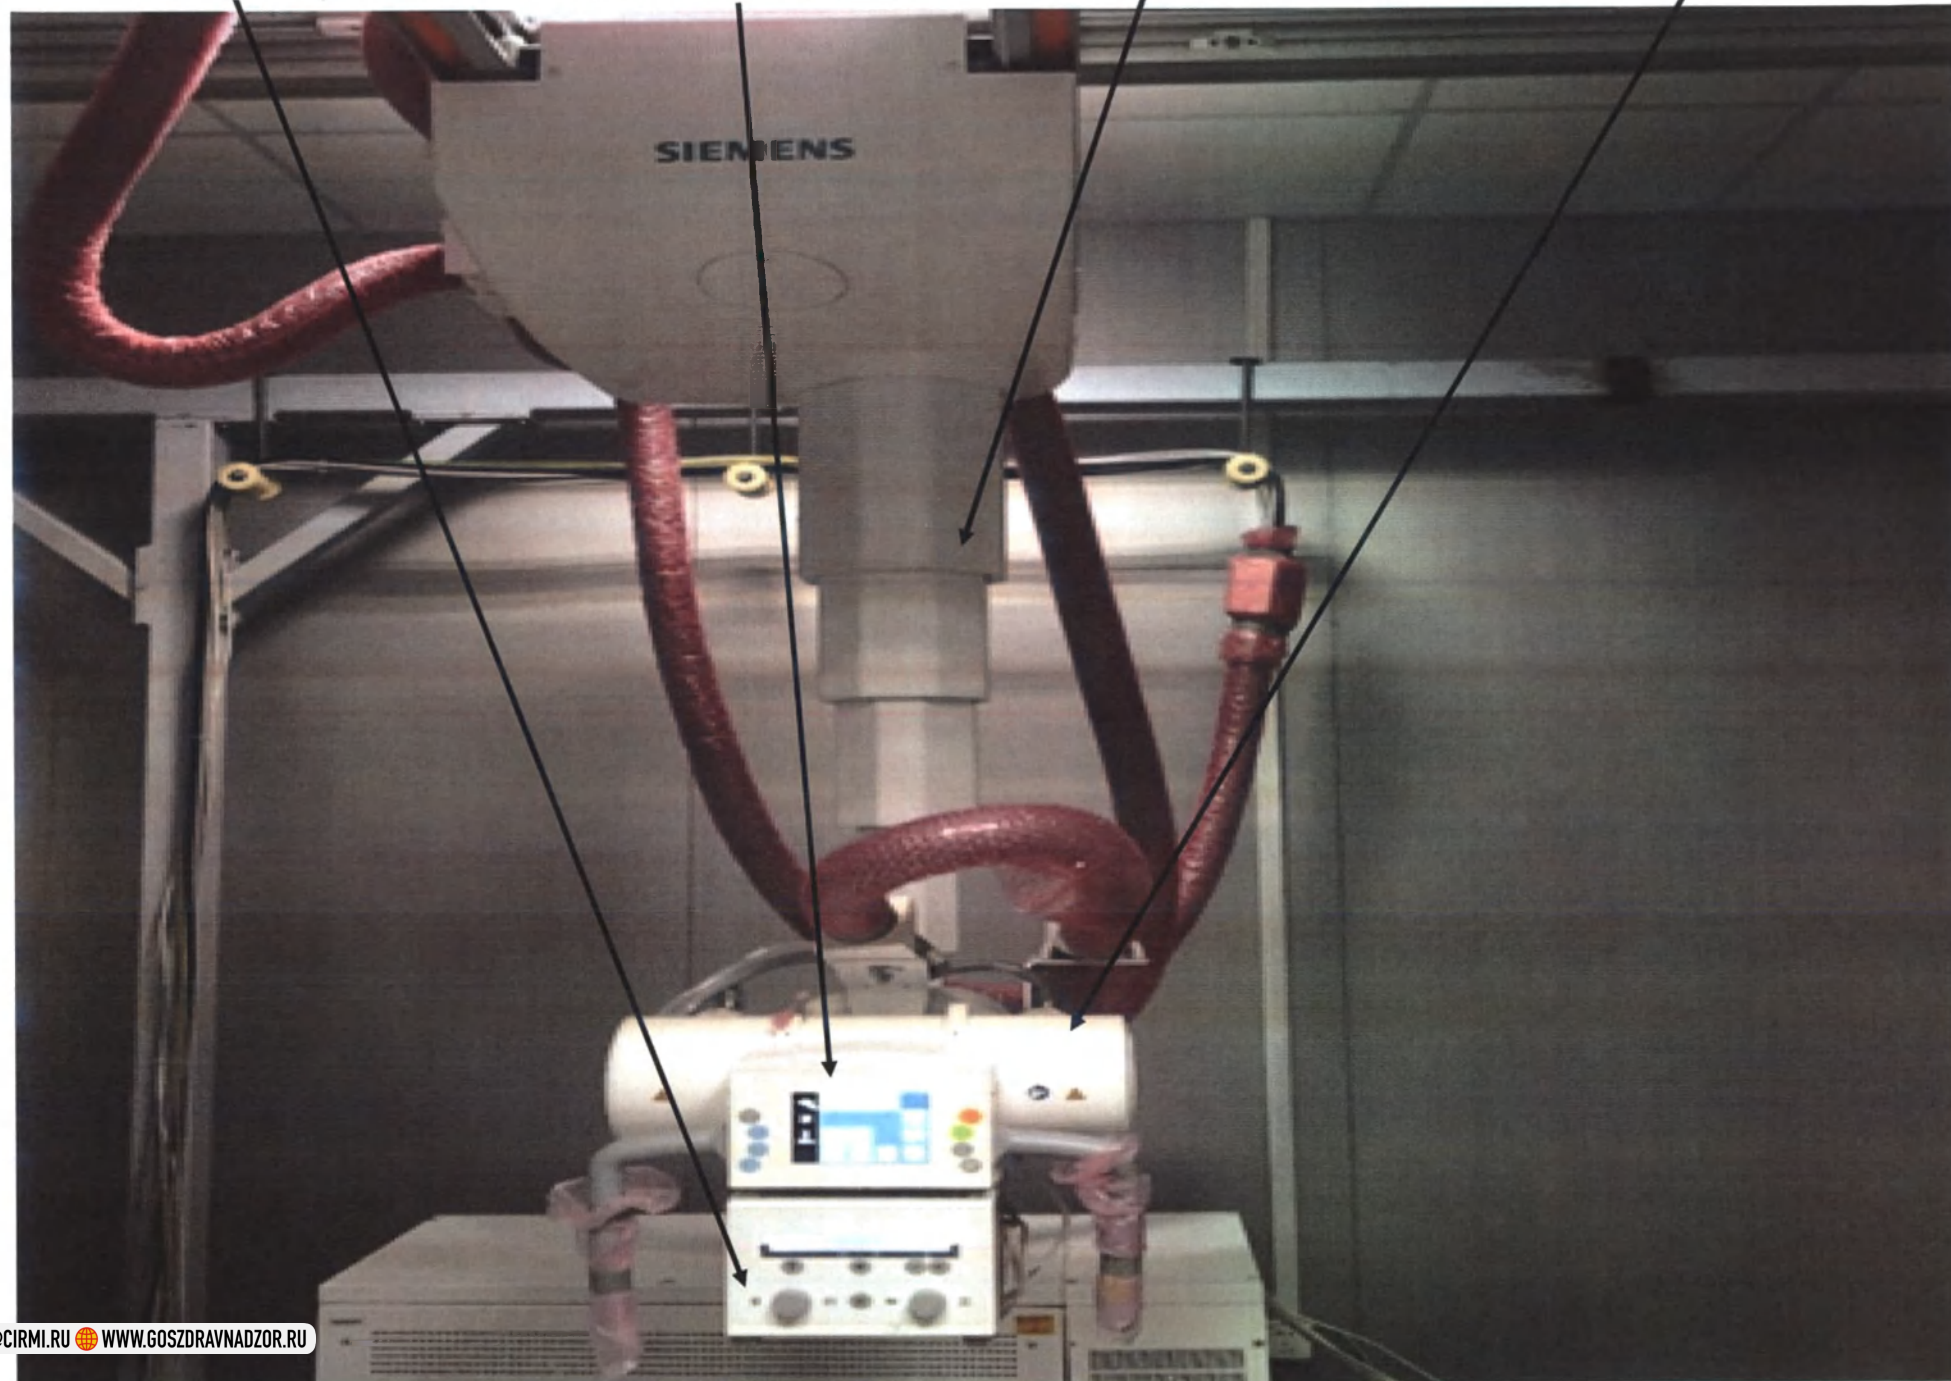

Базовый состав 1: Штатив потолочный в составе: - коллиматор многолепестковый.




Базовый состав 1: - Рельсы потолочные .




Базовый состав 1: Стол пациента.




Базовый состав 1: Стойка снимков вертикальная.

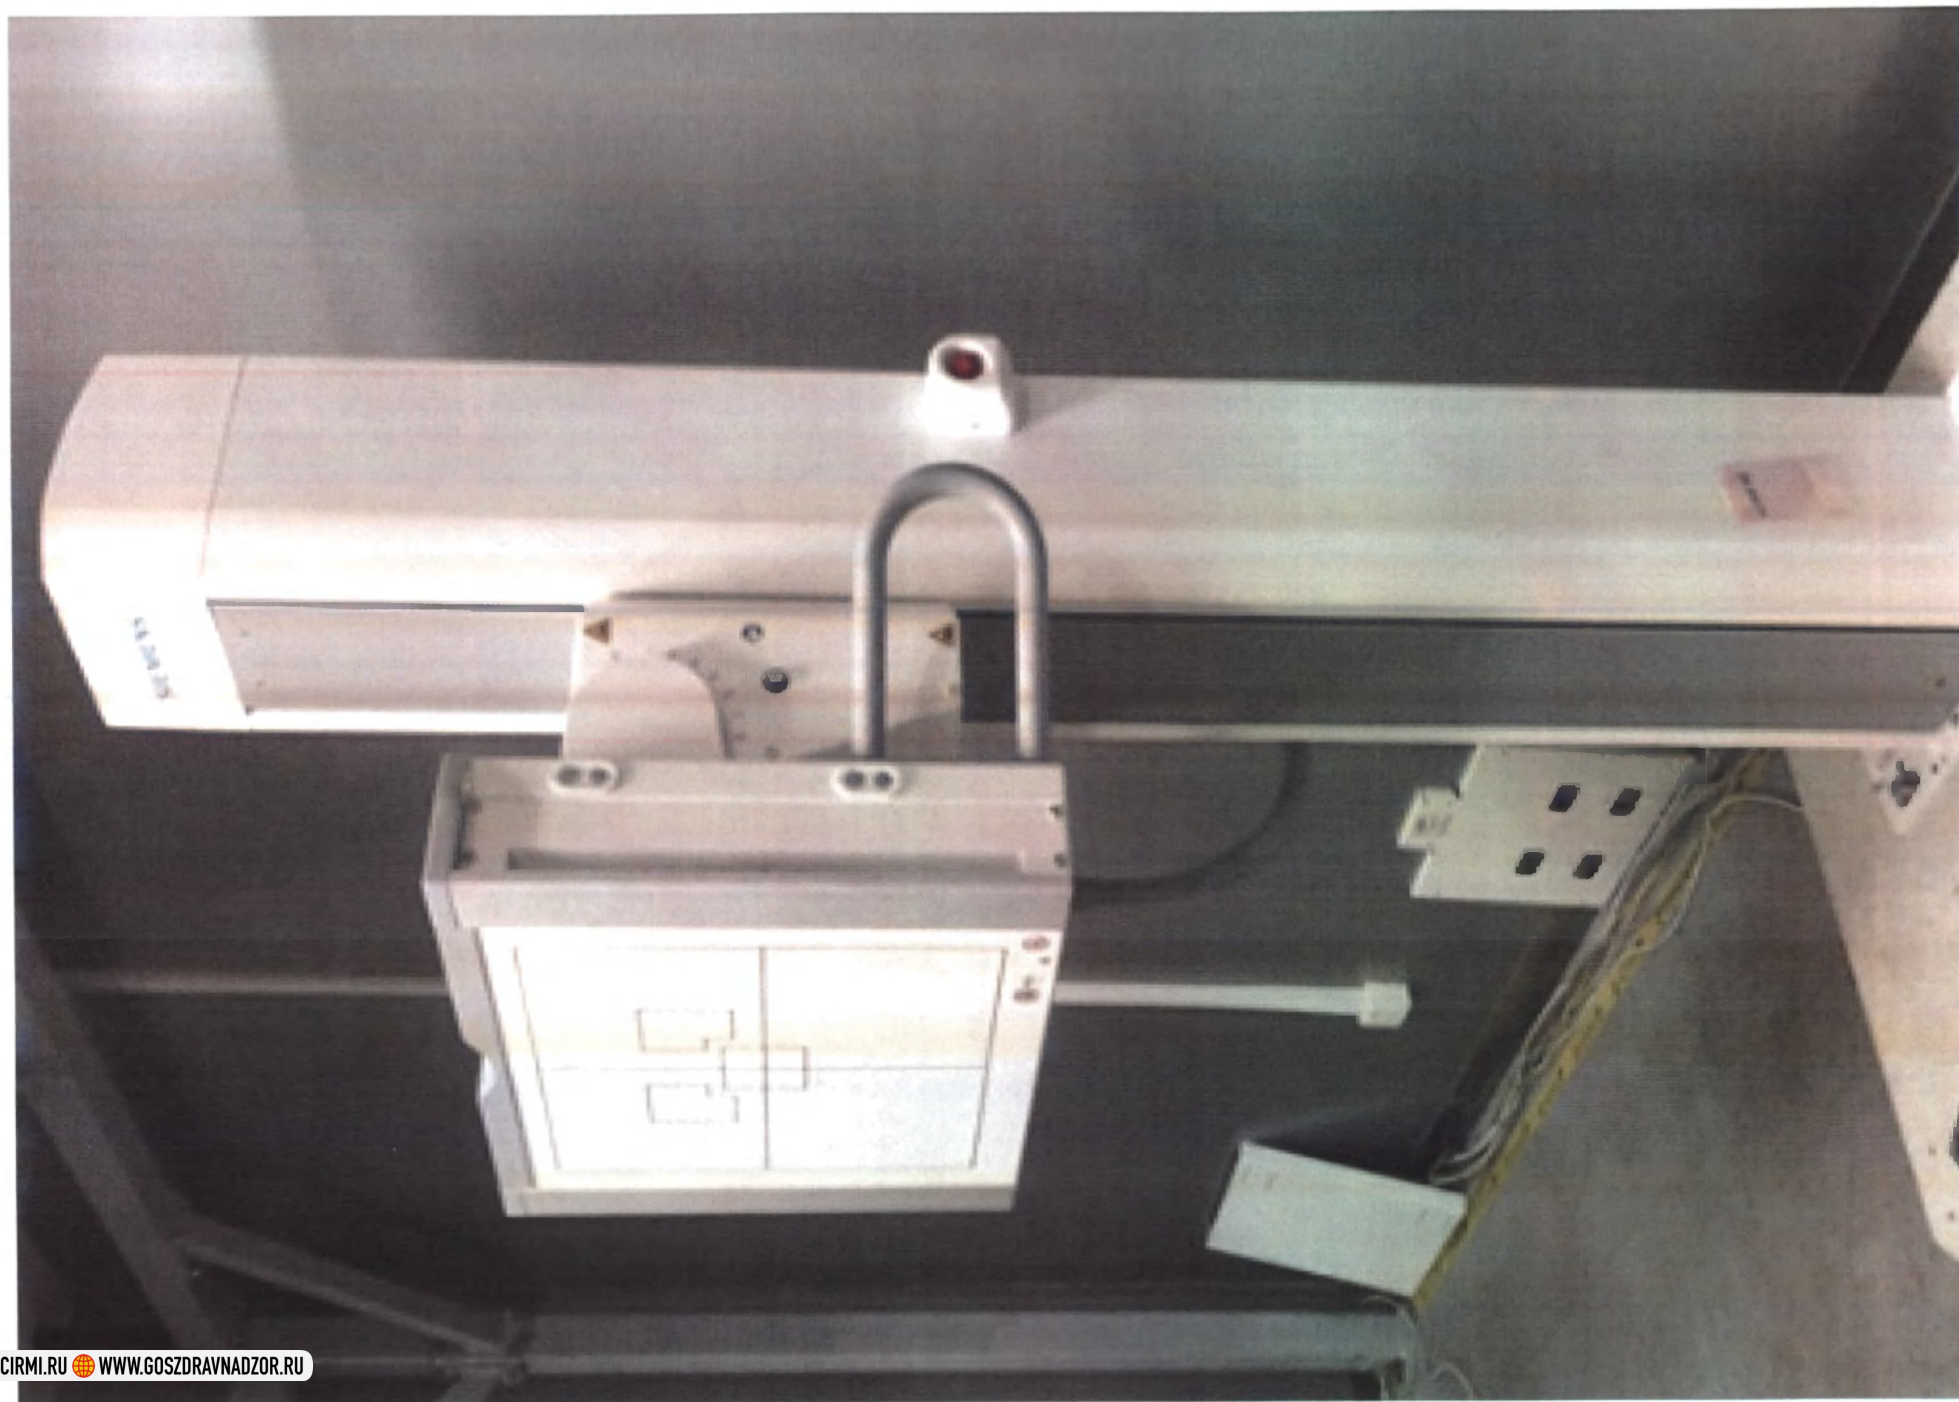

Базовый состав 1: Детектор беспроводной мобильный MAX wi-D и/или детектор беспроводной мобильный MAX mini (не более 5 шт.) и/или детектор встроенный MAX static .

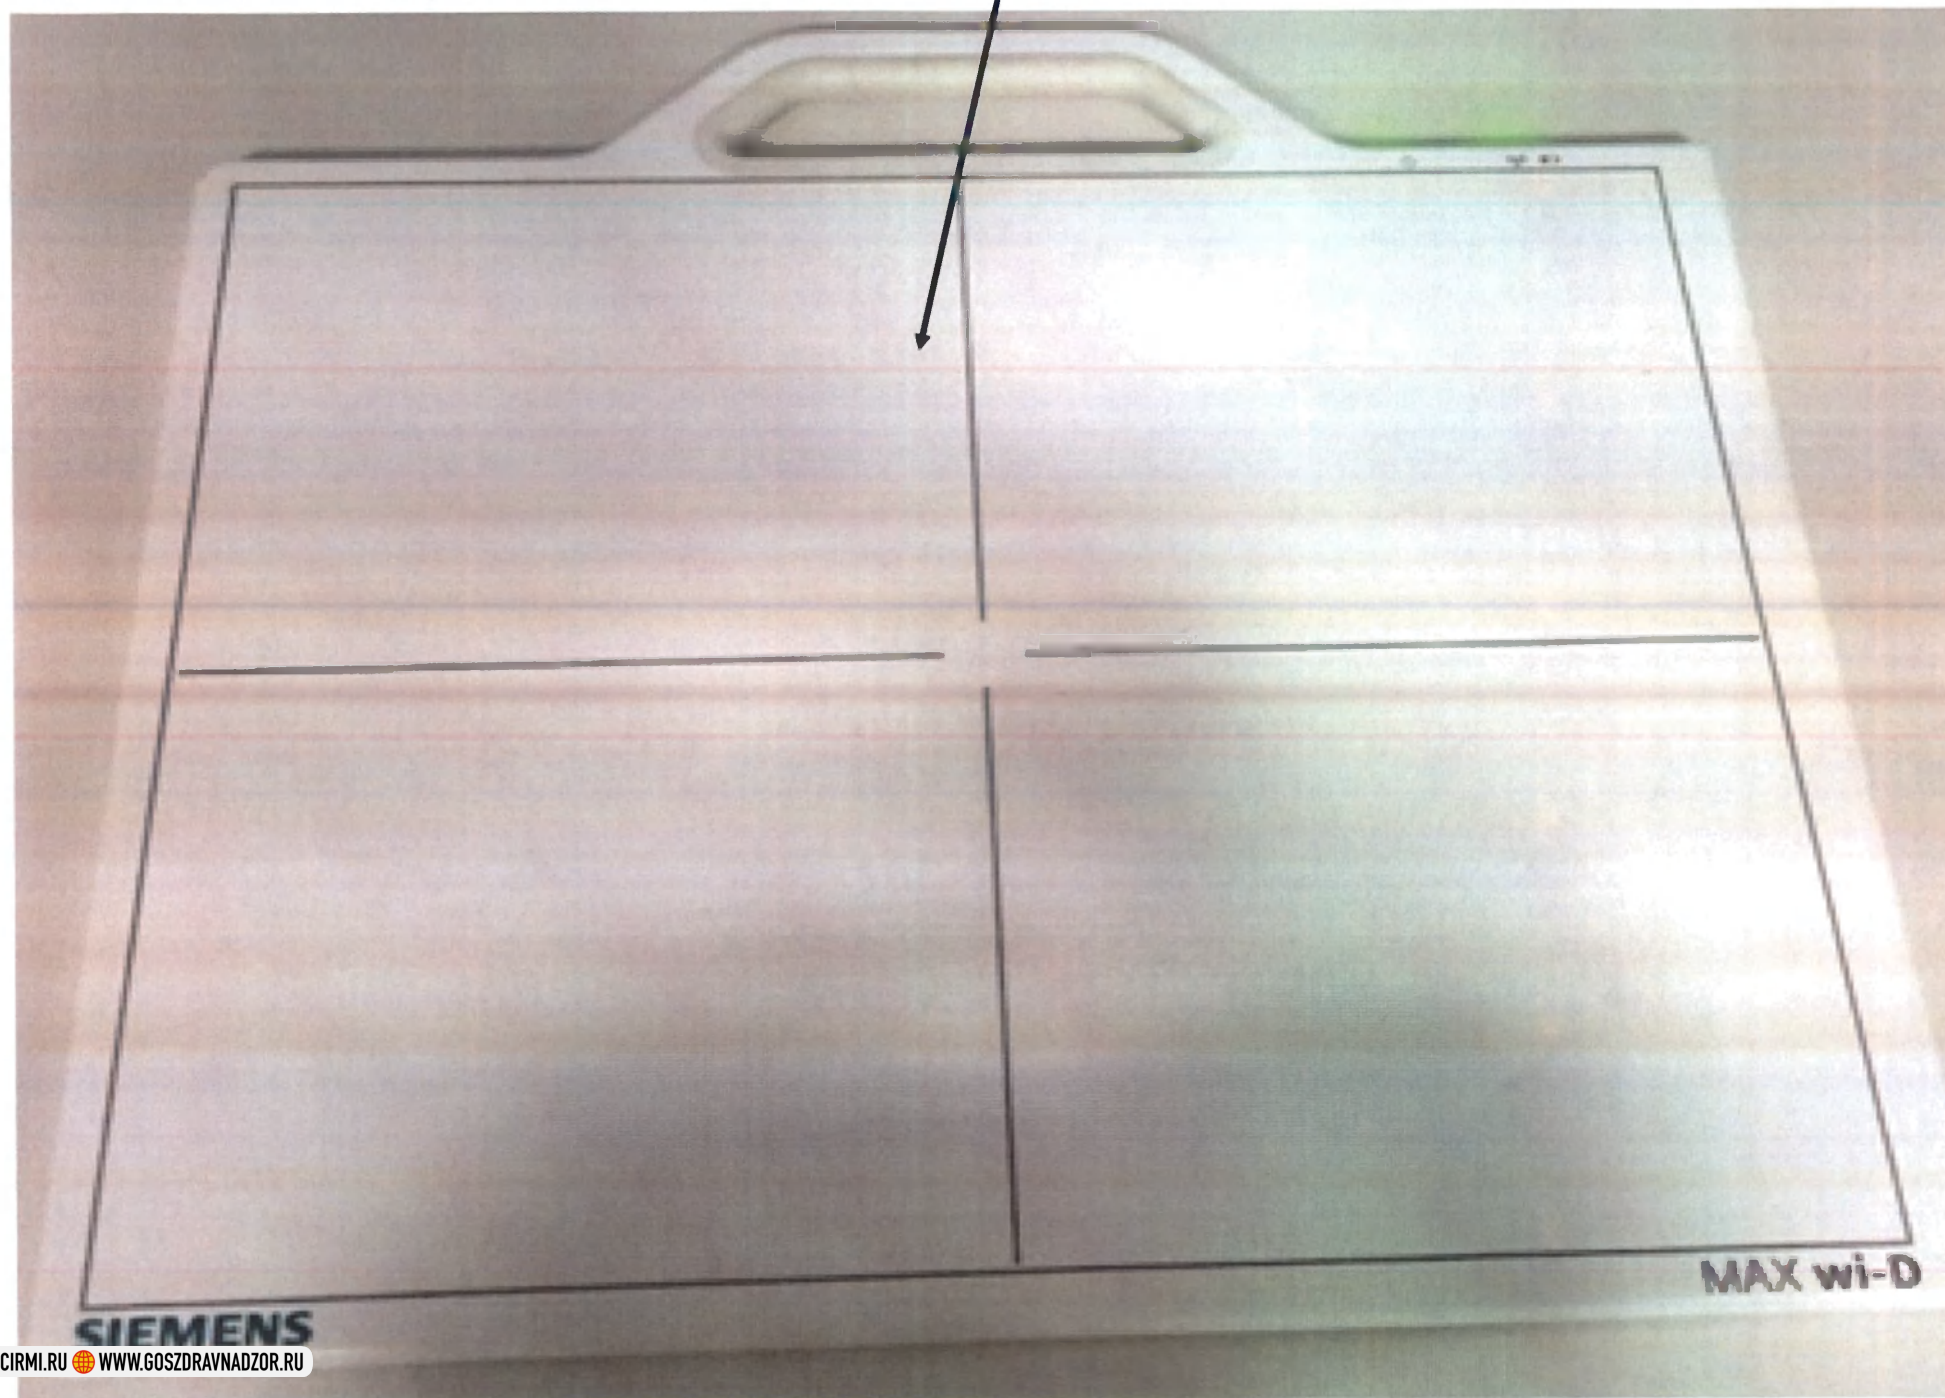


Базовый состав 1: Детектор беспроводной мобильный MAX wi-D и/или детектор беспроводной мобильный MAX mini (не более 5 шт.) и/или детектор встроенный MAX static .

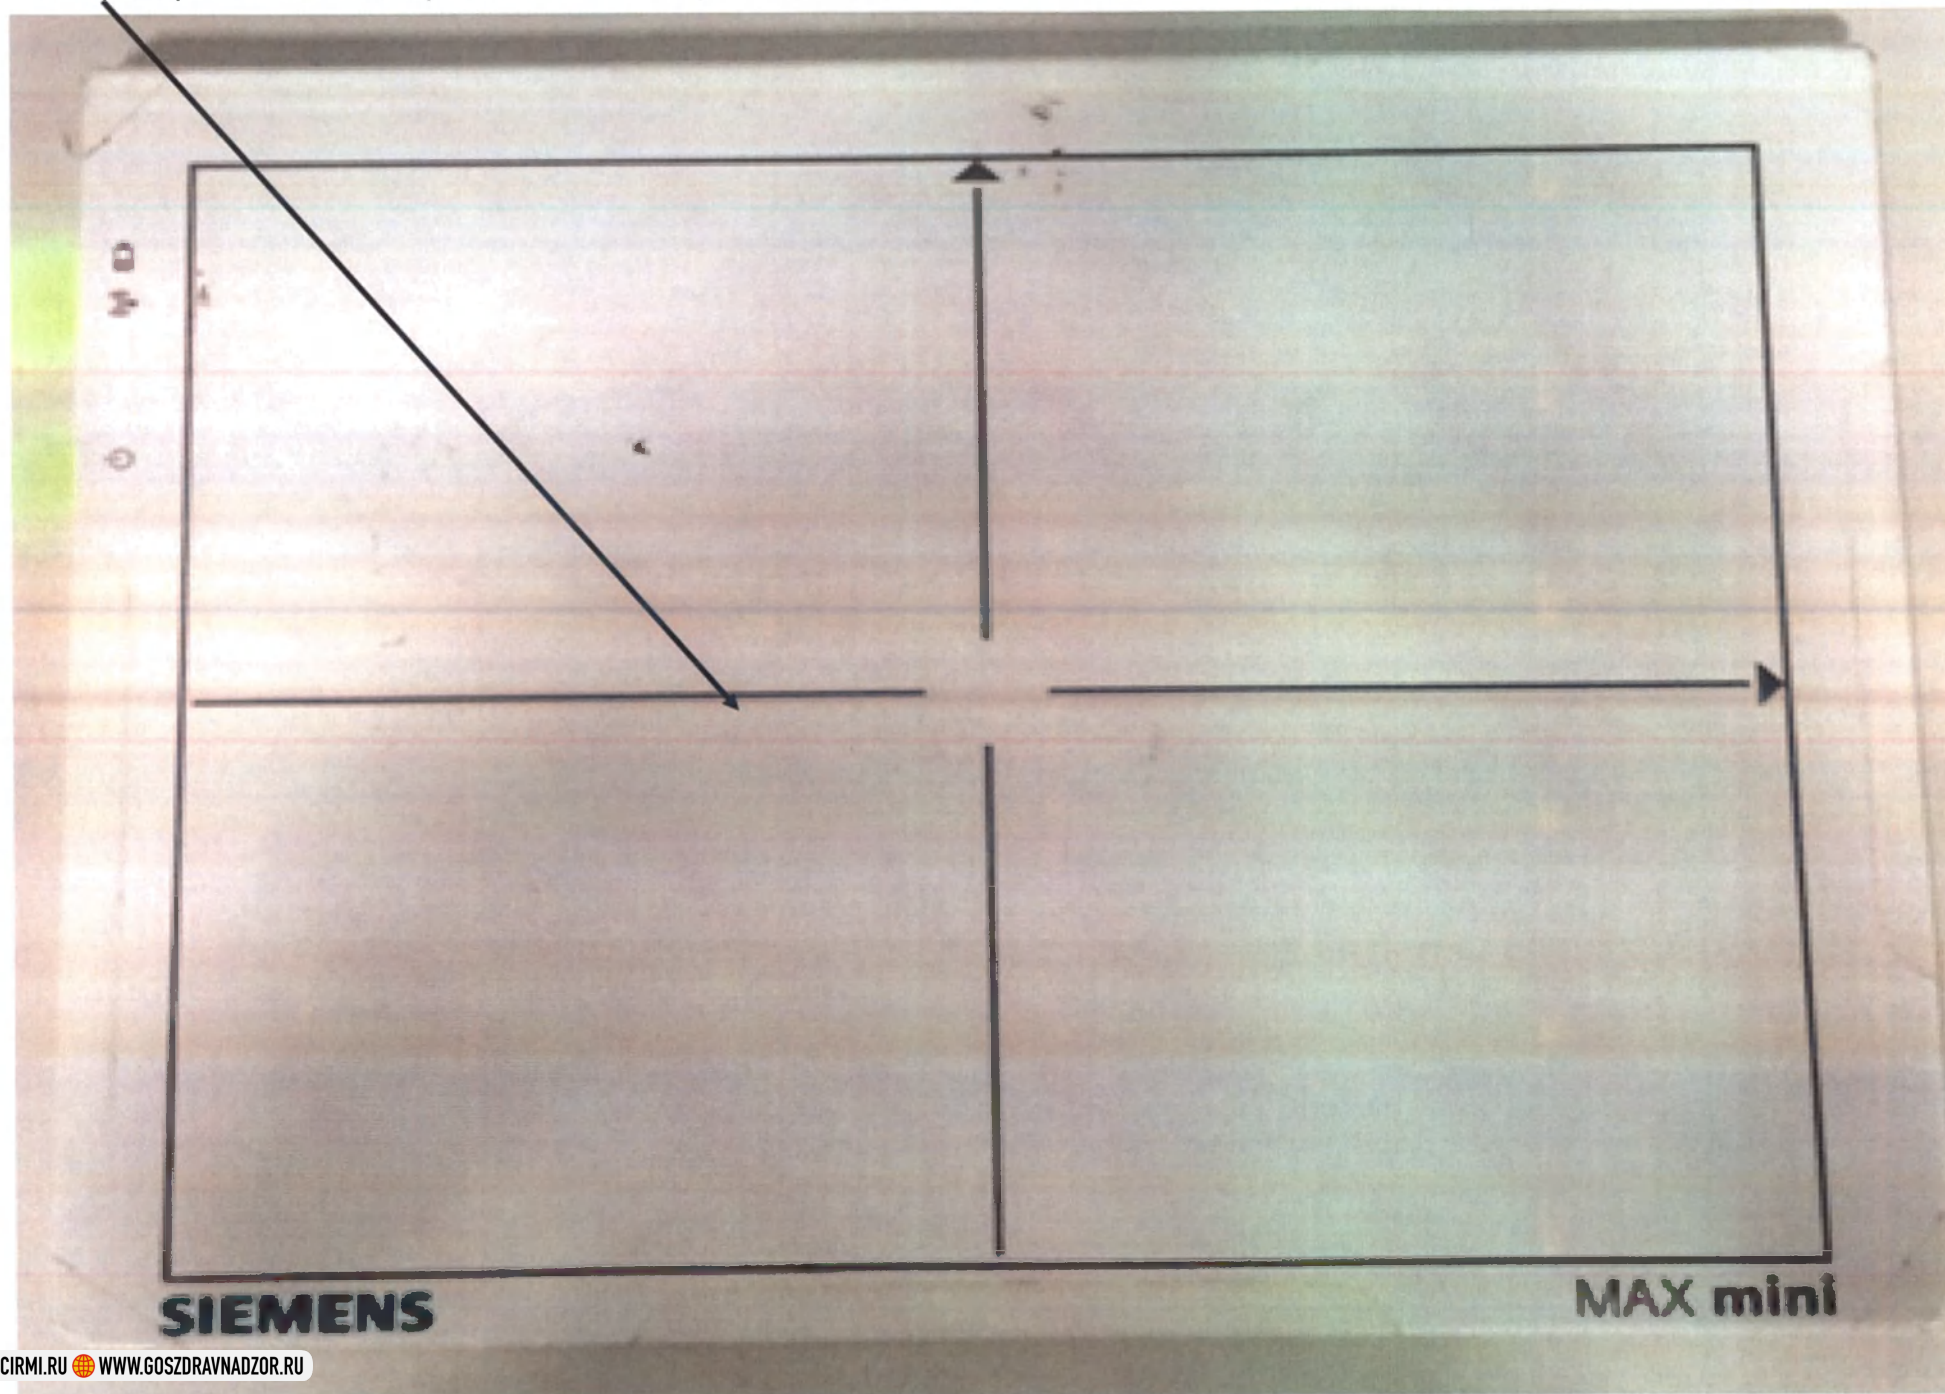


Базовый состав 1: Детектор беспроводной мобильный MAX wi-D и/или детектор беспроводной мобильный MAX mini (не более 5 шт.) и/или детектор встроенный MAX static .



Базовый состав 1: Устройство измерения дозы.

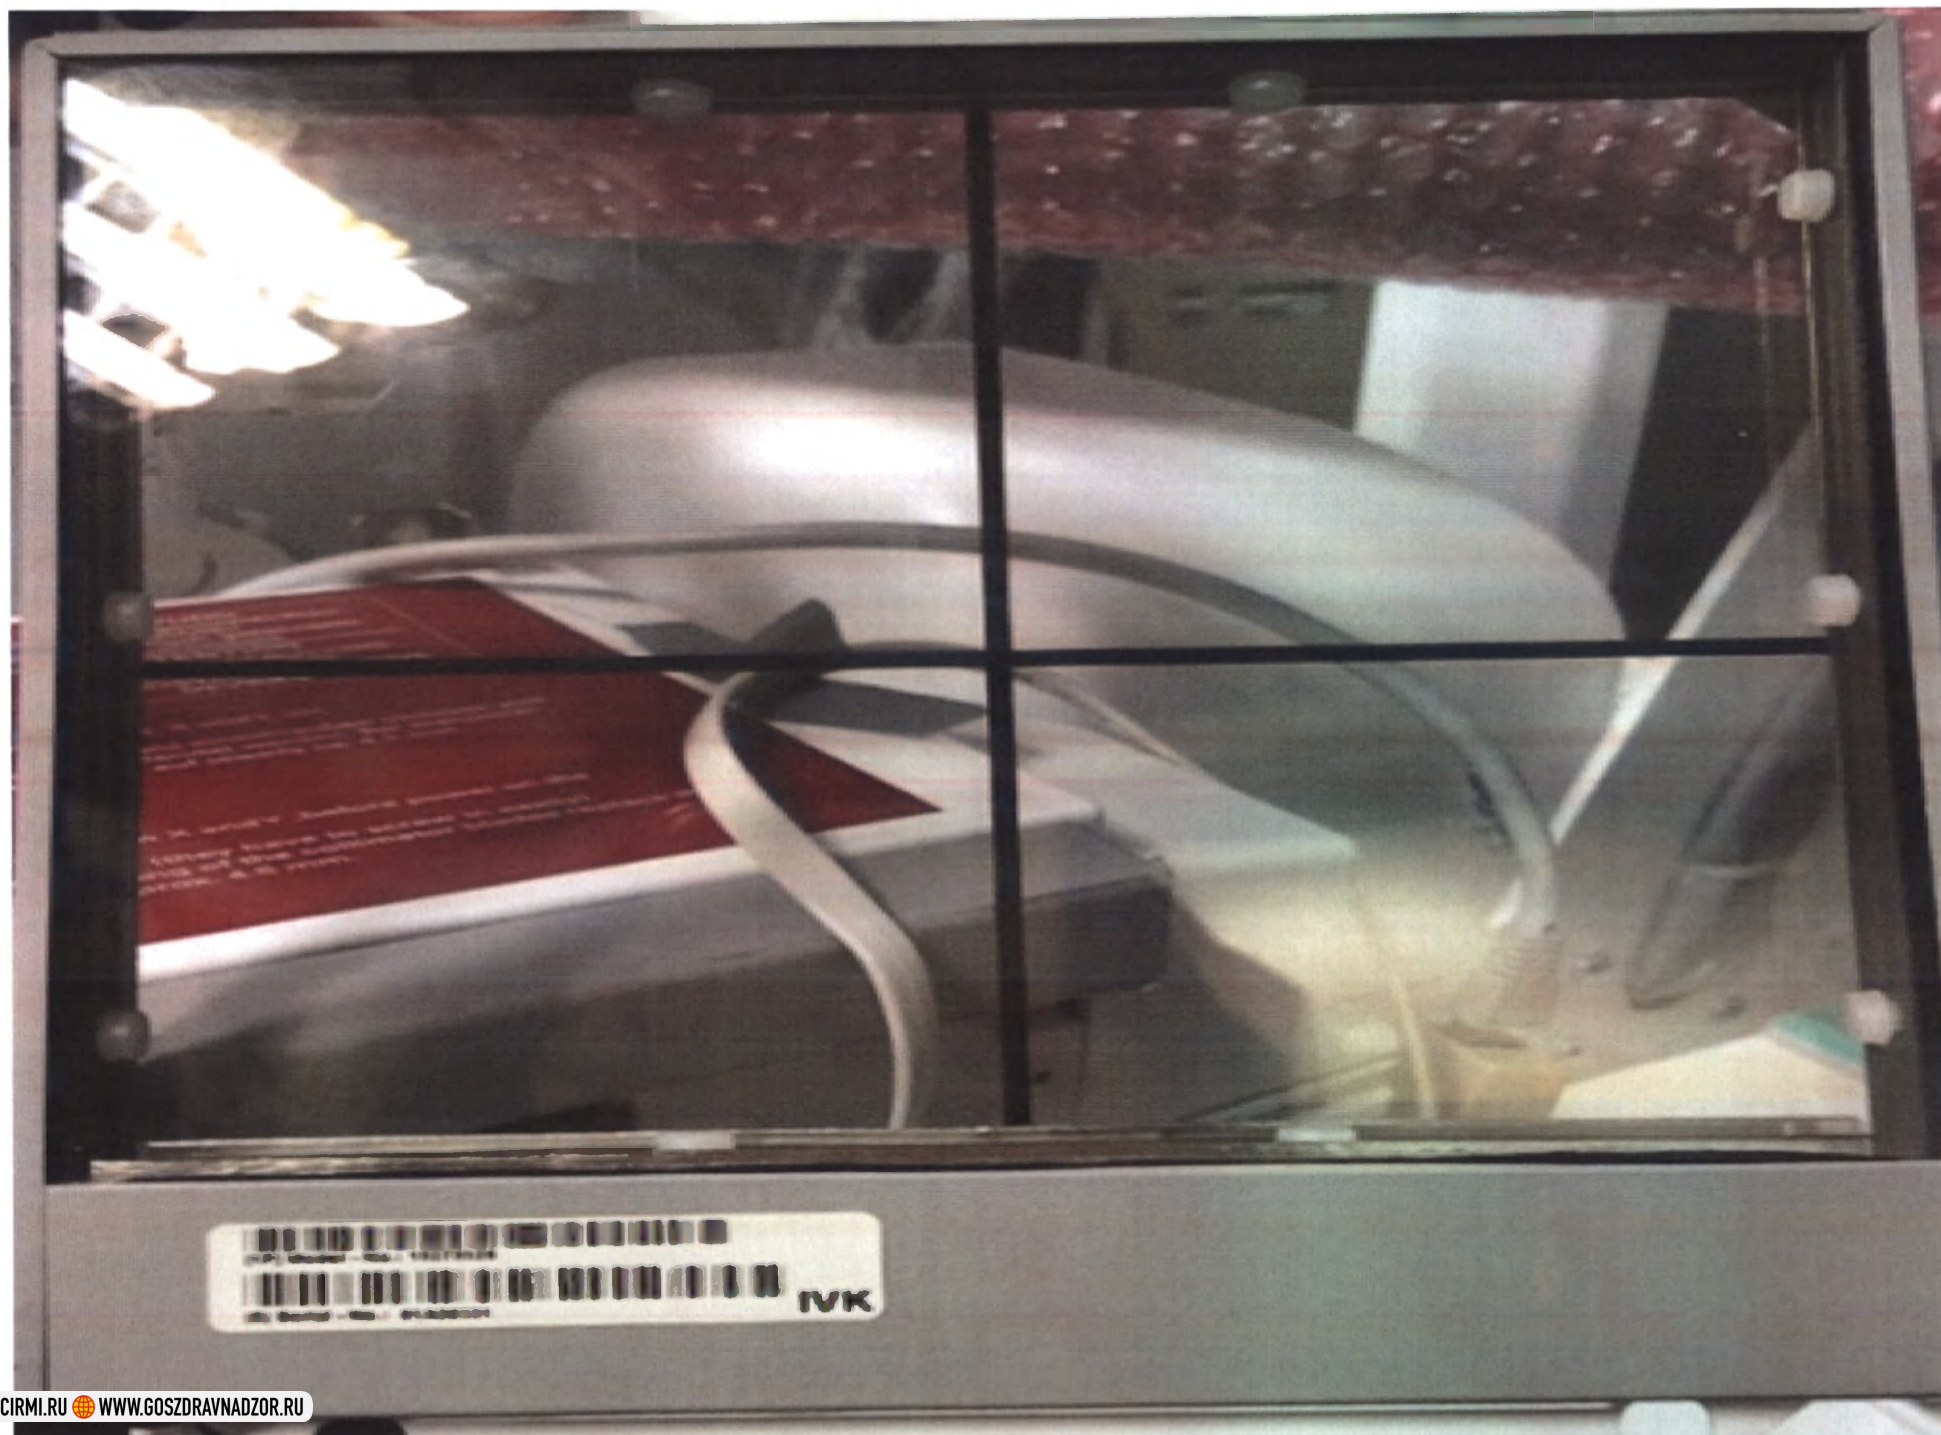

Базовый состав 1: Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.

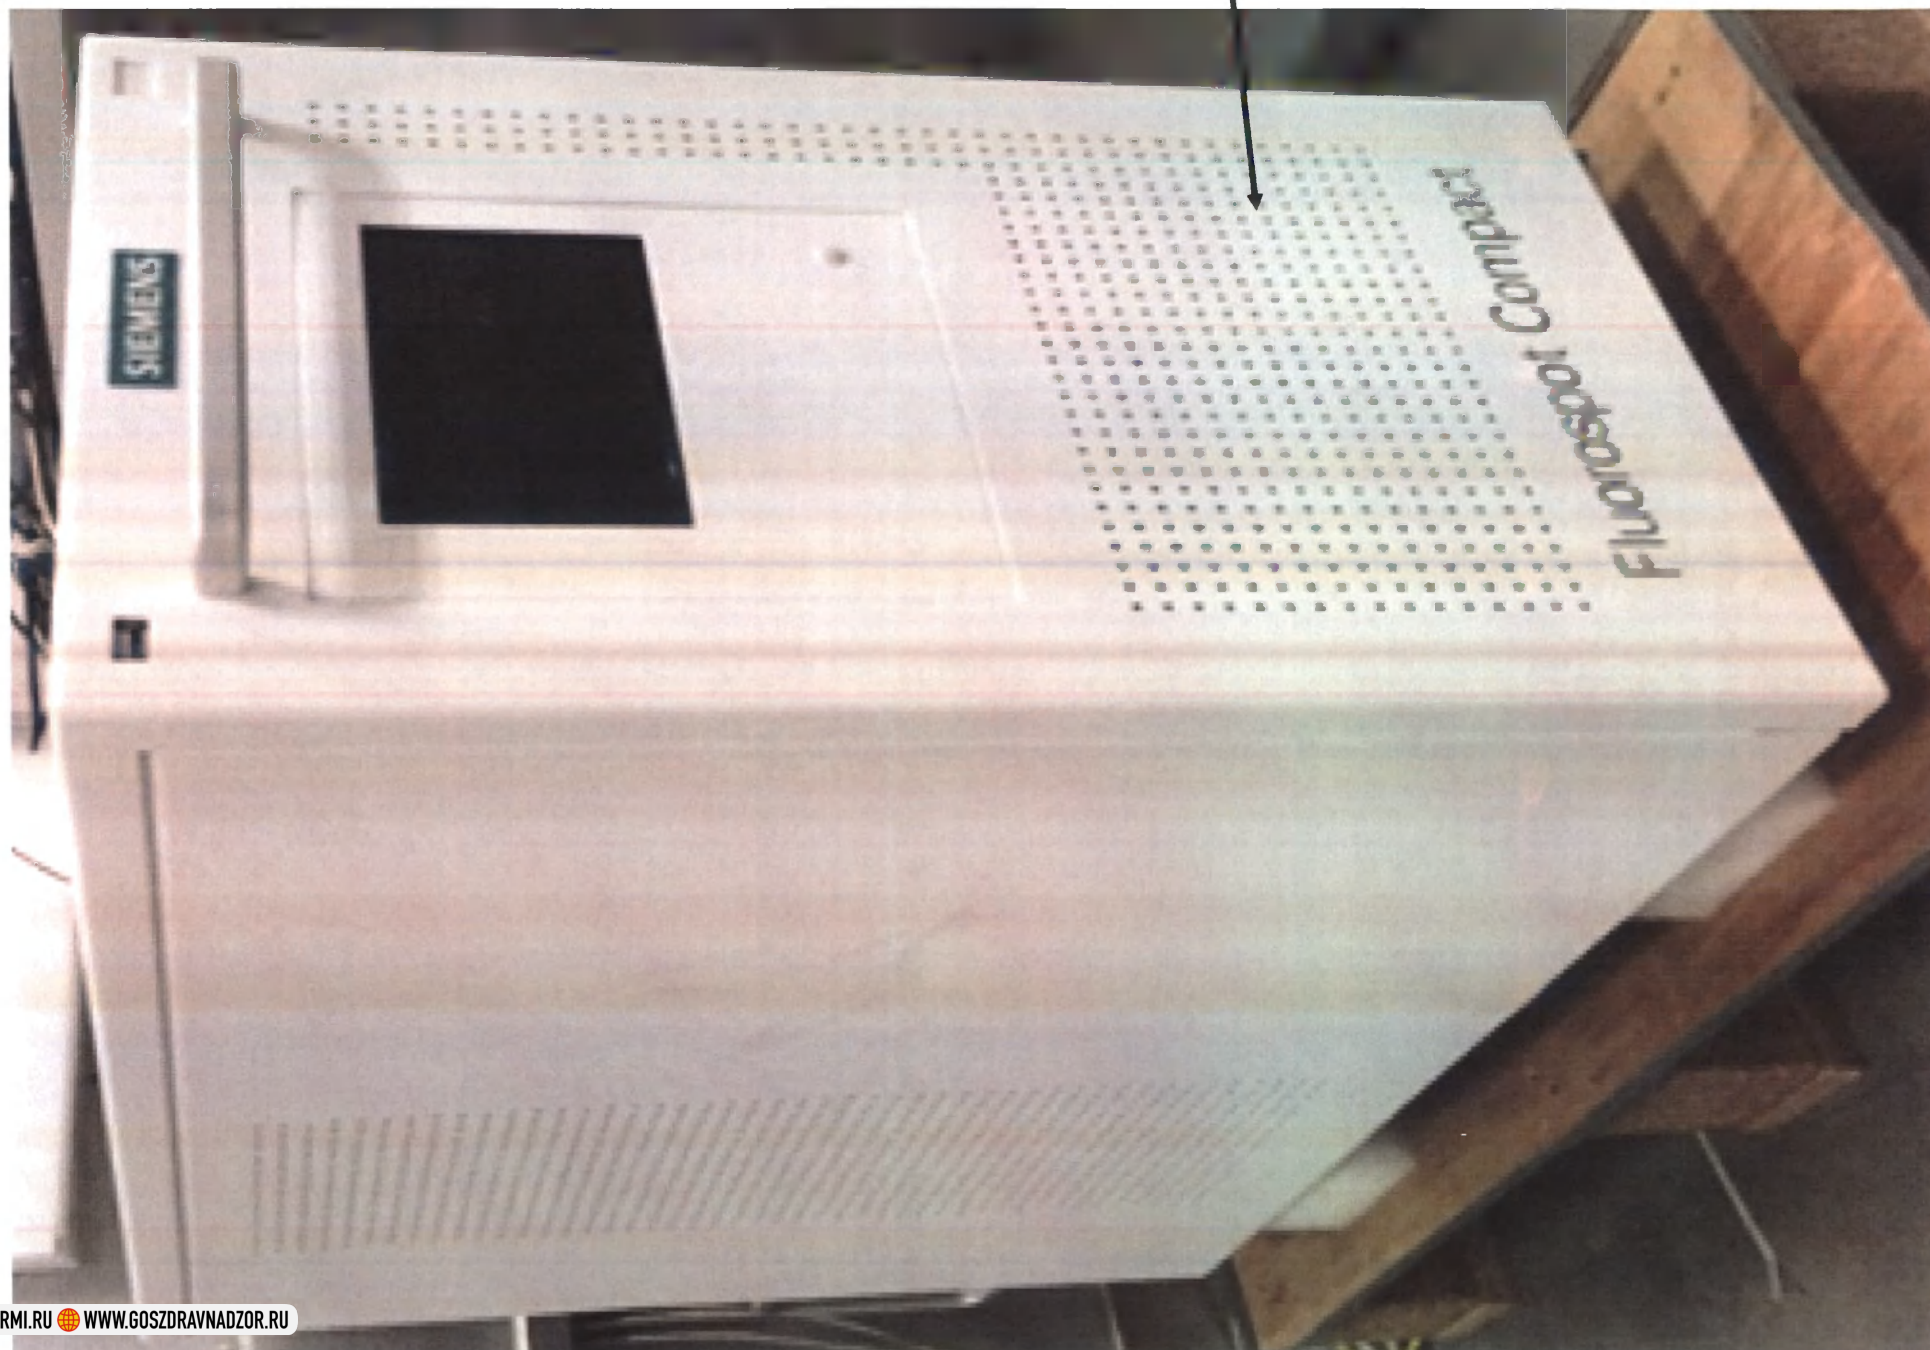

Базовый состав 1: Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.



Базовый состав 1: Система формирования изображений FLUOROSPOT Contrast с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.



Базовый состав 1: Генератор рентгеновский, вариант исполнения: -генератор рентгеновский 55 кВт;



Базовый состав 1: Генератор рентгеновский, варианты исполнения: -генератор рентгеновский 65 кВт;



Базовый состав 1: Генератор рентгеновский, варианты исполнения: -генератор рентгеновский 80 кВт;



Базовый состав 1: Документация пользователя на русском языке .




Multix Fusion Max


Руководство пользователя

SIEMENS

Базовый состав 2: Штатив потолочный в составе: - штатив потолочный ; - блок рентгеновской трубки; -коллиматор многолепестковый; - центратор лазерный с сенсорным интерфейсом.

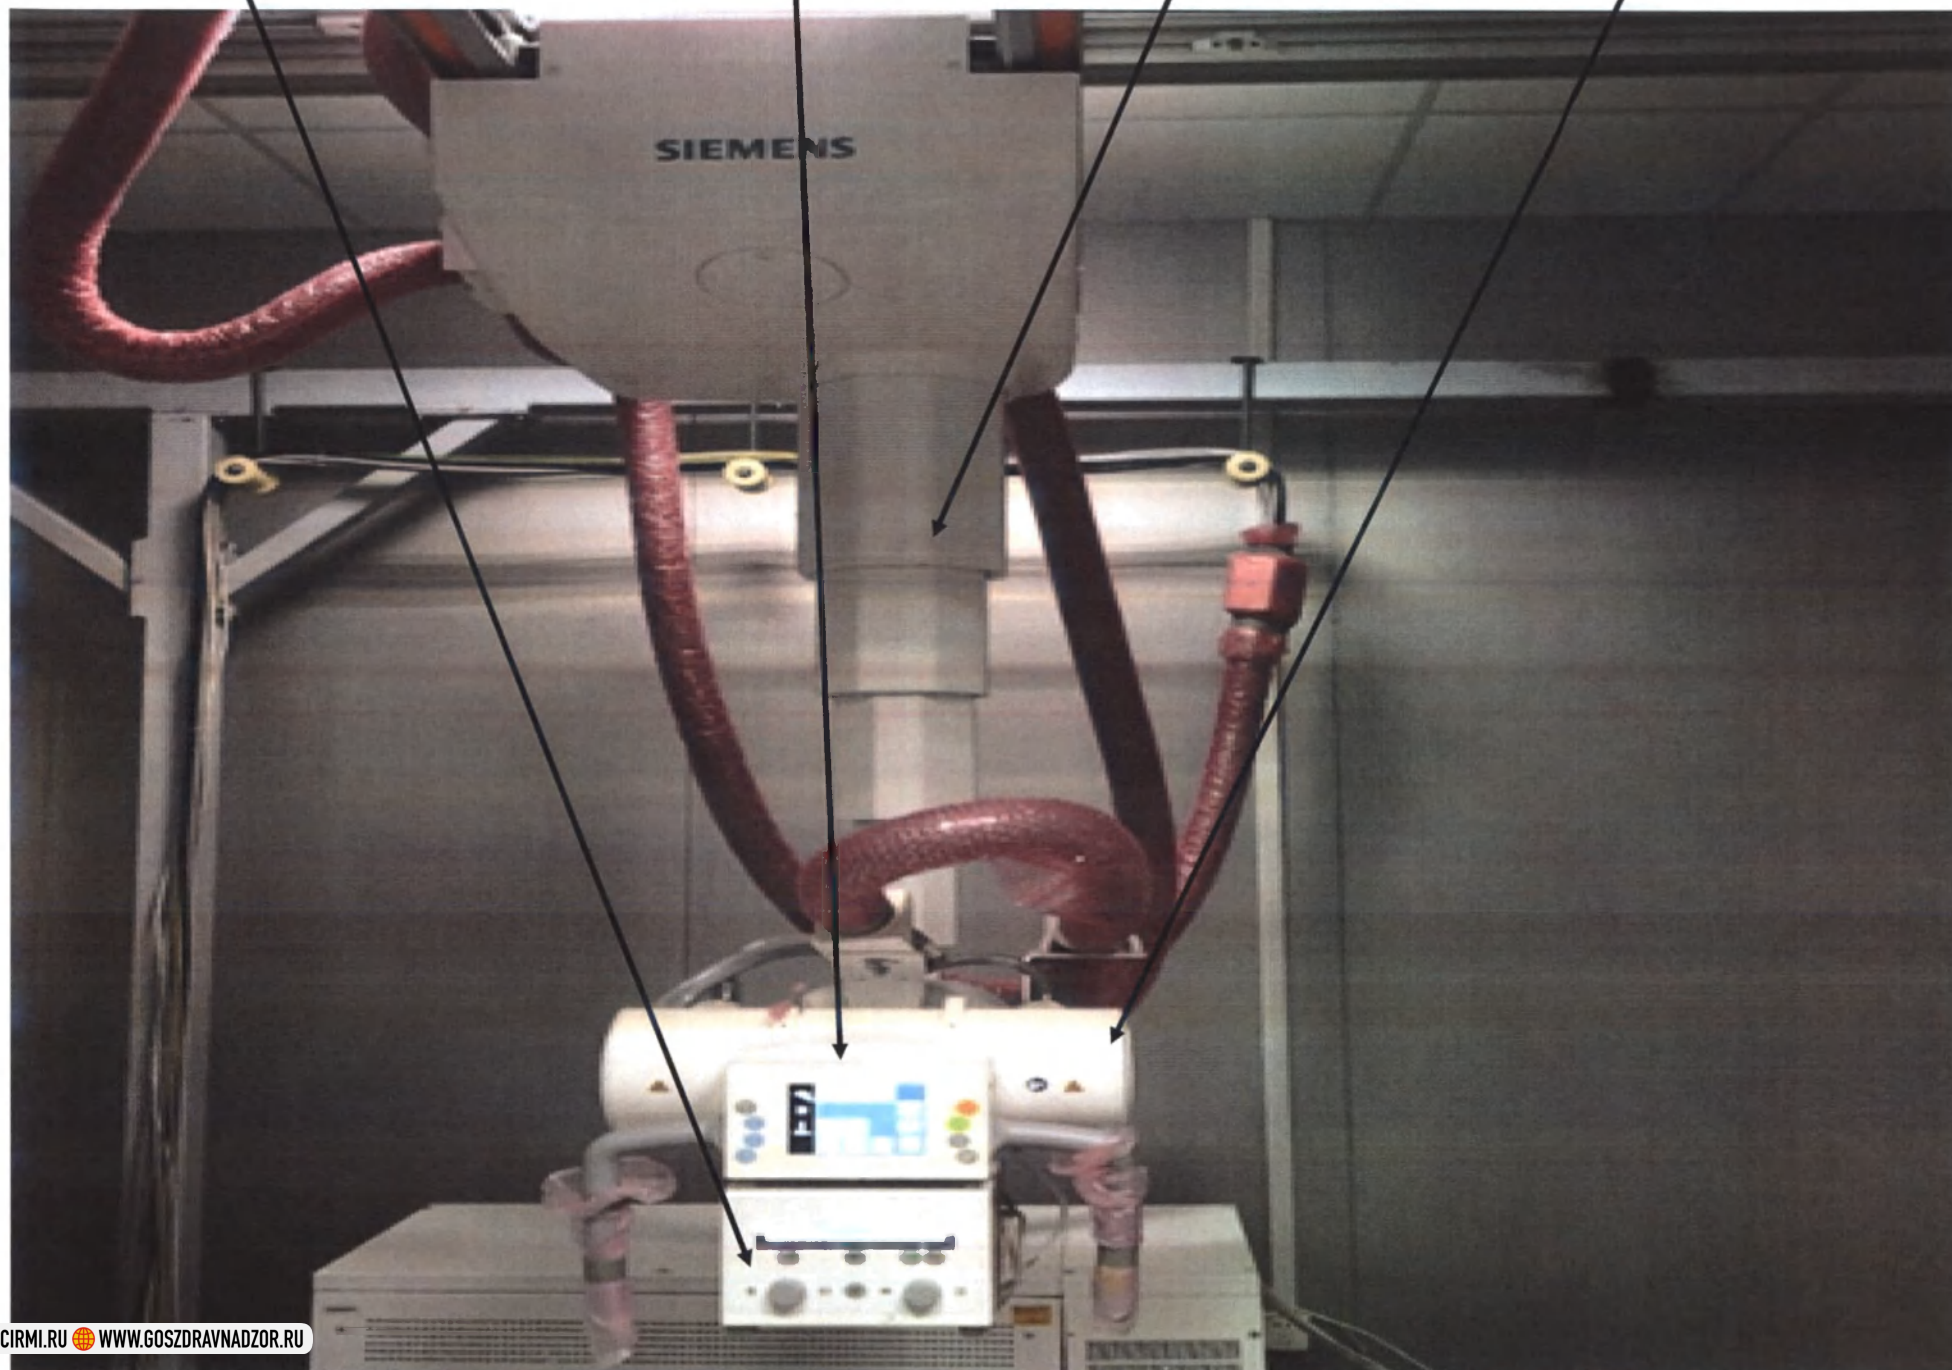

Базовый состав 2: Штатив потолочный в составе: - коллиматор многолепестковый.

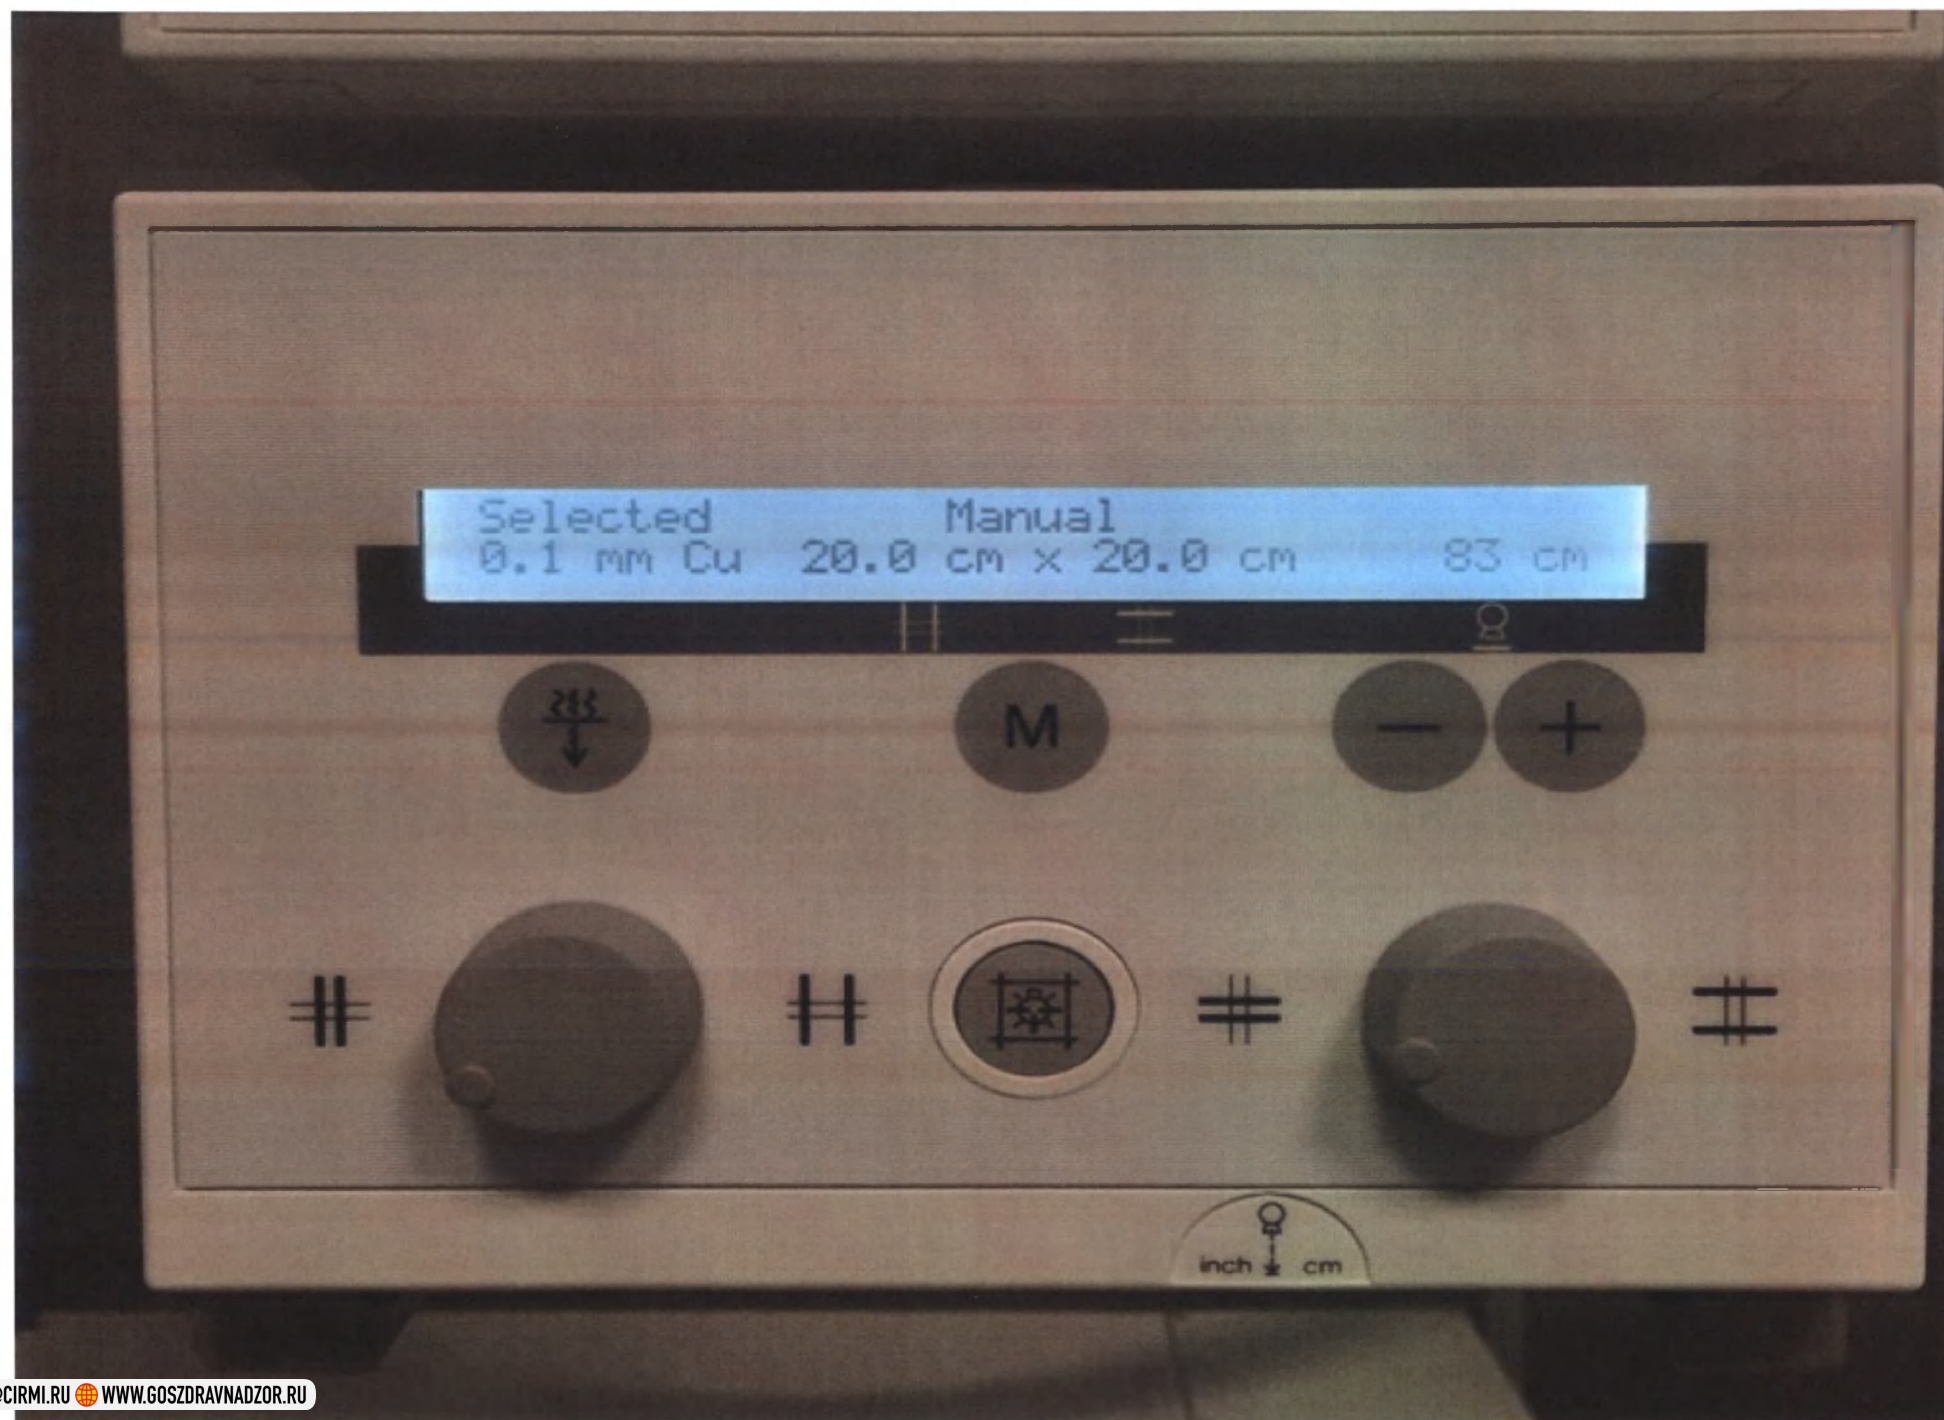


Базовый состав 2: - Рельсы потолочные .




Базовый состав 2: Стол пациента.



Базовый состав 2: Детектор беспроводной мобильный MAX wi-D и/или детектор беспроводной мобильный MAX mini (не более 5 шт.) и/или детектор встроенный MAX static

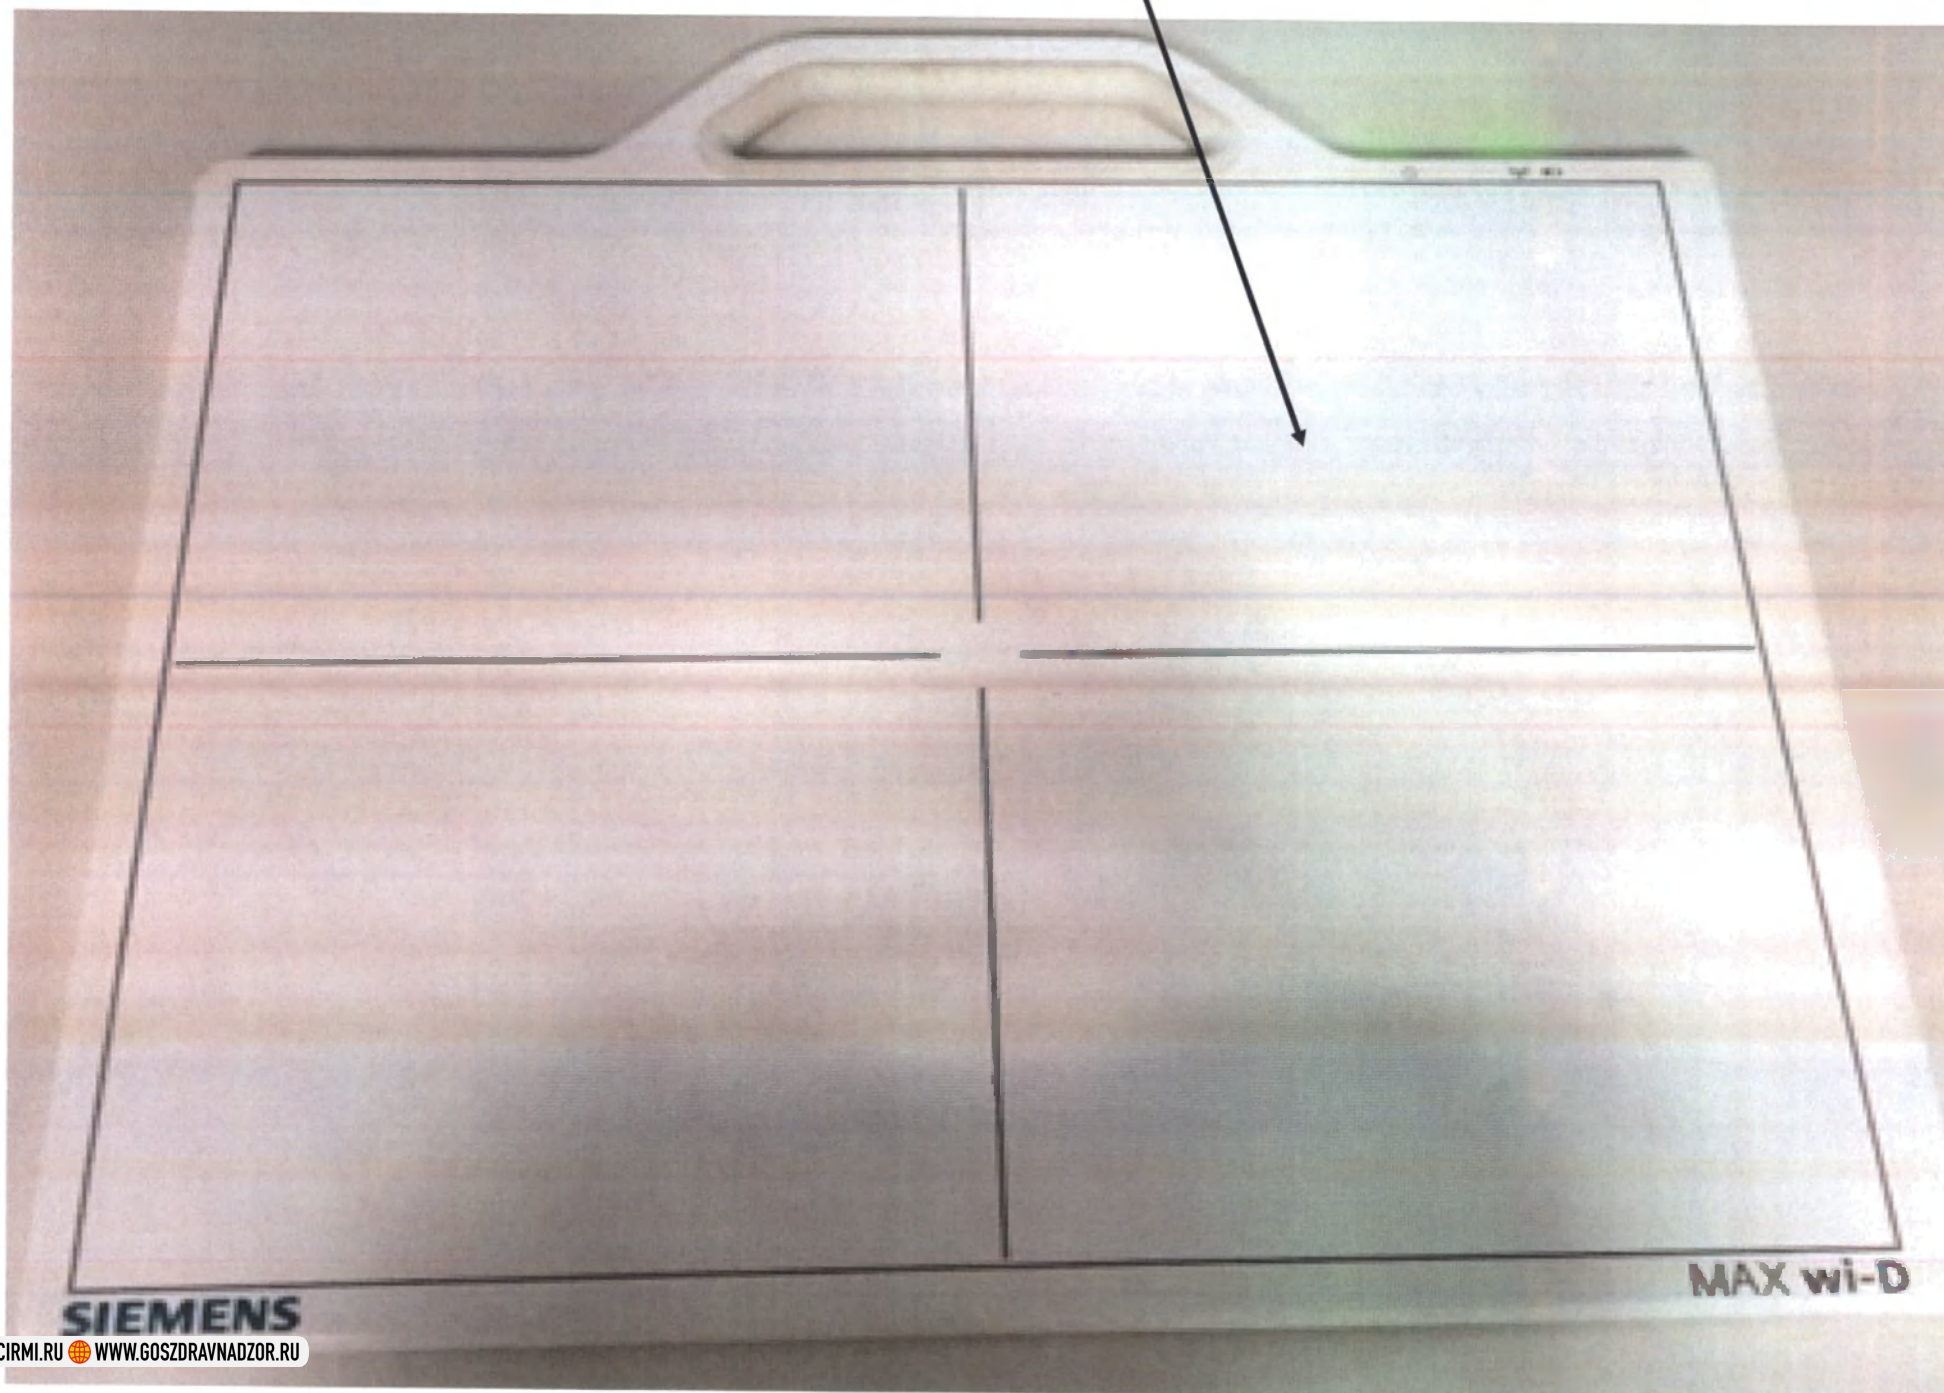


Базовый состав 2: Детектор беспроводной мобильный MAX wi-D и/или детектор беспроводной мобильный MAX mini (не более 5 шт.) и/или детектор встроенный MAX static

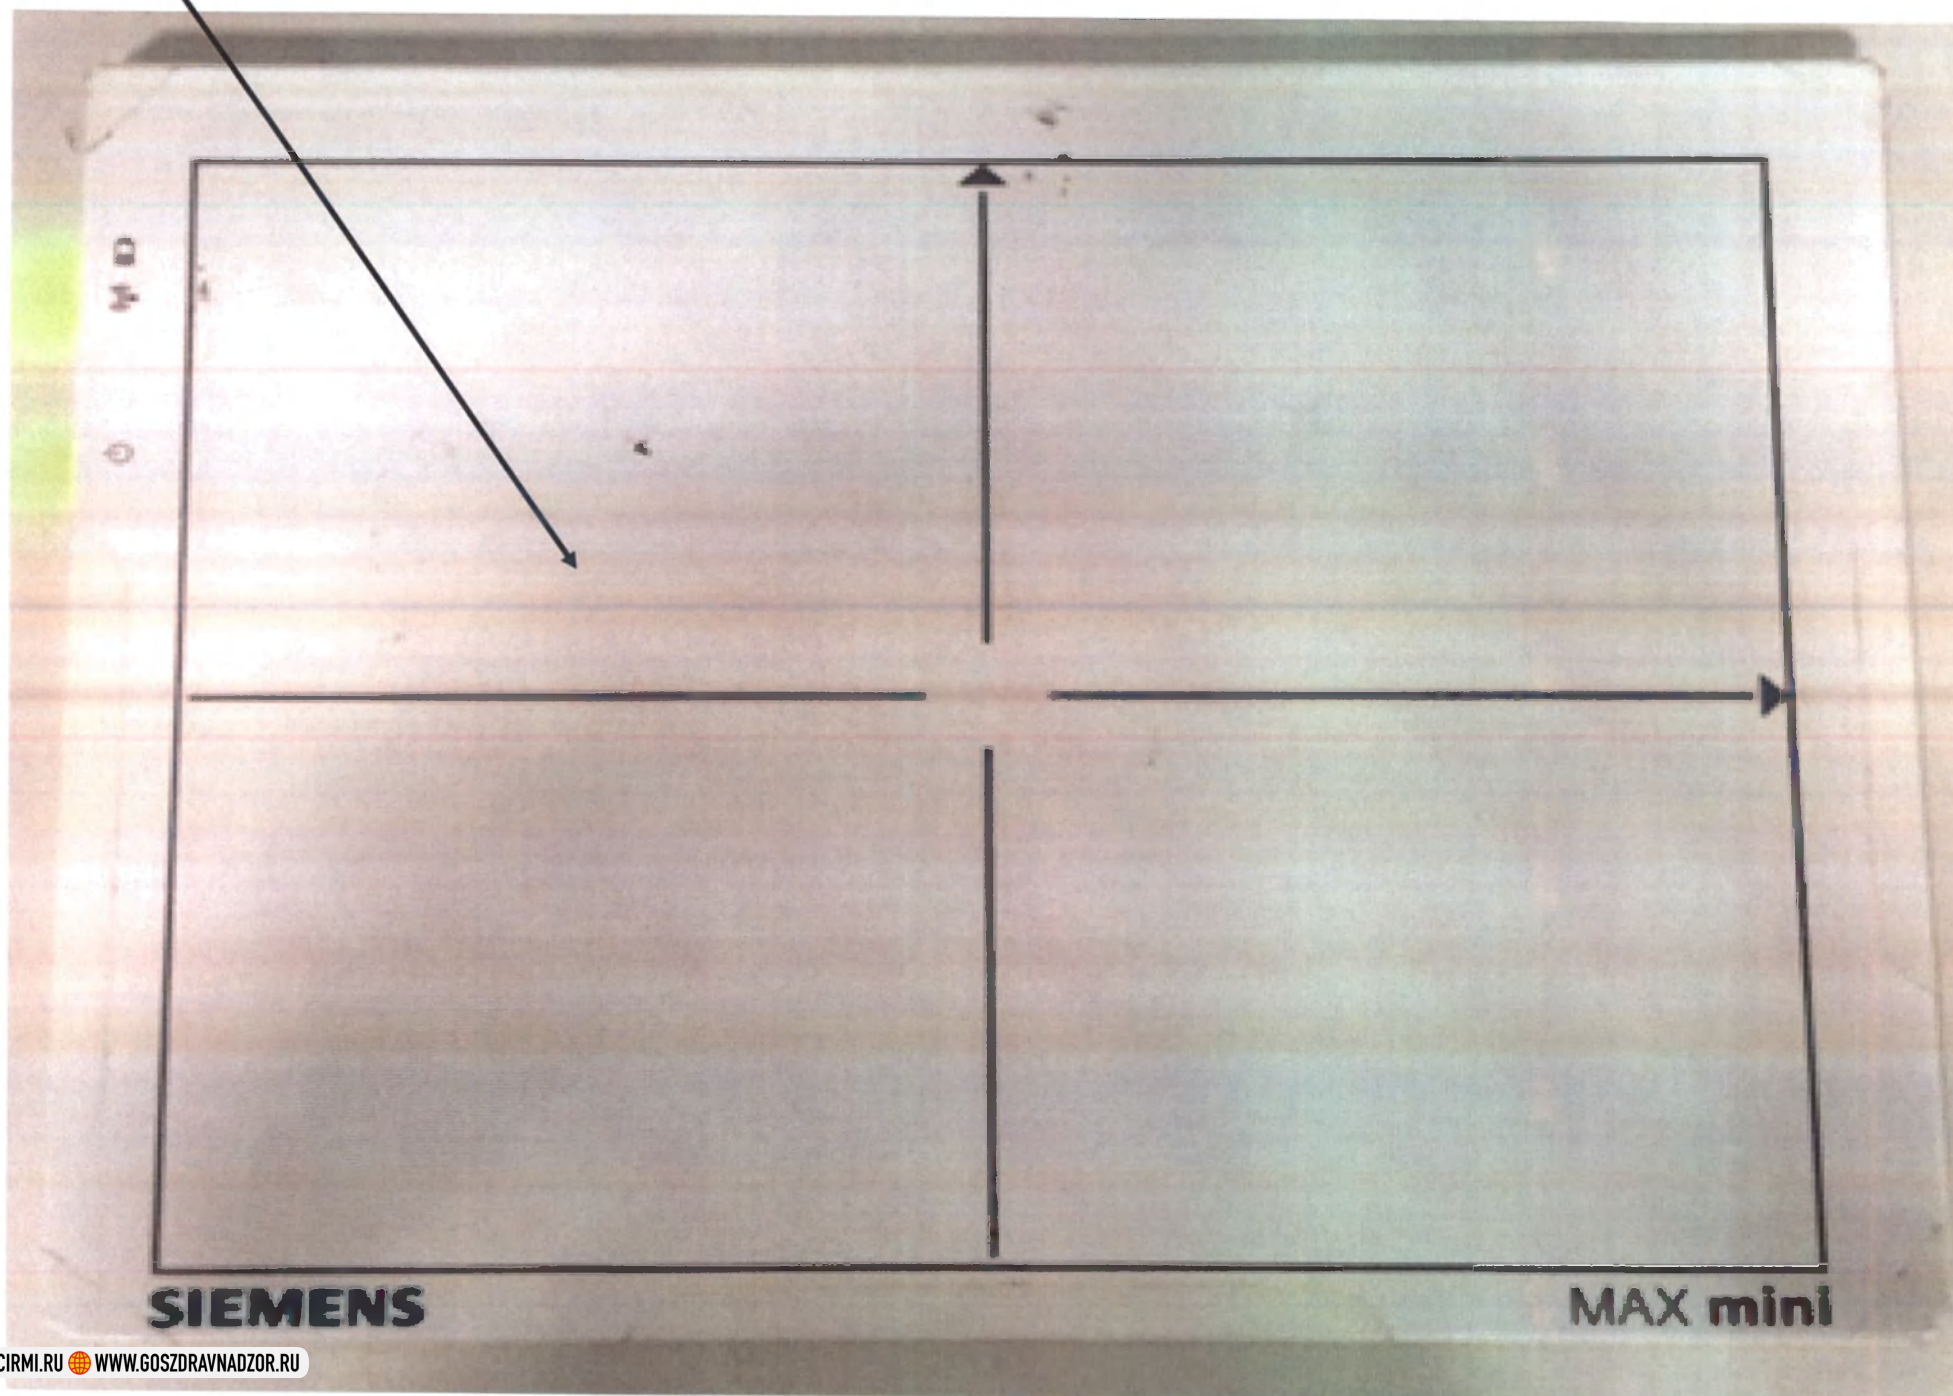


Базовый состав 2: Детектор беспроводной мобильный MAX wi-D и/или детектор беспроводной мобильный MAX mini (не более 5 шт.) и/или детектор встроенный MAX static




Базовый состав 2: Устройство измерения дозы.

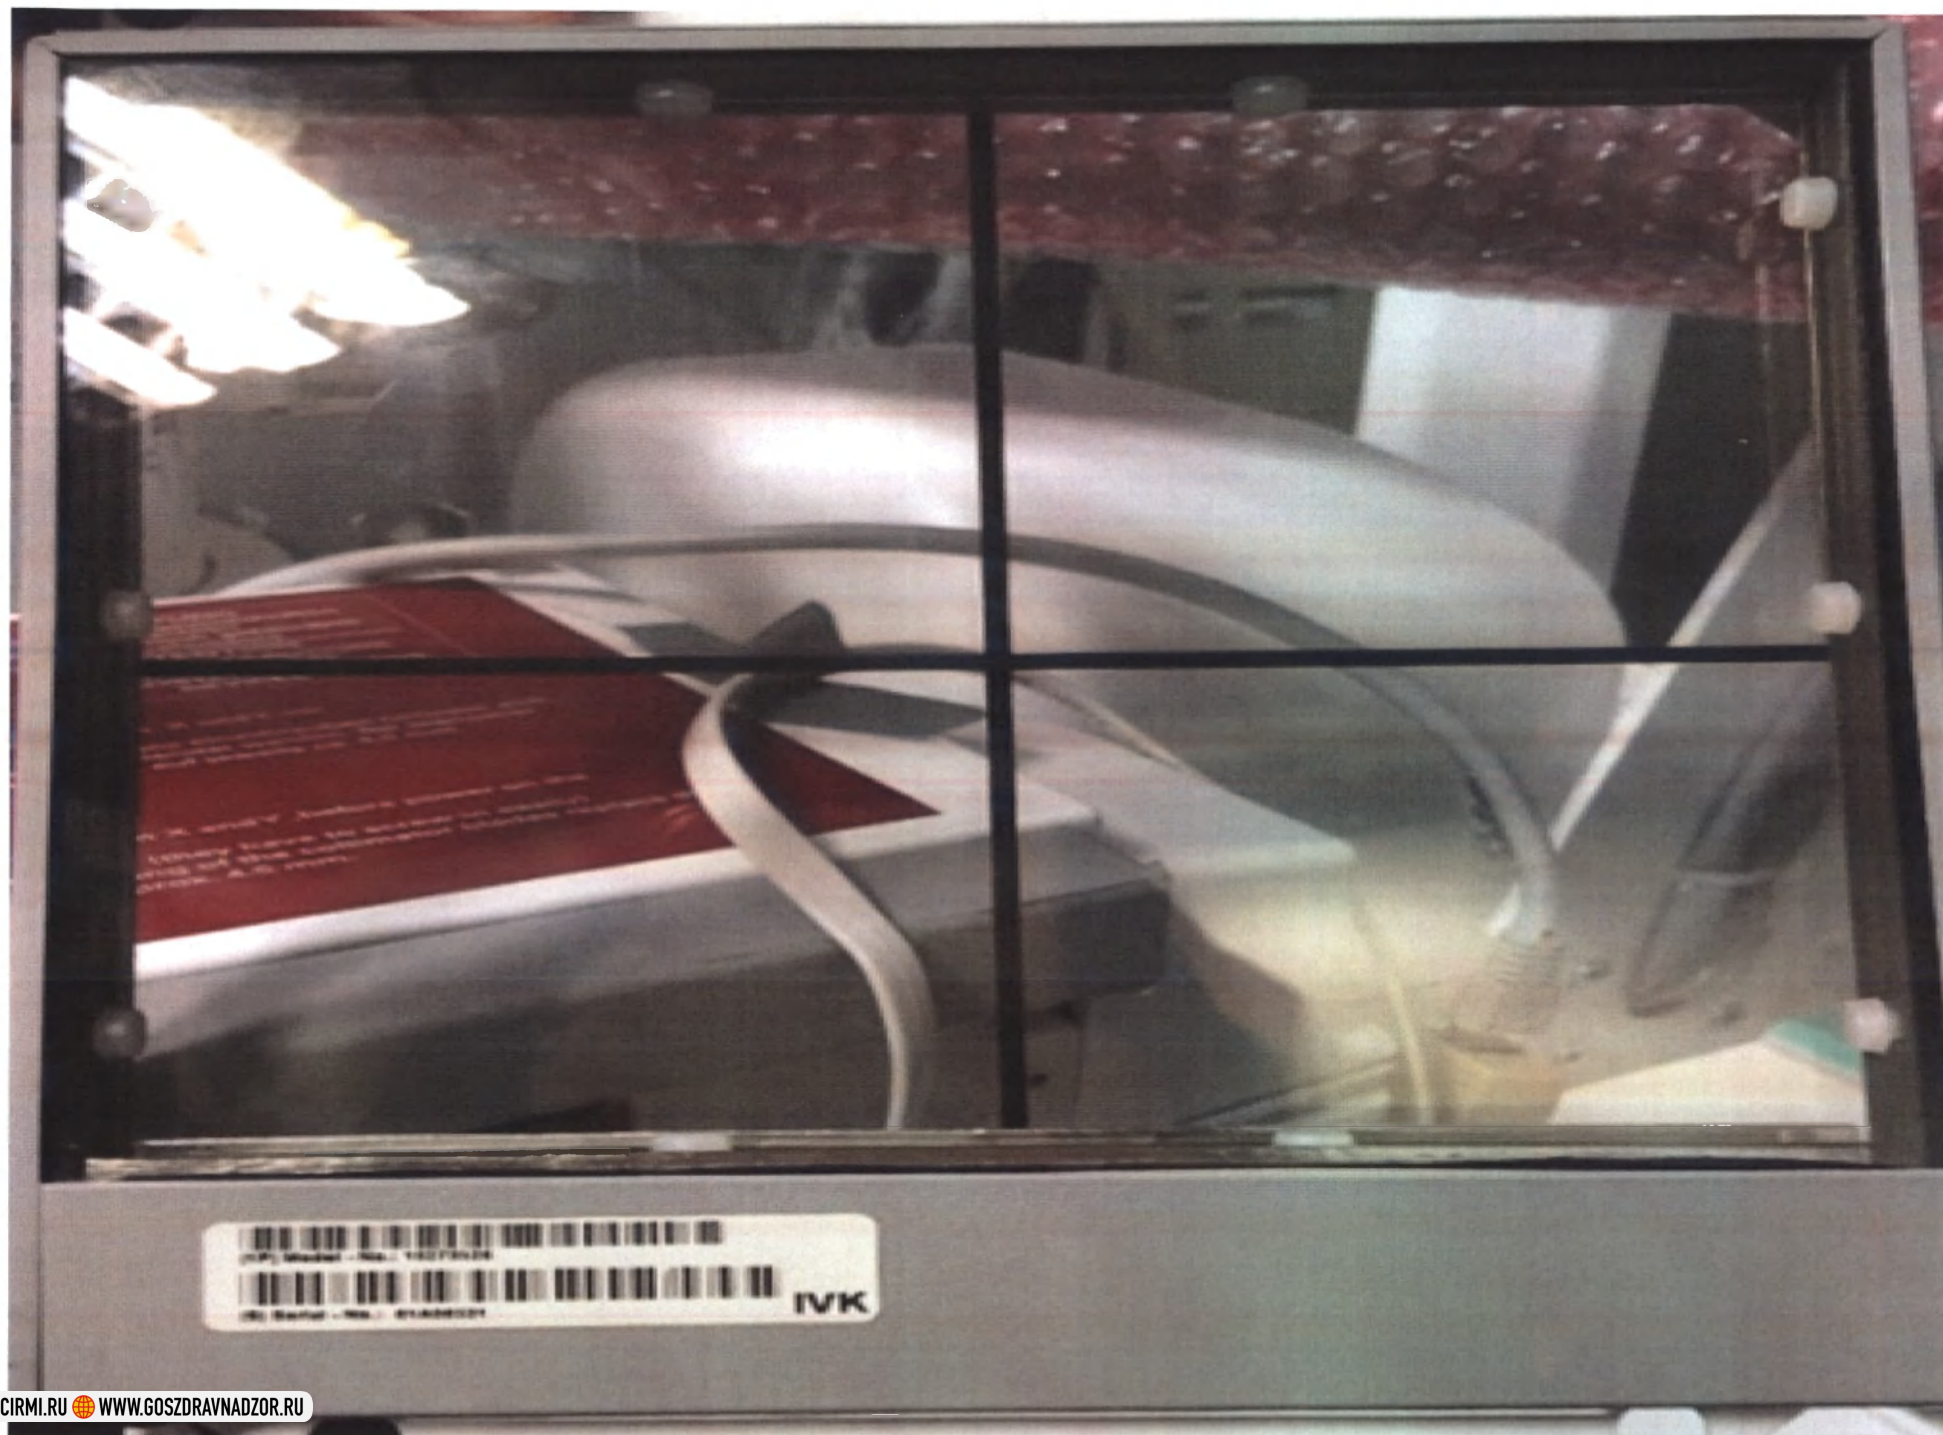

Базовый состав 2: Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.

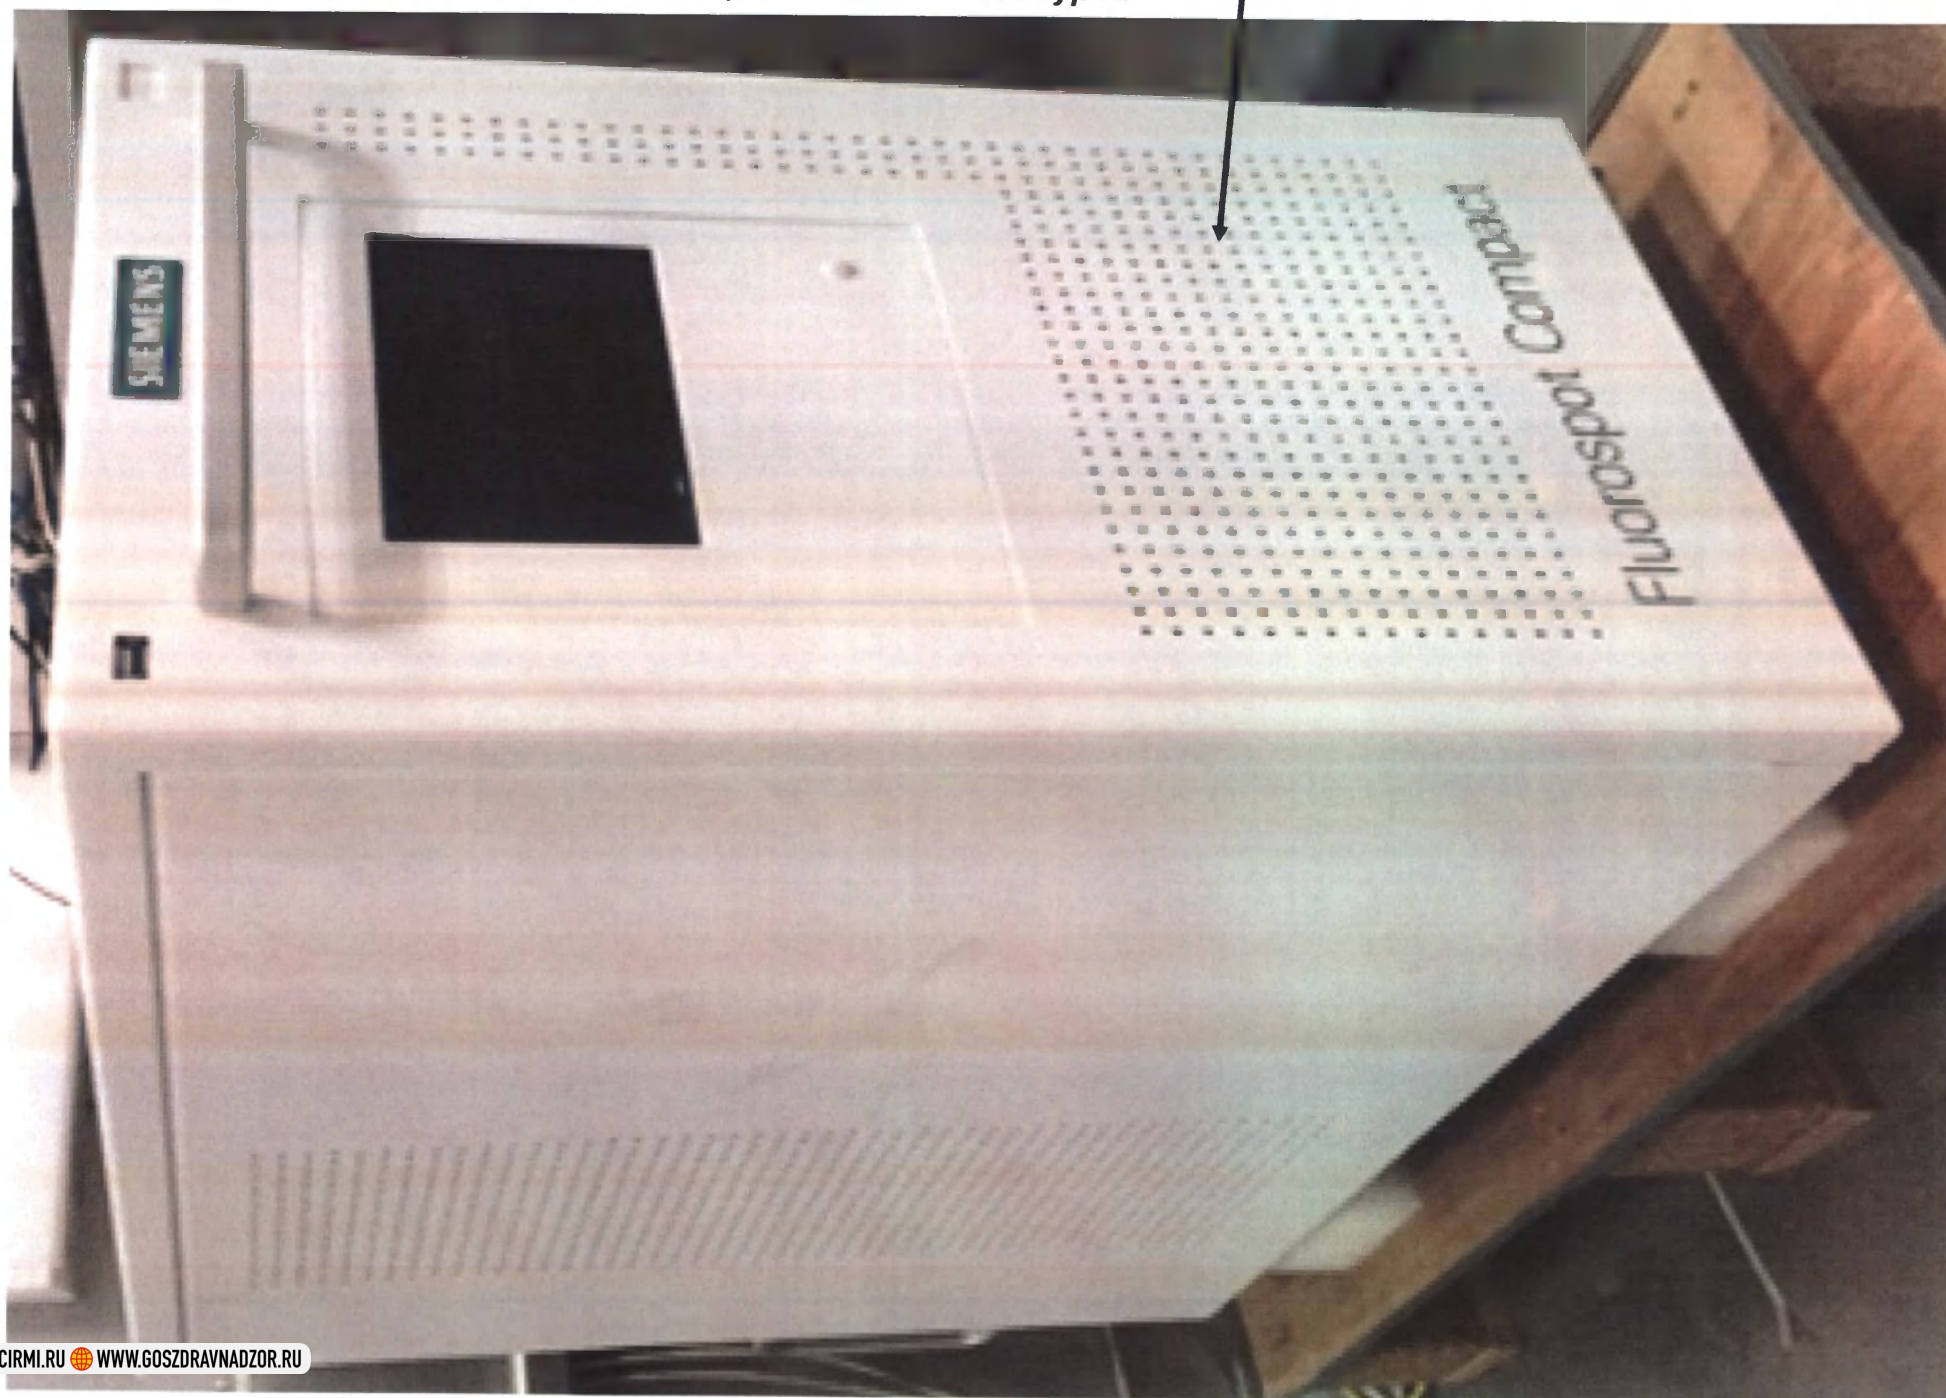

Базовый состав 2: Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact

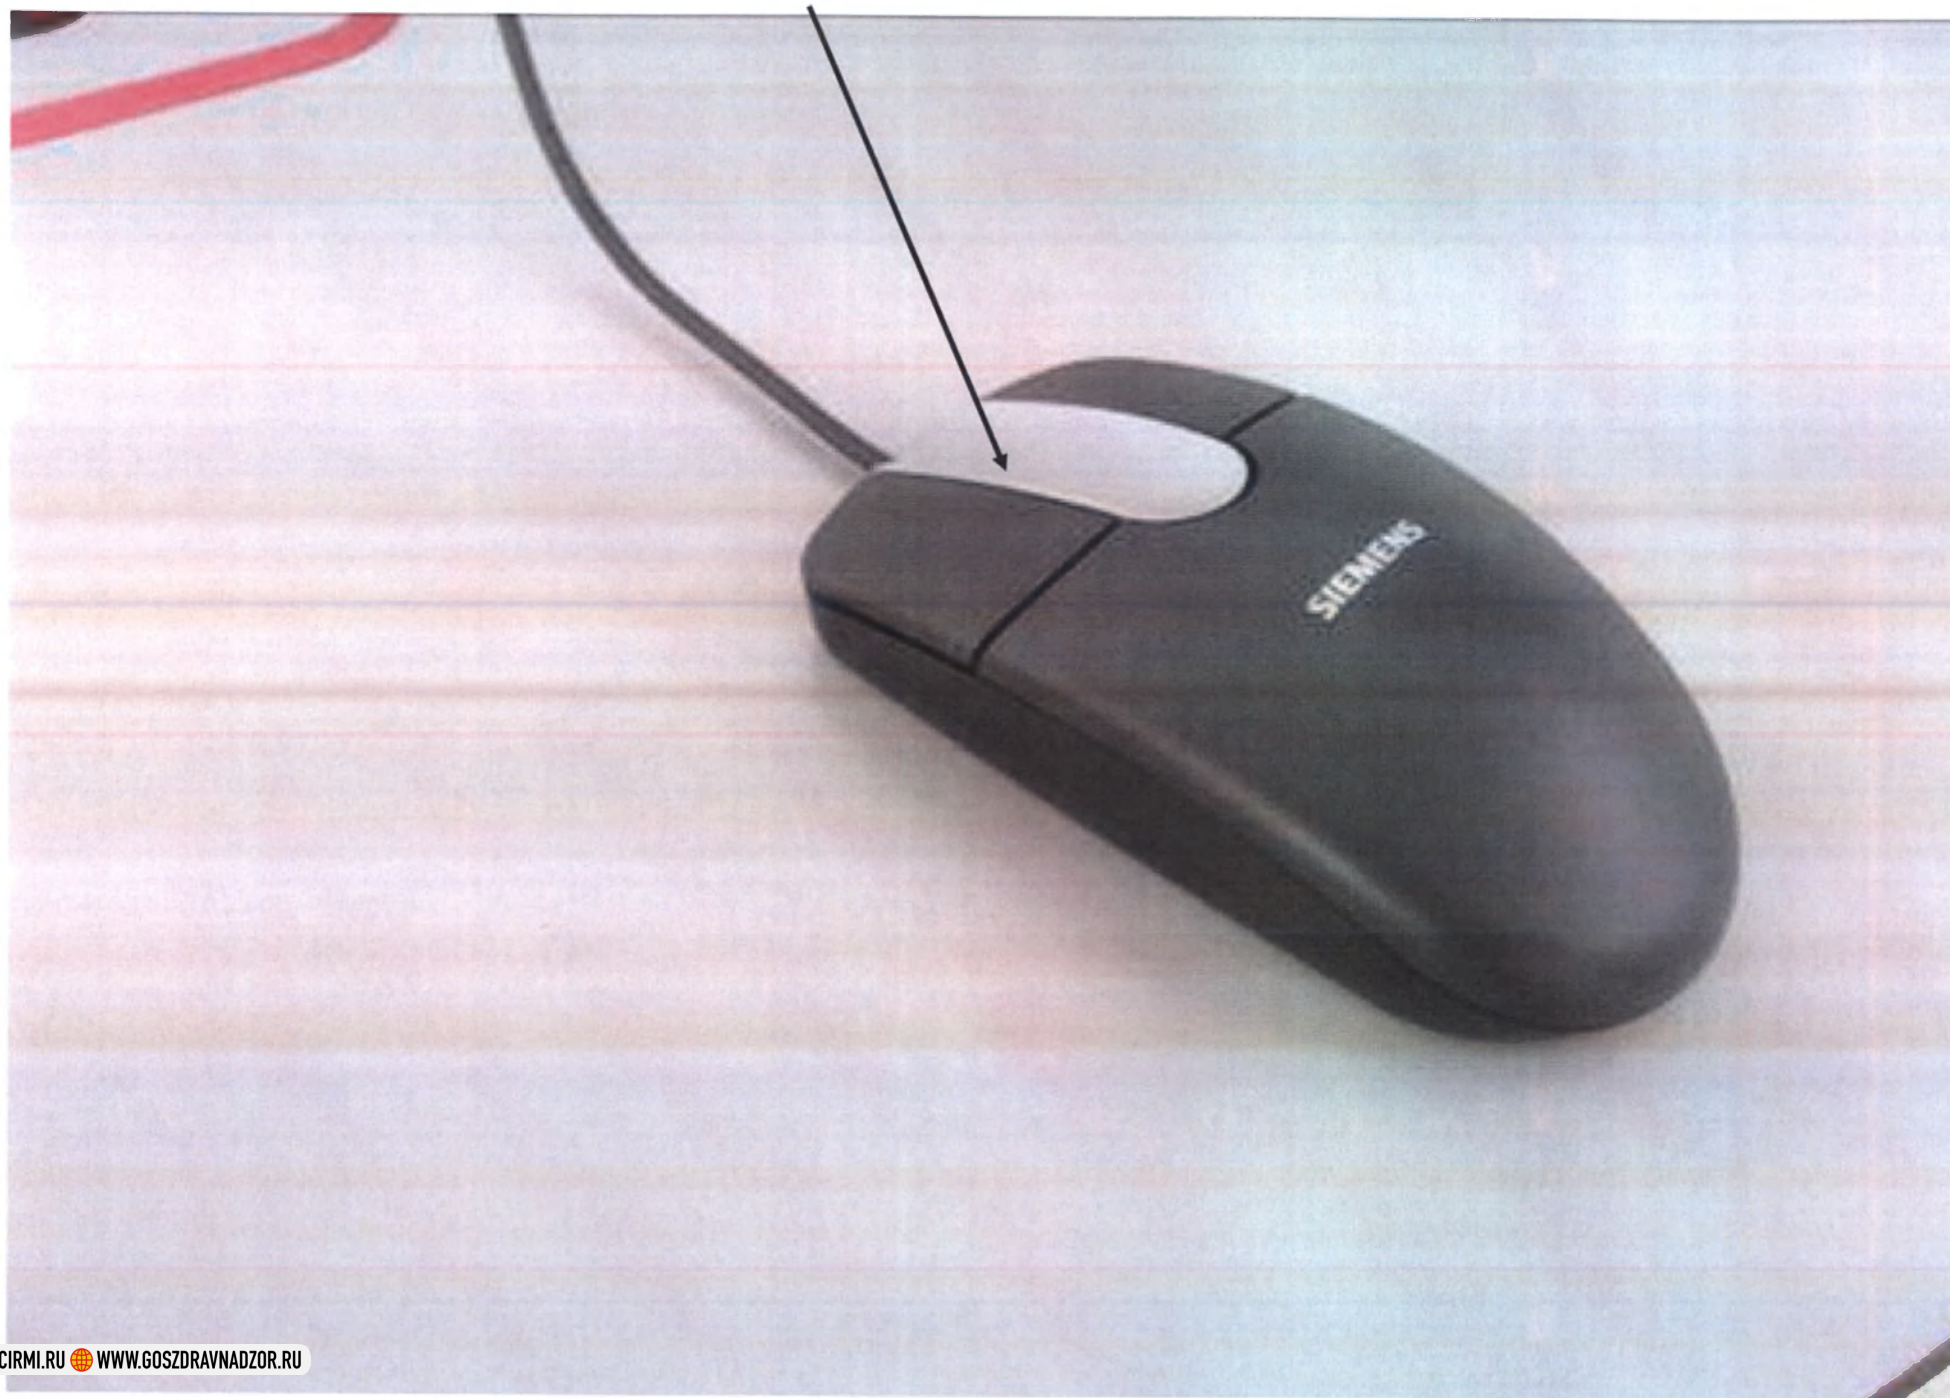

Базовый состав 2: Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.



Базовый состав 2: Генератор рентгеновский, вариант исполнения: -генератор рентгеновский 55 кВт;



Базовый состав 2: Генератор рентгеновский, вариант исполнения: -генератор рентгеновский 65 кВт;



Базовый состав 2: Генератор рентгеновский, вариант исполнения: -генератор рентгеновский 80 кВт;



Базовый состав 2: Документация пользователя на русском языке.




Multix Fusion Max


Руководство пользователя

SIEMENS

Базовый состав 3: Штатив потолочный в составе: - штатив потолочный ; - блок рентгеновской трубки; -коллиматор многолепестковый; - центратор лазерный с сенсорным интерфейсом.

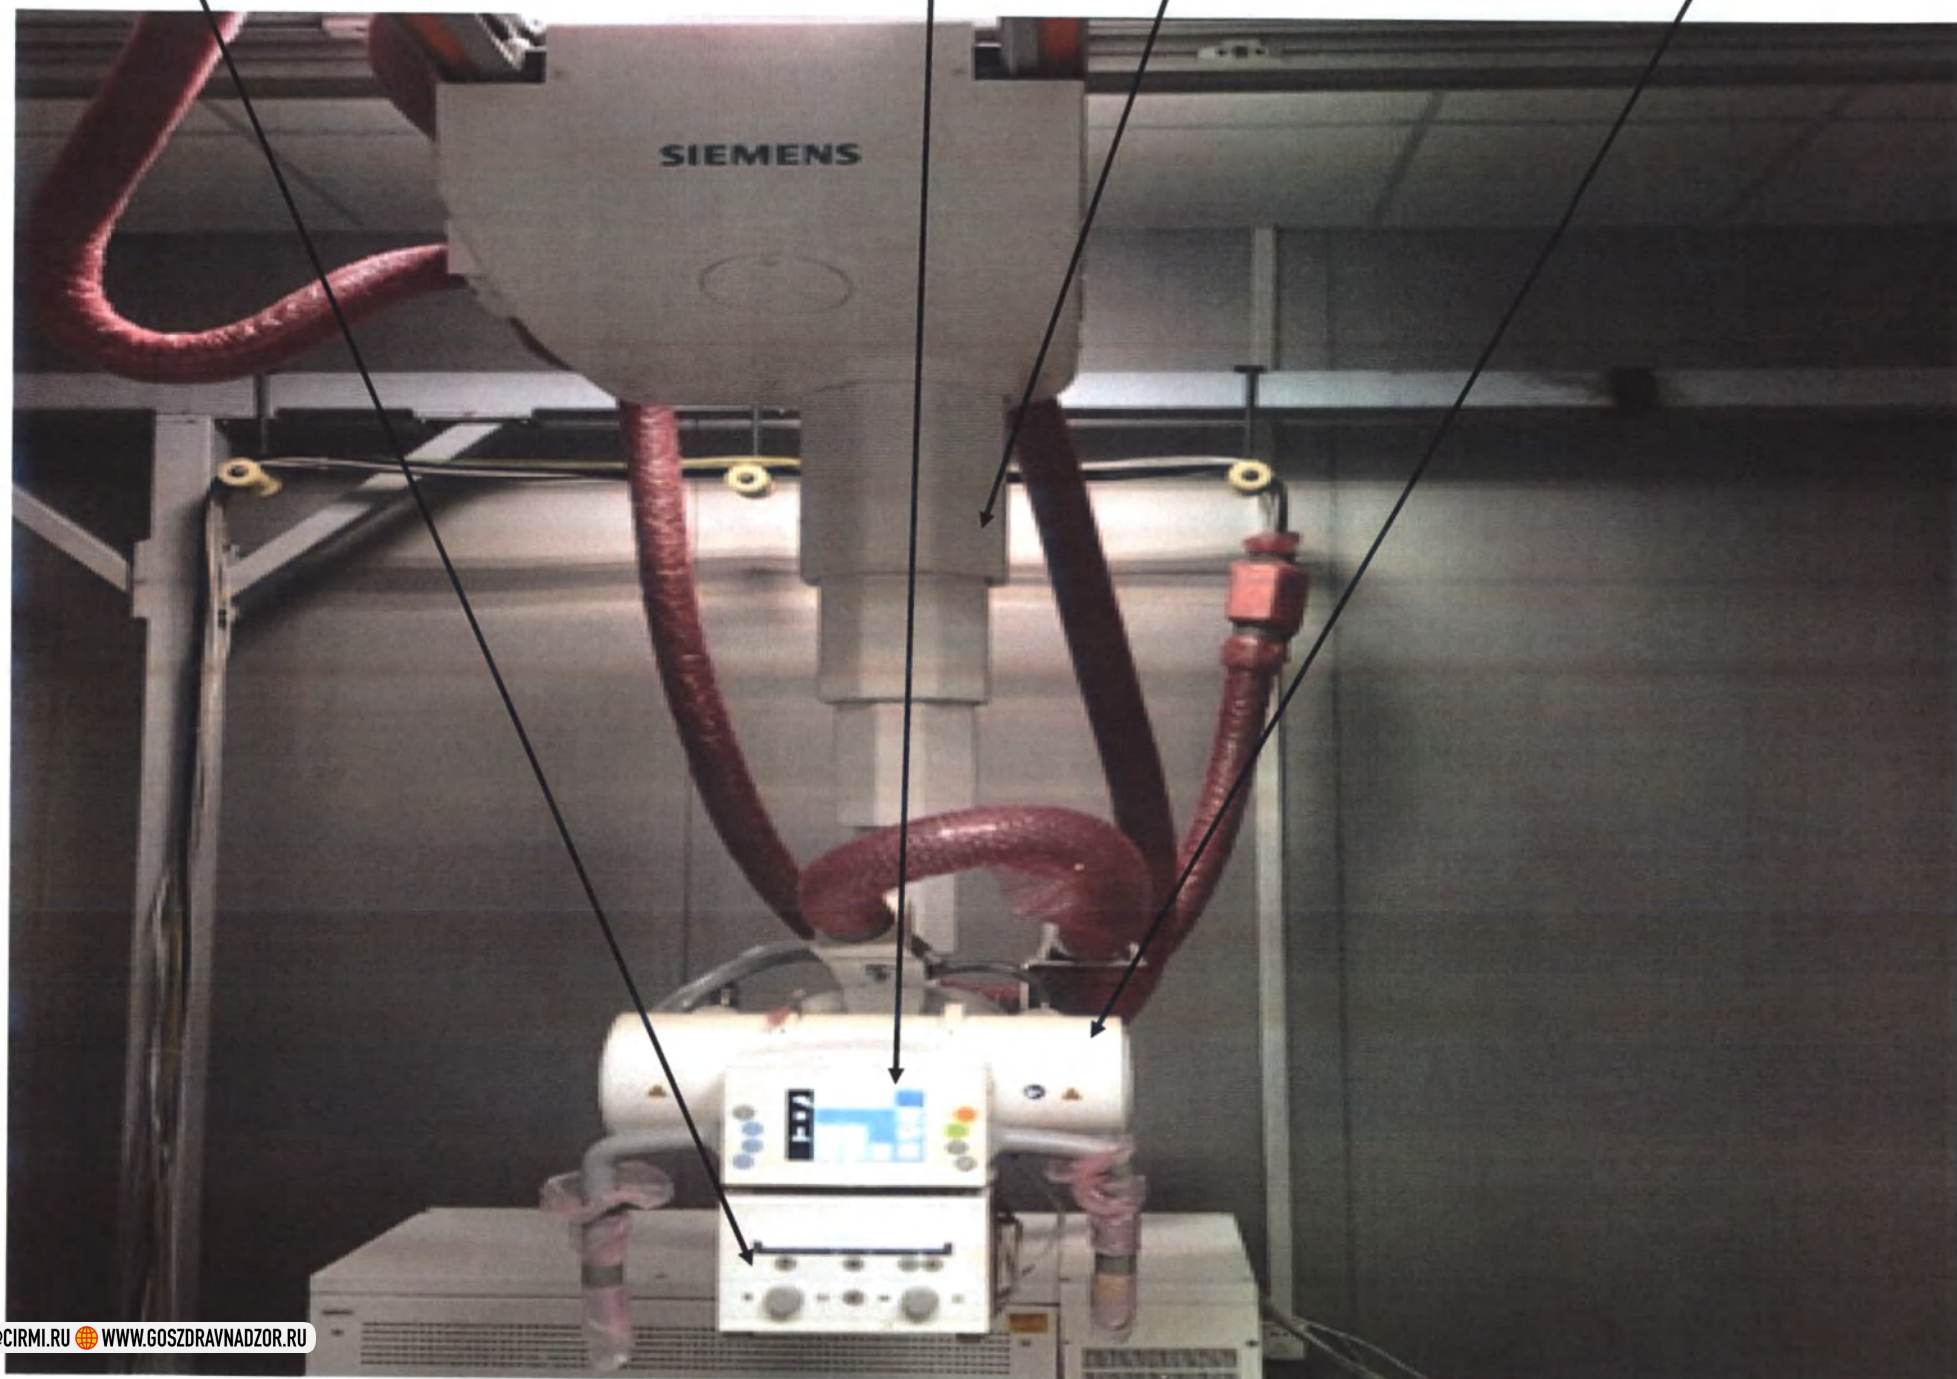


Базовый состав 3: Штатив потолочный в составе: - коллиматор многолепестковый.

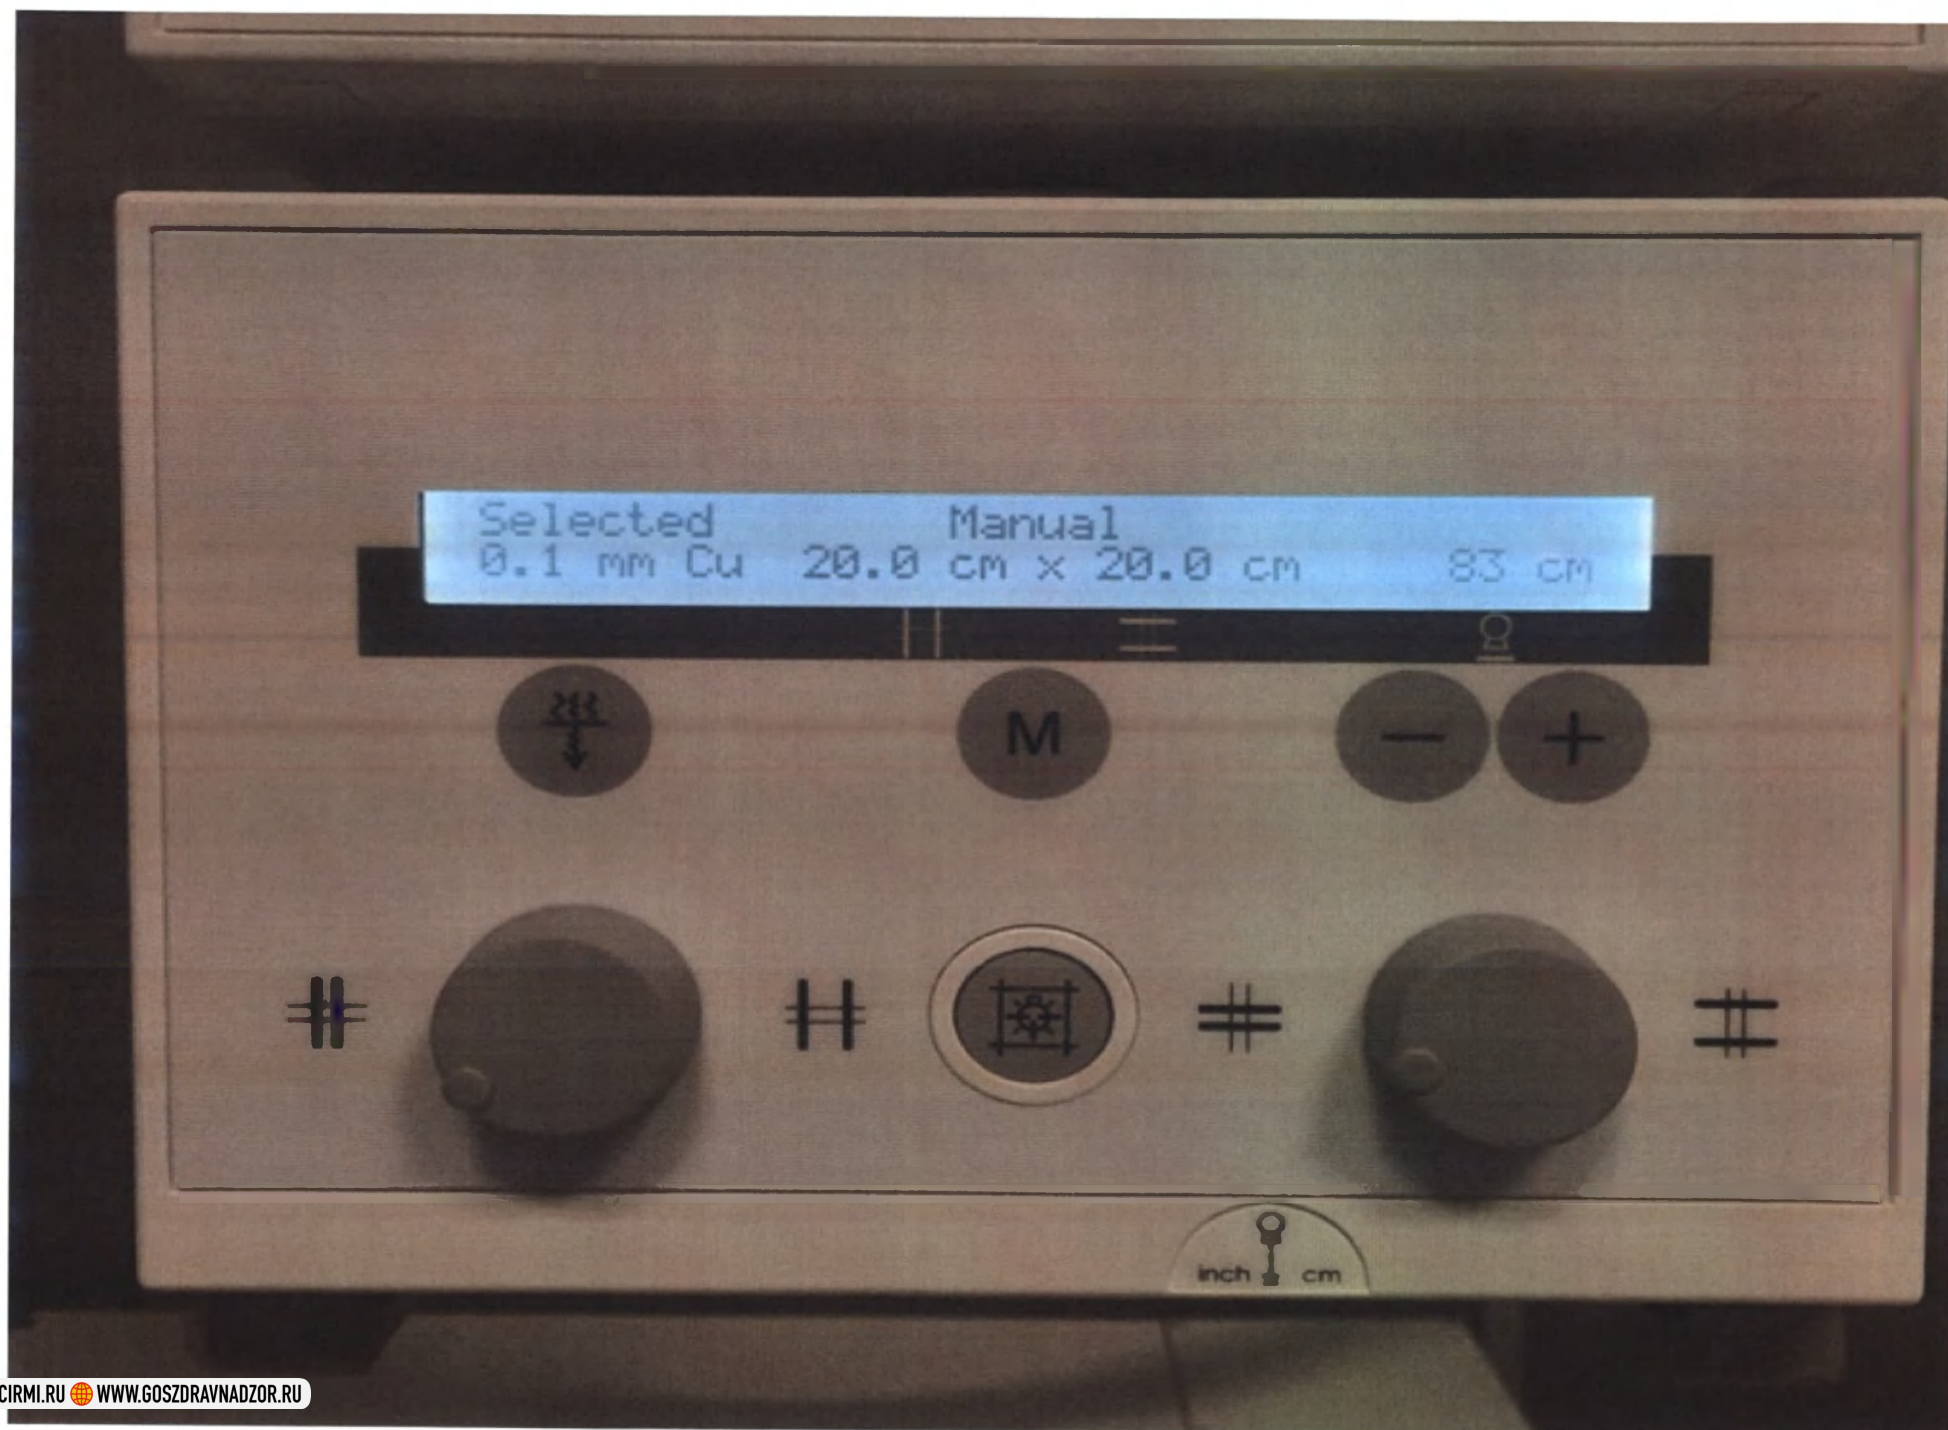


Базовый состав 3: - Рельсы потолочные .




Базовый состав 3: Стойка снимков вертикальная.

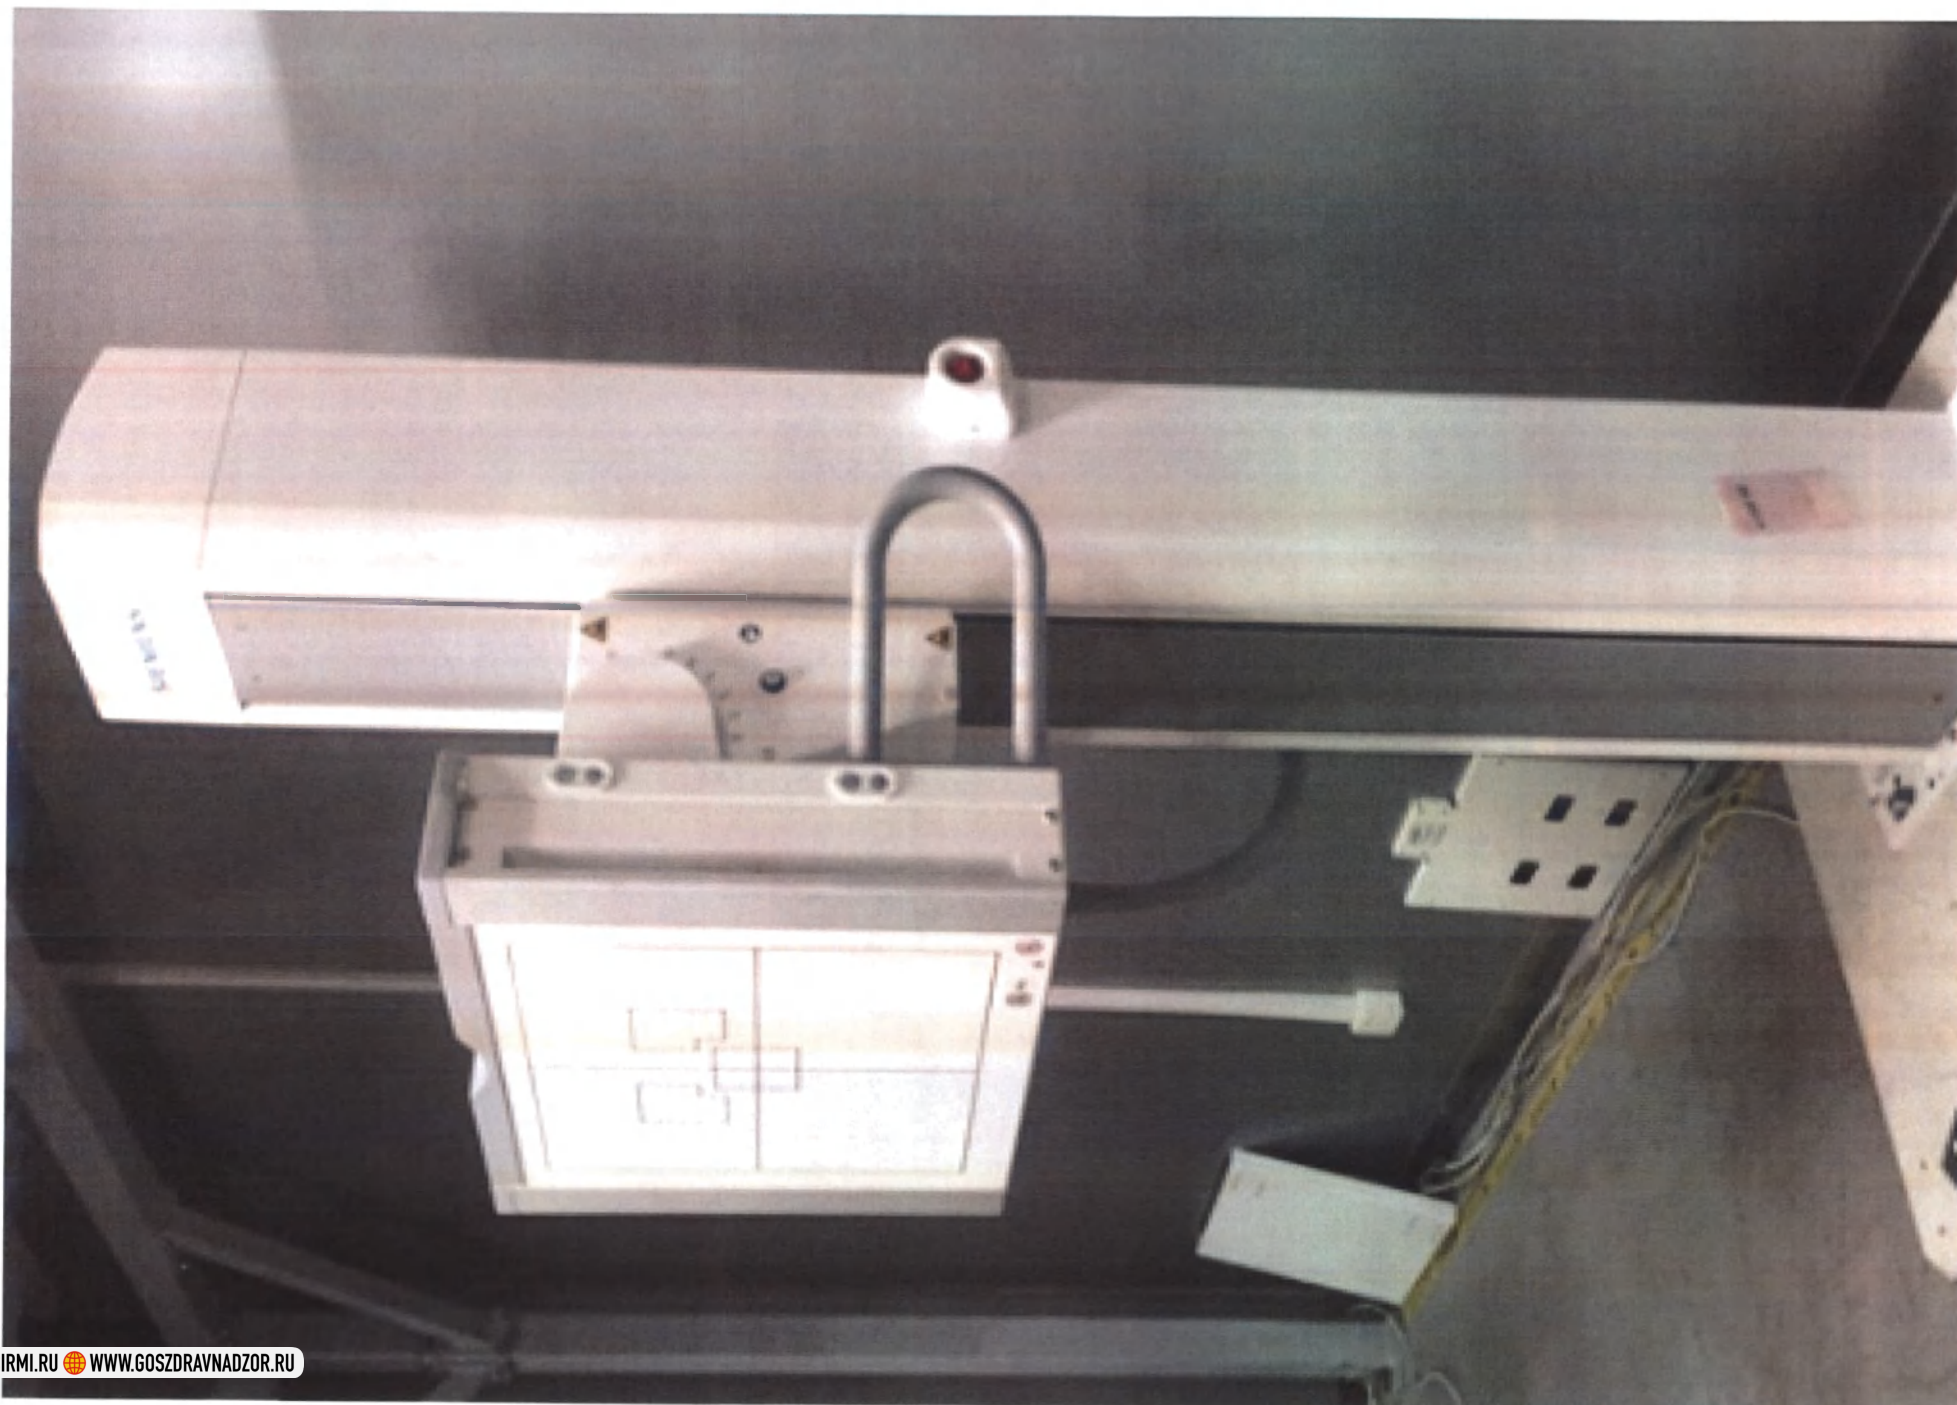

Базовый состав 3: Детектор беспроводной мобильный MAX wi-D и/или детектор беспроводной мобильный

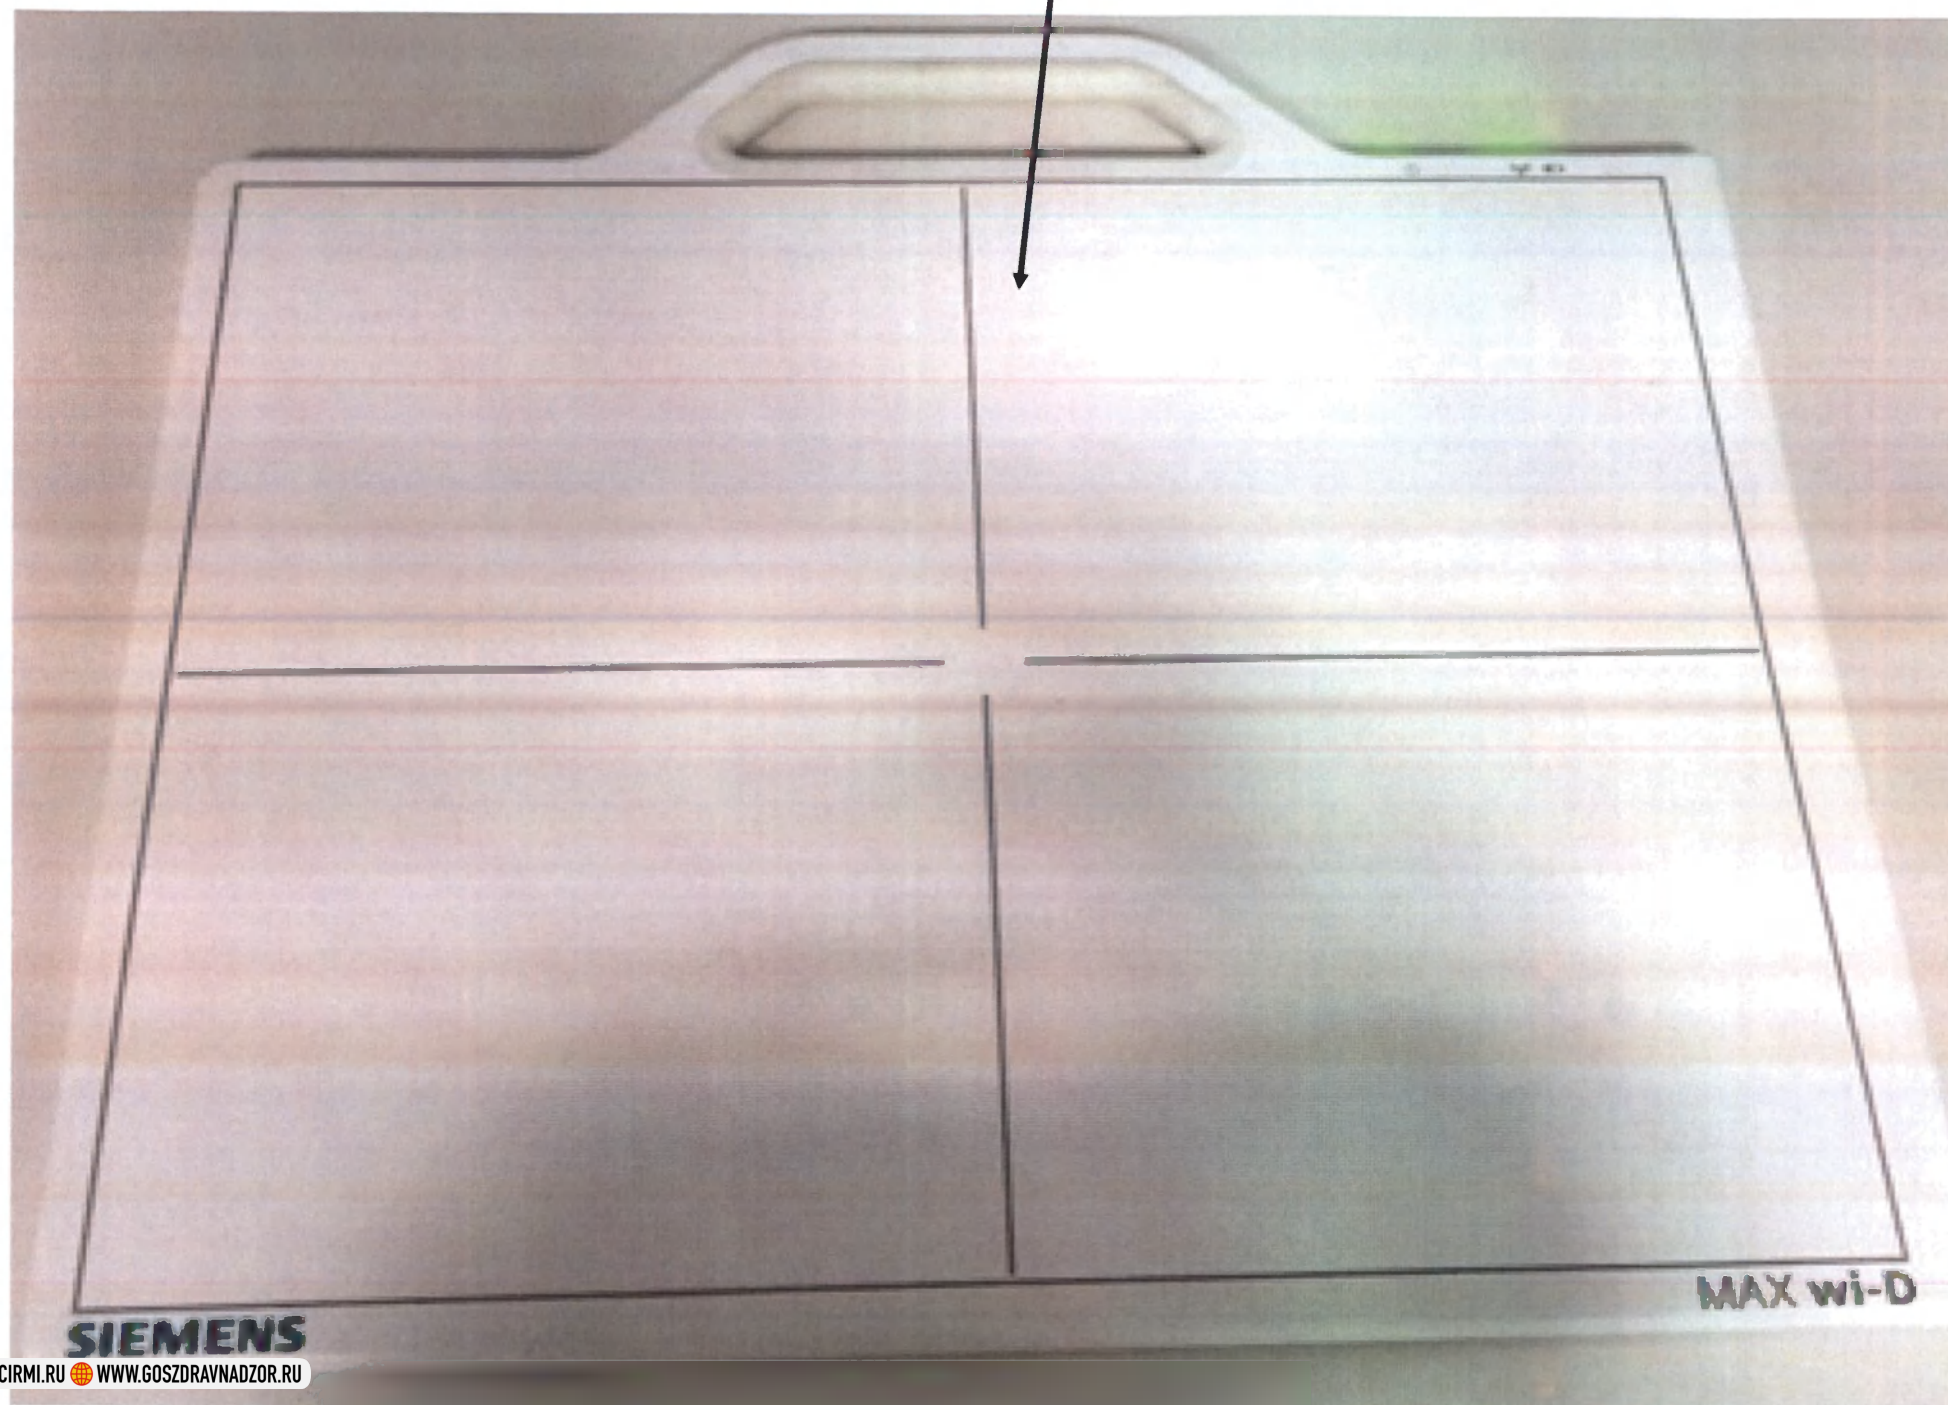


Базовый состав 3: Детектор беспроводной мобильный MAX wi-D и/или детектор беспроводной мобильный MAX mini (не более 5 шт.) и/или детектор встроенный MAX static

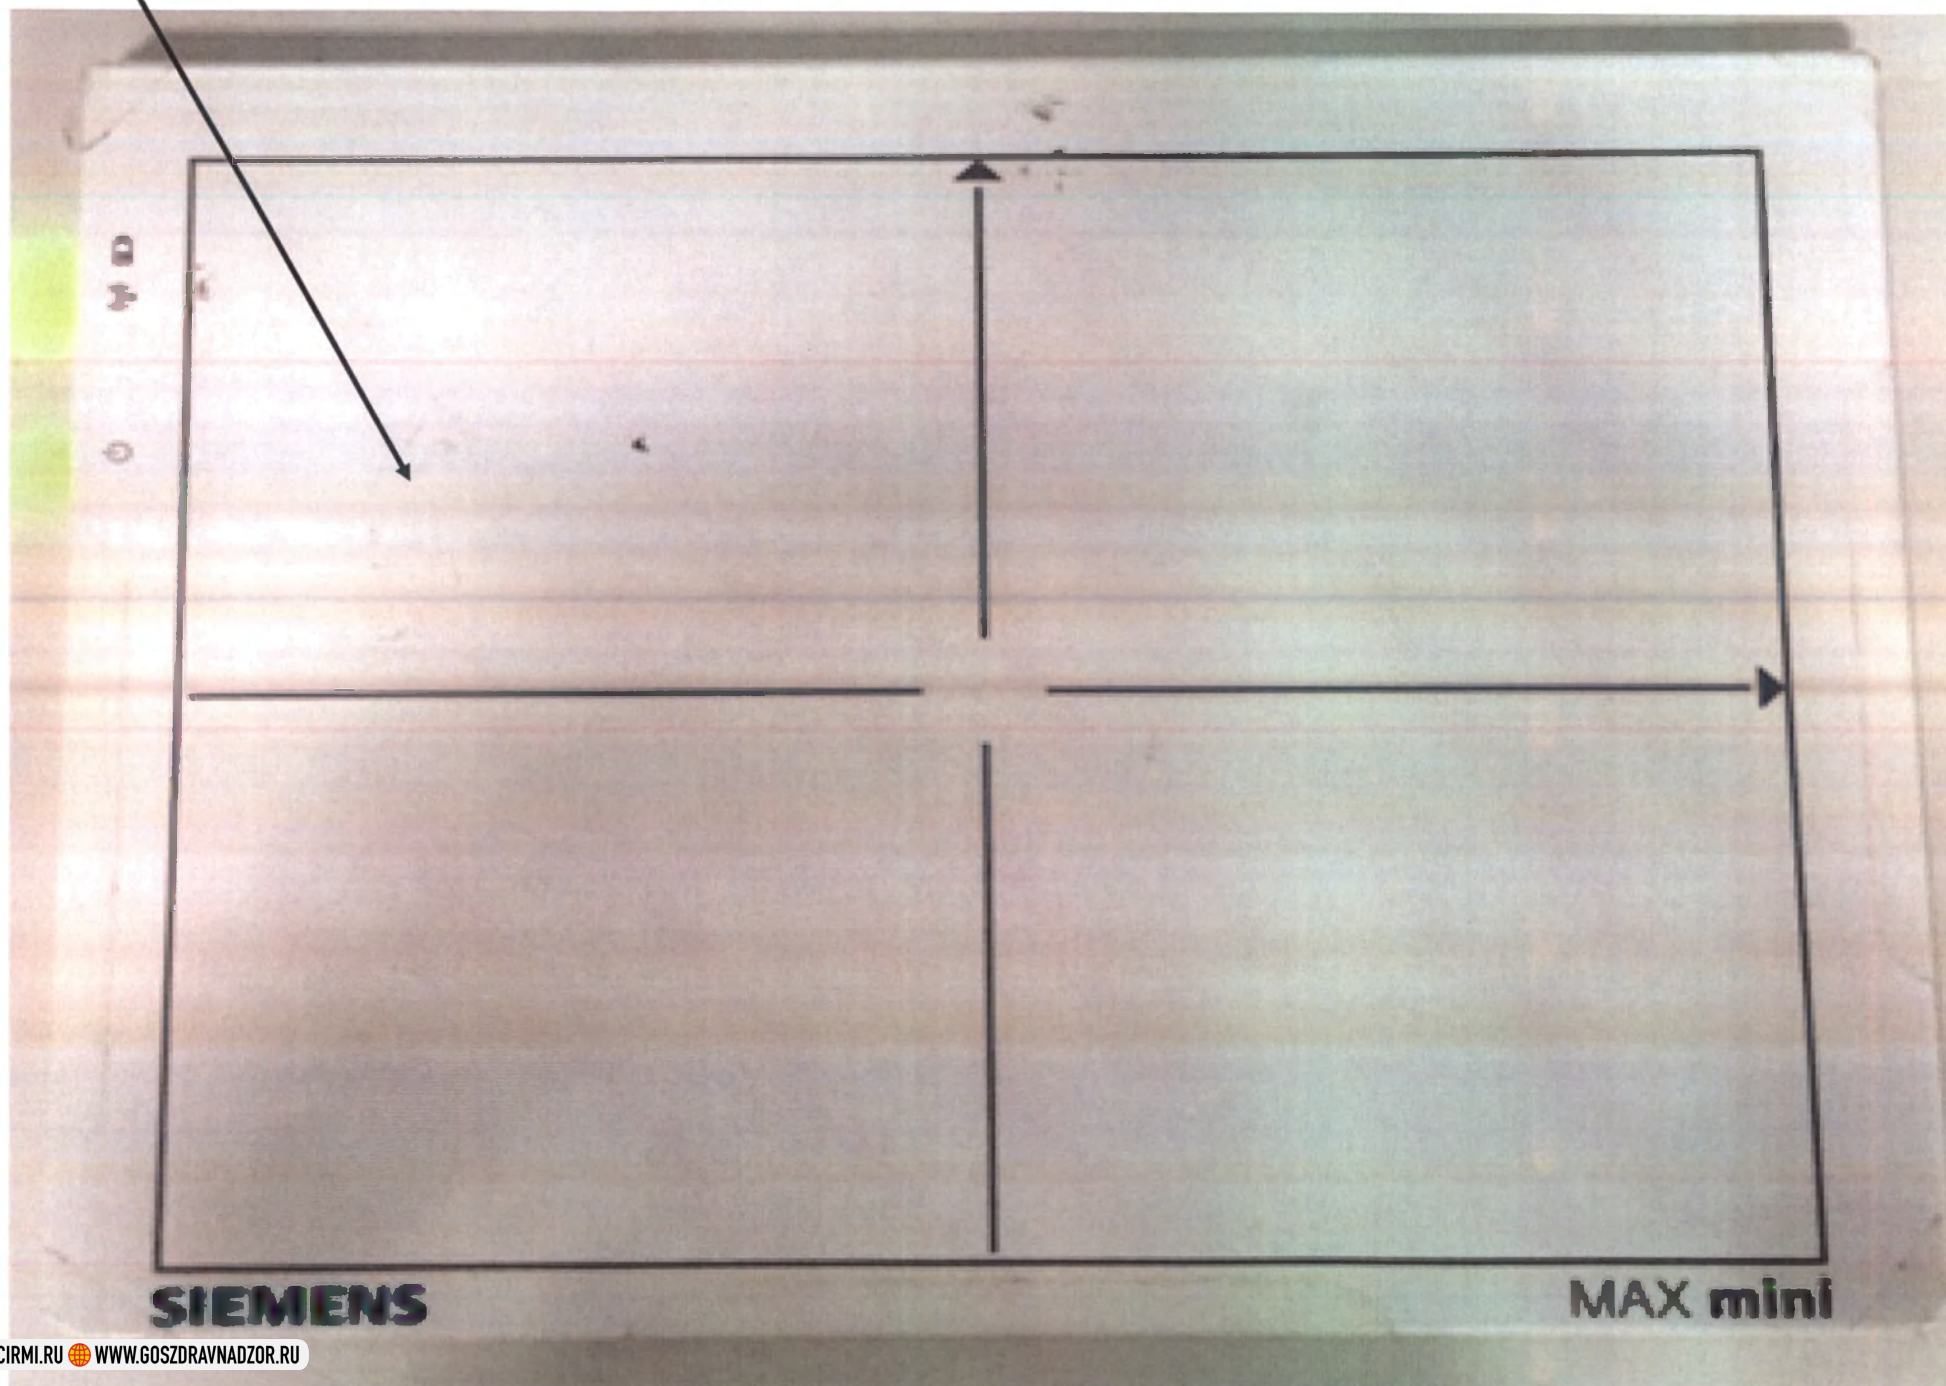


Базовый состав 3: Детектор беспроводной мобильный MAX wi-D и/или детектор беспроводной мобильный MAX mini (не более 5 шт.) и/или детектор встроенный MAX static



Базовый состав 3: Устройство измерения дозы.

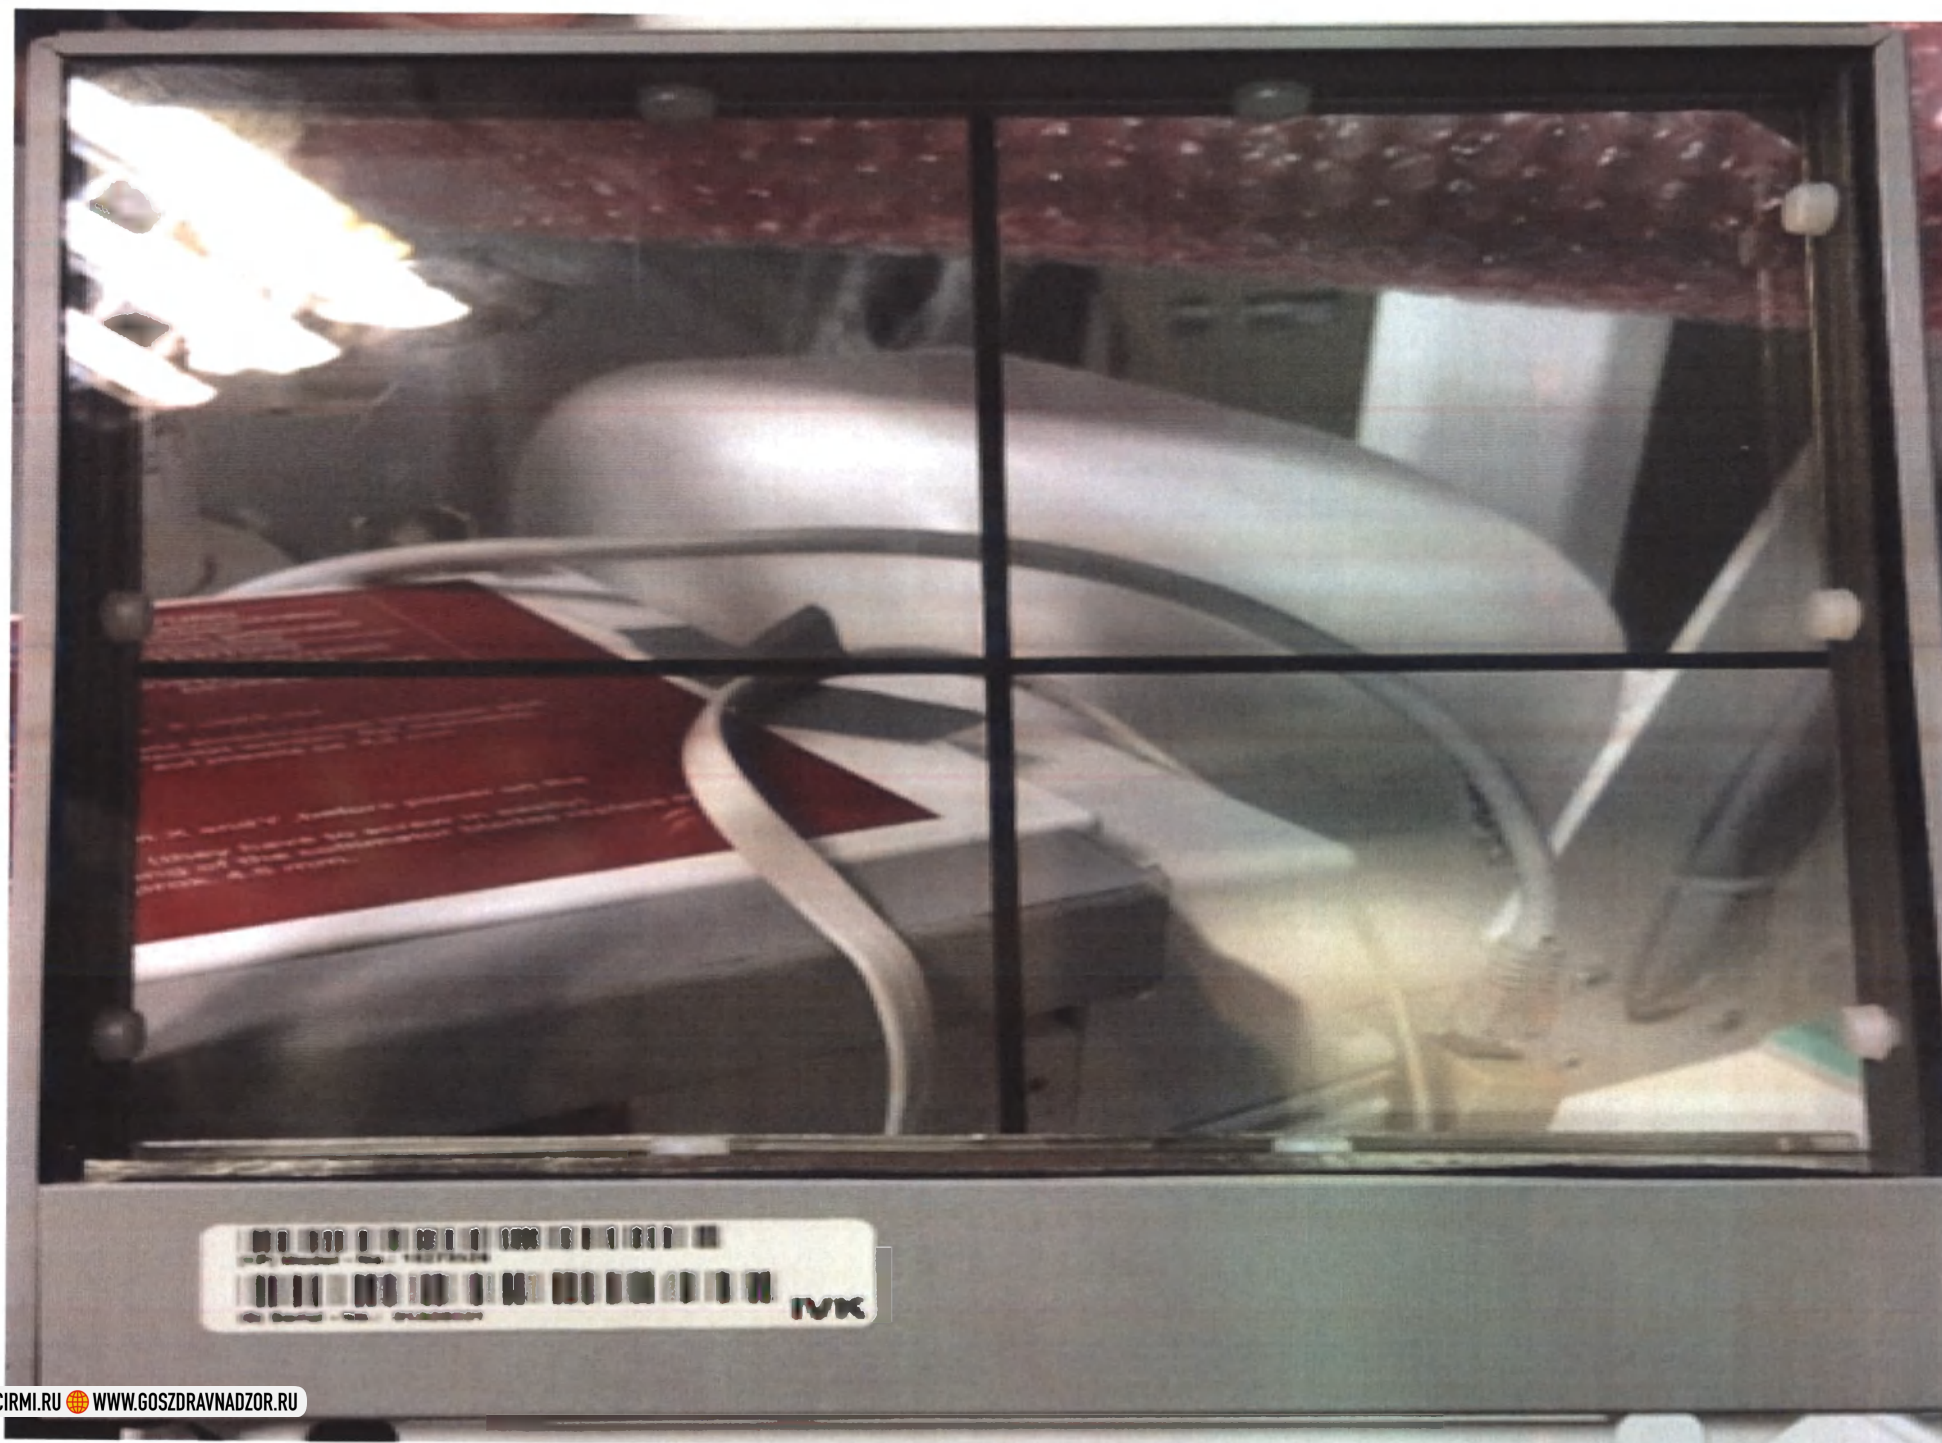

Базовый состав 3: Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.

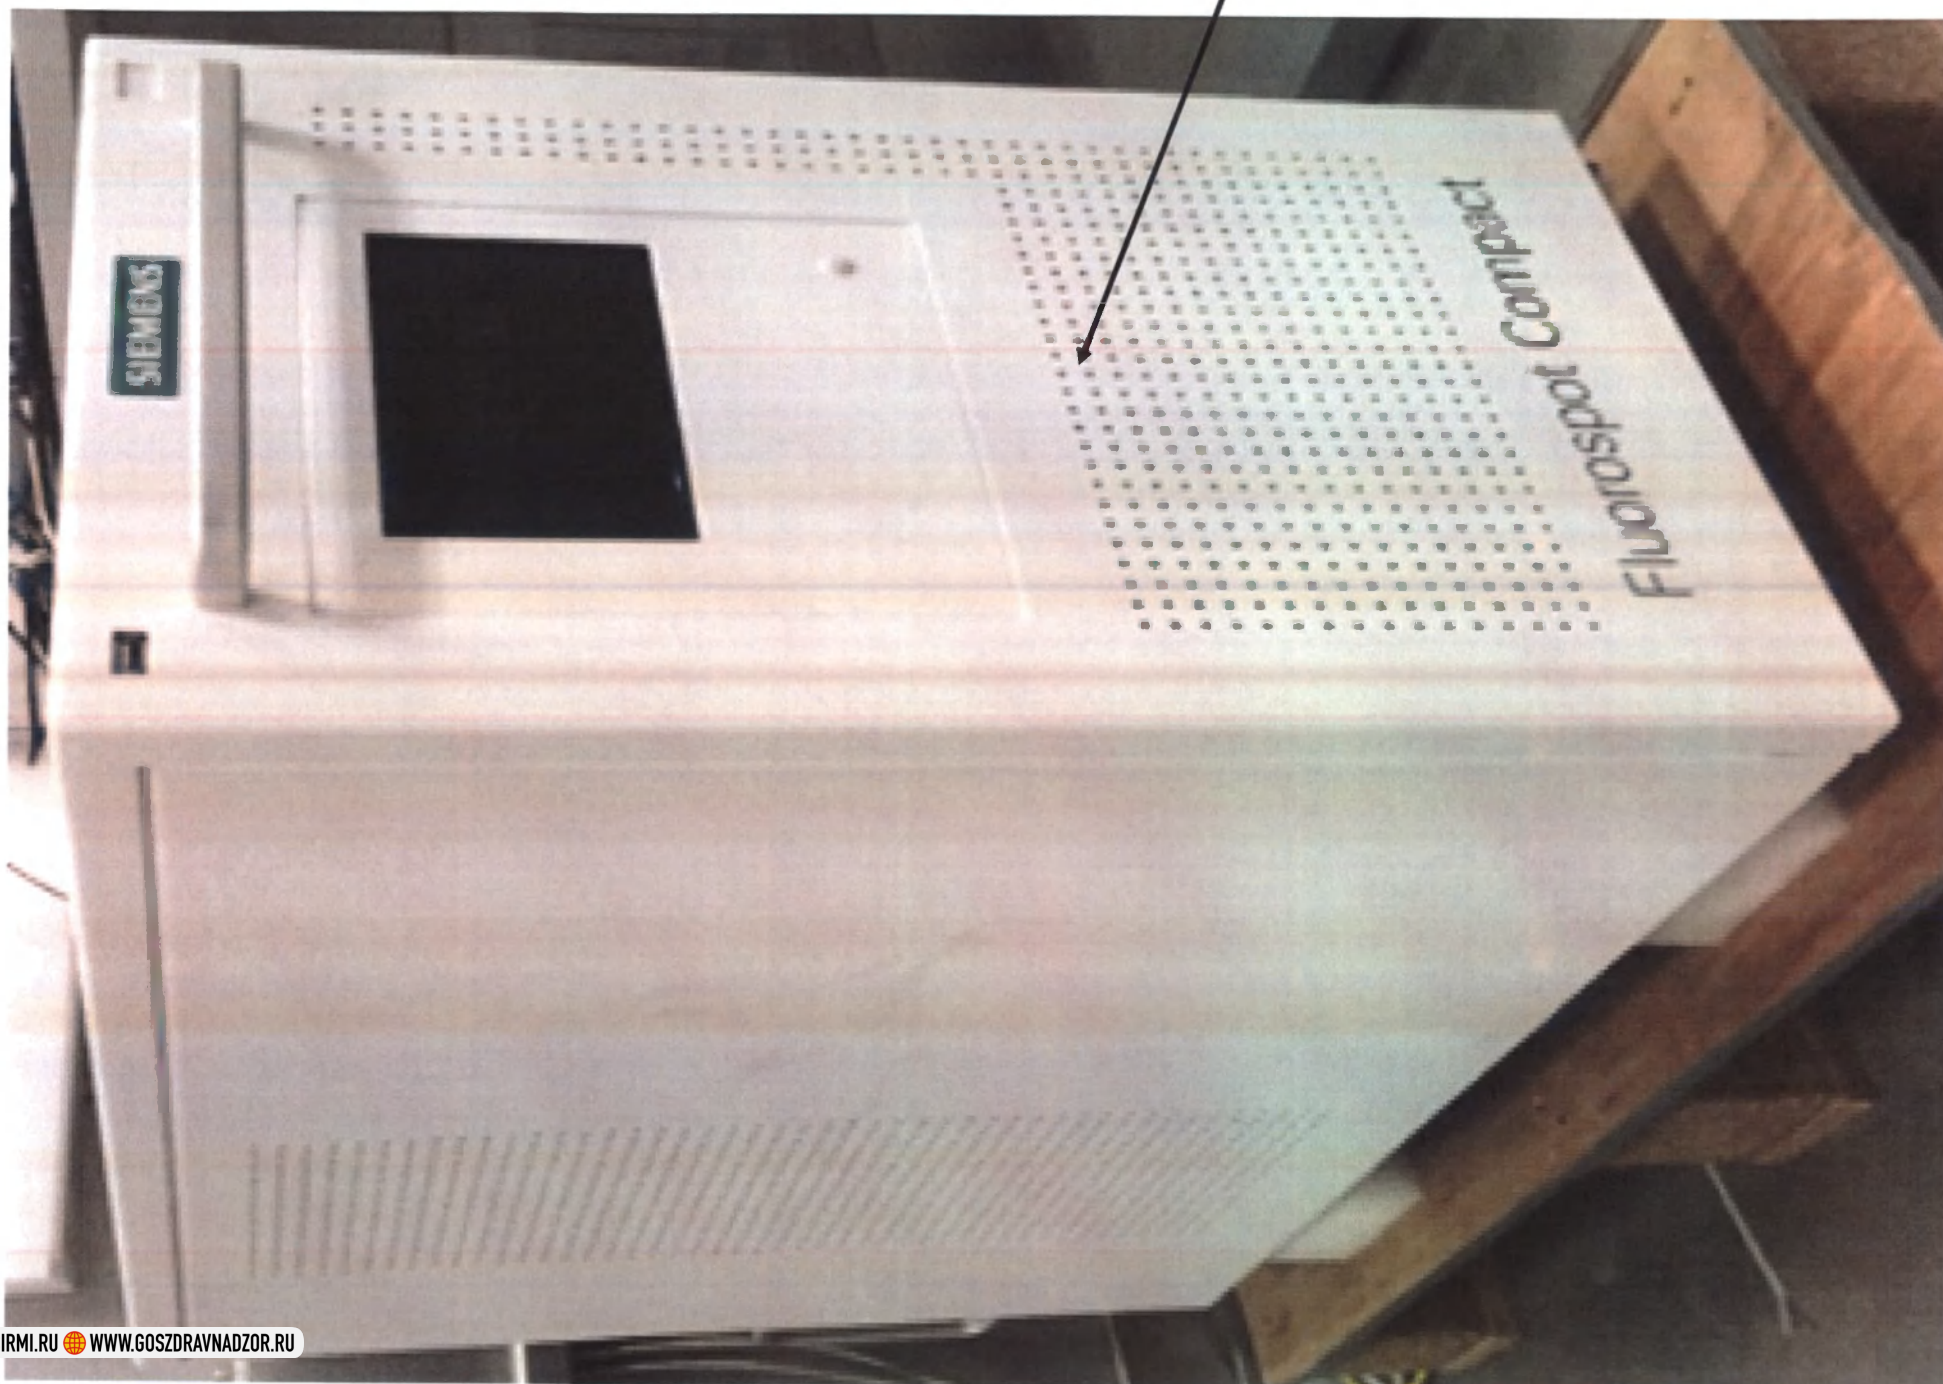

Базовый состав 3: Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.



Базовый состав 3: Система формирования изображений FLUOROSPOT Compact с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.



Базовый состав 3: Генератор рентгеновский, вариант исполнения: -генератор рентгеновский 55 кВт;



Базовый состав 3: Генератор рентгеновский, вариант исполнения: -генератор рентгеновский 65 кВт;



Базовый состав 3: Генератор рентгеновский, варианты исполнения: -генератор рентгеновский 80 кВт;



Базовый состав 3: Документация пользователя на русском языке.




Multix Fusion Max

Руководство пользователя

SIEMENS

Принадлежности: Программный режим DICOM Worklist/MPPS.

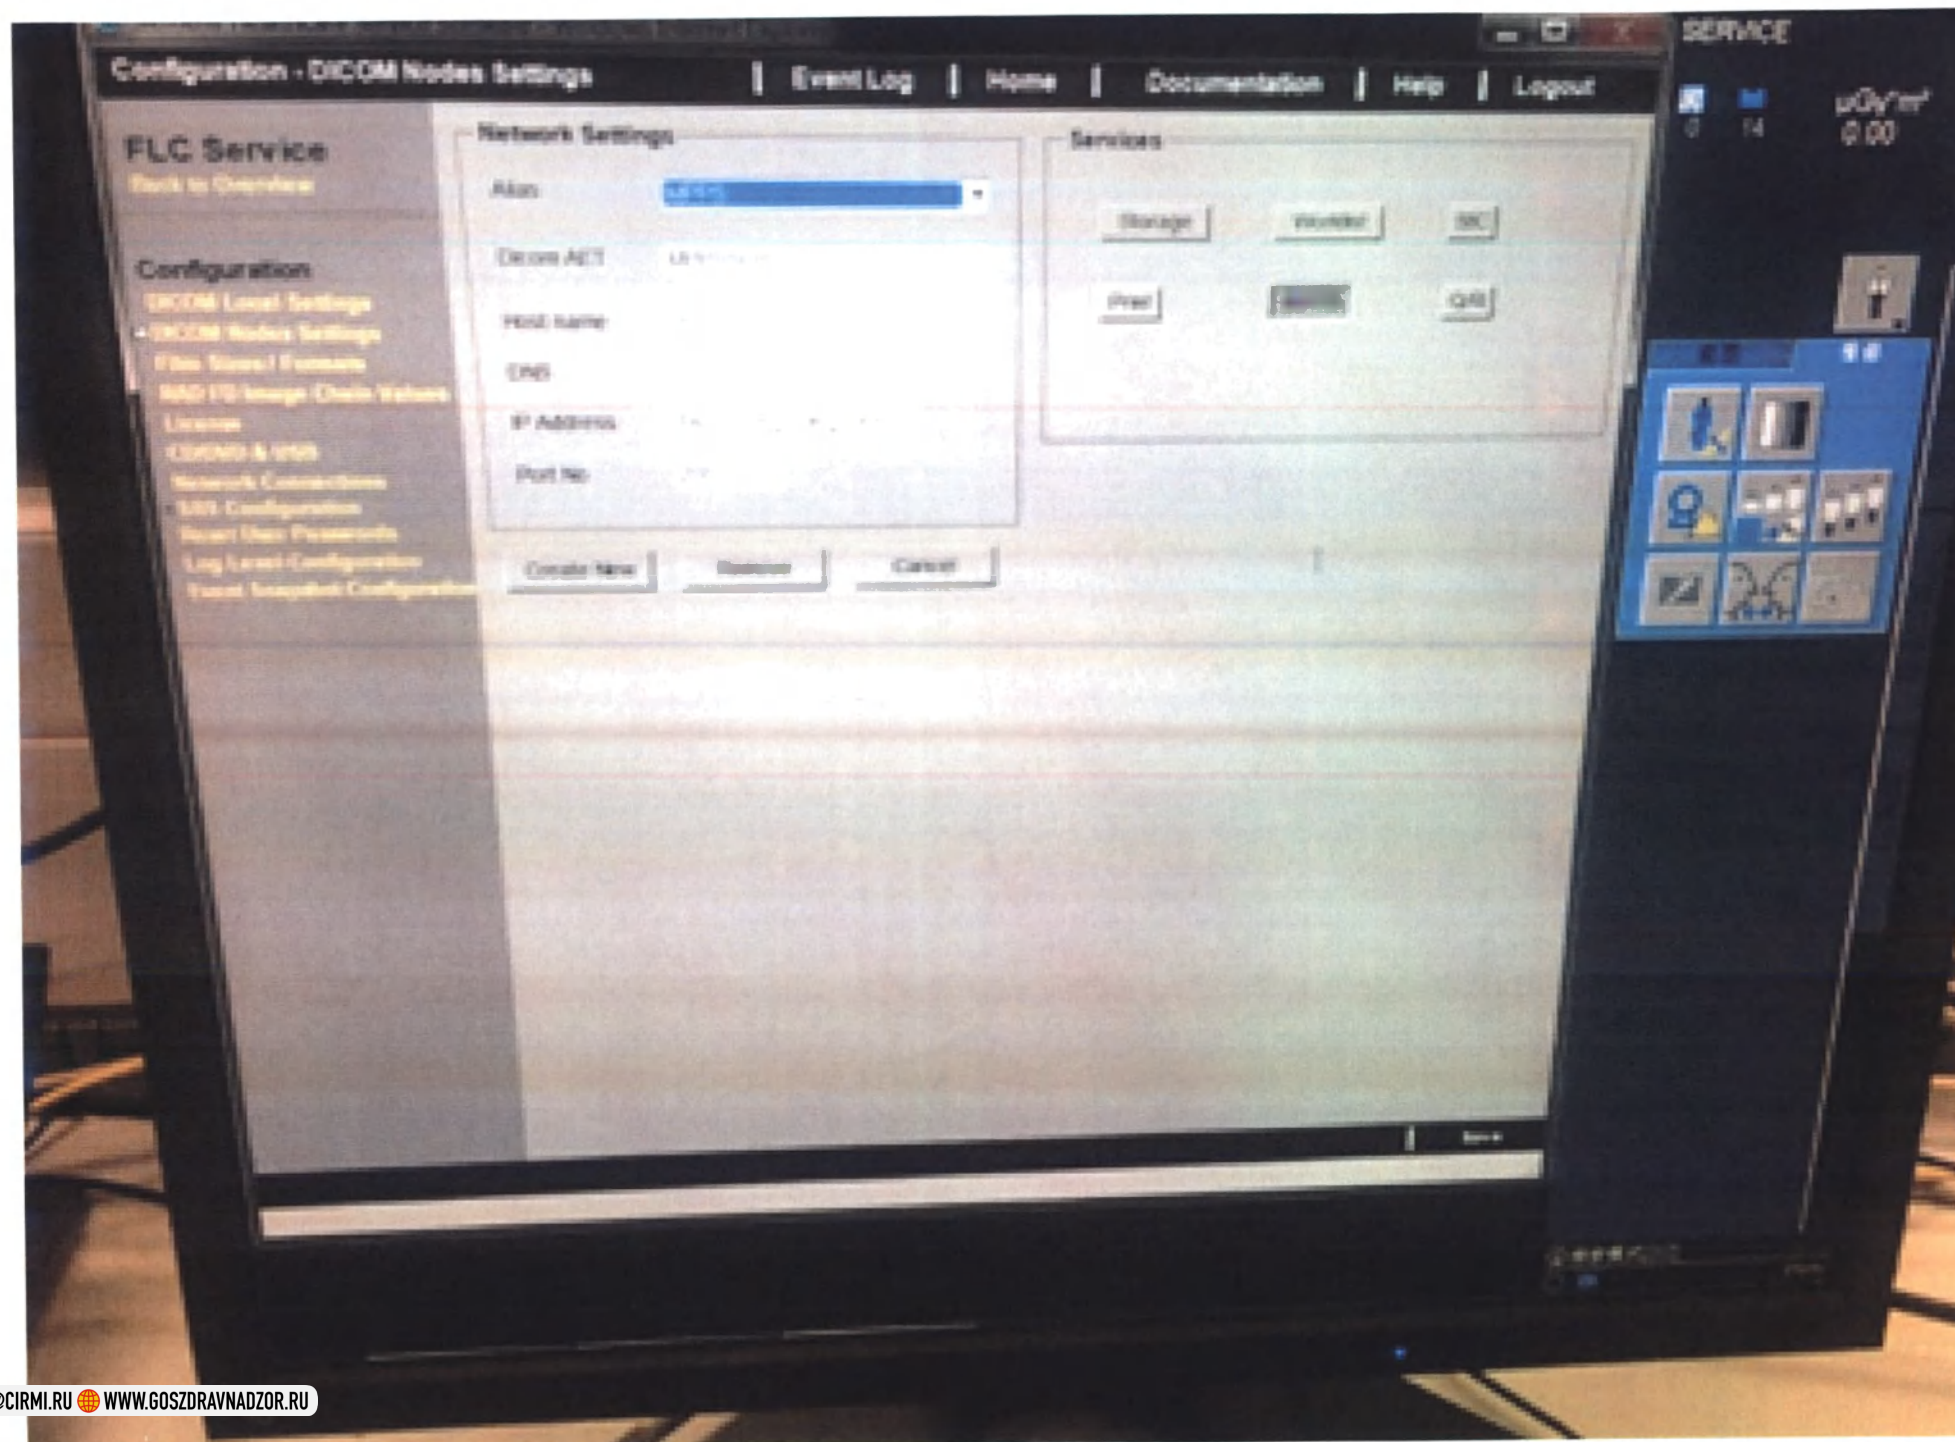

Принадлежности: Программный режим архивированных изображений DICOM Query Retrive.

Tomographic Acquisition Module (key)	No
DSA Acquisition Module (key)	No
DR Scanning (key)	No
Ortho (key)	Yes ▾
Dual Energy (key)	No
CDR (key)	Yes ▾
DVD Recorder (key)	No
Dicom Send (key)	Yes ▾
Dicom Print (key)	Yes ▾
Dicom Worklist (key)	Yes ▾
Dicom Query (key)	Yes ▾
Paper Printer (key)	No
Harmonisation only for DFR images (key)	No
Care Profile (key)	No
Care Position (key)	No
Stenosis Quantification (key)	No

Default Values
AutoLic
Configure

Принадлежности: Программный режим информационной безопасности .

Dicom Print (key)	Yes ▼
Dicom Worklist (key)	Yes ▼
Dicom Query (key)	Yes ▼
Paper Printer (key)	Yes ▼
Harmonisation only for DFR images (key)	No
Care Profile (key)	No
Care Position (key)	No
Stenosis Quantification (key)	No
Automatic Positioning (key)	No
Magic Watch (key)	Yes ▼
Trend Micro (key)	No
Multi Modality View (key)	No
Netviewer Support (key)	Yes ▼
HIPAA (key)	Yes ▼
Reference Monitor (key)	No
Video Loop Short (key)	No
Framerate 3 (key)	No
Framerate 2 (key)	No
Framerate 1 (key)	No

Default Values | AutoLic | Configure | Sa

Принадлежности: Программный режим получения панорамных изображений.

Tomographic Acquisition Module (key)	No
DSA Acquisition Module (key)	No
DR Scanning (key)	No
Ortho (key)	Yes ▾
Dual Energy (key)	No
CDR (key)	Yes ▾
DVD Recorder (key)	No
Dicom Send (key)	Yes ▾
Dicom Print (key)	Yes ▾
Dicom Worklist (key)	Yes ▾
Dicom Query (key)	Yes ▾
Paper Printer (key)	No
Harmonisation only for DFR images (key)	No
Care Profile (key)	No
Care Position (key)	No
Stenosis Quantification (key)	No

Default Values
AutoLic
Configure

Принадлежности: Программный режим увеличения мощности генератора.

CAN Node-ID for Polydoros F80/R80 [1, 127]	28
Tubes	
High Tension Cable Length Tube 1 [m]	24m ▾
Small Focus for Tube 1	available ▾
Large Focus for Tube 1	available ▾
Third Focus for Tube 1	n.a ▾
max power (key)	55 kW ▾
max kWa iont [0.1 kWa] [0, 10000]	80 kW
min current [0.1 mA] [0, 20000]	65 kW
max current [0.1 mA] [0, 20000]	55 kW
min kV [0.1 kV] [0, 1500]	400
max kV [0.1 kV] [0, 1500]	1500
min mAs of [0.01 mAs] [0, 80000]	50
max mAs	800mAs ▾
min time for 3-pnt [0.1 ms] [0, 999999]	200
max time for iont [0.1 ms] [0, 999999]	50000
AEC	
Table AEC Type (Channel A)	2p 6mm 3-fields
AEC Orientation (Channel A)	No Flip
AEC APC Type (Channel B)	2p 6mm 3-fields
Default Values	

Принадлежности: Удлинение потолочных рельс для продольного перемещения .




Принадлежности: Удлинение рельс телескопическое .




Принадлежности: Удлинение для вертикальной стойки .




Принадлежности: Решетка съёмная отсеивающая для детектора MAX wi-D (5/85, F115).

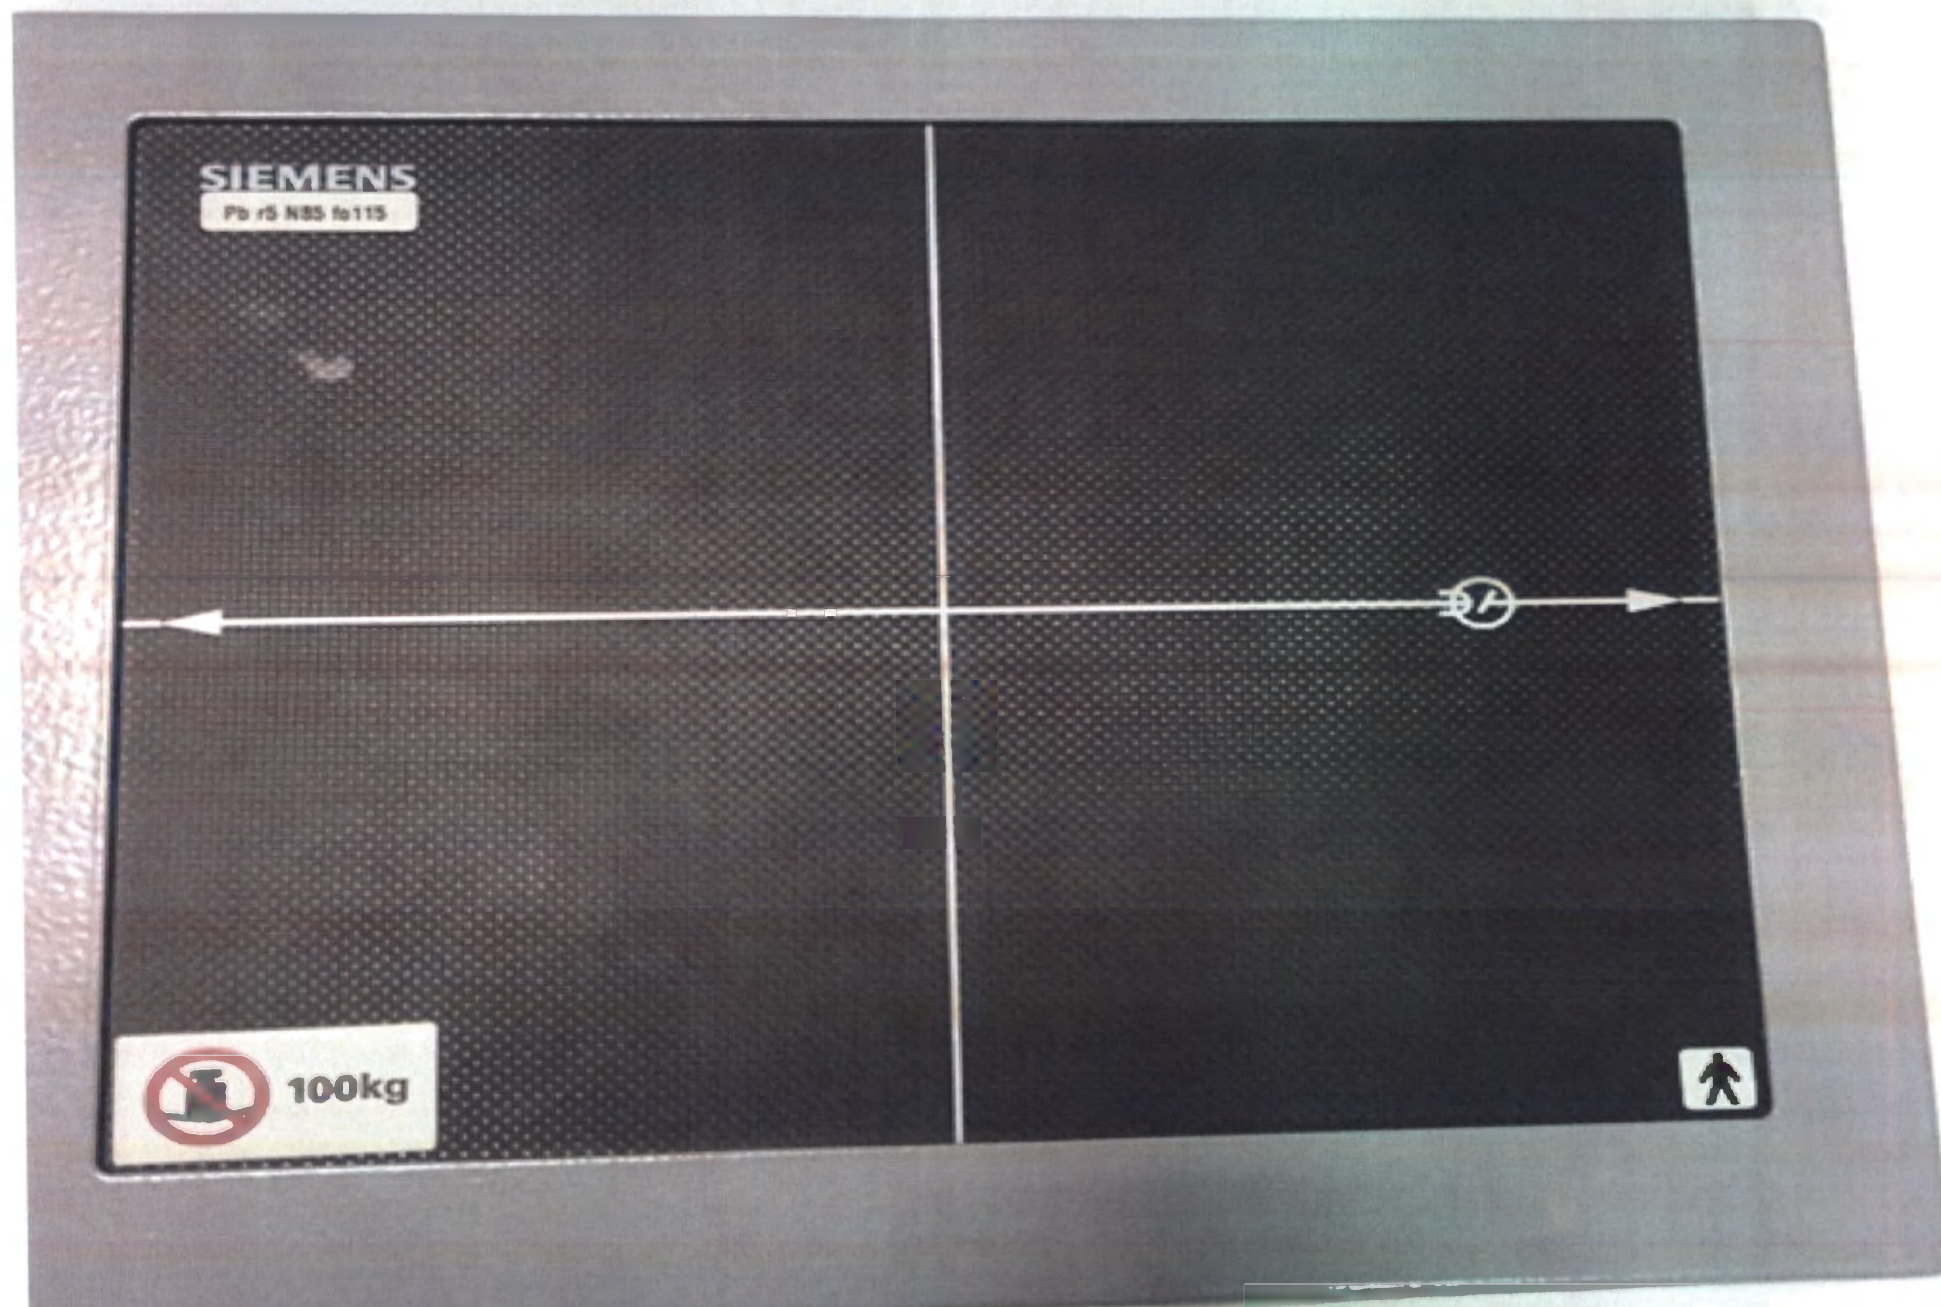


Принадлежности: Решетка съемная отсеивающая для детектора MAX mini (5/85, F115).

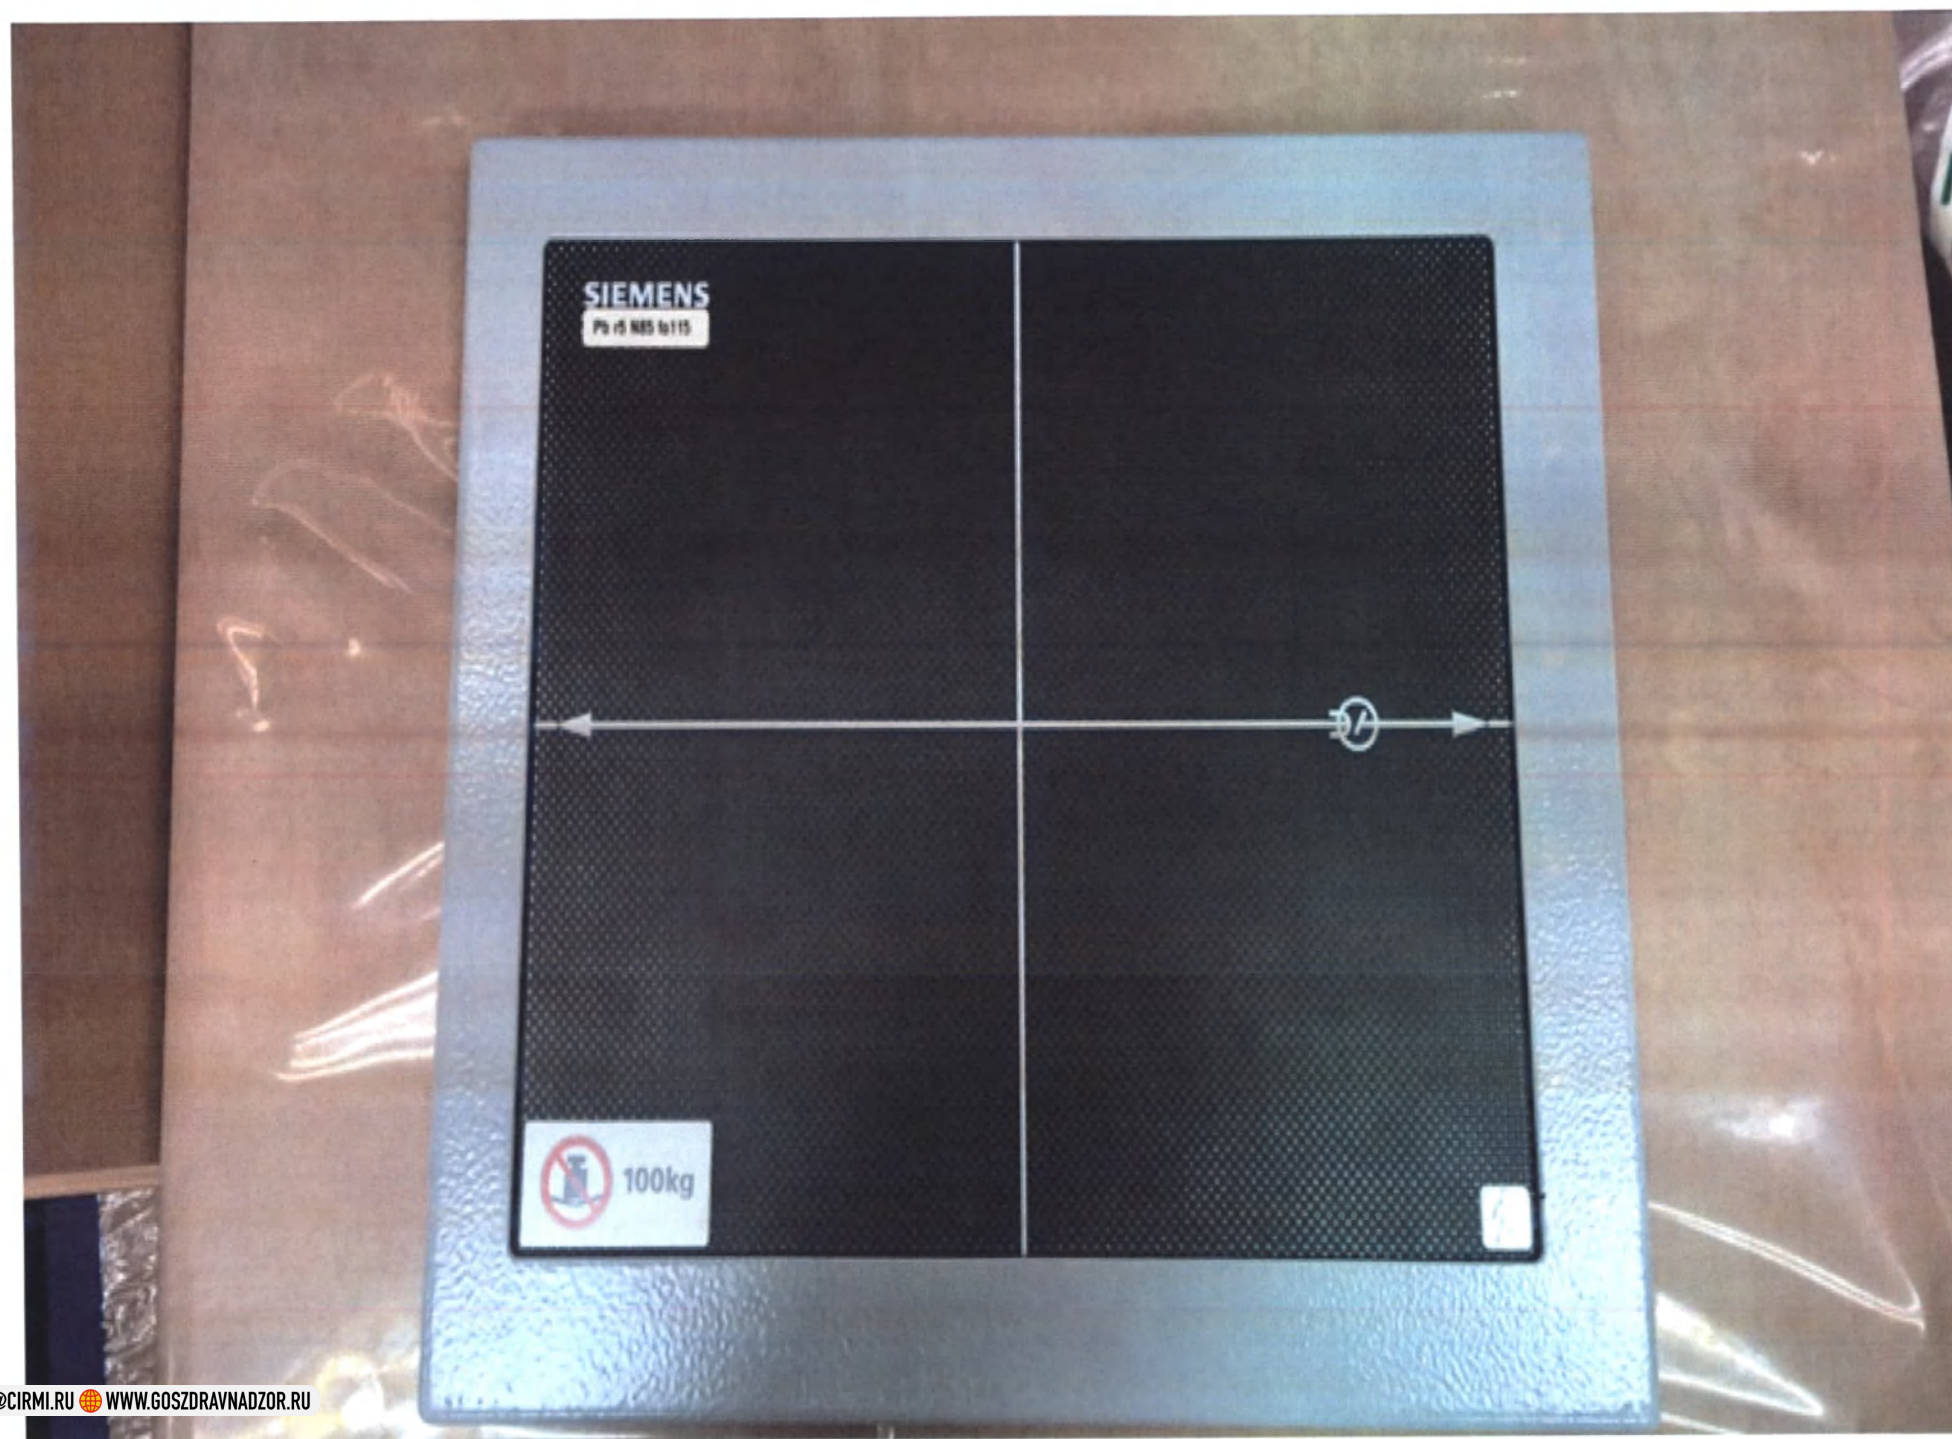


Принадлежности: Решетка отсеивающая (13/92, F115).

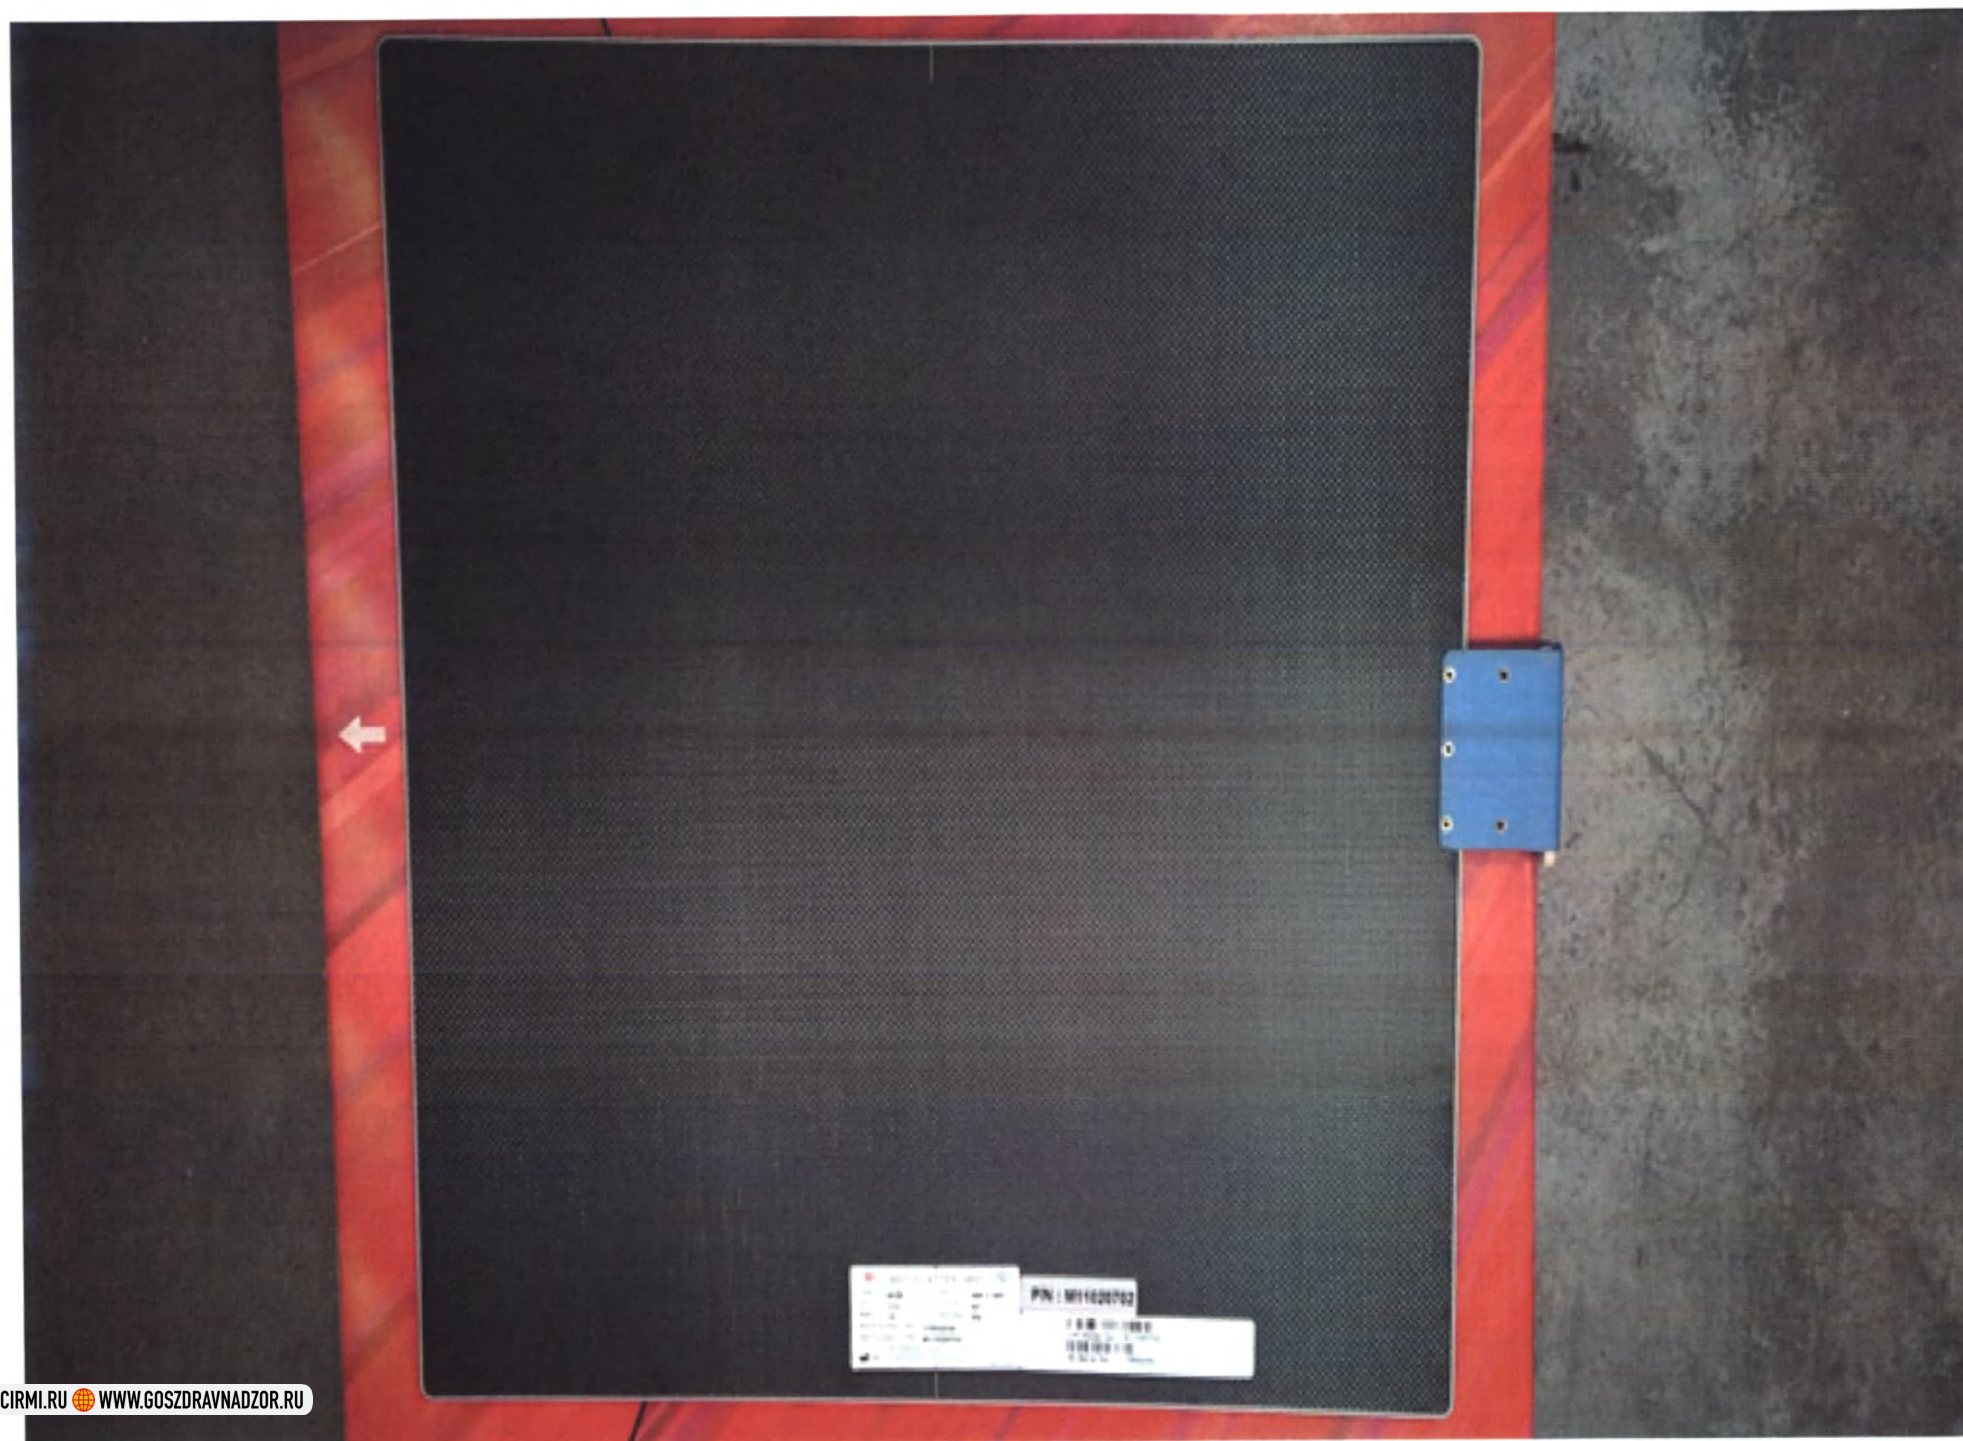


Принадлежности: Решетка отсеивающая (13/92, F180).

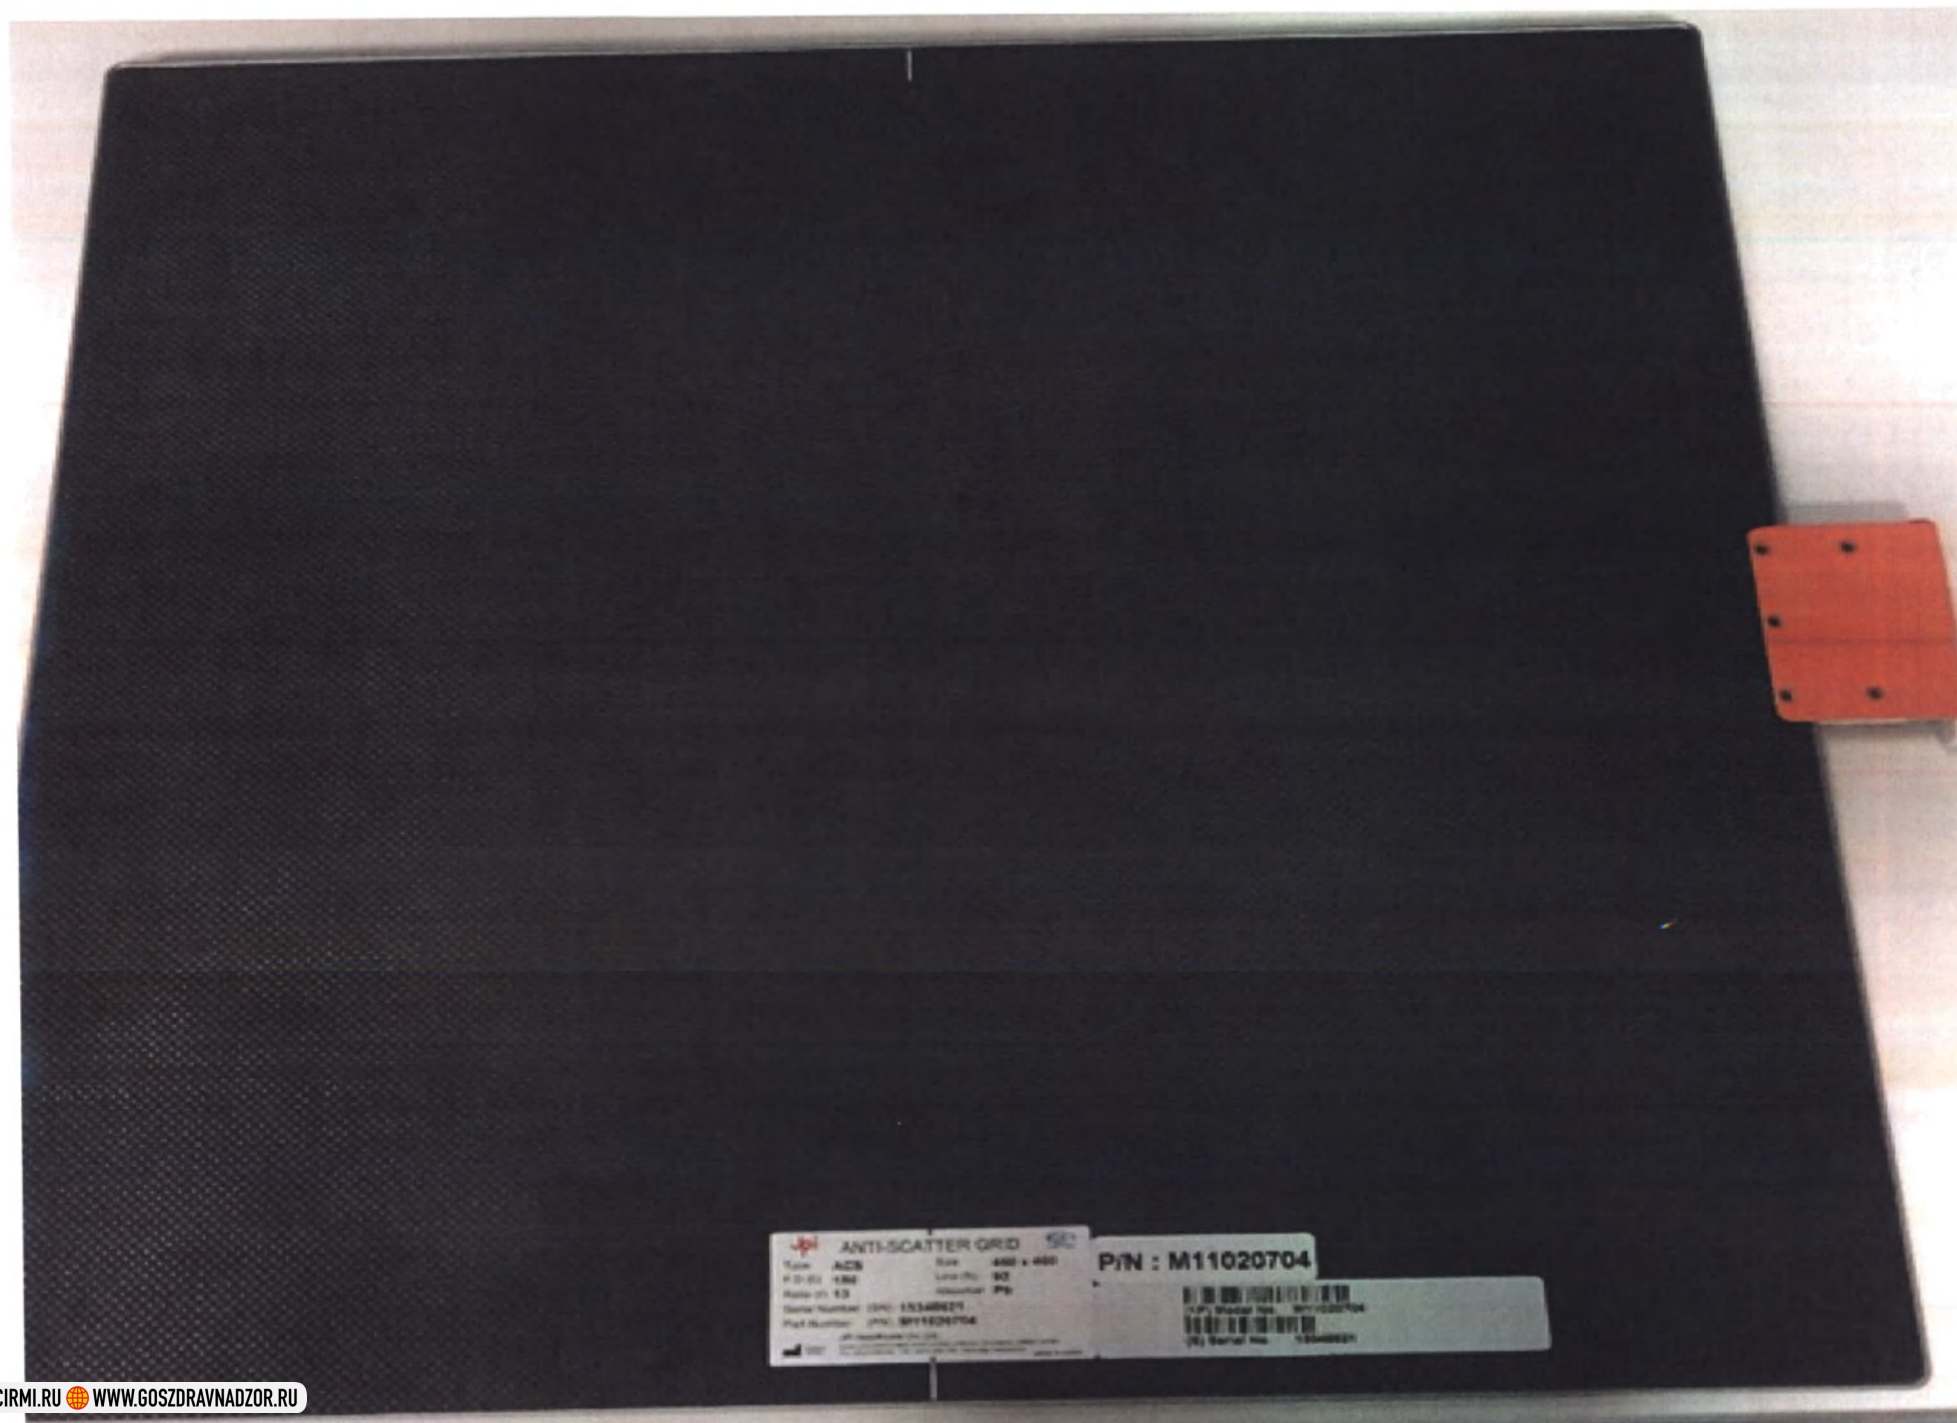


Принадлежности: Решетка отсеивающая универсальная (13/92) .

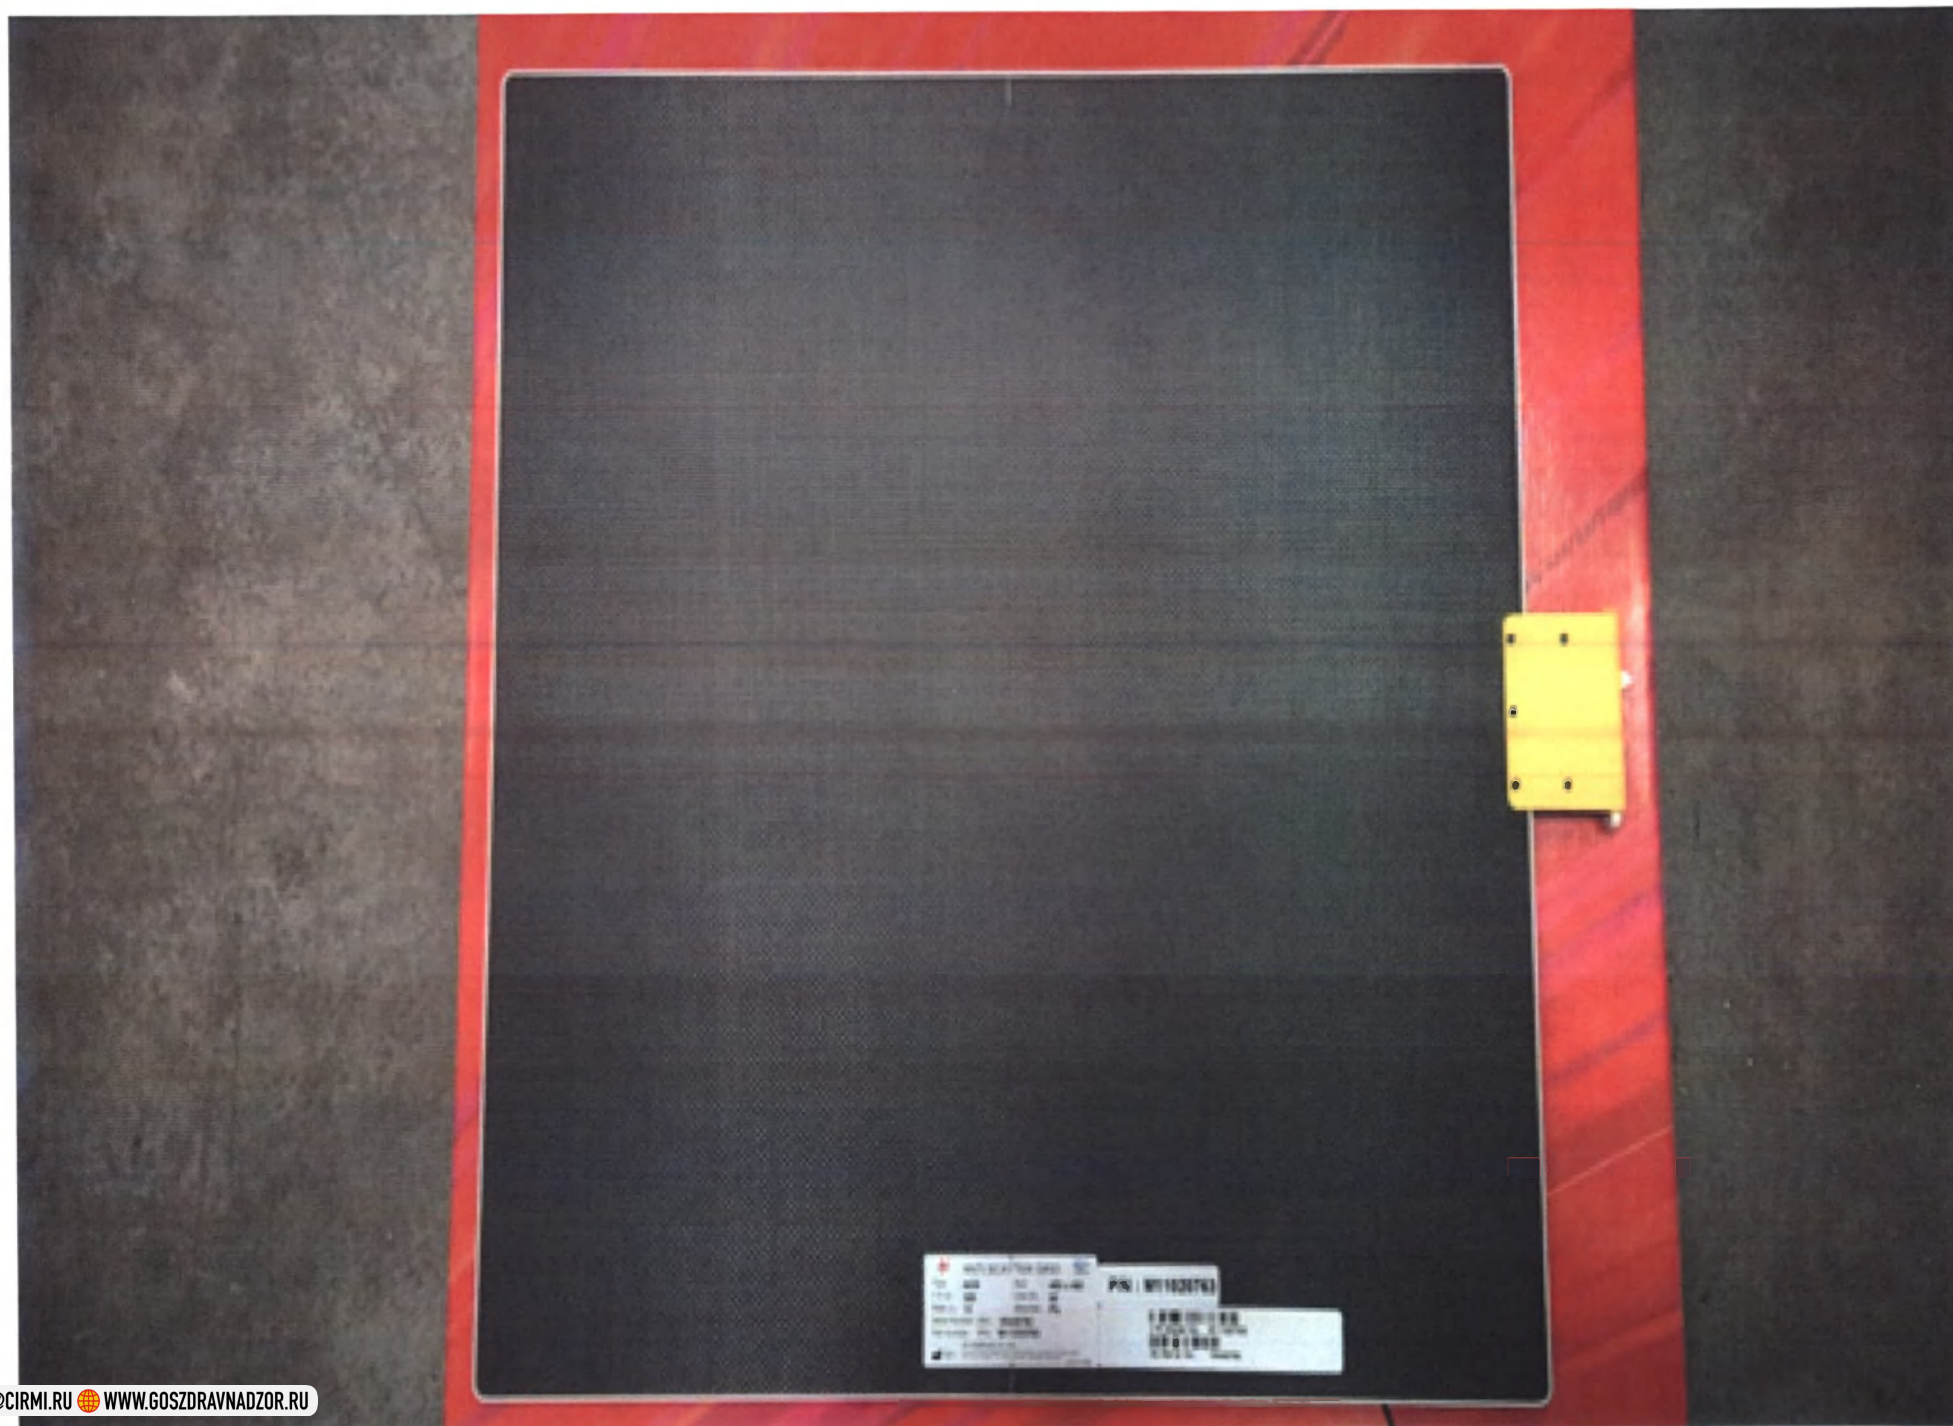


Принадлежности: Ножной переключатель двухсторонний .

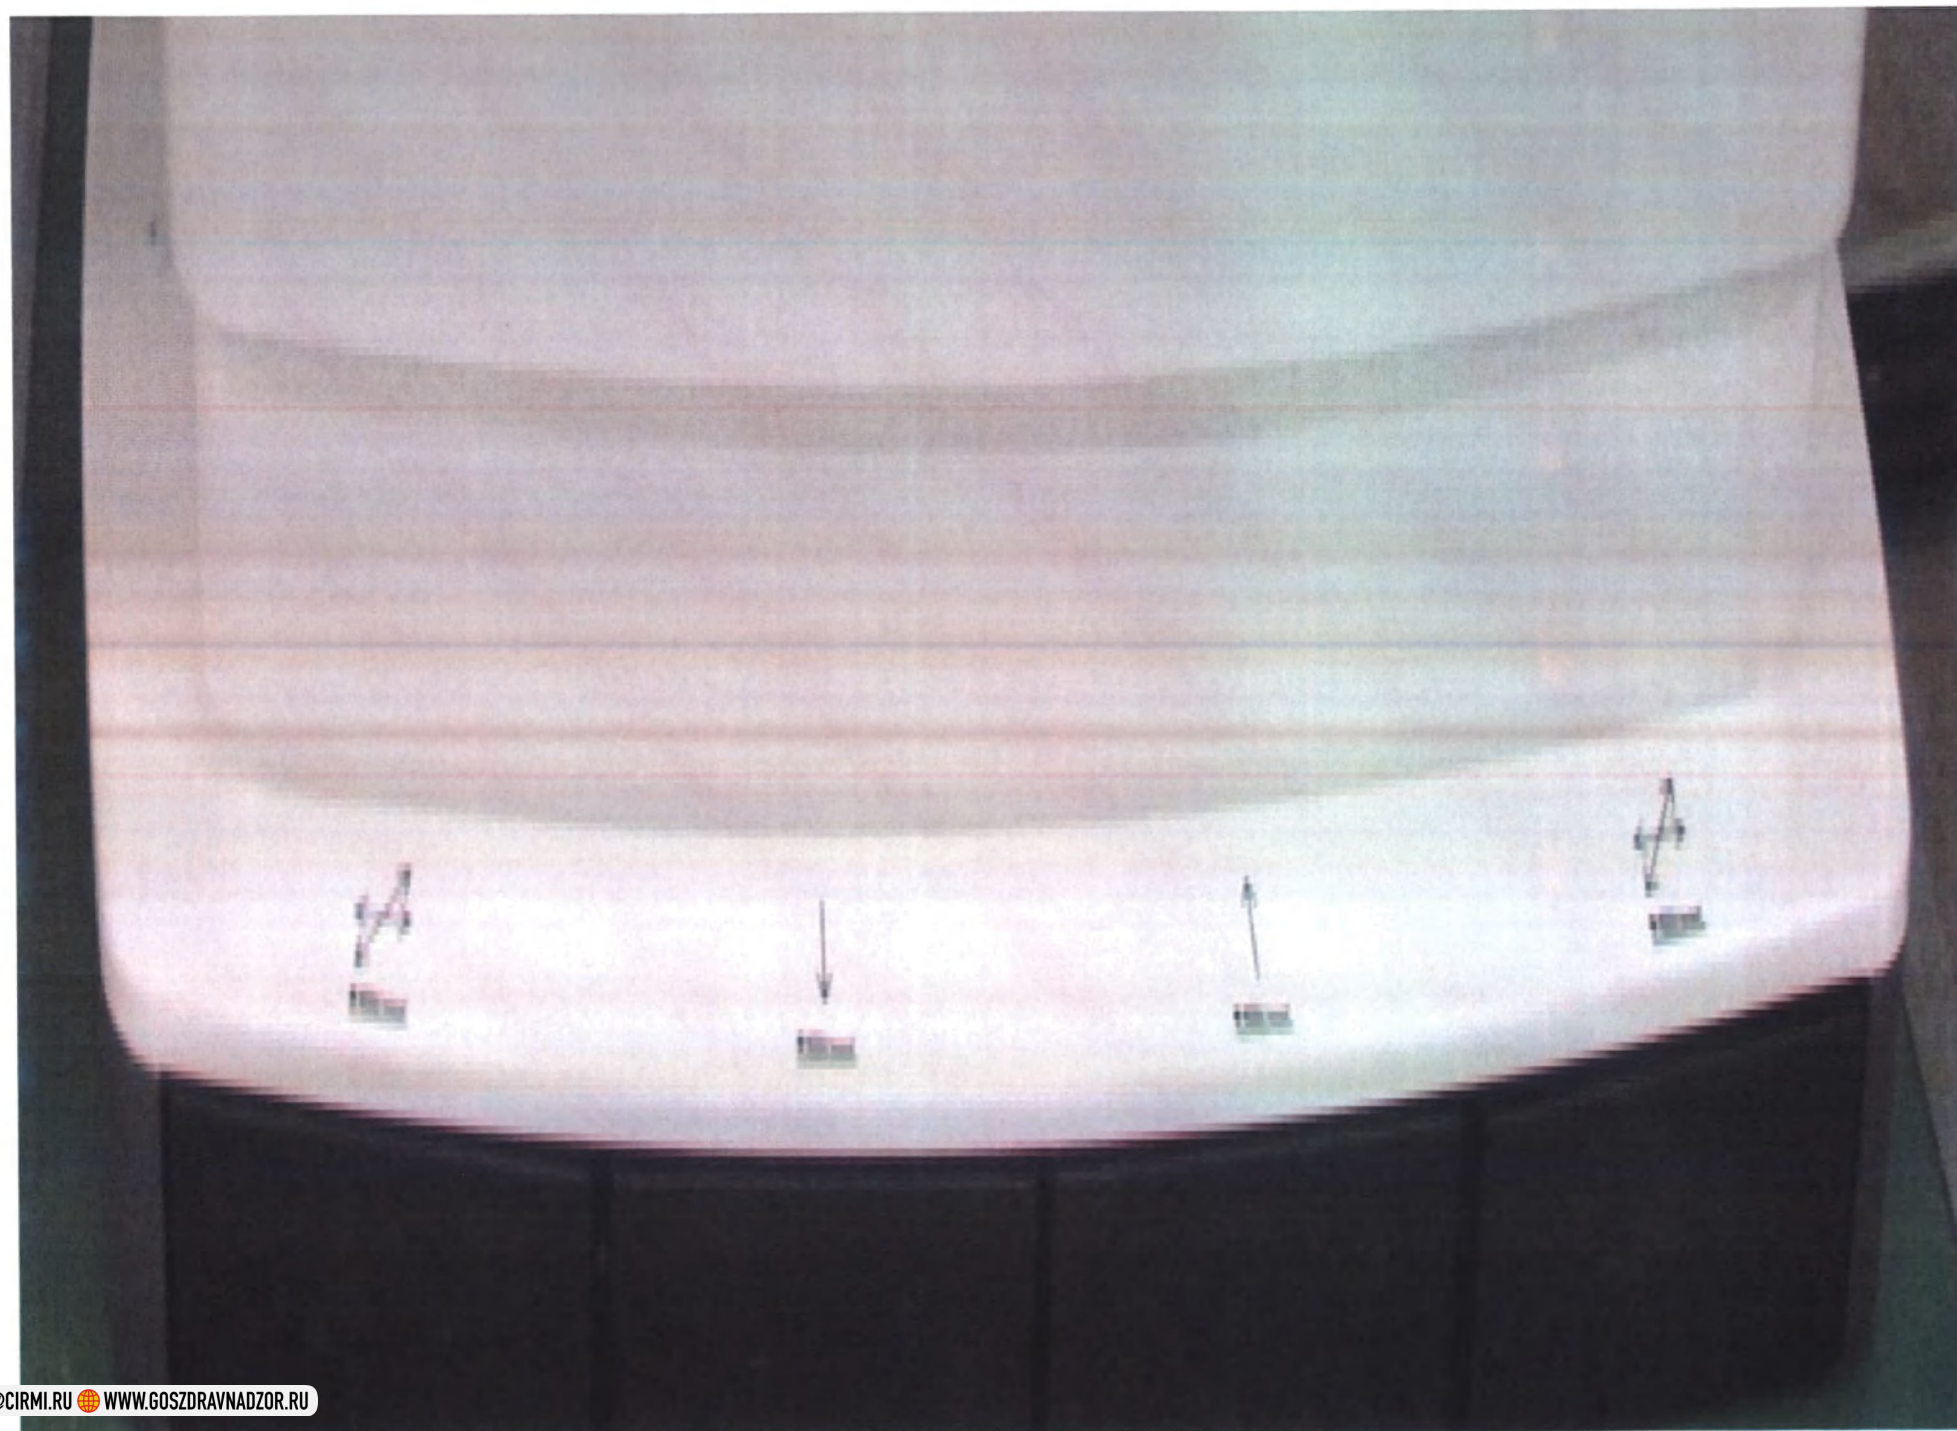

Принадлежности: Зарядное устройство для батарей.

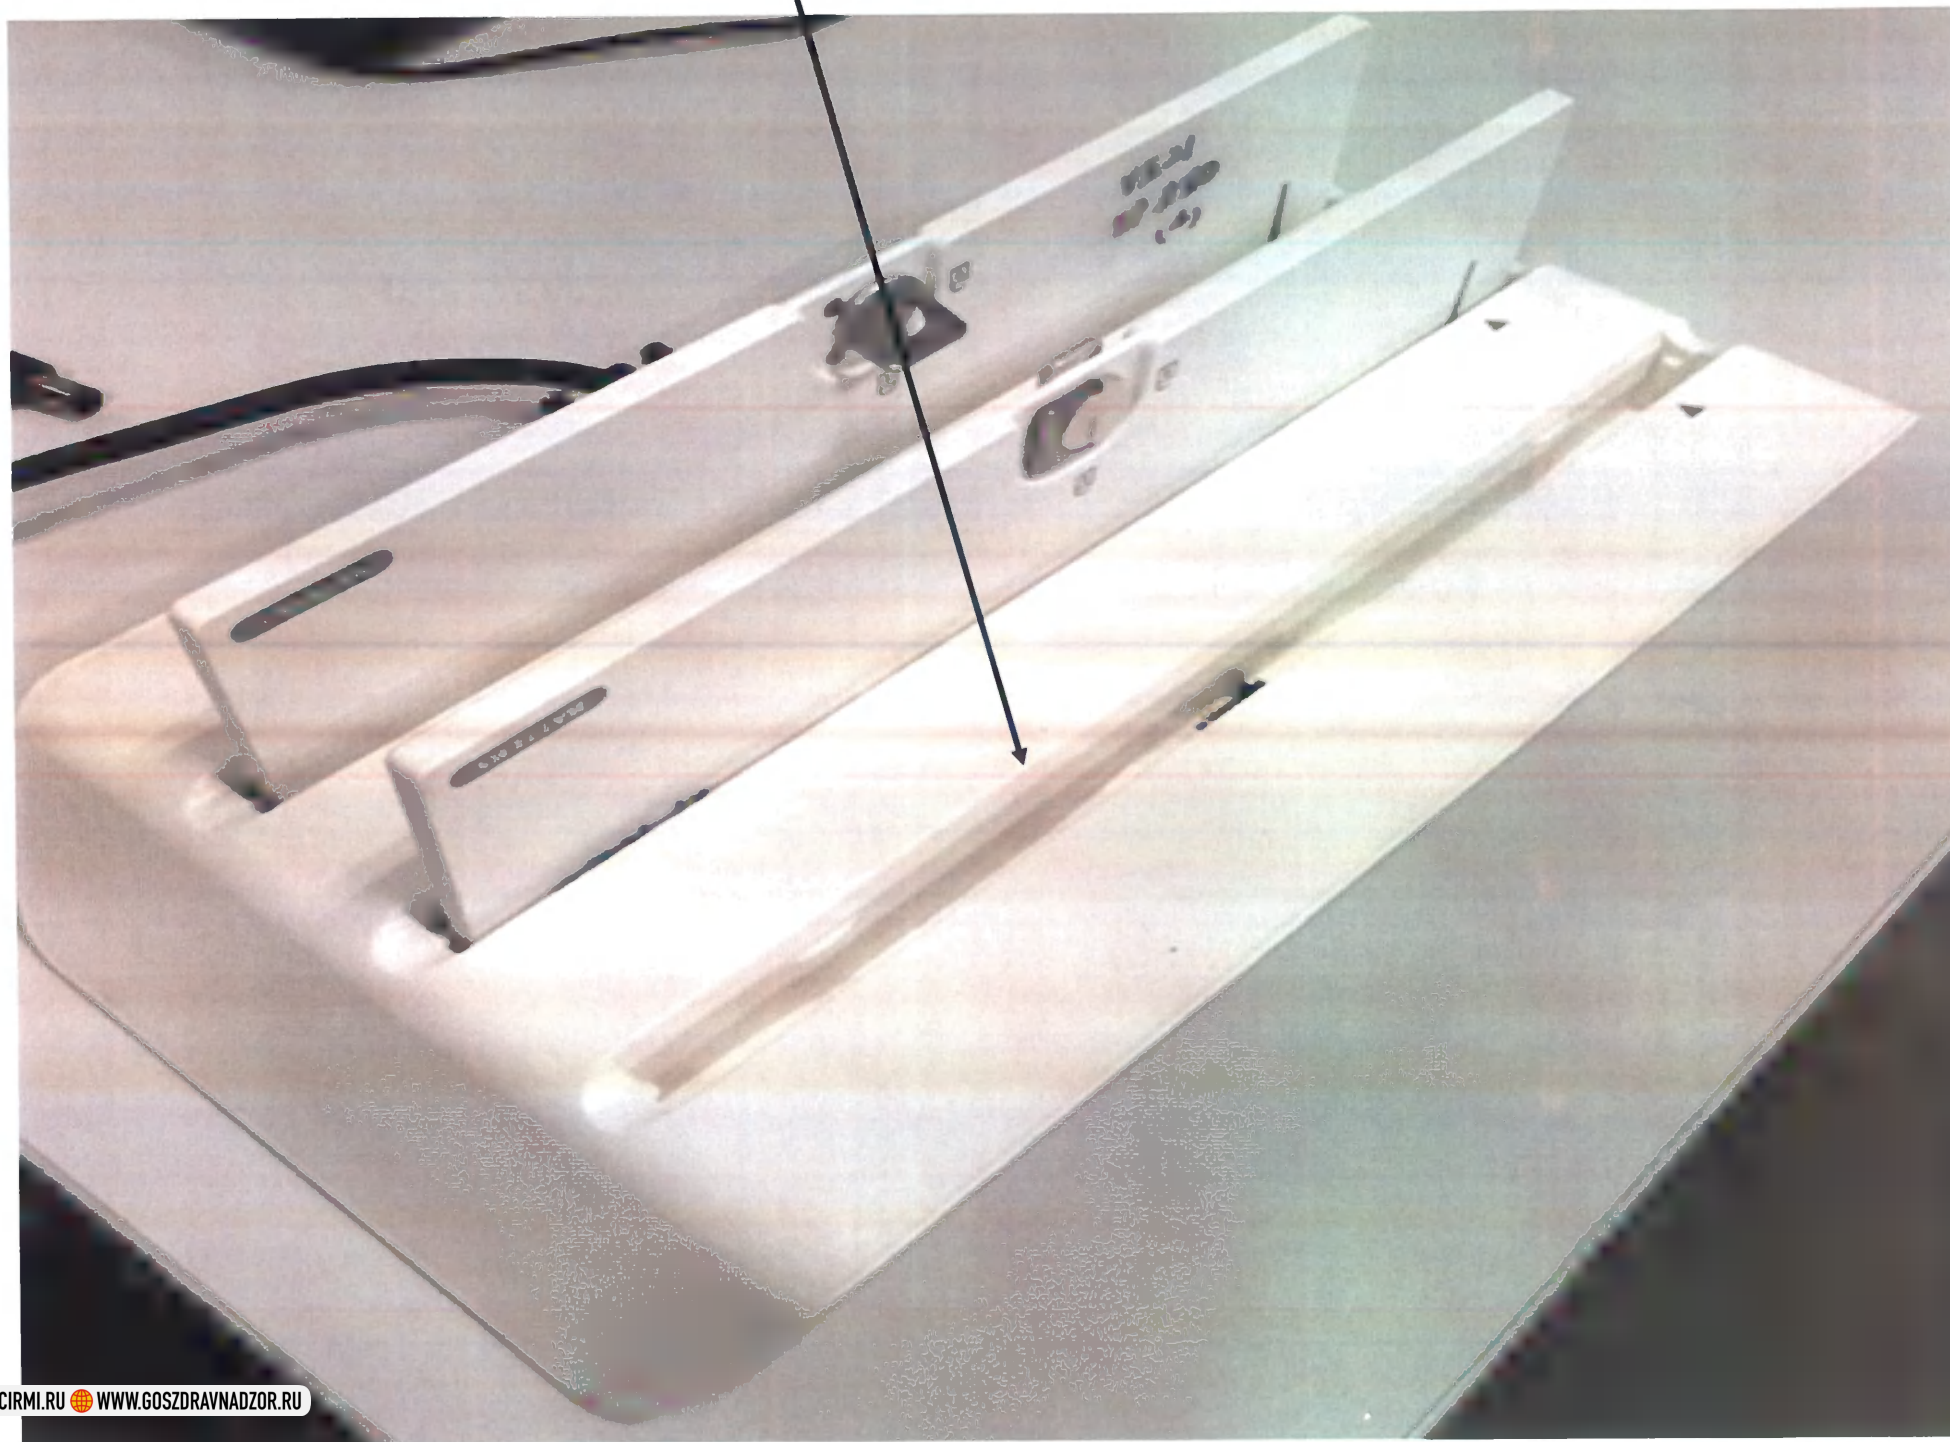

Принадлежности: Аккумулятор для детекторов дополнительный .

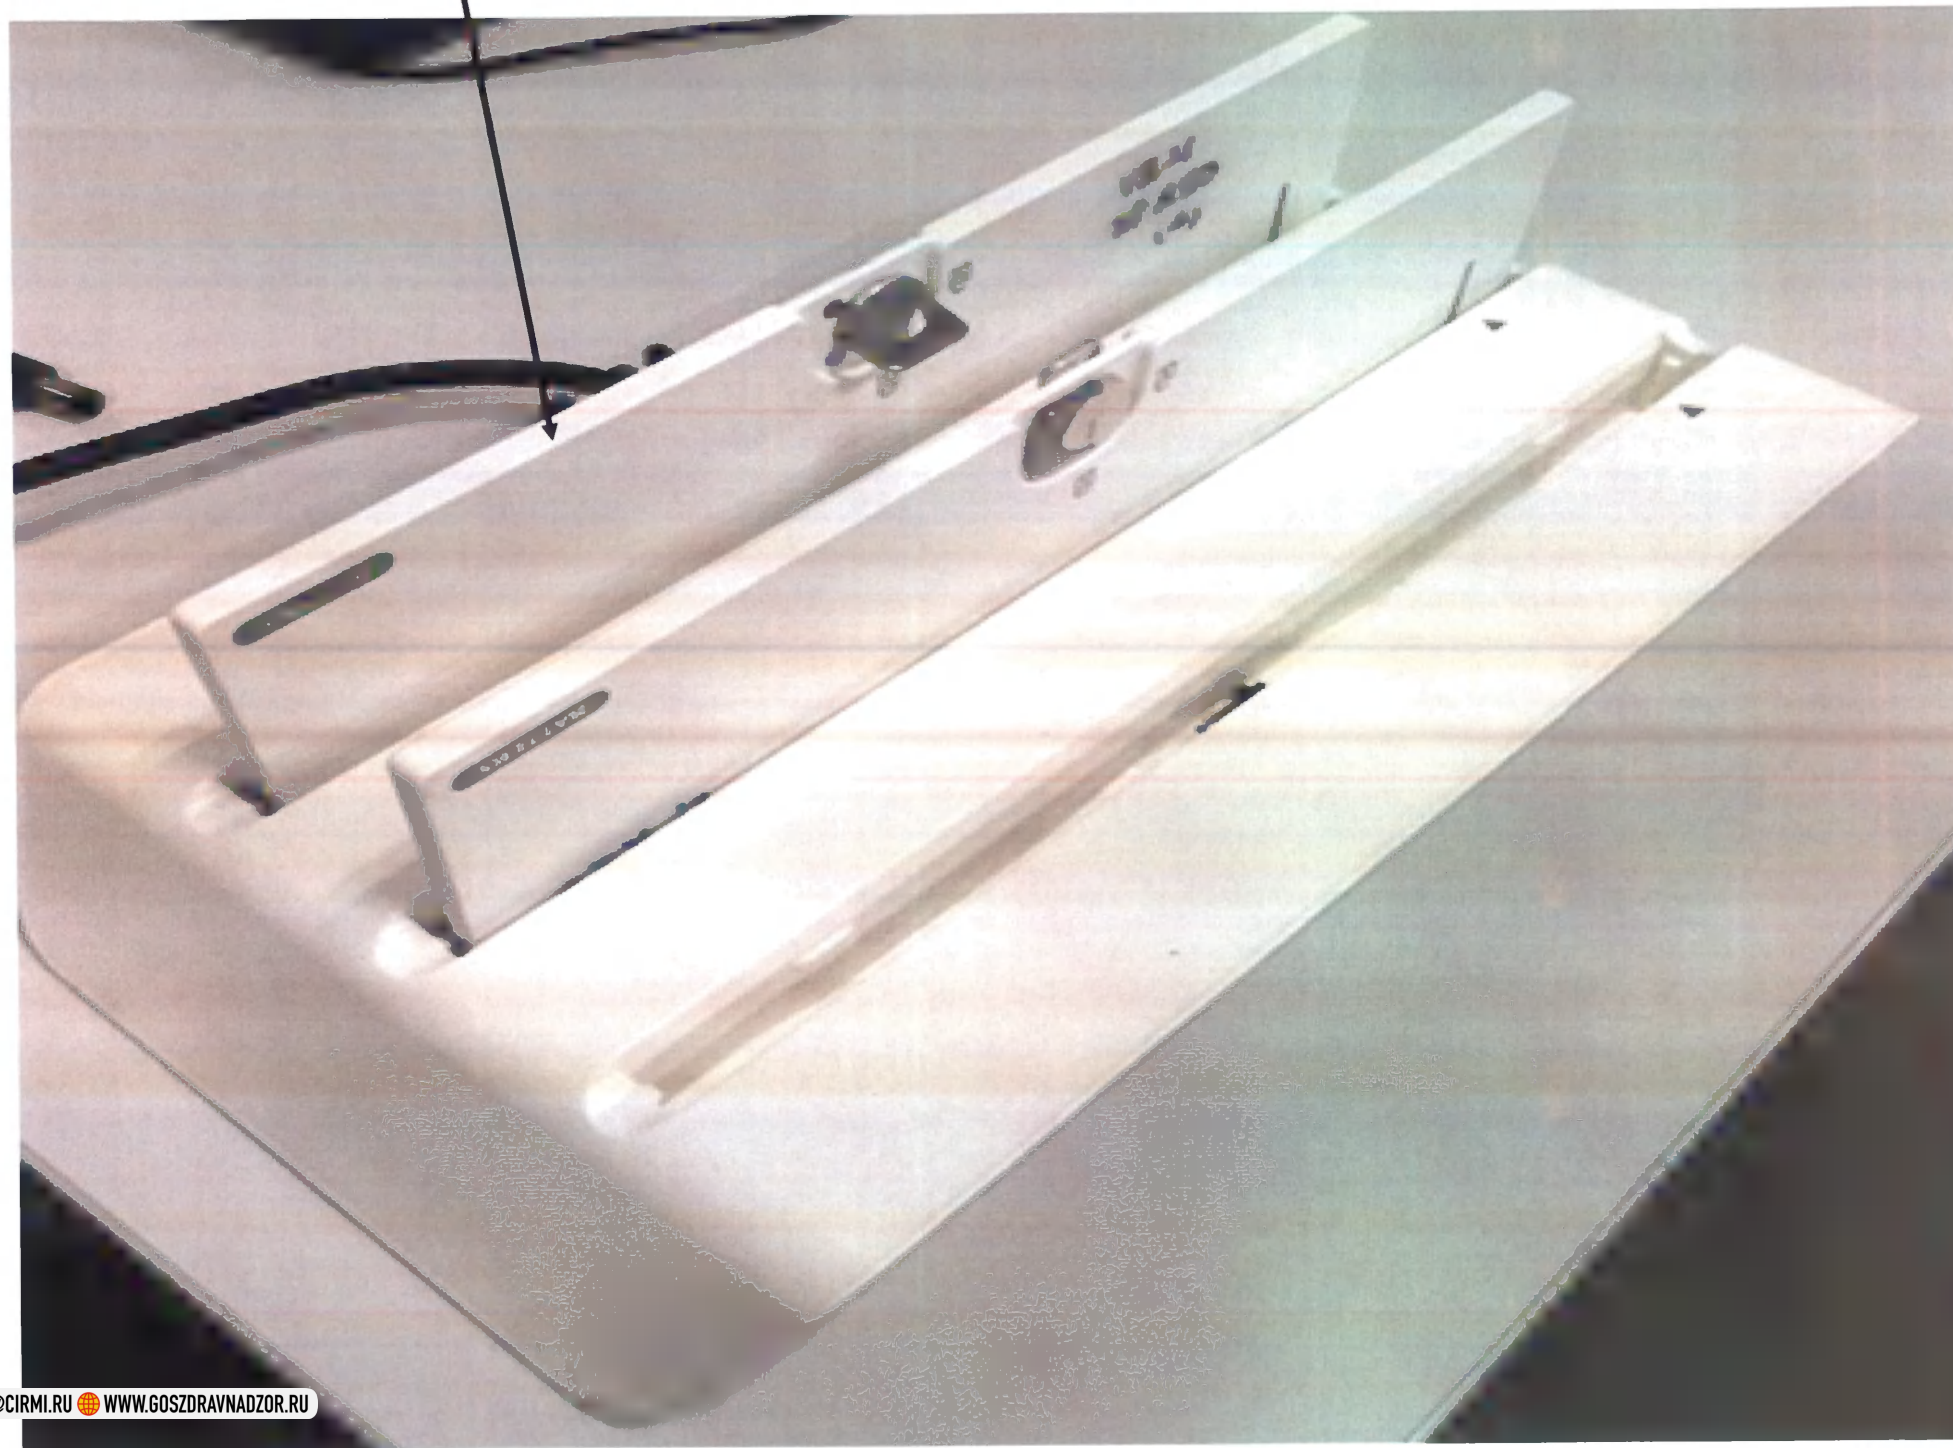

Принадлежности: Точка доступа беспроводного соединения WLAN для детекторов.




Принадлежности: Монитор .




Принадлежности: Монитор высокой яркости .



Принадлежности: Пульт дистанционного управления .

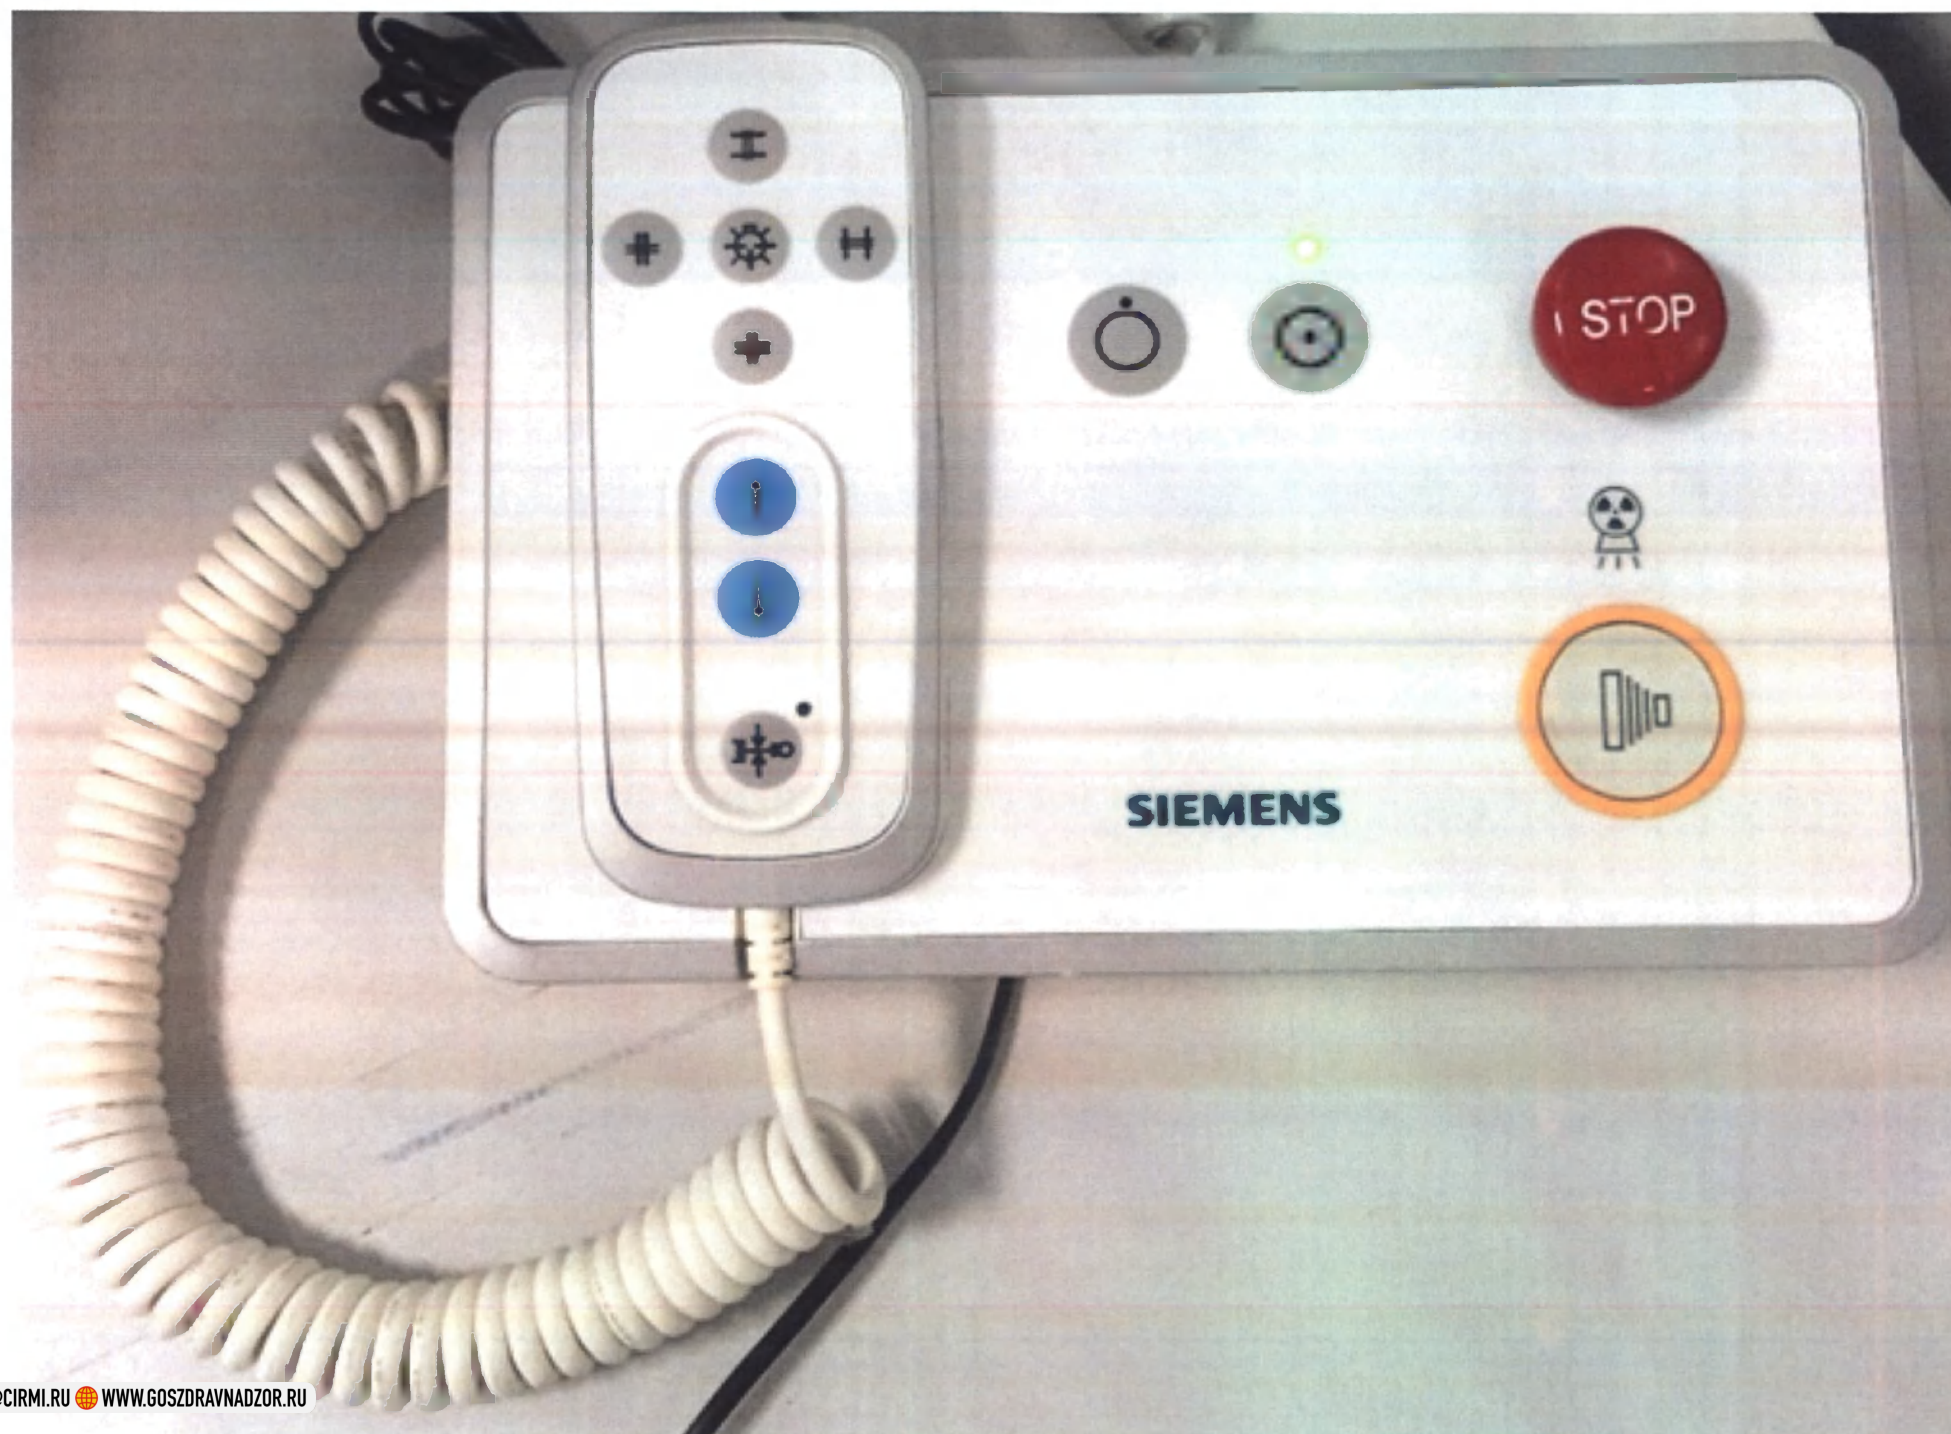

Принадлежности: Табло сигнальное.

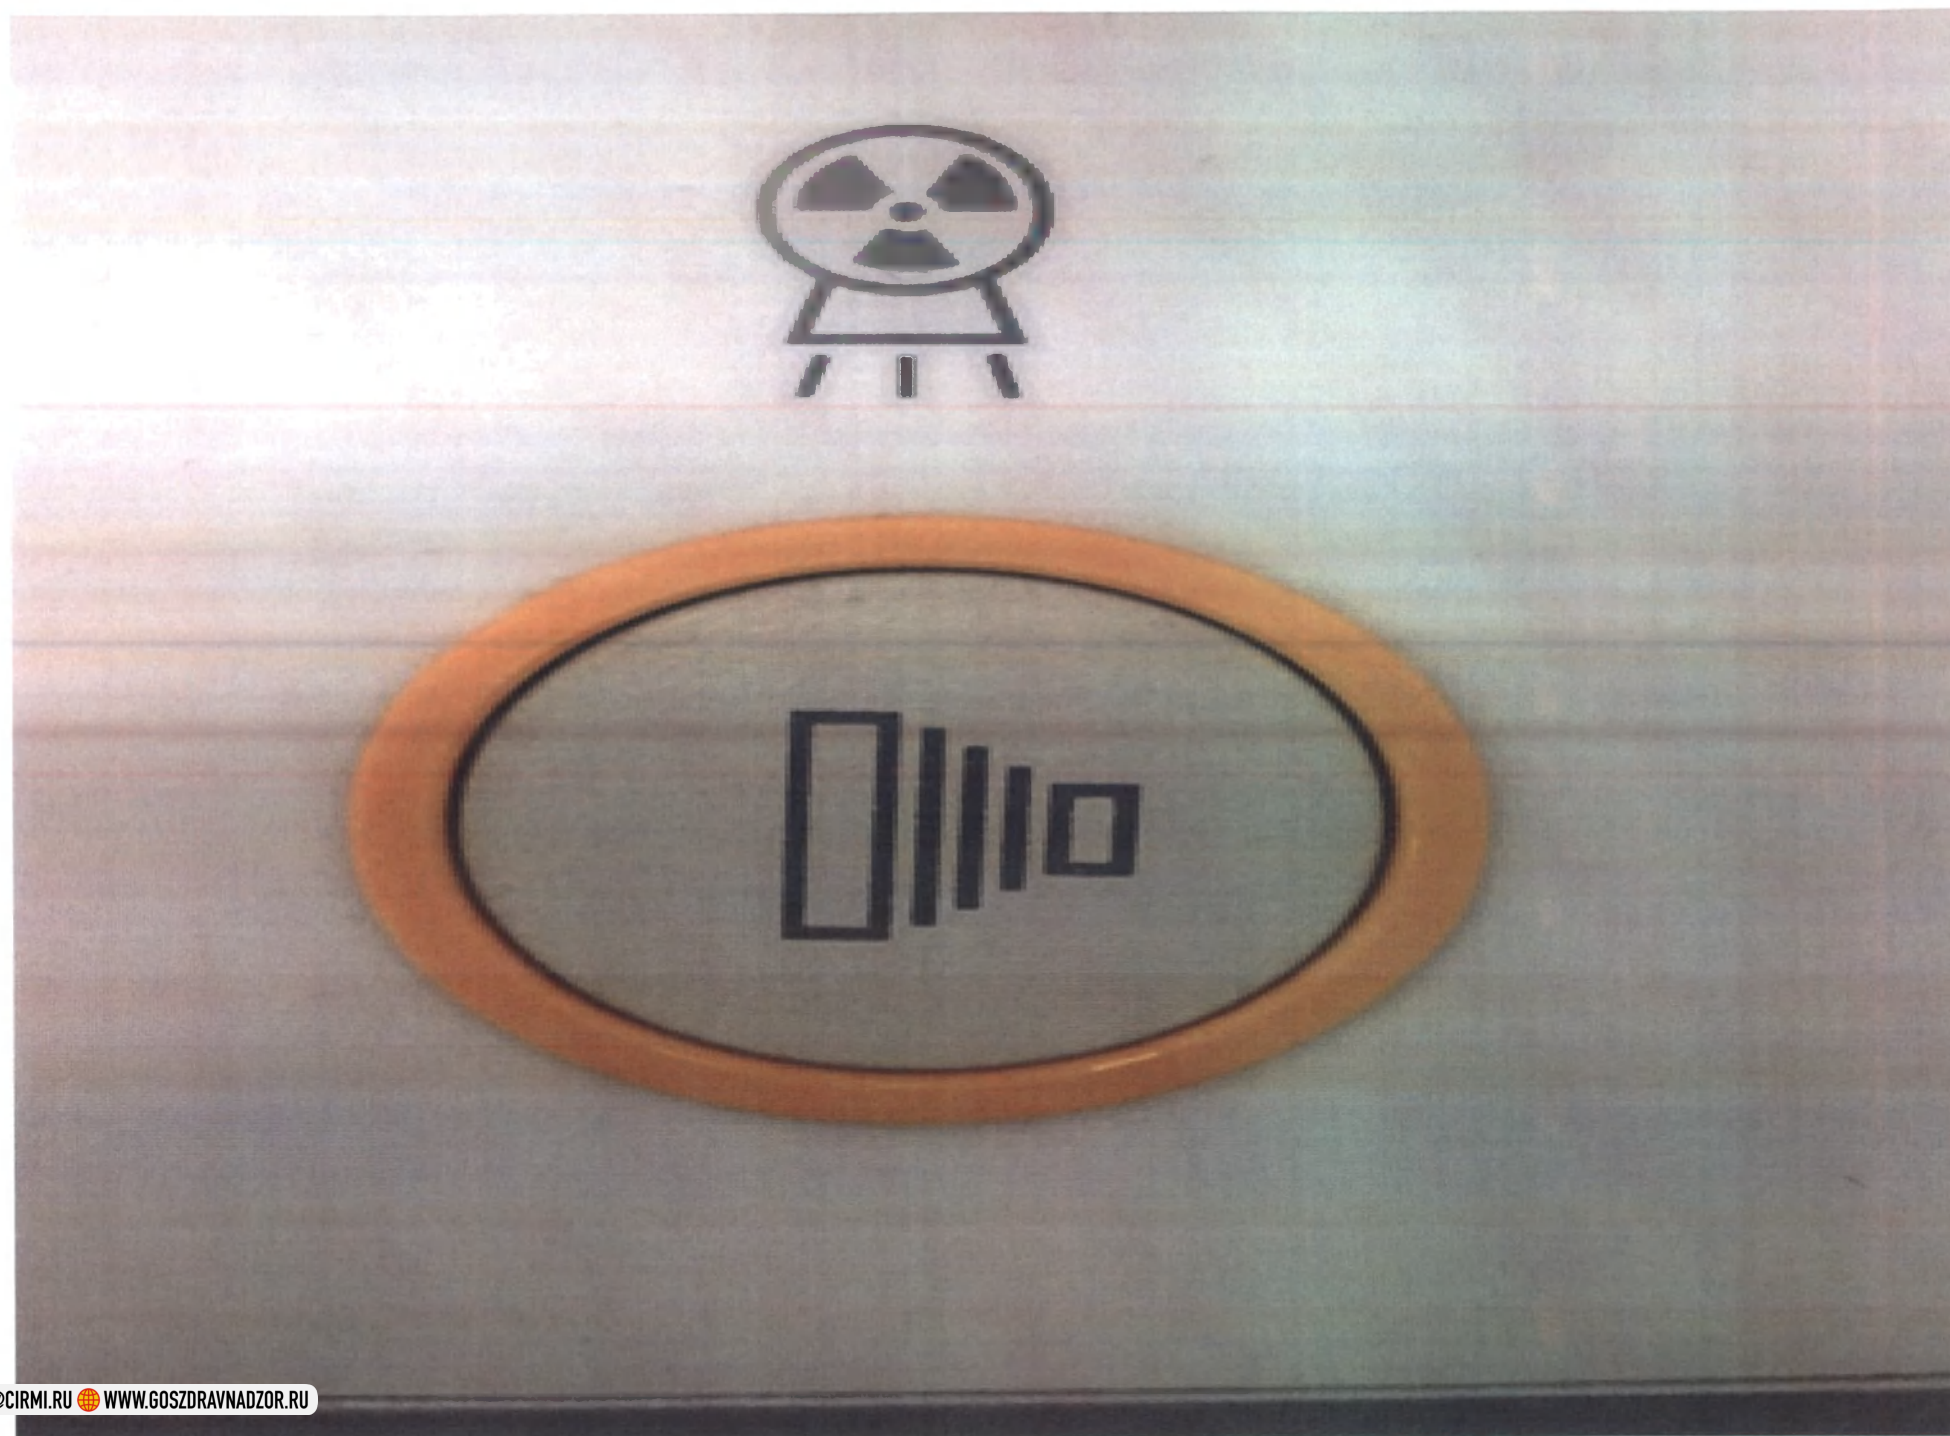

Принадлежности: Преобразователь напряжения.



Принадлежности: Источник бесперебойного питания.




Принадлежности: Интерфейс для подключения принтера .




Принадлежности: Принтер для печати изображений.



Принадлежности: Ремень компрессионный .

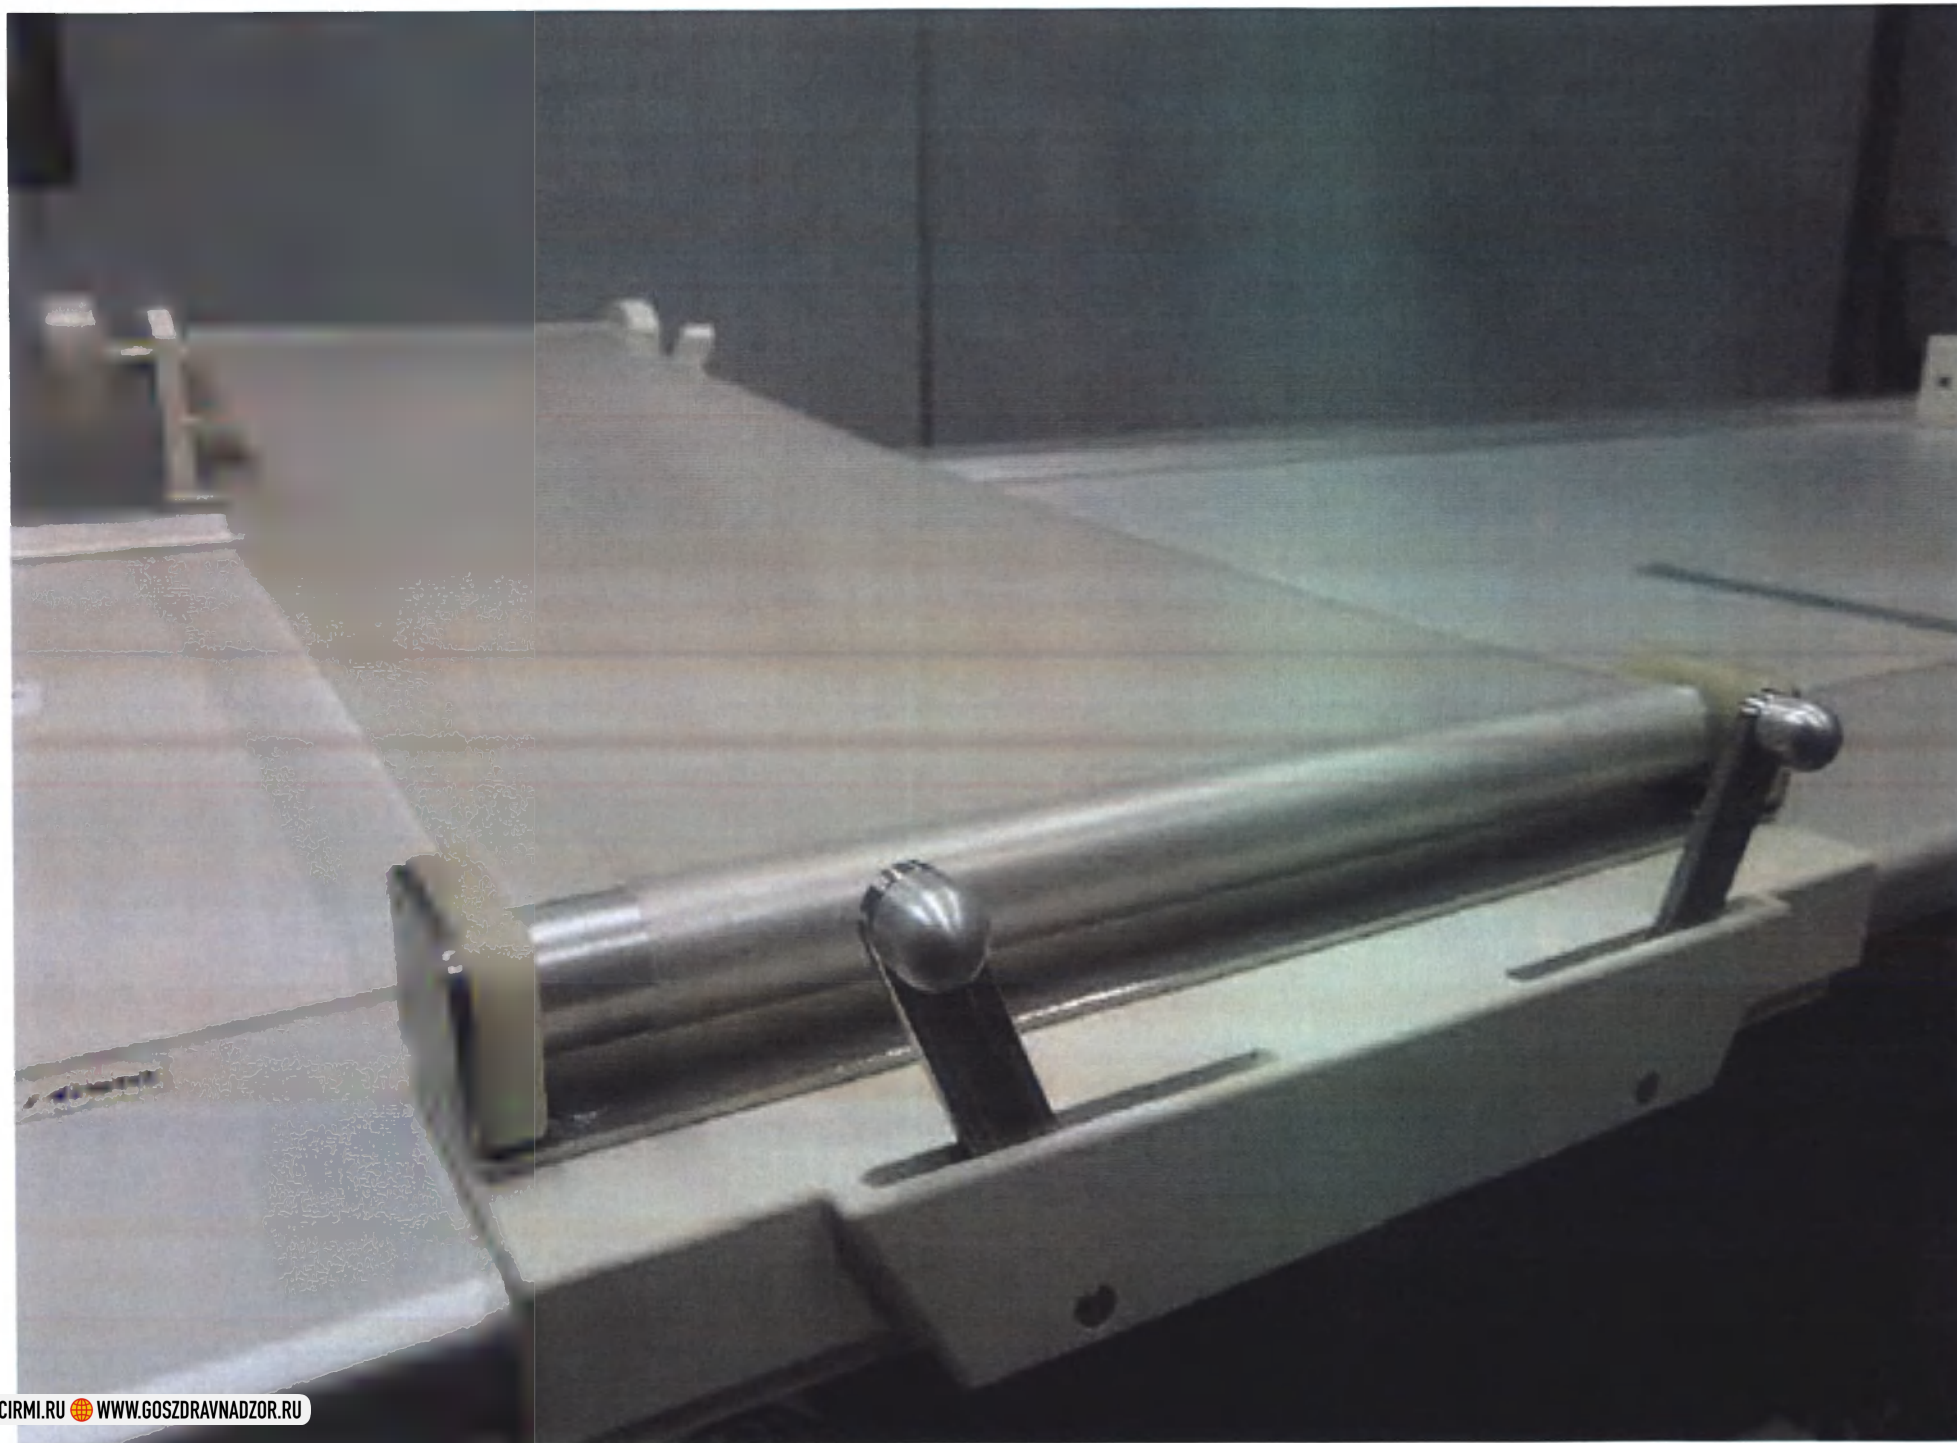

Принадлежности: Планка – поручень .

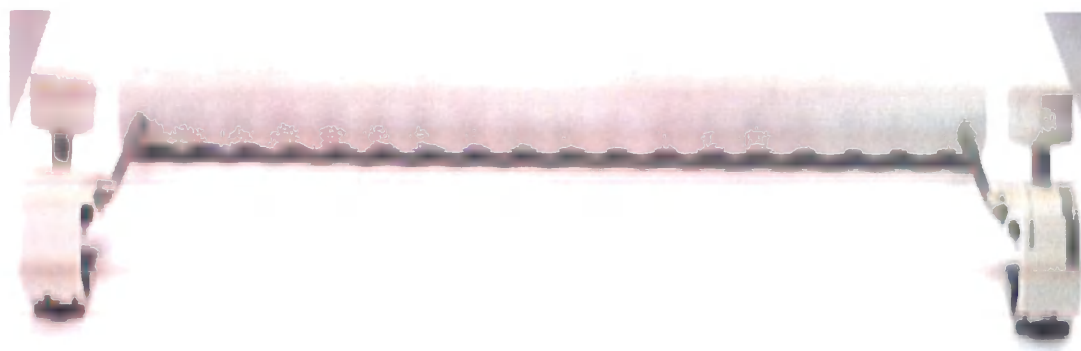

Принадлежности: Держатель для хранения VABIX для U-образной люльки .




Принадлежности: Держатель для хранения VABIX для плоской люльки .




Принадлежности: Держатель BABIX для стола .




Принадлежности: Держатель детской люльки .

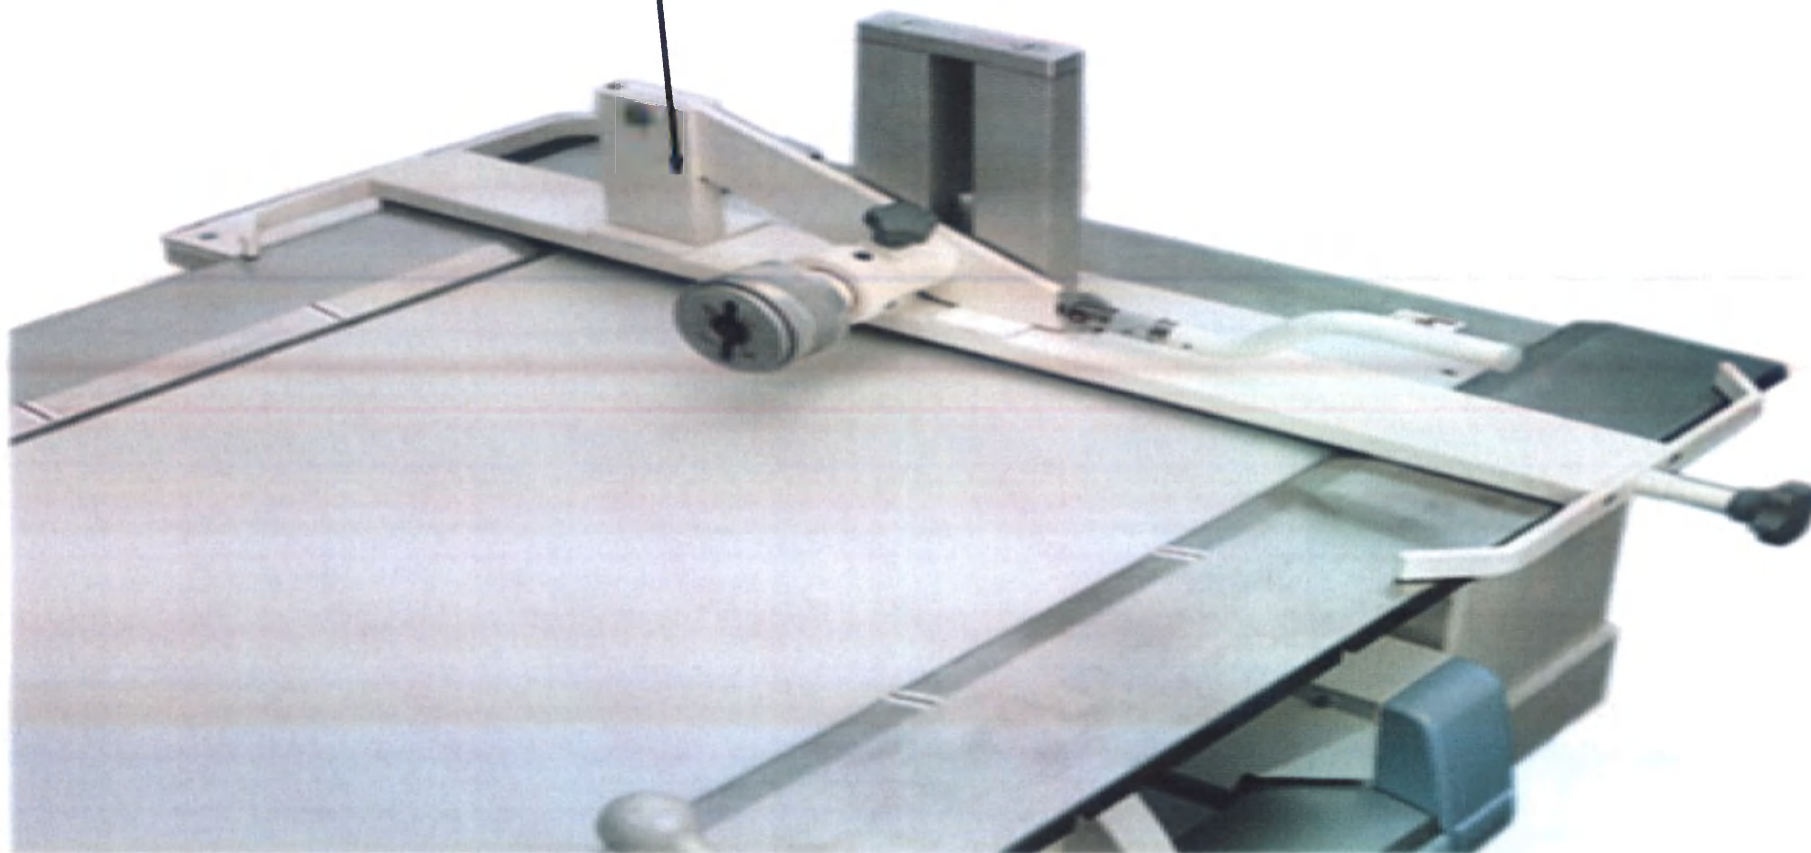


Принадлежности: Укладка для детей U-образная .

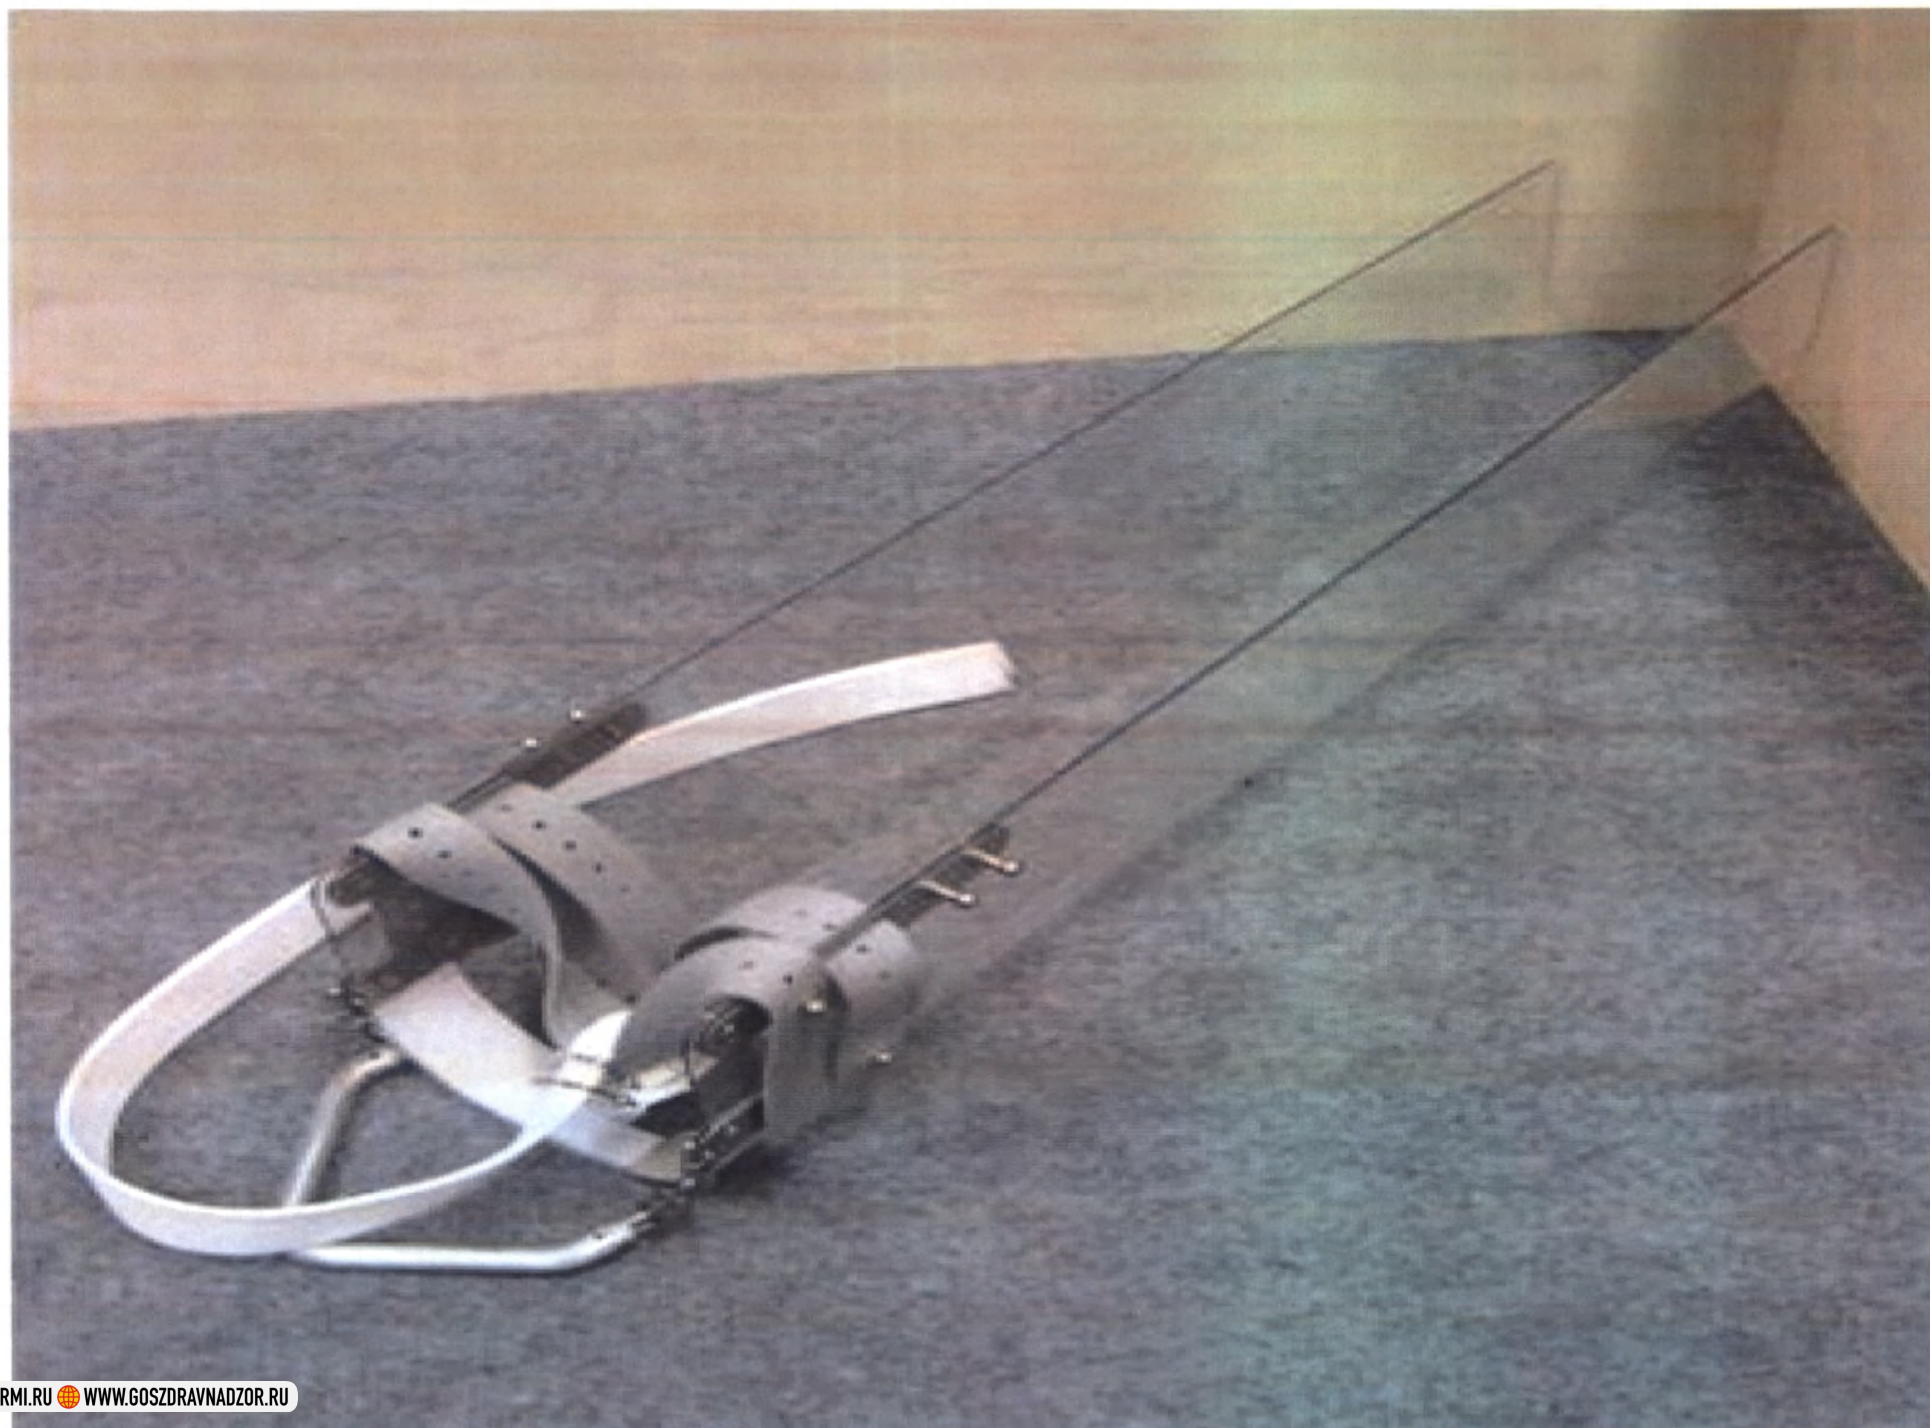


Принадлежности: Укладка для детей плоская .

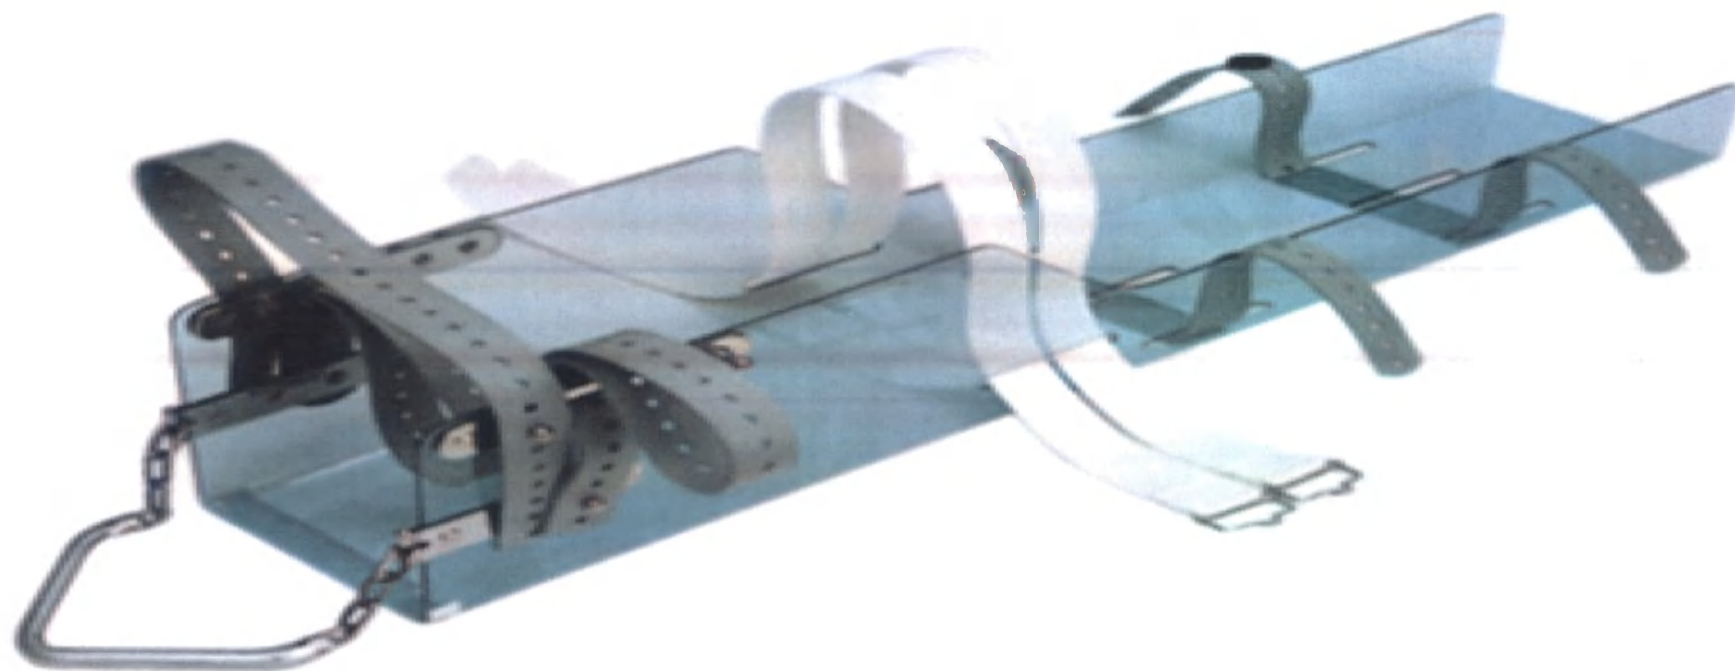


Принадлежности: Тележка для люльки BABIX.

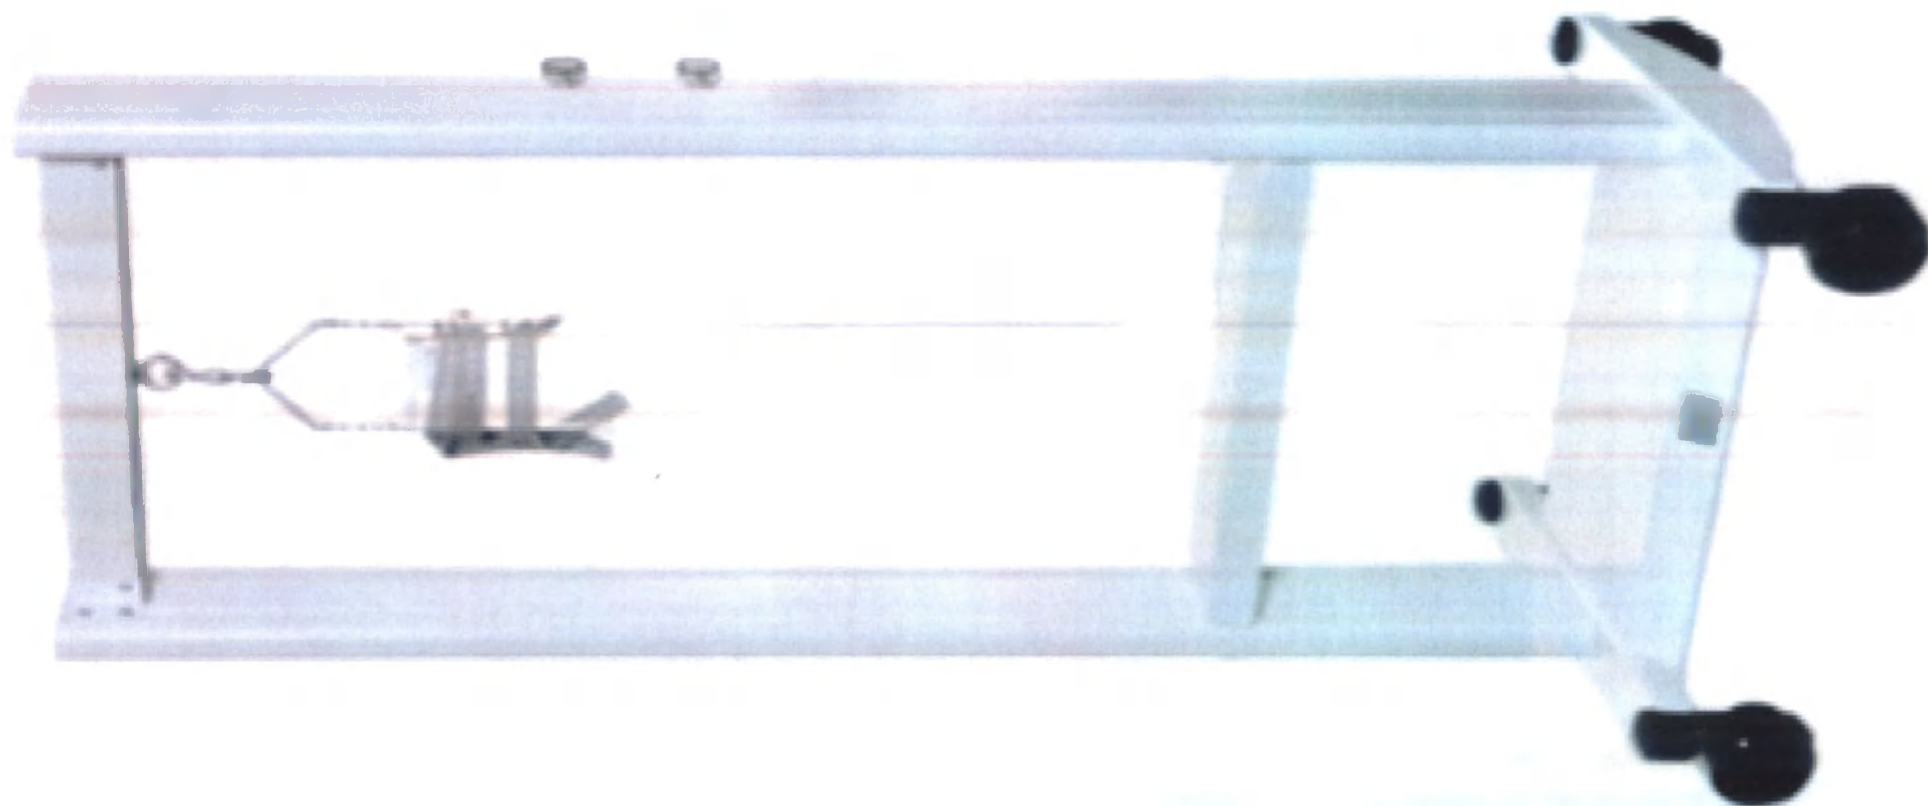


Принадлежности: Тележка для люльки BABIX с фиксатором .

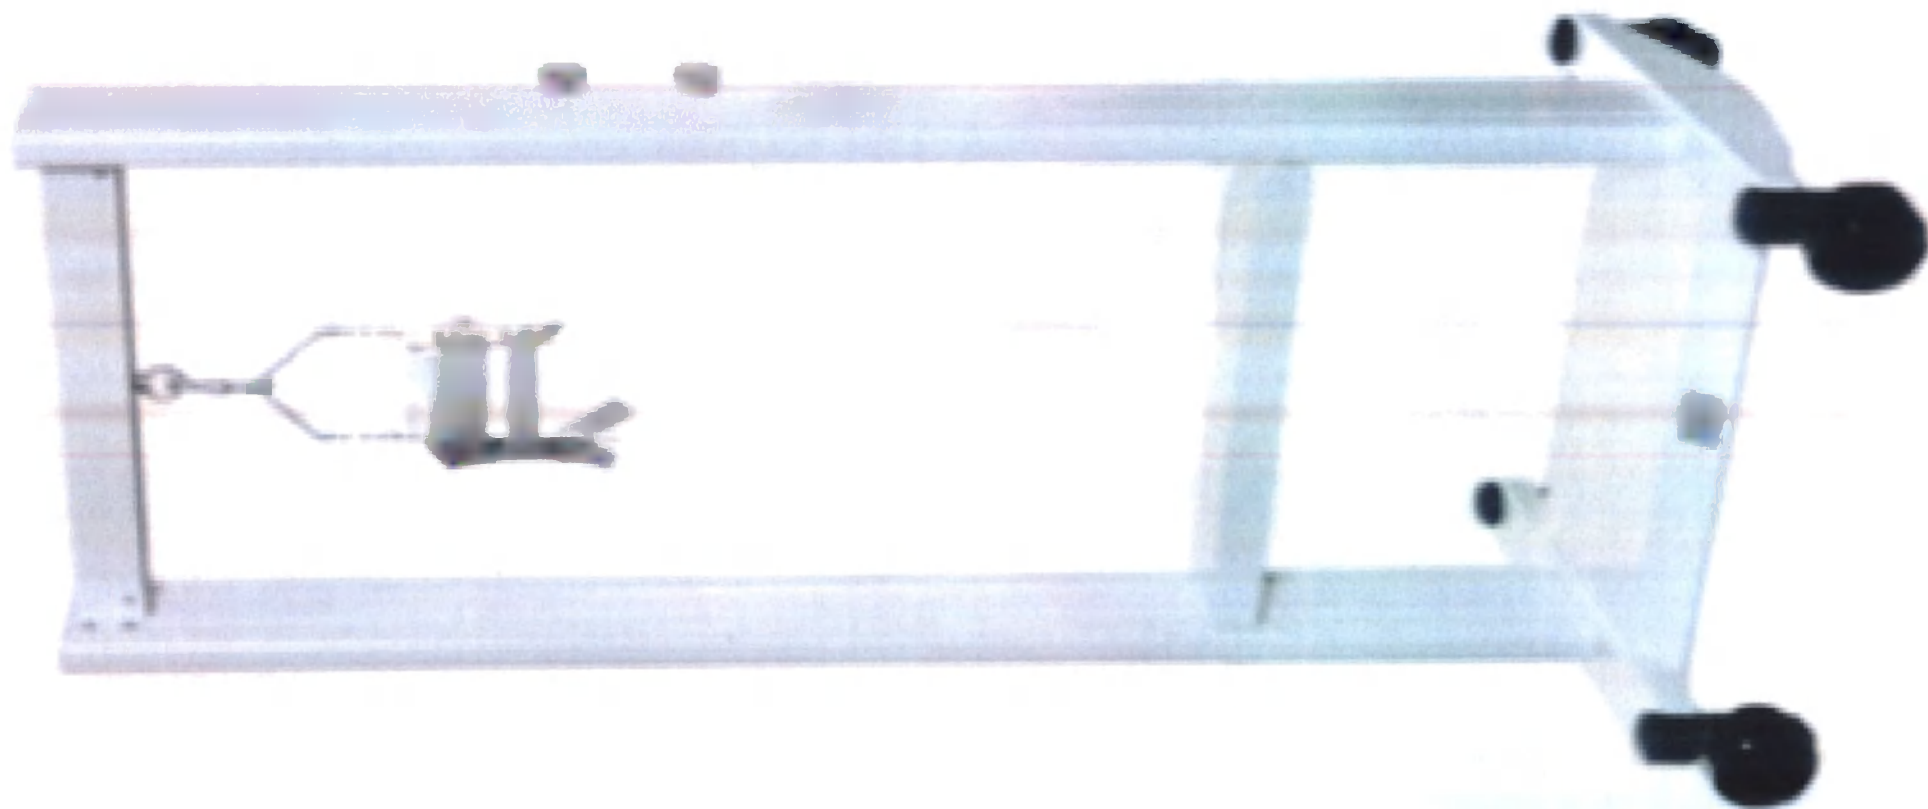


Принадлежности: Люльки с лентами – липучками .

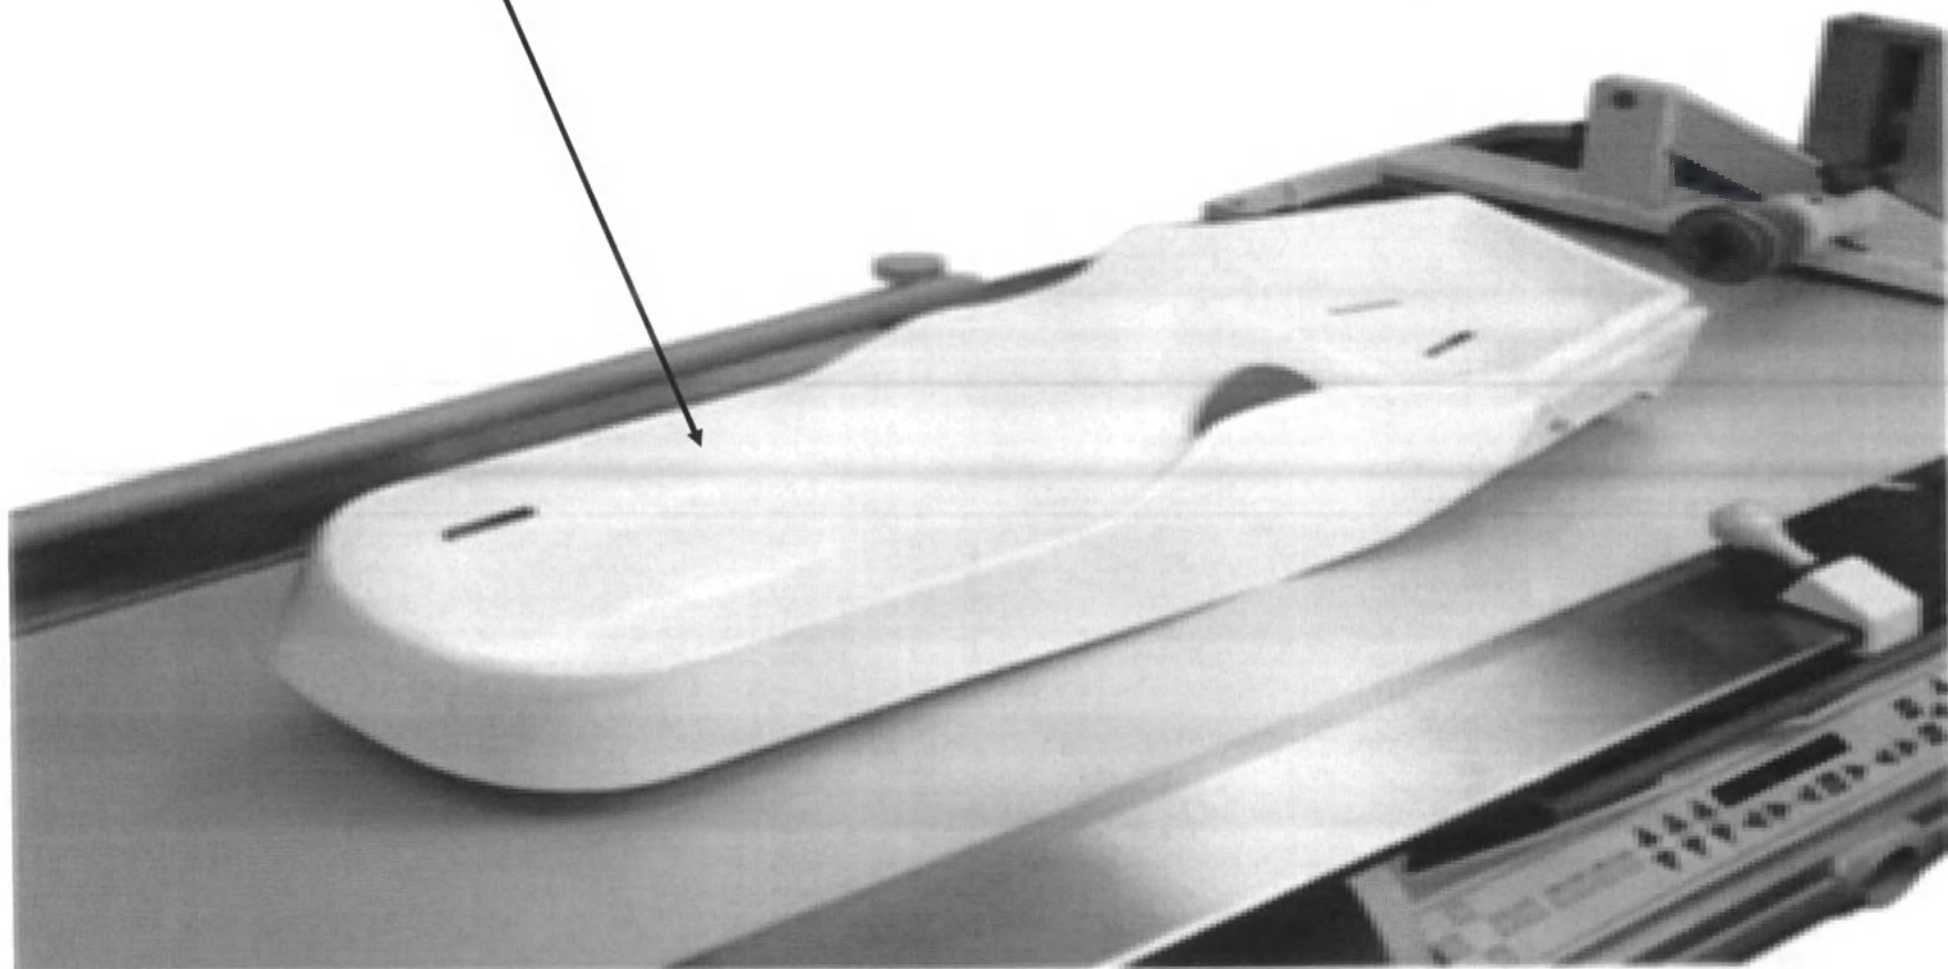


Принадлежности: Люльки с лентами – липучками .

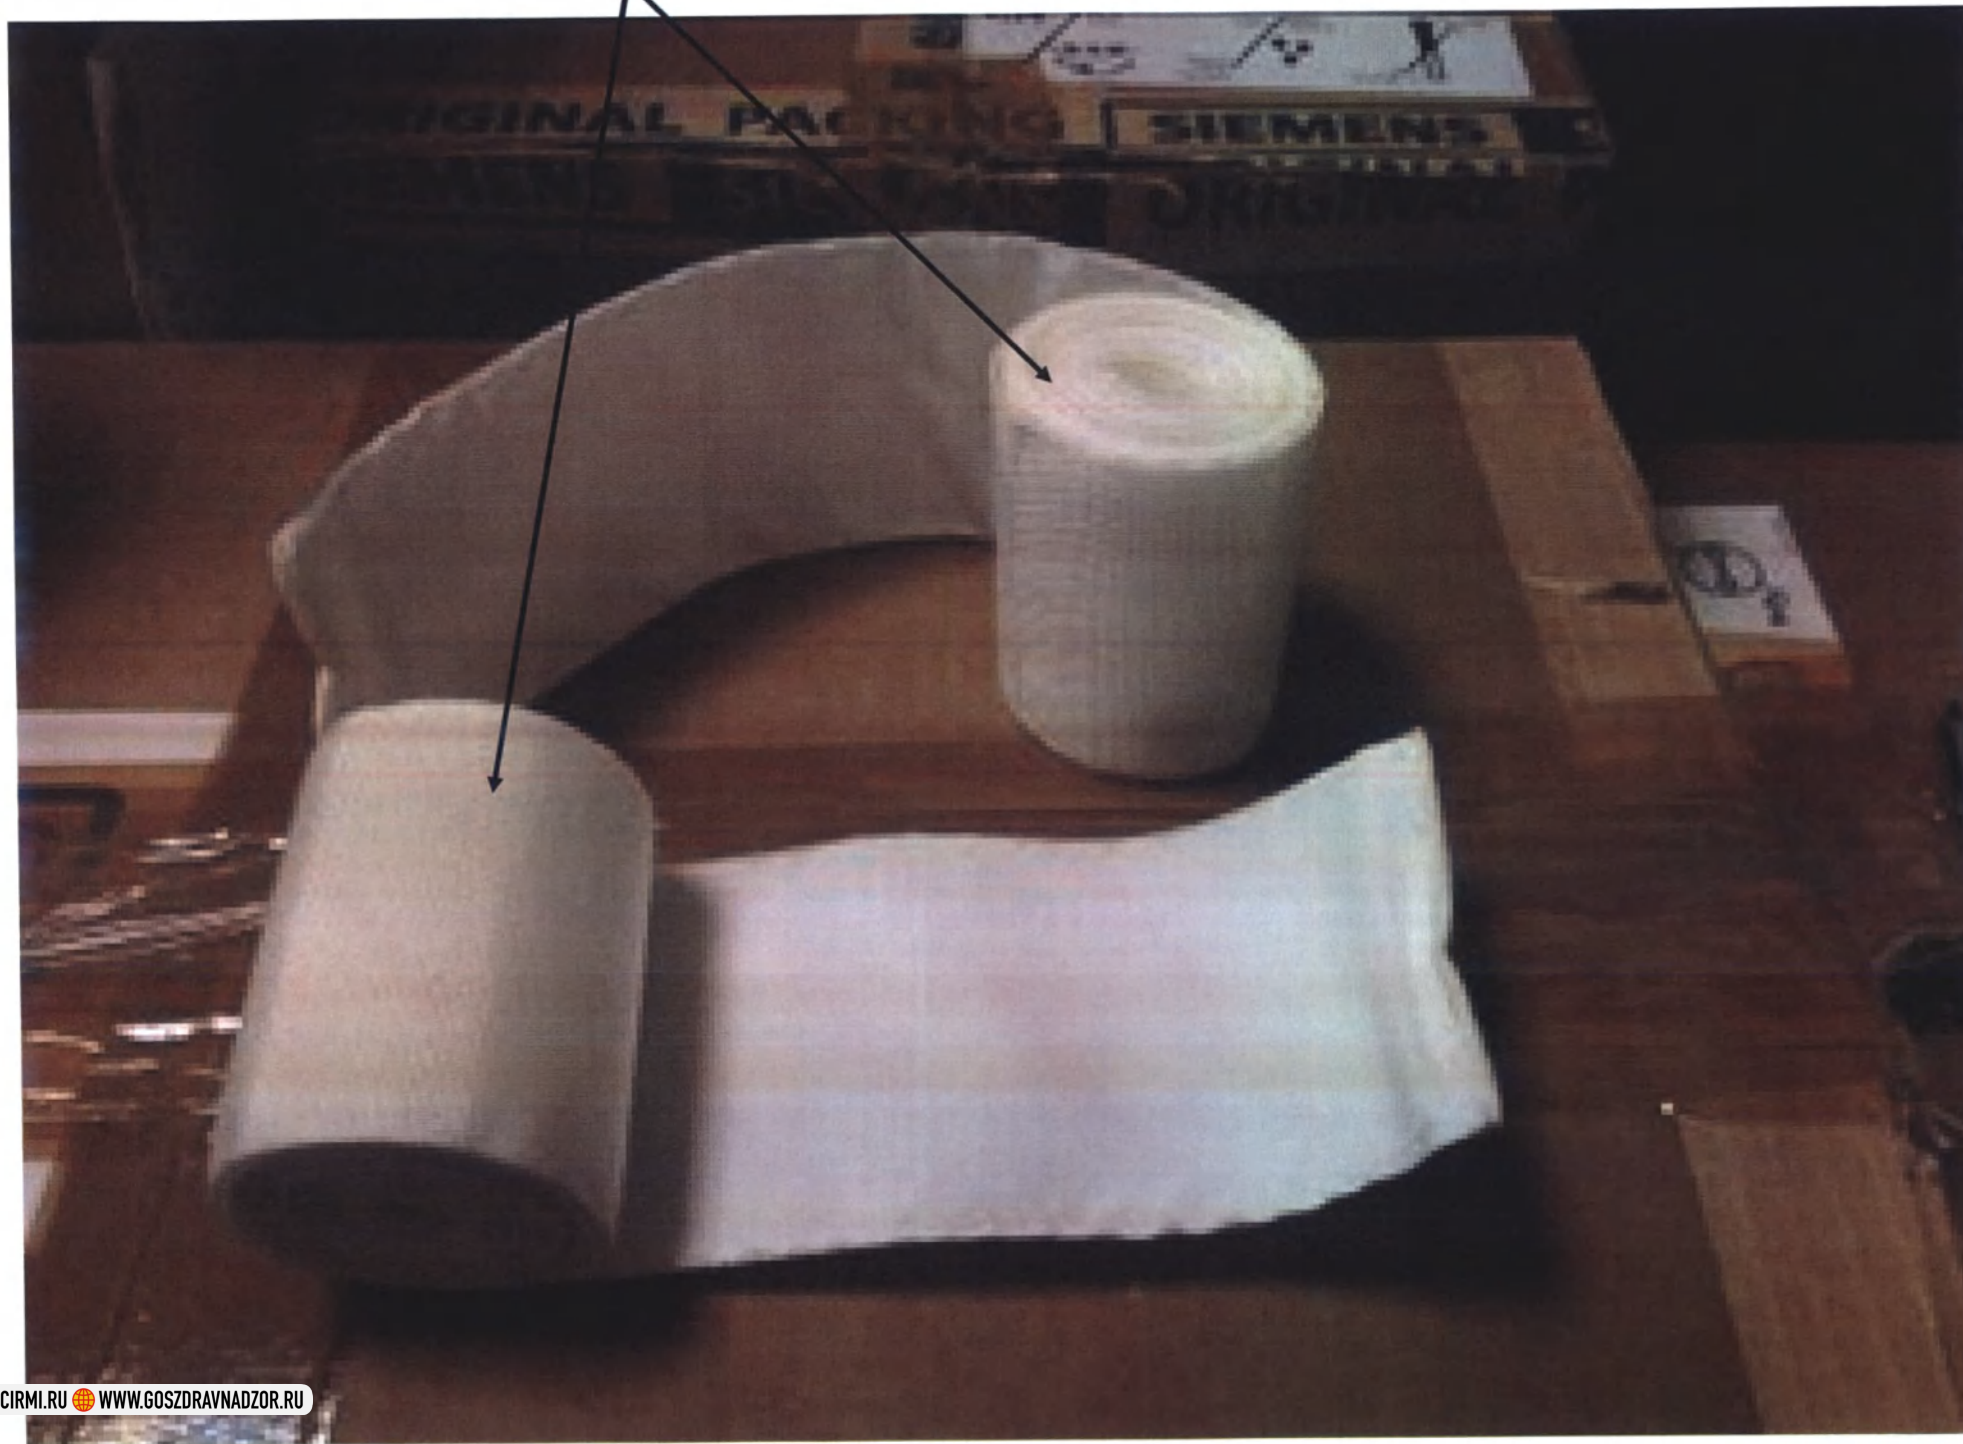

Принадлежности: Люльки.

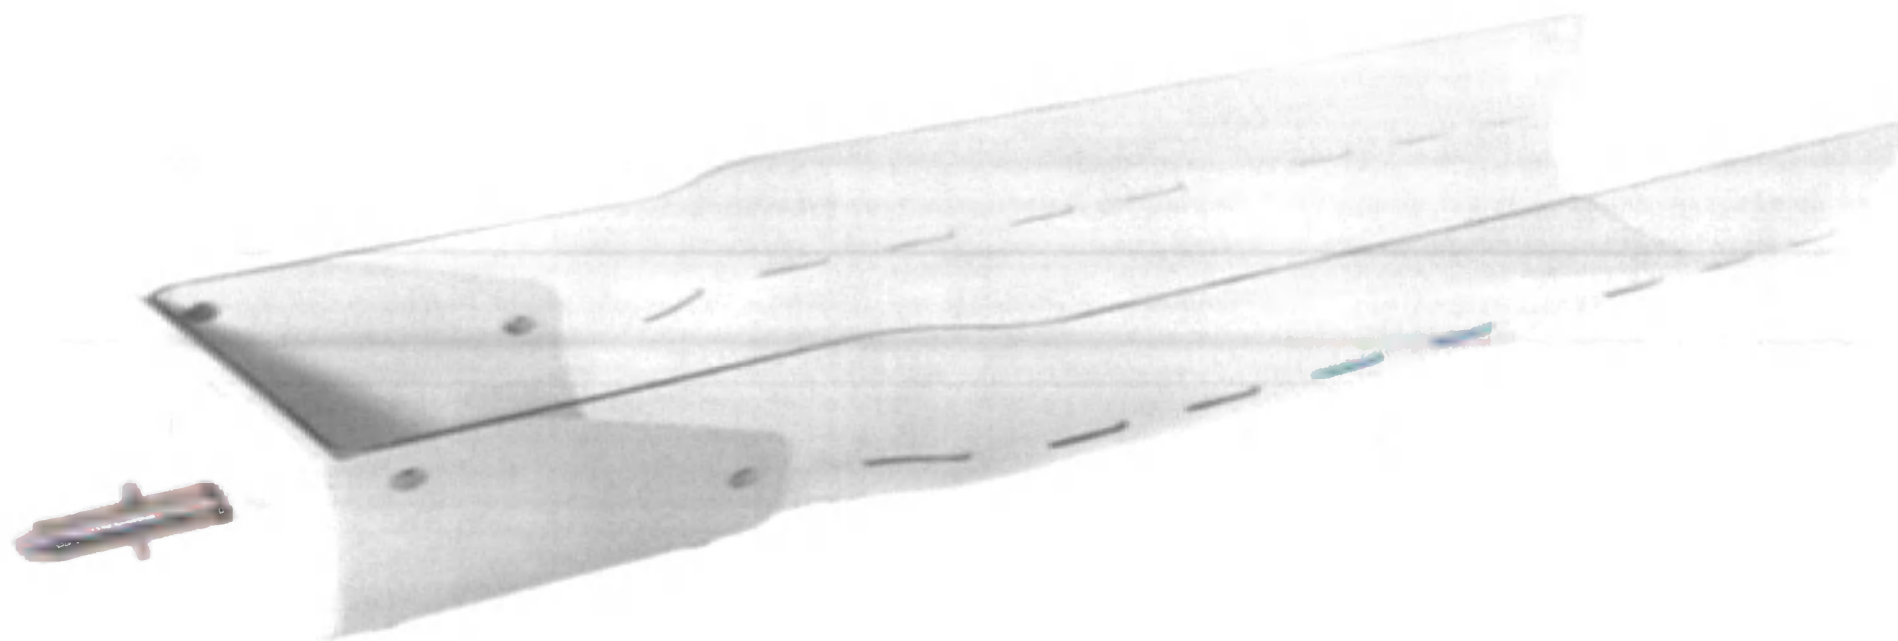

Принадлежности: Устройства для позиционирования .

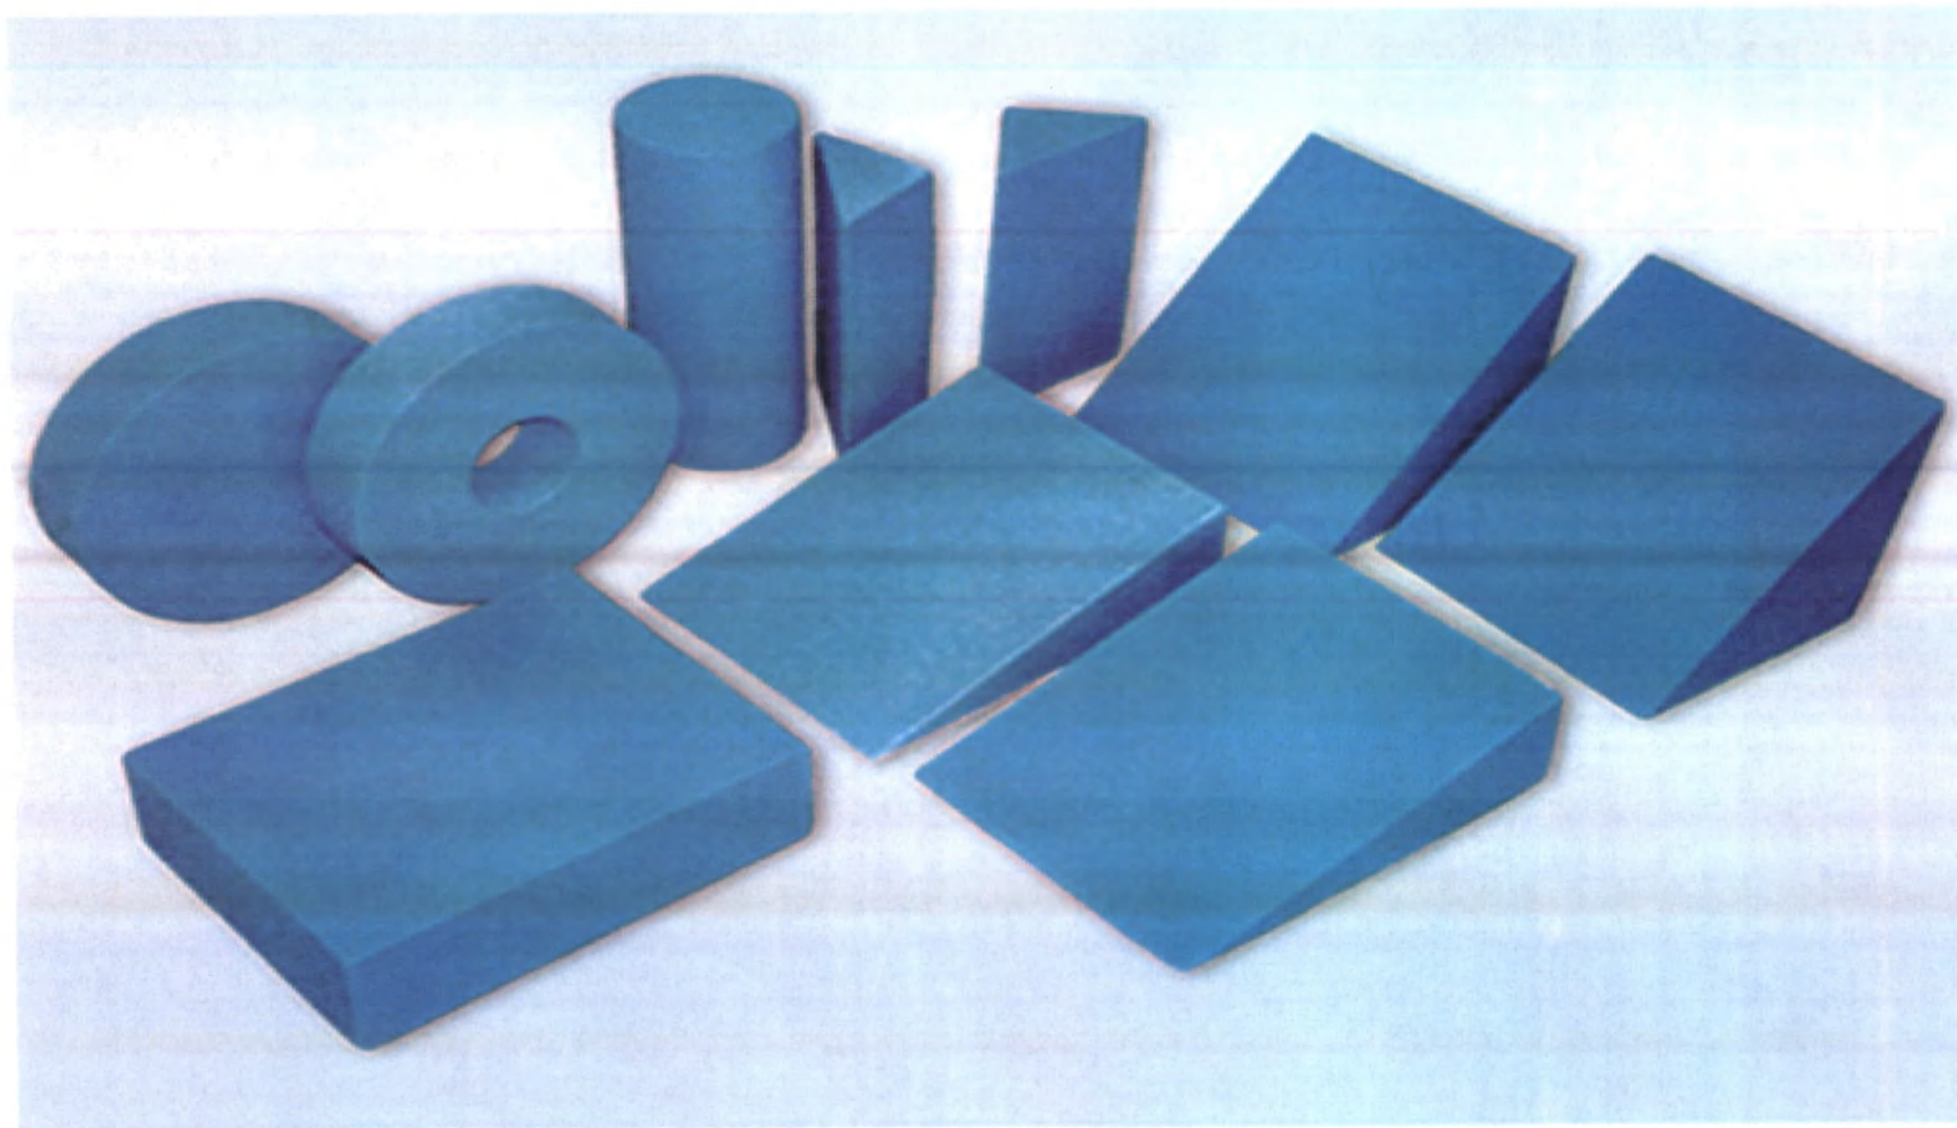


Принадлежности: Устройство переговорное (врач – пациент) .




Принадлежности: Педаль напольная для переговорного устройства .




Принадлежности: Фильтр компенсационный (таз) .

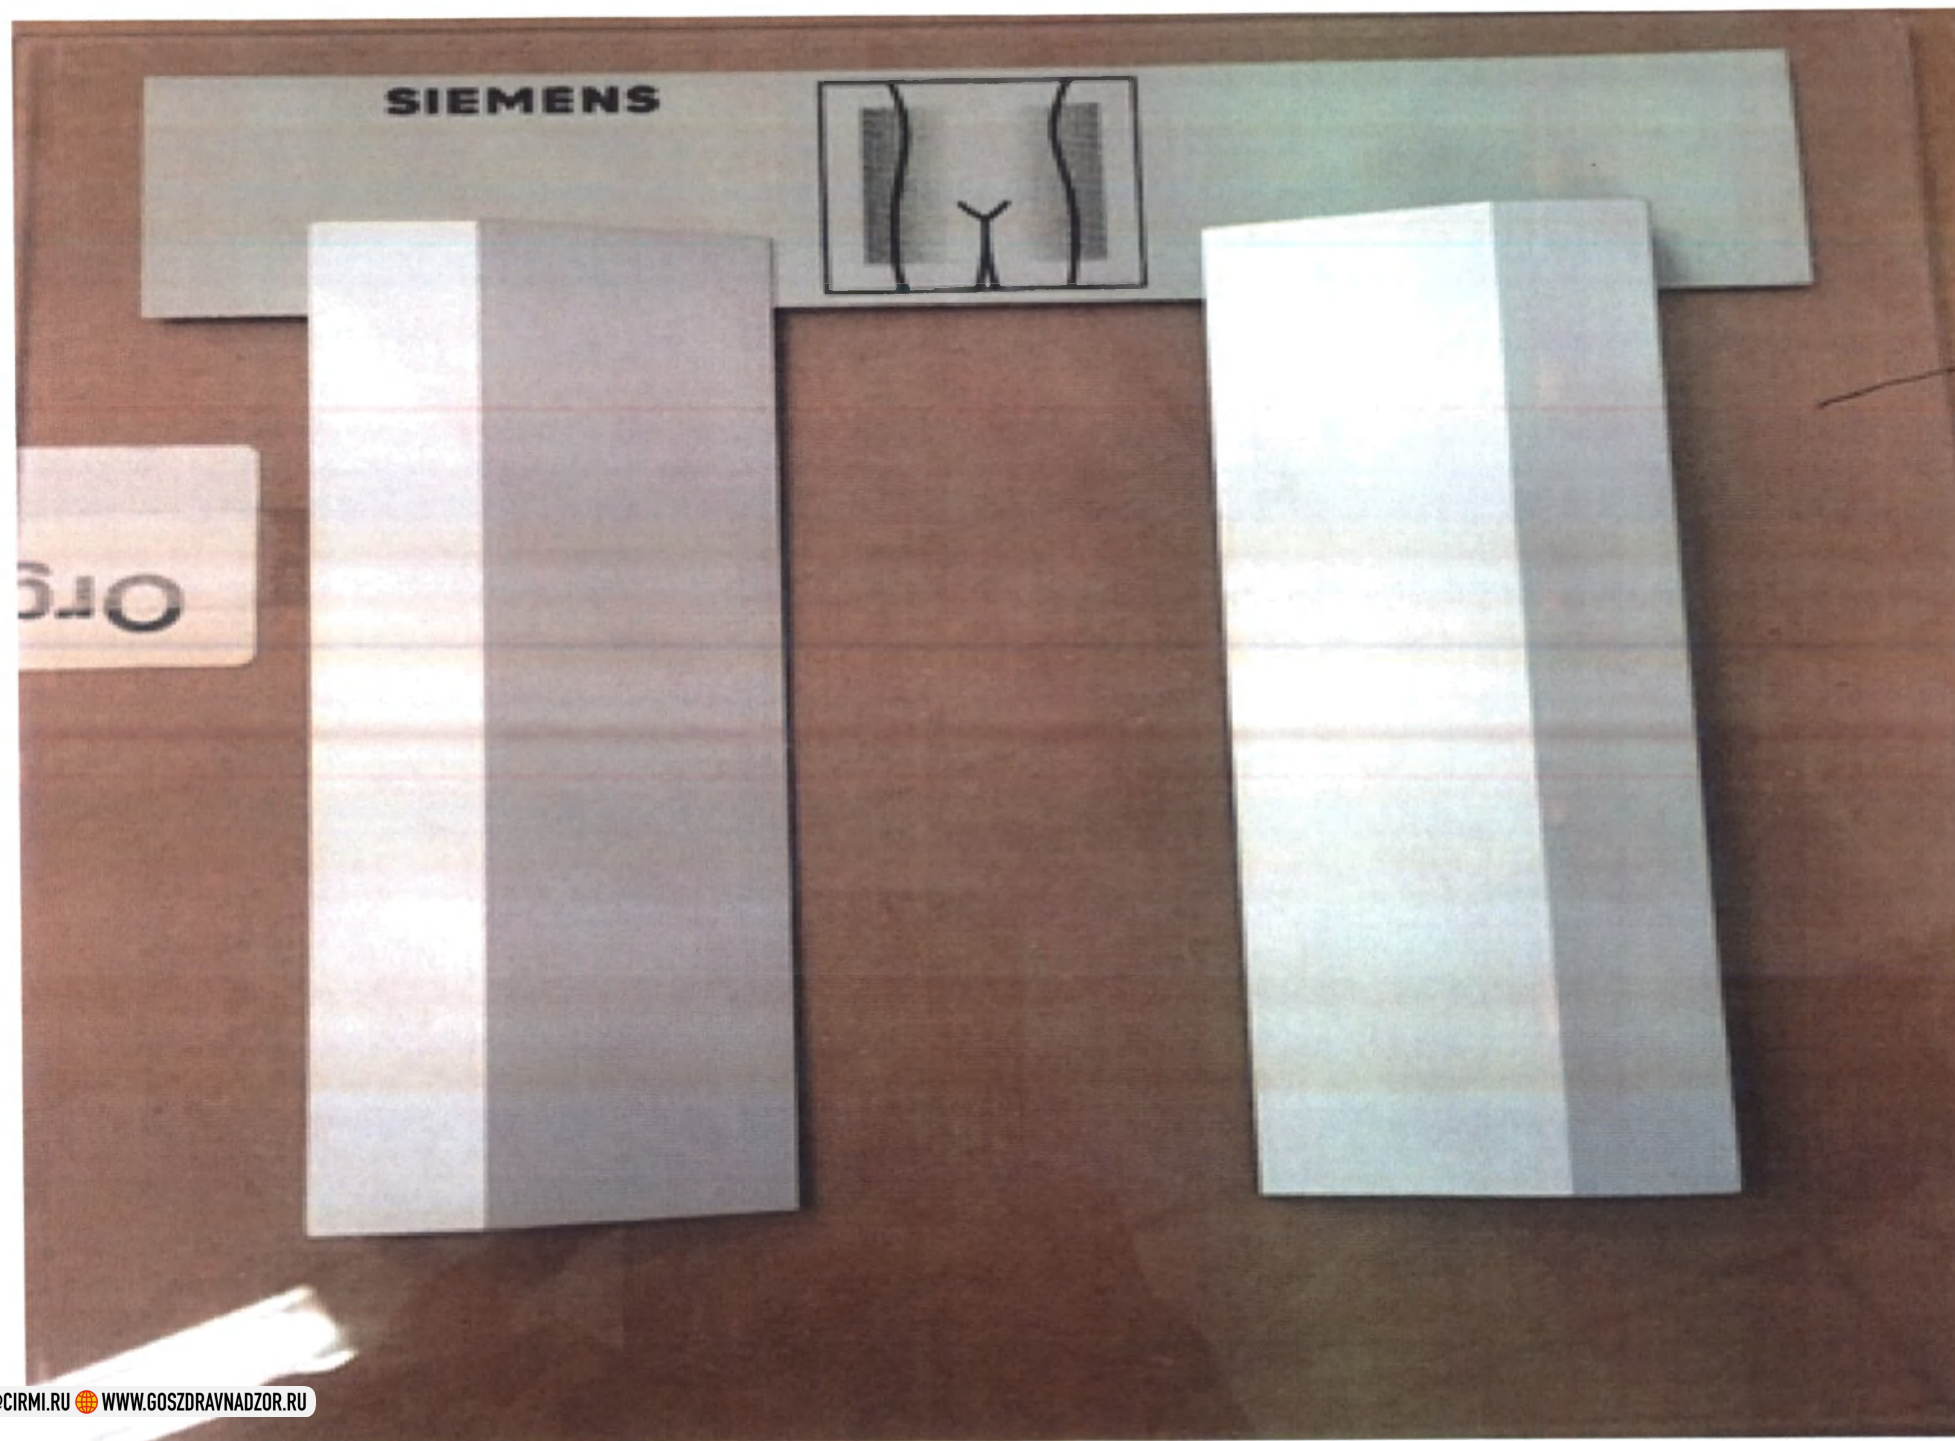


Принадлежности: Фильтр компенсационный (череп взрослого) .

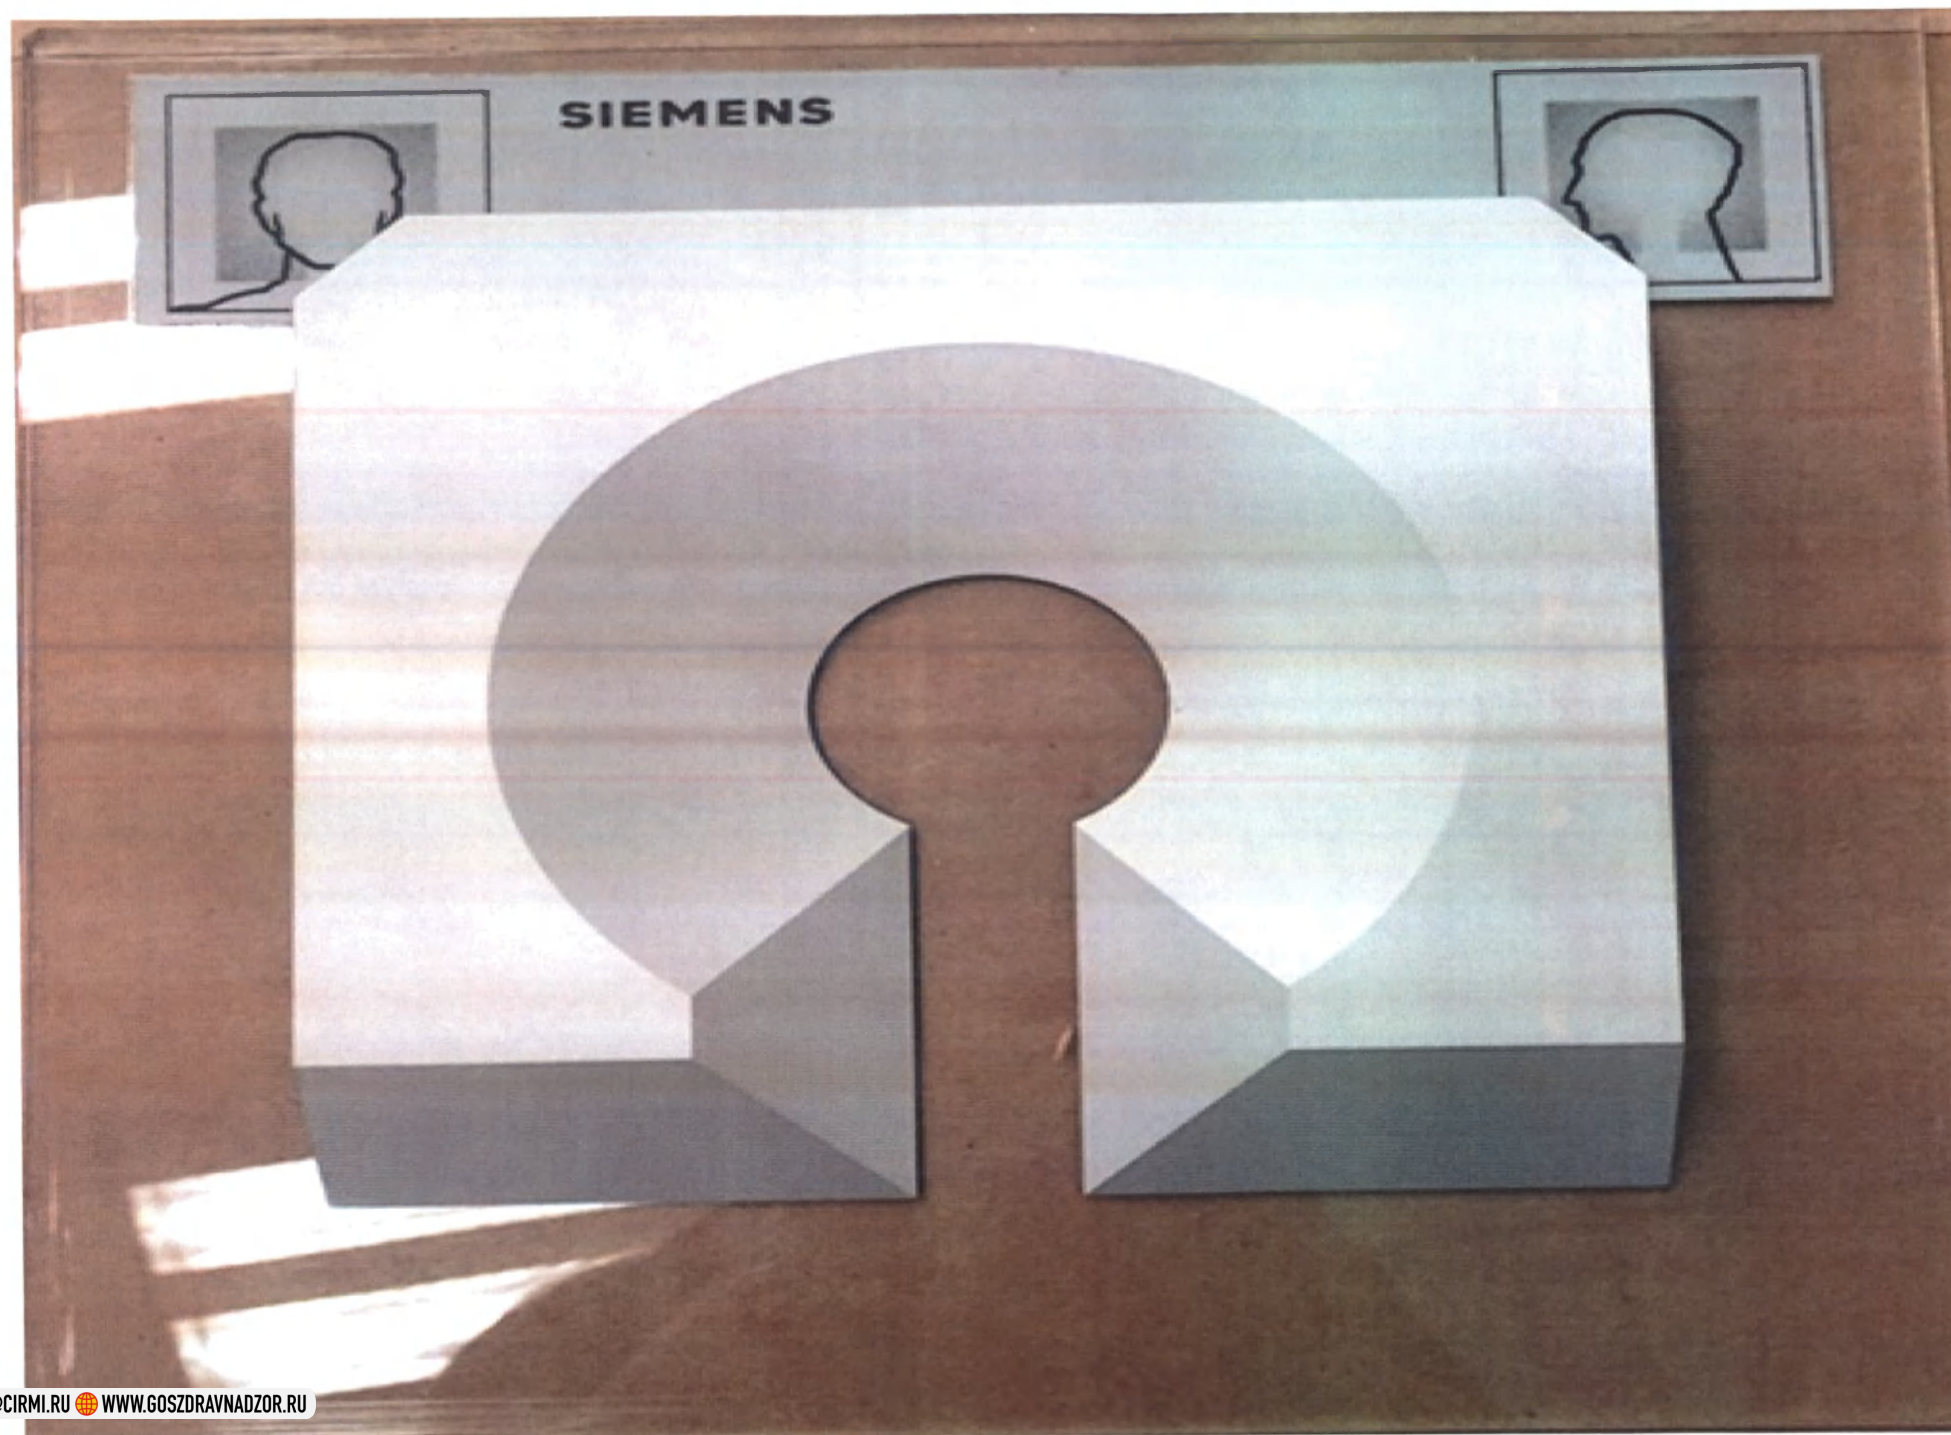


Принадлежности: Фильтр компенсационный (череп ребенка) .

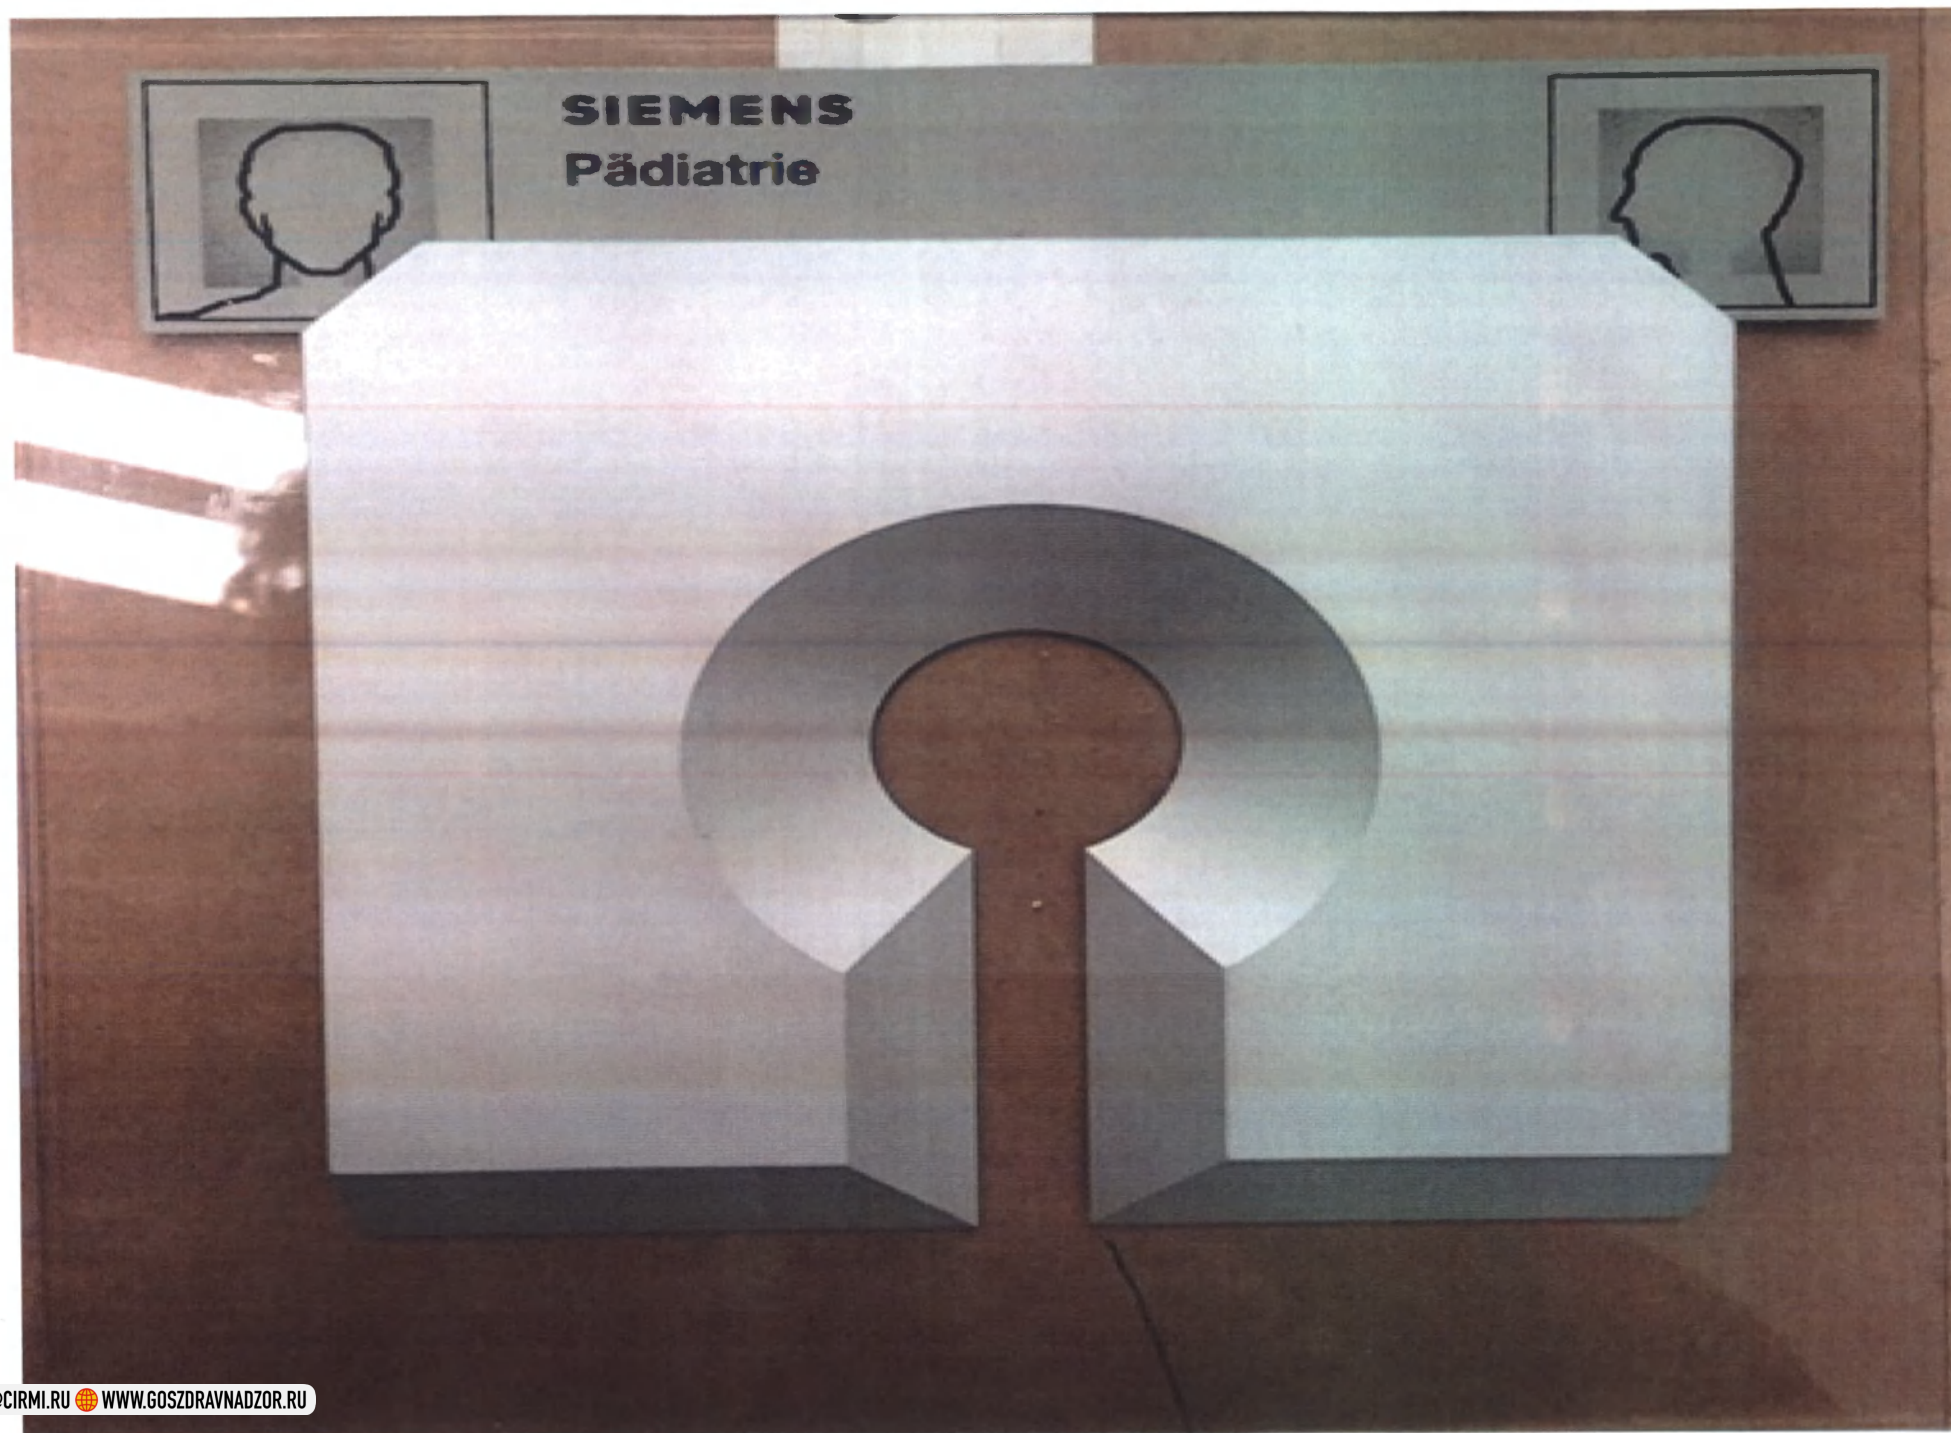

Принадлежности: Фильтр компенсационный (нога).

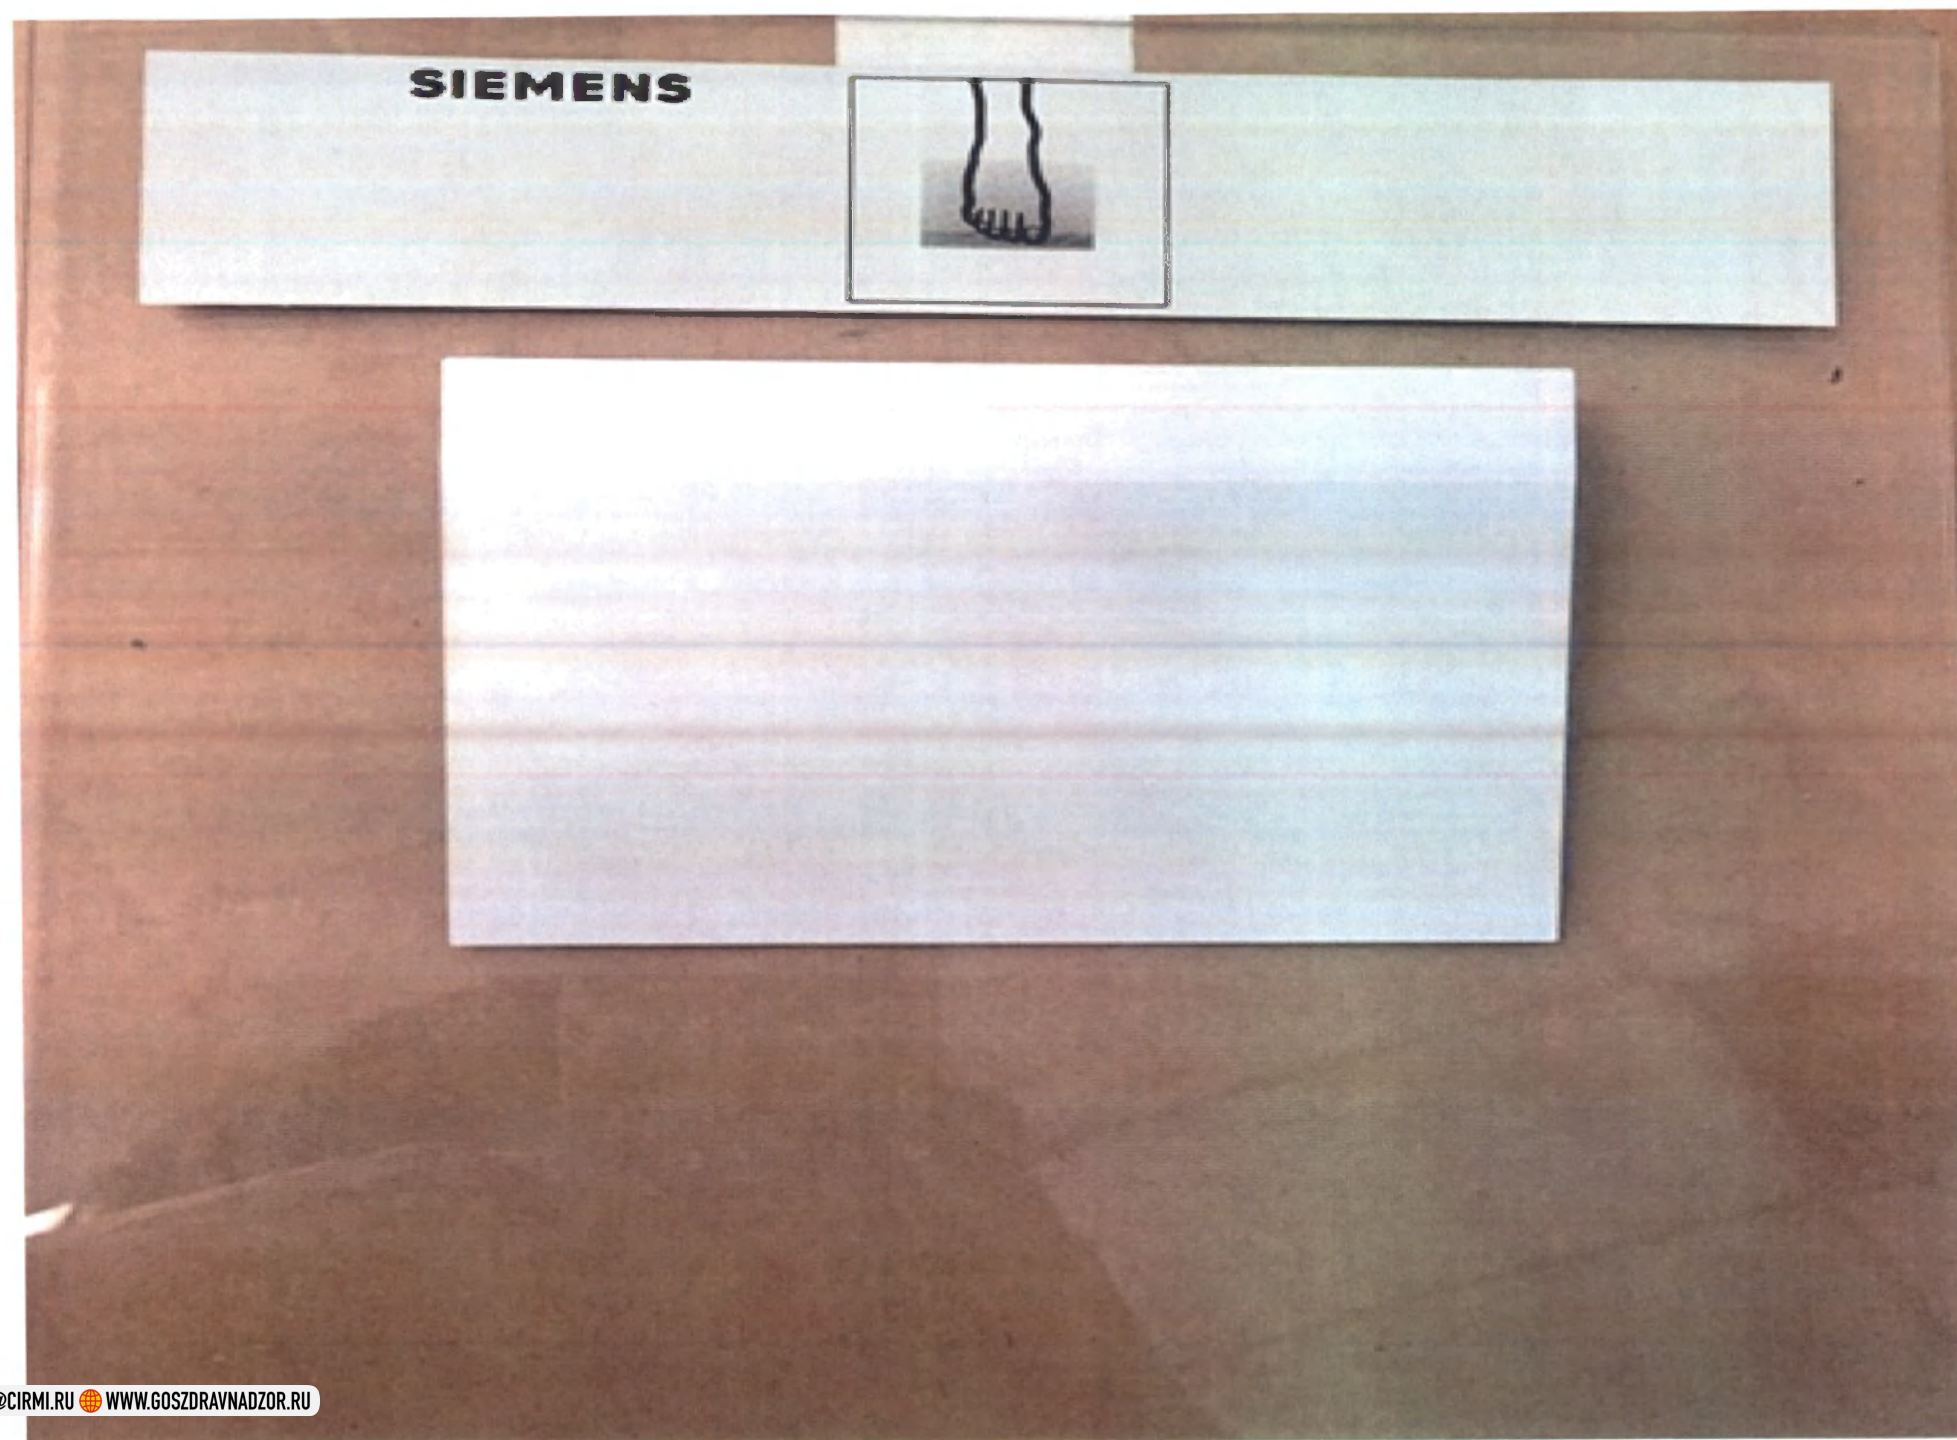


Принадлежности: Фильтр компенсационный (плечо).

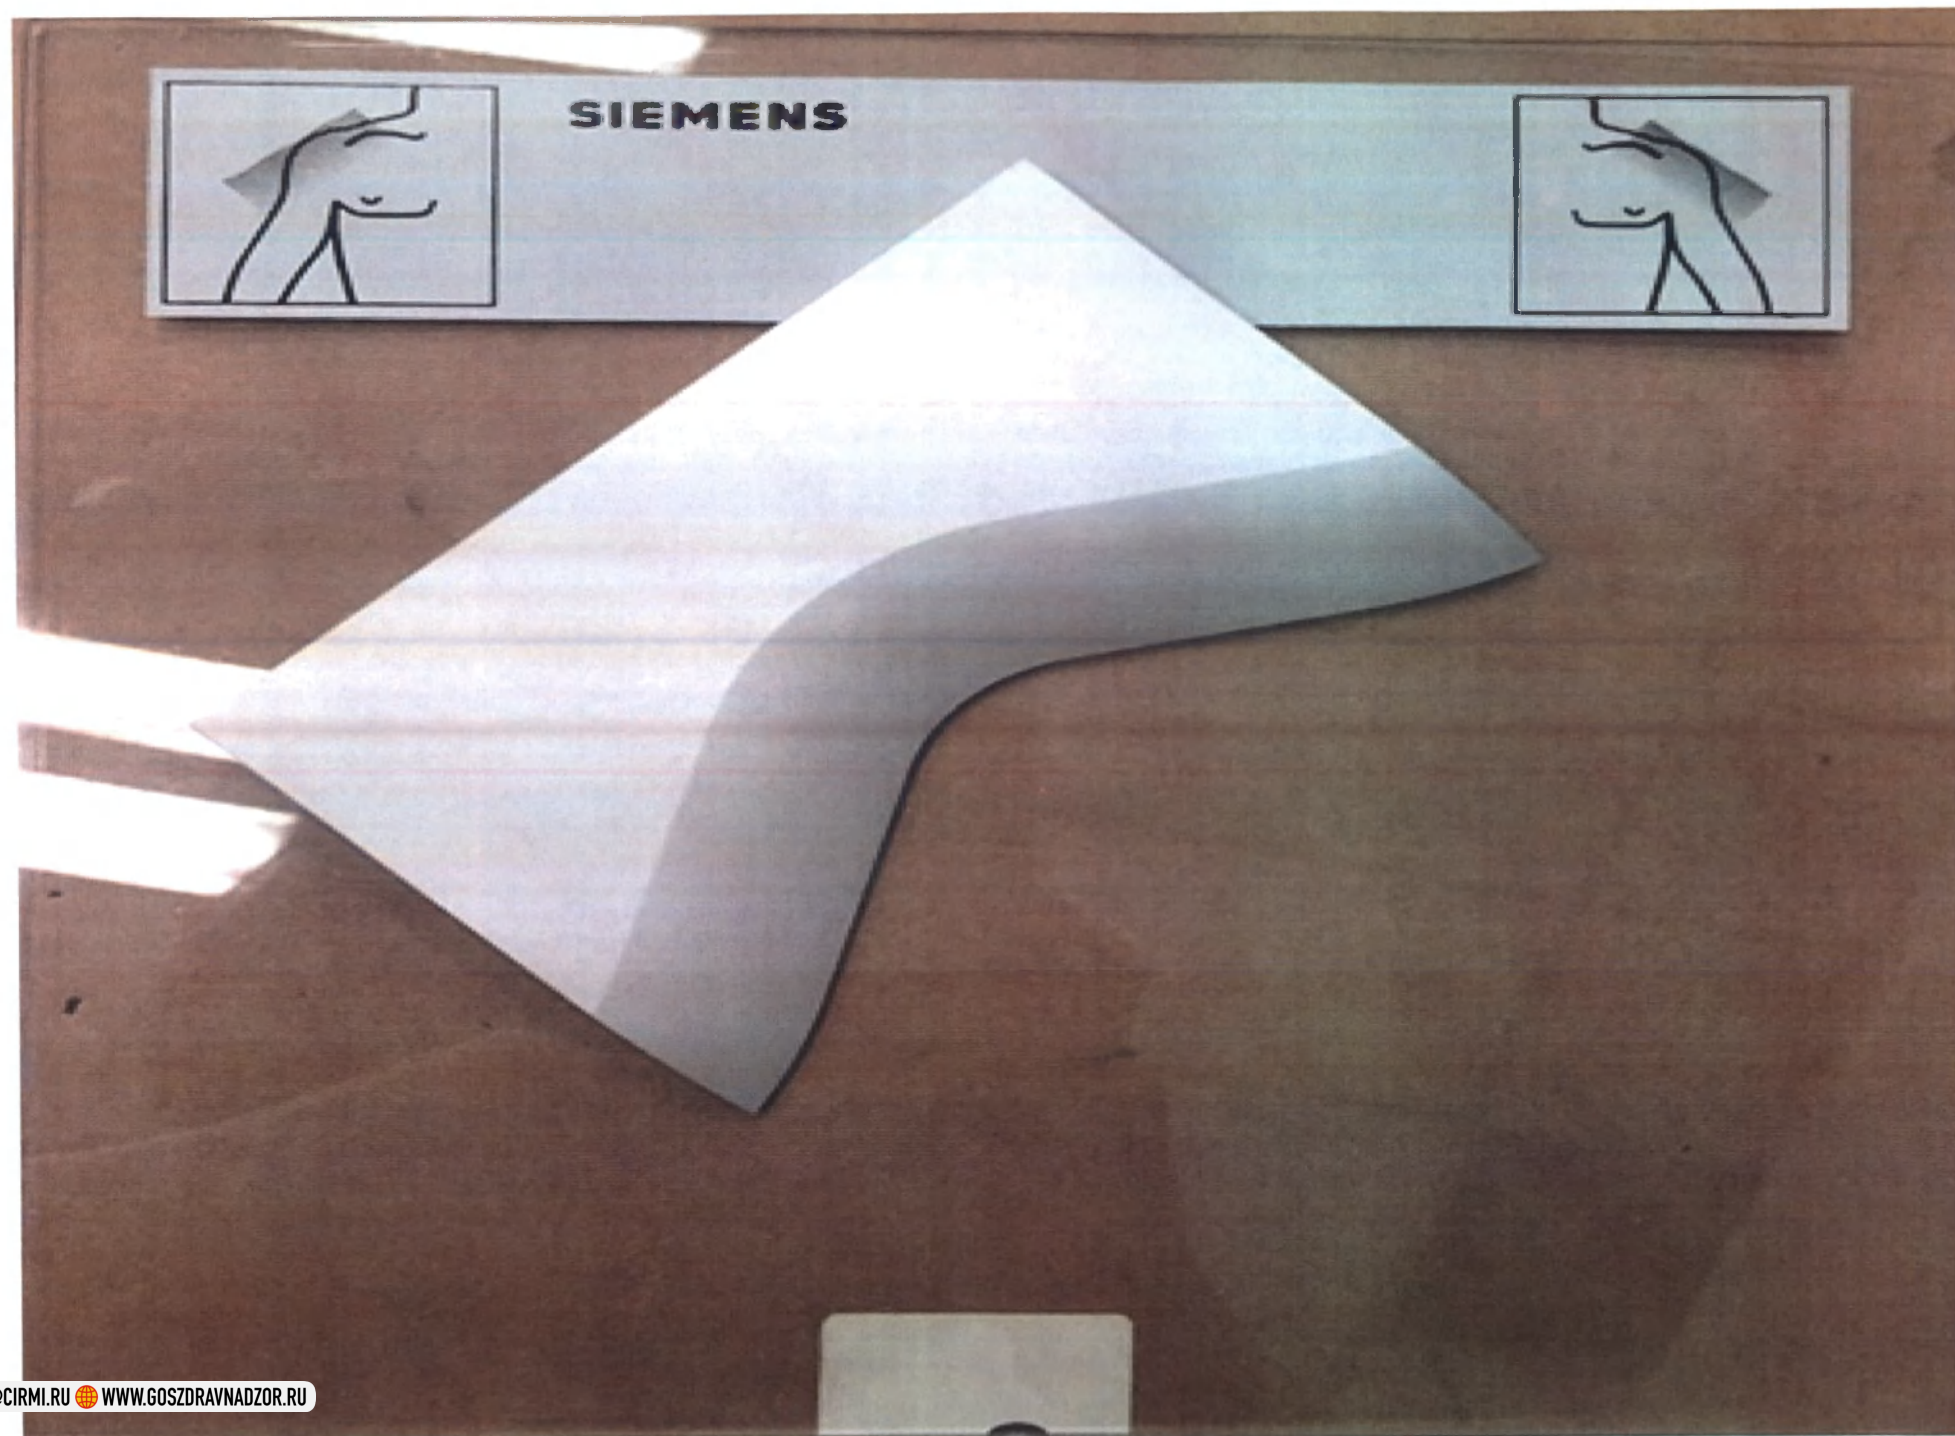


Принадлежности: Фильтр компенсационный (Т-позвоночник, L - позвоночник) .

SIEMENS


LWS, lateral
BWS, a. p.




Принадлежности: Фильтр компенсационный (Т-позвоночник, L - позвоночник) .

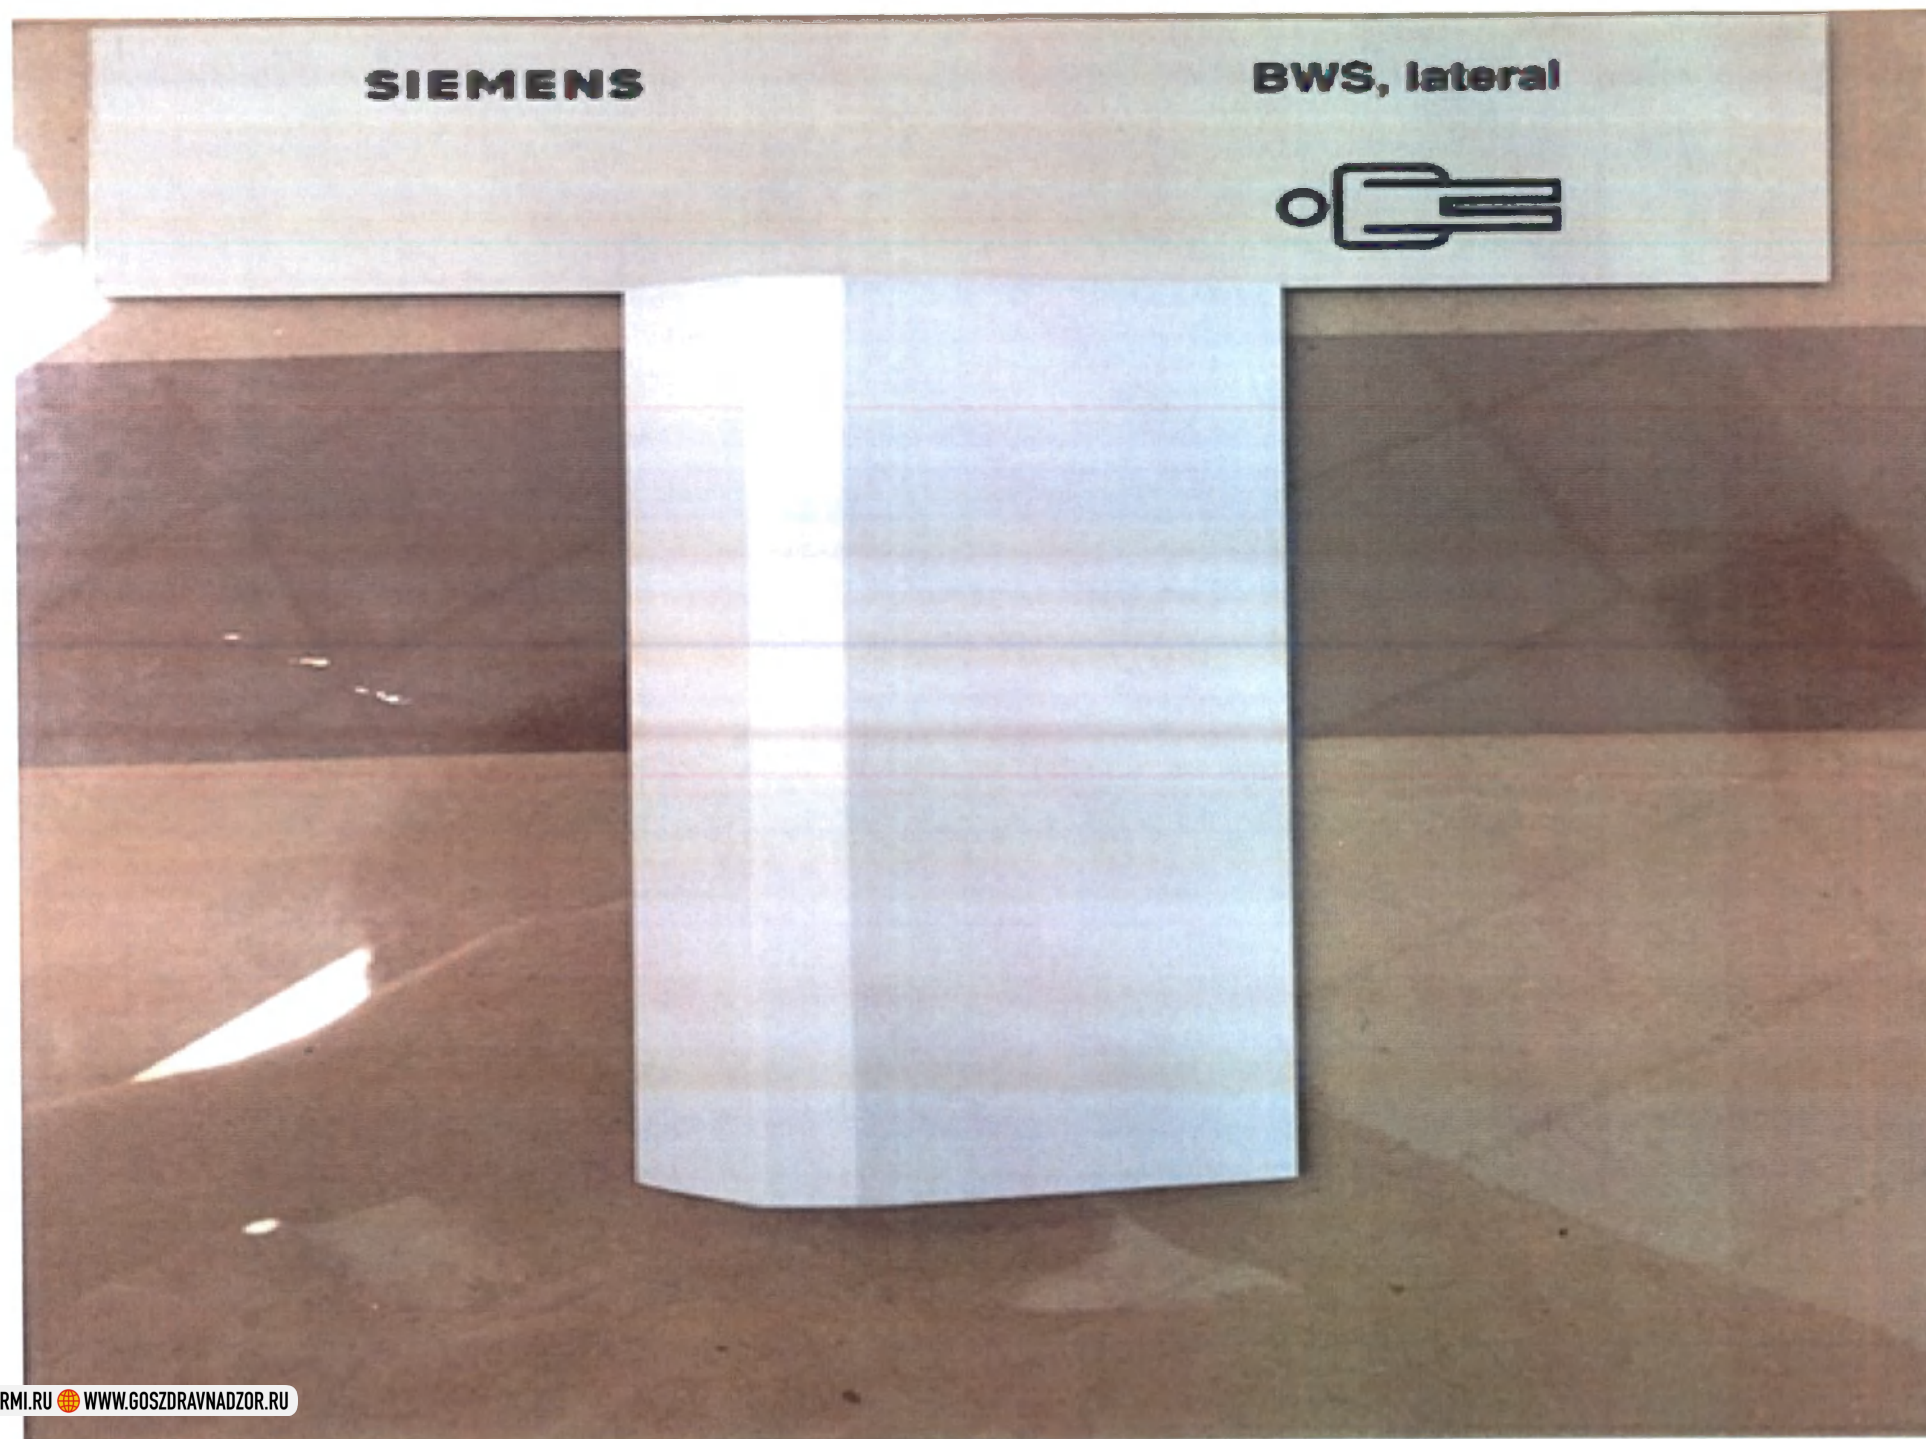

Принадлежности: Держатель фильтров .

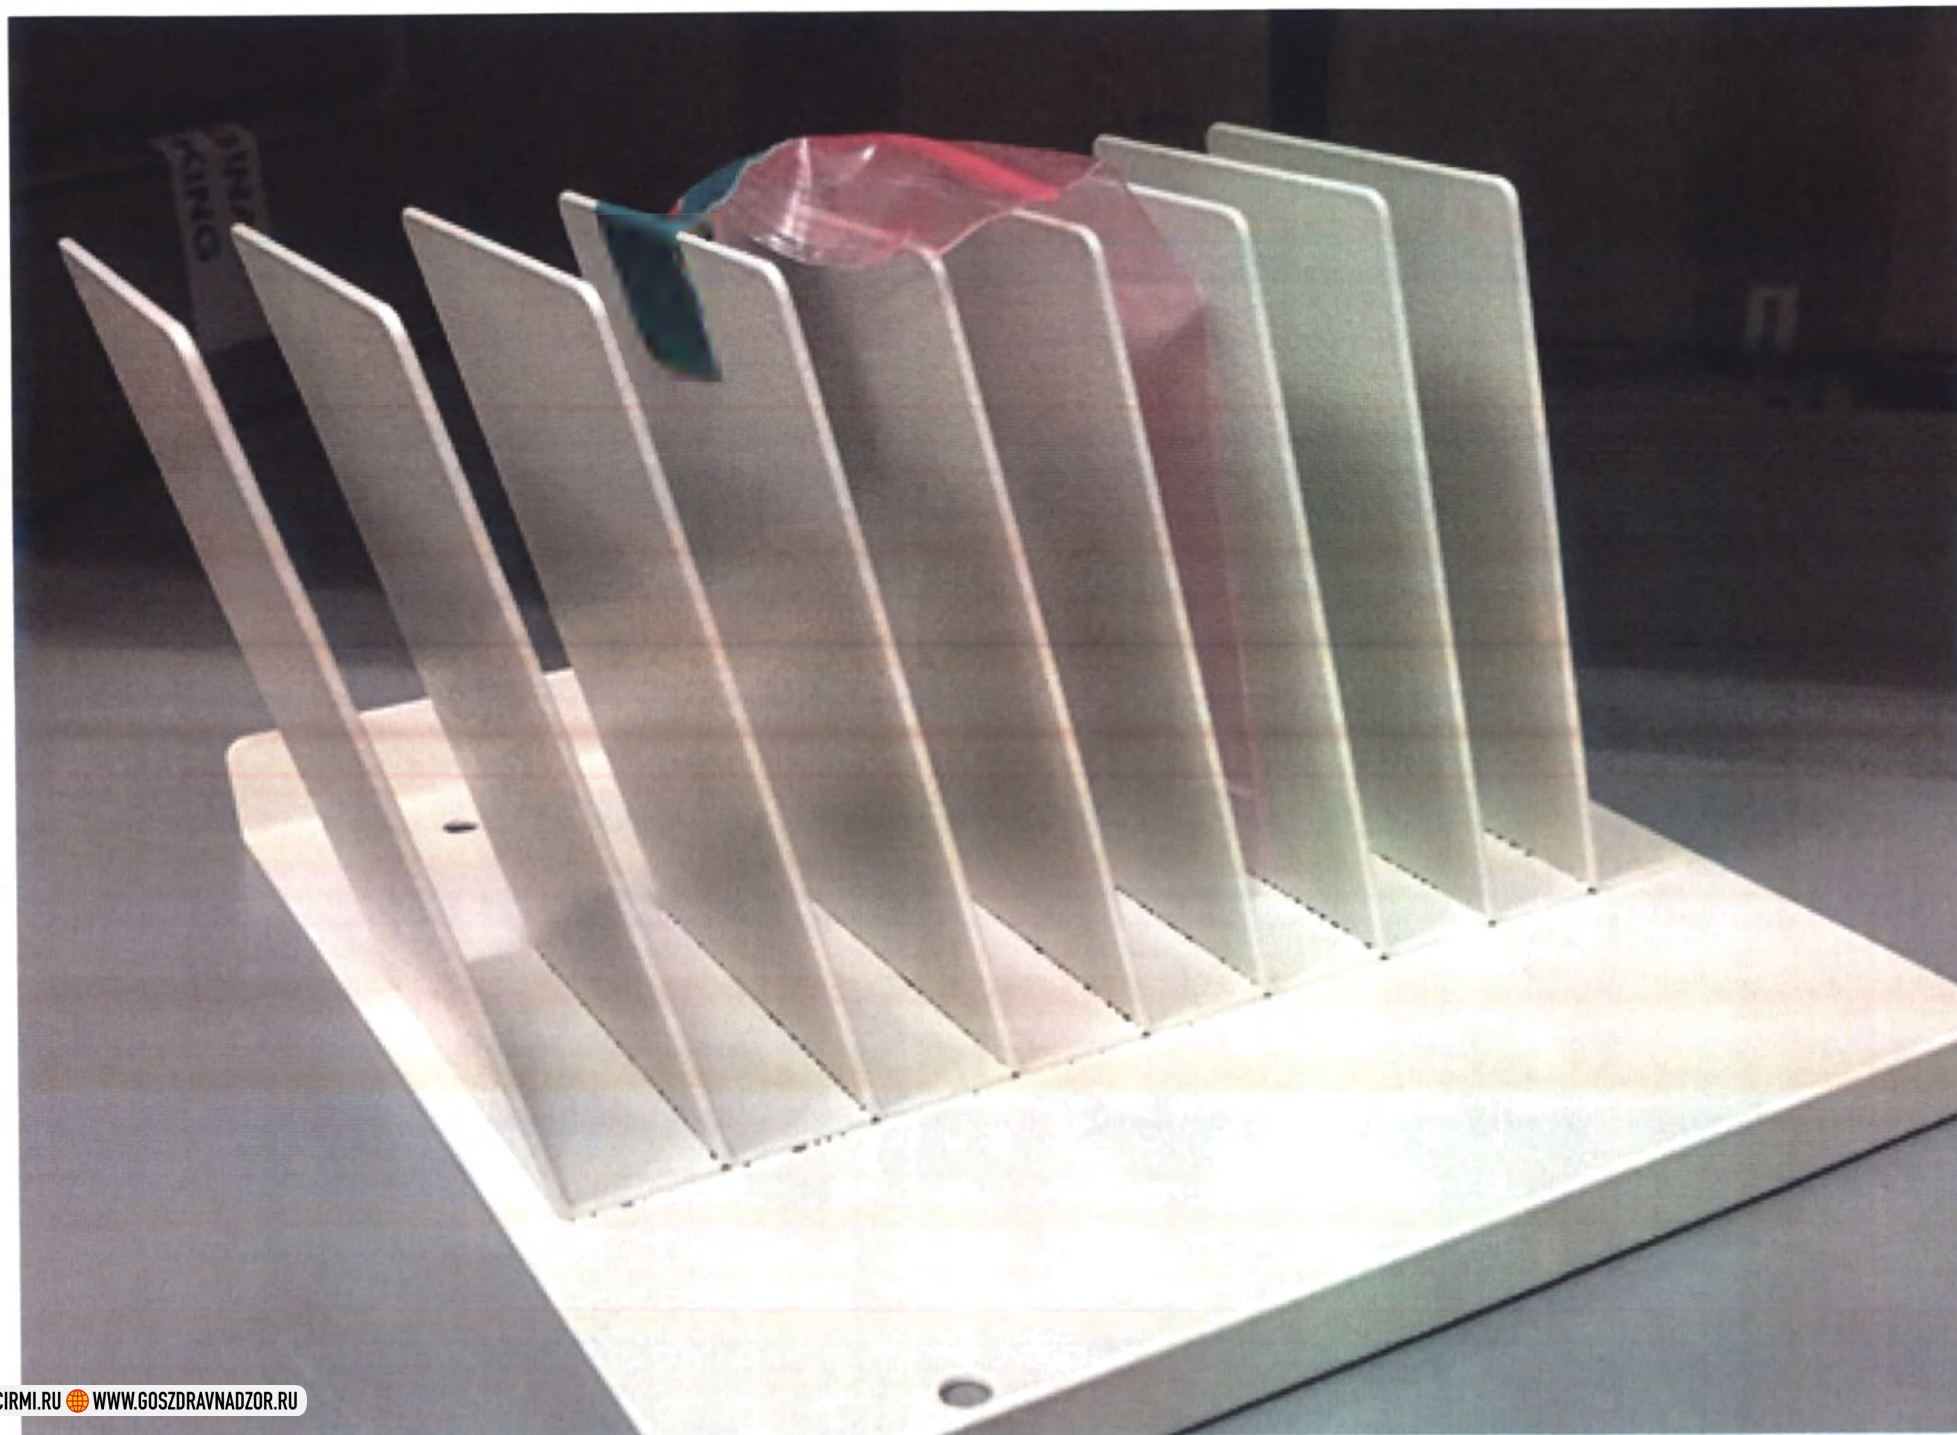

Принадлежности: Консоли управления дополнительные в составе: -системный блок; -мониторы ; -мышь; - клавиатура.

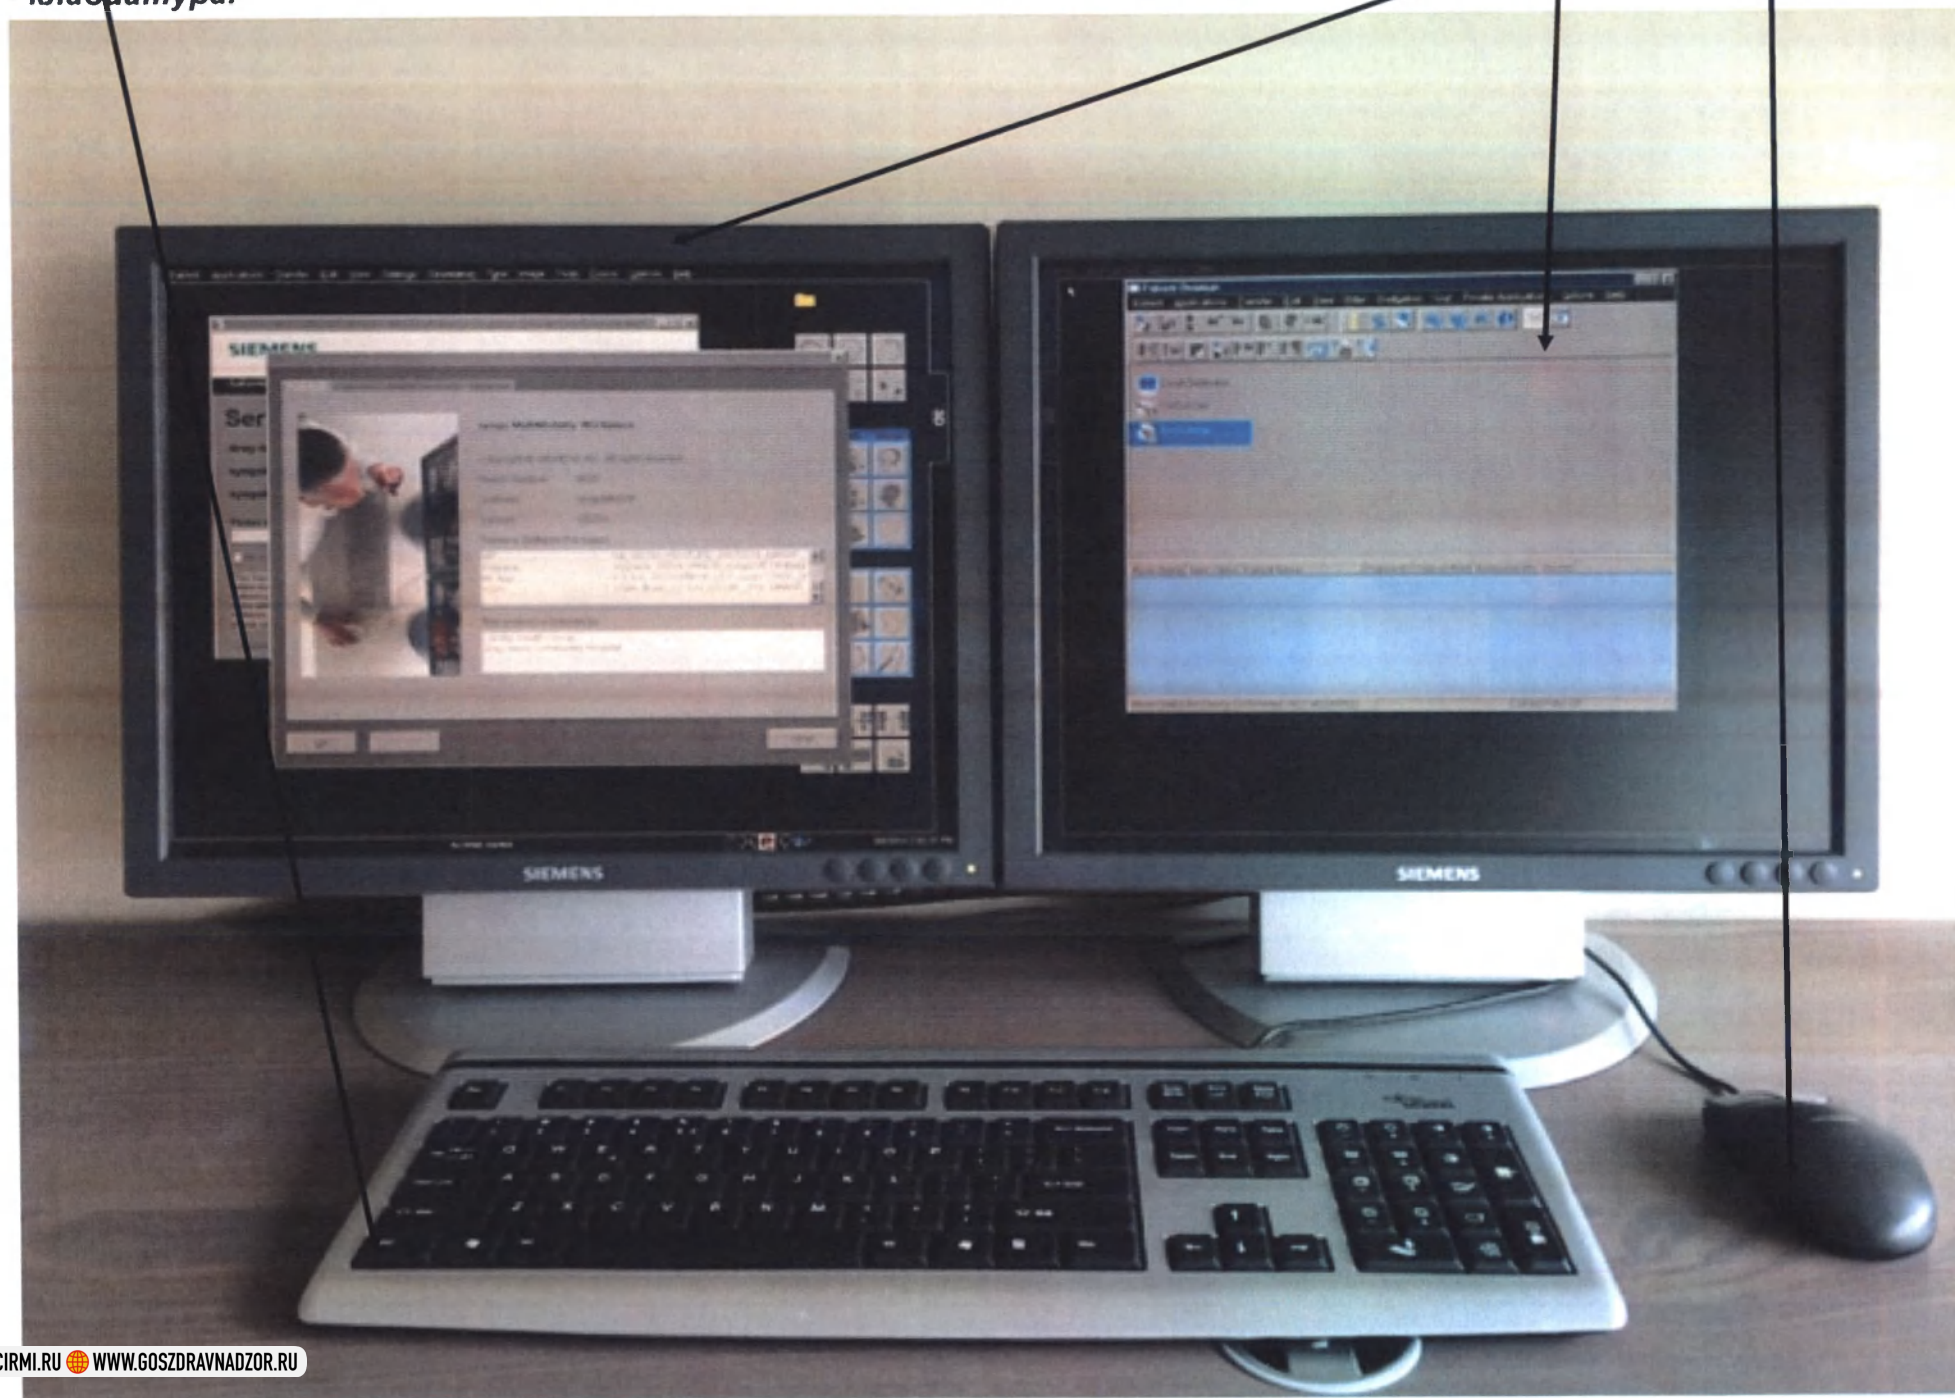

Принадлежности: Консоли управления дополнительные для улучшенной визуализации в составе:
-системный блок; -мониторы ; -мышь;- клавиатура.



Всего прошито и пронумеровано
29 листов.



«Сименс Здравоохранение»