

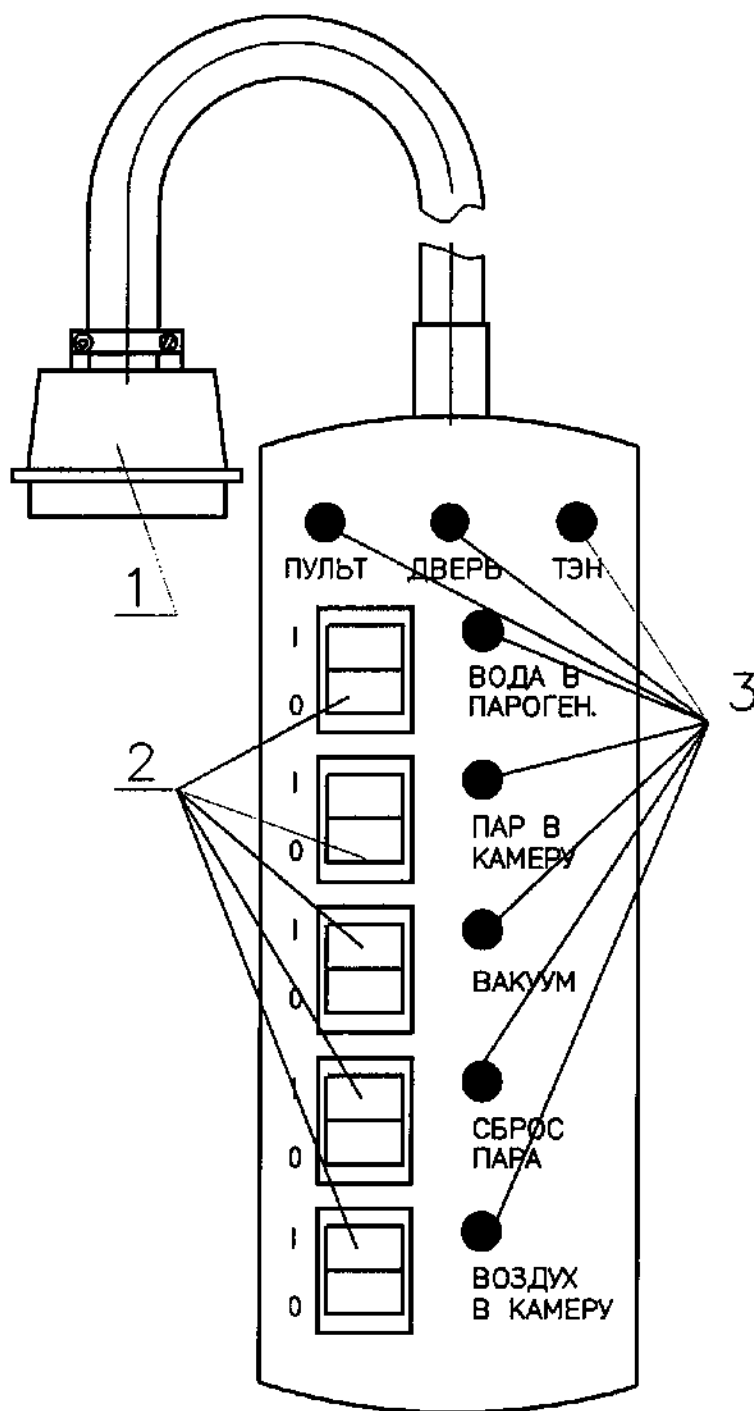


Рисунок 18 - Стерилизатор паровой ГП-400-2 "ТЗМОИ"
Пульт управления ИМ

1 - вилка; 2 - переключатели; 3 - светодиодные индикаторы

Инф. N	подл.	Погр.	и дата	Взам.	инф. N	дубл.	Инф. N	Погр.	и дата

Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата

ГП400.00.000 РЭ

Лист
101