

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Фотографические изображения медицинского изделия

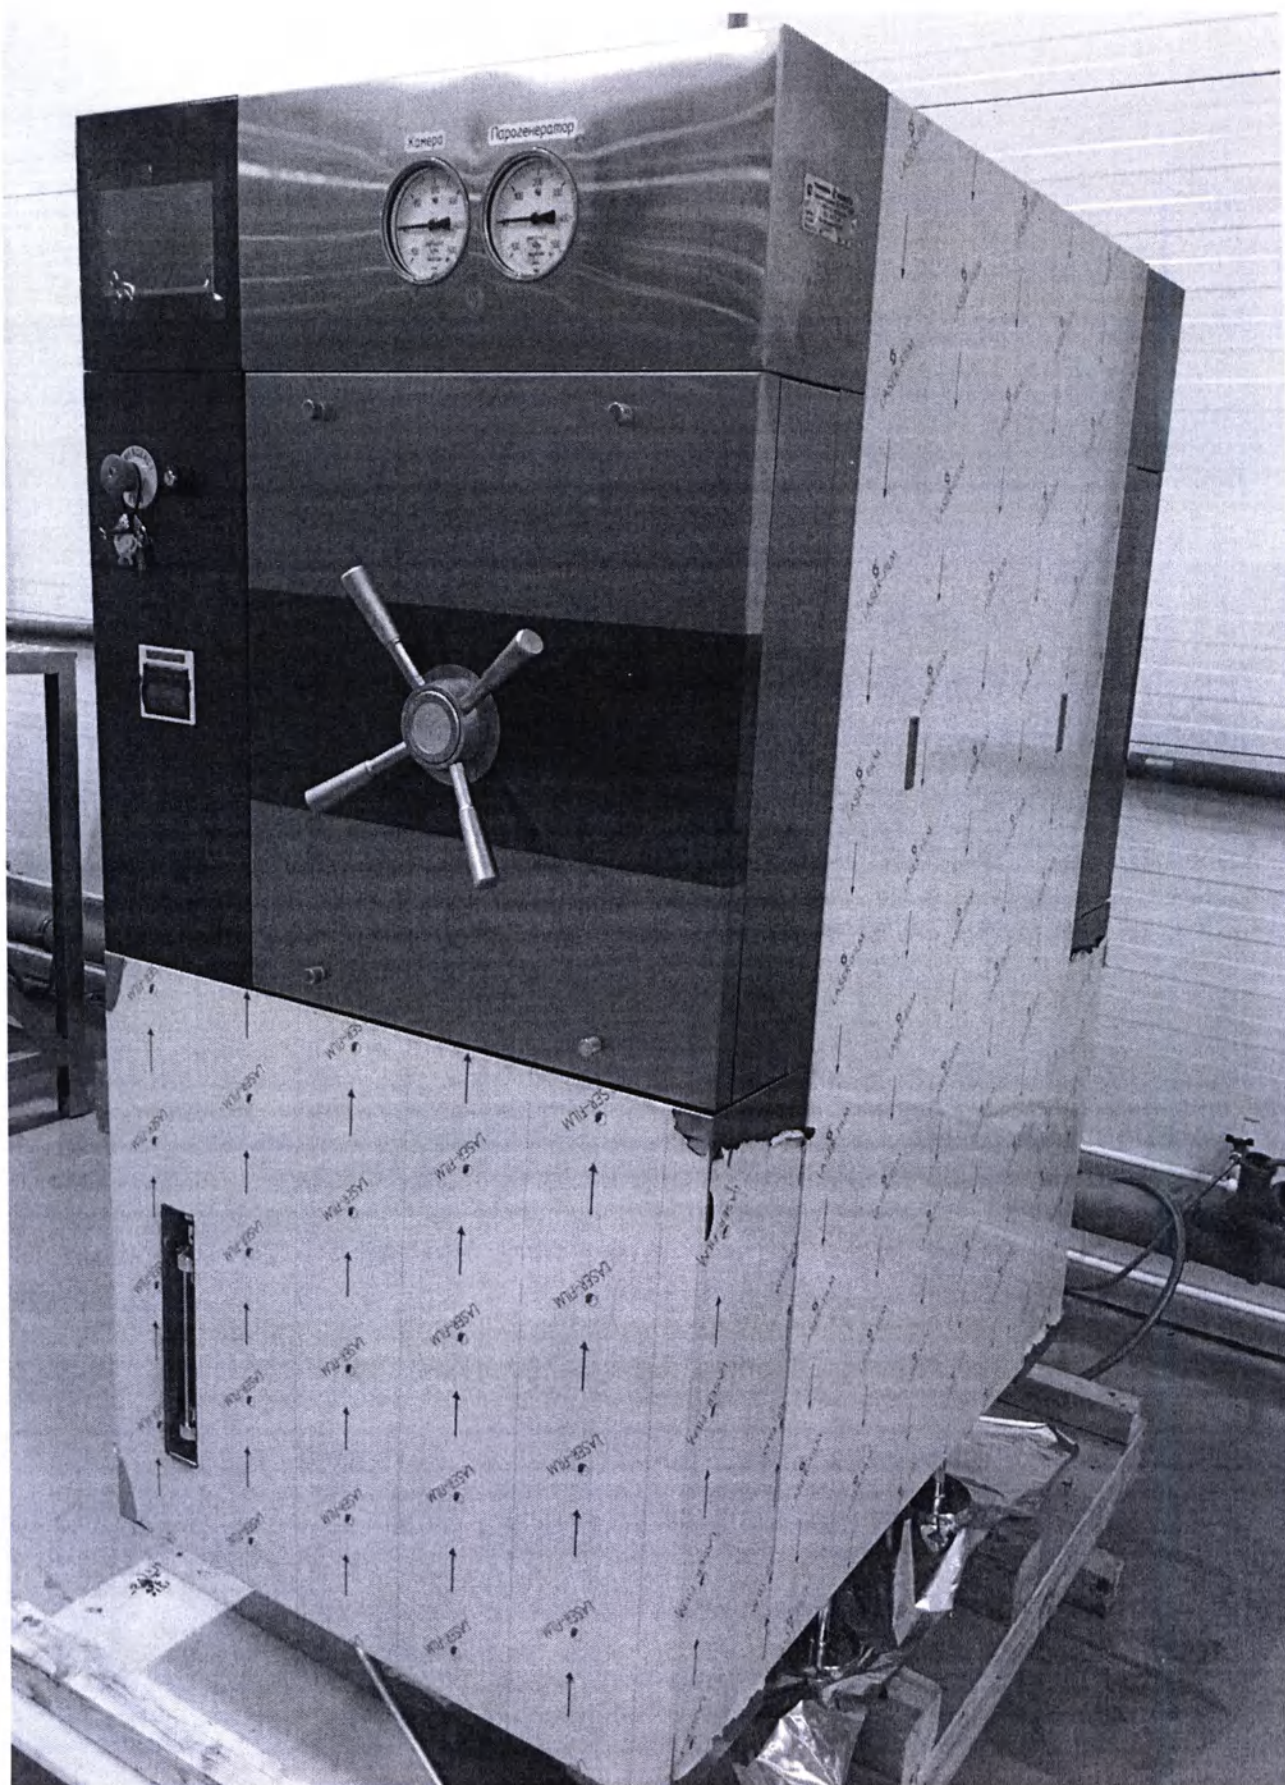


Рис. 1 Стерилизатор паровой двухдверный ГKD-100-4-«ТЗМОИ» по ТУ 9451-102-12517820-2011. Внешний вид.

ТЮМЕНЬ МЕДИКО
PG Стерилизатор паровой ГКД-100-4 "ТЗМОИ"
ТУ 9451-102-12517820-2011
50 Гц 380 В 11 кВт
Сделано в России Рабочее давление 0,23 МПа
Масса 360 кг № 10180618 Дата 06 2018 г.

Рис. 2 Стерилизатор паровой двухдверный ГКД-100-4-«ТЗМОИ» по ТУ 9451-102-12517820-2011. Маркировка

Произведено для АО ТЗМОИ на
Shandong Xinhua Instrument Co.,Ltd
Камера
Давление рабочее 0,23 МПа, расчетное 0,25 МПа, пробное 0,32 МПа
Расчетная температура стенок сосуда 139° С
Масса 70 кг № 2018B643 Дата 04 2018 г.

Рис. 3 Стерилизатор паровой двухдверный ГКД-100-4-«ТЗМОИ» по ТУ 9451-102-12517820-2011. Маркировка стерилизационной камеры