



Генеральный директор
ООО «Сирона Денталь Системс»

К.Г. Левин

25 мая 2020 г.

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

«Компоненты ортопедические, варианты исполнений: для систем дентальных имплантатов Ankylos, AstraTech, Osstem, BioHorizons, Thommen Medical»,

производства SIRONA Dental Systems GmbH (СИРОНА Дентал Системс ГмбХ), Германия

Абатмент стоматологический TiBase ANK C/GH1 S.



TiBase ANK C/GH1 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов Ankylos

Абатмент стоматологический

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:
Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:
ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase ANK C/GH2 S

Компонент ортопедический для систем зубных имплантатов Ankylos

Абатмент стоматологический

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase ANK/X GH1 S

Компонент ортопедический для систем зубных имплантатов Ankylos

Абатмент стоматологический

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase ANK/X GH2 S

Компонент ортопедический для систем зубных имплантатов Ankylos

Абатмент стоматологический

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87

Аналог абатмента ScanPost ANK S.



ScanPost ANK S

Компонент ортопедический для систем зубных имплантатов Ankylos

Аналог абатмента

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase AT EV 3.0 GH1 S

Компонент ортопедический для систем зубных имплантатов
AstraTech

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase AT EV 3.6 GH1 S

Компонент ортопедический для систем зубных имплантатов
AstraTech

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase AT EV 4.2 GH1 L

Компонент ортопедический для систем зубных имплантатов
AstraTech

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase AT EV 4.8 GH1 L

Компонент ортопедический для систем зубных имплантатов
AstraTech

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase AT EV 5.4 GH1 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов AstraTech

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87

Винт абатмента AT EV 3.0 (Abutment Screw AT EV 3.0).



Abutment Screw AT EV 3.0

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов AstraTech

Винт абатмента

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



Abutment Screw AT EV 3.6

Компонент ортопедический для систем зубных имплантатов AstraTech

Винт абатмента

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



Abutment Screw AT EV 4.2

Компонент ортопедический для систем зубных имплантатов AstraTech

Винт абатмента

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



Abutment Screw AT EV 4.8

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов AstraTech

Винт абатмента

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



Abutment Screw AT EV 5.4

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов AstraTech

Винт абатмента

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost AT EV 3.0 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов AstraTech

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals




Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost AT EV 3.6 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов AstraTech

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost AT EV 4.2 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов AstraTech

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost AT EV 4.8 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов AstraTech

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost AT EV 5.4 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов AstraTech

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals




Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase O TS 3.5 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов Osstem

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase O TS 4.0 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов Osstem

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87

Винт абатмента O TS 3.5 (Abutment Screw O TS 3.5).



Abutment Screw O TS 3.5

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов Osstem

Винт абатмента

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



Abutment Screw O TS 4.0

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов Osstem

Винт абатмента

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87

Аналог абатмента ScanPost O TS 3.5 L в комплекте с винтом.



ScanPost O TS 3.5 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов Osstem

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost O TS 4.0 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов Osstem

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87

Абатмент стоматологический TiBase BH 3.0 S в комплекте с винтом.



TiBase BH 3.0 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов BioHorizons

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase BH 3.5 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов BioHorizons

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase BH 4.5 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов BioHorizons

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals




Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase BH 5.7 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов BioHorizons

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87

Винт абатмента BH 3.0 (Abutment Screw BH 3.0).



Abutment Screw BH 3.0

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов BioHorizons

Винт абатмента

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals




Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



Abutment Screw BH 3.5, 4.5, 5.7

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов BioHorizons

Винт абатмента

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87

Аналог абатмента ScanPost BH 3.0 S в комплекте с винтом.



ScanPost BH 3.0 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов BioHorizons

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals




Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost BH 3.5 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов BioHorizons

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost BH 4.5 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов BioHorizons

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost BH 5.7 L

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов BioHorizons

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase TM 3.5 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов Thommen Medical

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals




Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase TM 4.0 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов
Thommen Medical

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase TM 4.5 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов
Thommen Medical

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



TiBase TM 5.0 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов
Thommen Medical

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87

Абатмент стоматологический TiBase TM 6.0 S в комплекте с винтом.



TiBase TM 6.0 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов
Thommen Medical

Абатмент стоматологический в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals




Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



Abutment Screw ТМ 3.5

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов
Thommen Medical

Винт абатмента

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87

Винт абатмента ТМ 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 (Abutment Screw ТМ 4.0, 4.5, 5.0, 6.0).



Abutment Screw ТМ 4.0, 4.5, 5.0, 6.0

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов
Thommen Medical

Винт абатмента

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals




Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost TM 3.5 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов
Thommen Medical

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost TM 4.0 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов
Thommen Medical

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost TM 4.5 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов
Thommen Medical

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost TM 5.0 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов
Thommen Medical

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals




Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



ScanPost TM 6.0 S

Компонент ортопедический для систем дентальных имплантатов
Thommen Medical

Аналог абатмента в комплекте с винтом

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Обратитесь к инструкции по применению по ссылке
www.dentsplysirona.com/manuals



Производитель:

Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
тел.: +7 (495) 725 10 87



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 25 лист (ов)

К.Г. Левин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Сирона Денталь Системс»

- К.Г. Левин



20" ноября 2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Компоненты ортопедические, варианты исполнений:
для систем дентальных имплантатов
Ankylos, AstraTech, Osstem, BioHorizons, Thommen Medical

производства SIRONA Dental Systems GmbH
(СИРОНА Дентал Системс ГмбХ), Германия

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Компоненты ортопедические для систем дентальных имплантатов Ankylos:	
1.	Абатмент стоматологический ANK C/GH1 S.	3
2.	Абатмент стоматологический ANK C/GH2 S.	4
3.	Абатмент стоматологический ANK/X GH1 S.	5
4.	Абатмент стоматологический ANK/X GH2 S.	6
5.	Аналог абатмента ScanPost ANK S.	7
II.	Компоненты ортопедические для систем дентальных имплантатов AstraTech:	
1.	Абатмент стоматологический AT EV 3.0 GH1 S в комплекте с винтом.	8
2.	Абатмент стоматологический AT EV 3.6 GH1 S в комплекте с винтом.	9
3.	Абатмент стоматологический AT EV 4.2 GH1 L в комплекте с винтом.	10
4.	Абатмент стоматологический AT EV 4.8 GH1 L в комплекте с винтом.	11
5.	Абатмент стоматологический AT EV 5.4 GH1 L в комплекте с винтом.	12
6.	Винт абатмента AT EV 3.0 (Abutment Screw AT EV 3.0).	13
7.	Винт абатмента AT EV 3.6 (Abutment Screw AT EV 3.6).	14
8.	Винт абатмента AT EV 4.2 (Abutment Screw AT EV 4.2).	15
9.	Винт абатмента AT EV 4.8 (Abutment Screw AT EV 4.8).	16
10.	Винт абатмента AT EV 5.4 (Abutment Screw AT EV 5.4).	17
11.	Аналог абатмента ScanPost AT EV 3.0 S в комплекте с винтом.	18
12.	Аналог абатмента ScanPost AT EV 3.6 S в комплекте с винтом.	19
13.	Аналог абатмента ScanPost AT EV 4.2 L в комплекте с винтом.	20
14.	Аналог абатмента ScanPost AT EV 4.8 L в комплекте с винтом.	21
15.	Аналог абатмента ScanPost AT EV 5.4 L в комплекте с винтом.	22
III.	Компоненты ортопедические для систем дентальных имплантатов Osstem:	
1.	Абатмент стоматологический O TS 3.5 L в комплекте с винтом.	23
2.	Абатмент стоматологический O TS 4.0 L в комплекте с винтом.	24
3.	Винт абатмента O TS 3.5 (Abutment Screw O TS 3.5).	25
4.	Винт абатмента O TS 4.0 (Abutment Screw O TS 4.0).	26
5.	Аналог абатмента ScanPost O TS 3.5 L в комплекте с винтом.	27
6.	Аналог абатмента ScanPost O TS 4.0 L в комплекте с винтом.	28
IV.	Компоненты ортопедические для систем дентальных имплантатов BioHorizons:	
1.	Абатмент стоматологический BH 3.0 S в комплекте с винтом.	29
2.	Абатмент стоматологический BH 3.5 L в комплекте с винтом.	30
3.	Абатмент стоматологический BH 4.5 L в комплекте с винтом.	31
4.	Абатмент стоматологический BH 5.7 L в комплекте с винтом.	32
5.	Винт абатмента BH 3.0 (Abutment Screw BH 3.0).	33
6.	Винт абатмента BH 3.5, 4.5, 5.7 (Abutment Screw BH 3.5, 4.5, 5.7).	34
7.	Аналог абатмента ScanPost BH 3.0 S в комплекте с винтом.	35
8.	Аналог абатмента ScanPost BH 3.5 L в комплекте с винтом.	36
9.	Аналог абатмента ScanPost BH 4.5 L в комплекте с винтом.	37
10.	Аналог абатмента ScanPost BH 5.7 L в комплекте с винтом.	38
V.	Компоненты ортопедические для систем дентальных имплантатов Thommen Medical:	
1.	Абатмент стоматологический TM 3.5 S в комплекте с винтом.	39
2.	Абатмент стоматологический TM 4.0 S в комплекте с винтом.	40
3.	Абатмент стоматологический TM 4.5 S в комплекте с винтом.	41
4.	Абатмент стоматологический TM 5.0 S в комплекте с винтом.	42
5.	Абатмент стоматологический TM 6.0 S в комплекте с винтом.	43
6.	Винт абатмента TM 3.5 (Abutment Screw TM 3.5).	44
7.	Винт абатмента TM 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 (Abutment Screw TM 4.0, 4.5, 5.0, 6.0).	45
8.	Аналог абатмента ScanPost TM 3.5 S в комплекте с винтом.	46
9.	Аналог абатмента ScanPost TM 4.0 S в комплекте с винтом.	47
10.	Аналог абатмента ScanPost TM 4.5 S в комплекте с винтом.	48
11.	Аналог абатмента ScanPost TM 5.0 S в комплекте с винтом.	49
12.	Аналог абатмента ScanPost TM 6.0 S в комплекте с винтом.	50
	Инструкция по эксплуатации TiBase.	51
	Инструкция по эксплуатации ScanPost.	52

I. Компоненты ортопедические стоматологические для систем децальных имплантатов Ankylos:
1. Абатмент стоматологический ANK C/GH1 S.



2. Абатмент стоматологический ANK C/GH2 S.




3. Абатмент стоматологический ANK/X GH1 S.




4. Абъёмист стоматологический ANK/X GH2 S.



5. Аналог абатмента ScanPost ANK S.

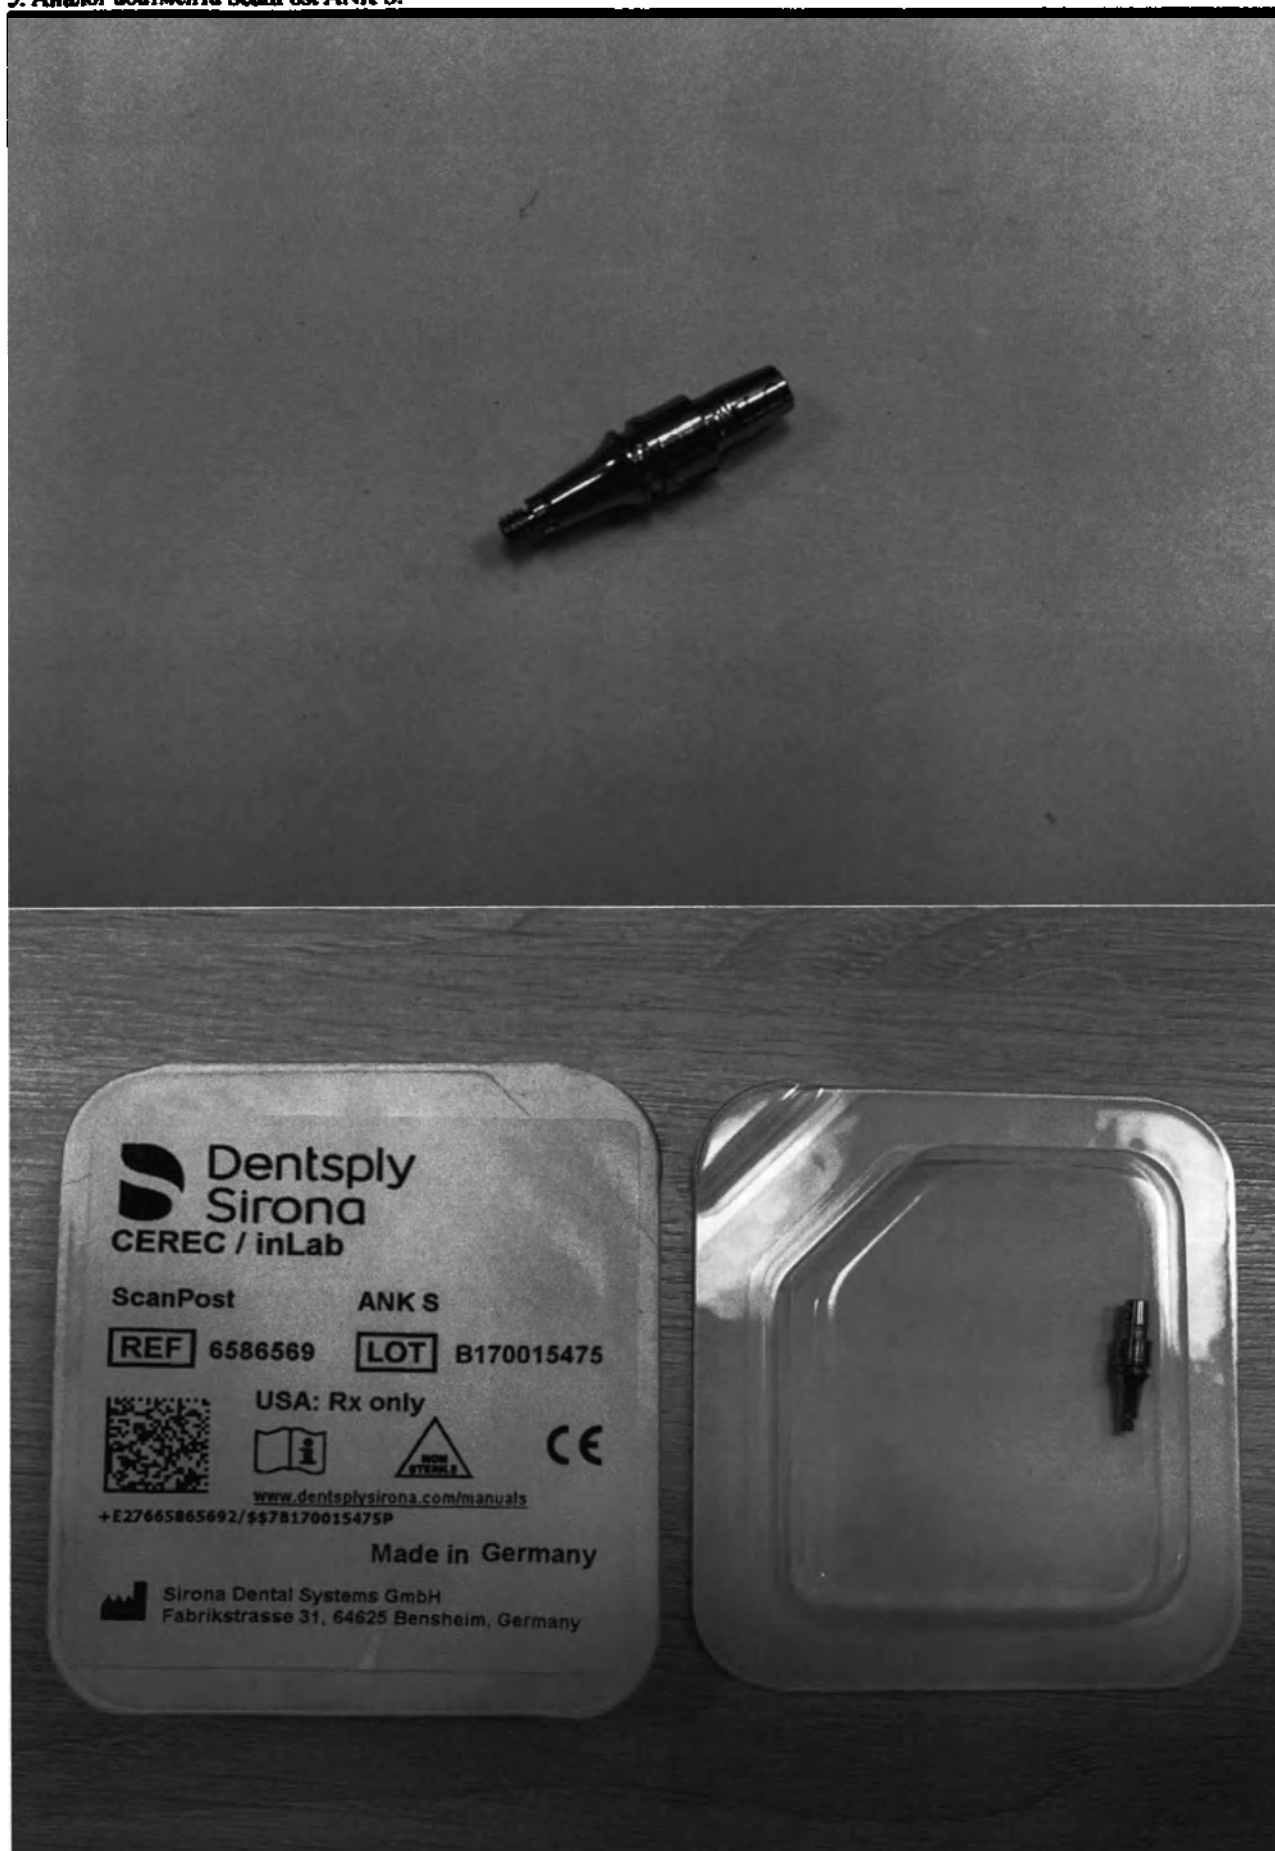


II. Компоненты ортопедические для систем дентальных имплантатов AstraTech:
1. Абатмент стоматологический AT EV 3.0 GH1 S в комплекте с винтом.

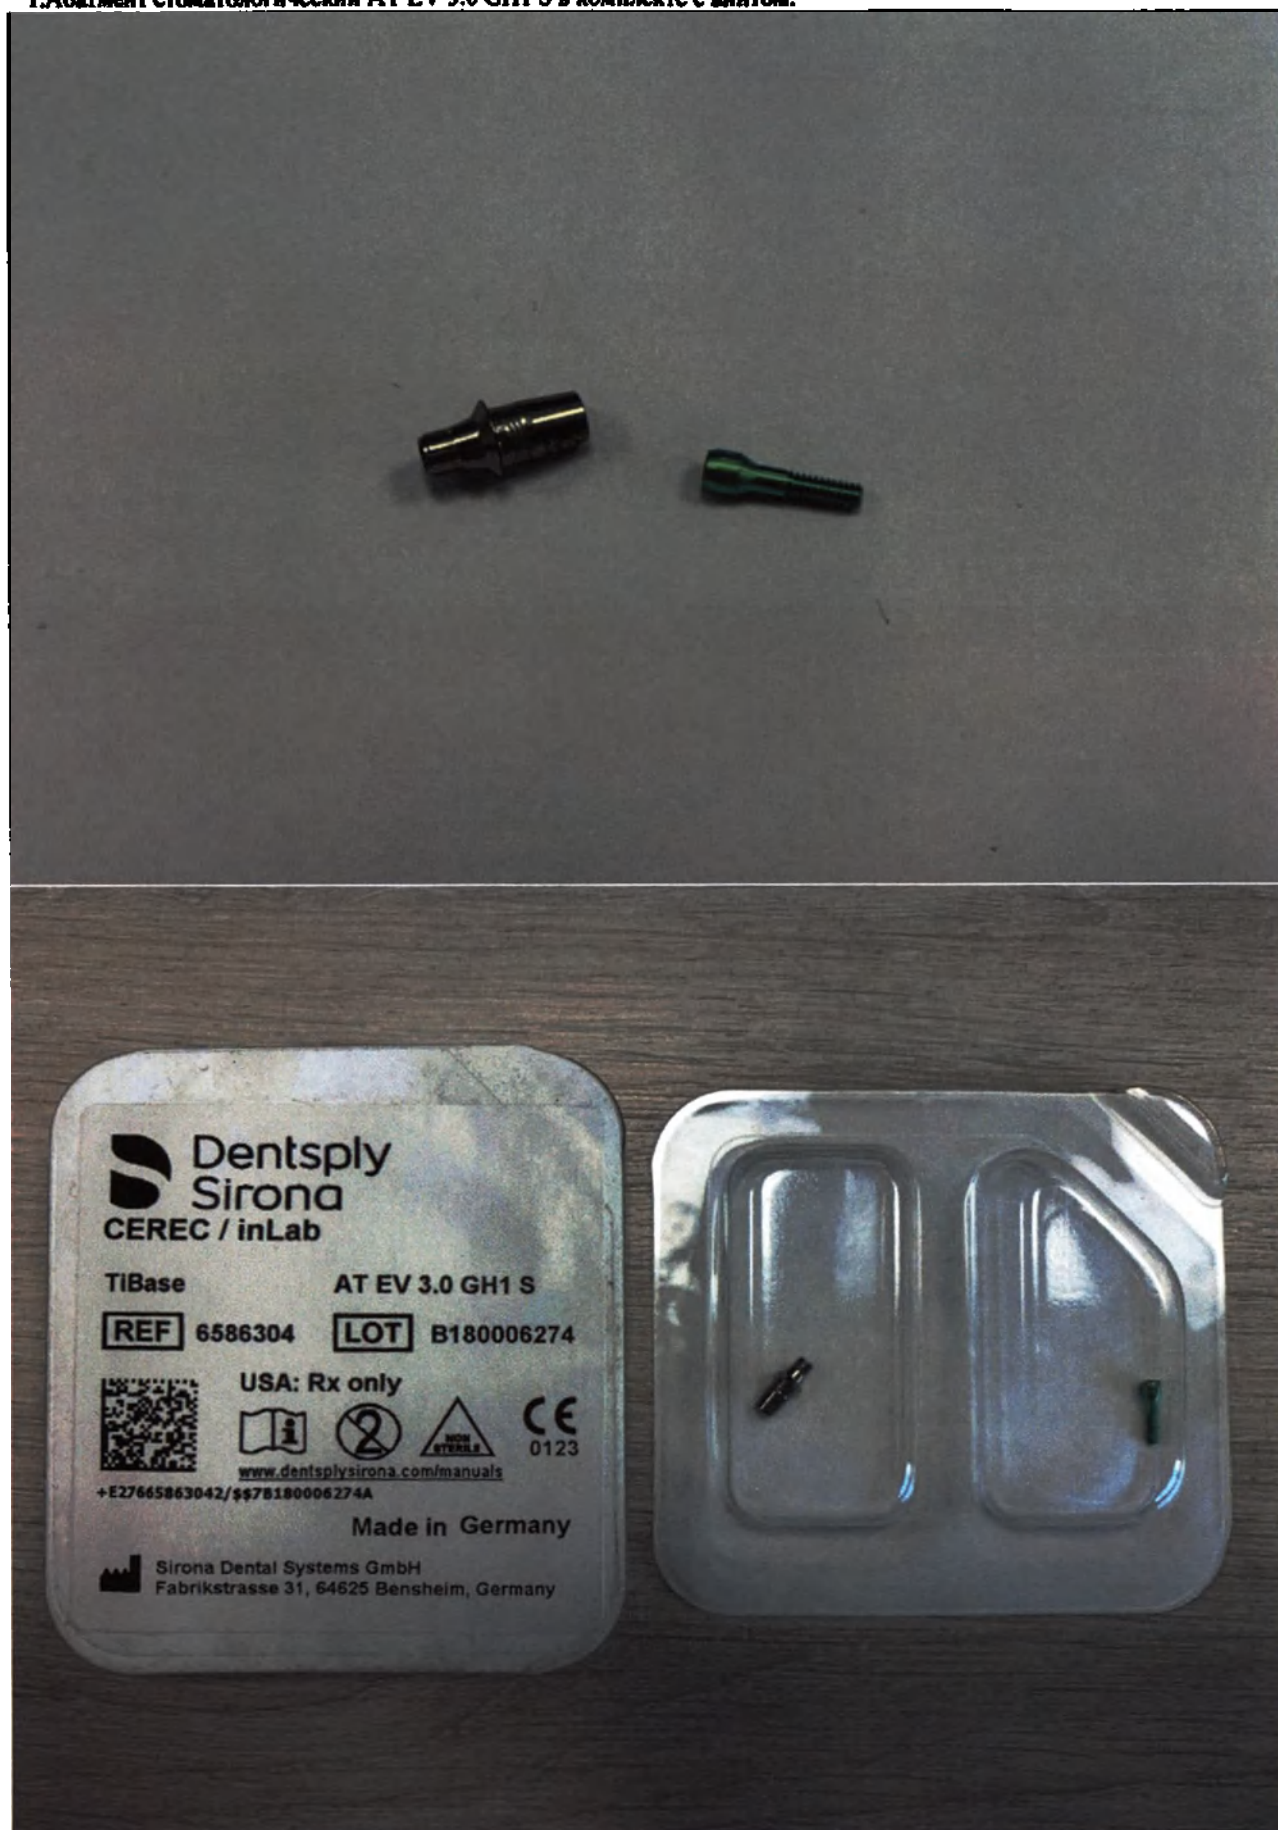

2. Абатмент стоматологический AT EV 3.6 GH1 S в комплекте с винтом.



3. Абатмент стоматологический AT EV 4.2 GH1 L в комплекте с винтом.

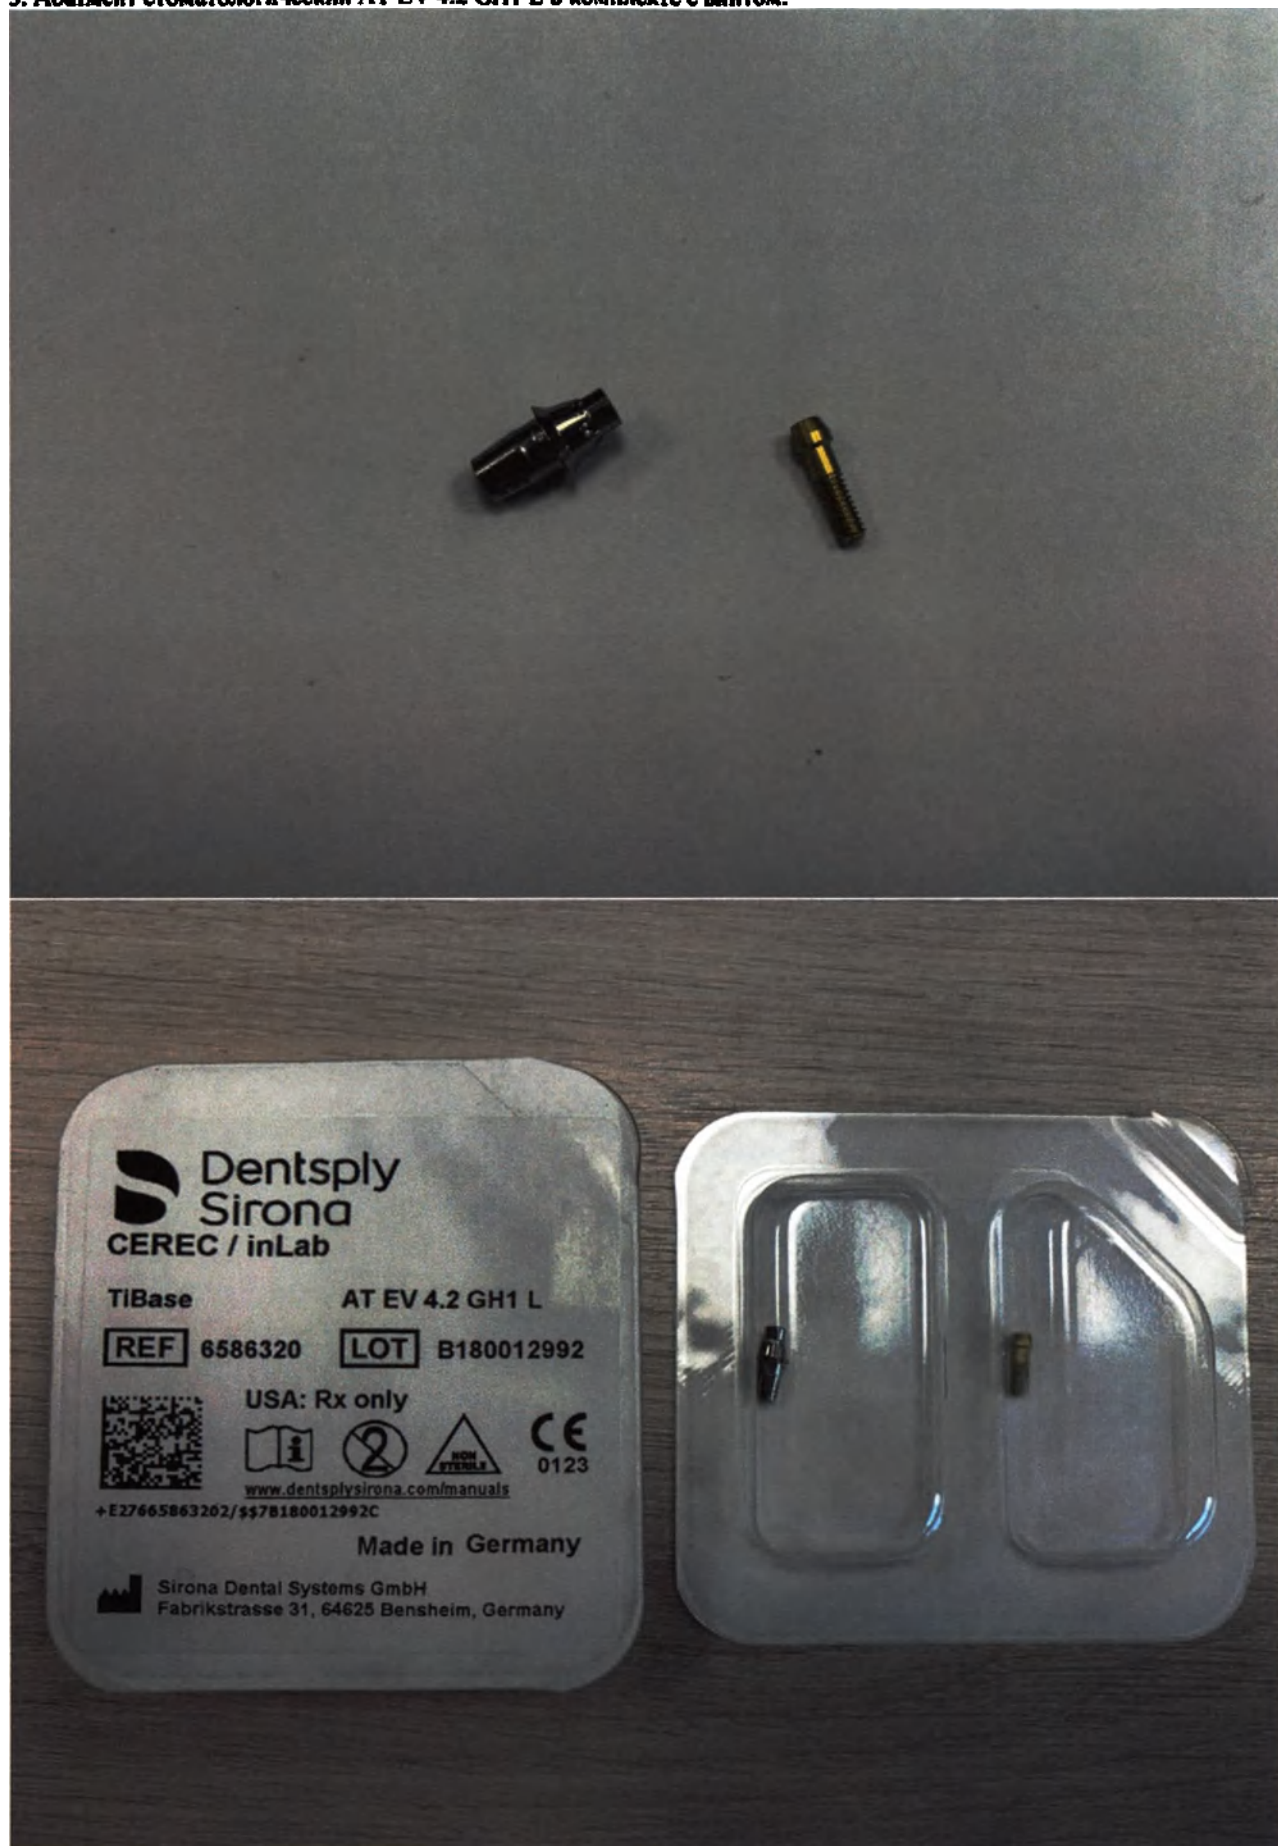

4. Абатмент стоматологический AT EV 4.8 GH1 L в комплекте с винтом.



5. Абатмент стоматологический AT EV 5.4 GH1 L в комплекте с винтом.




6. Винт для абатмента AT EV 3.0 (Abutment Screw AT EV 3.0).




7. Винт для абатмента AT EV 3.6 (Abutment Screw AT EV 3.6).



8. Винт для абатмента АТ EV 4.2 (Abutment Screw AT EV 4.2).

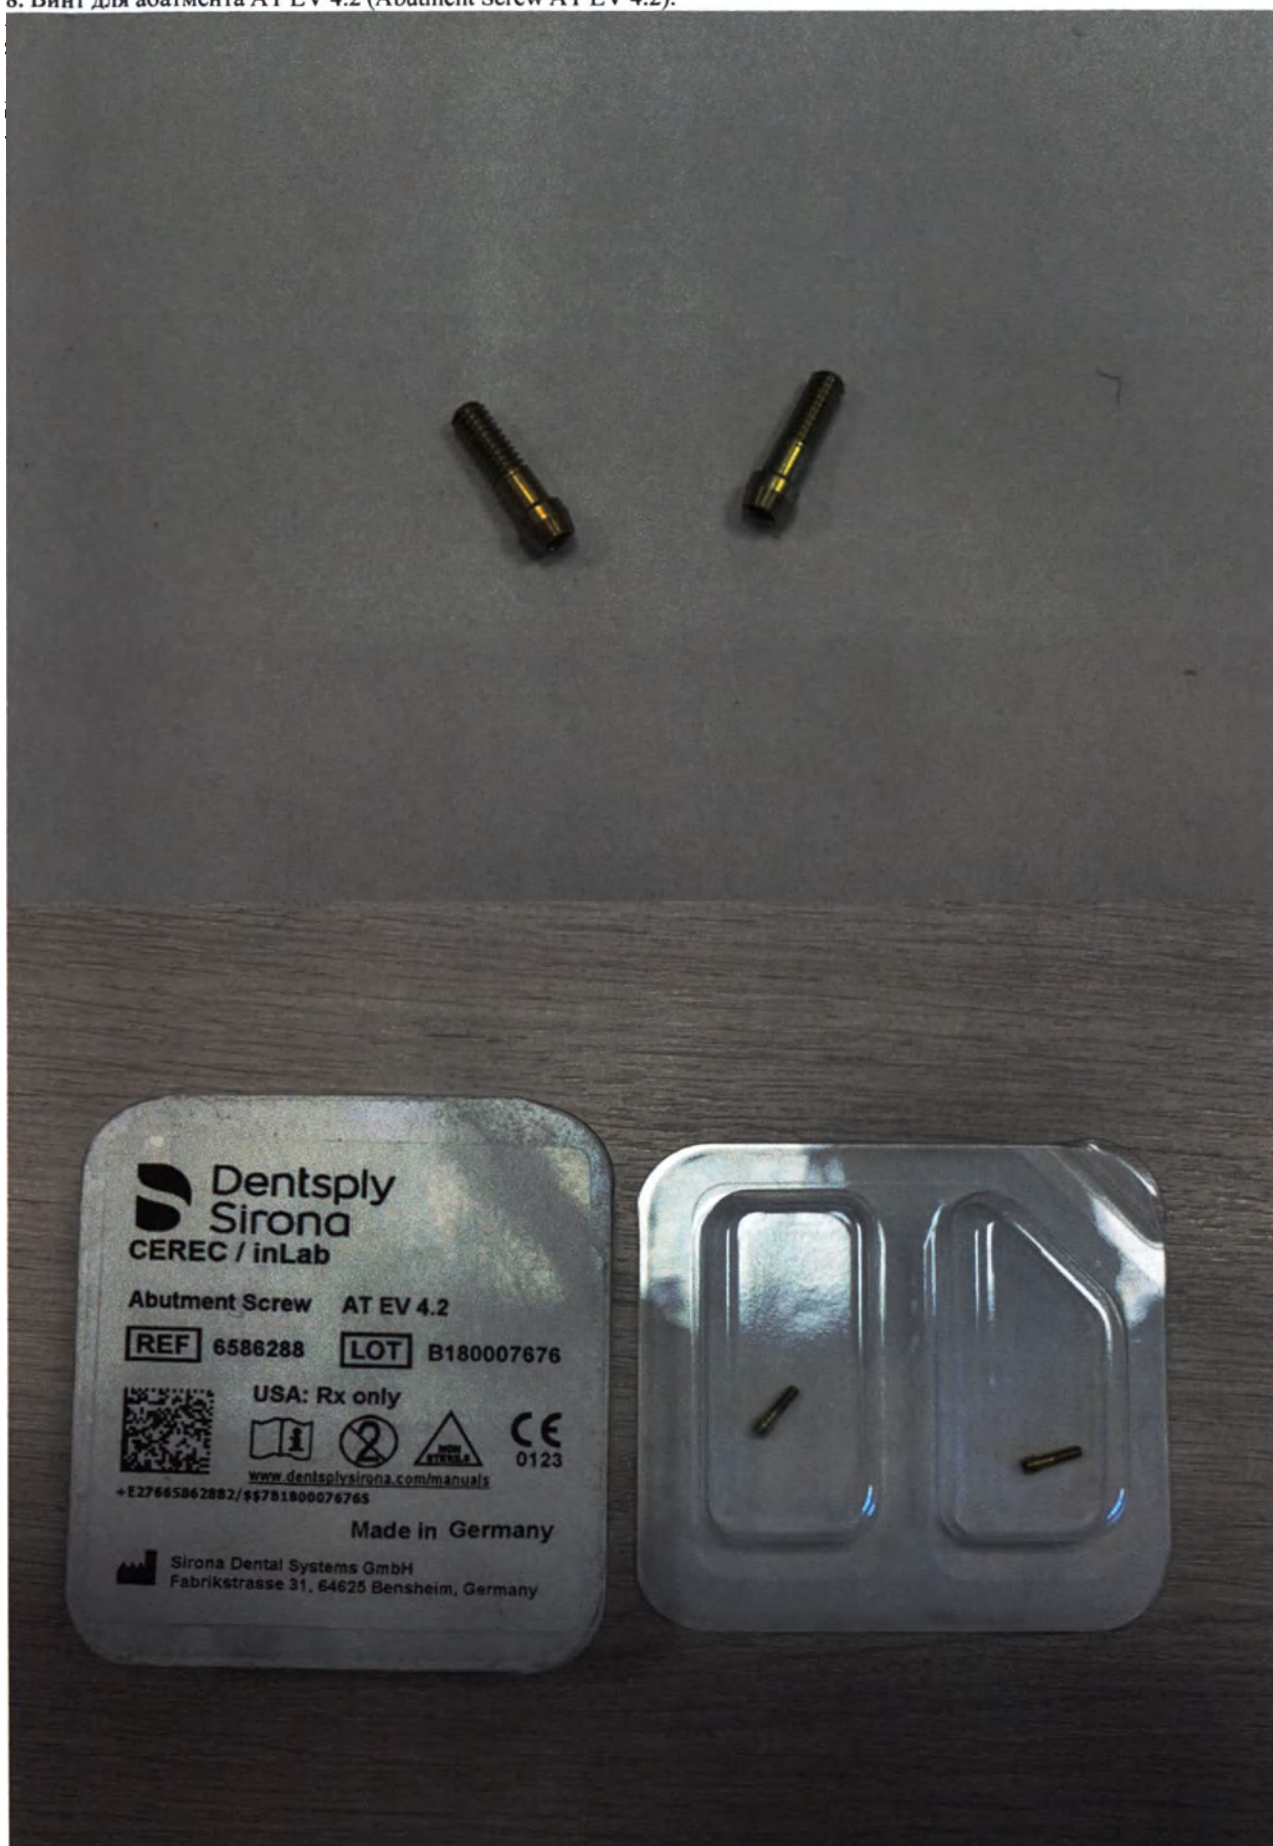


9. Винт для абатмента AT EV 4.8 (Abutment Screw AT EV 4.8).

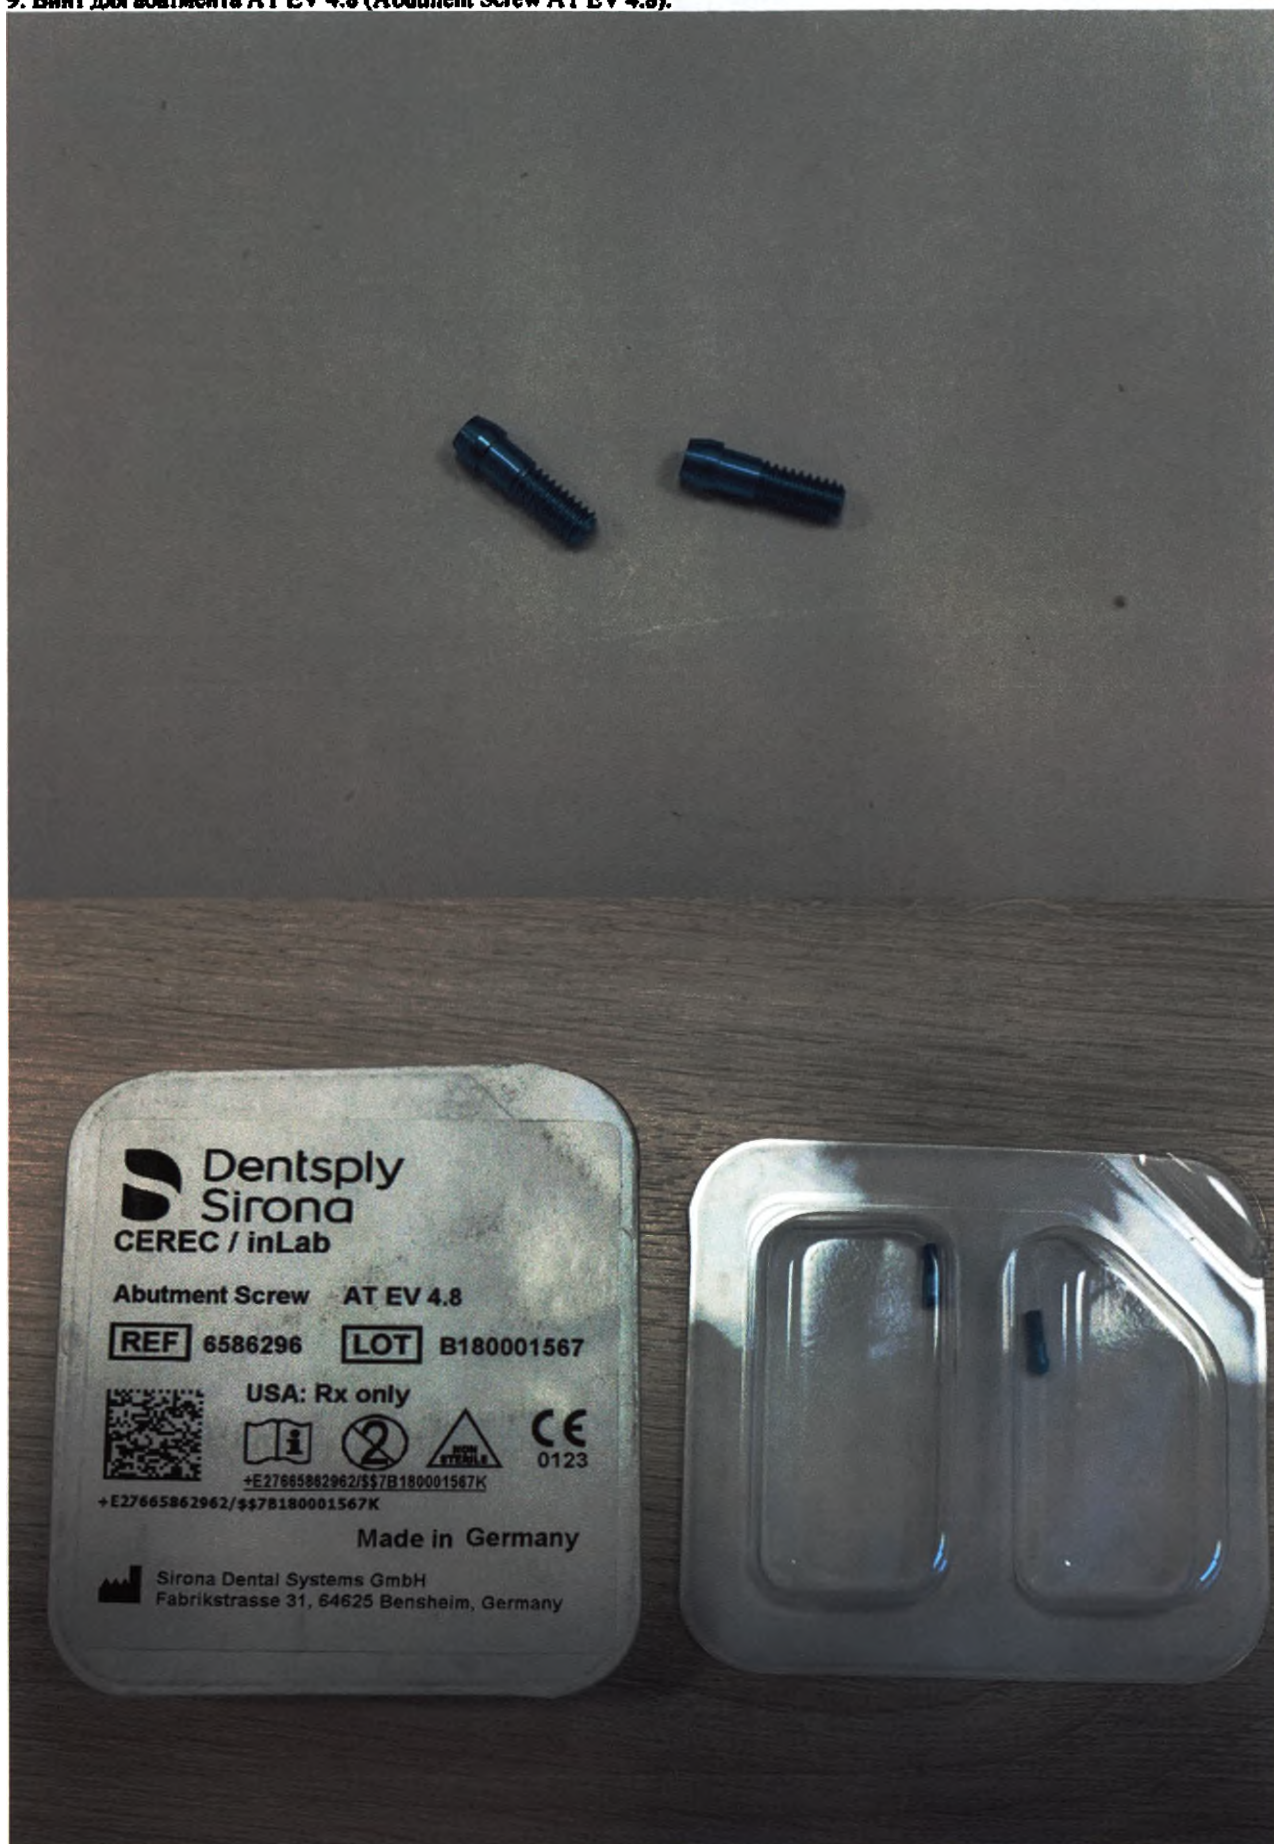

10. Винт для абатмента AT EV 5.4 (Abutment Screw AT EV 5.4).



11. Аналог абатмента ScanPost AT EV 3.0 S в комплекте с винтом.

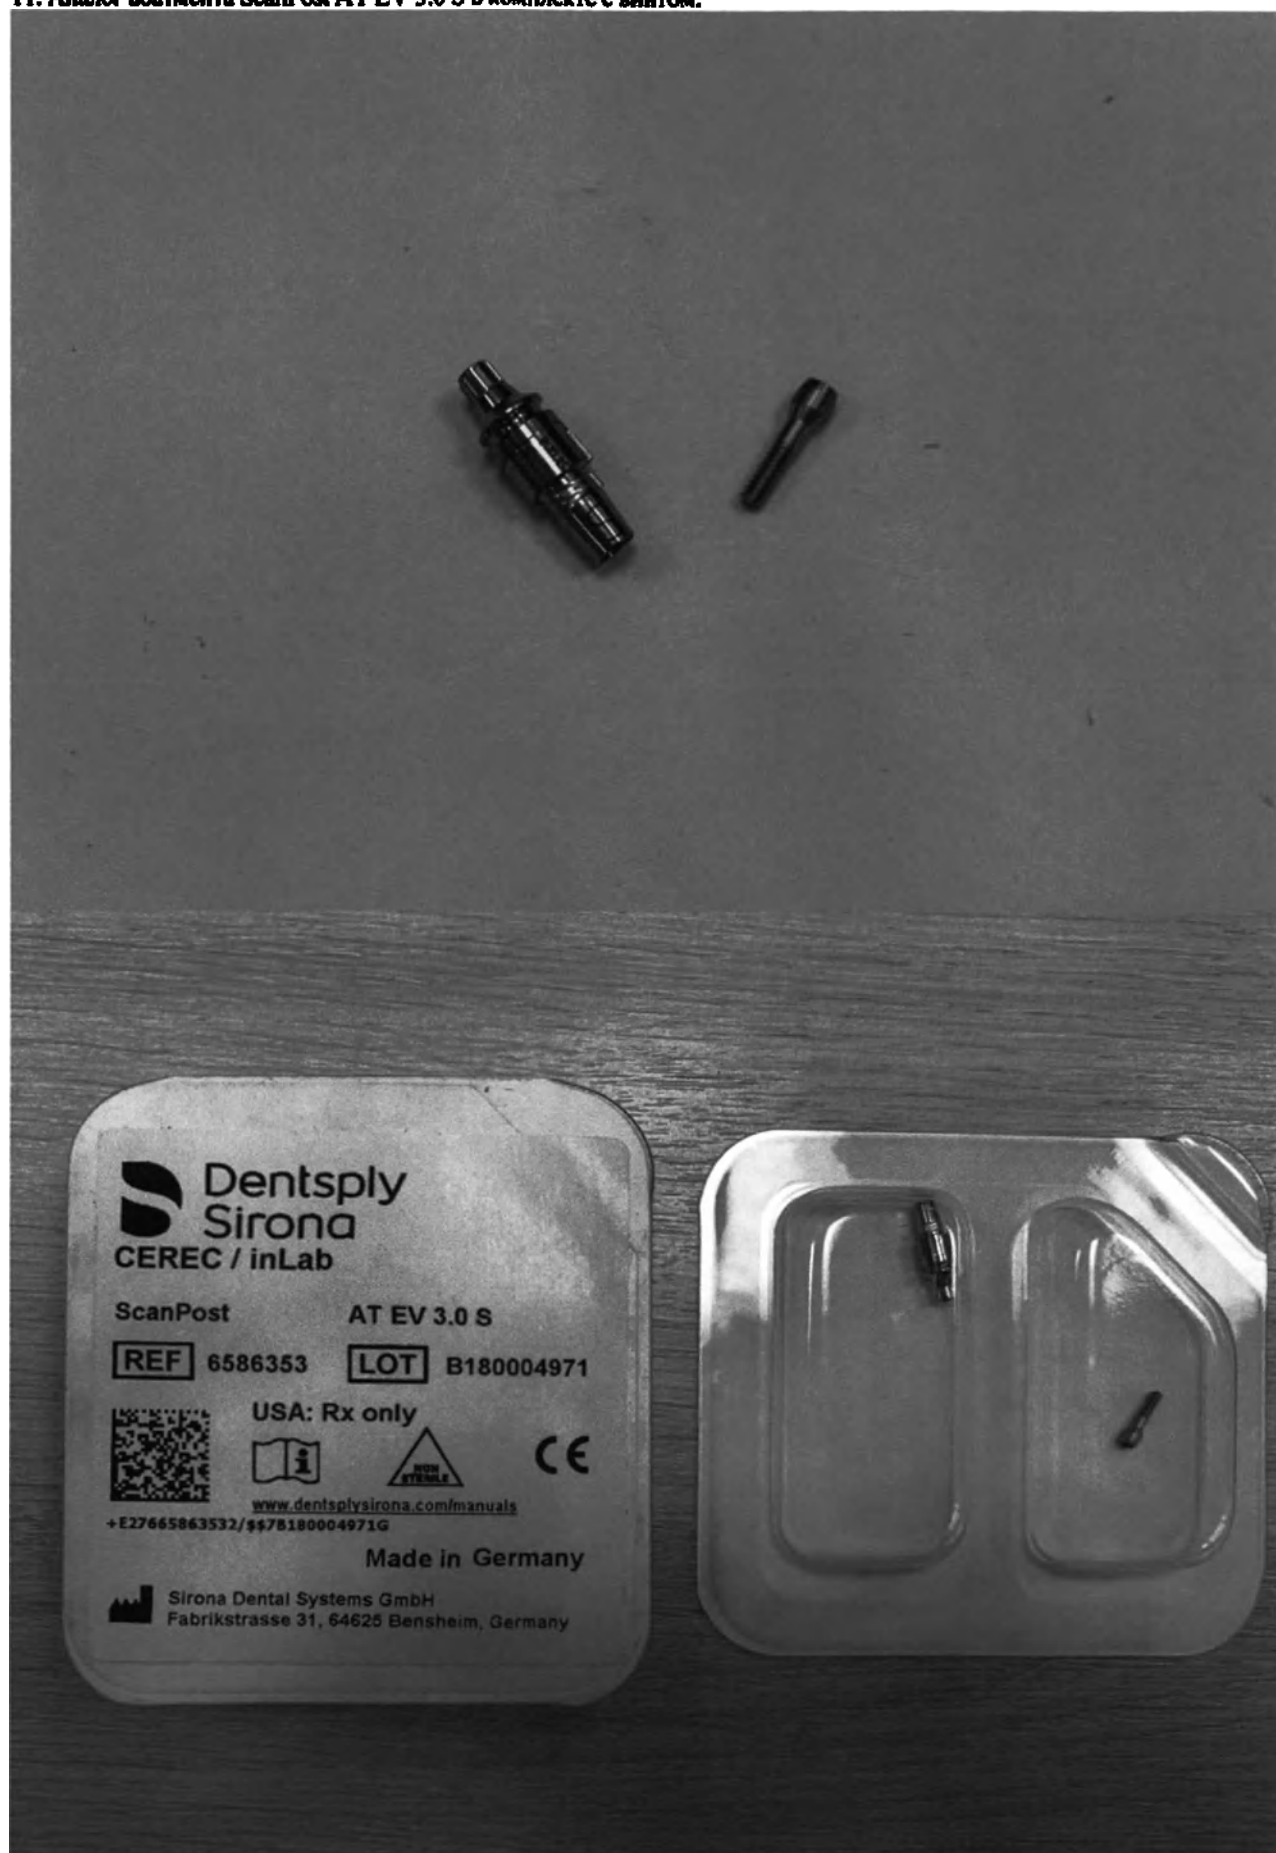

12. Аналог абатмента ScanPost AT EV 3.6 S в комплекте с винтом.



13. Аналог абатмента ScanPost AT EV 4.2 L в комплекте с винтом.




14. Аналог абатмента ScanPost AT EV 4.8 L в комплекте с винтом.



15. Аналог абетмента ScanPost AT EV 5.4 L в комплекте с винтом.



III. Компоненты ортопедические для систем дентальных имплантатов Ostem:
1. Абтмент стоматологический O TS 3.5 L в комплекте с винтом.

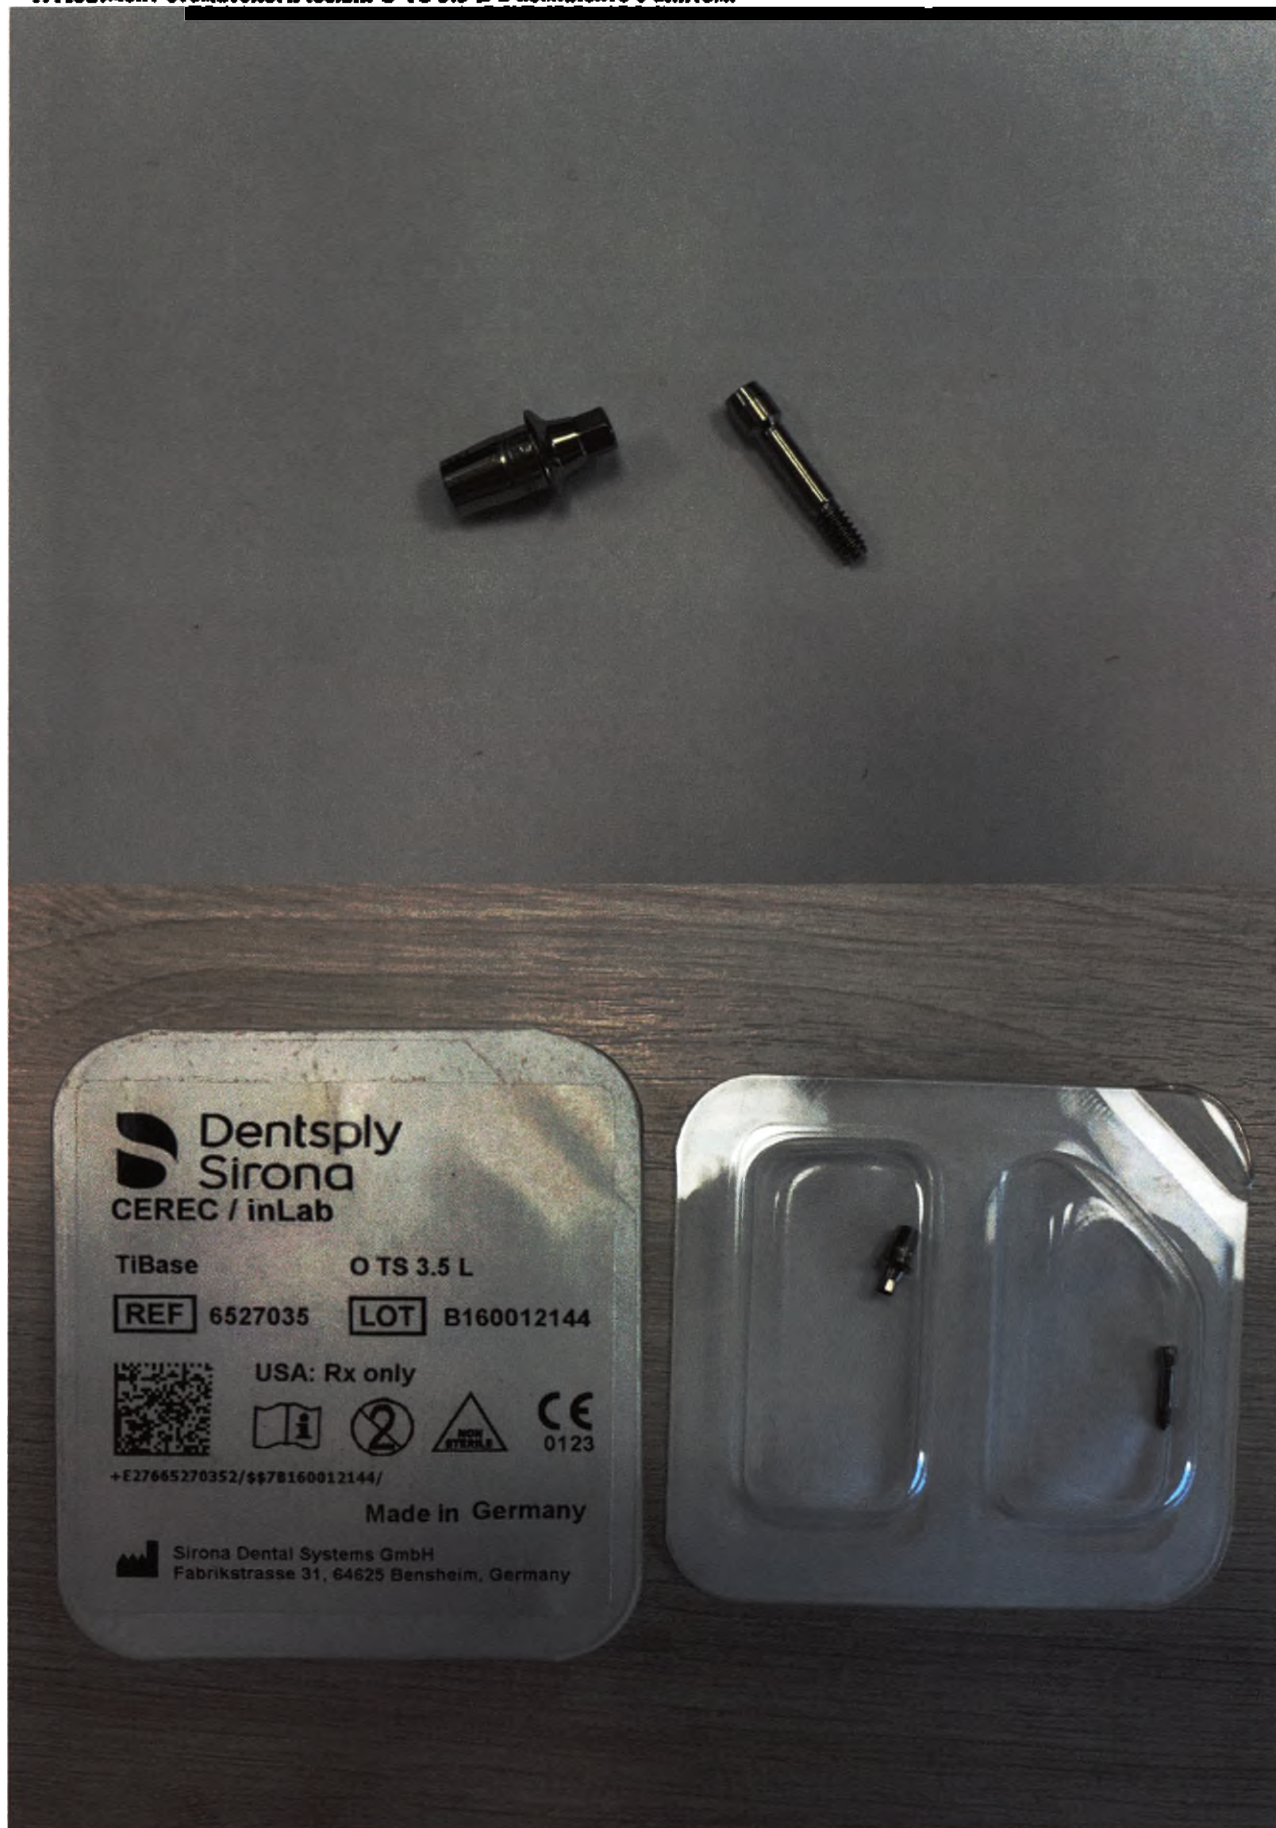

2. Абатмент стоматологический O TS 4.0 L в комплекте с винтом.



3. Вит для абатмента O TS 3.5 (Abutment Screw O TS 3.5).



4. Винт для абатмента O TS 4.0 (Abutment Screw O TS 4.0).



5. Аналог абатмента ScanPost O TS 3.5 L в комплекте с винтом.



6. Аналог абатмента ScanPost O TS 4.0 L в комплекте с винтом.




IV. Компоненты ортопедические для систем дентальных имплантатов BioHorizons:


1. Абатмент стоматологический BH 3.0 S в комплекте с винтом.



2. Абатмент стоматологический ВН 3.5 L в комплекте с винтом.

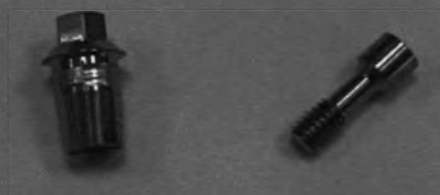

3. Абатмент стоматологический BH 4.5 L в комплекте с винтом.

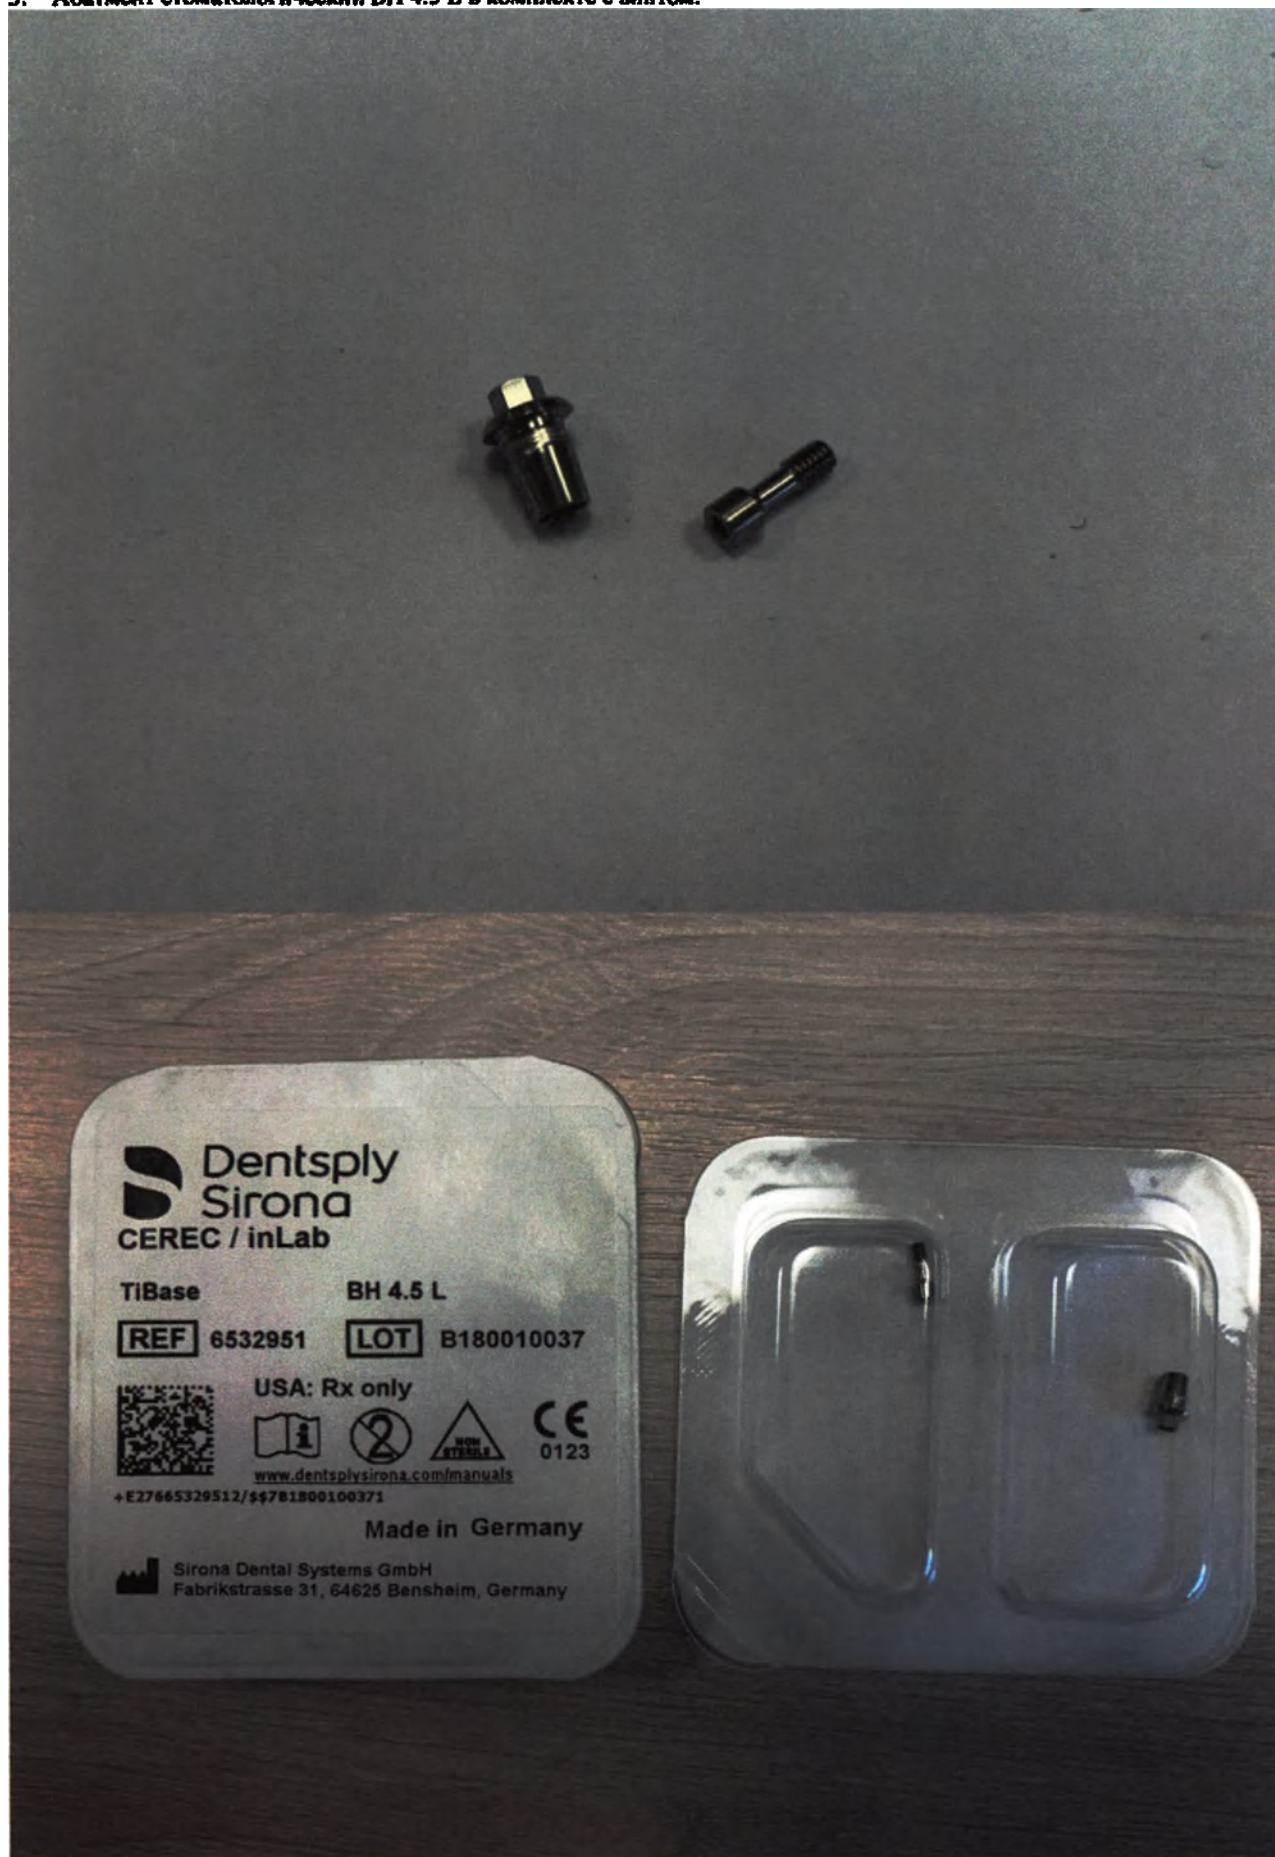

4. Абатмент стоматологический BH 5.7 L в комплекте с винтом.



5. Винт для абатмента BH 3.0 (Abutment Screw BH 3.0).



6. Винт для абатмента BH 3.5, 4.5, 5.7 (Abutment Screw BH 3.5, 4.5, 5.7).



7. Аналог абатмента ScanPost BH 3.0 S в комплекте с винтом.



8. Аналог абатмента ScanPost BH 3.5 L в комплекте с винтом.



9. Аналог абатмента ScanPost BH 4.5 L в комплекте с винтом.



10. Аналог абатмента ScanPost BH 5.7 L в комплекте с винтом.



V. Компоненты ортопедические для систем дентальных имплантатов Thommen Medical:

1. Абатмент стоматологический TM 3.5 S в комплекте с винтом.



2. Абатмент стоматологический TM 4.0 S в комплекте с винтом.



3. Абатмент стоматологический ТМ 4.5 S в комплекте с винтом.



4. Абатмент стоматологический ТМ 5.0 S в комплекте с винтом.




5. Абатмент стоматологический TM 6.0 S в комплекте с винтом.



6. Винт для абутмента ТМ 3.5 (Abutment Screw TM 3.5).



7. Винт для абатмента TM 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 (Abutment Screw TM 4.0, 4.5, 5.0, 6.0).

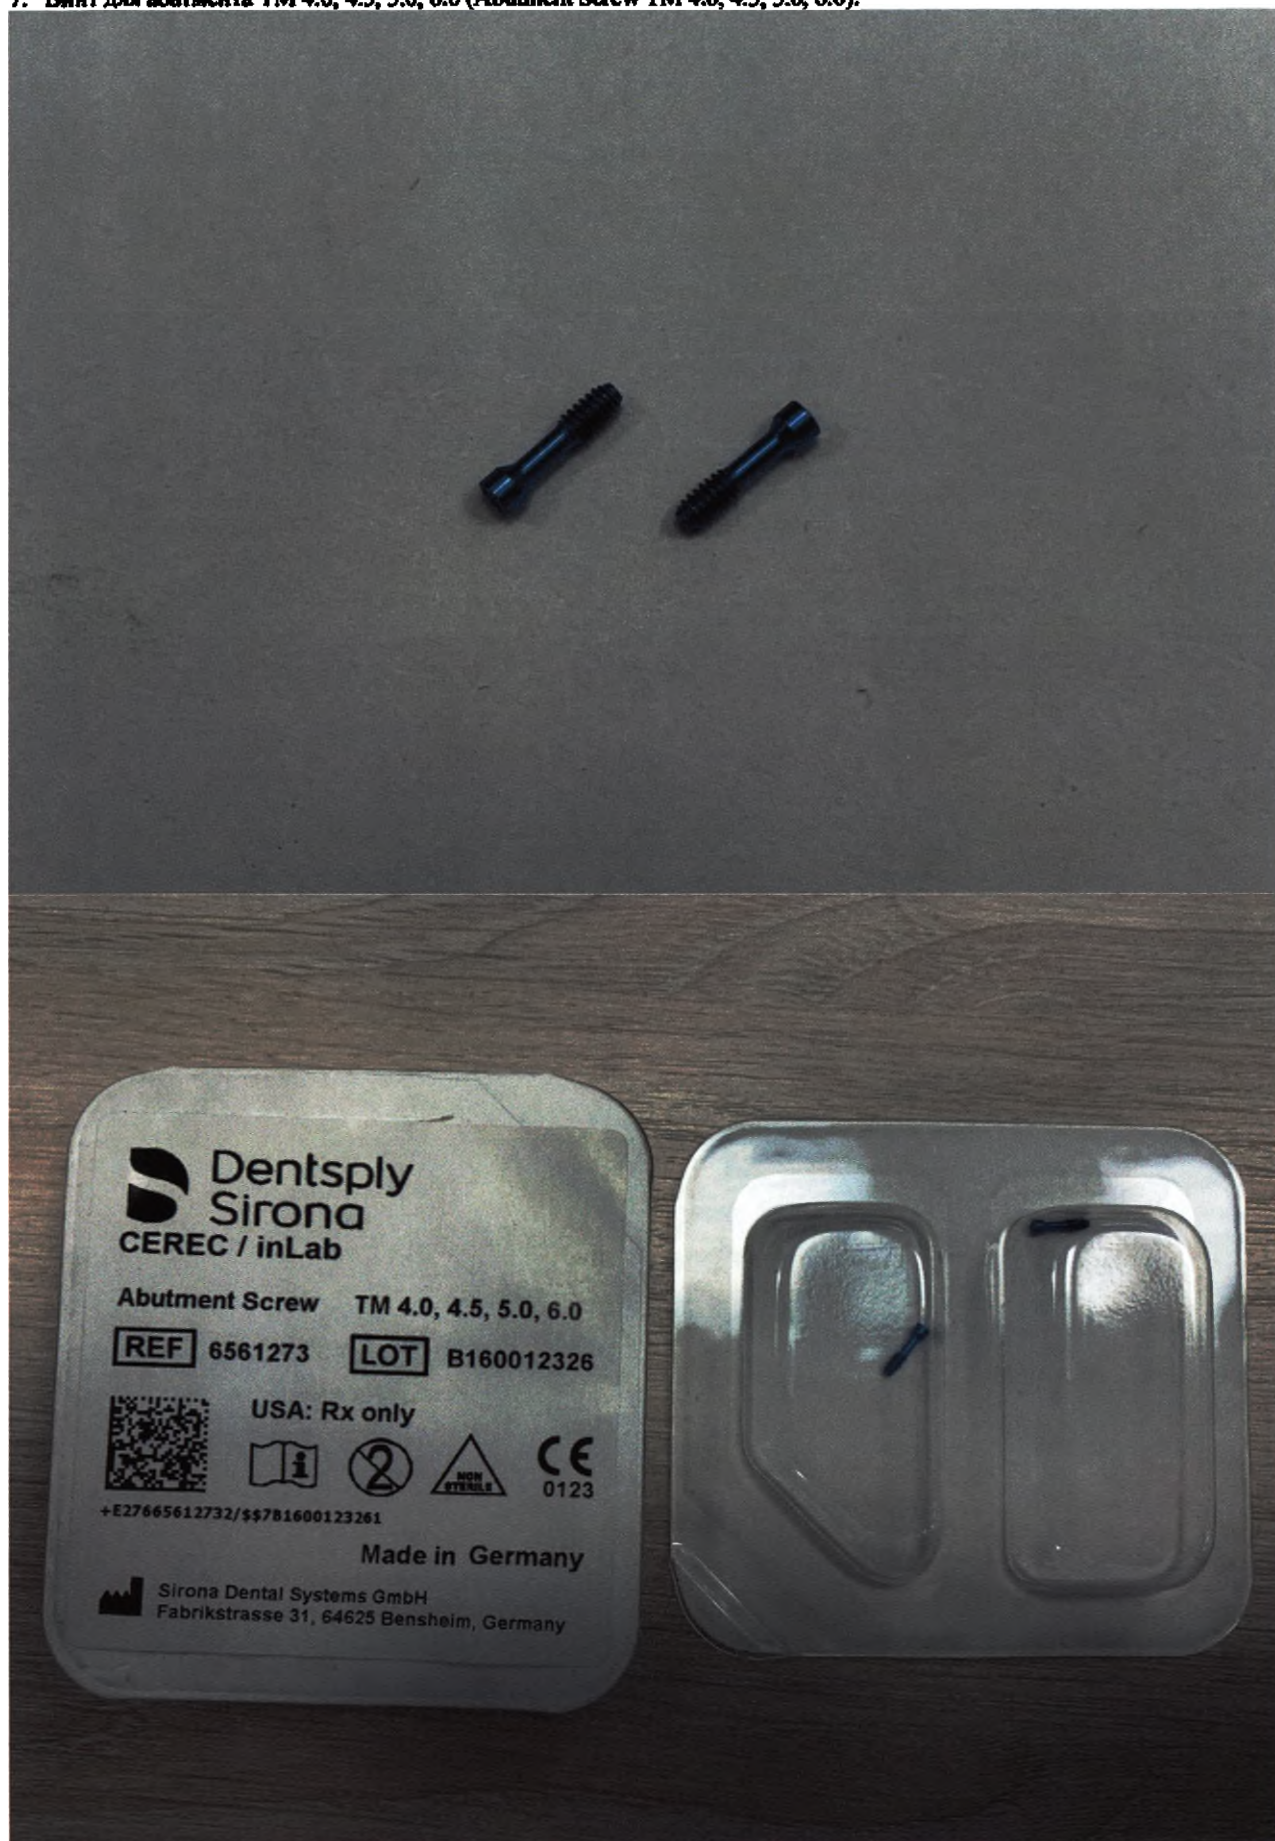

8. Аналог абатмента ScanPost TM 3.5 S в комплекте с винтом.



9. Аналог абатмента ScanPost TM 4.0 S в комплекте с винтом.



10. Аналог абатмента ScanPost TM 4.5 S в комплекте с винтом.



11. Аналог абатмента ScanPost TM 5.0 S в комплекте с винтом.



12. Аналог абатмента ScanPost TM 6.0 S в комплекте с винтом.



Действует с:

08.2017

sirona
The Dental Company

TiBase

Инструкция по эксплуатации

Русский

This product is covered by one or more of the following US patents:

- US7901209




Действует с: 06.2017

sirona.
The Dental Company

ScanPost

Инструкция по эксплуатации


Русский

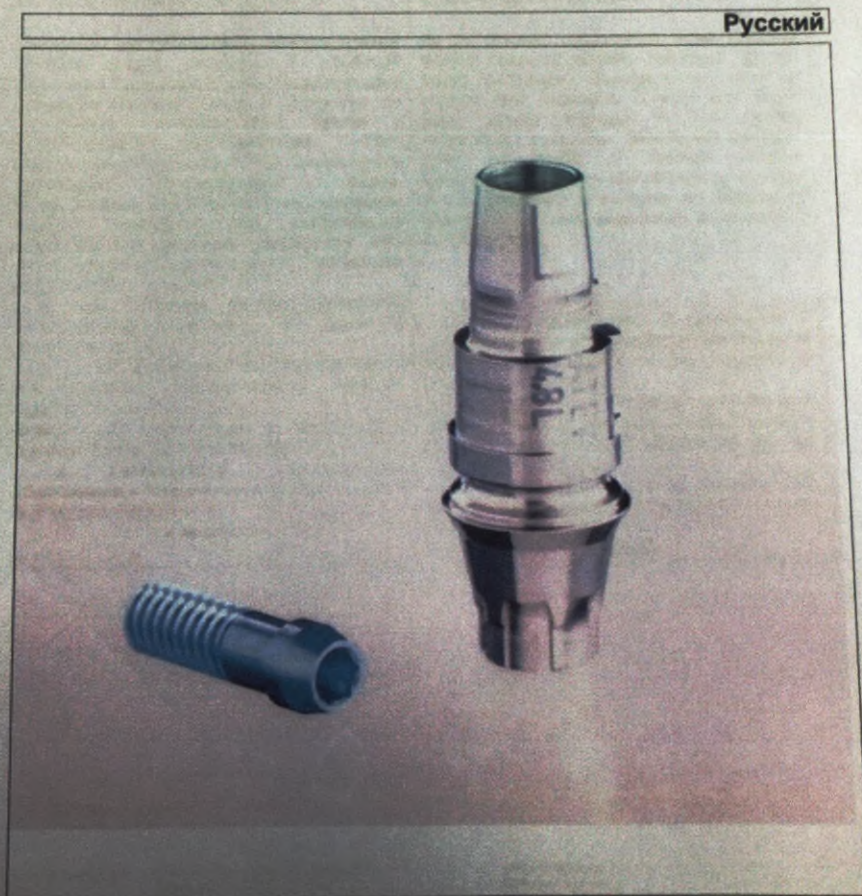

Генеральный директор

(Handwritten signature)
(подпись)

К.Г. Левин

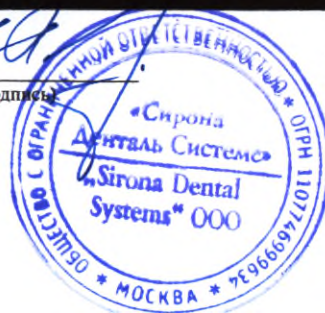



Синто
Генеральный директор
ООО «Сирона Денталь Системс»
Левин К.Г.

27

листа(ов)