


Иглы биопсийные эндоскопические
Вариант исполнения: HBAN -1-22



HBAN-1-22
HOWELL BILIARY ASPIRATION NEEDLE

G21791

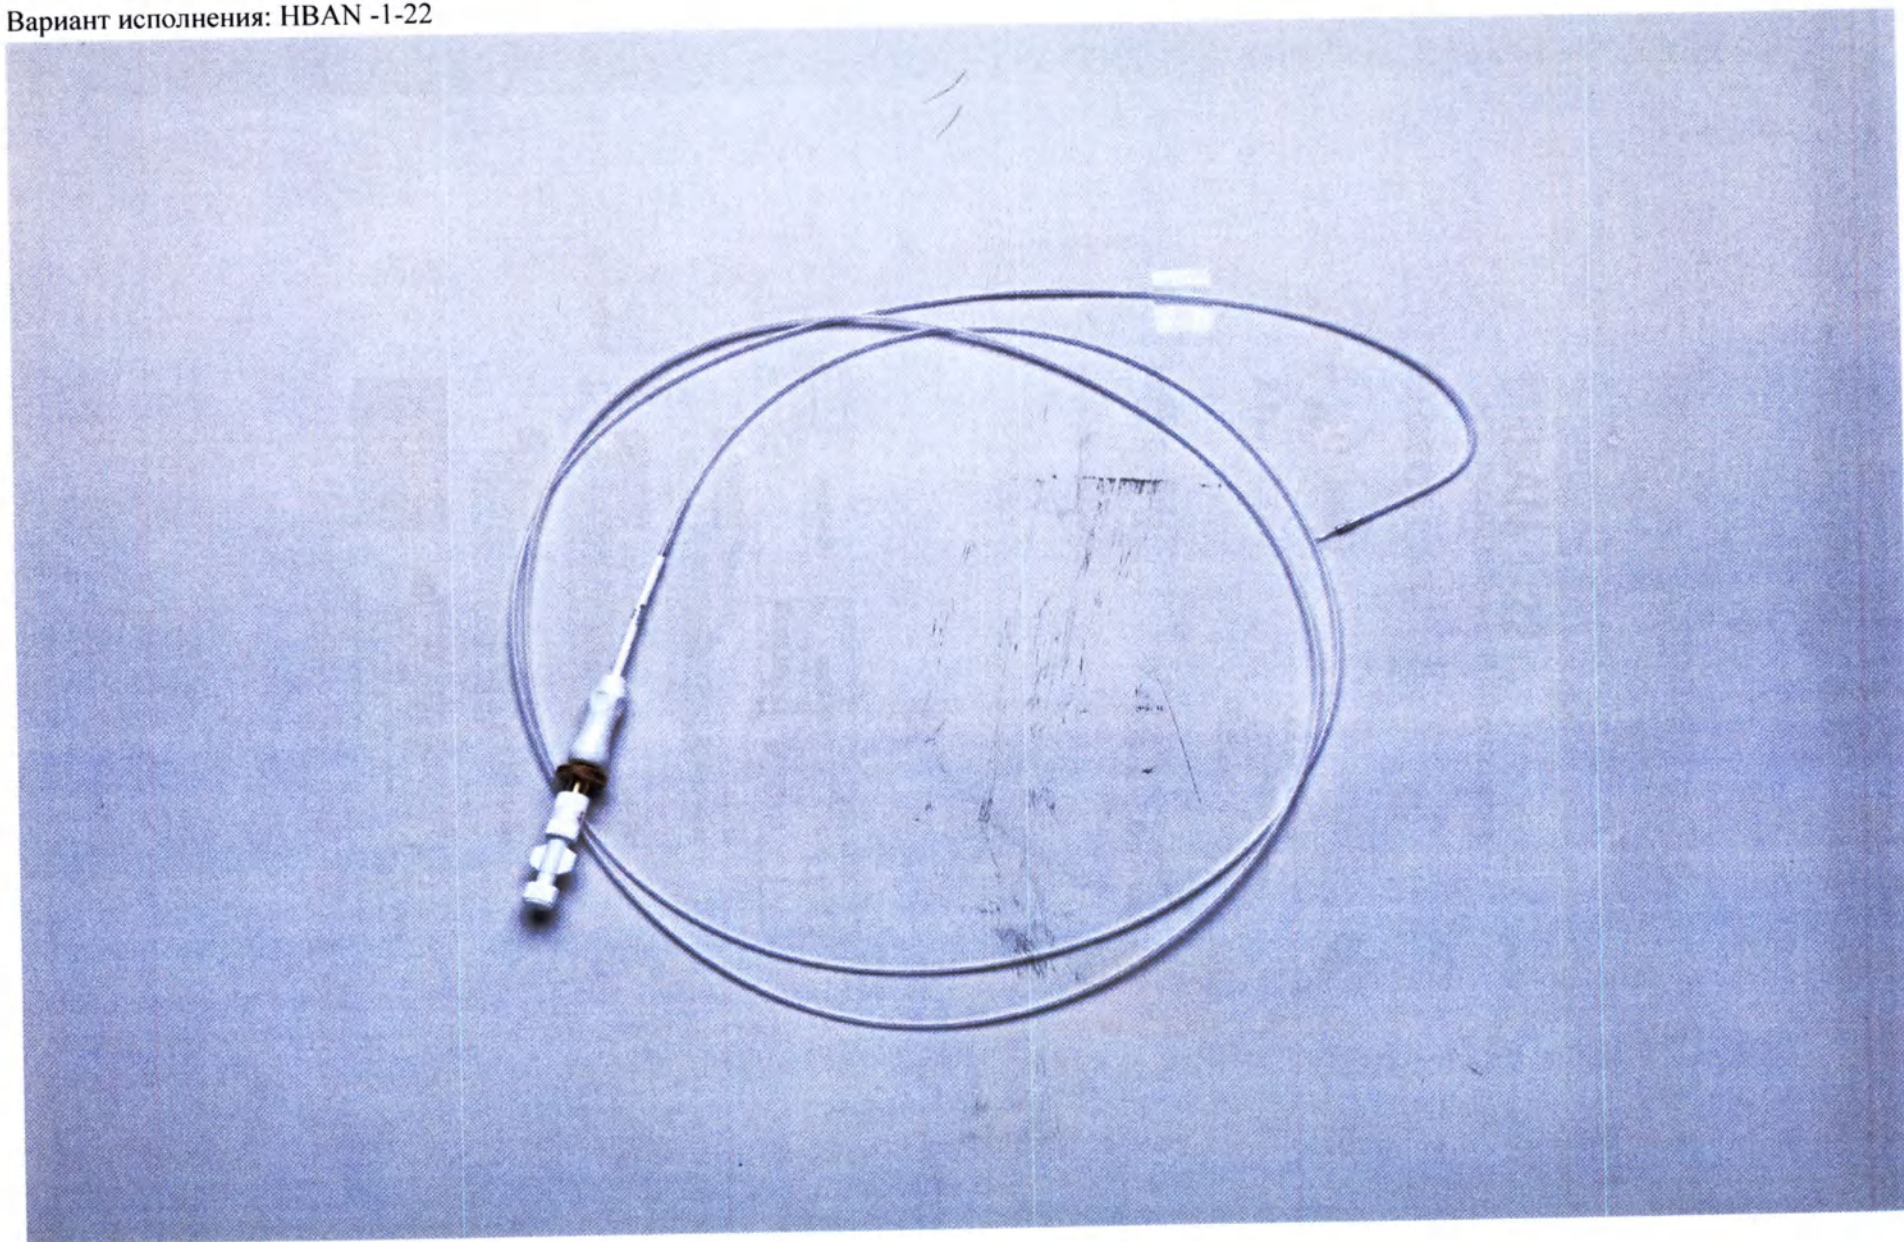

22 ga (.76 mm)

7.5 mm



DISPOSABLE - SINGLE USE ONLY

LOT	V1234667	EXP	2020-11-17	MANUFACTURE	2017-11-17
STERILE	DD	RxOnly			

SAMPLE

COOK® HBAN-1-22 G21791



COOK® HBAN-1-22 G21791



COOK® HBAN-1-22 G21791



AtCook Cook & Cook Inc.
 4000 Bannockburn Road
 Bannockburn, IL 60015-1199
 COOK, Inc. and
 CookCook Bannockburn Technology Park
 Bannockburn, IL 60015-1199
 www.cookmedical.com



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____





Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Иглы биопсийные эндоскопические

Вариант исполнения: ECHO-HD-19-C; ECHO-HD-22-C; ECHO-HD-25-C; ECHO-HD-3-20-C

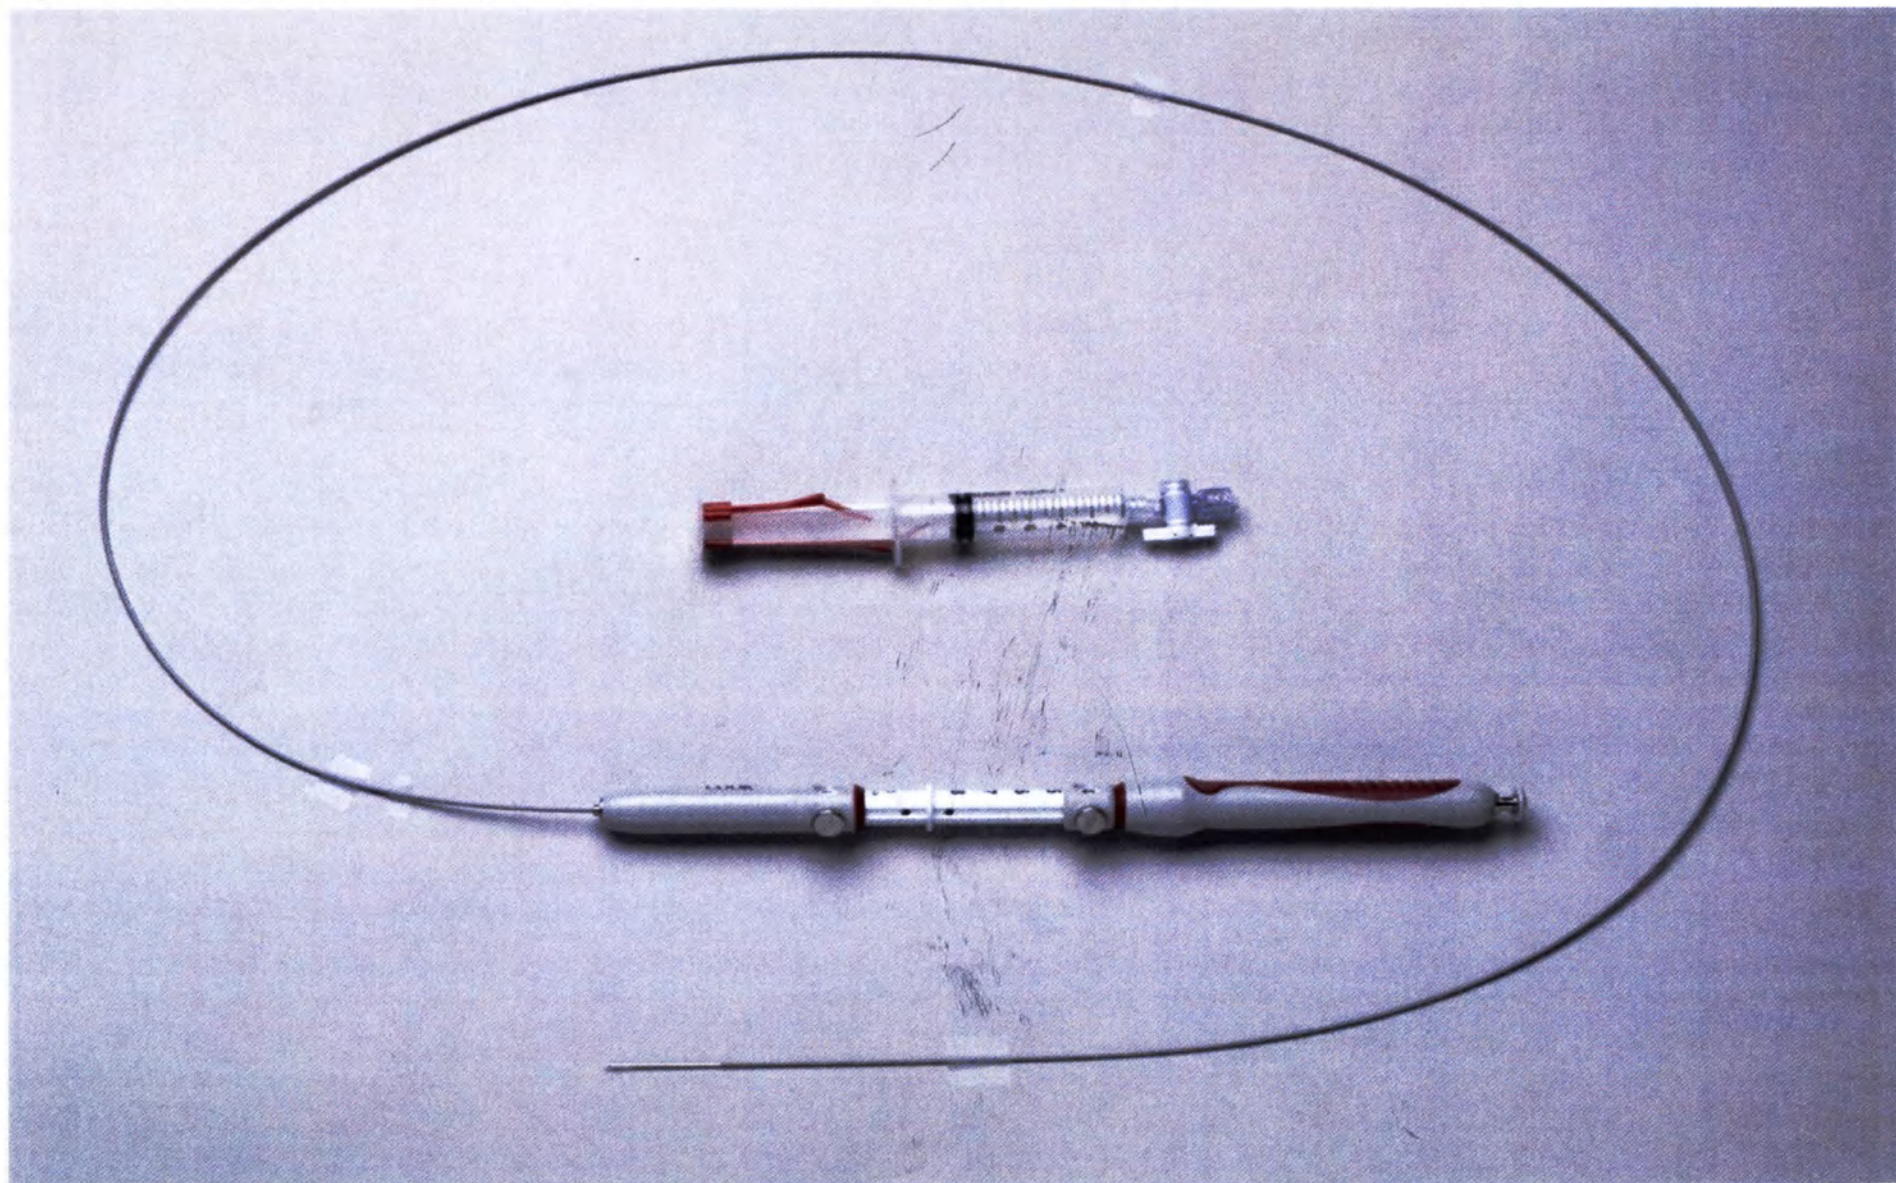

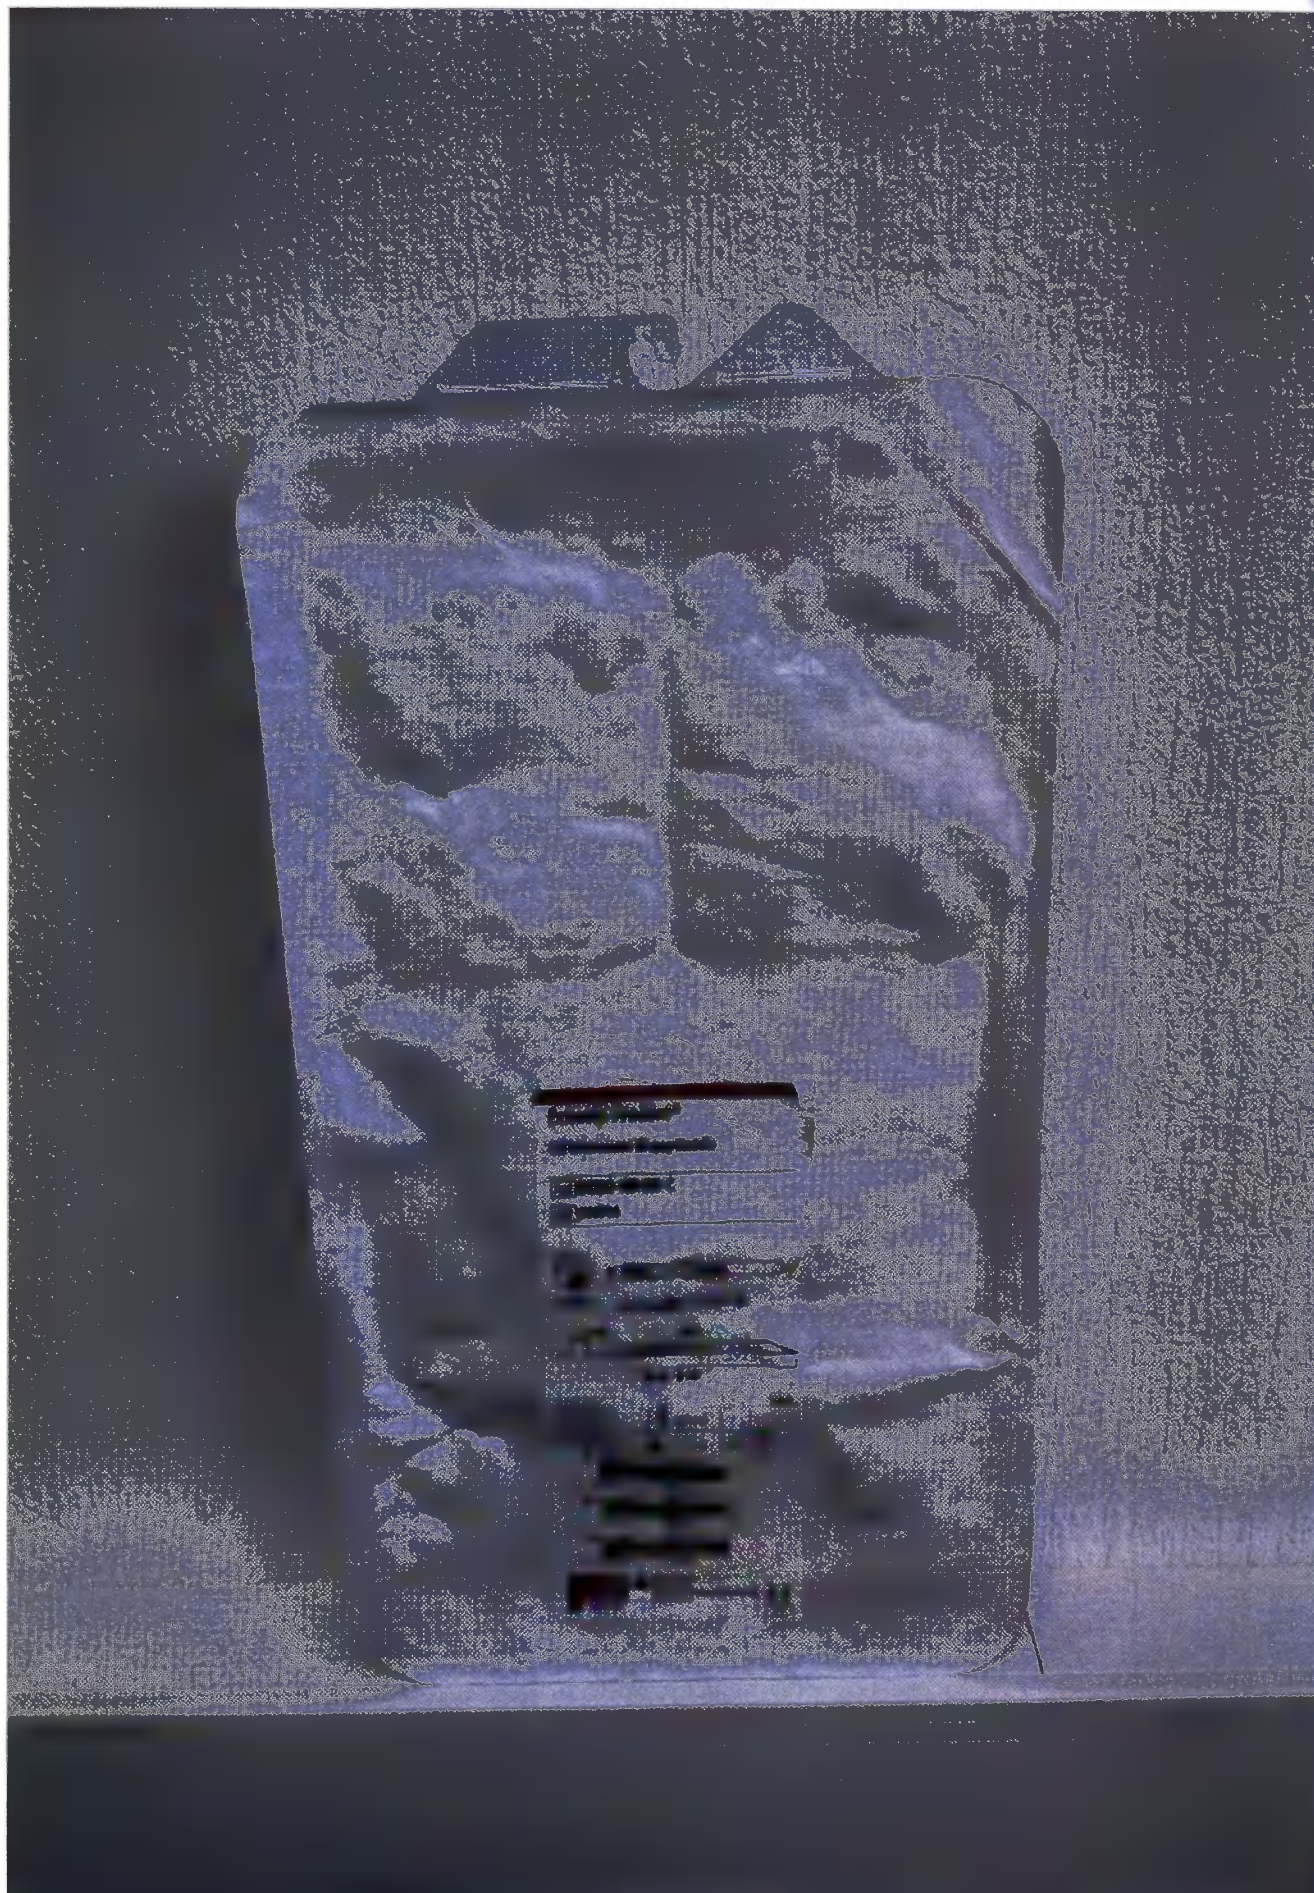

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____





Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Иглы биопсийные эндоскопические

Вариант исполнения: ECHO-19; ECHO-25; ECHO-1-22; ECHO-3-22

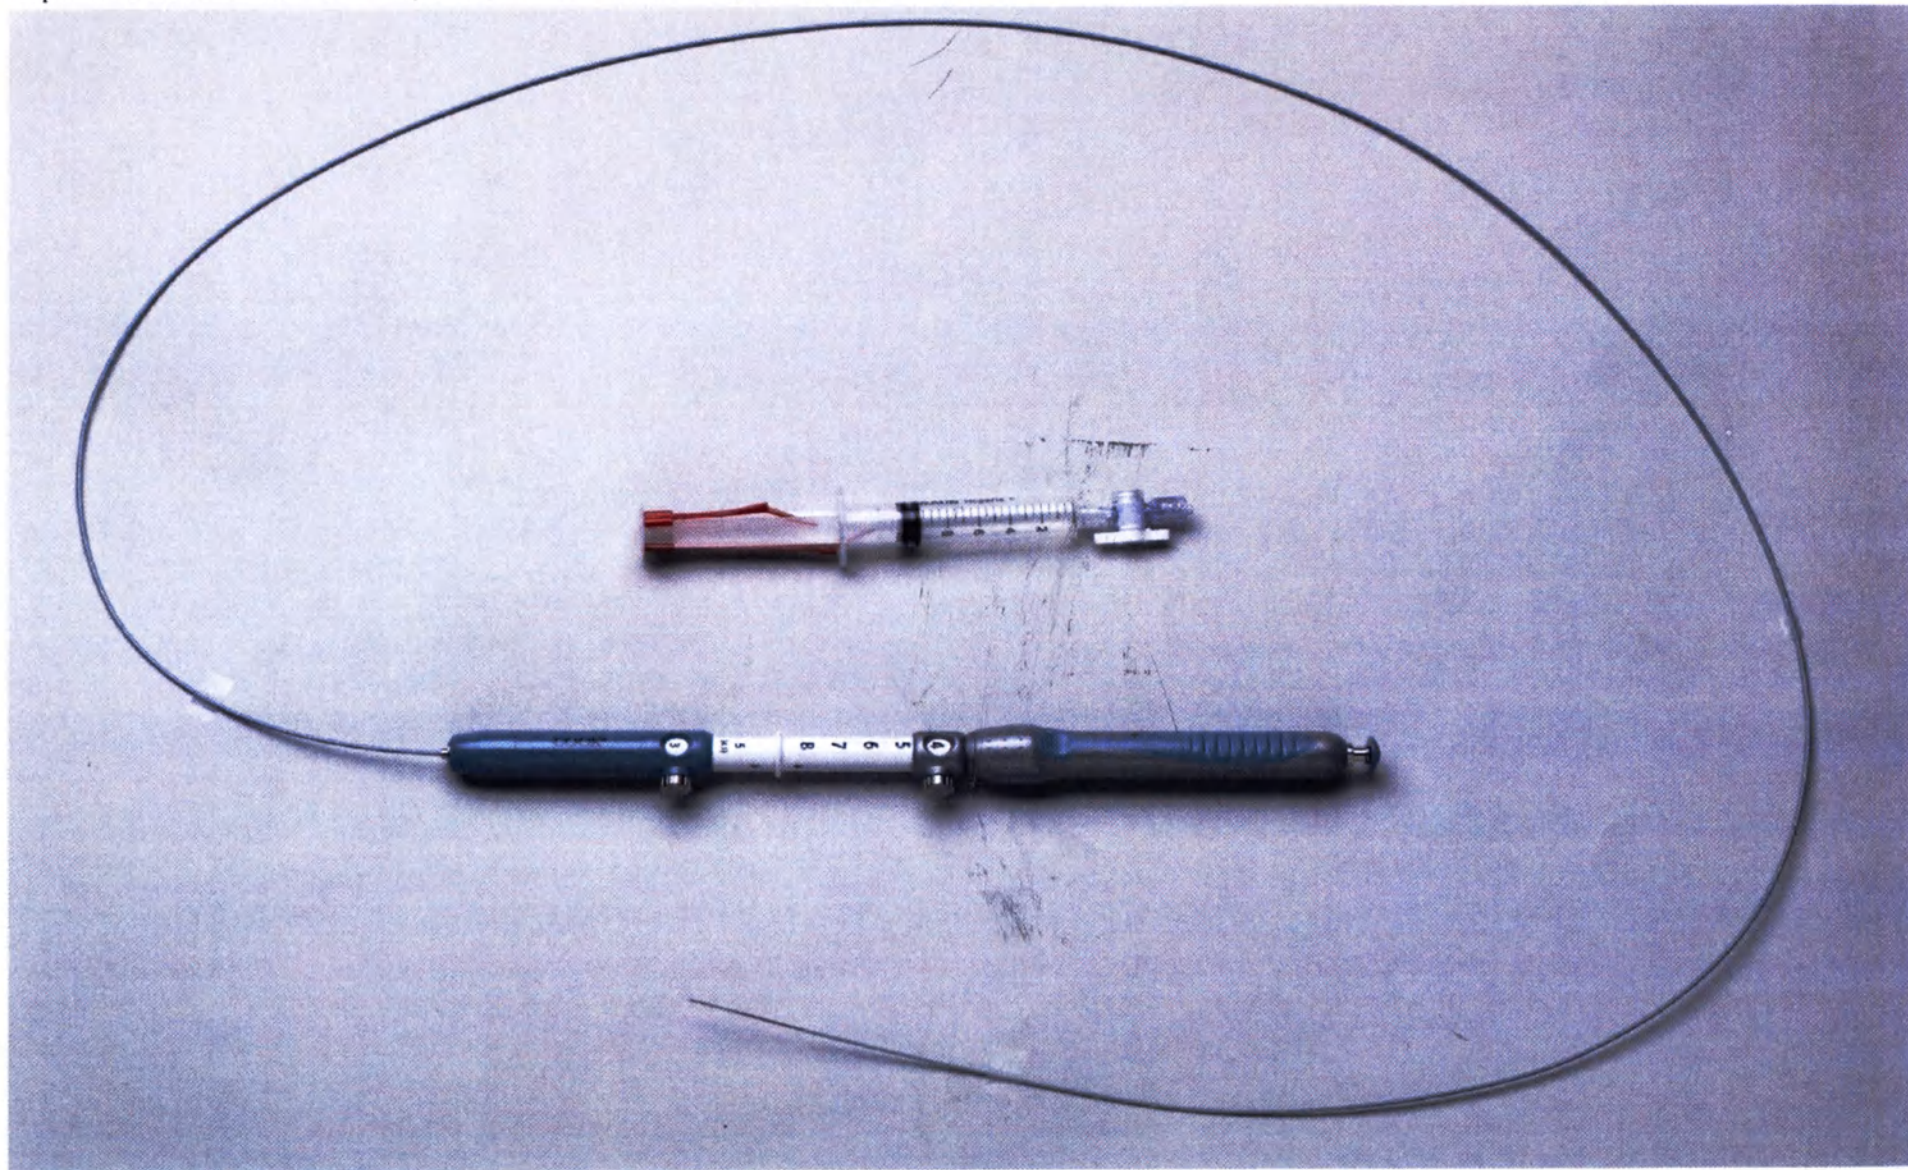

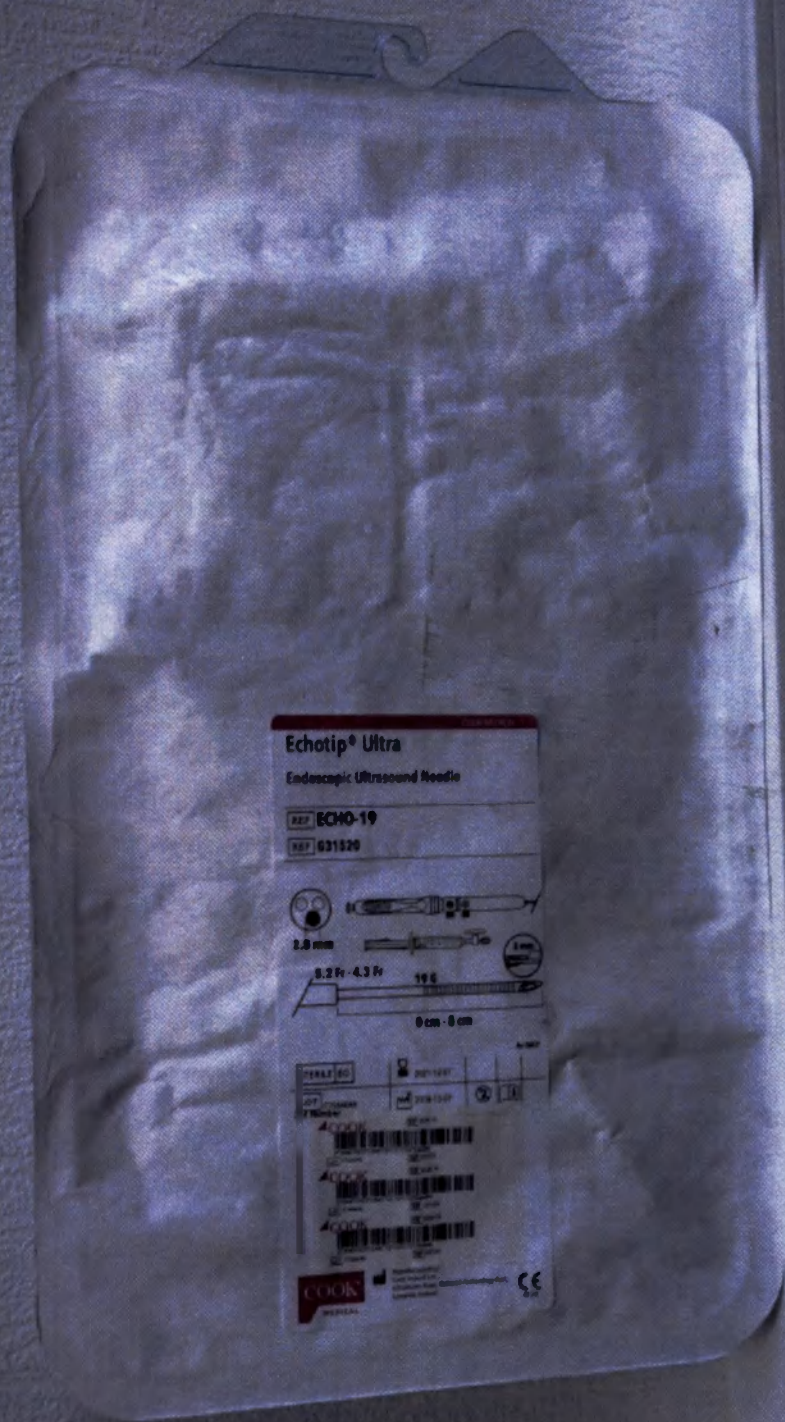

Echotip® Ultra
Endoscopic Ultrasound Needle

REF ECHO-19
REF 631520

2.0 mm
0.2 Pt - 4.3 Pt
19 G
0 cm - 8 cm

STERILE
LOT 2011201
EXP 12/14
COOK MEDICAL

CE

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование


Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____


Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09

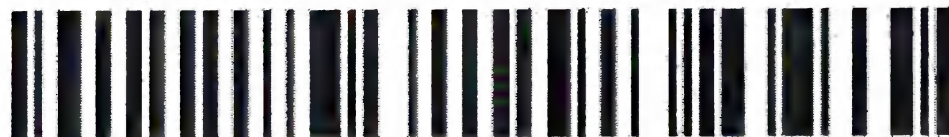

Иглы биопсийные эндоскопические
Вариант исполнения: ECHO-HD-19-A

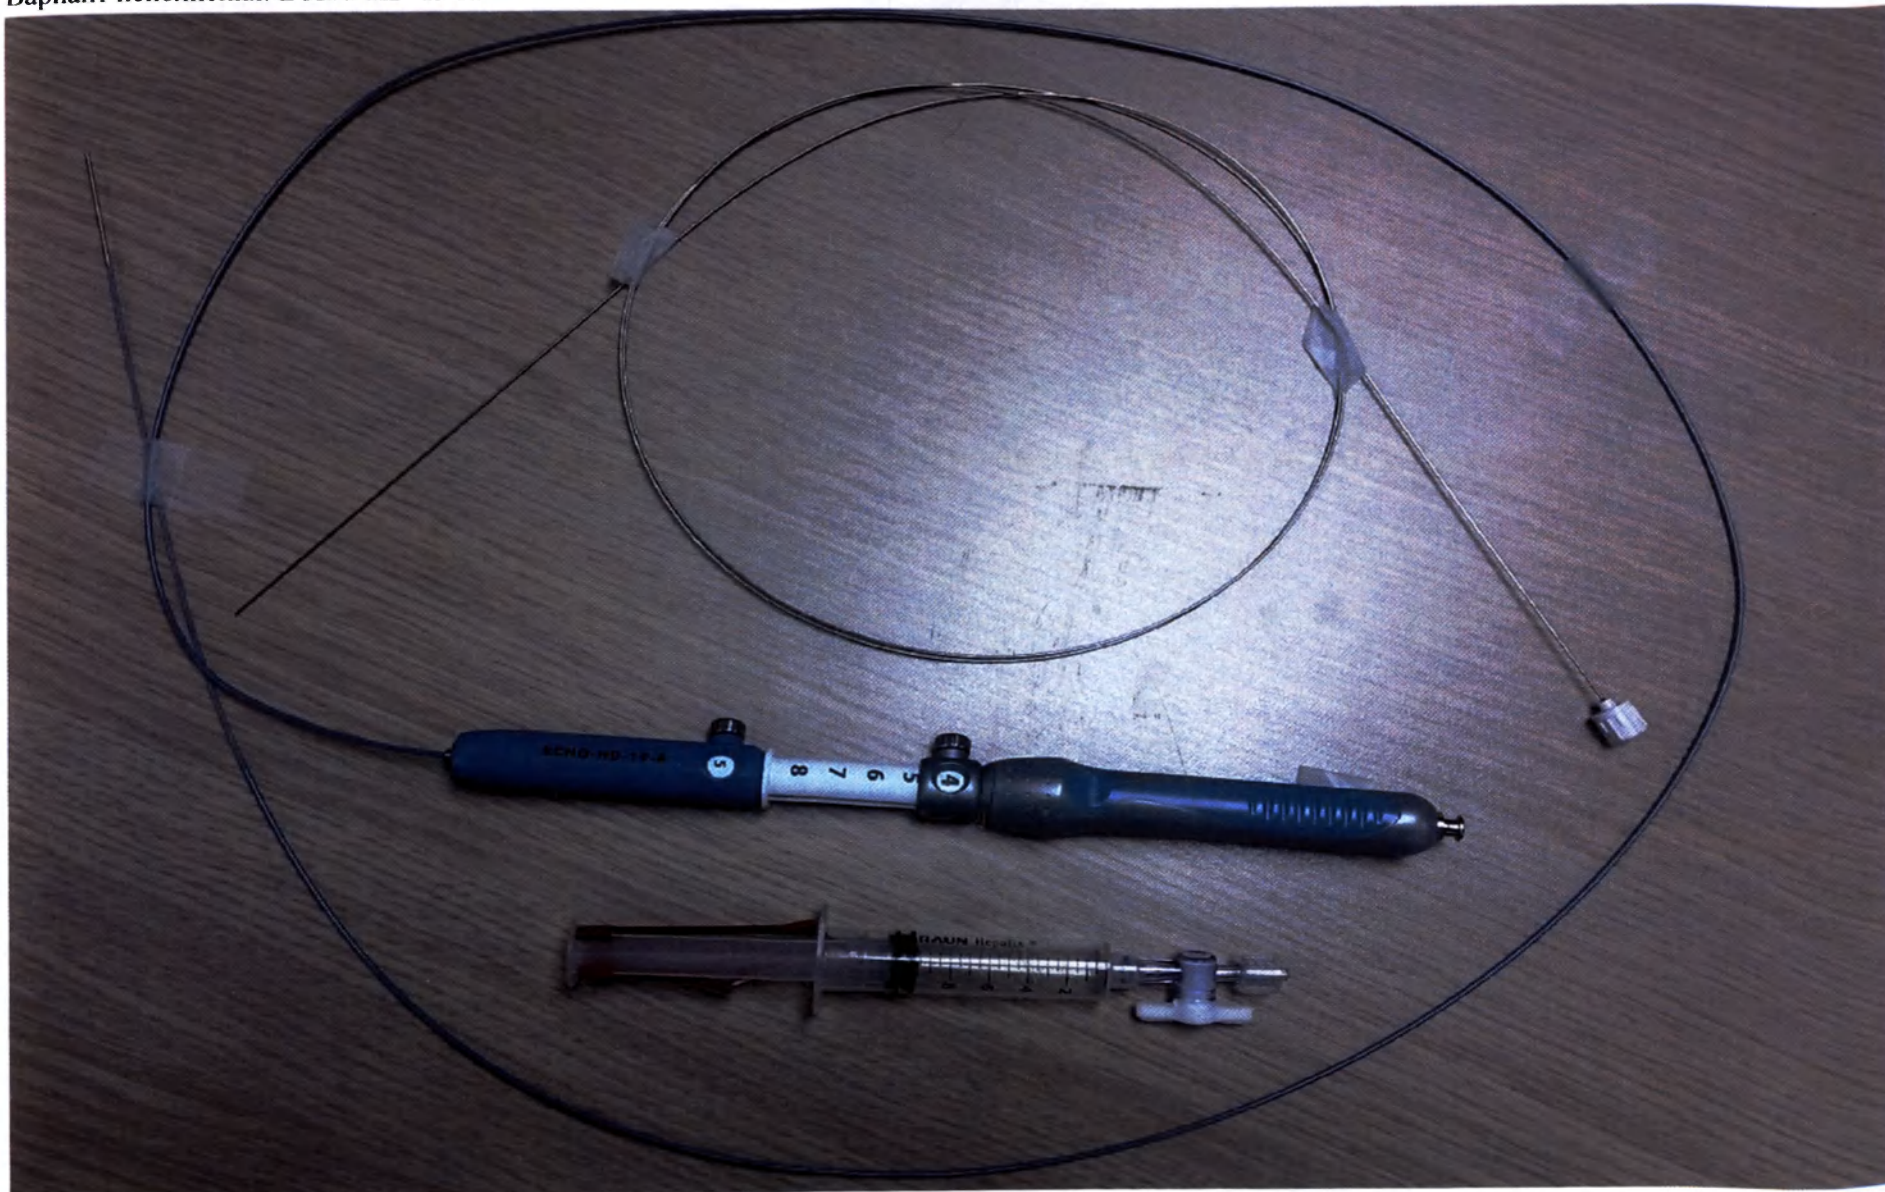

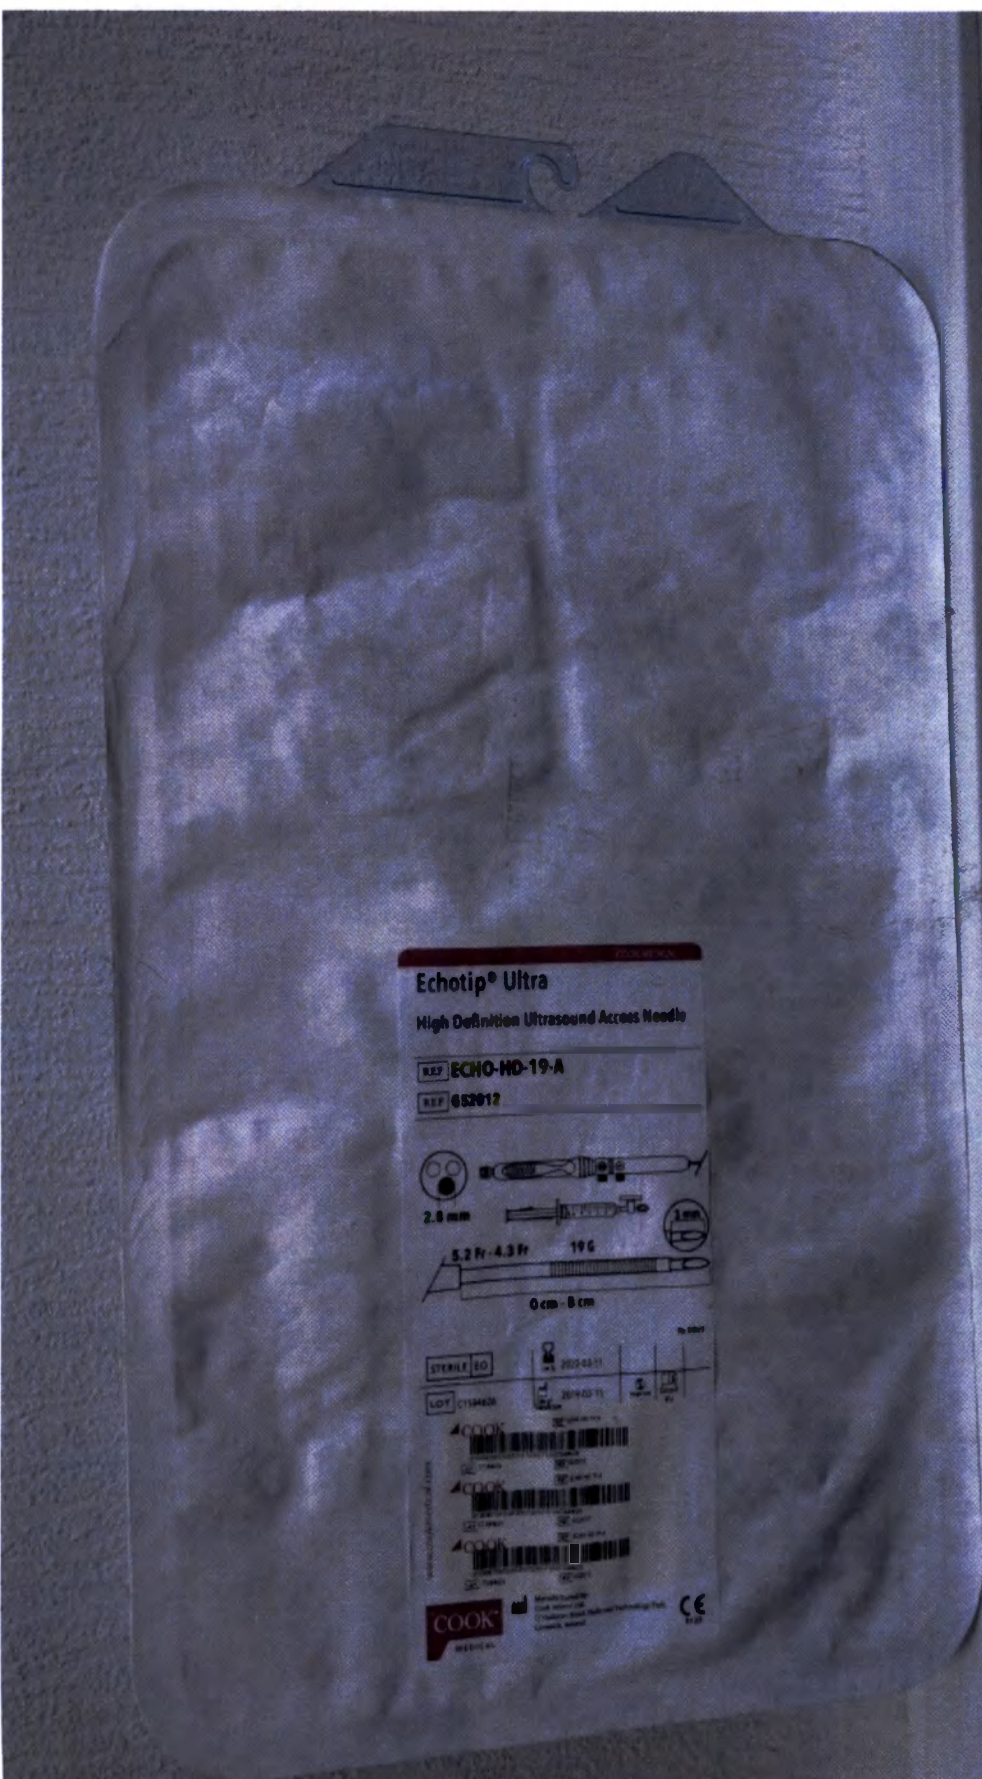

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09




Иглы биопсийные эндоскопические


Вариант исполнения: ECHO-HD-22-EBUS-O; ECHO-HD-25-EBUS-O

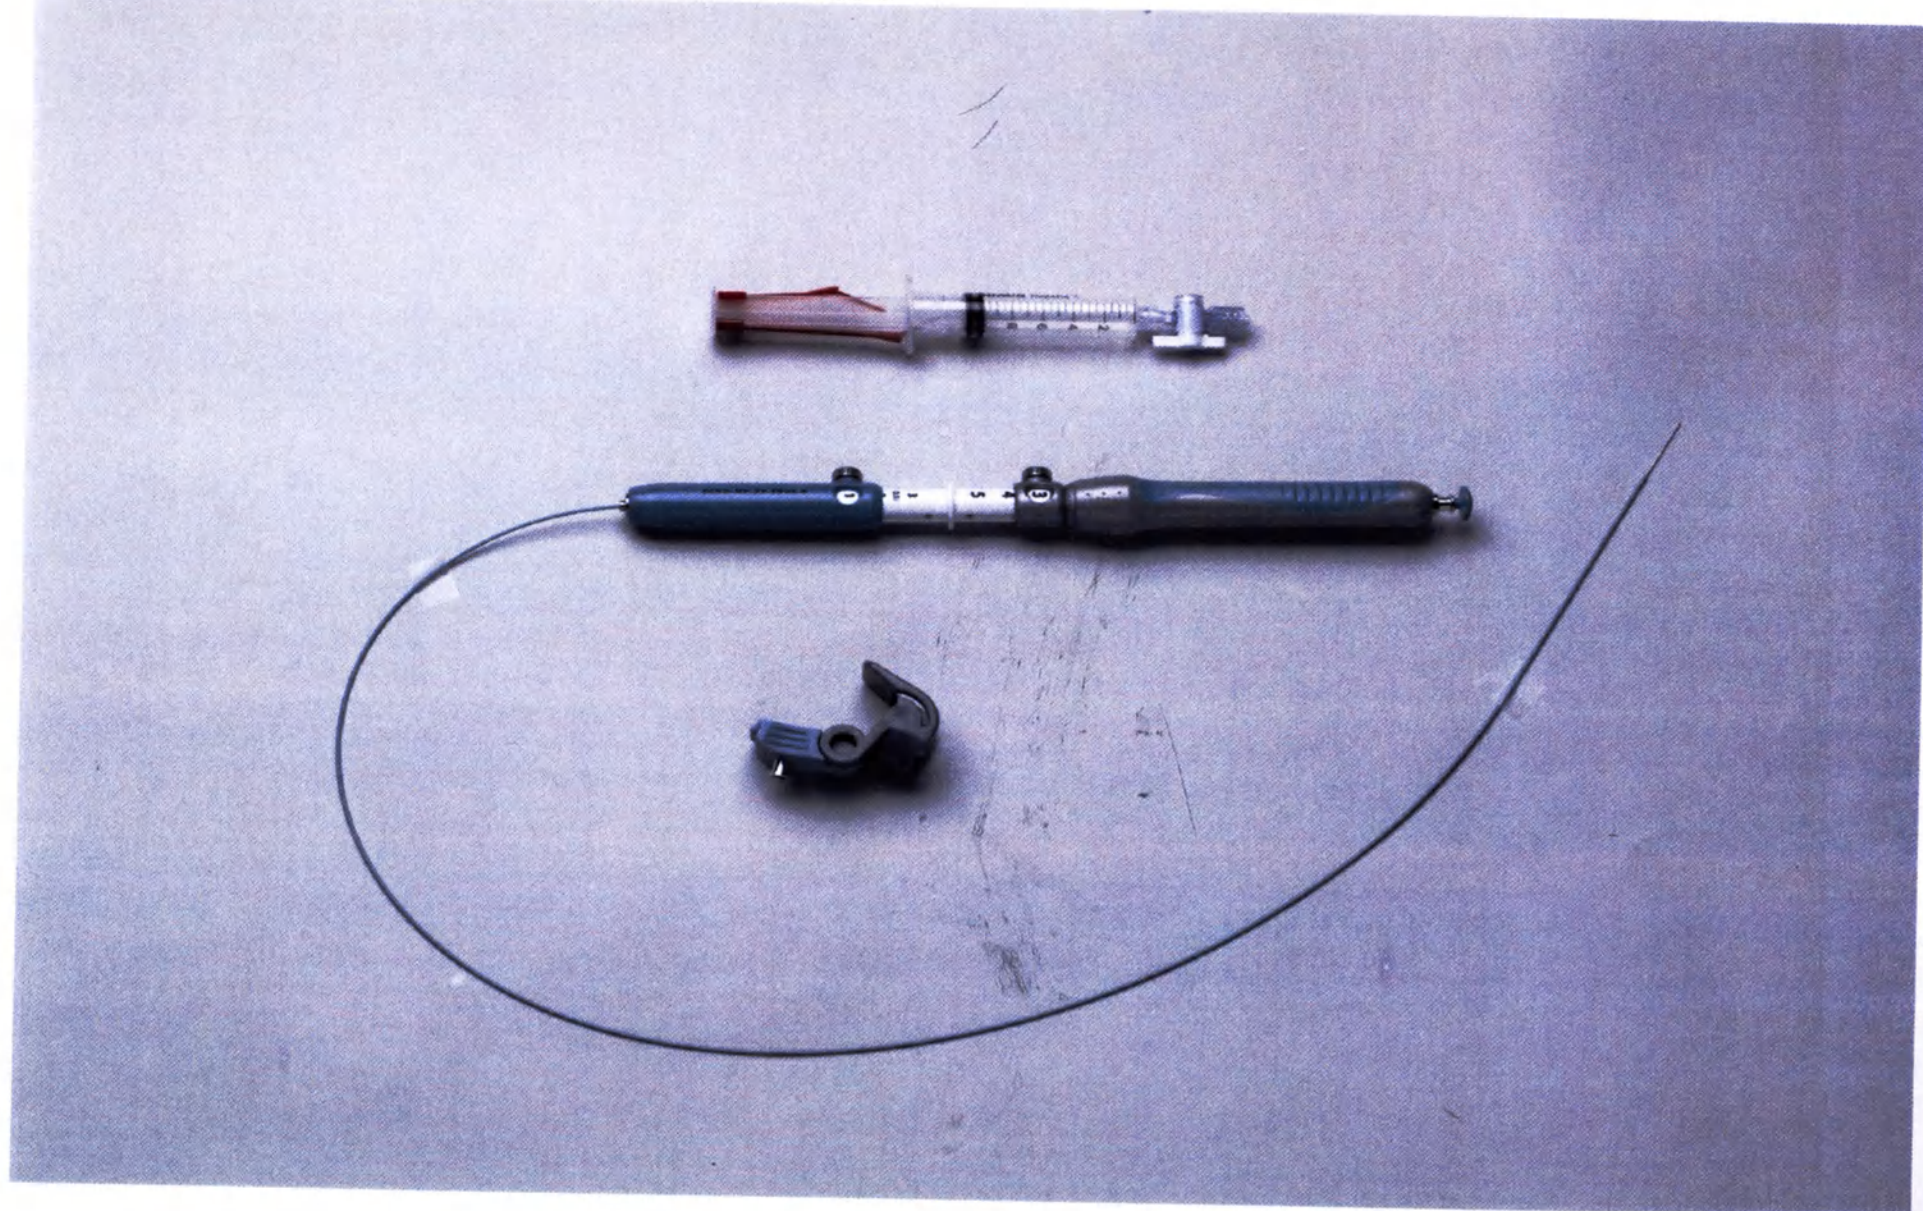

Echotip® Ultra
 Endobronchial High Definition Ultrasound
 Needle
 REF ECHO-HD-2S-EBUS-O
 REF 624062

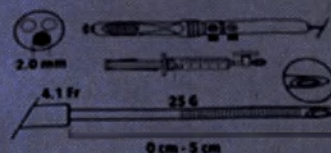

STERILE EO 2023-06-18
 LOT 17622581 2019-06-18



COOK
 MEDICAL

Manufactured by
 Cook Medical Ltd.
 Chesham Road, Redwood Technology Park,
 Lutterworth, Leicestershire



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Иглы биопсийные эндоскопические

Вариант исполнения: ECHO-HD-22-EBUS-P; ECHO-HD-25-EBUS-P

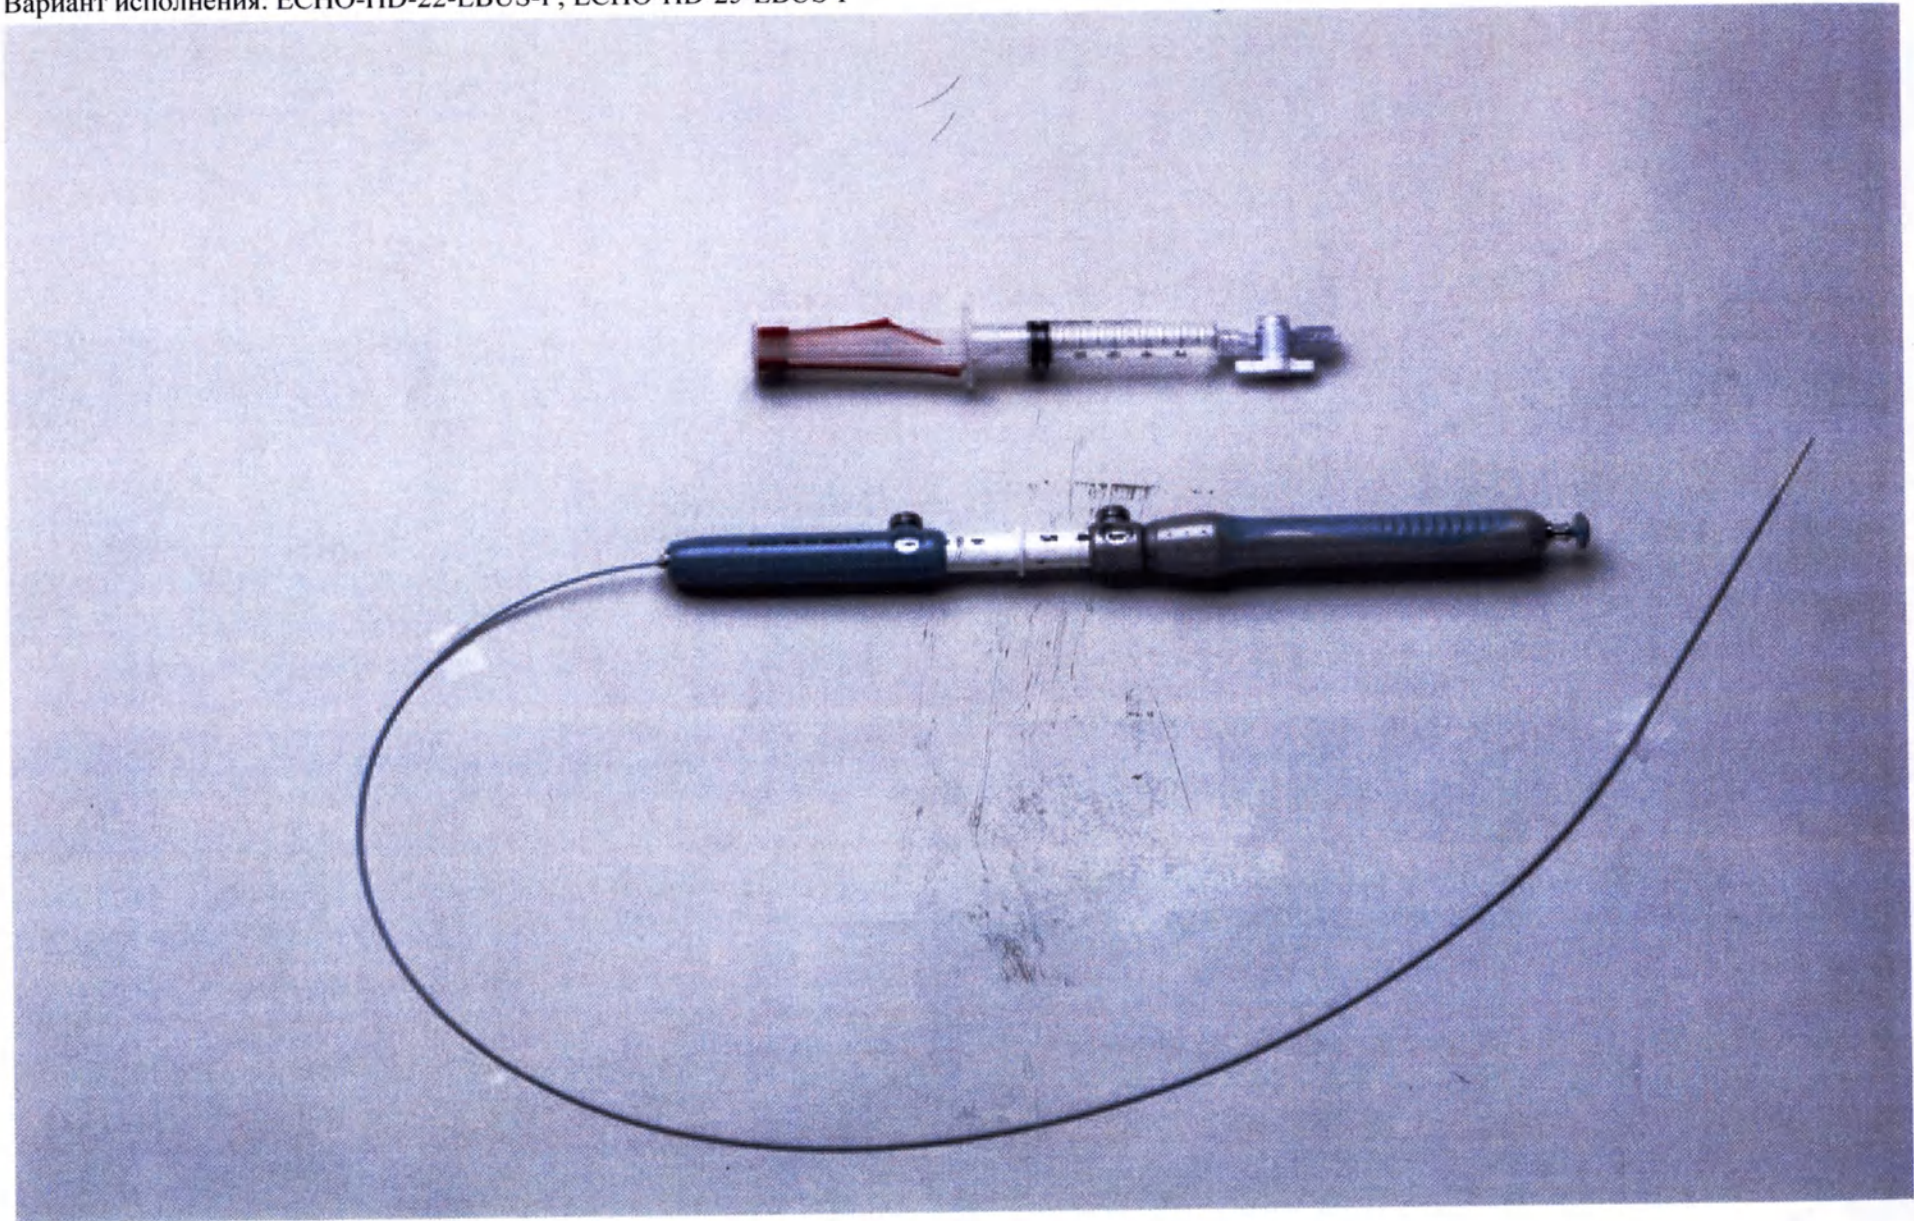

Echolip® Ultra
Endoprosthetic High Definition Ultrasound
Needle
REF: ECHO-HD-23-EBUS-P
REF: 653406

4.1H
2.0 mm
37.8
0.1mm - 3.5mm

STERILE (10)
LOT: 00000000
EXP: 01/2025

COOK®
www.cookmedical.com

CE

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортёр ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Иглы биопсийные эндоскопические

Вариант исполнения: ECHO-HD-22-EBUS-P-C; ECHO-HD-25-EBUS-P-C

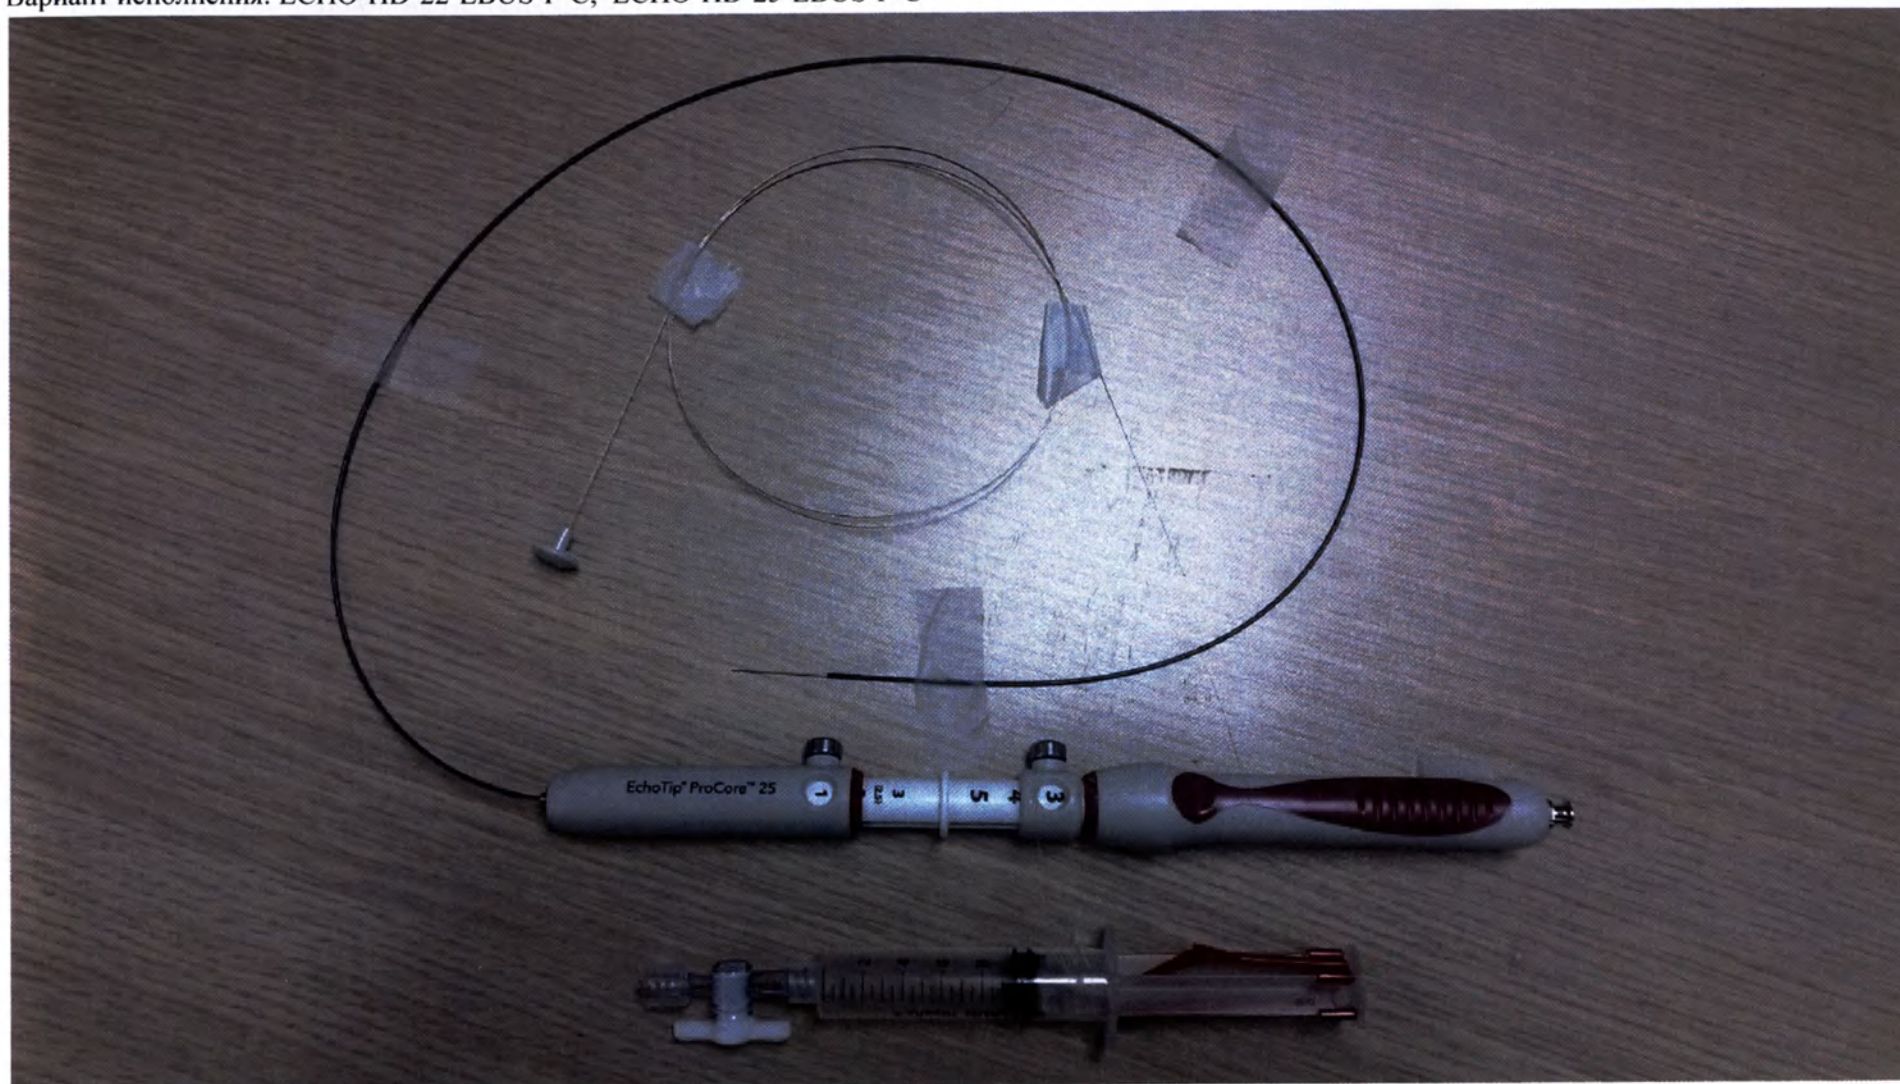

EchoTip ProCore®
Endobronchial HD Ultrasound Biopsy
Needle for Pentax Scopes
REF ECHO-HD-25-EBUS-P-C
REF 6341780

2.0 mm
4.1 ft
25 G
0 cm - 8 cm

STERILE TO
LOT 0428802
EXP 2019-06-30
REF 6341780

COOK MEDICAL

Manufactured by
Cook Medical LLC
Greenfield, Indiana, USA
0123

www.cookmedical.com

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Иглы биопсийные эндоскопические

Вариант исполнения: ECHO-HD-22-EBUS-O-C; ECHO-HD-25-EBUS-O-C





Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 29 листов

Генеральный директор

С.Н.Курин

