

Фотоальбом

**Маммограф рентгеновский цифровой МРц-«ТМО»
по ТУ 9442-012-04657145-2014**

**Изготовитель АО «НИИЭМ»,
143502, Московская область, г. Истра,
ул. Панфилова, д.11**




На фото представлен генератор рентгеновский маммографический DIGITAL MAMMO 10, производства Metaltronica S.p.A, Италия



Production date 10-2018
Tube No. 67V244 Type XM1016T
0.1 0.3 10000 rpm



IAE SpA
Via Filzi, 53
CORMANO (MI) - ITALY



Production date 10-2018 MADE IN ITALY
Housing No. MA31V Type C339 V
Filtr. 0.5 mm Be kVp 49

CAUTION
It is restricted this device to sale by or on an
order of the user of the tube-assembly.
This product conforms to DHHS radiation
Standards of 21 CFR subchapter J.



I.A.E. SpA
Via Filzi, 53
CORMANO (MI) - ITALY

CE 0051

Production date 10- 2018 MADE IN ITALY

Tube No. **67V244** Type **XM1016 T**

0.1 **0.3** **10000 rpm** **49 kV**



I.A.E. SpA
Via Filzi, 53
CORMANO (MI) - ITALY

CE

0051



Type

Production date 10- 2018 MADE IN ITALY

Housing No. **A31V** Type **C339 V**

Filtr. **0.5 mm Be** **kVp 49**

CAUTION


it is restricted this device to sale by or on an order of the user of the tube-assembly.

This product conforms to DHHS radiation Standards of 21 CFR subchapter J.

На фото представлен рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой XM1016T
производства IAE S.p.A., Италия



3. На фото представлен защитно-декоративный корпус, производства Metaltronica S.p.A, Италия или ТМО.00А.8049 производства АО «НИИЭМ», Россия

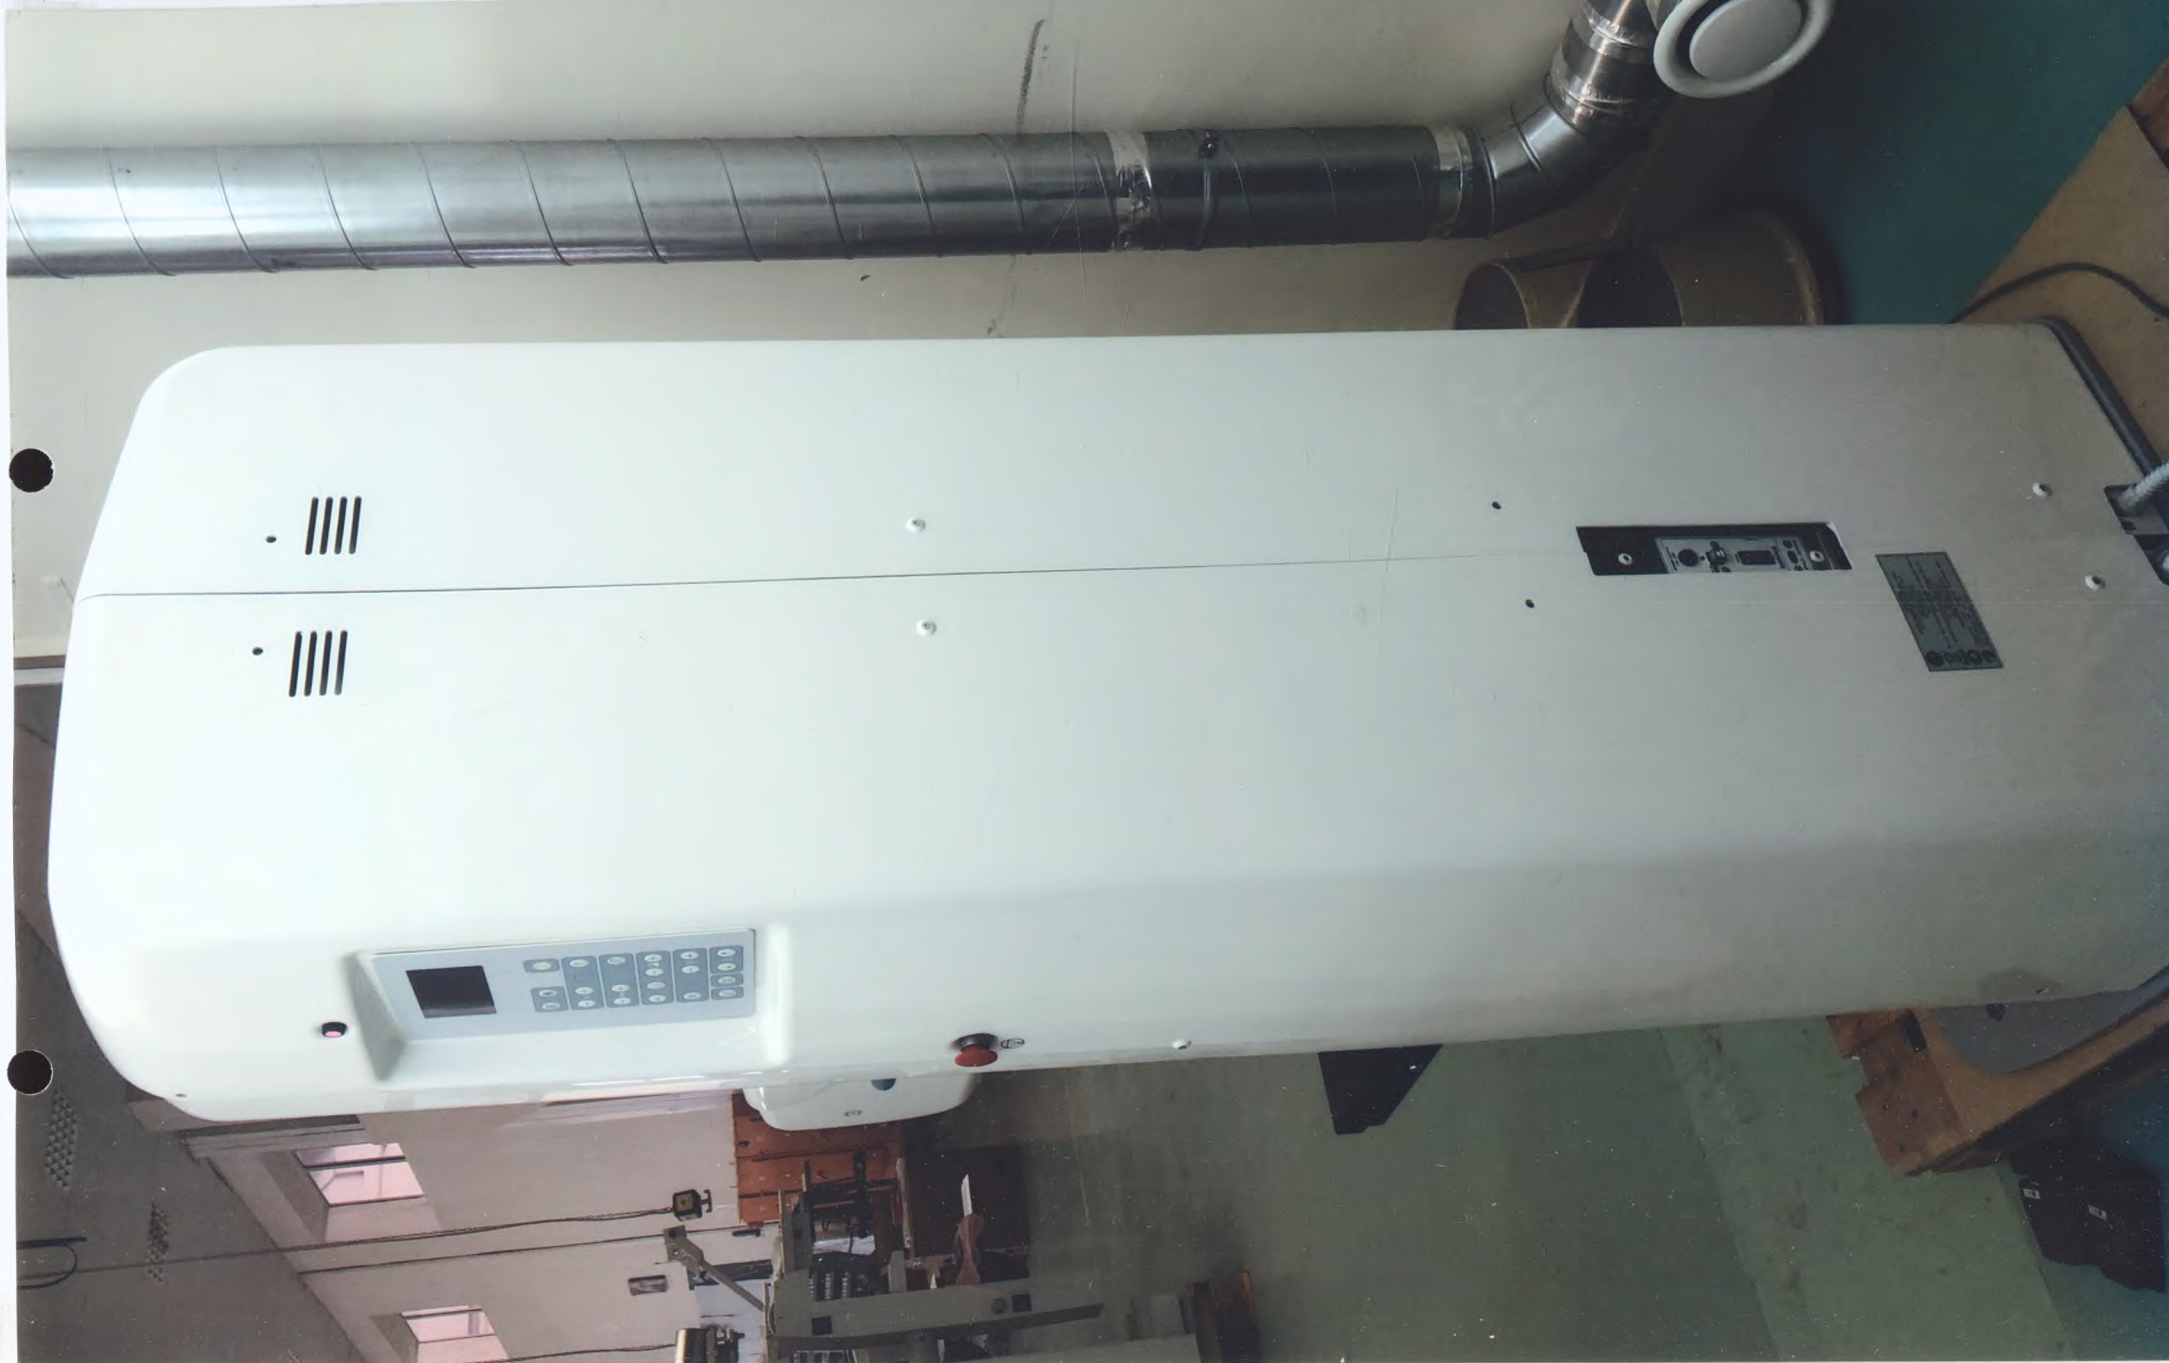

На фото представлен защитно-декоративный корпус, производства Metaltronica S.p.A, Италия или
ТМО.00А.8049 производства АО «НИИЭМ», Россия (вид сзади).

SUPPLY



МАММОГРАФ
РЕНТГЕНОВСКИЙ ЦИФРОВОЙ МРЦ-«ТМО»
ПО ТУ 9442-012-04657145-2014

зав. № 0216918002

ИЗГОТОВЛЕН 11.2018

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

АО "Научно-исследовательский институт электромеханики"
(АО "НИИЭМ")

143502 Российская федерация, Московская область,

г.Истра, ул.Панфилова, д.11

тел. (495) 994-52-13

факс (49831) 5-26-92

ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ:



Напряжение ~220 В Частота пит. напряжения 50Гц

Сопротивление сети <0,5 Ом

Макс. потребляемый ток 25 А

На фото представлена наклейка аппарата Маммограф рентгеновский цифровой МРЦ-«ТМО»
на защитно-декоративном корпусе



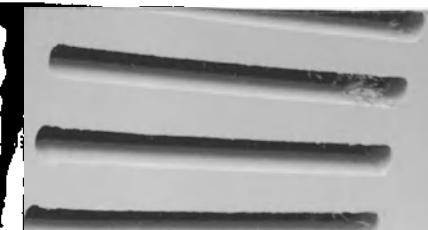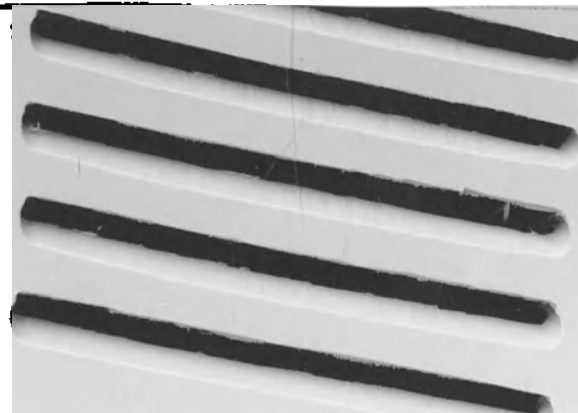

TOTAL FILTRATION (COMPRESSION PLATE INCLUDED) : 0.5mm Al eq.
FILTRACION TOTAL (COMPRESOR INCLUIDO) : 0.5mm Al eq.

Съемочное
устройство
ТМО.00А.8080
№ 0218818 002





6. На фото представлена: Ширма рентгенозащитная ТМО.00А.8042 производства АО «НИИЭМ»
или производства Metaltronica S.p.A, Италия




From : Analogic Canada Corp.
4950 LEVY, SAINT-LAURENT, QC, CANADA H4R 2P1
(514) 856-6920

AXS-2430FDI DETECTOR

PN# : 100-01426

S/N : AIF-28414



1805


7. Плоскопанельный детектор серии AXS, производства фирмы Analogic Canada Corporation, Канада или серии Xineos производства Teledyne Dalsa, Канада.

На фото представлена: Упаковка с плоскопанельным детектором серии AXS, производства фирмы Analogic Canada Corporation формата 24x30 см



8. Детектор с отсеивающим растром серии Gridgil Gilardoni S.p.A., Италия или
серии SmitRontgen Philips Medical Systems Nederland B.V., Нидерланды или серии Grid 2100 JPI Healthcare Solutions Inc., Республика Корея

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU иенный на съемочное устройство детектор с отсеивающим растром серии Gridgil Gilardoni S.p.A., Италия

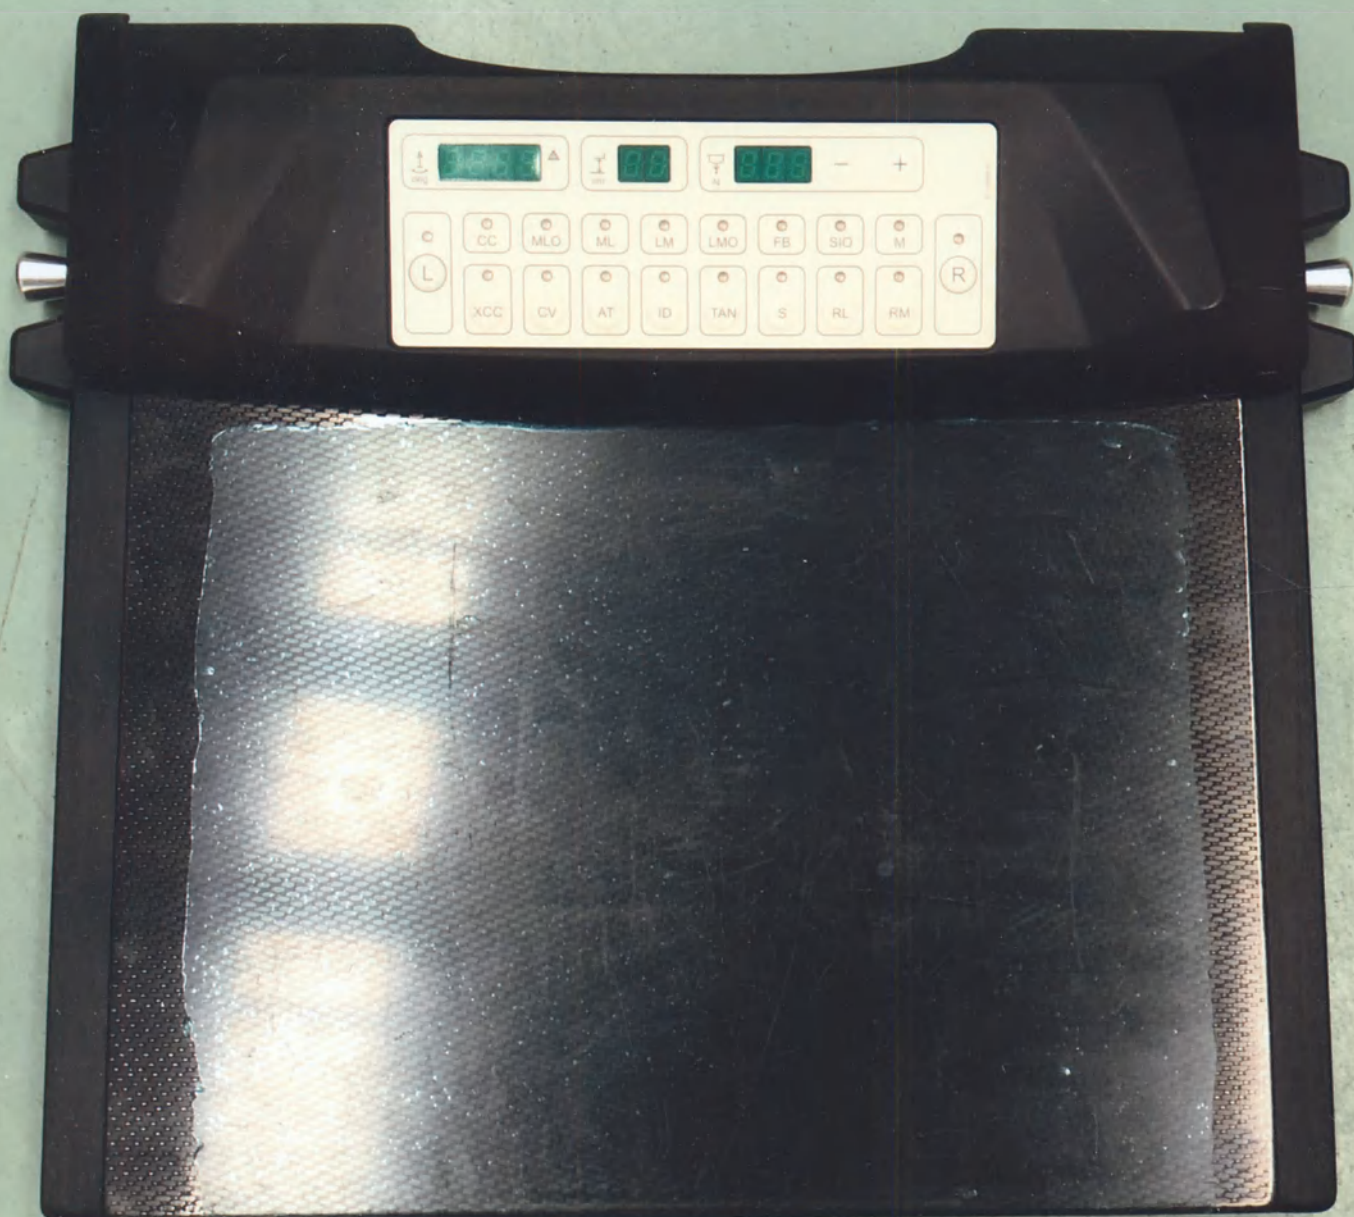

8.1 На фото представлен: Детектор серии AXS, производства Analogic Canada Corporation, Канада., с отсеивающим растром.




9. Коллиматор с автоматическим устройством смены фильтров (Rh/Ag),
производства Metaltronica S.p.A, Италия



10. Блок педалей компресії та декомпресії ТМО.00А.8043 виробництва АО «НІІЕМ»
или виробництва Metaltronica S.p.A



**Блок педалей компрессии и декомпрессии ТМО.00А.8043 производства АО «НИИЭМ»
или производства Metaltronica S.p.A**

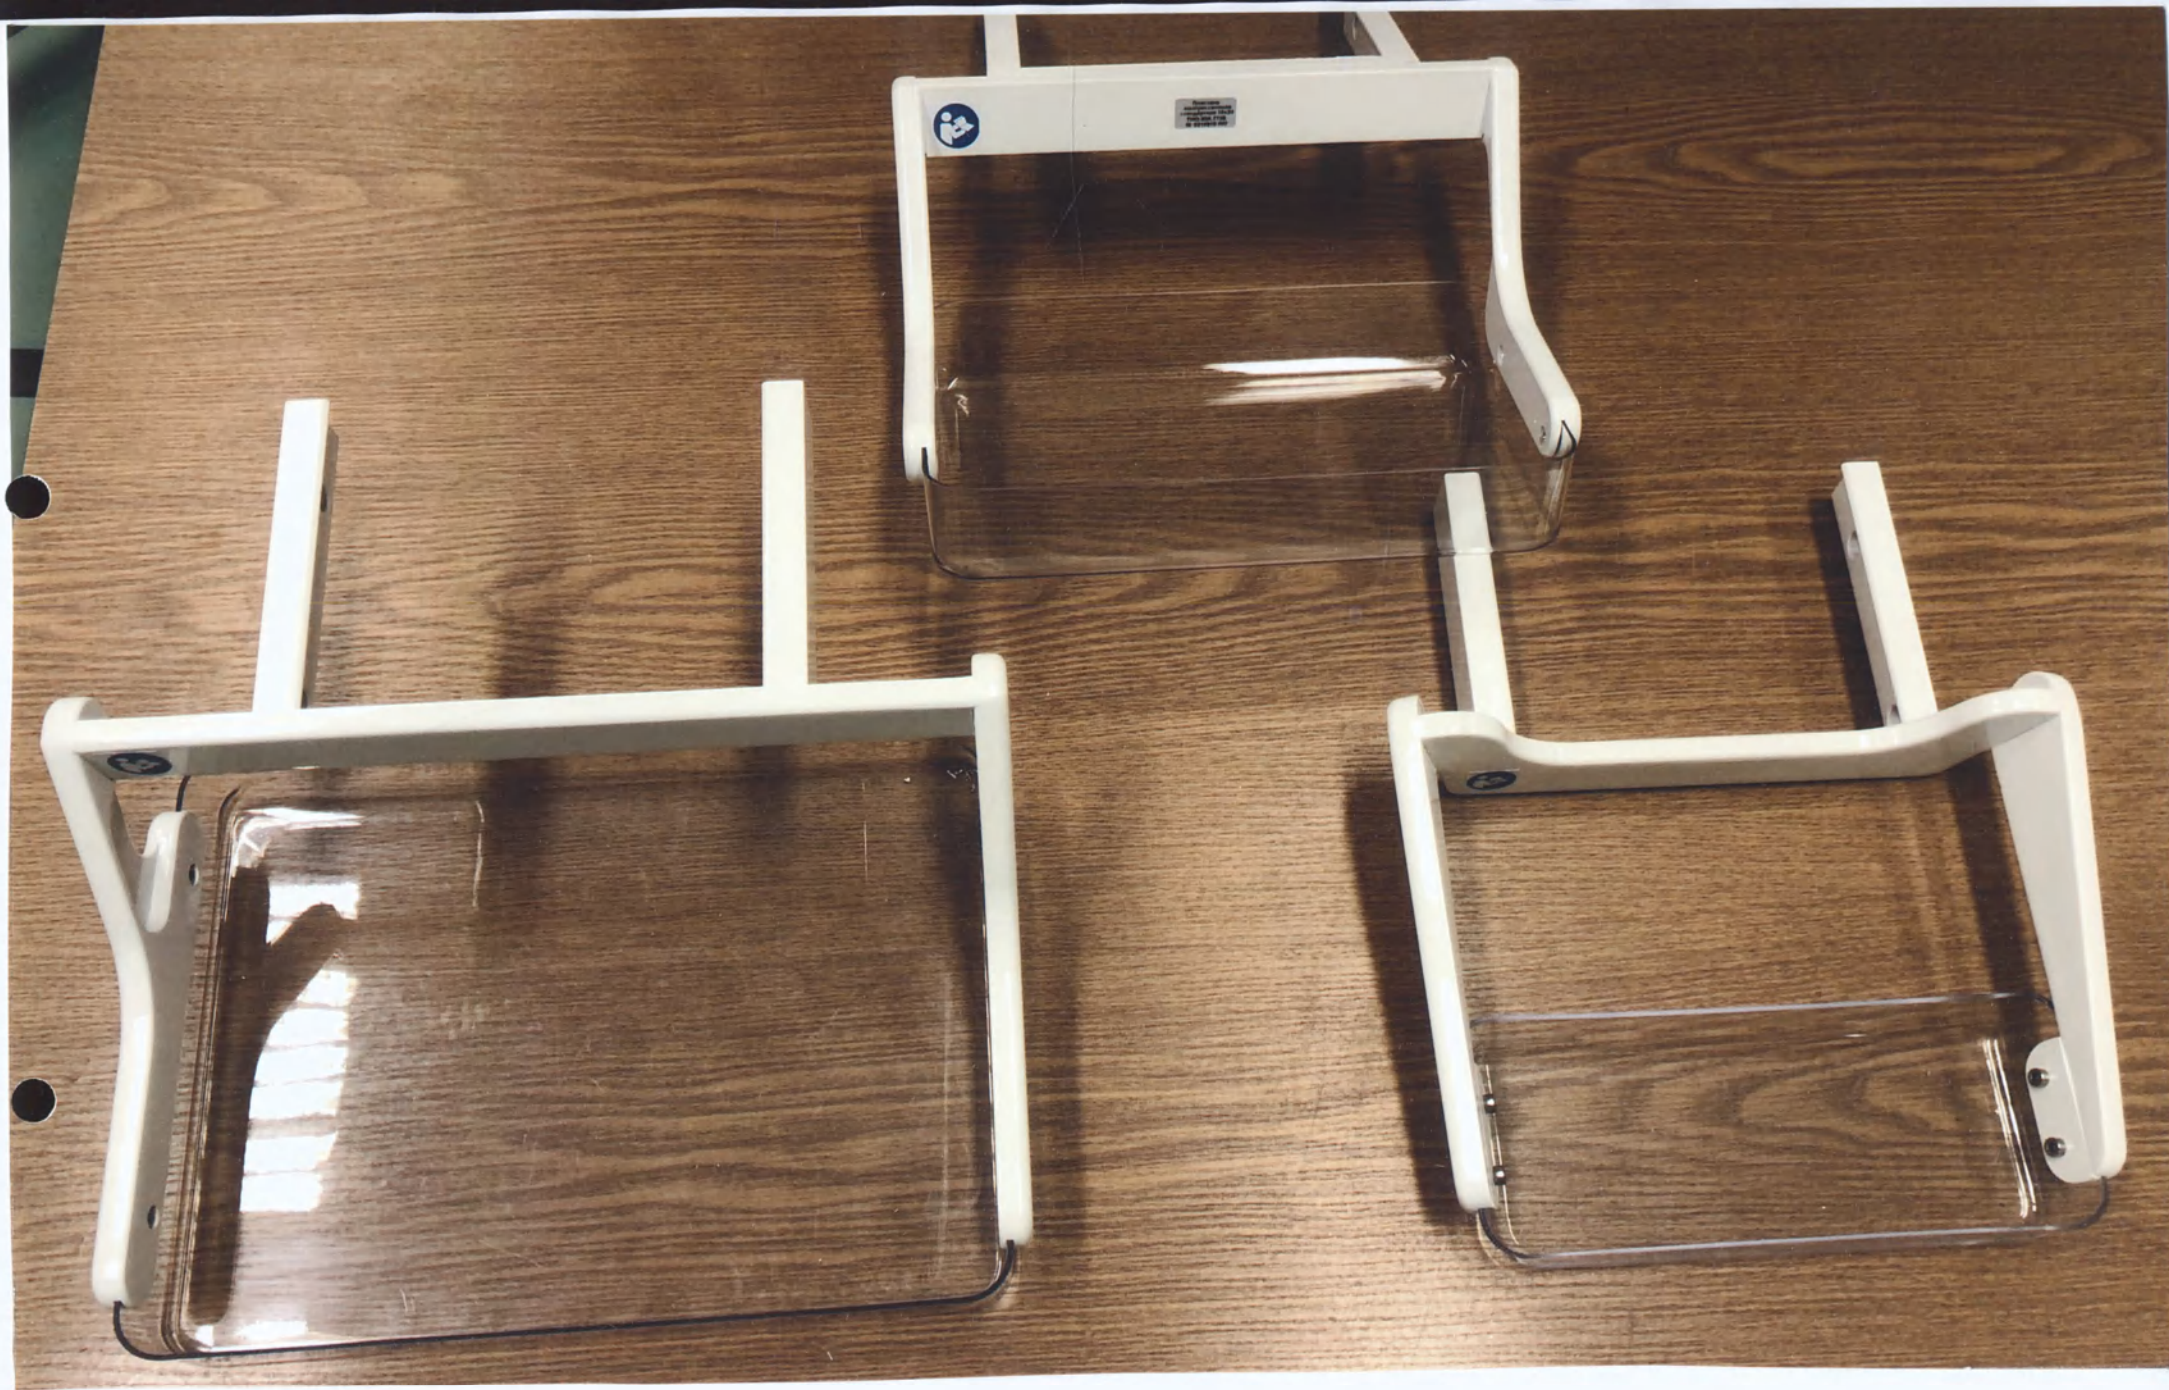

11. Компрессионная лопатка под формат детектора 24×30 см ТМО.00А.8055 производства АО «НИИЭМ», Россия или производства Metaltronica S.p.A, Италия


Компрессионная лопатка 18×24 см с боковым сдвигом ТМО.00А.8058 производства АО «НИИЭМ», Россия или производства Metaltronica S.p.A, Италия

Компрессионная лопатка, правая 18×21 см для увеличения ТМО.00А.8056 производства АО «НИИЭМ», Россия или производства Metaltronica S.p.A, Италия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




12. Защитный щиток ТМО.00А.8063 производства АО «НИИЭМ», Россия
или производства Metaltronica S.p.A, Италия

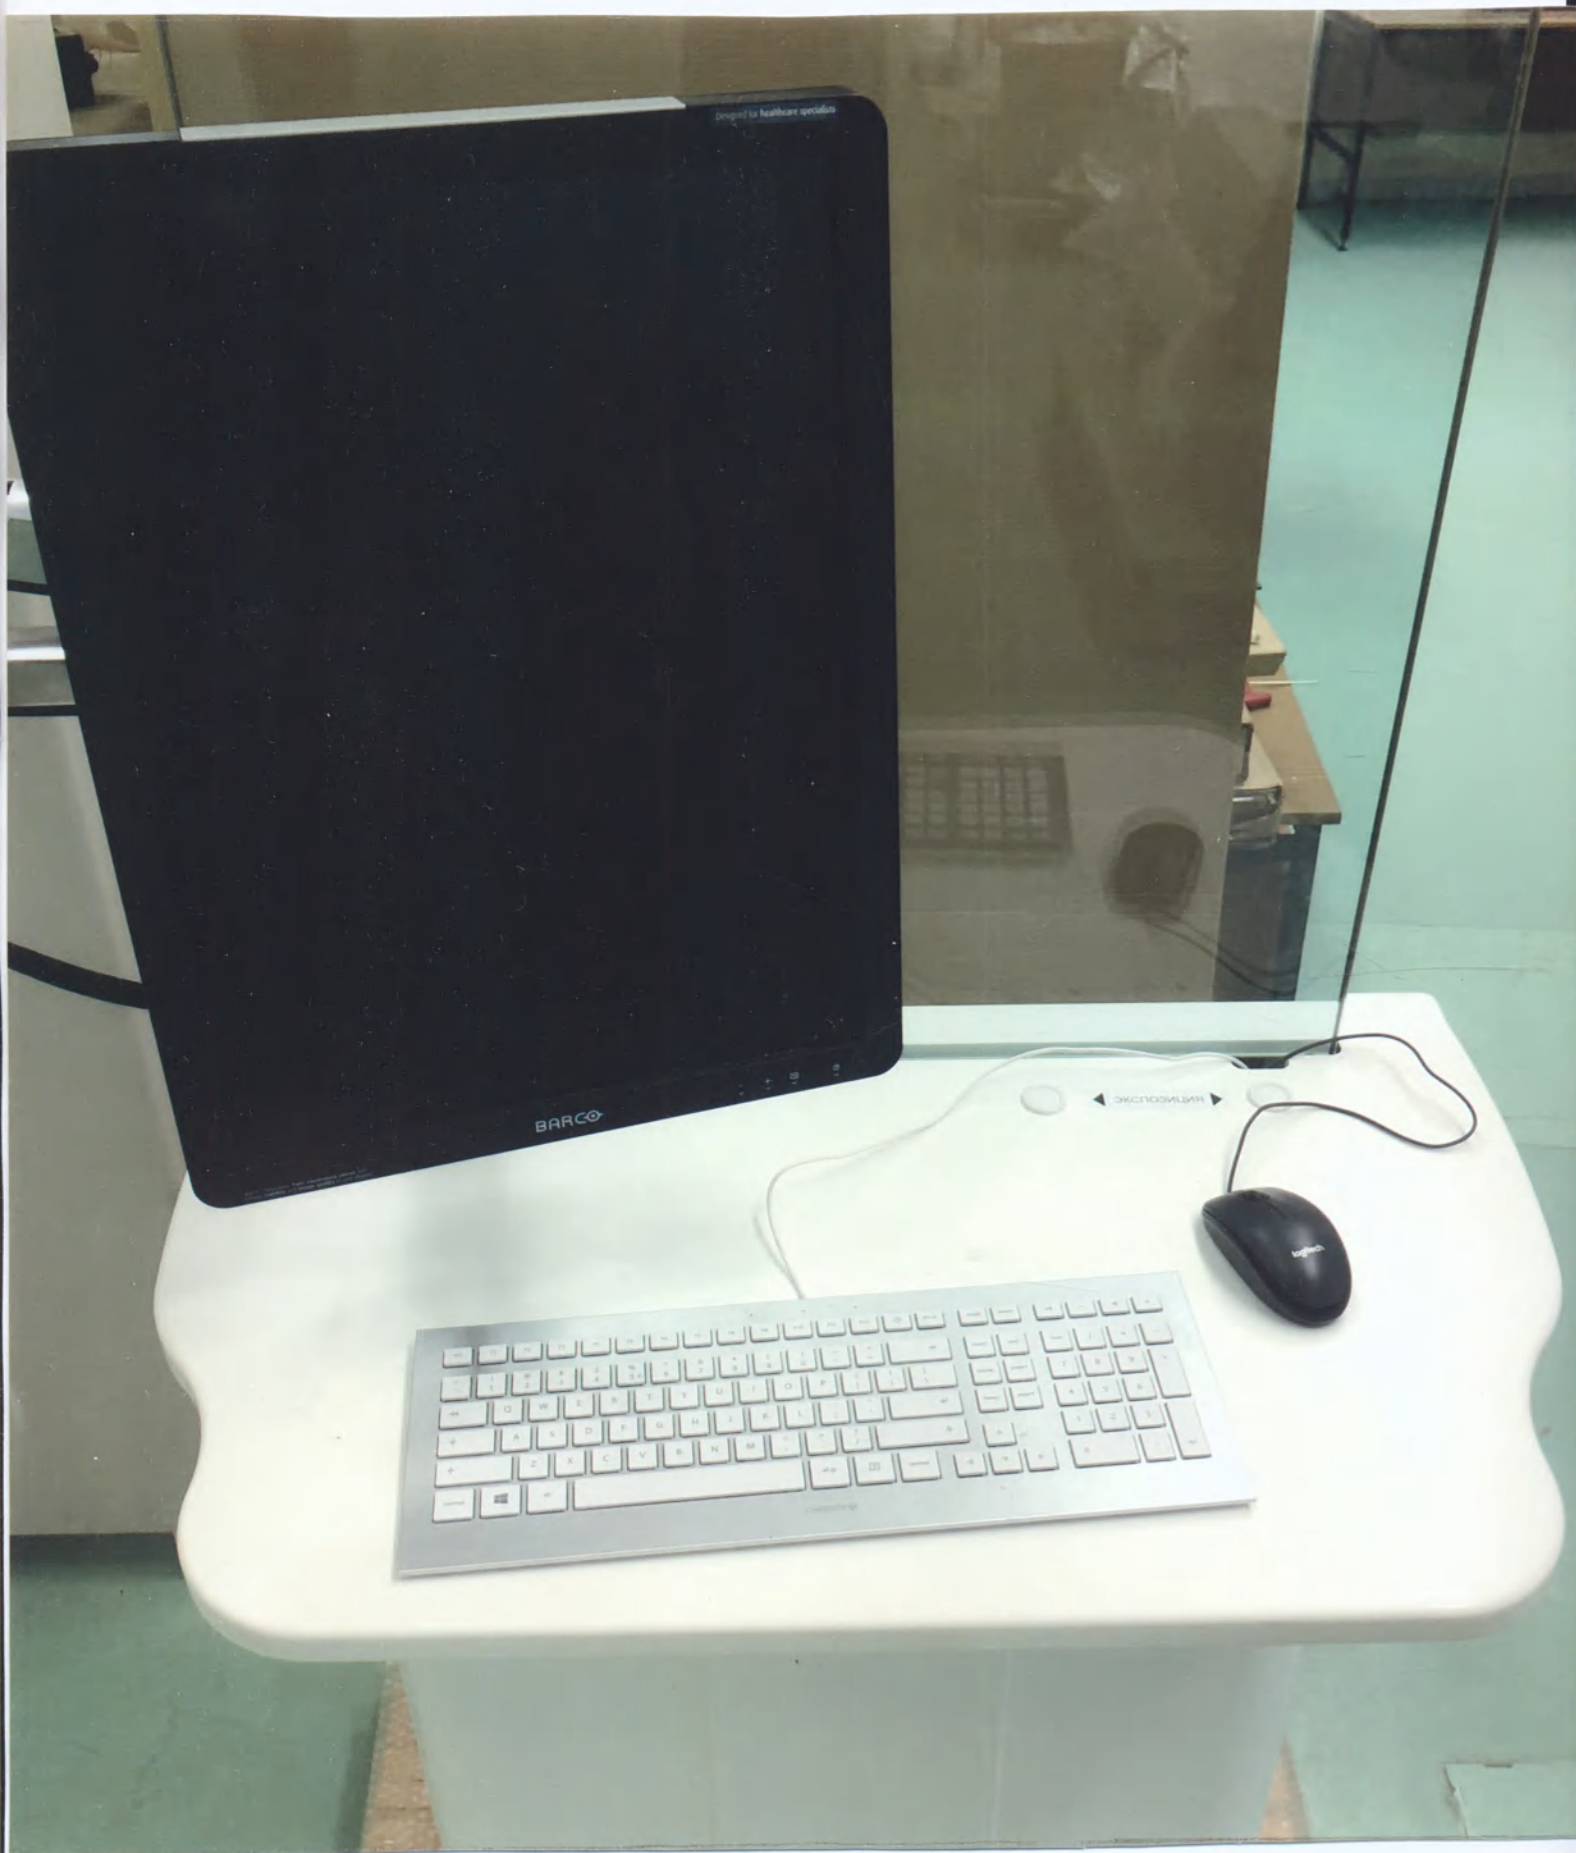

13. Рабочая станция (автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта) ТМО.00А.7638
производства АО НИИЭМ, Россия или Metaltronica S.p.A, Италия

На фото представлены: монитор, клавиатура, мышь.

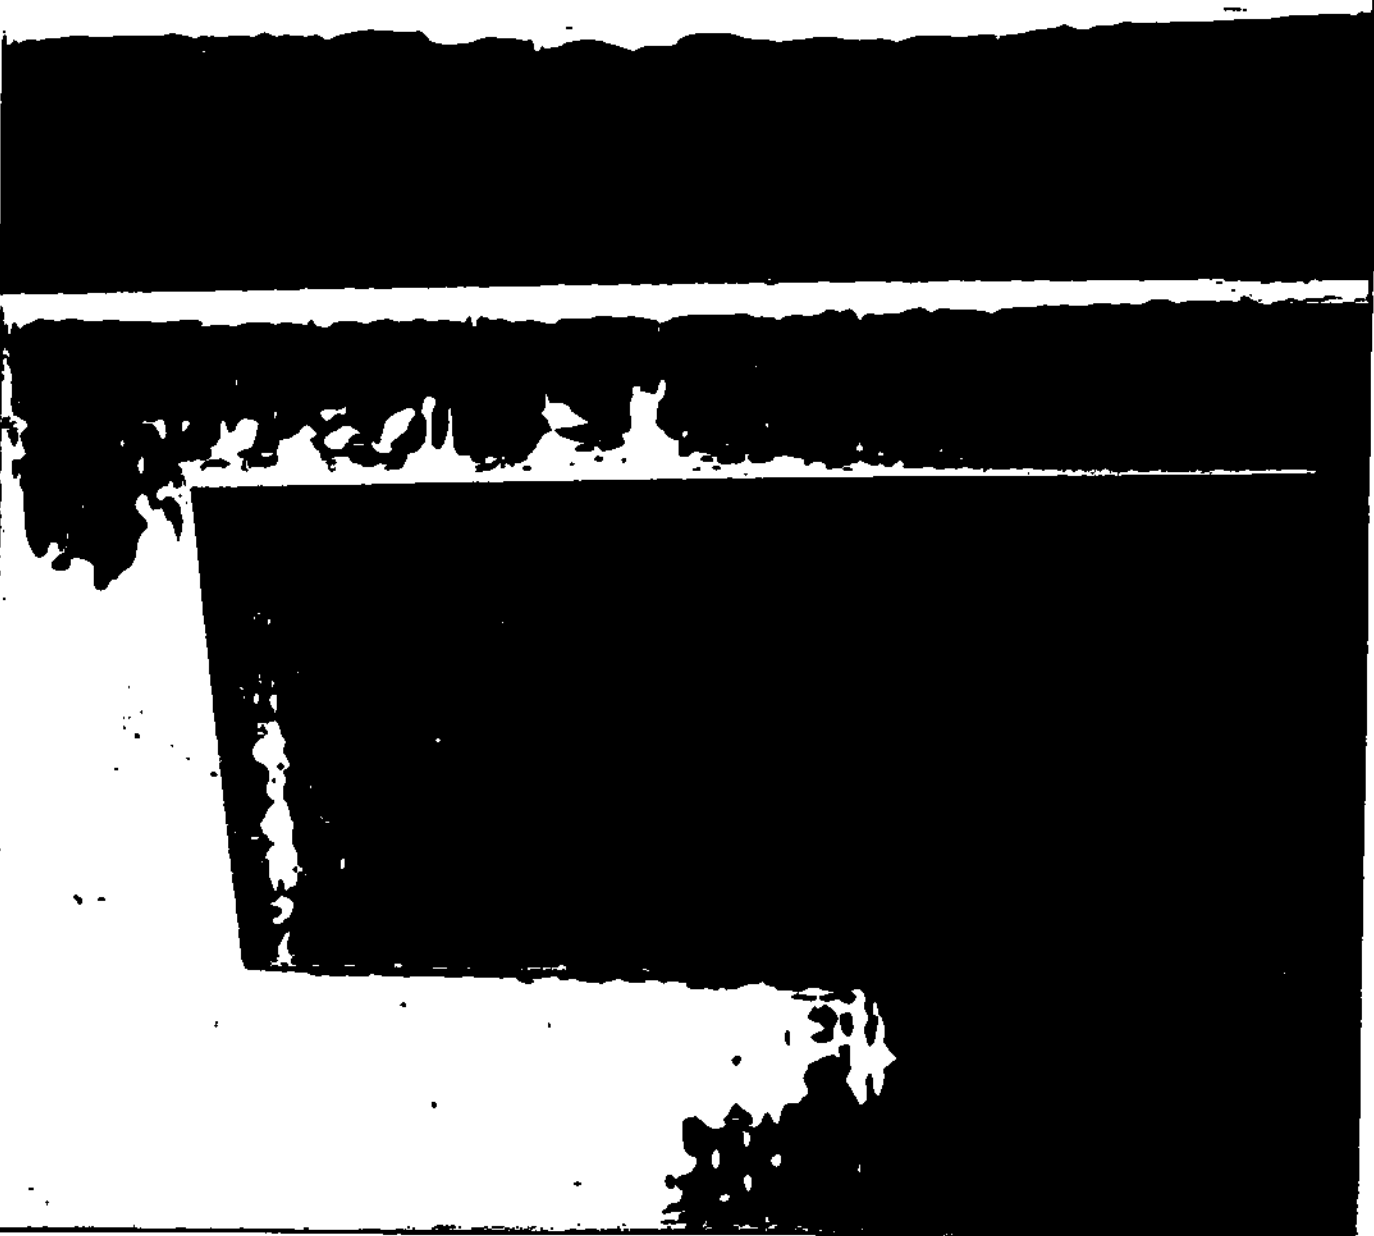

На фото представлена: тумба автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта ТМО.00А.7638
производства АО НИИЭМ, Россия или Metaltronica S.p.A, Италия



На фото представлен: персональный компьютер автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта ТМО.00А.7638




На фото представлен: монитор автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта ТМО.00А.7638 производства АО НИИЭМ, Россия или Metaltronica S.p.A, Италия (вид сзади)




**На фото представлены: кабели автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта
ТМО.00А.7638 производства АО НИИЭМ, Россия или Metaltronica S.p.A, Италия**



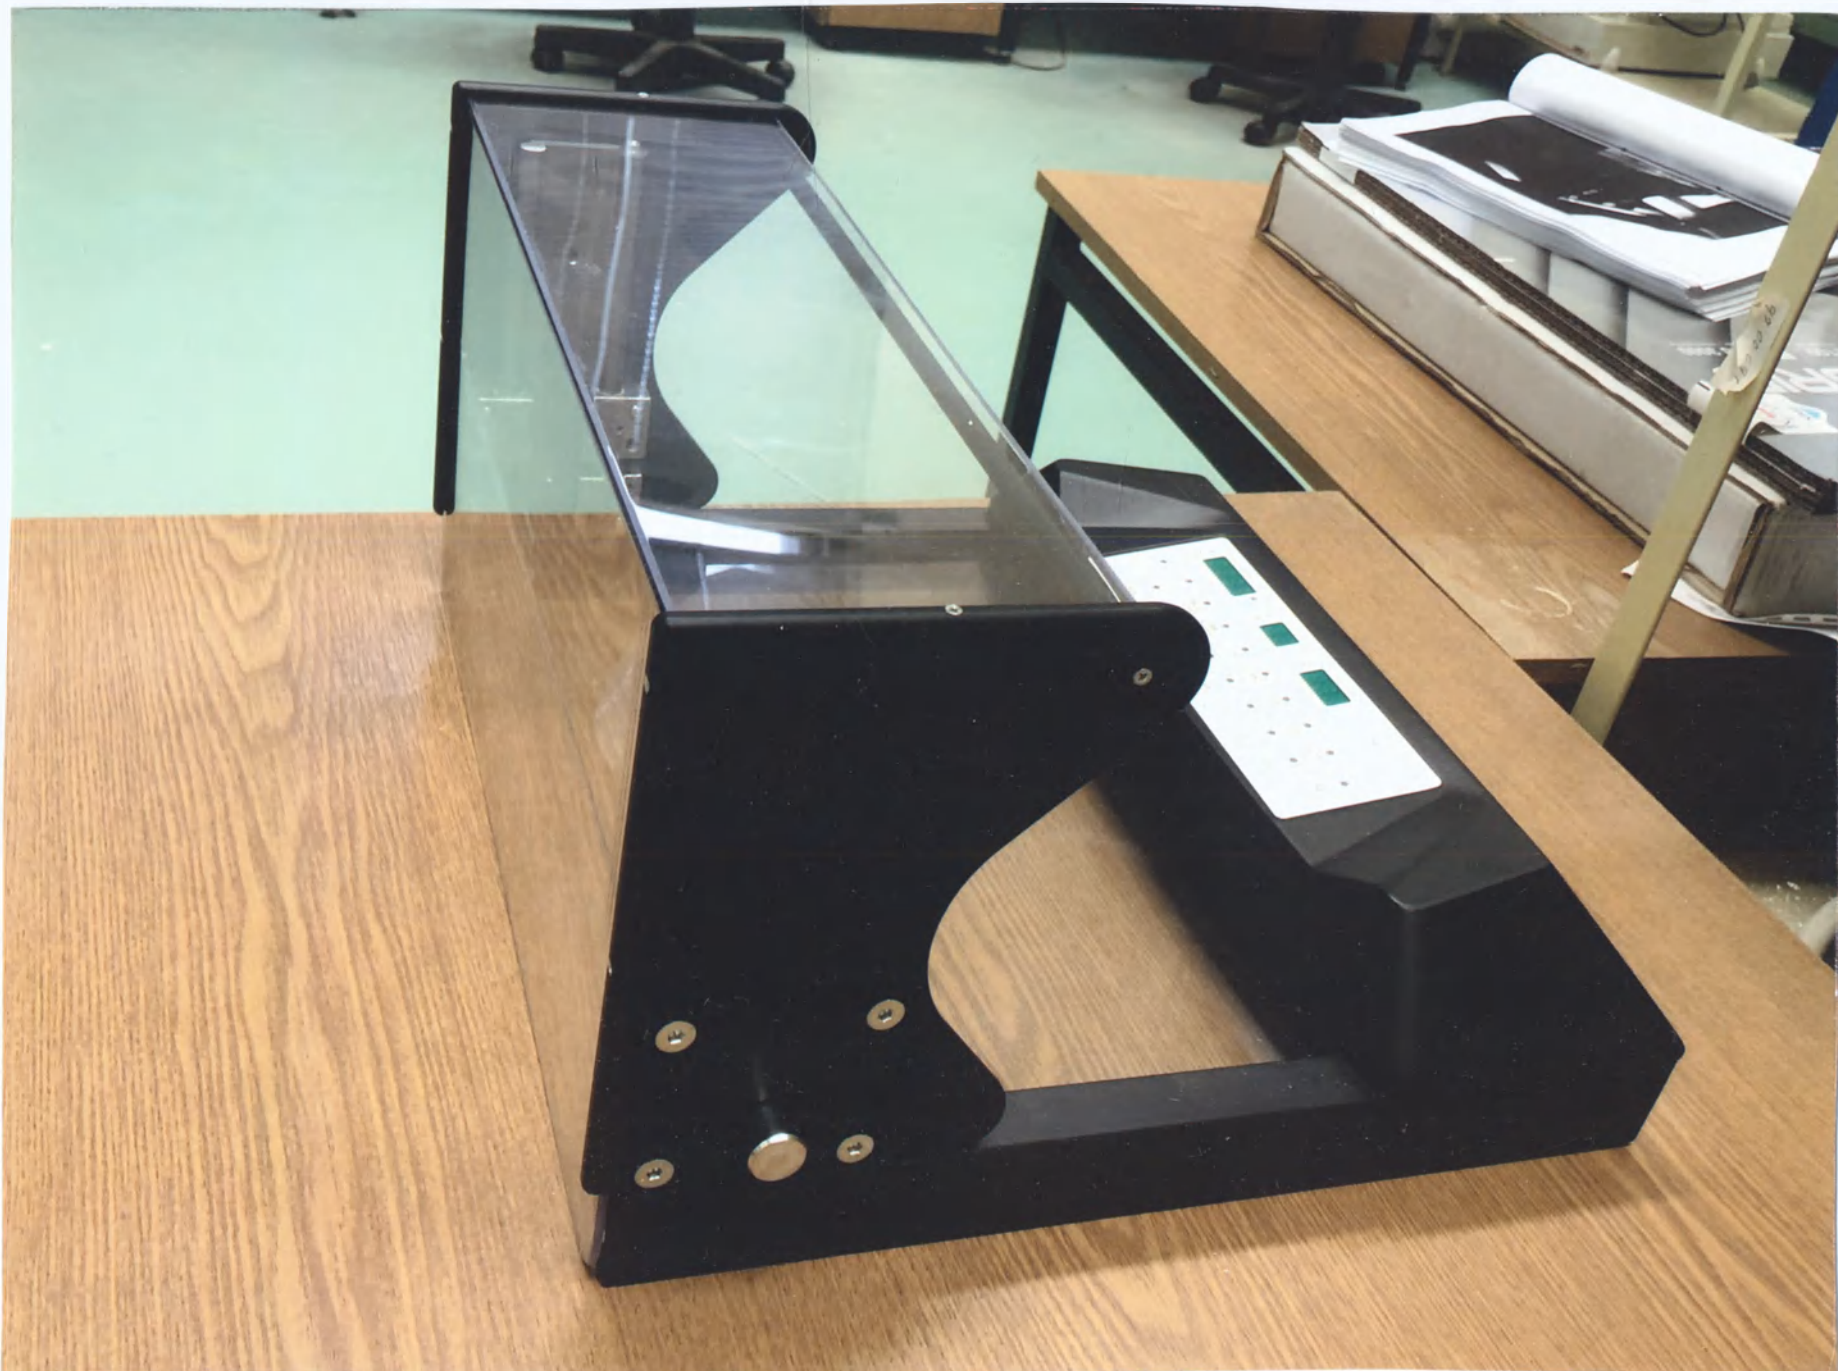




16. На фото представлена: двухпозиционная кнопка экспозиции,
производства Metaltronica S.p.A, Италия

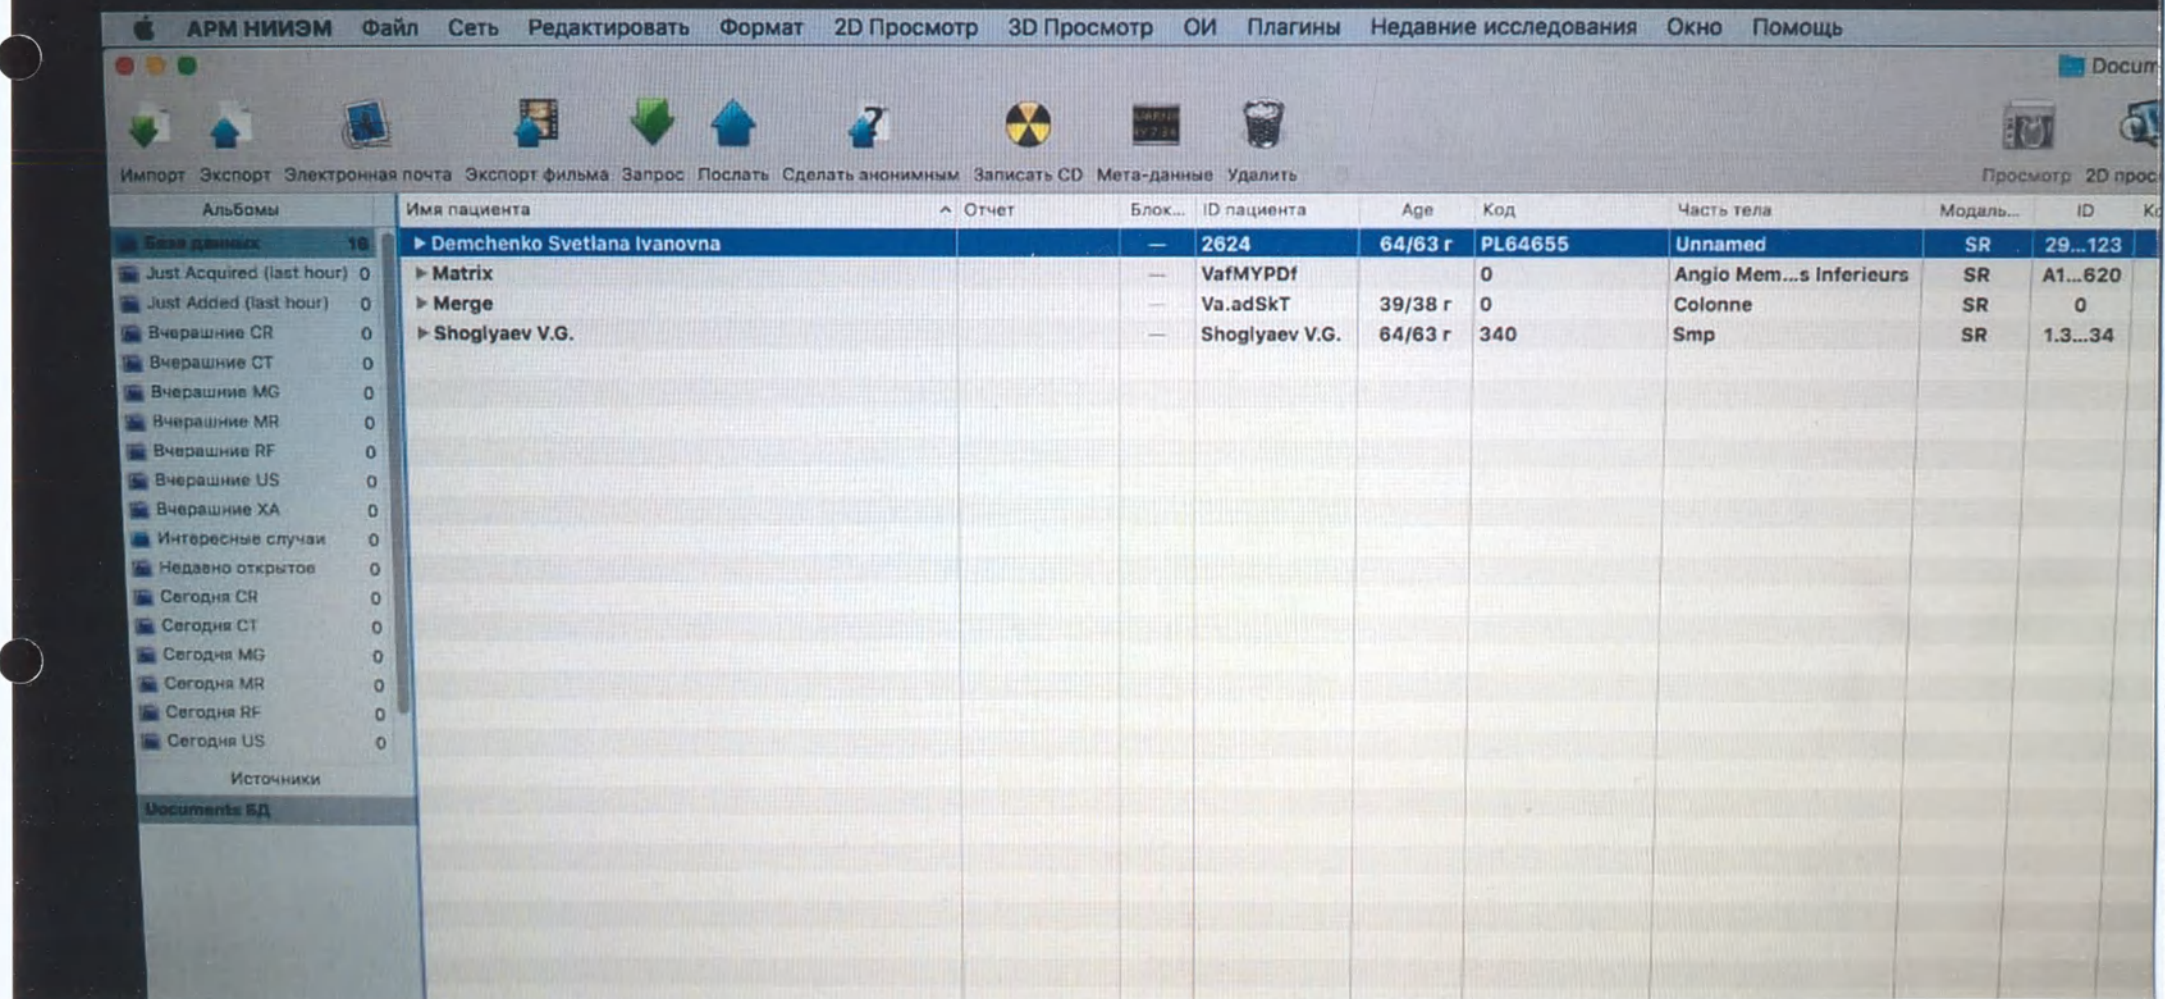



**На фото представлен: персональный компьютер рабочей станции врача рентгенолога ТМО.00А.7991
производства АО НИИЭМ, Россия**

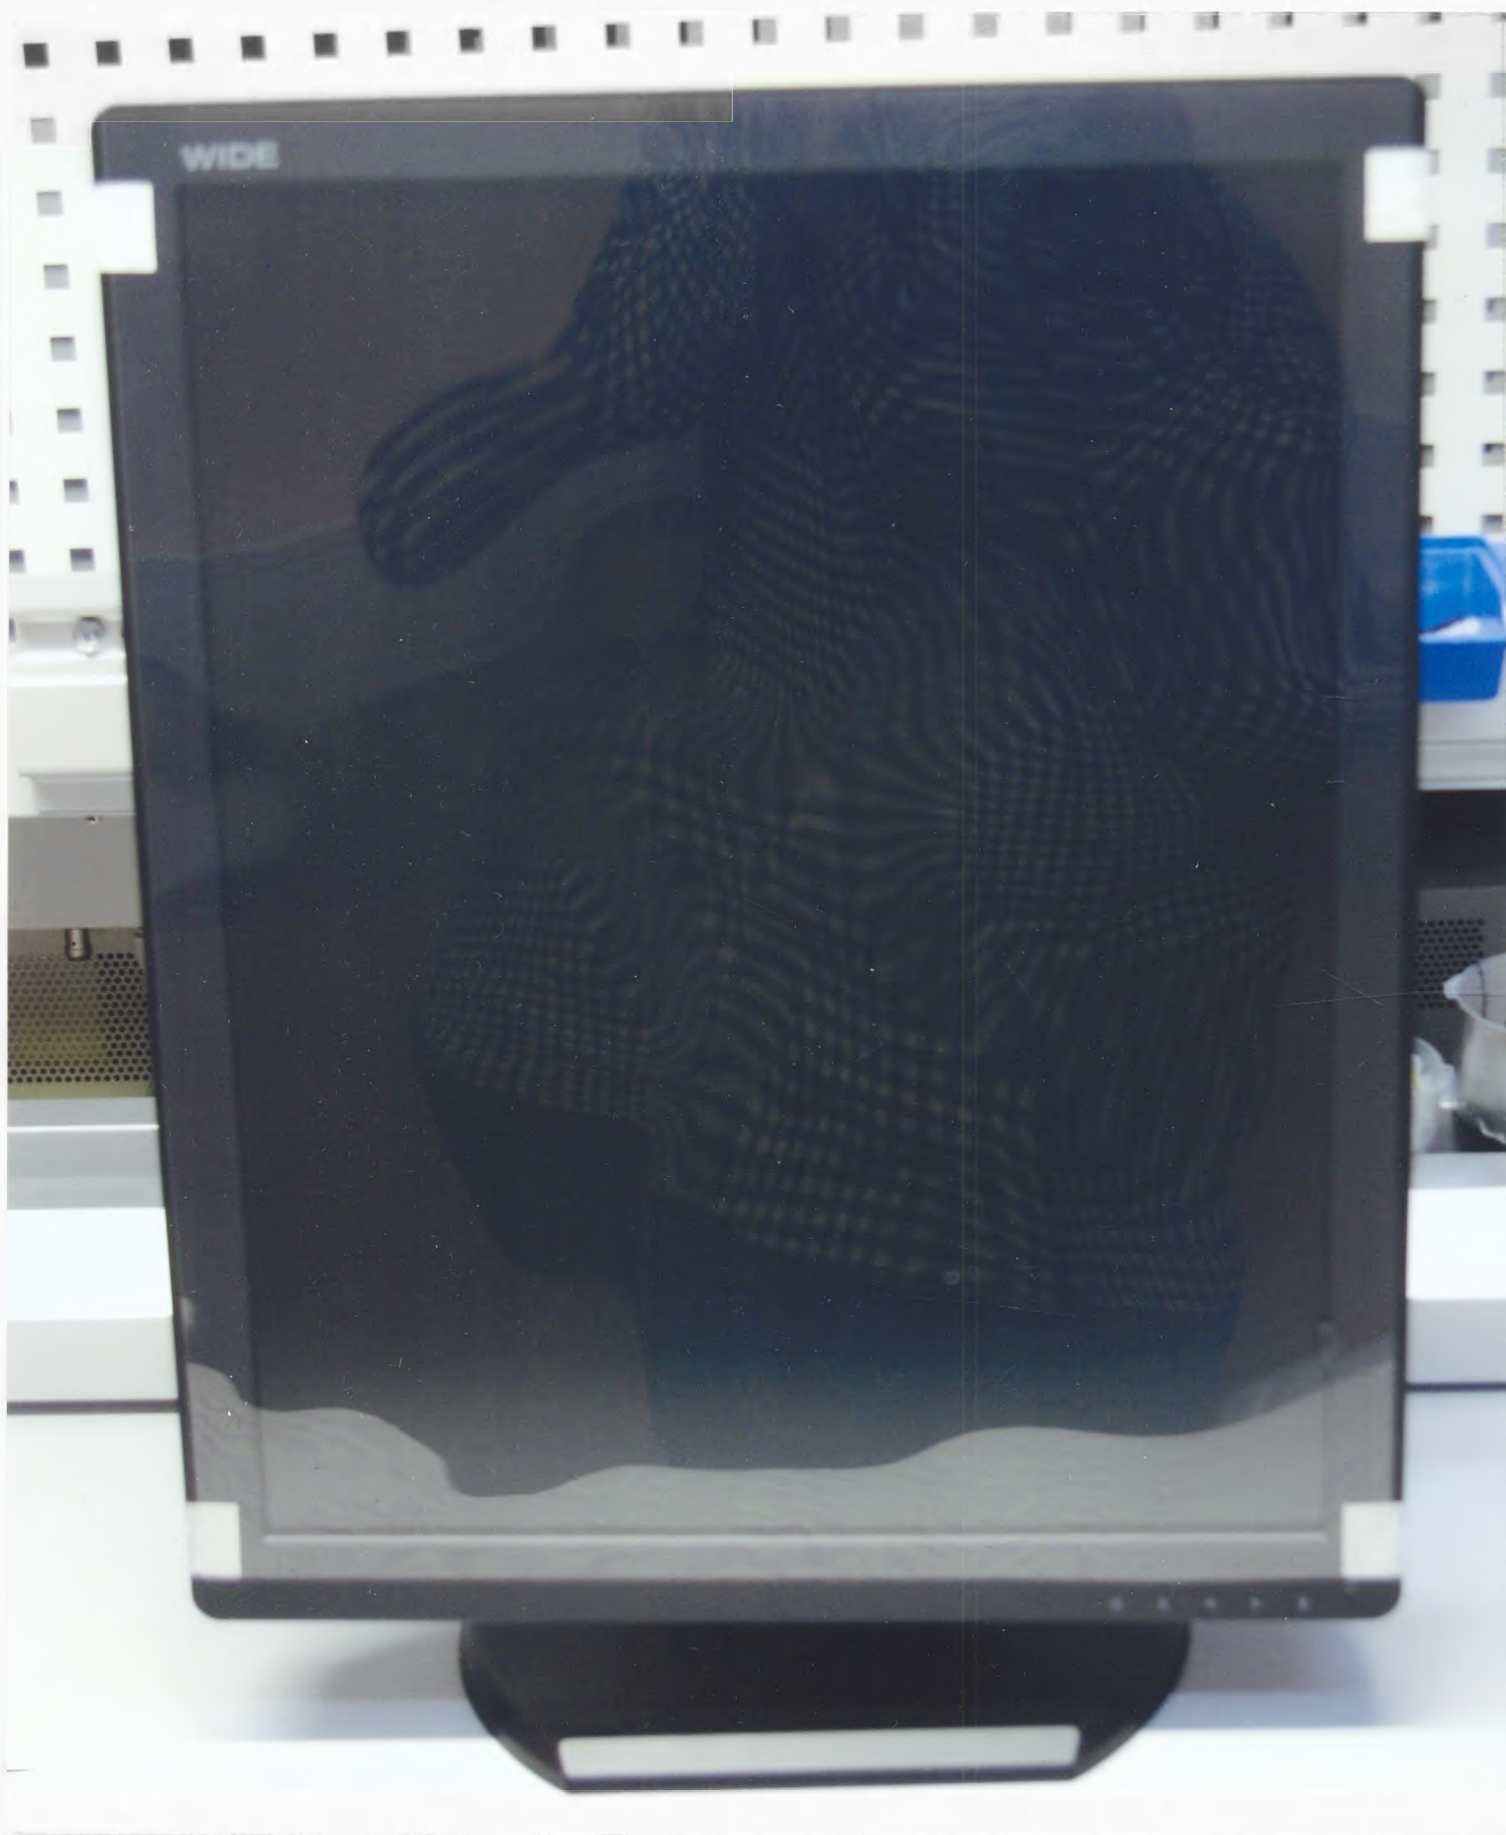

Монитор для рабочей станции врача серии RX, серии GX EIZO NANANO Corporation, Япония или серии MX WIDE Corp., Республика Корея или серии MS JVCKENWOOD Deutschland GmbH, ФРГ или серии Coronis, серии Nio, серии NioColor Barco NV, Бельгия

На фото представлен: Монитор серии MX WIDE Corp., Республика Корея

WIDE

Distributor / Vertrieb

USA REF WIDE USA Corporation 2210 E. Winston Road, Anaheim, CA92808
Tel : +1 714 300 0540
EC REF Foreseeson GmbH, Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Germany
Tel : +49 (0) 6104/643980

Product Name : LCD Monitor
Model : MX50N
Input : DC24V $\approx$ 4.2A





AC/DC Adapter
Manufacturer : Bridge Power Corp
Model : JMW1100KB2449F03



MSIP REM.
WDM-MX50N

MEDICAL EQUIPMENT
E358550

ANSI/AAMI
ES60601-1
& CAN/CSA C22.2
N) 60601-1



This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003



(01)08809241513018(11)161001(21)MX50NDMAS0013



2016-10-01 MADE IN KOREA



WIDE Corporation

(Gomae-Dong) 12 Wongomae-Ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, 446-901, Korea
Tel : 82-31-218-1600 Fax : 82-31-274-7400

Монитор для рабочей станции врача серии RX, серии GX EIZO NANANO Corporation, Япония или серии MX WIDE Corp., Республика Корея или серии

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU OOD Deutschland GmbH, ФРГ или серии Coronis, серии Nio, серии NioColor Barco NV, Бельгия

На фото представлен: Монитор серии MX WIDE Corp.. Республика Корея (вид сзади)

Маммограф рентгеновский цифровой МРЦ-"ТМО"

комплект № _____

Предприятие-изготовитель :



АО «НИИЭМ»

143502 г.Истра Московской обл.
ул. Панфилова , д.11

тел. (495) 994-52-13
факс (49631) 5-26-92

Всего ящиков _____

Ящик № _____

Вед. упаковки № _____

Дата упаковки _____

Грузополучатель:

ОСТОРОЖНО!


НЕ КАНТОВАТЬ!

Габаритные размеры
(см)


Брутто (кг)

Нетто (кг)

18. На фото представлена: маркировка упаковки при транспортировании МРЦ- «ТМО».

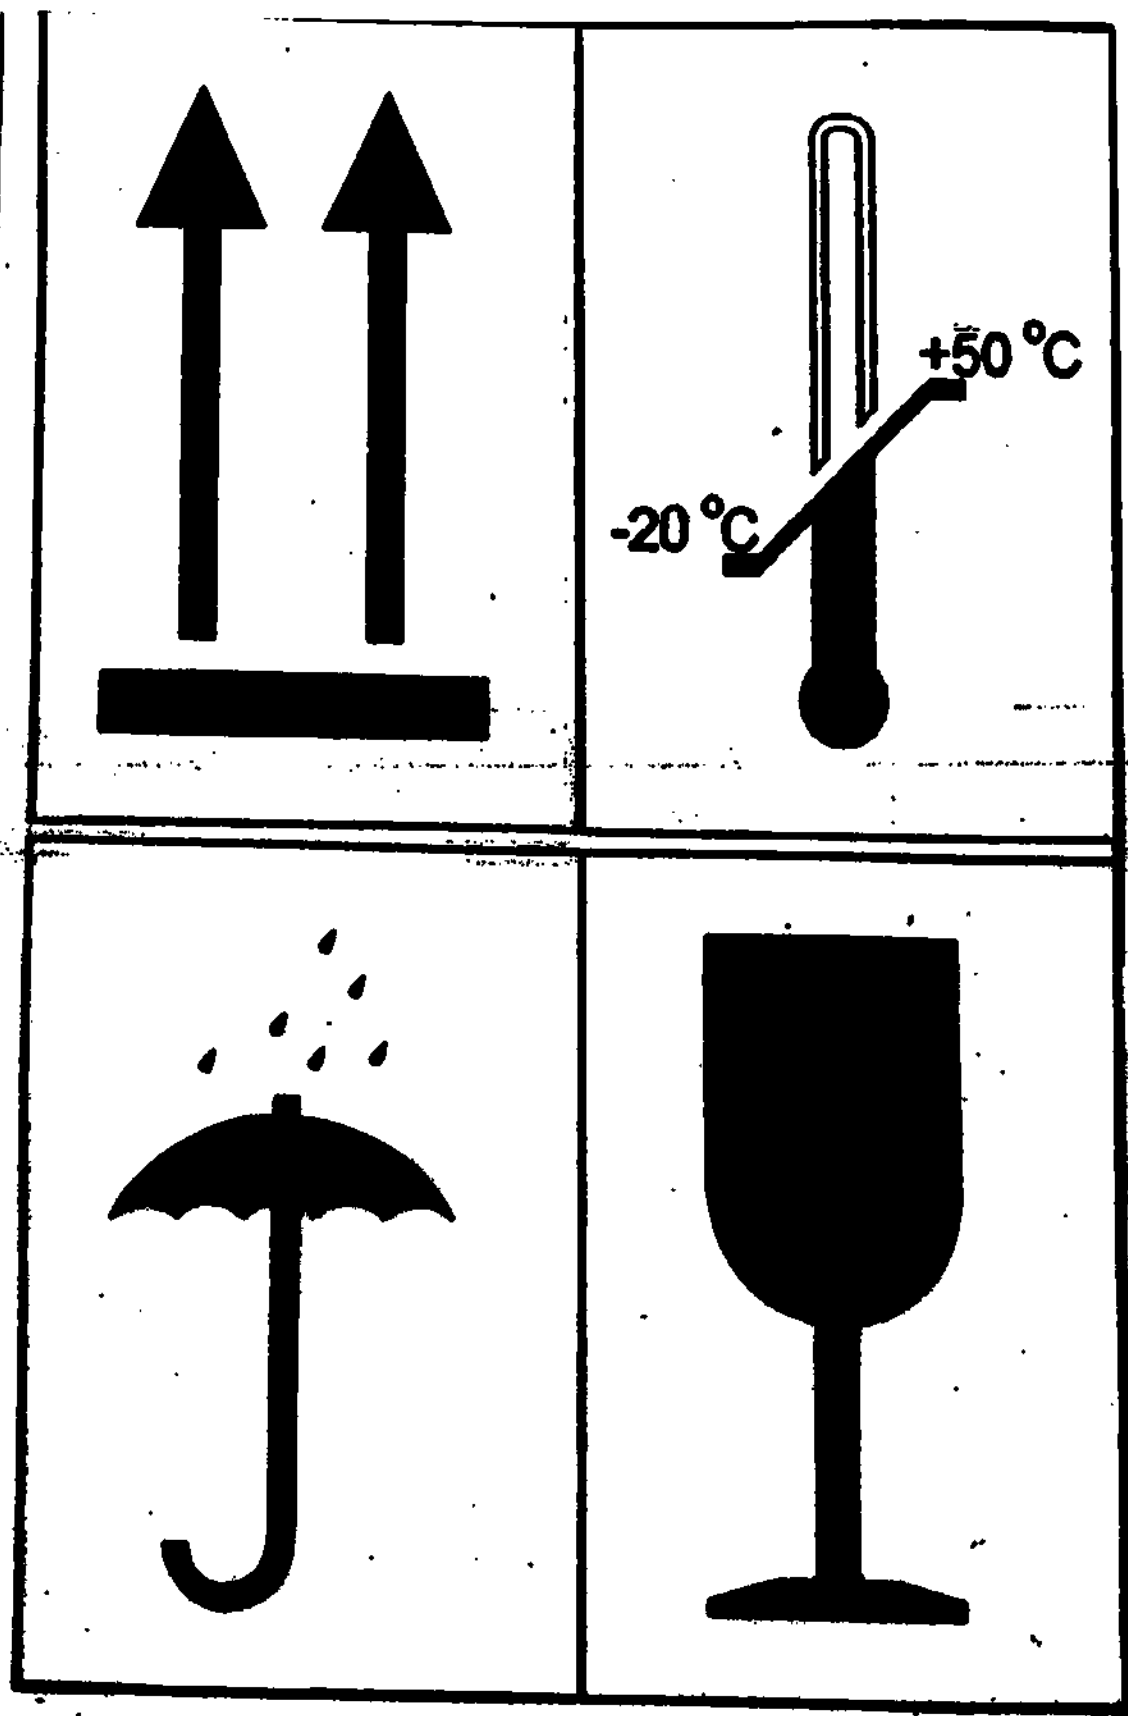

На фото представлена: маркировка упаковки при транспортировании МРЦ- «ТМО».

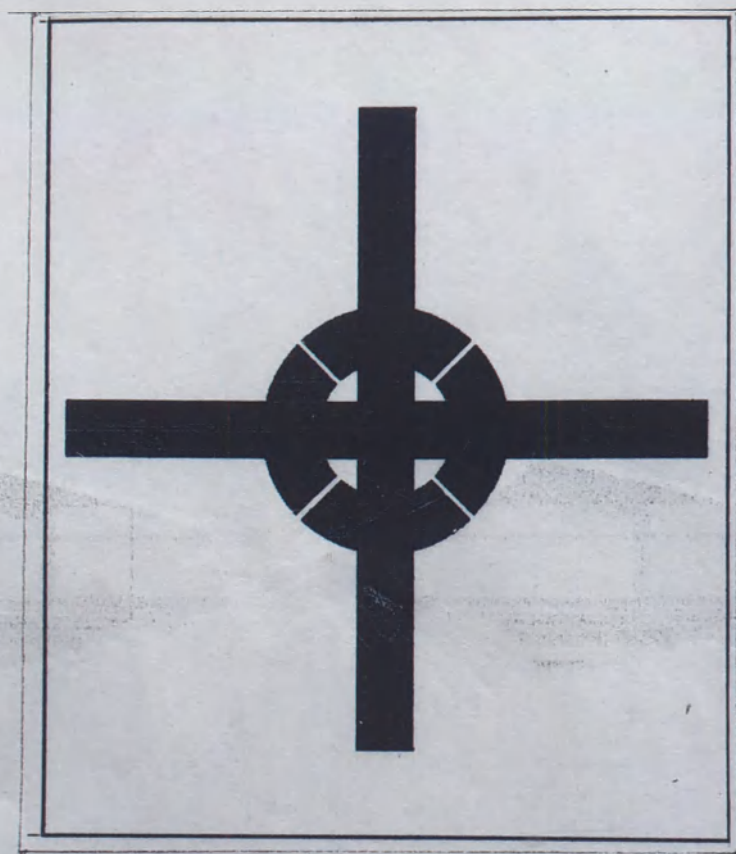

На фото представлена: маркировка упаковки при транспортировании МРЦ- «ТМО».

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
36 (тридцать шесть) листа(ов)

Заместитель генерального
директора по медицинской технике


В. А. Растеряев

