

Фотографические изображения


Трансплантат ксеногенный костный A-Oss,

производства

«Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.), Корея



Генеральный директор
ООО «ОССТЕМ»
Ли Чжэ Ву

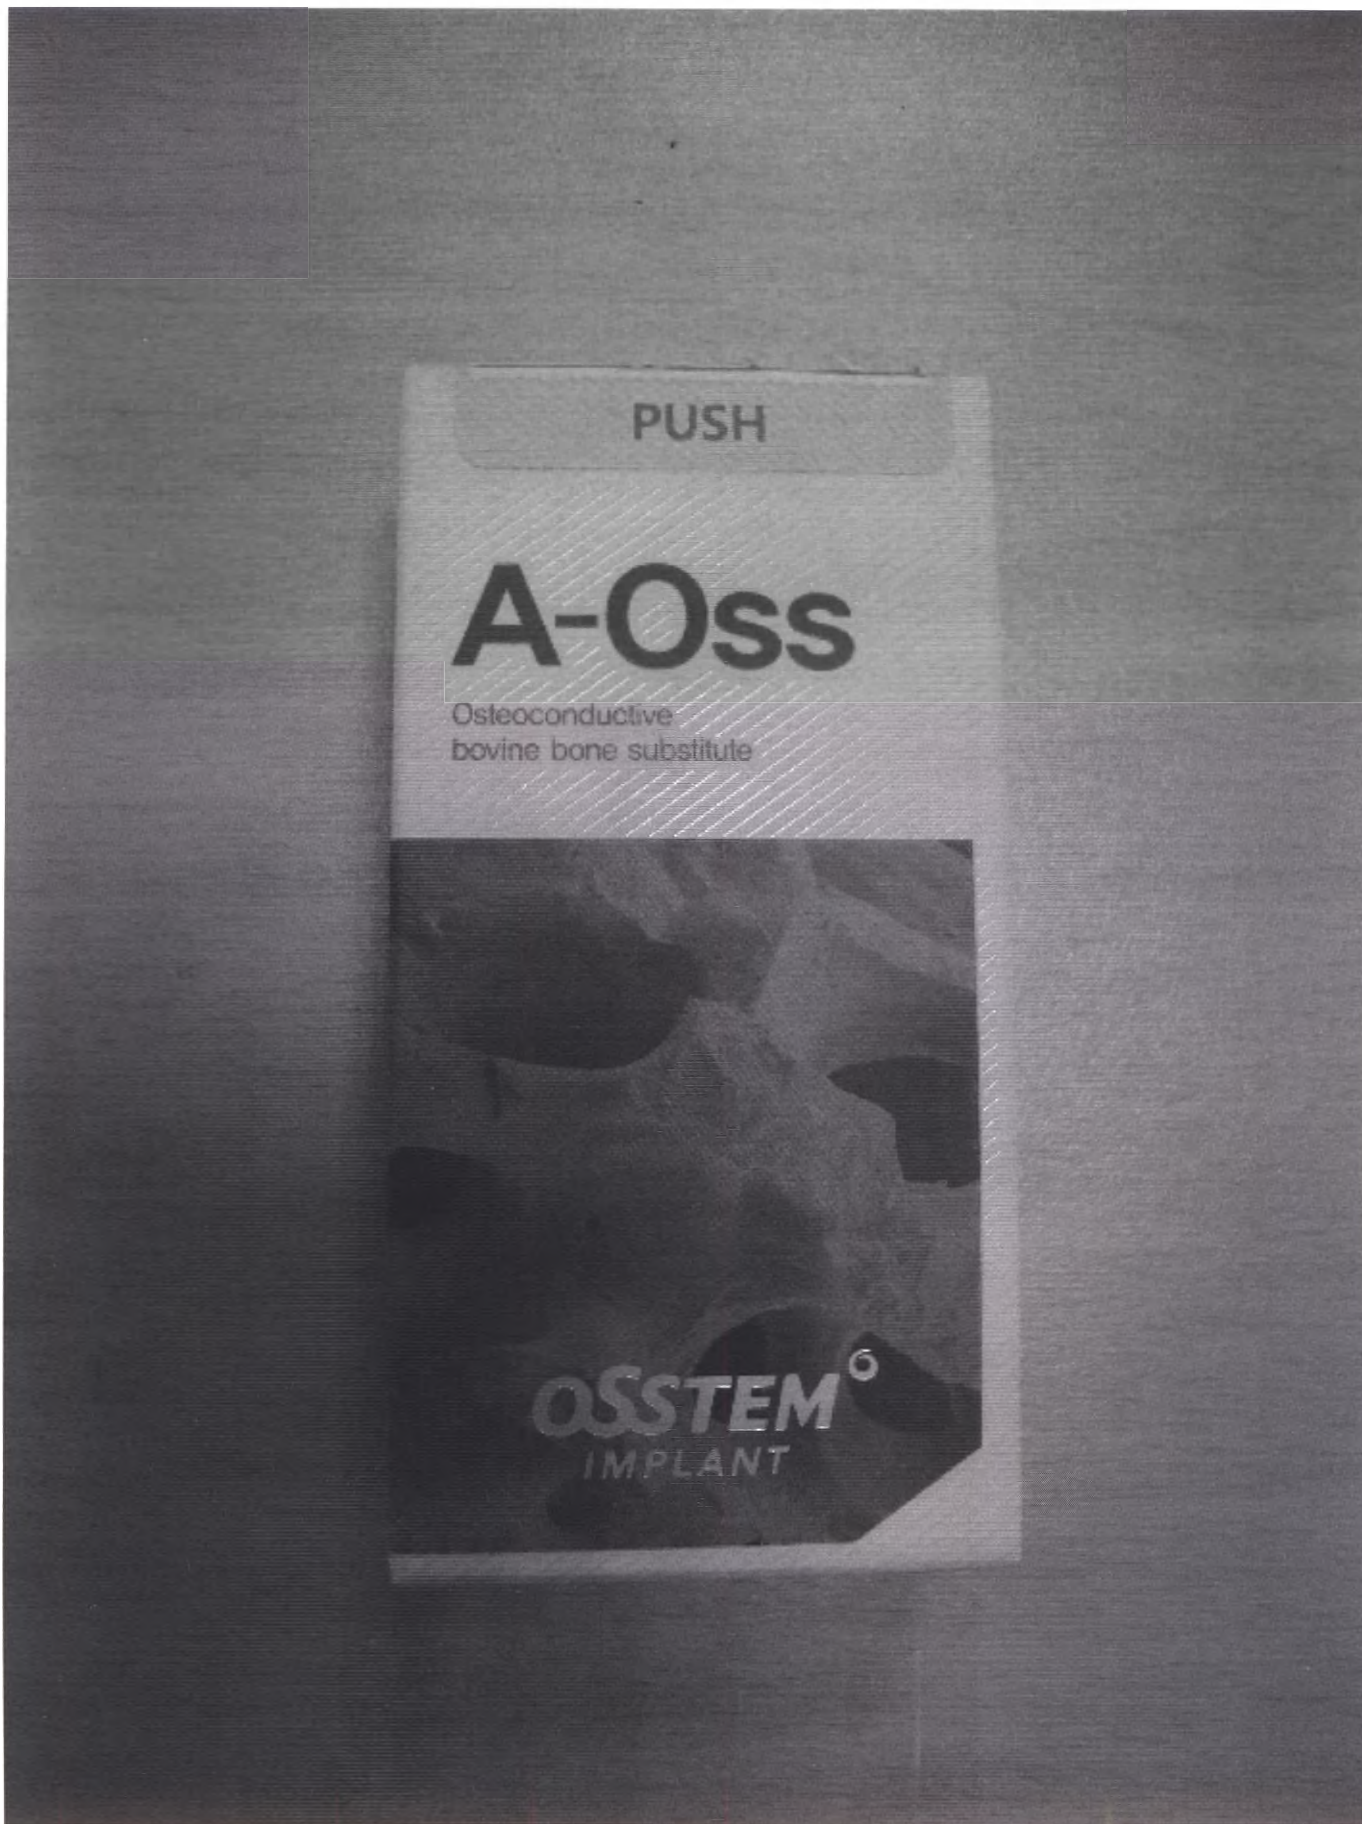


Вторичная упаковка
на примере Трансплантат ксеногенный костный А-Oss, вариант исполнения: BAS10 (0,25-1,0 мм (S), 1,0 г (2.0cc))



Первичная упаковка

Трансплантат ксеногенный костный A-Oss, вариант исполнения: BAS10 (0,25-1,0 мм (S), 1,0 г (2.0cc))

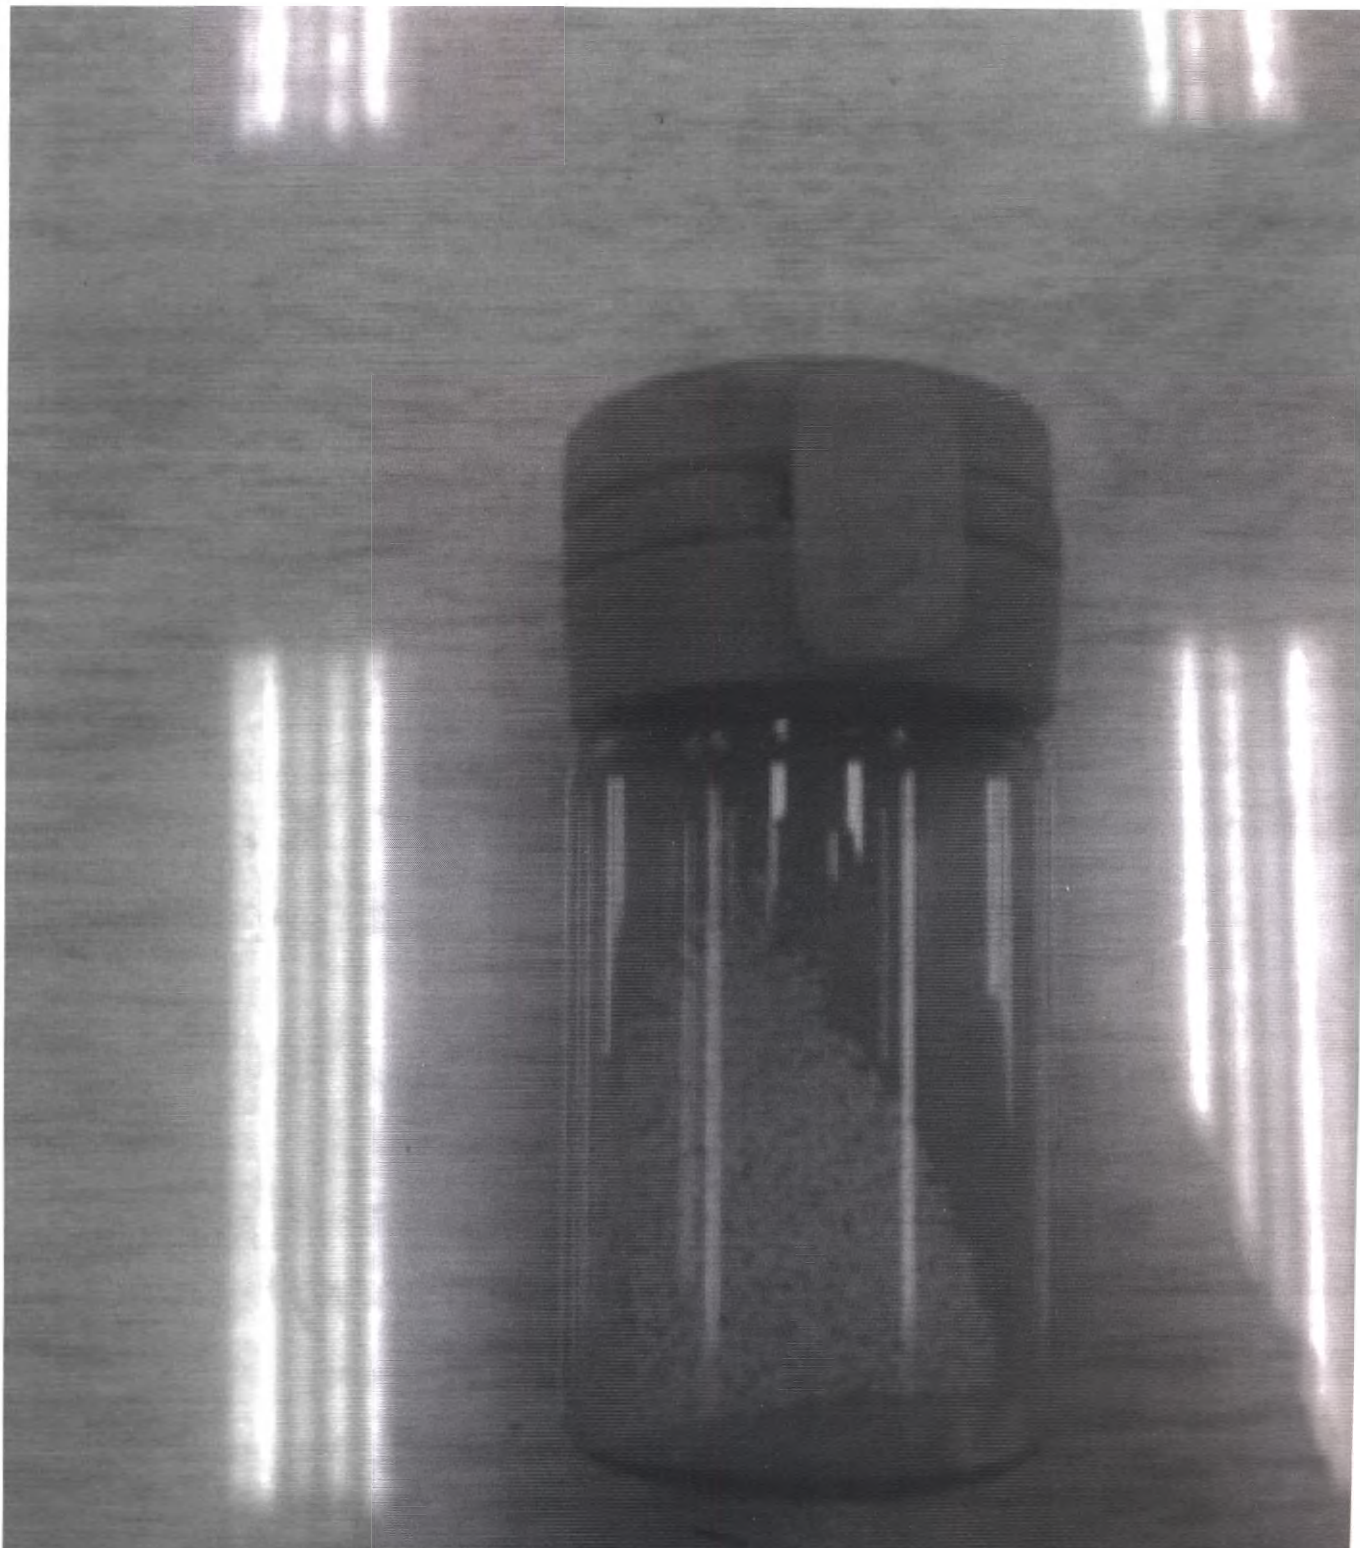


Трансплантат ксеногенный костный A-Oss, вариант исполнения: BAS10 (0,25-1,0 мм (S), 1,0 г (2.0cc)) – в первичной упаковке

Варианты исполнения

- BAS01 (0,25-1,0 мм (S), 0,1 г (0.2cc));
- BAS02 (0,25-1,0 мм (S), 0,25 г (0.5cc));
- BAS05 (0,25-1,0 мм (S), 0,5 г (1.0cc));
- BAS10 (0,25-1,0 мм (S), 1,0 г (2.0cc));
- BAS20 (0,25-1,0 мм (S), 2,0 г (4.0cc));
- BAL01 (1,0-2,0 мм (L), 0,1 г (0.3cc));
- BAL02 (1,0-2,0 мм (L), 0,25 г (0.75cc));
- BAL05 (1,0-2,0 мм (L), 0,5 г (1.5cc));
- BAL10 (1,0-2,0 мм (L), 1,0 г (3.0cc));
- BAL20 (1,0-2,0 мм (L), 2,0 г (6.0cc)).

Имеют идентичный внешний вид, отличаются только размером частиц и массой.

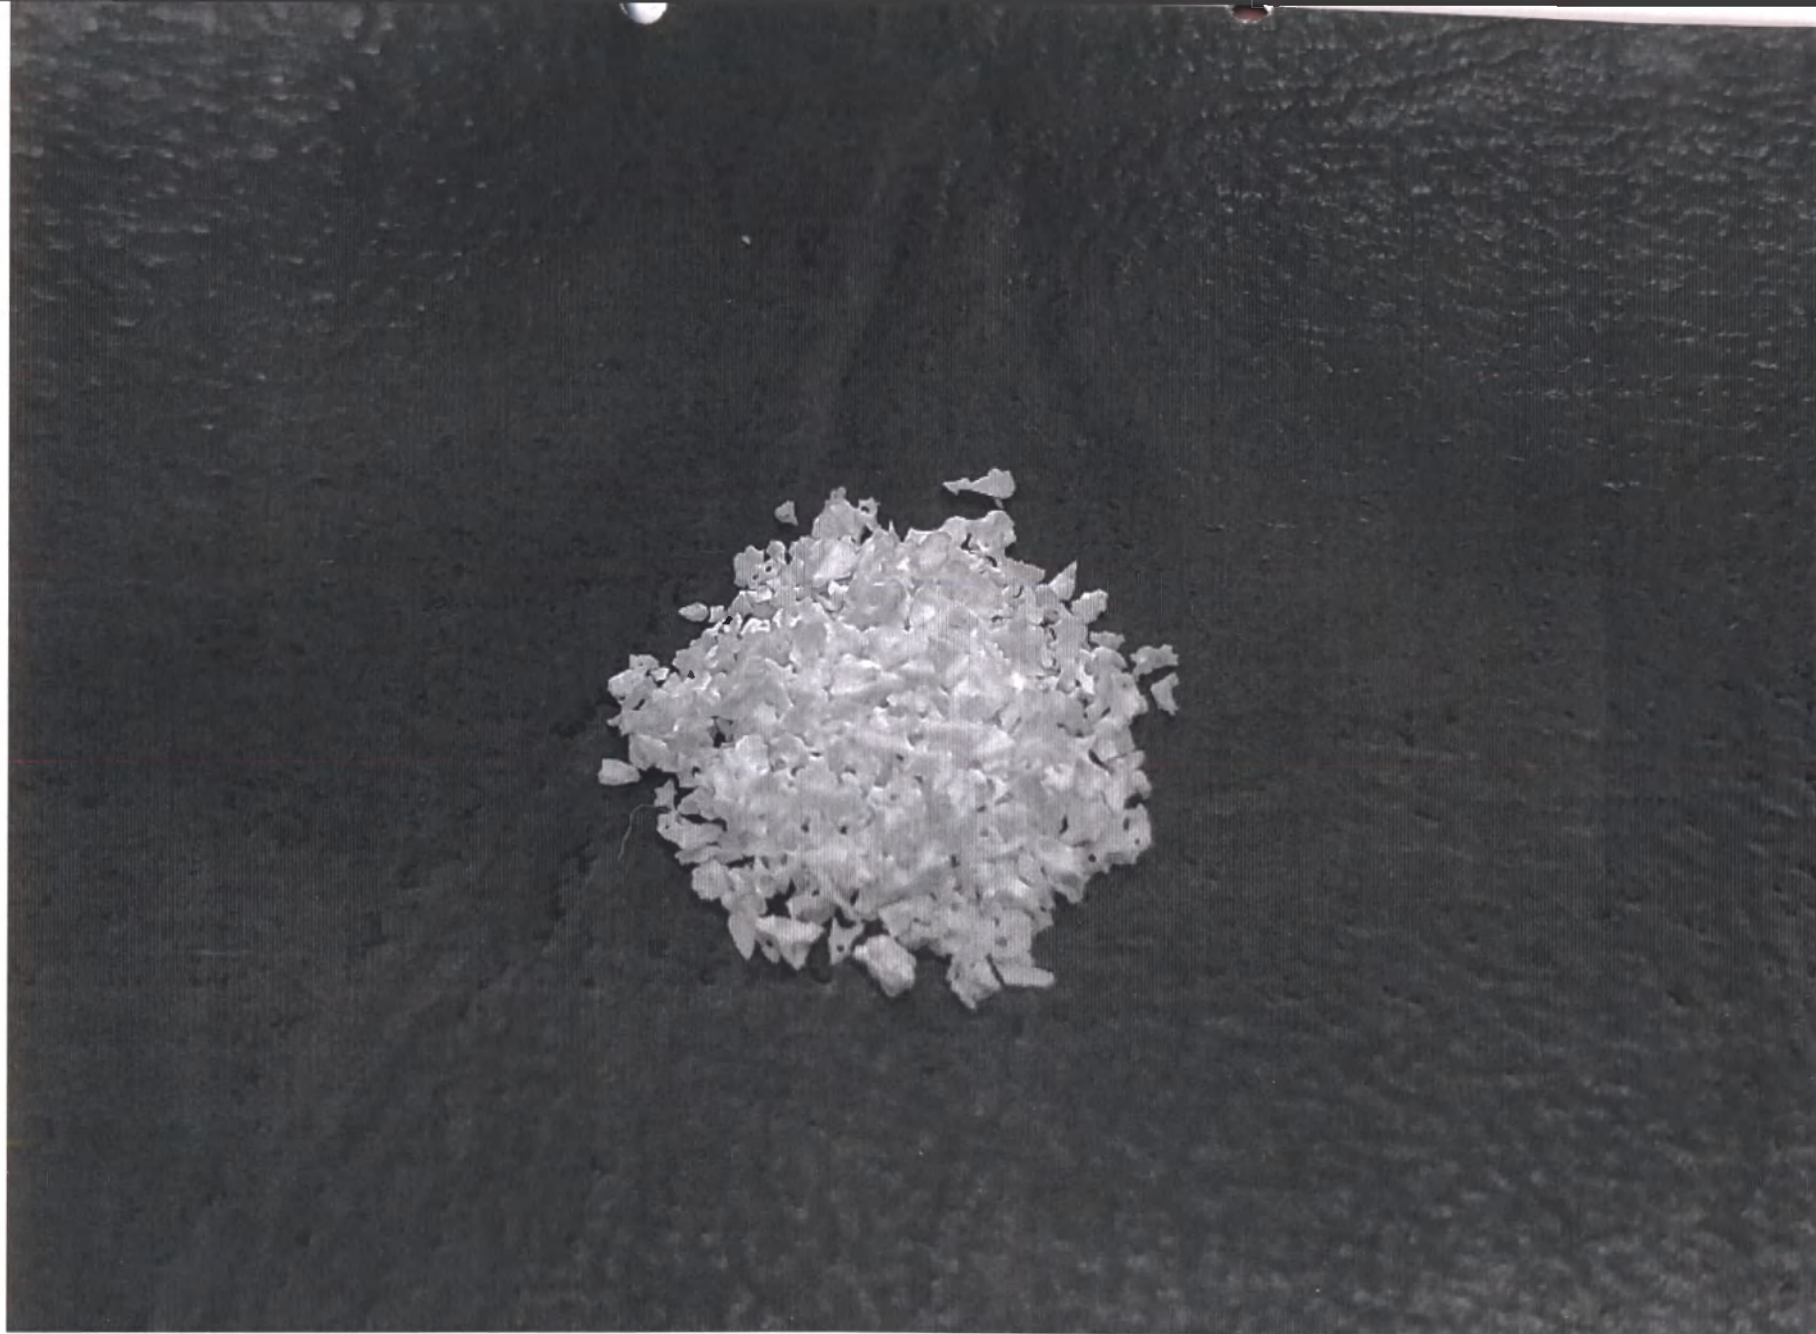

Внешний вид изделия

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (пять) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность Технической дирекции

Подпись А. М. А. / Ли Сян Ву

« 25 » ноября 20 19 г. М. П.

