

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Смарт Оптикс»

Рябенко М. В.



«07» ноября 2018 г.

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ ЖЕСТКИЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМЫЕ СКЛЕРАЛЬНЫЕ

по ТУ 32.50.41-006-01738989-2018

Фотографические изображения медицинского изделия

Рисунок 1. Общий вид изделия линзы контактные жесткие газопроницаемые склеральные по ТУ 32.50.41-006-01738989-2018

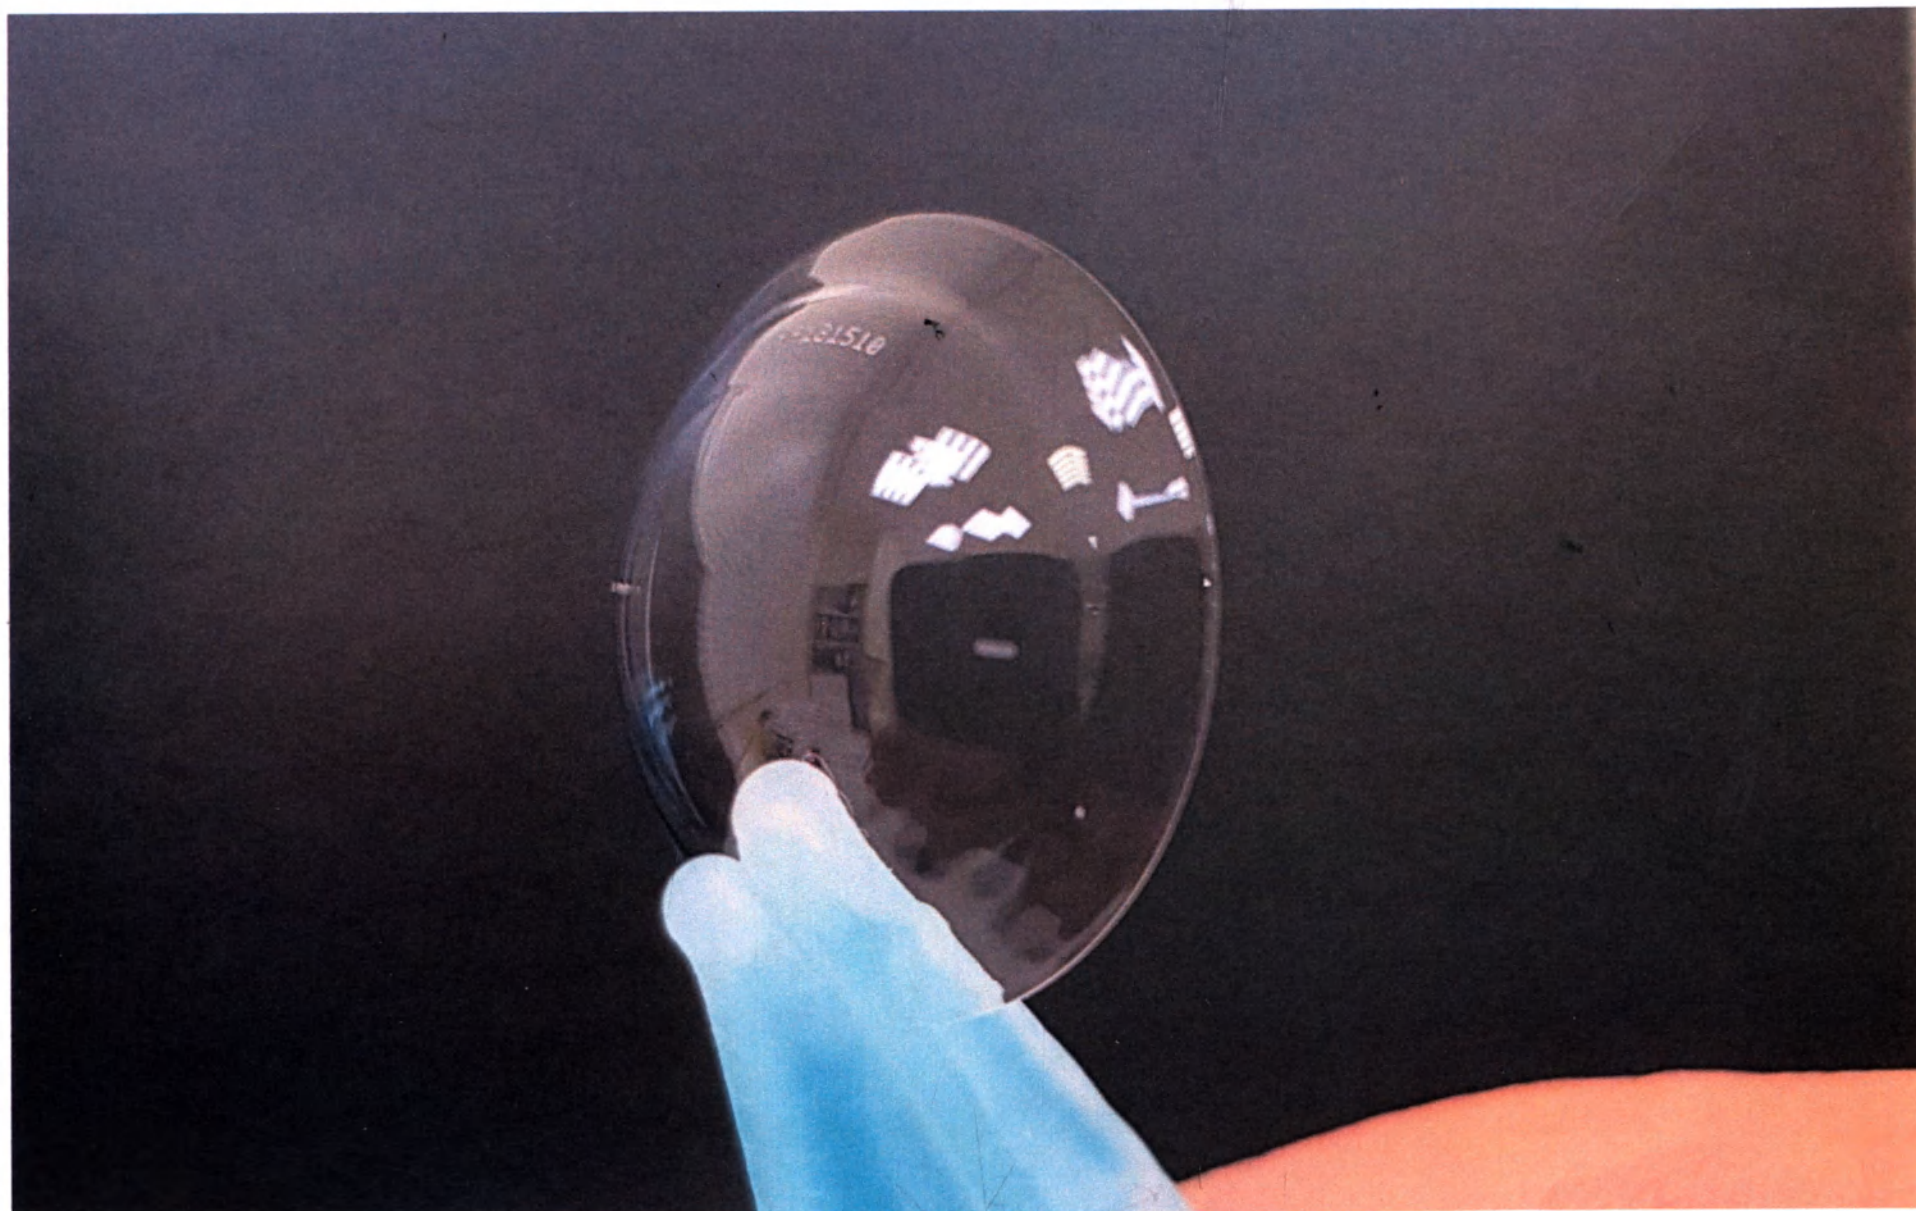


Рисунок 2. Общий вид линзы контактные жесткие газопроницаемые склеральные по ТУ 32.50.41-006-01738989-2018, вариант исполнения Zenlens / Зенленс

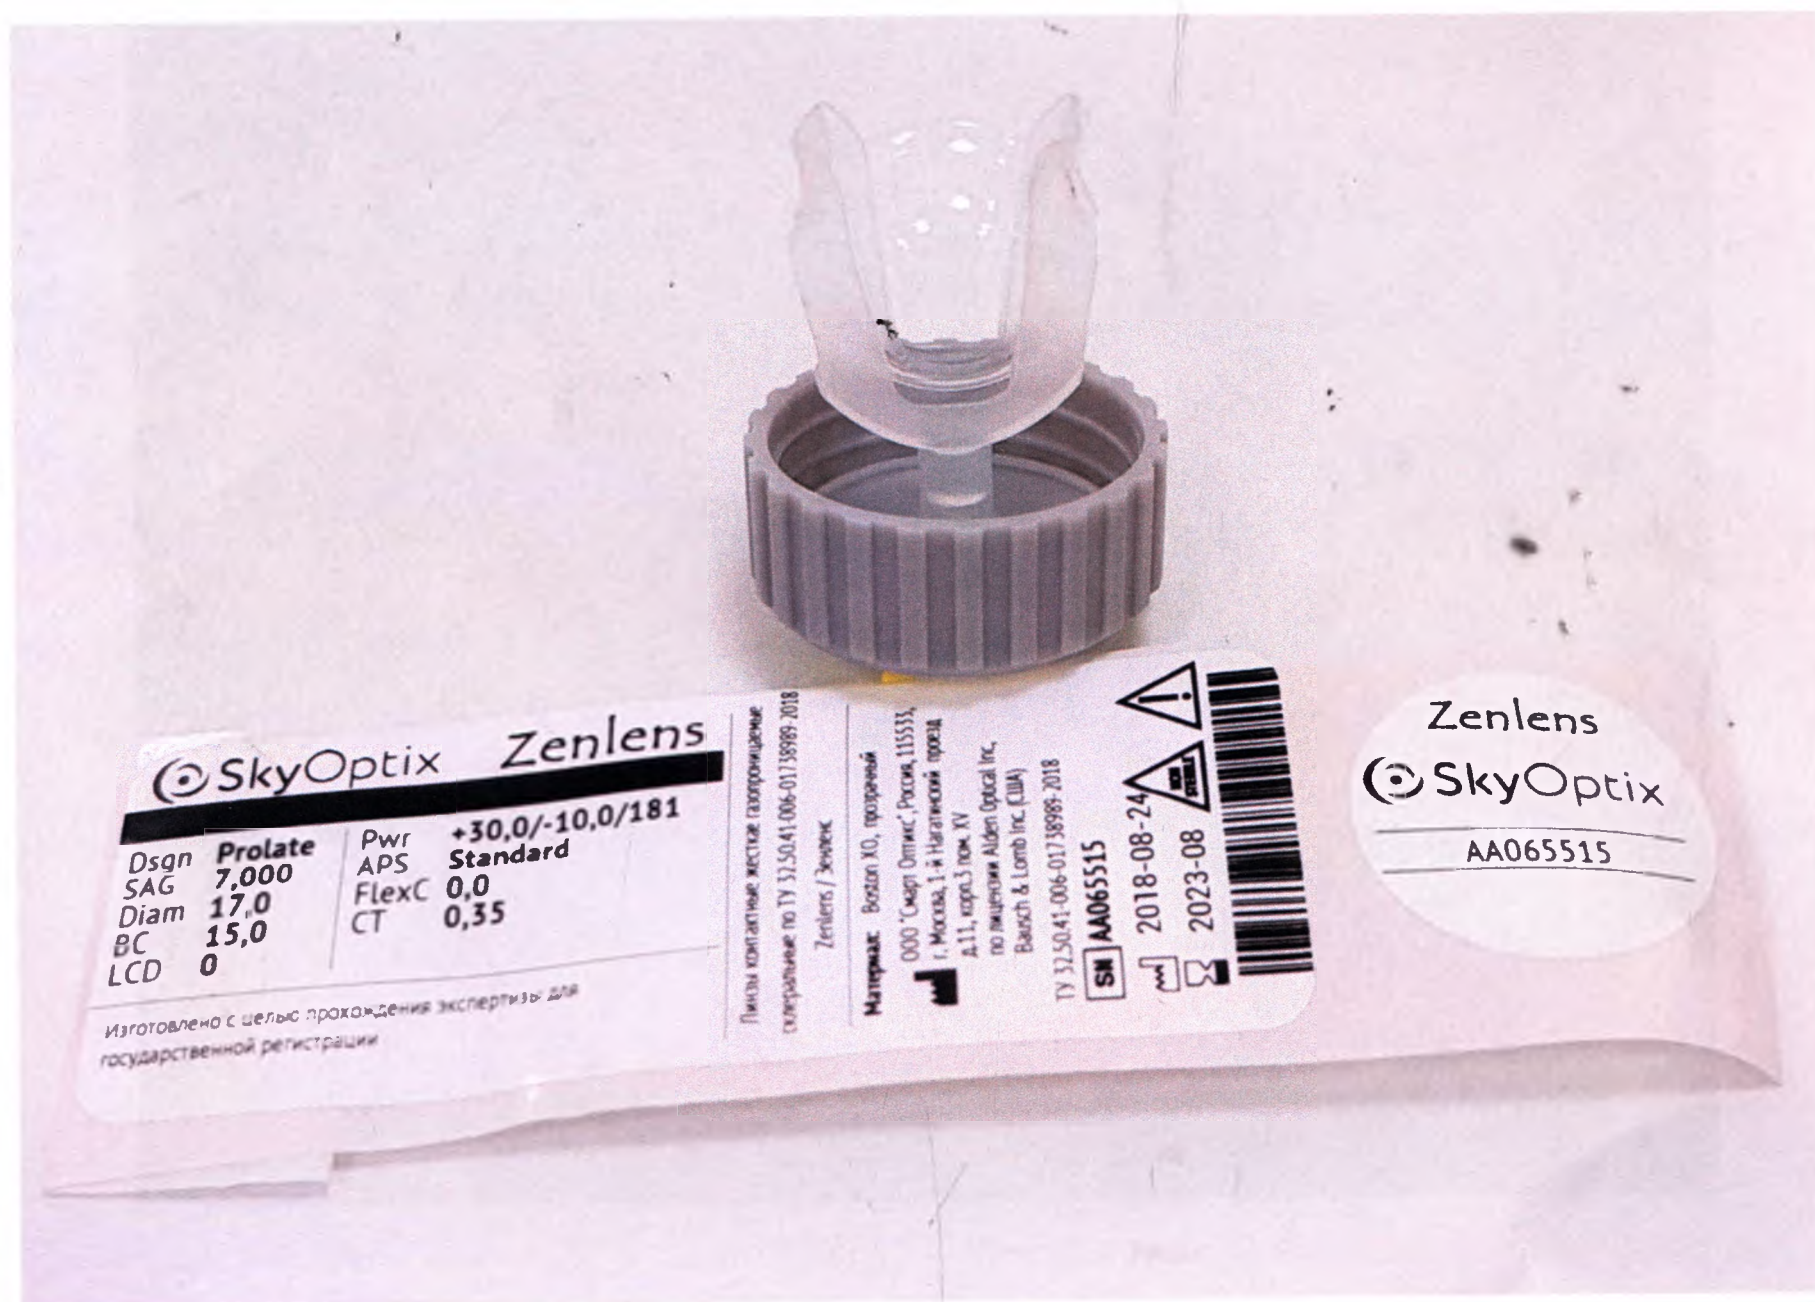


Рисунок 3. Контейнер и маркировка линзы контактные жесткие газопроницаемые склеральные по ТУ 32.50.41-006-01738989-2018, вариант исполнения Zenlens / Зенленс

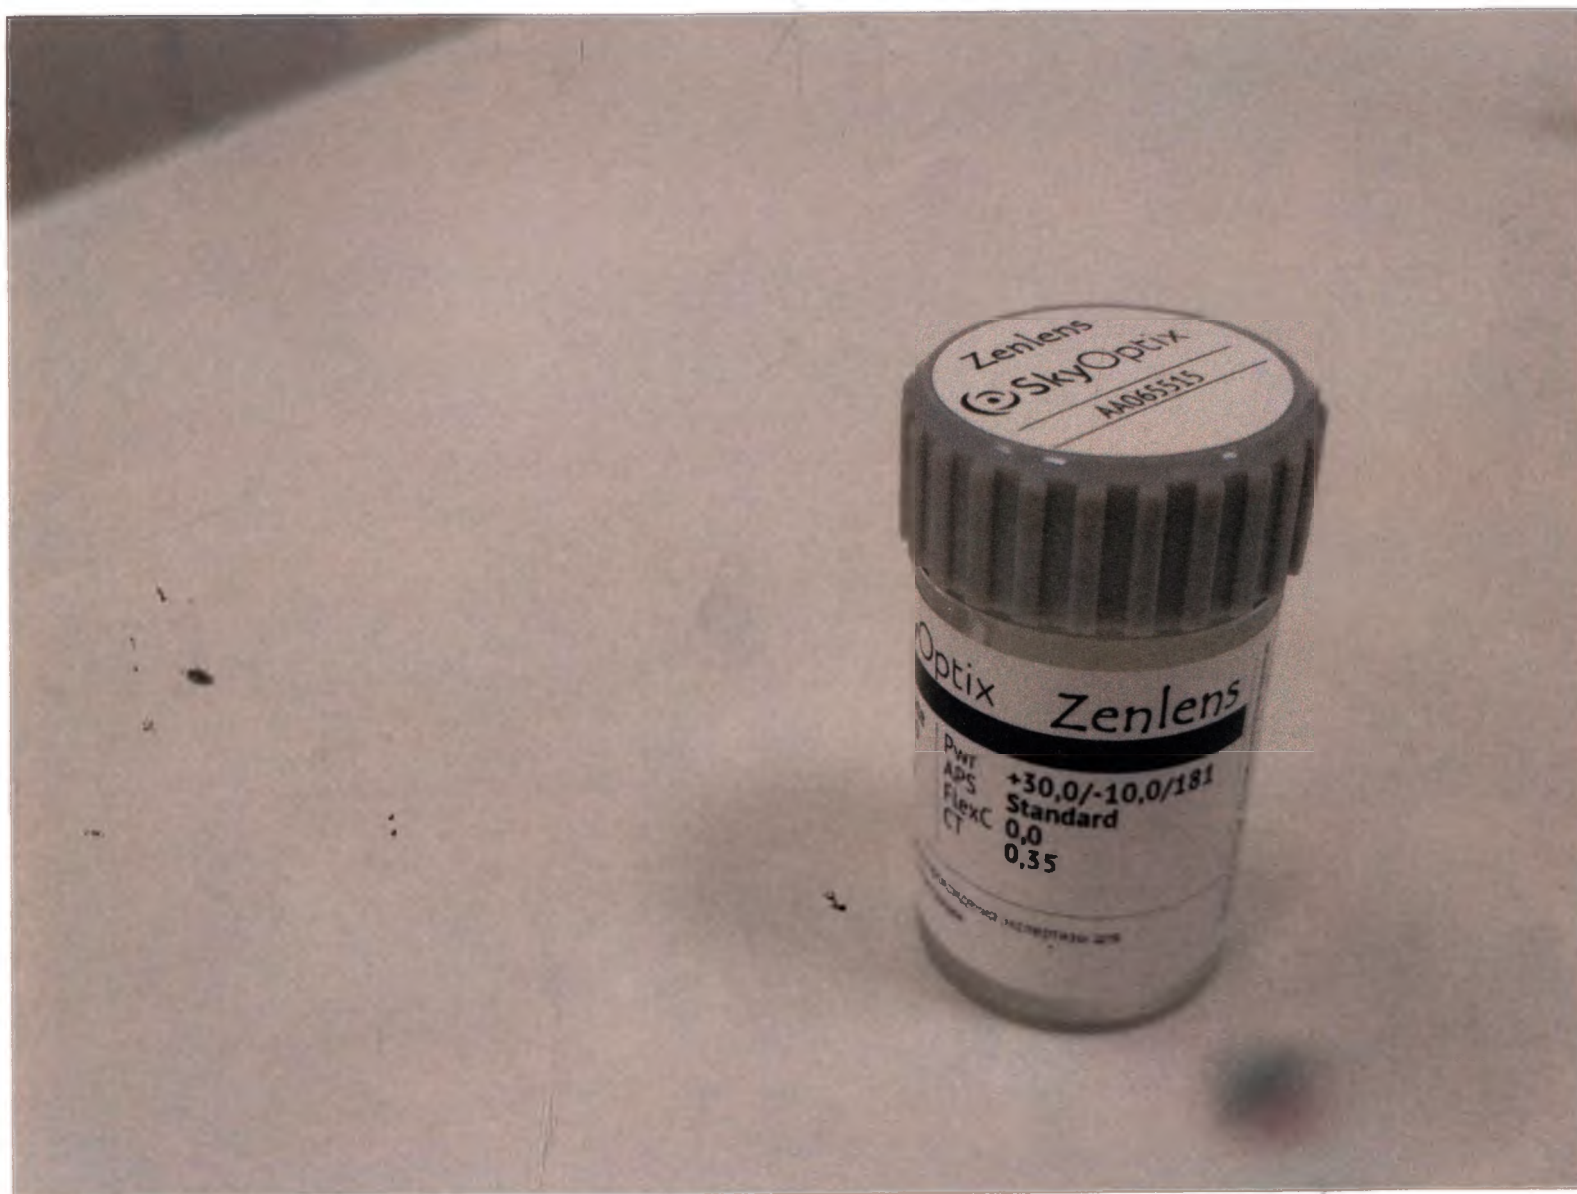


Рисунок 4. Общий вид и маркировка линзы контактные жесткие газопроницаемые склеральные по ТУ 32.50.41-006-01738989-2018, вариант исполнения ZenRC / ЗенРС

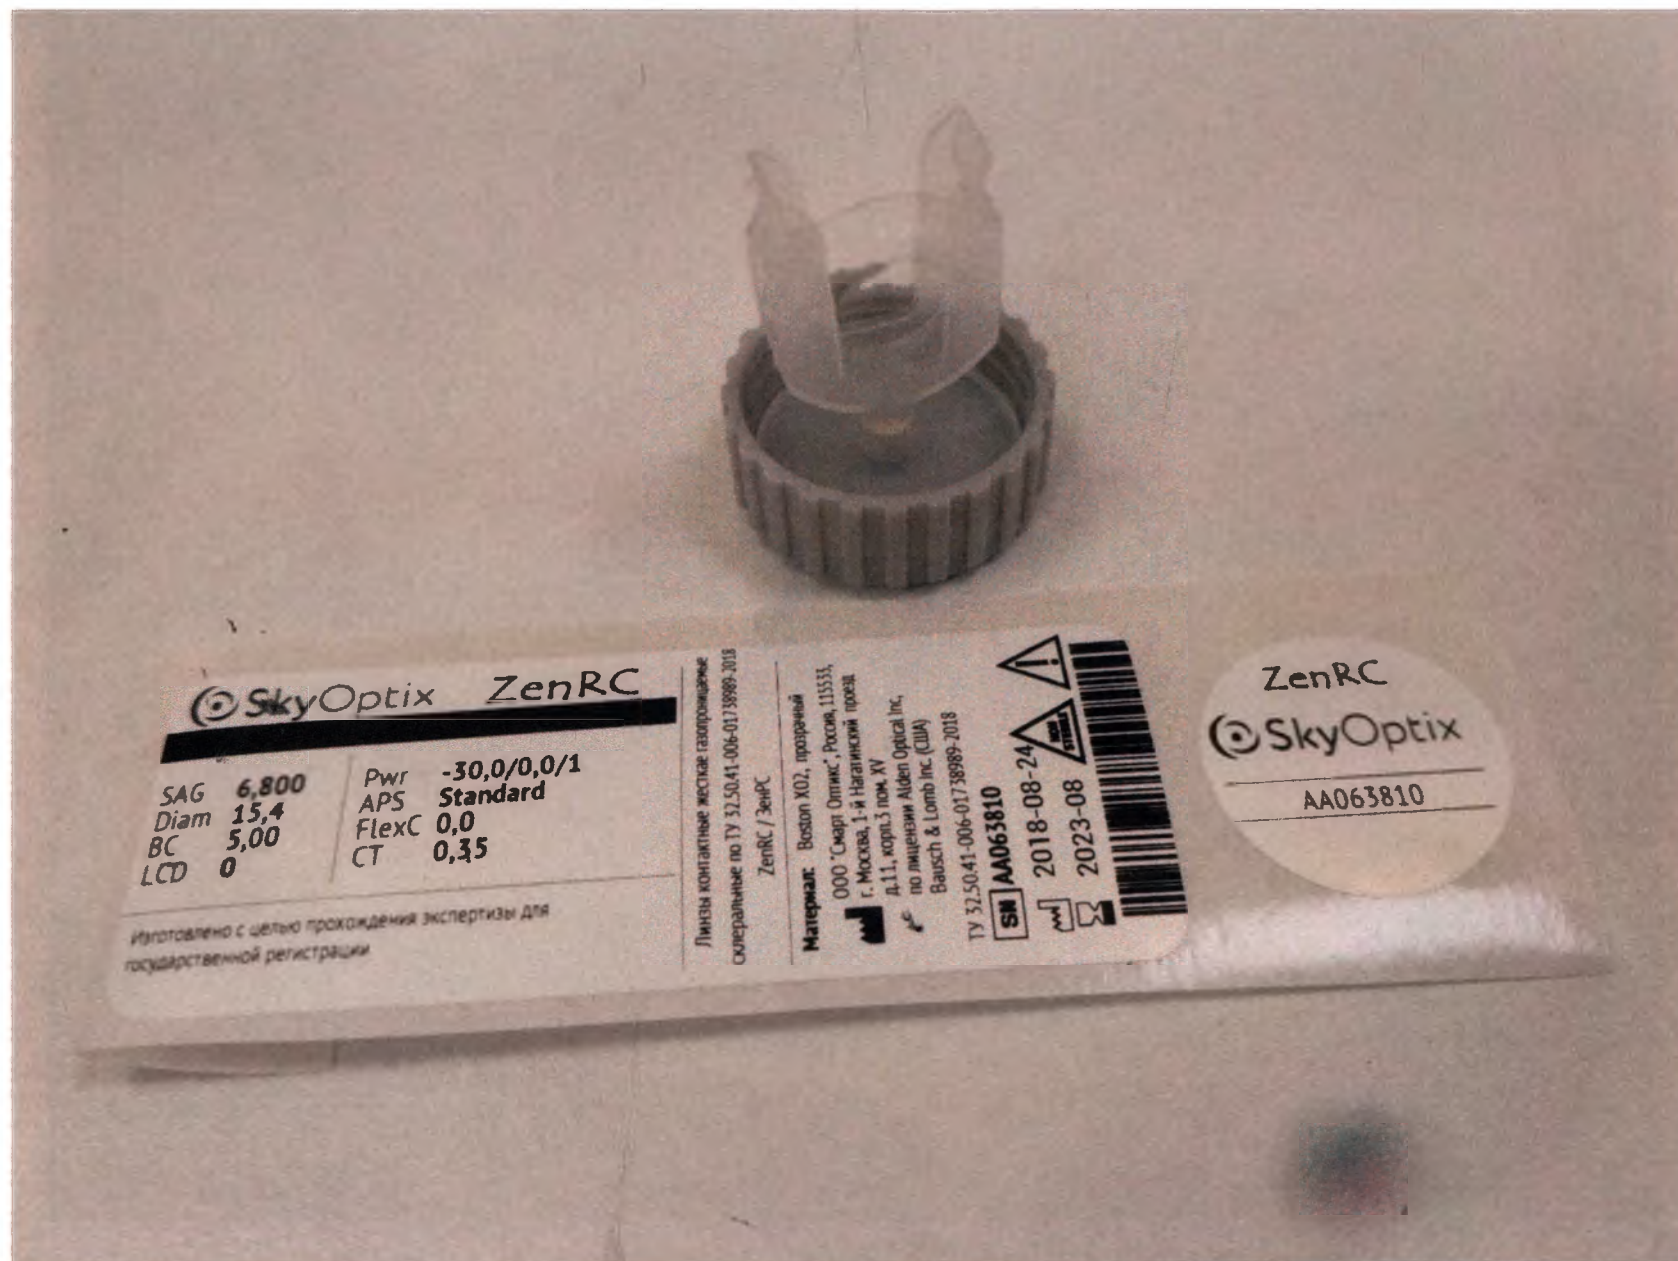


Рисунок 5. Контейнер и маркировка линзы контактные жесткие газопроницаемые склеральные по ТУ 32.50.41-006-01738989-2018, вариант исполнения ZenRC / ЗенРС

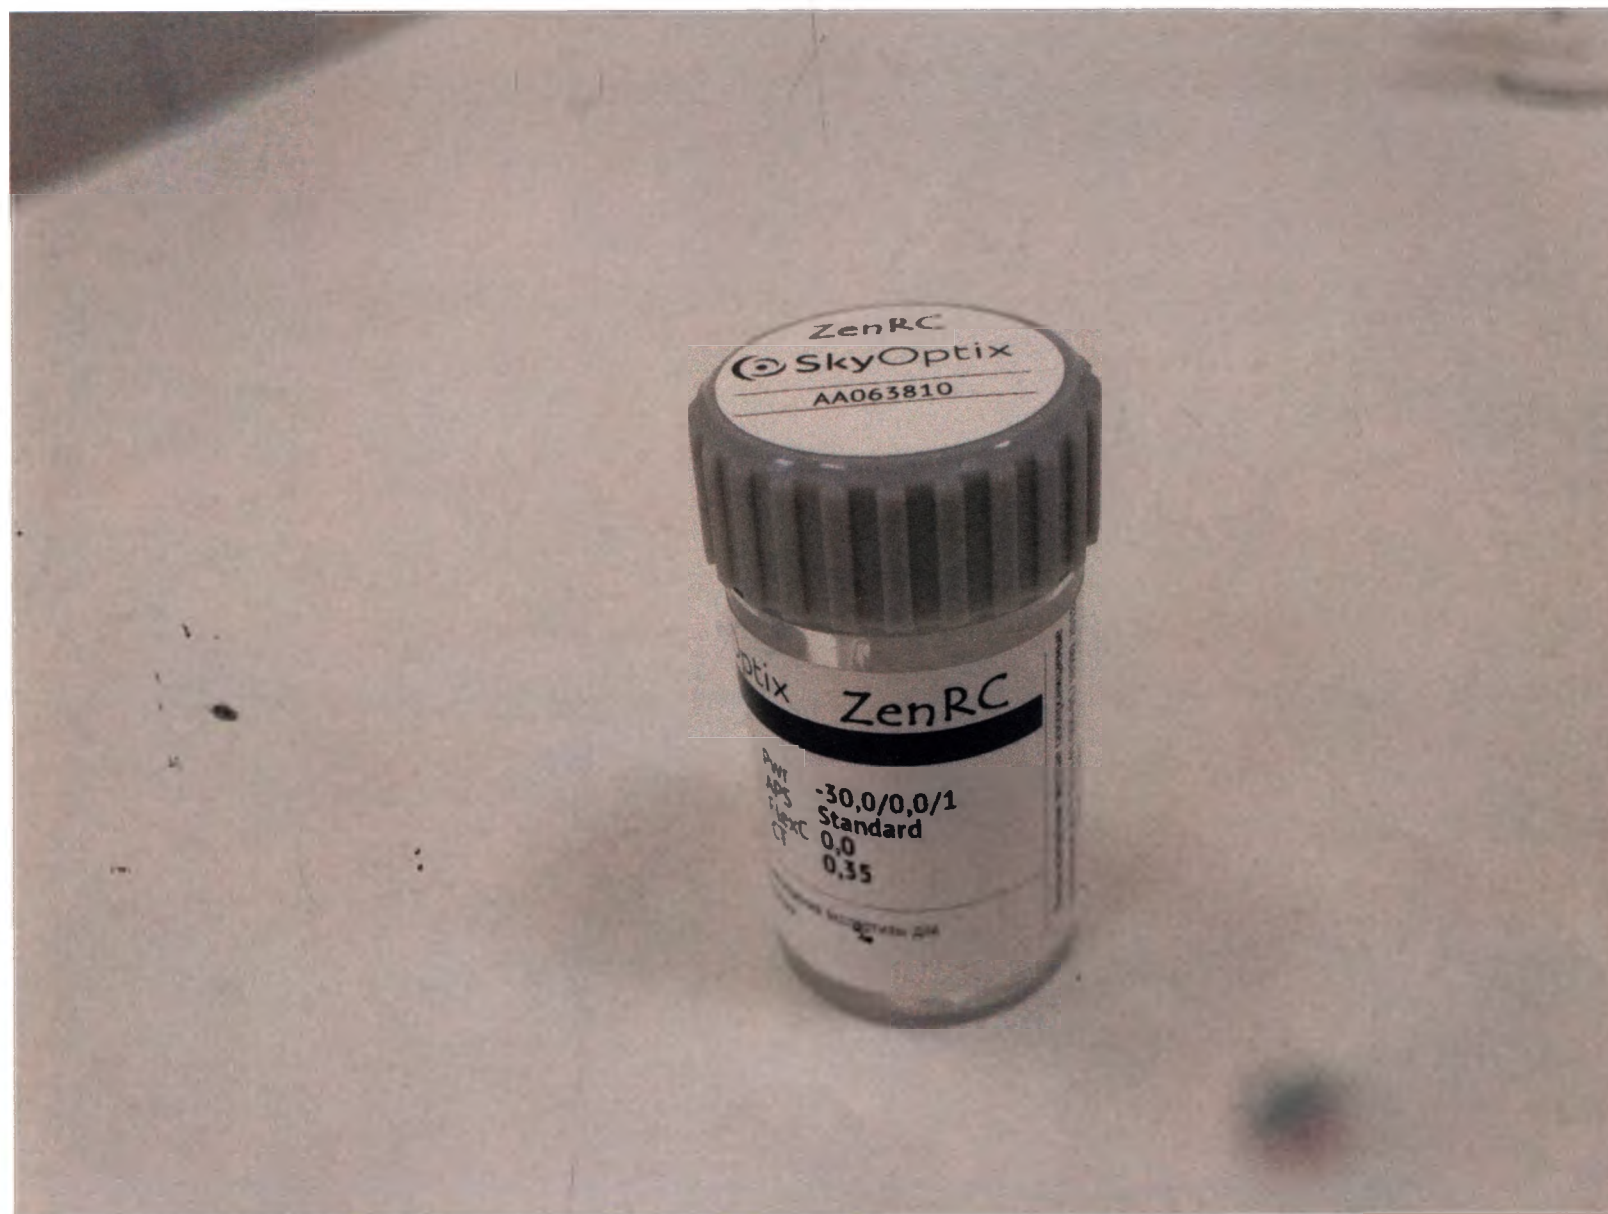


Рисунок 6. Общий вид и маркировка линзы контактные жесткие газопроницаемые склеральные по ТУ 32.50.41-006-01738989-2018, вариант исполнения MacroZen/ МакроЗен


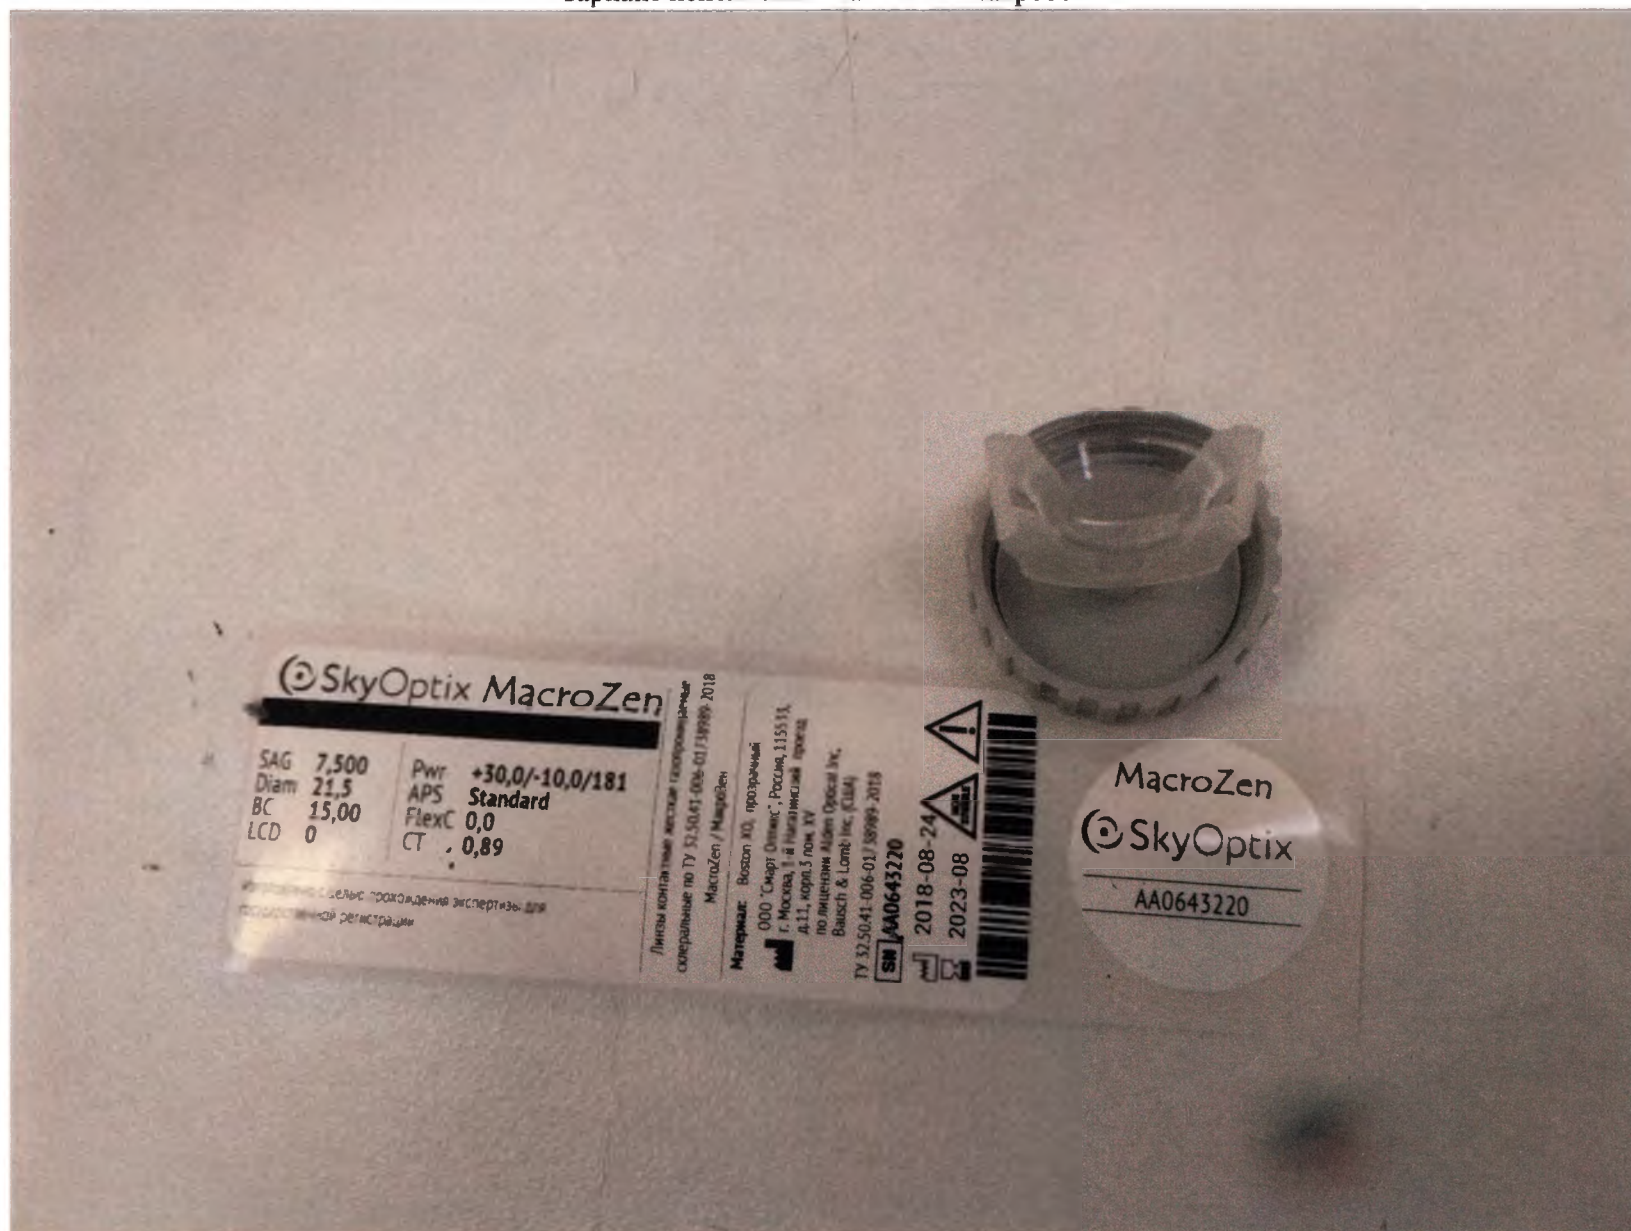


Рисунок 7. Контейнер и маркировка линзы контактные жесткие газопроницаемые склеральные по ТУ 32.50.41-006-01738989-2018, вариант исполнения MacroZen/ МакроЗен

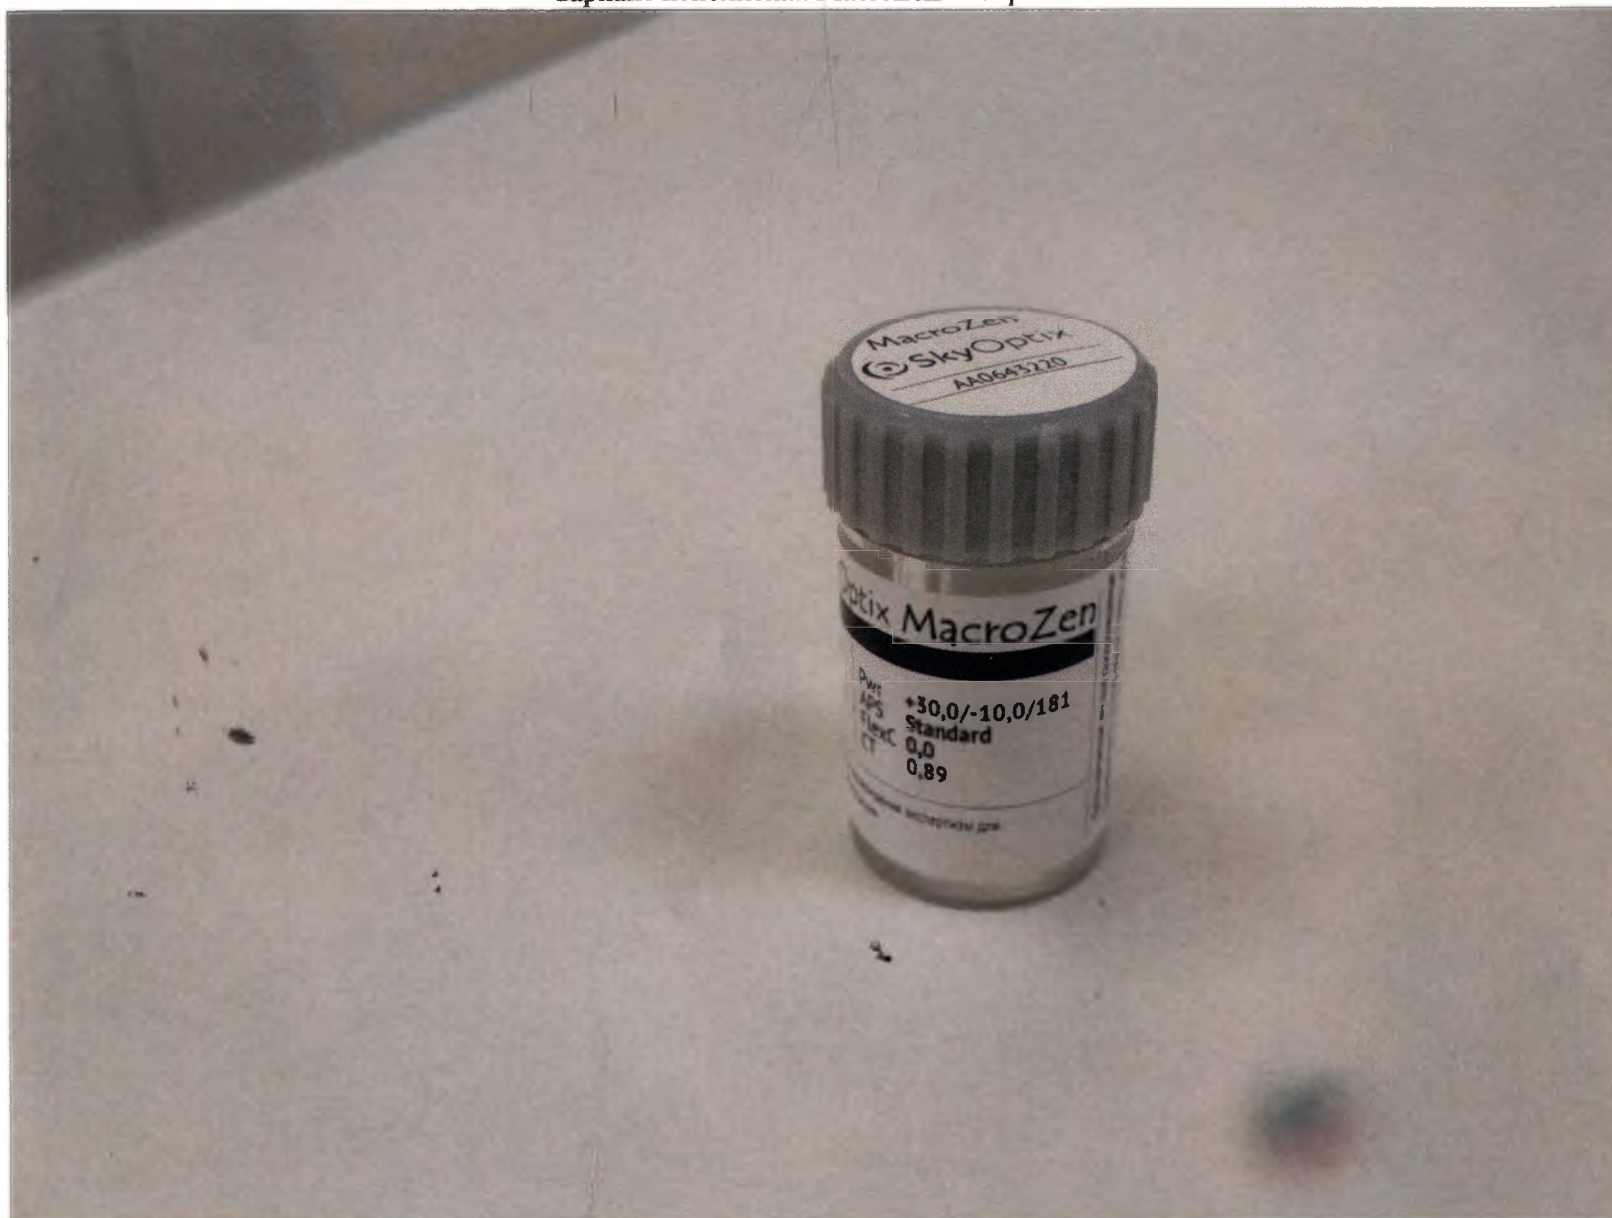

Проинформировано, пронумеровано и скреплено
печатью 8 (восемь) листов

01.11.18.

Генеральный директор ООО «Смарт Оптик»
Рябенко М.В.

