


Фотографические изображения
медицинского изделия:


Система доступа Watchman TruSeal, варианты исполнения

Производства «Бостон Сайентифик Корпорейшн», США /
Boston Scientific Corporation, USA


Общий вид интродьюсера системы доступа Watchman TruSeal

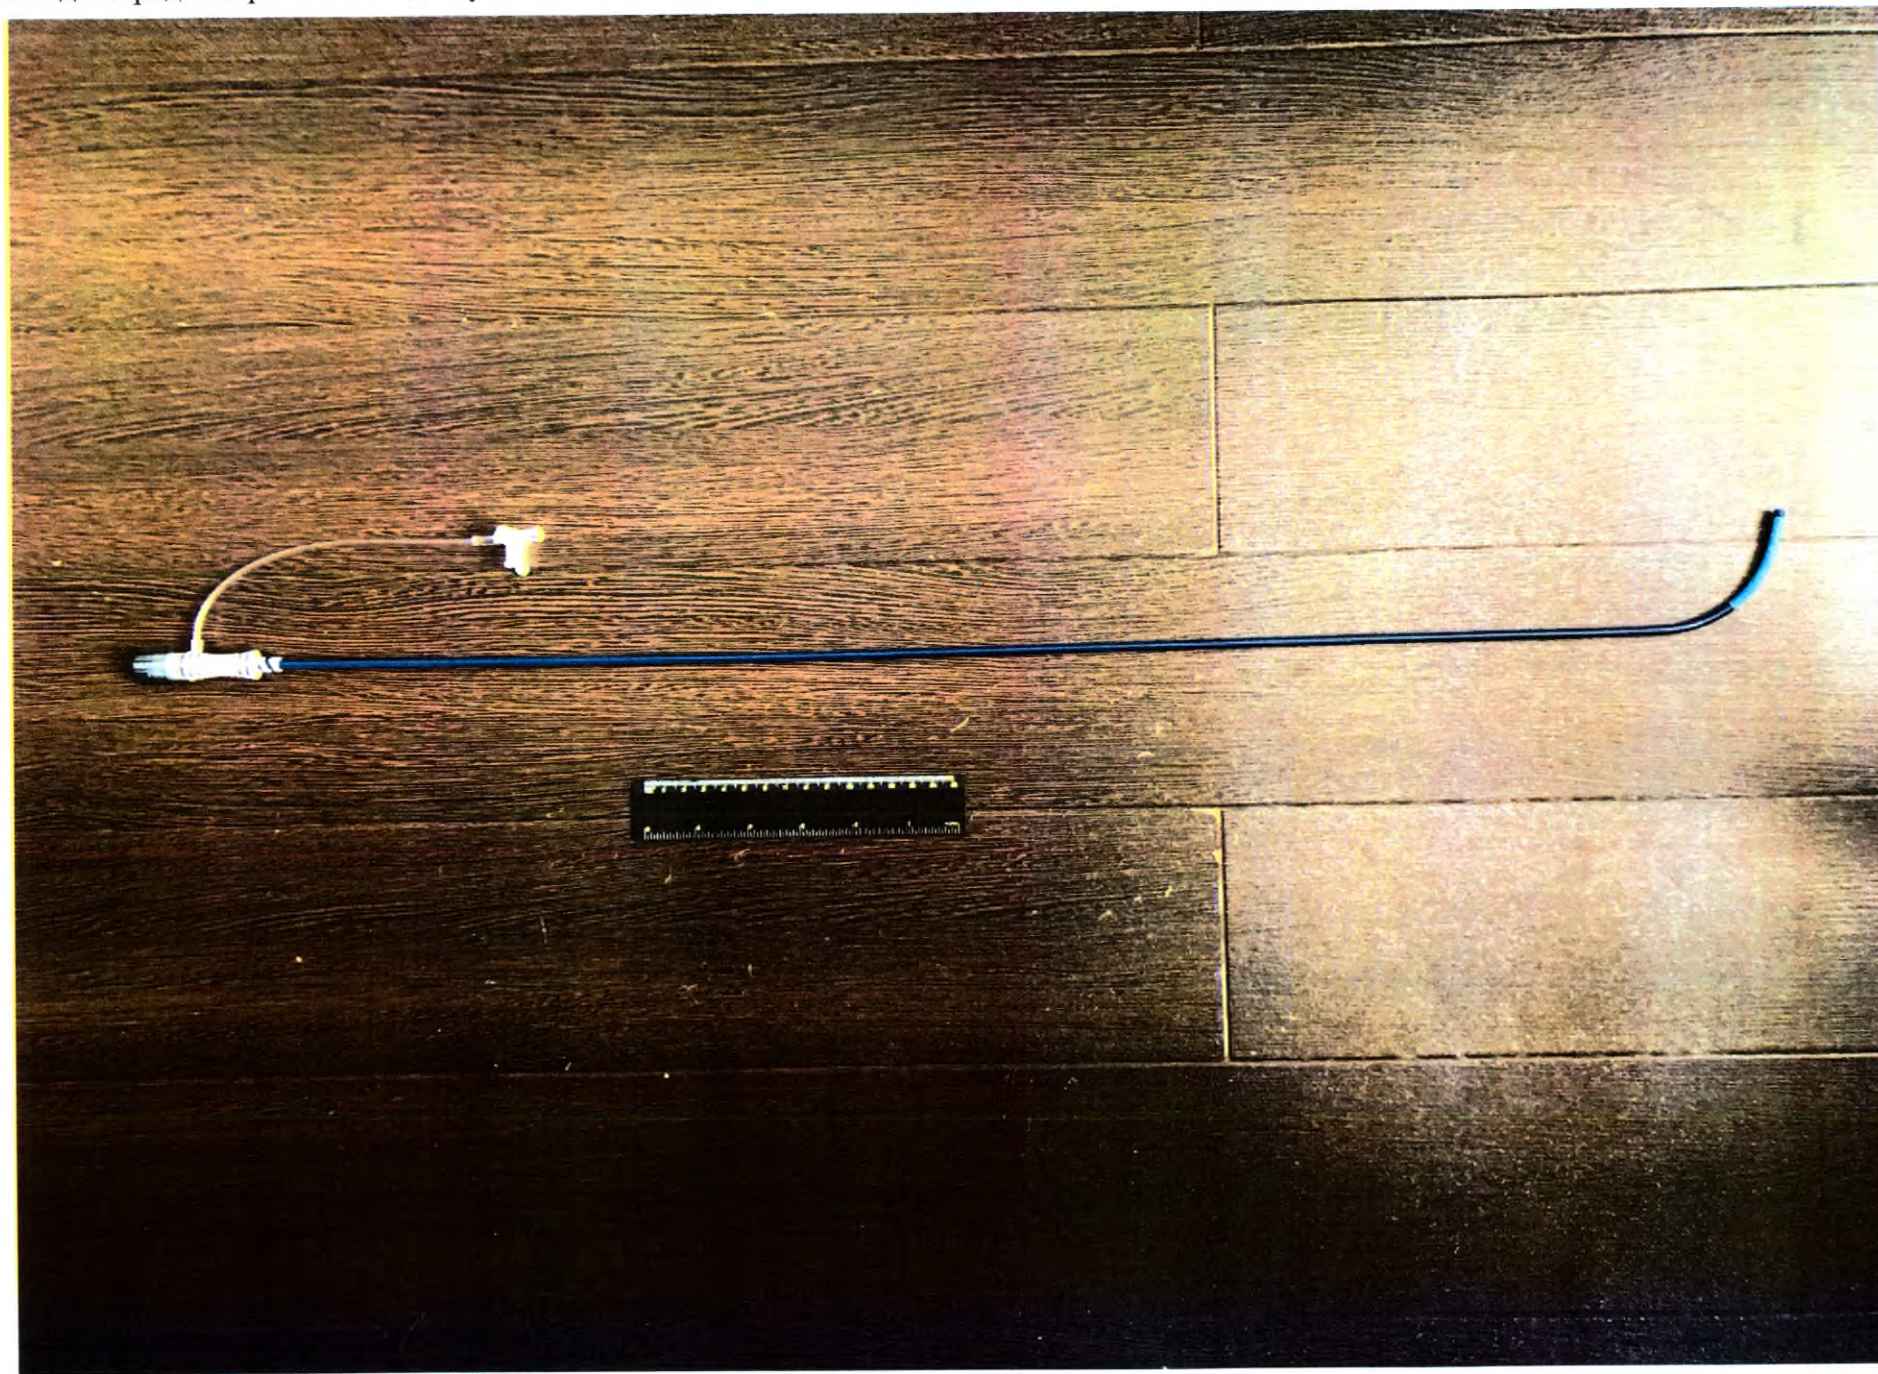


Дистальная часть shaft интродьюсера системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 1) Система доступа Watchman TruSeal, с одним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм)

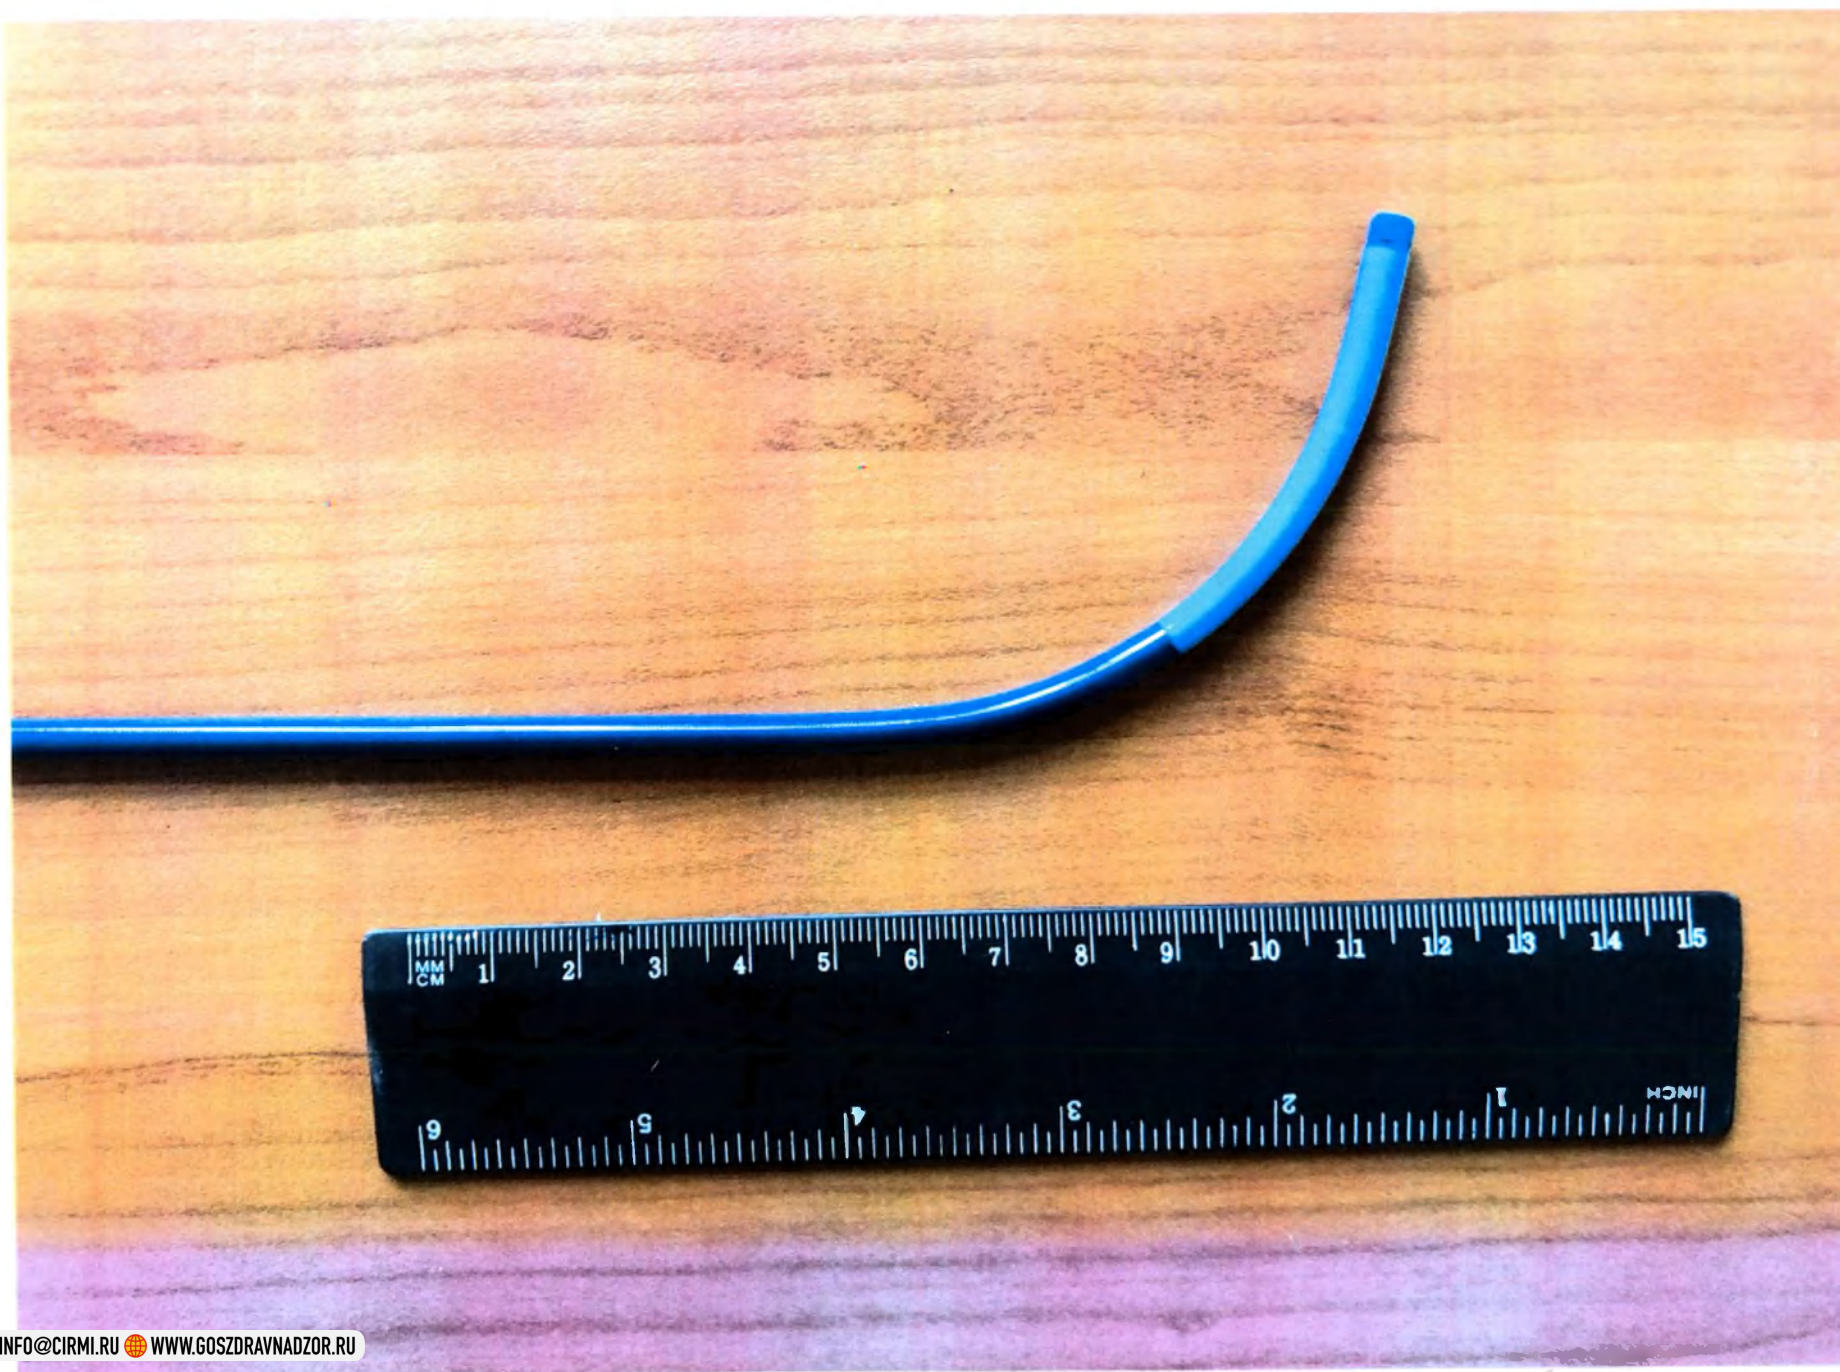


Дистальная часть shaft интродьюсера системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 1) Система доступа Watchman TruSeal, с одним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм)

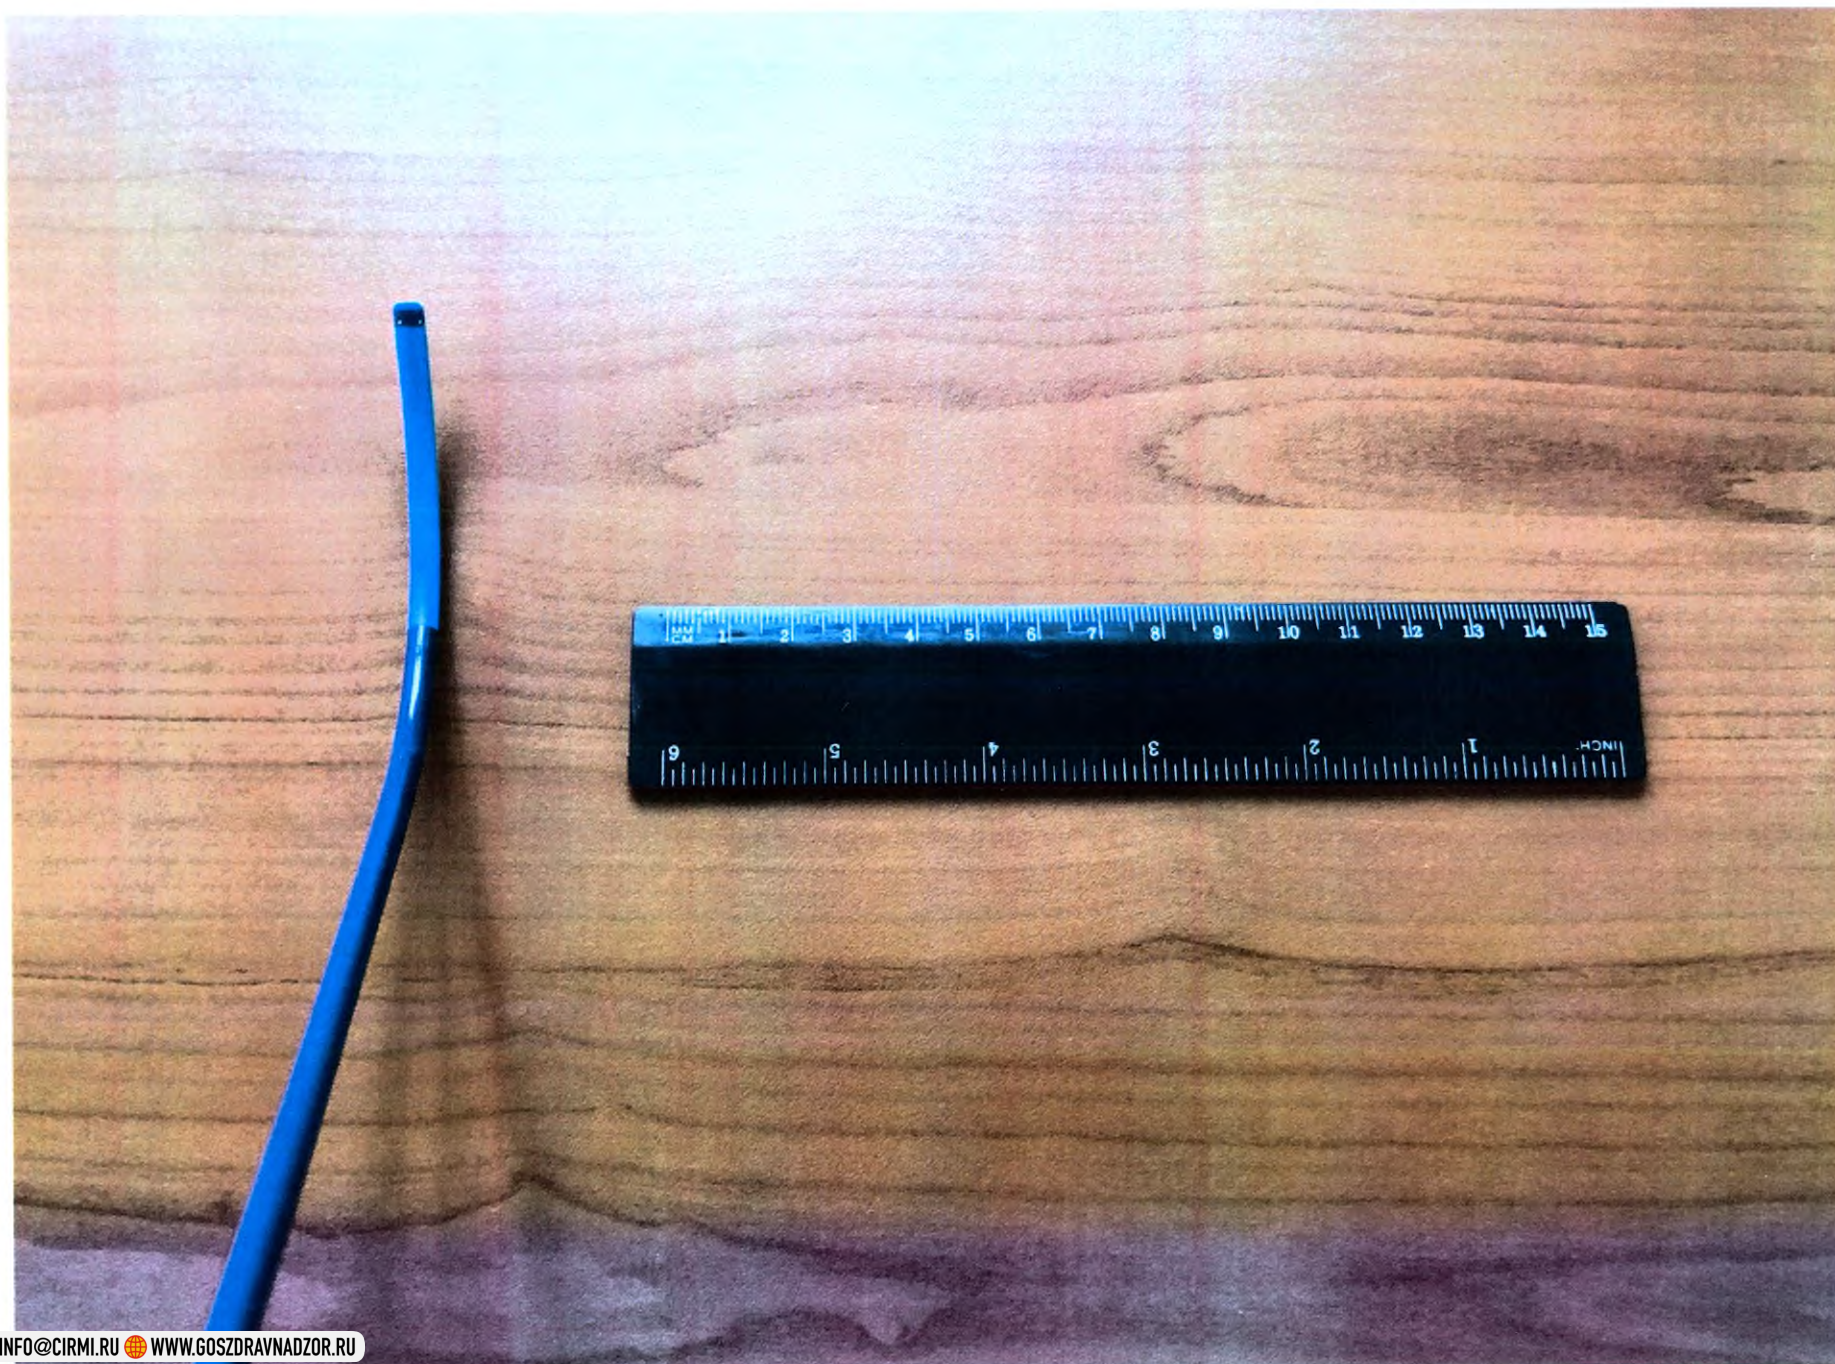


Дистальная часть shaft интродьюсера системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 2) Система доступа Watchman TruSeal, с двумя изгибами, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм)

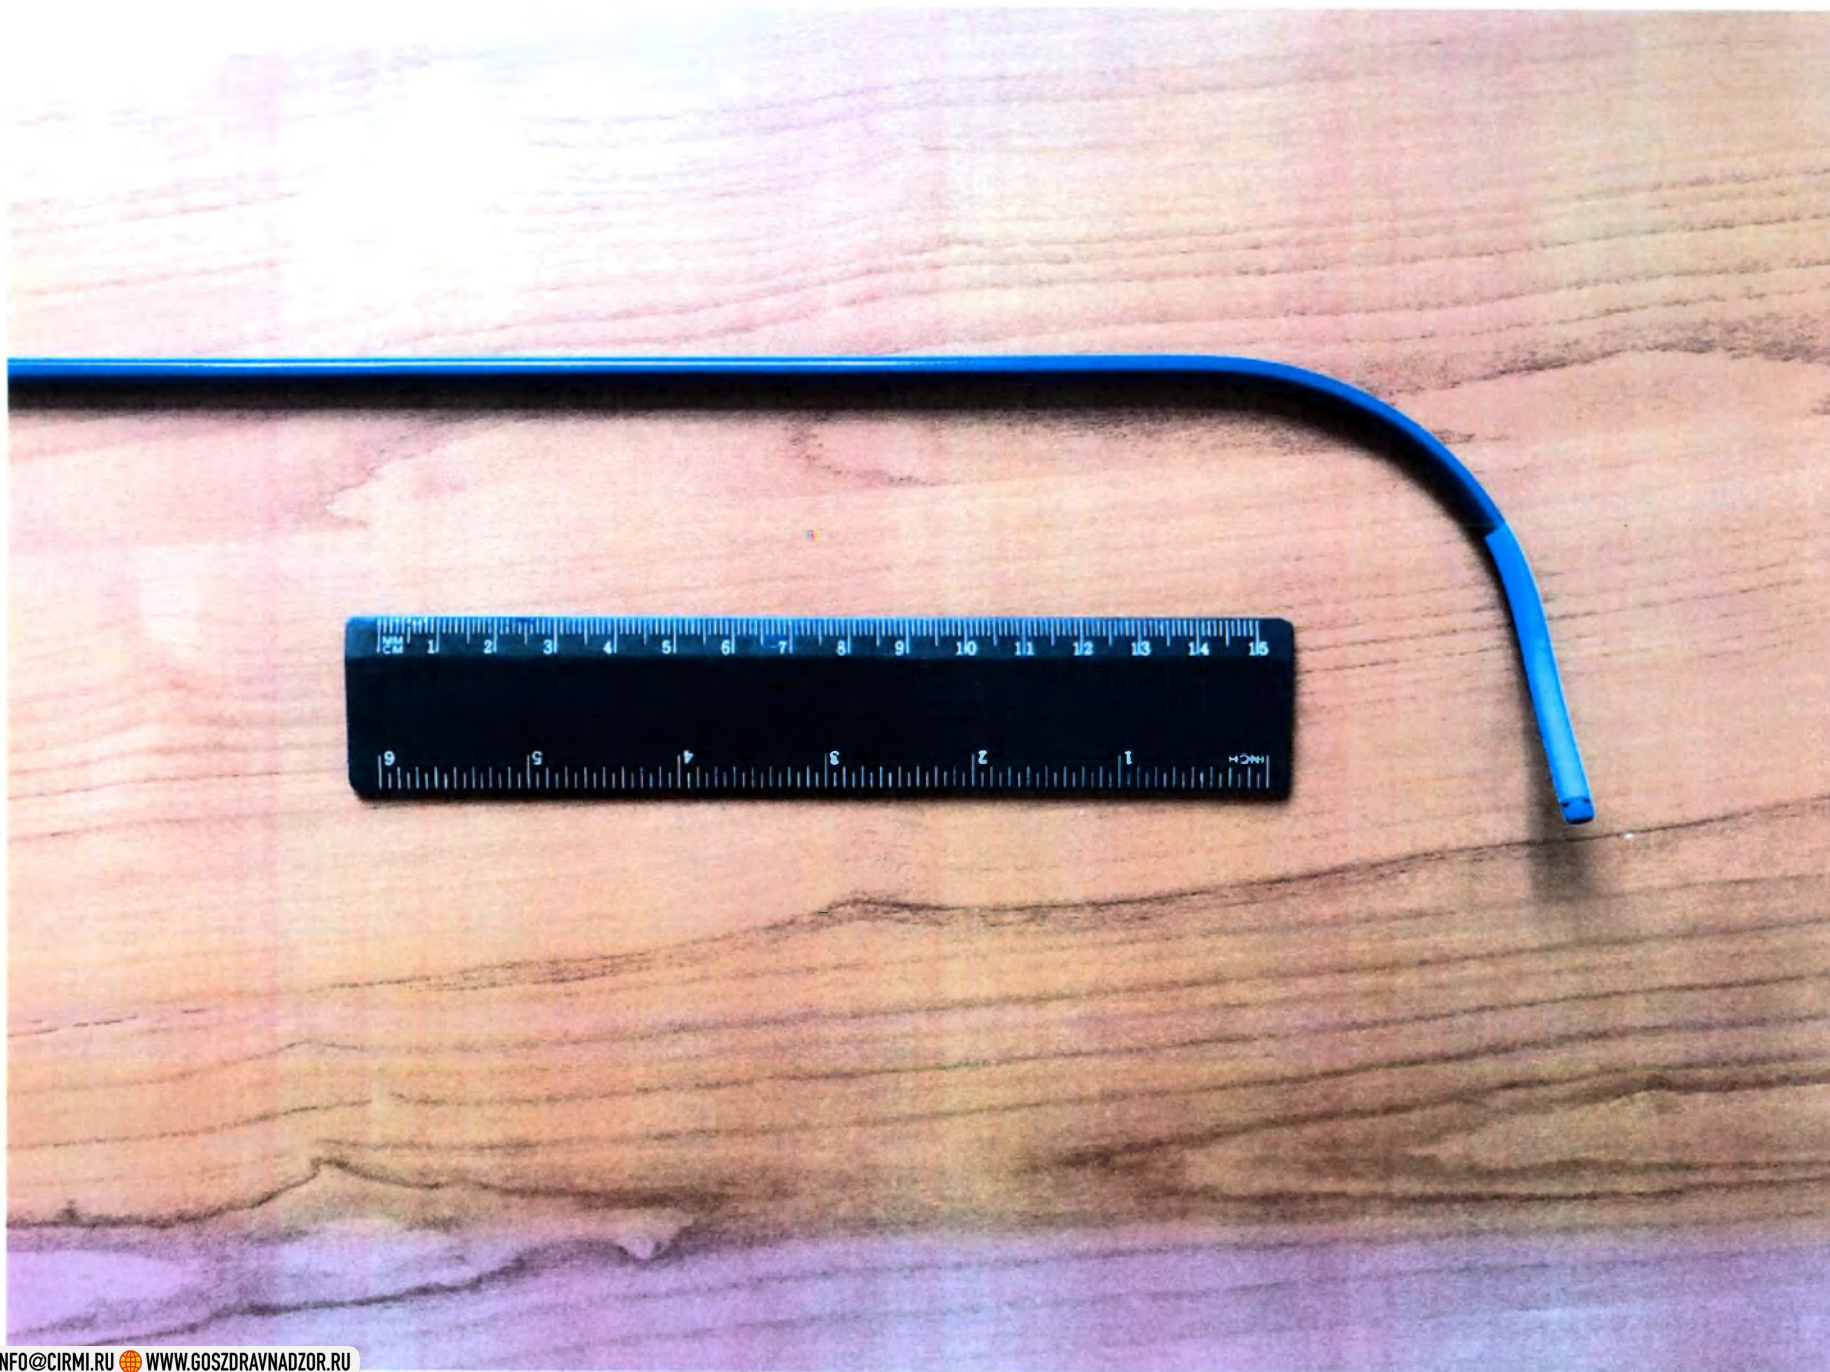


Дистальная часть shaft интродьюсера системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 2) Система доступа Watchman TruSeal, с двумя изгибами, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм)

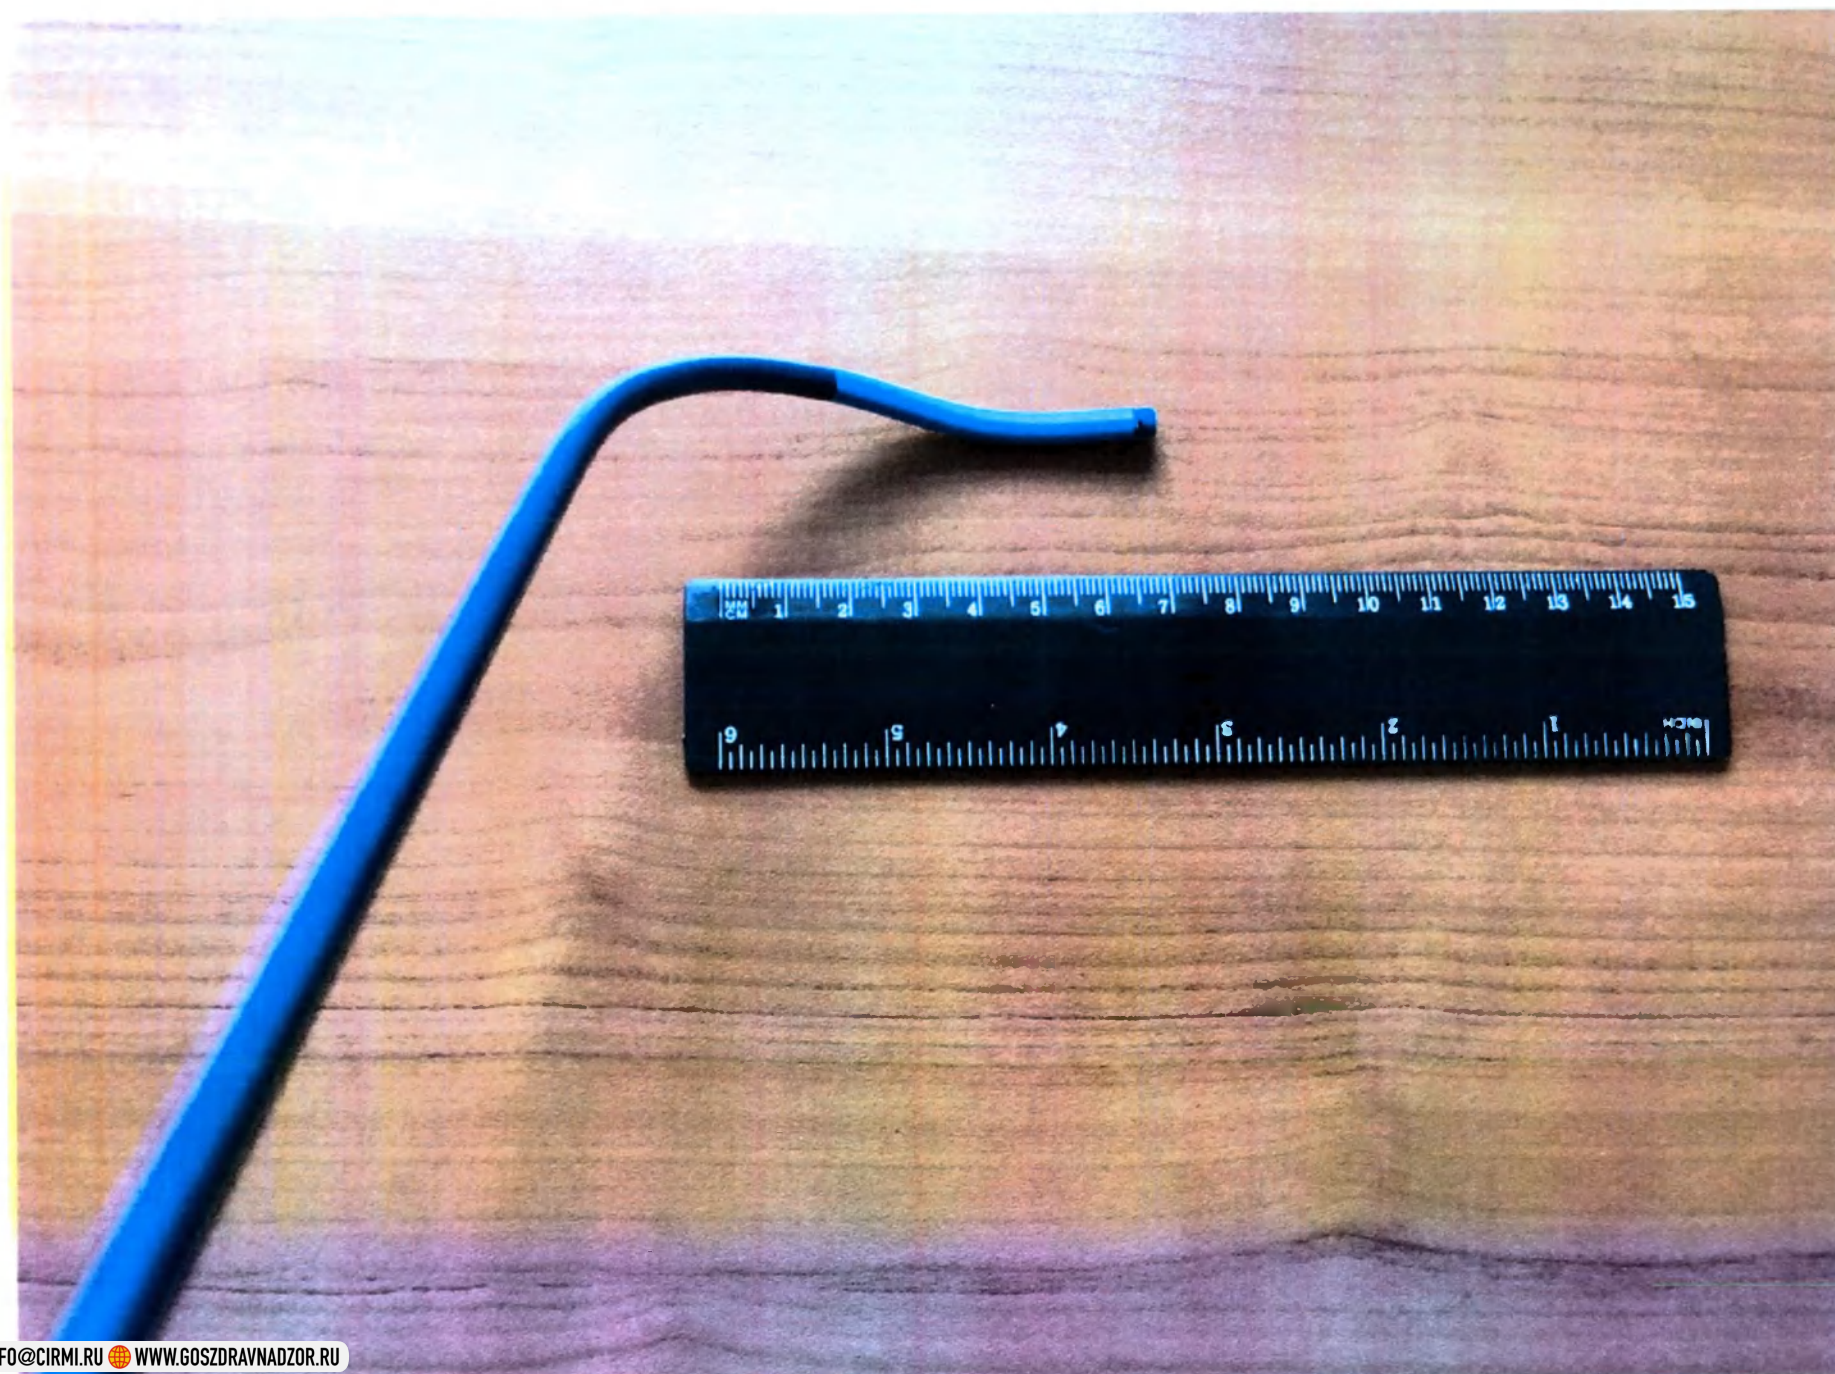


Дистальная часть shaft интродьюсера системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 3) Система доступа Watchman TruSeal, с передним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм)

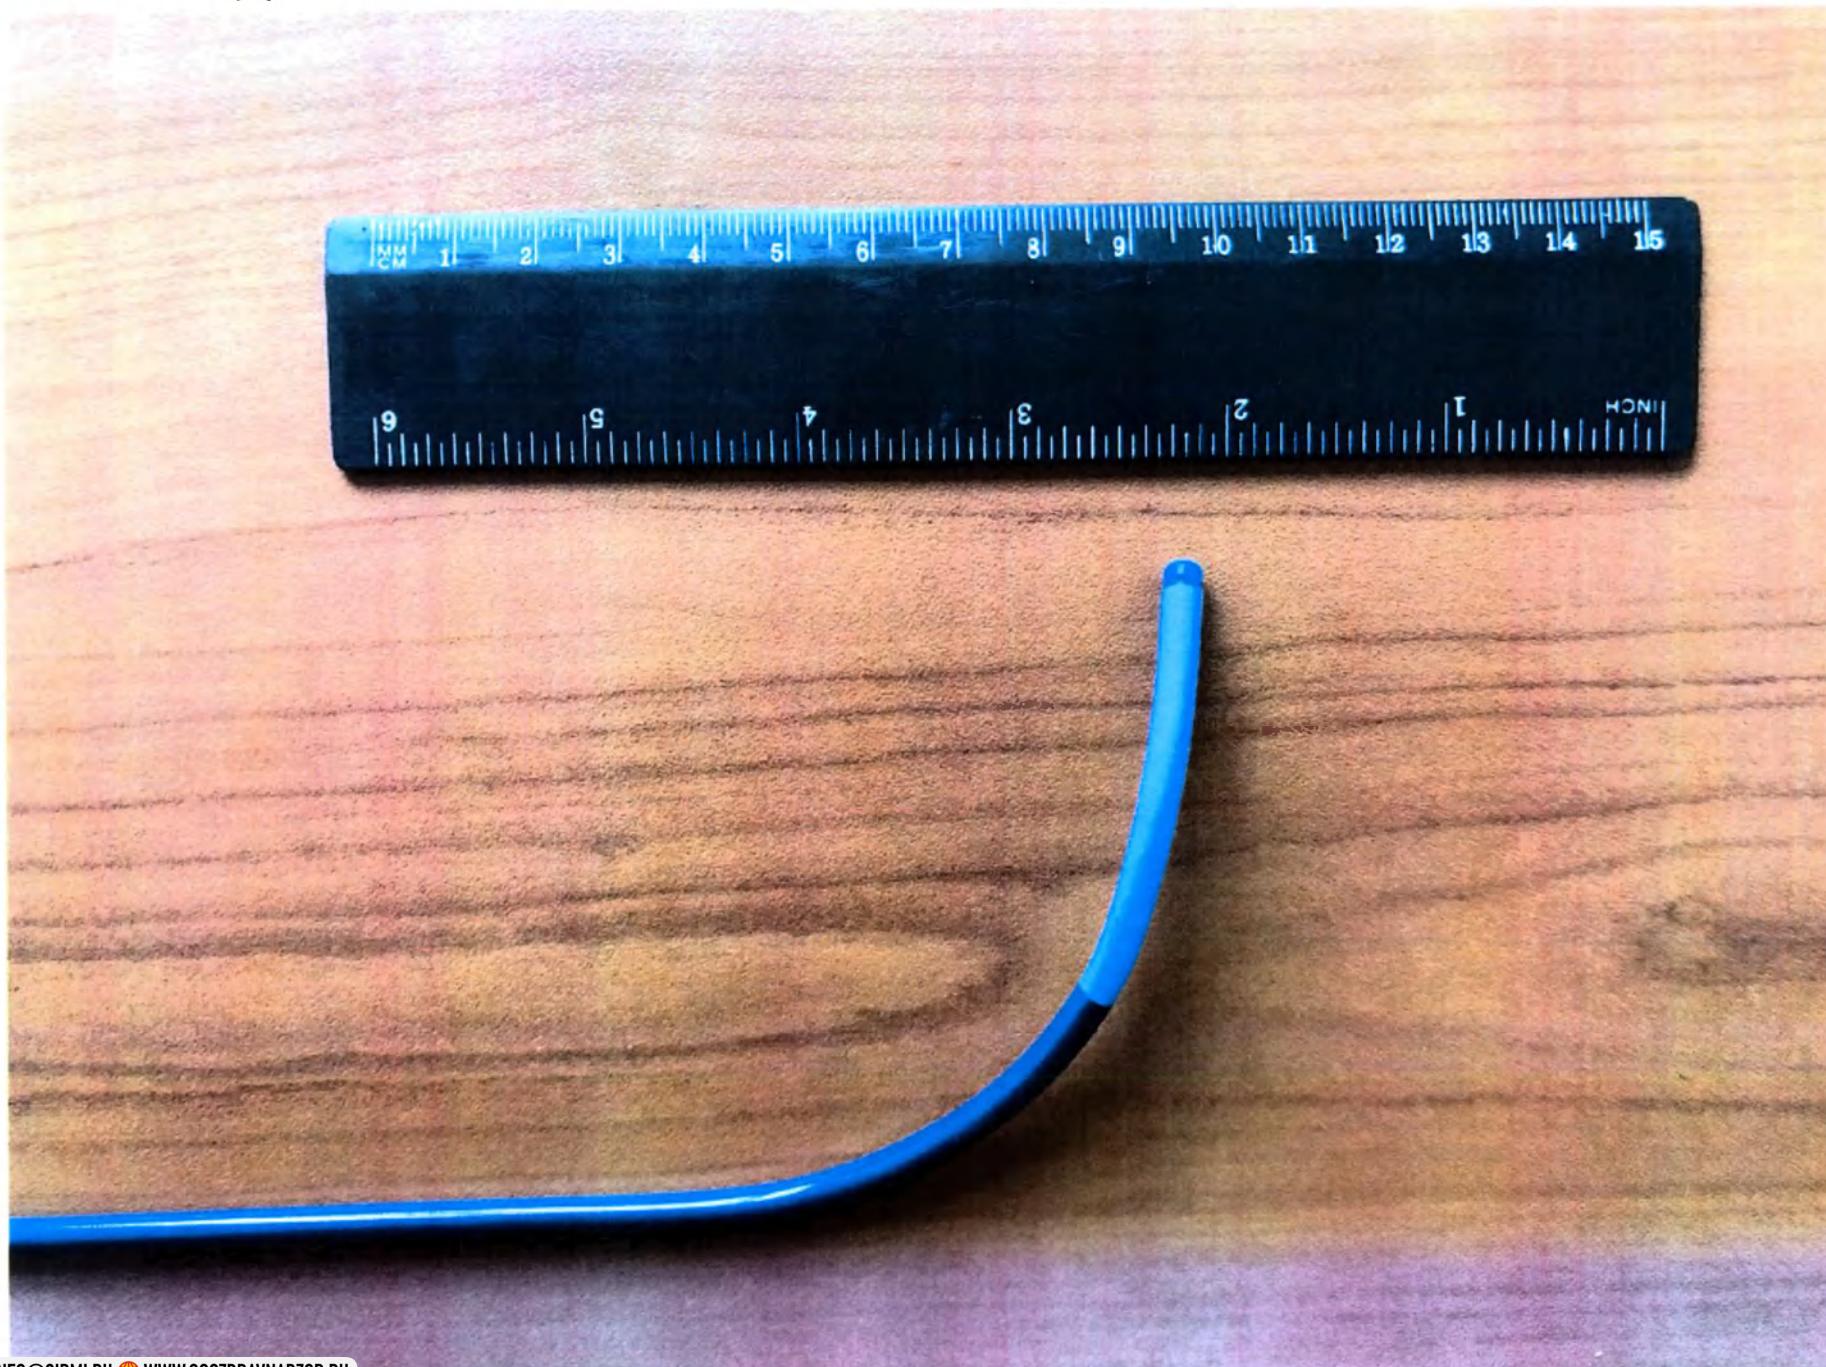


Дистальная часть shaft интродьюсера системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 3) Система доступа Watchman TruSeal, с передним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм)

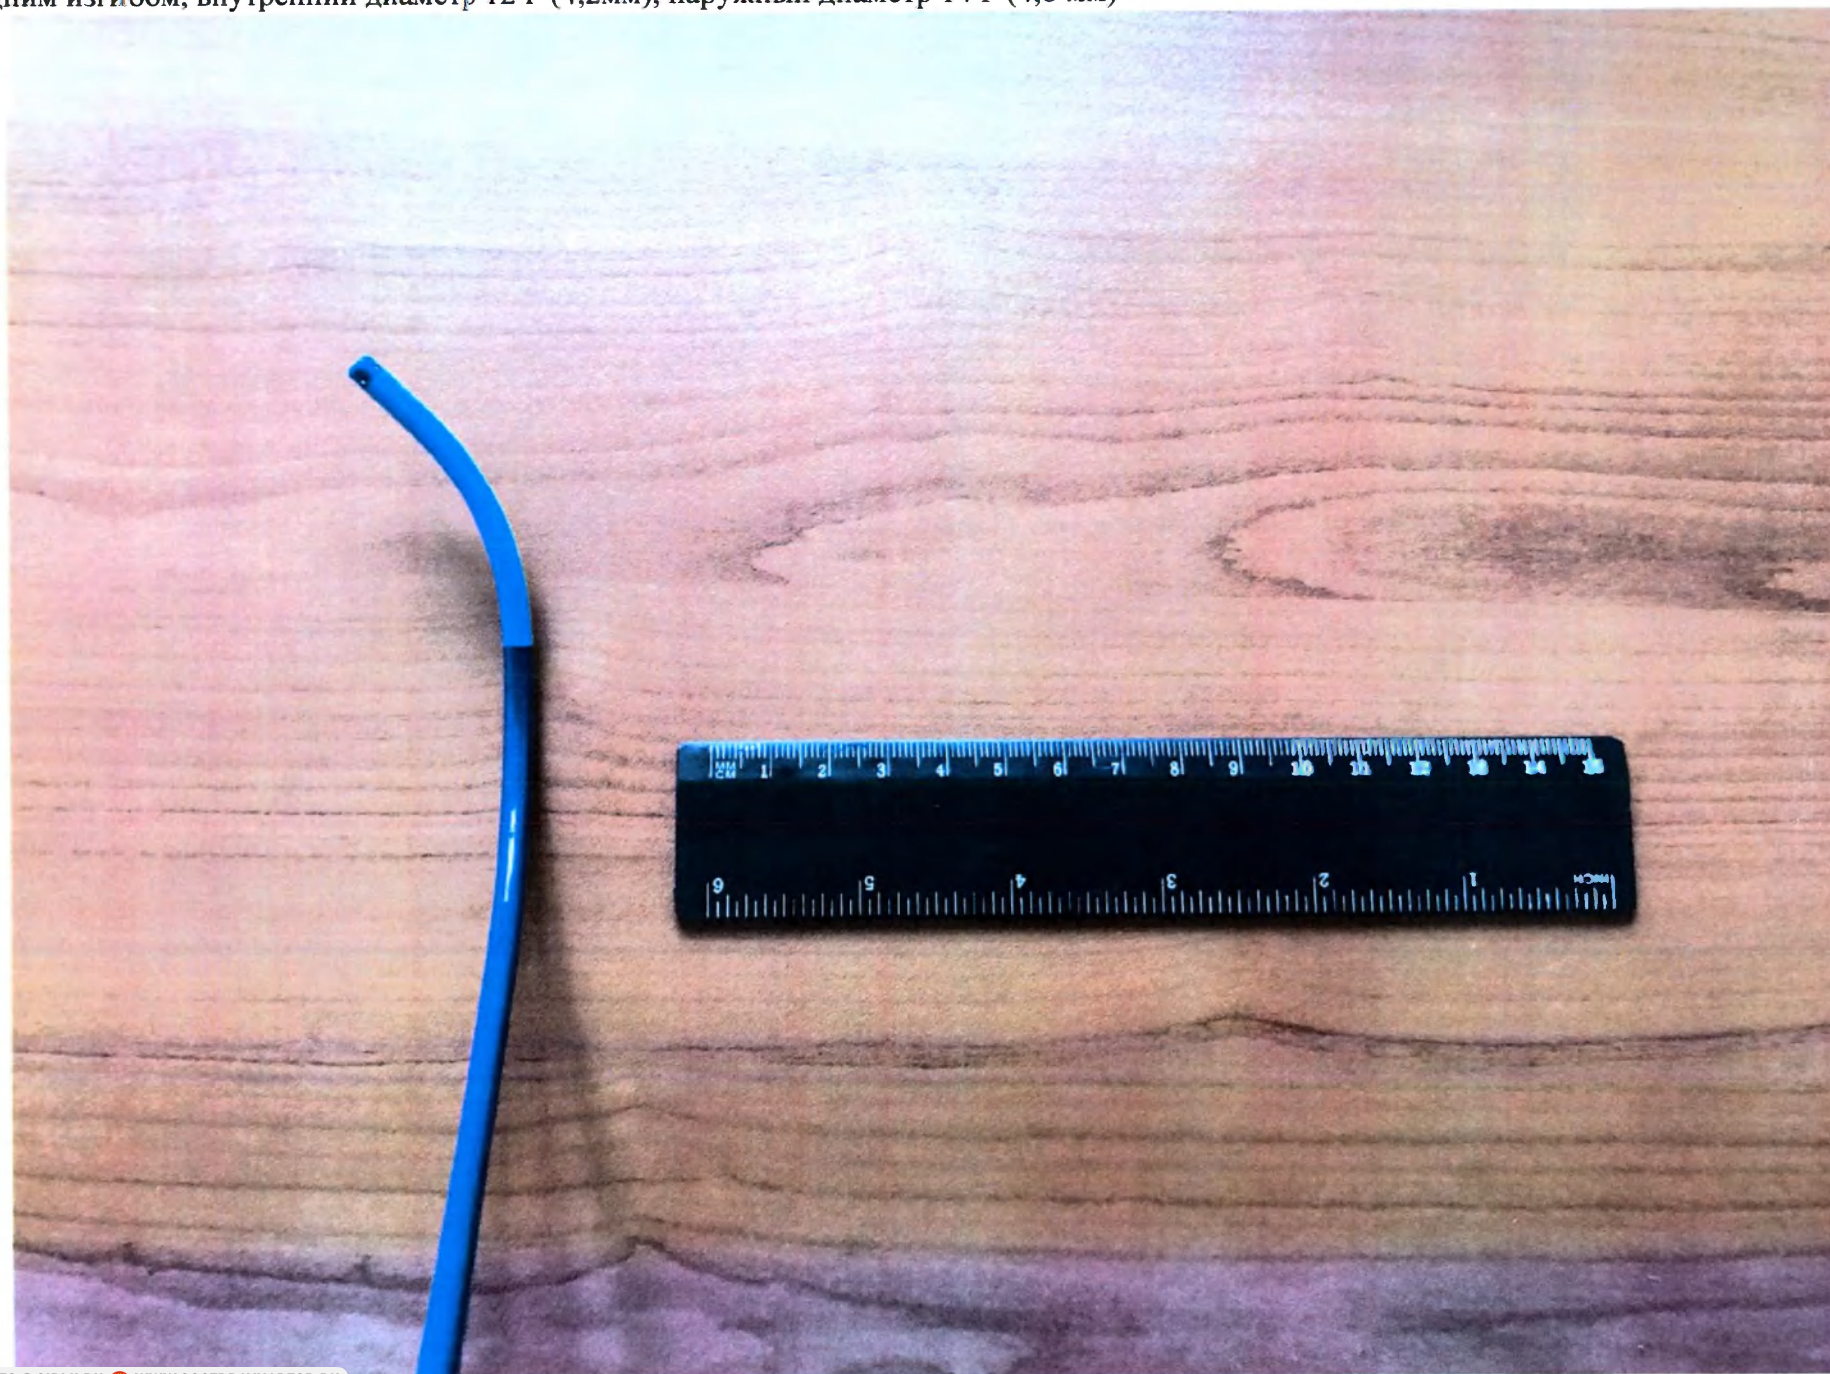

Мягкий кончик с боковыми отверстиями дистальной части шфта интродьюсера системы доступа Watchman TruSeal

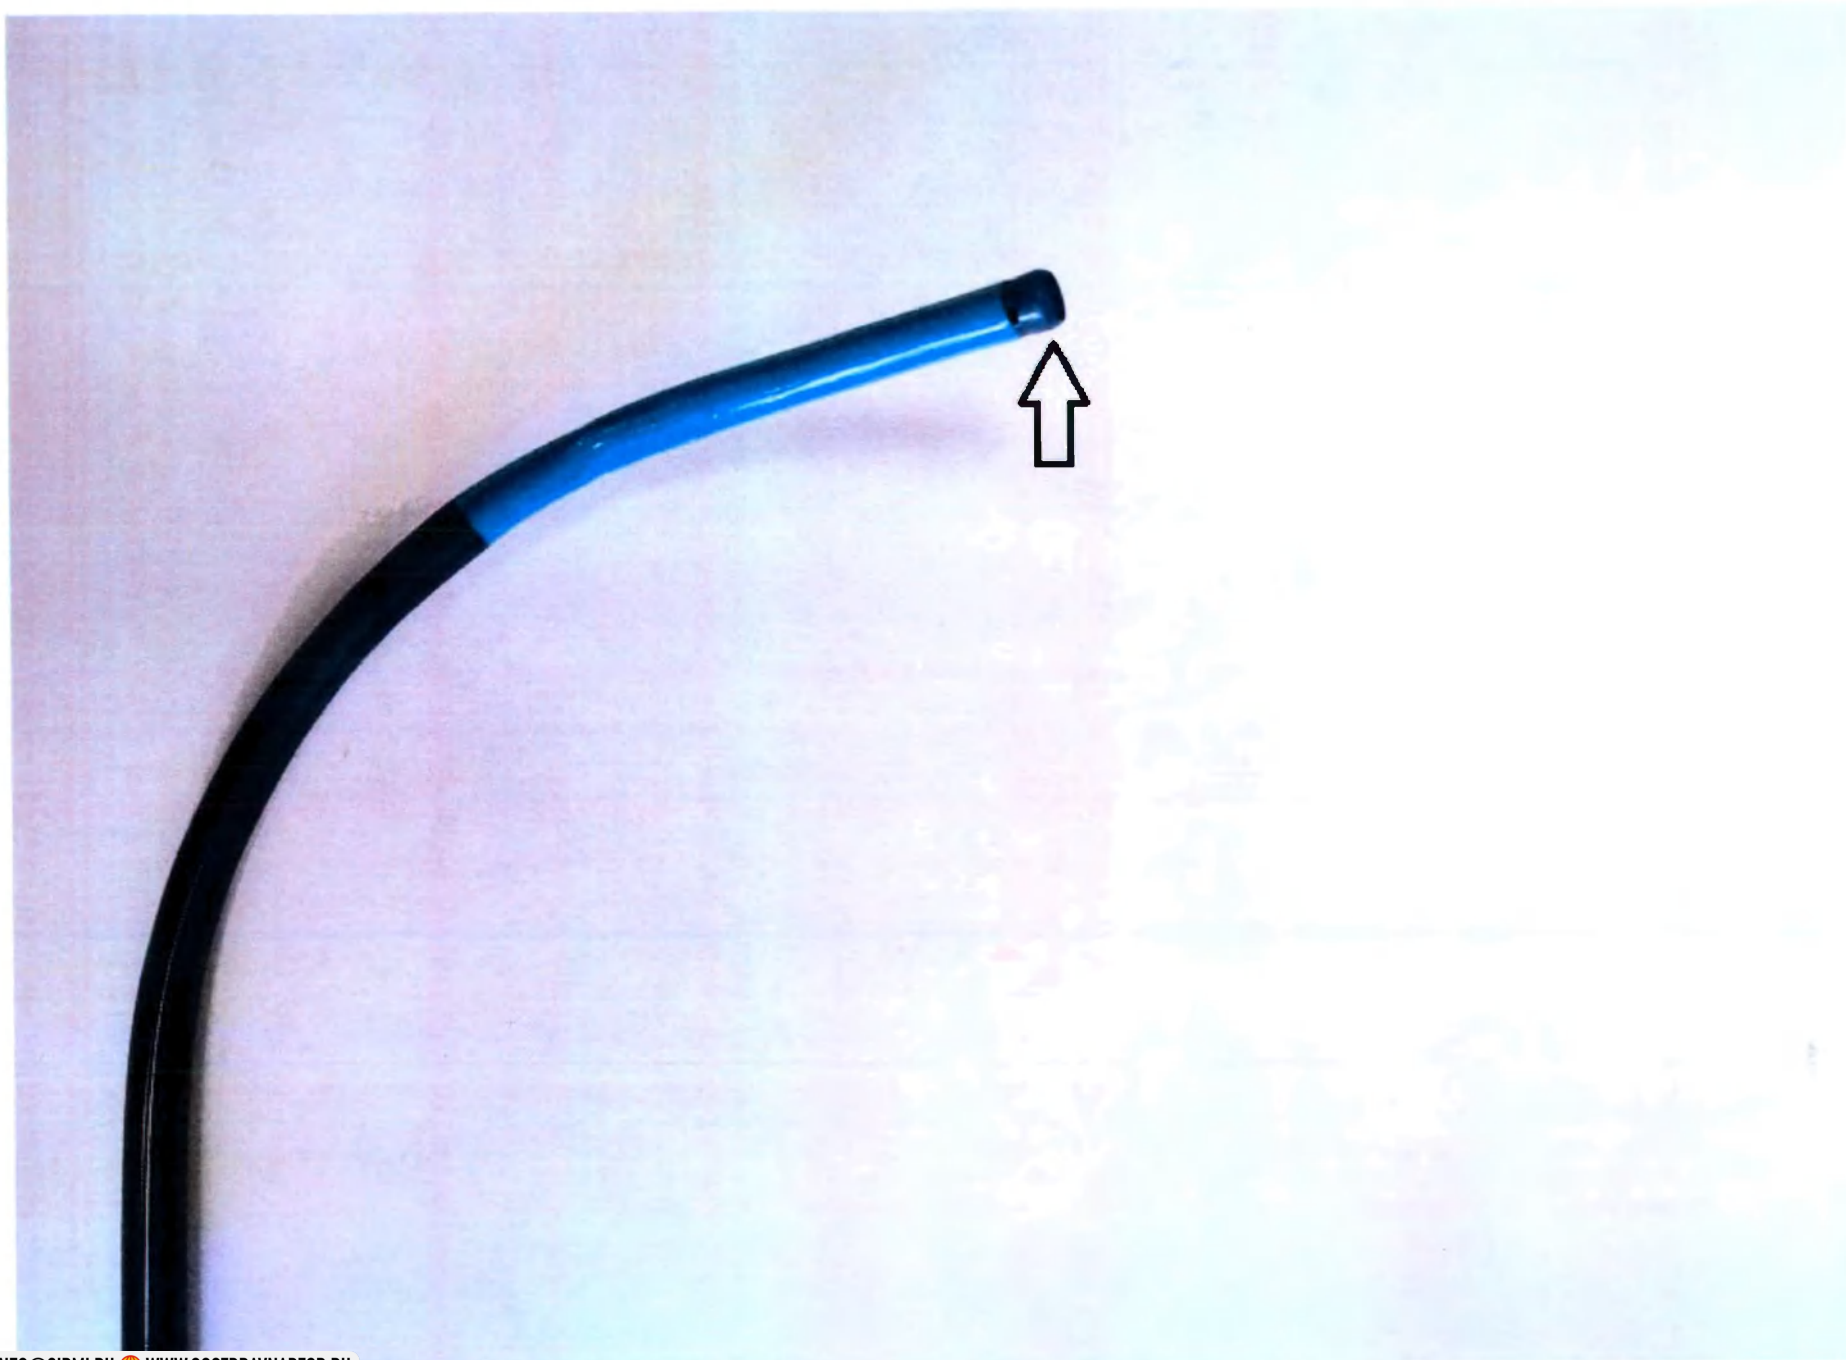


Хаб и боковой порт проксимальной части интродьюсера системы доступа Watchman TruSeal

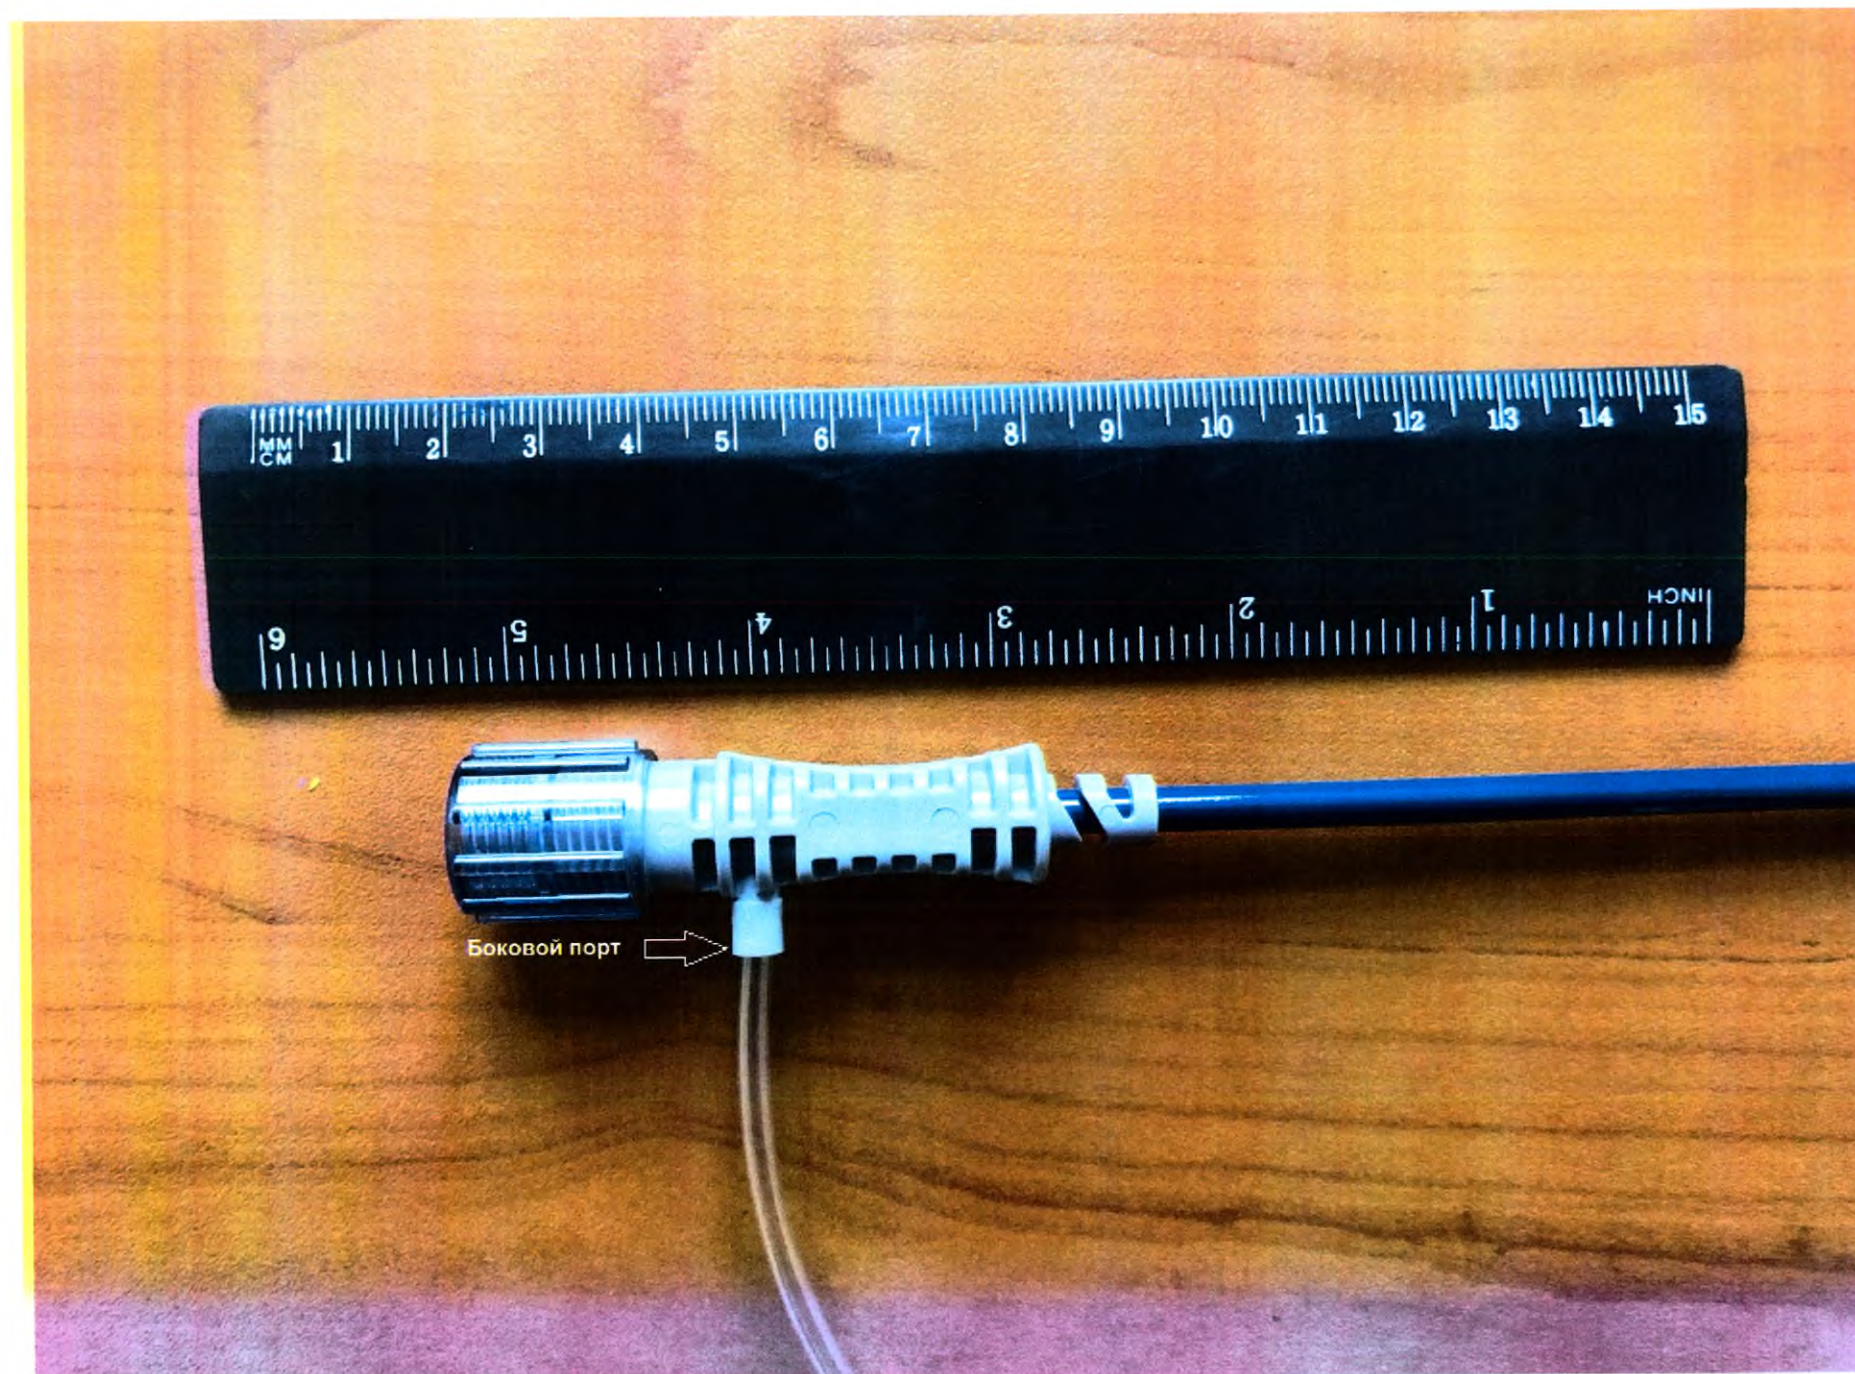


Гемостатический клапан Touhy-Borst проксимальной части интродьюсера системы доступа Watchman TruSeal




Трехходовой запорный кран с соединением «Луэр-лок мама» и боковая трубка проксимальной части интродьюсера системы доступа Watchman TruSeal

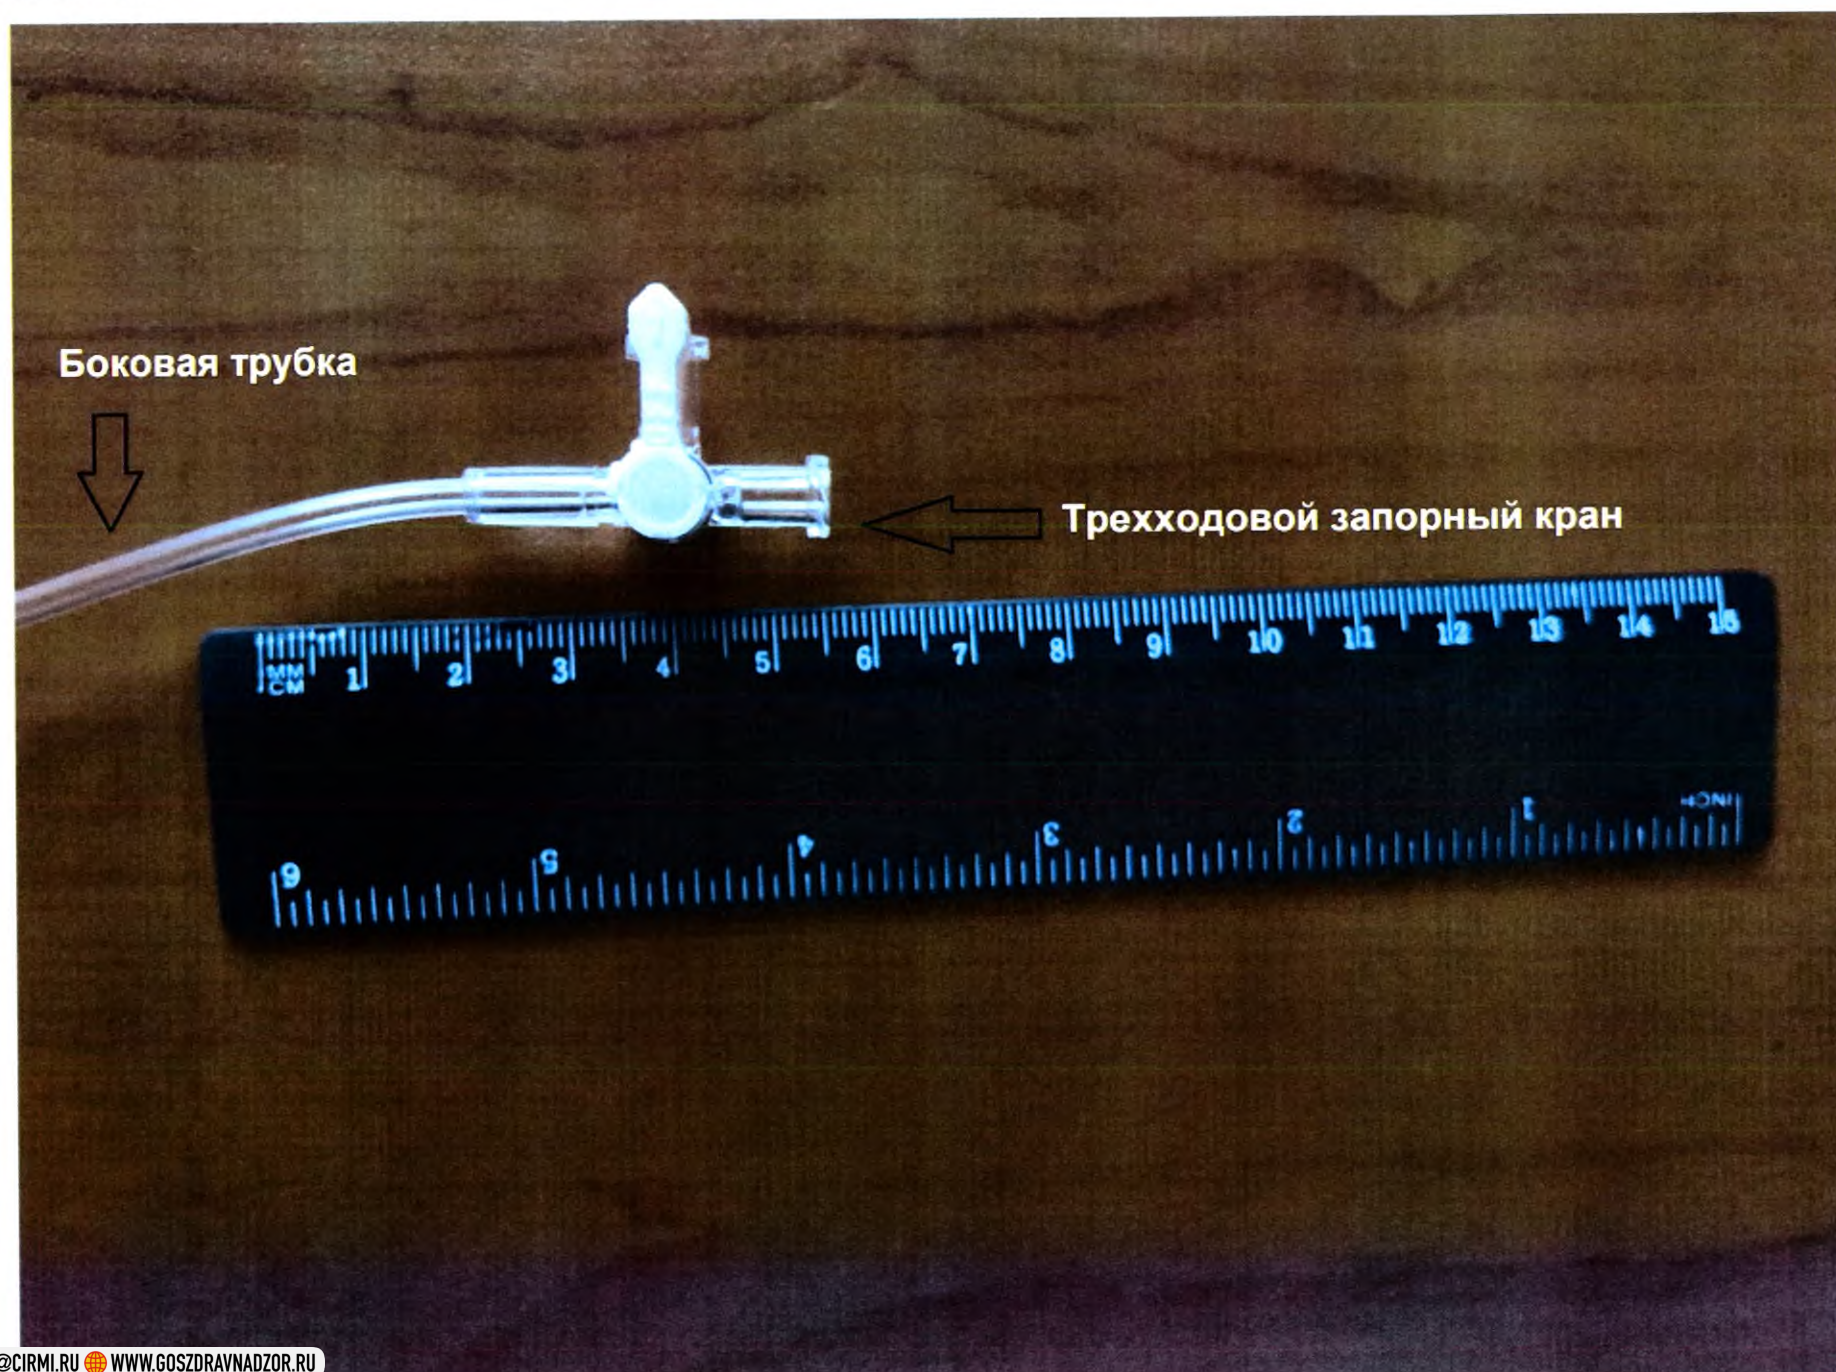


Дилататор системы доступа Watchman TruSeal

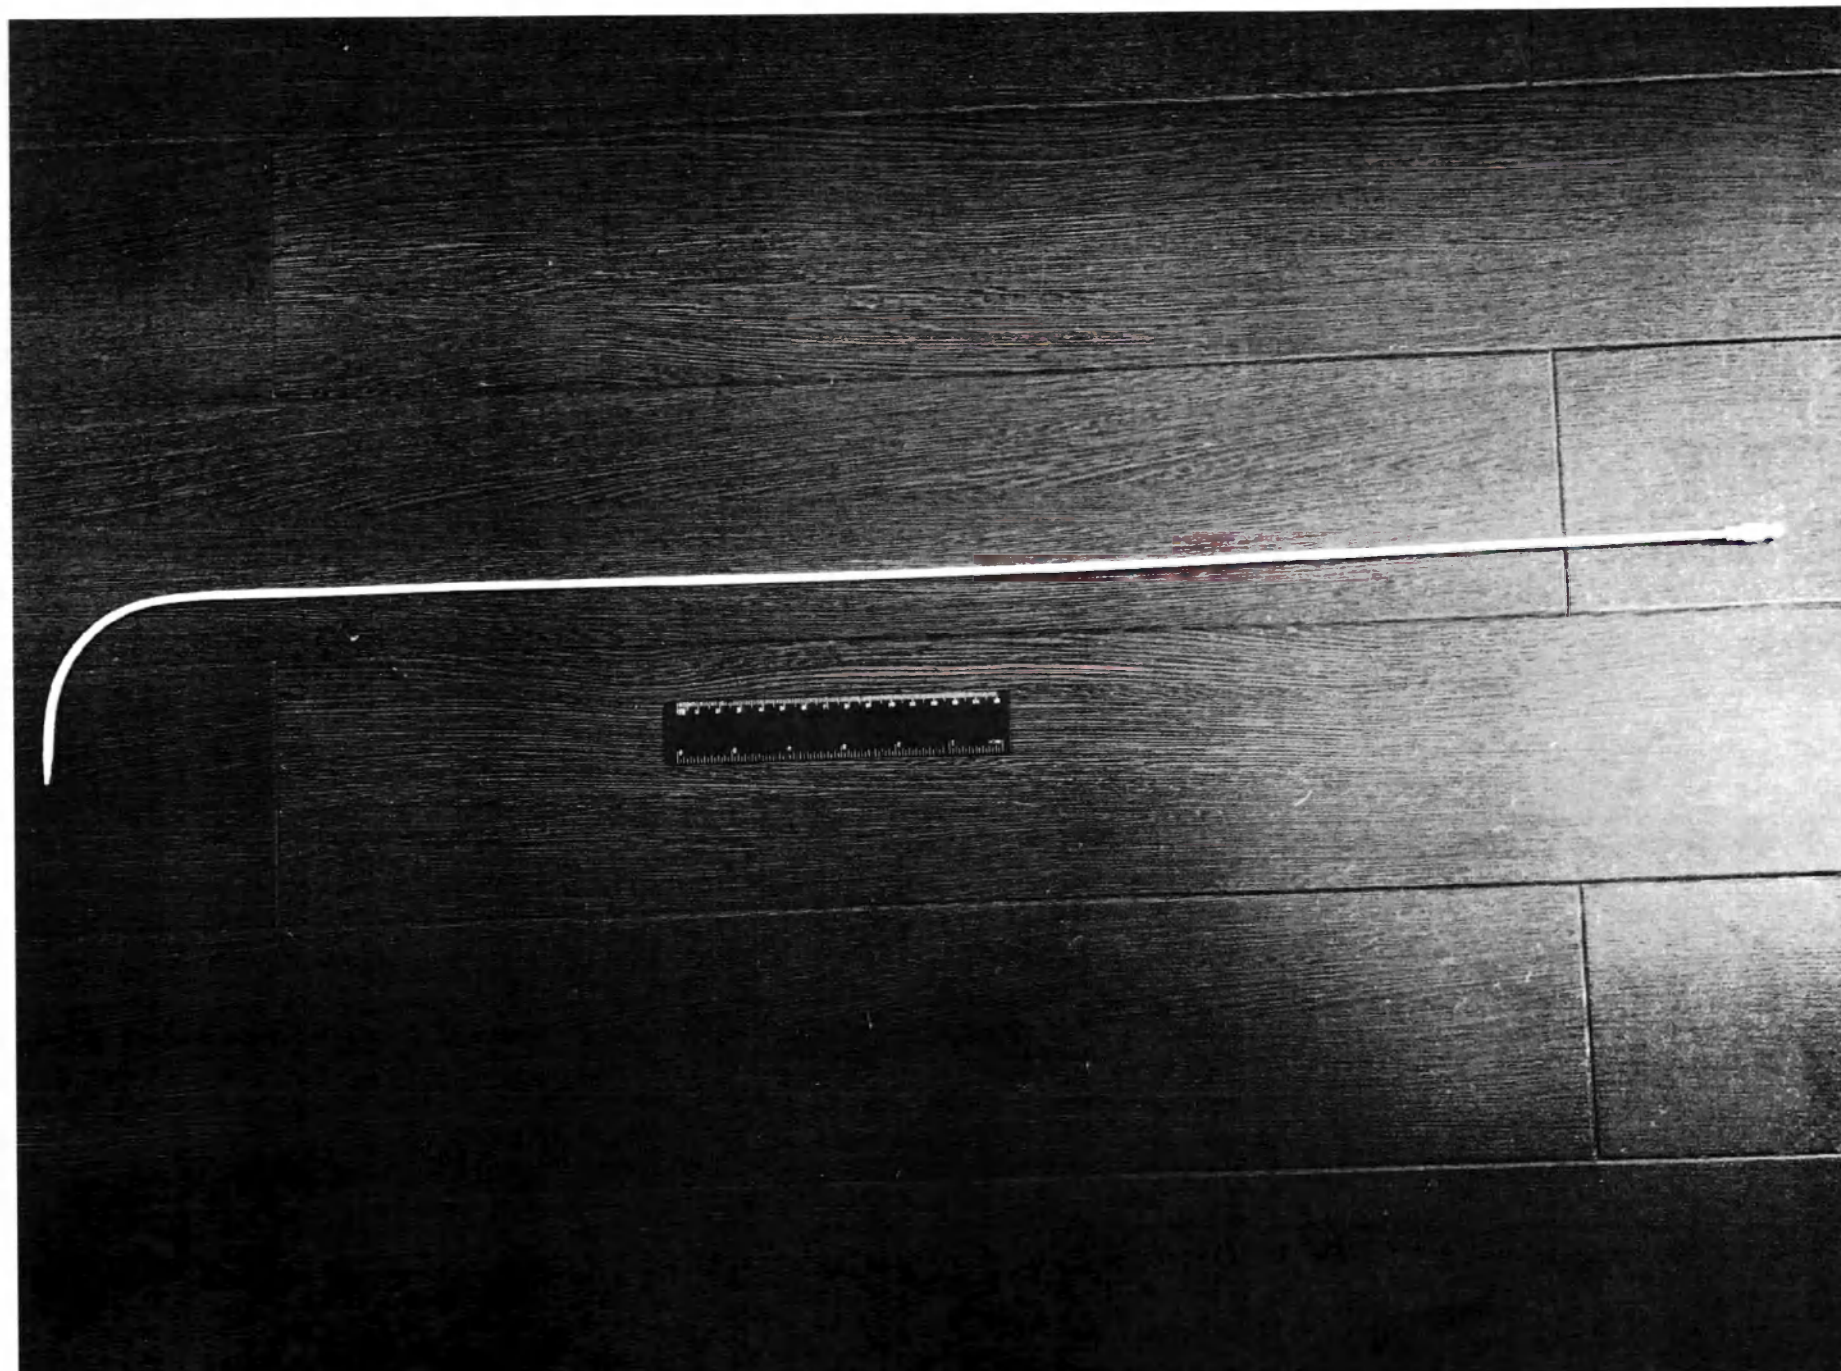


Хаб дилататора с соединением «Луэр лок мама»

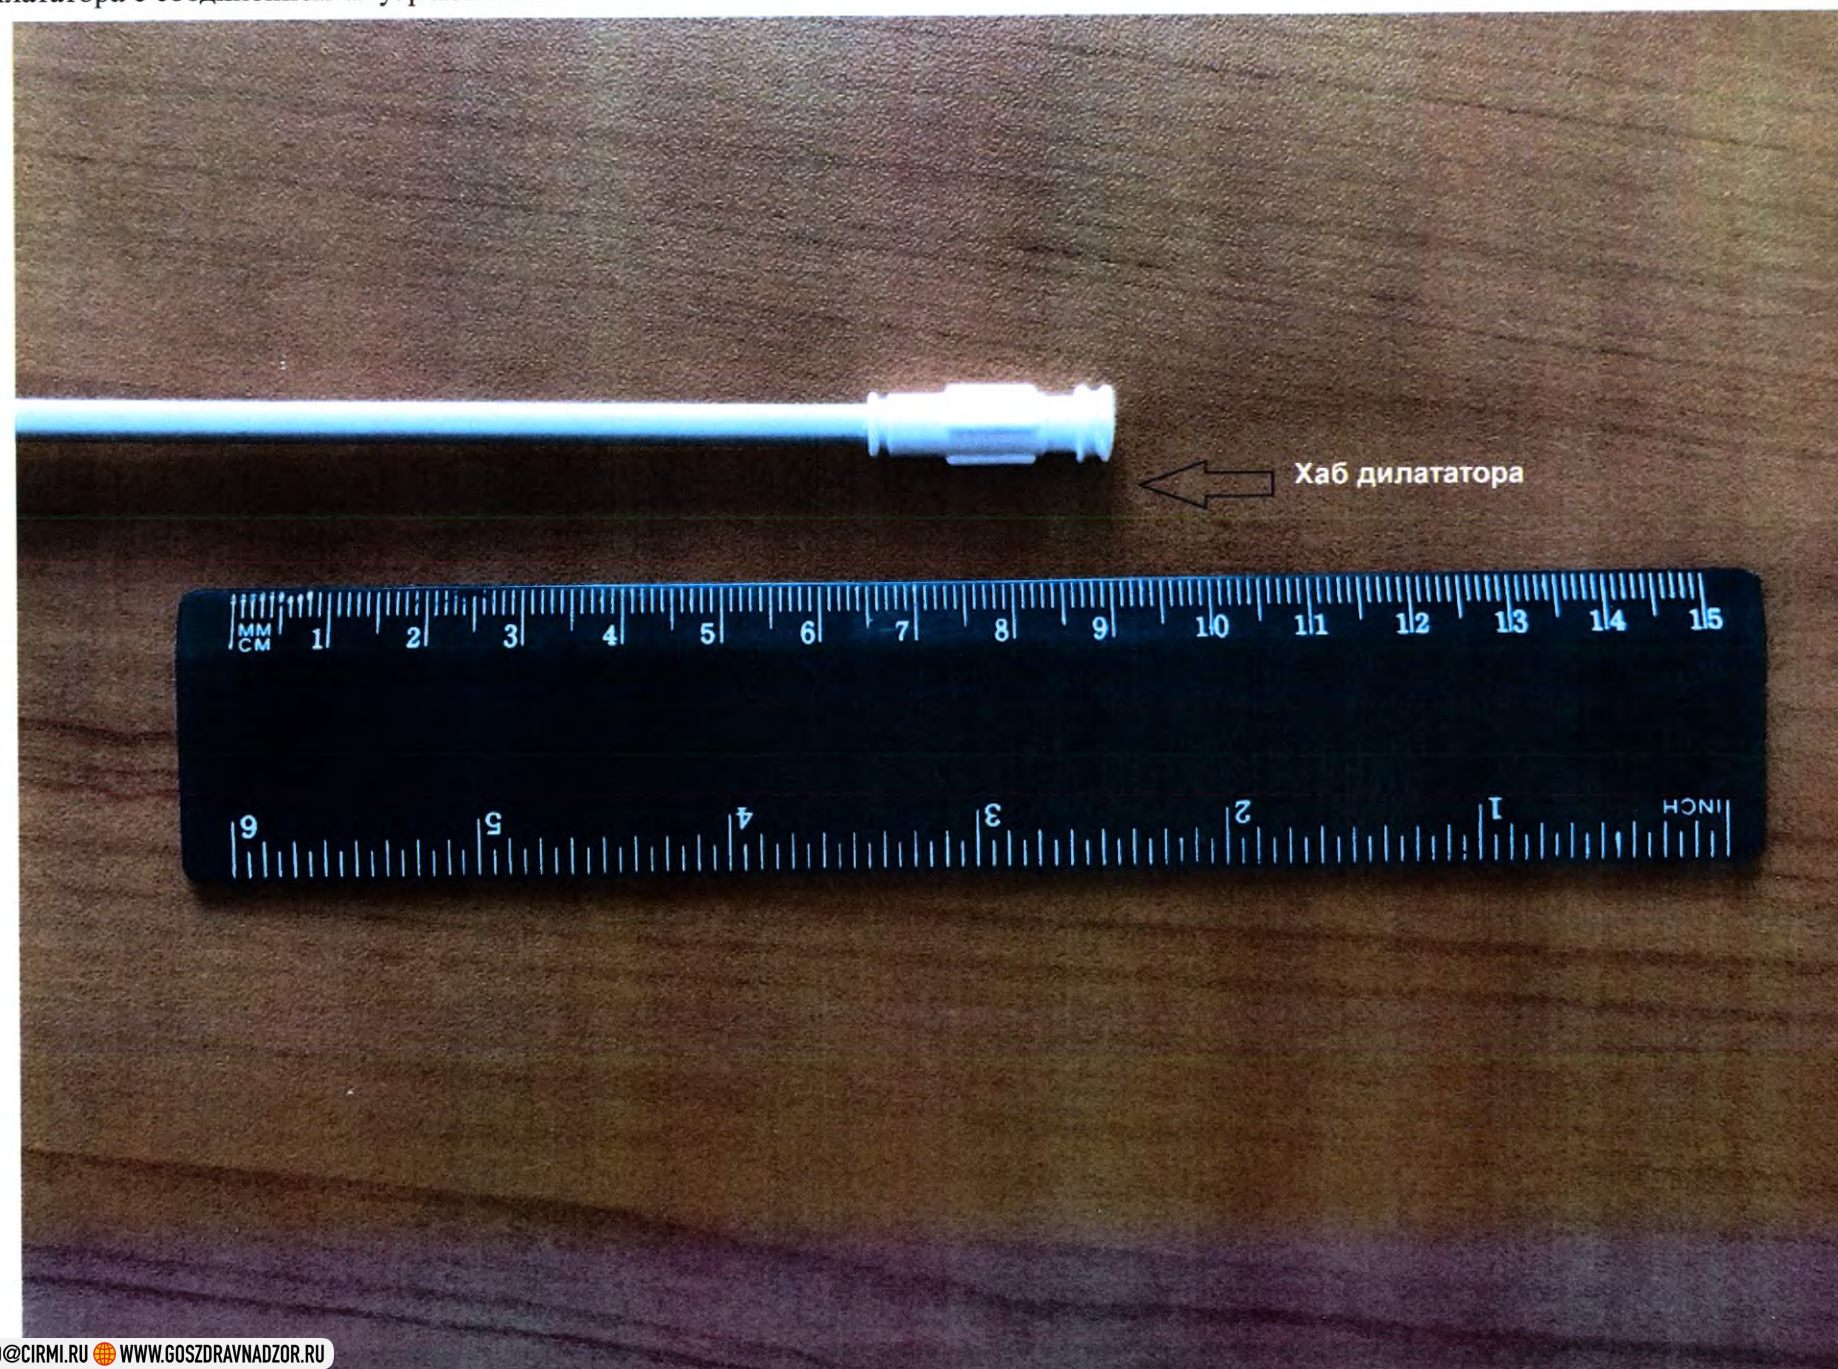


Собранный вид системы доступа Watchman TruSeal: интродьюсер доступа и дилататор

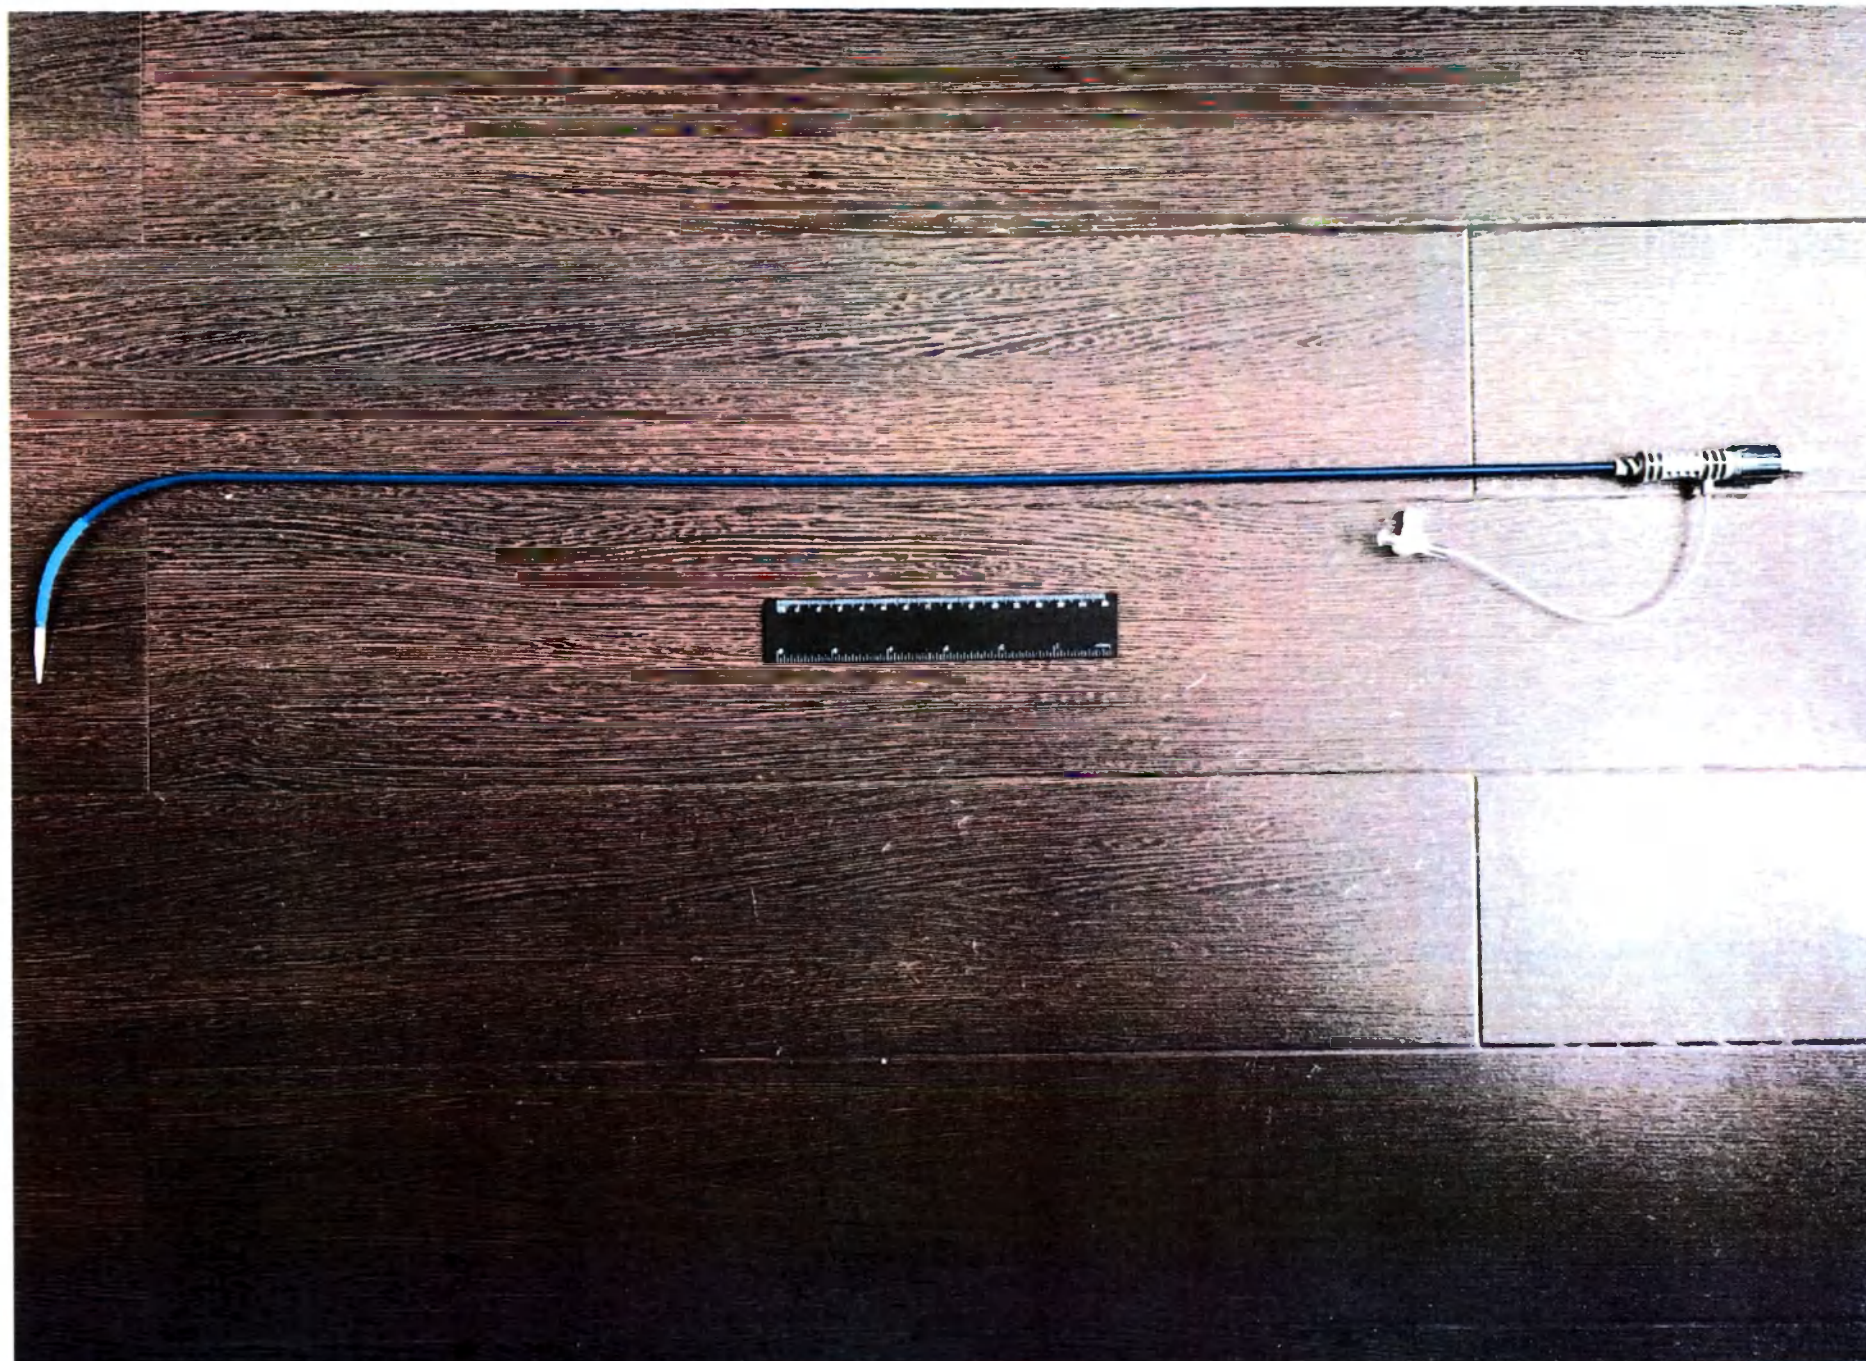

Упаковочный лоток системы доступа Watchman TruSeal

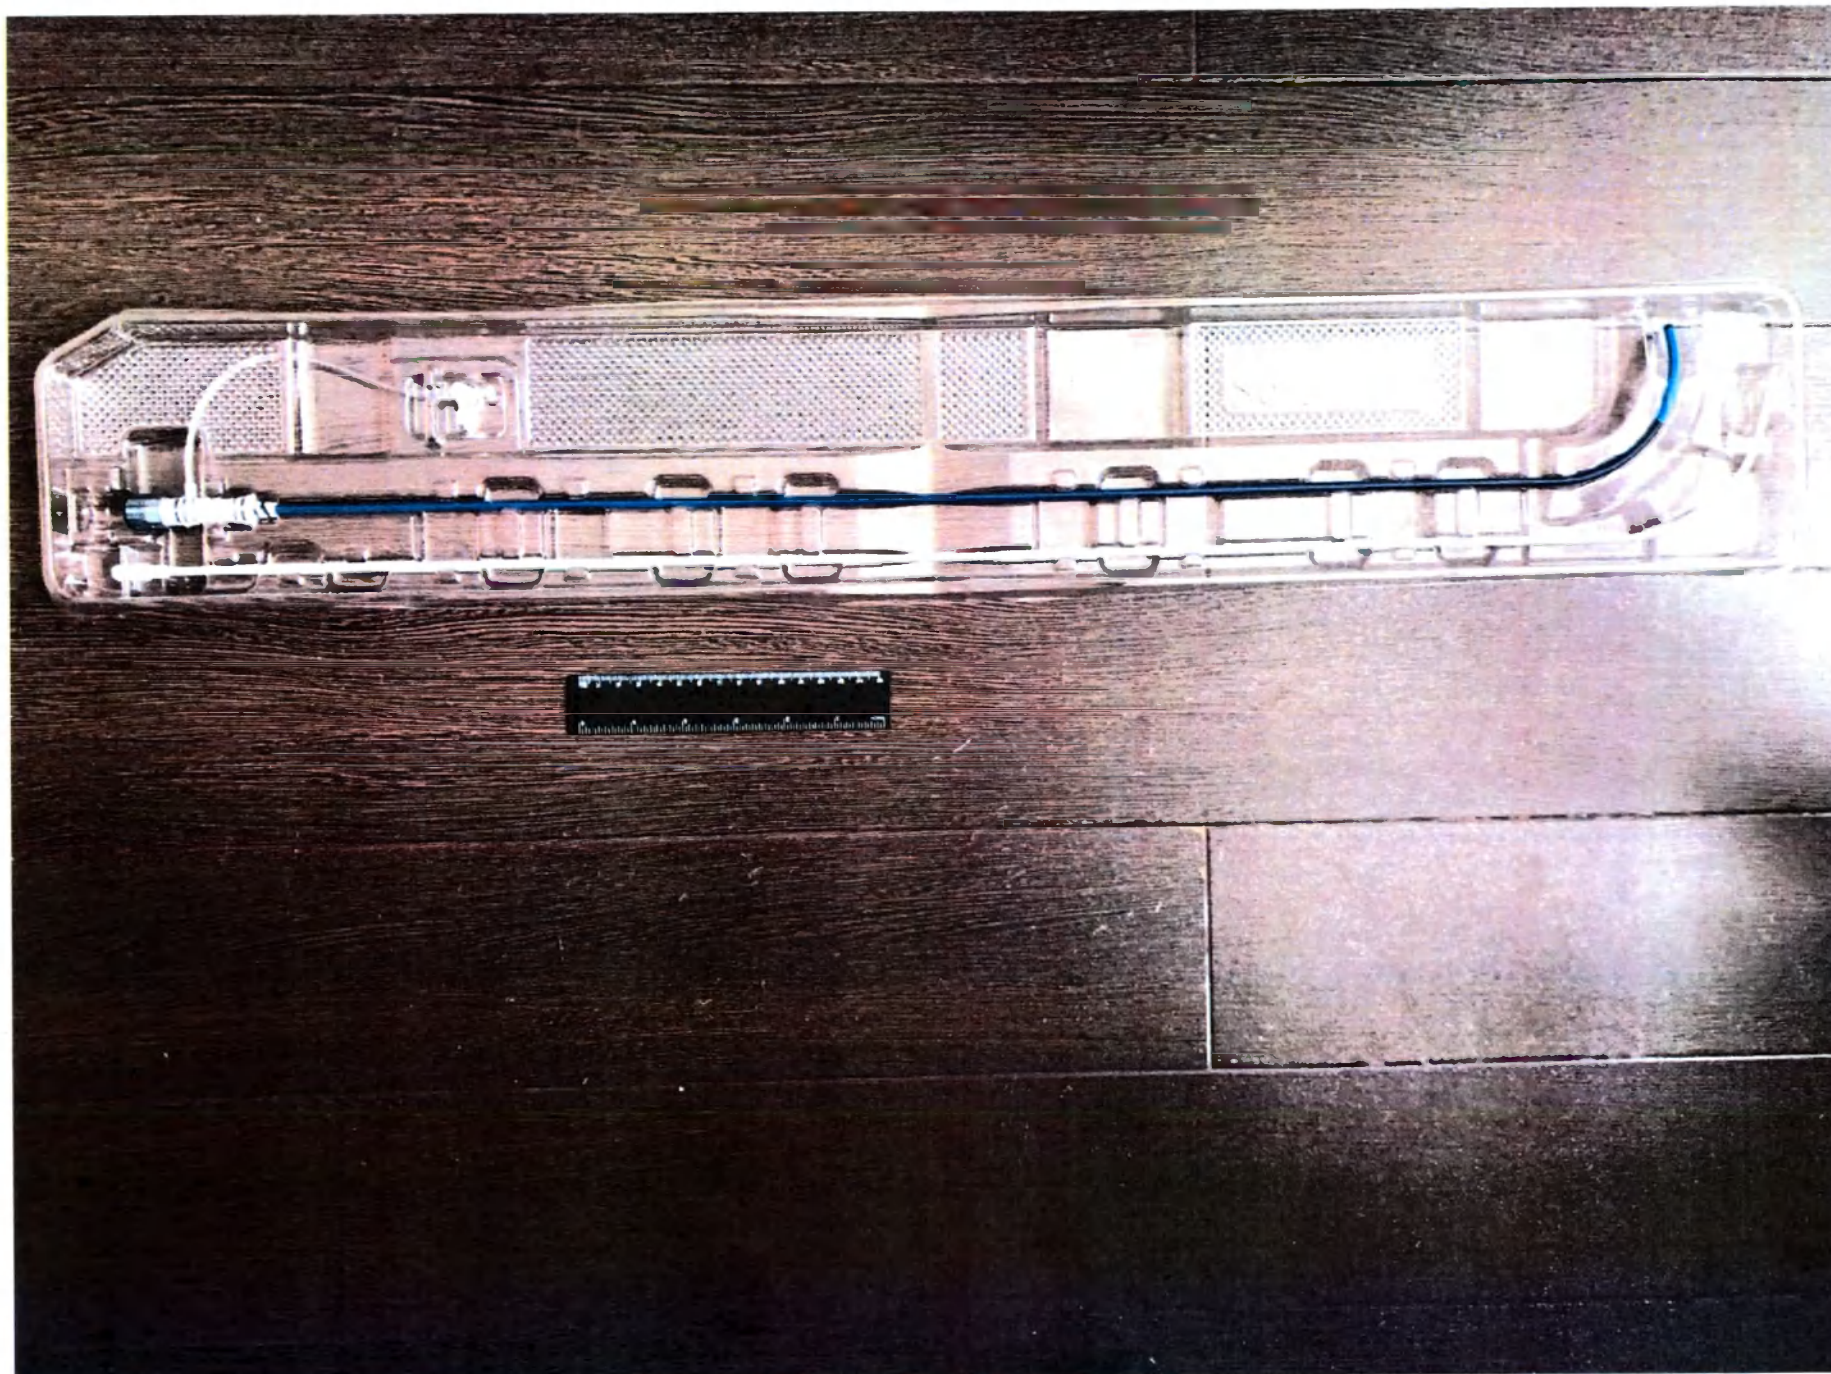

Запечатываемый пакет (лицевая сторона) системы доступа Watchman TruSeal

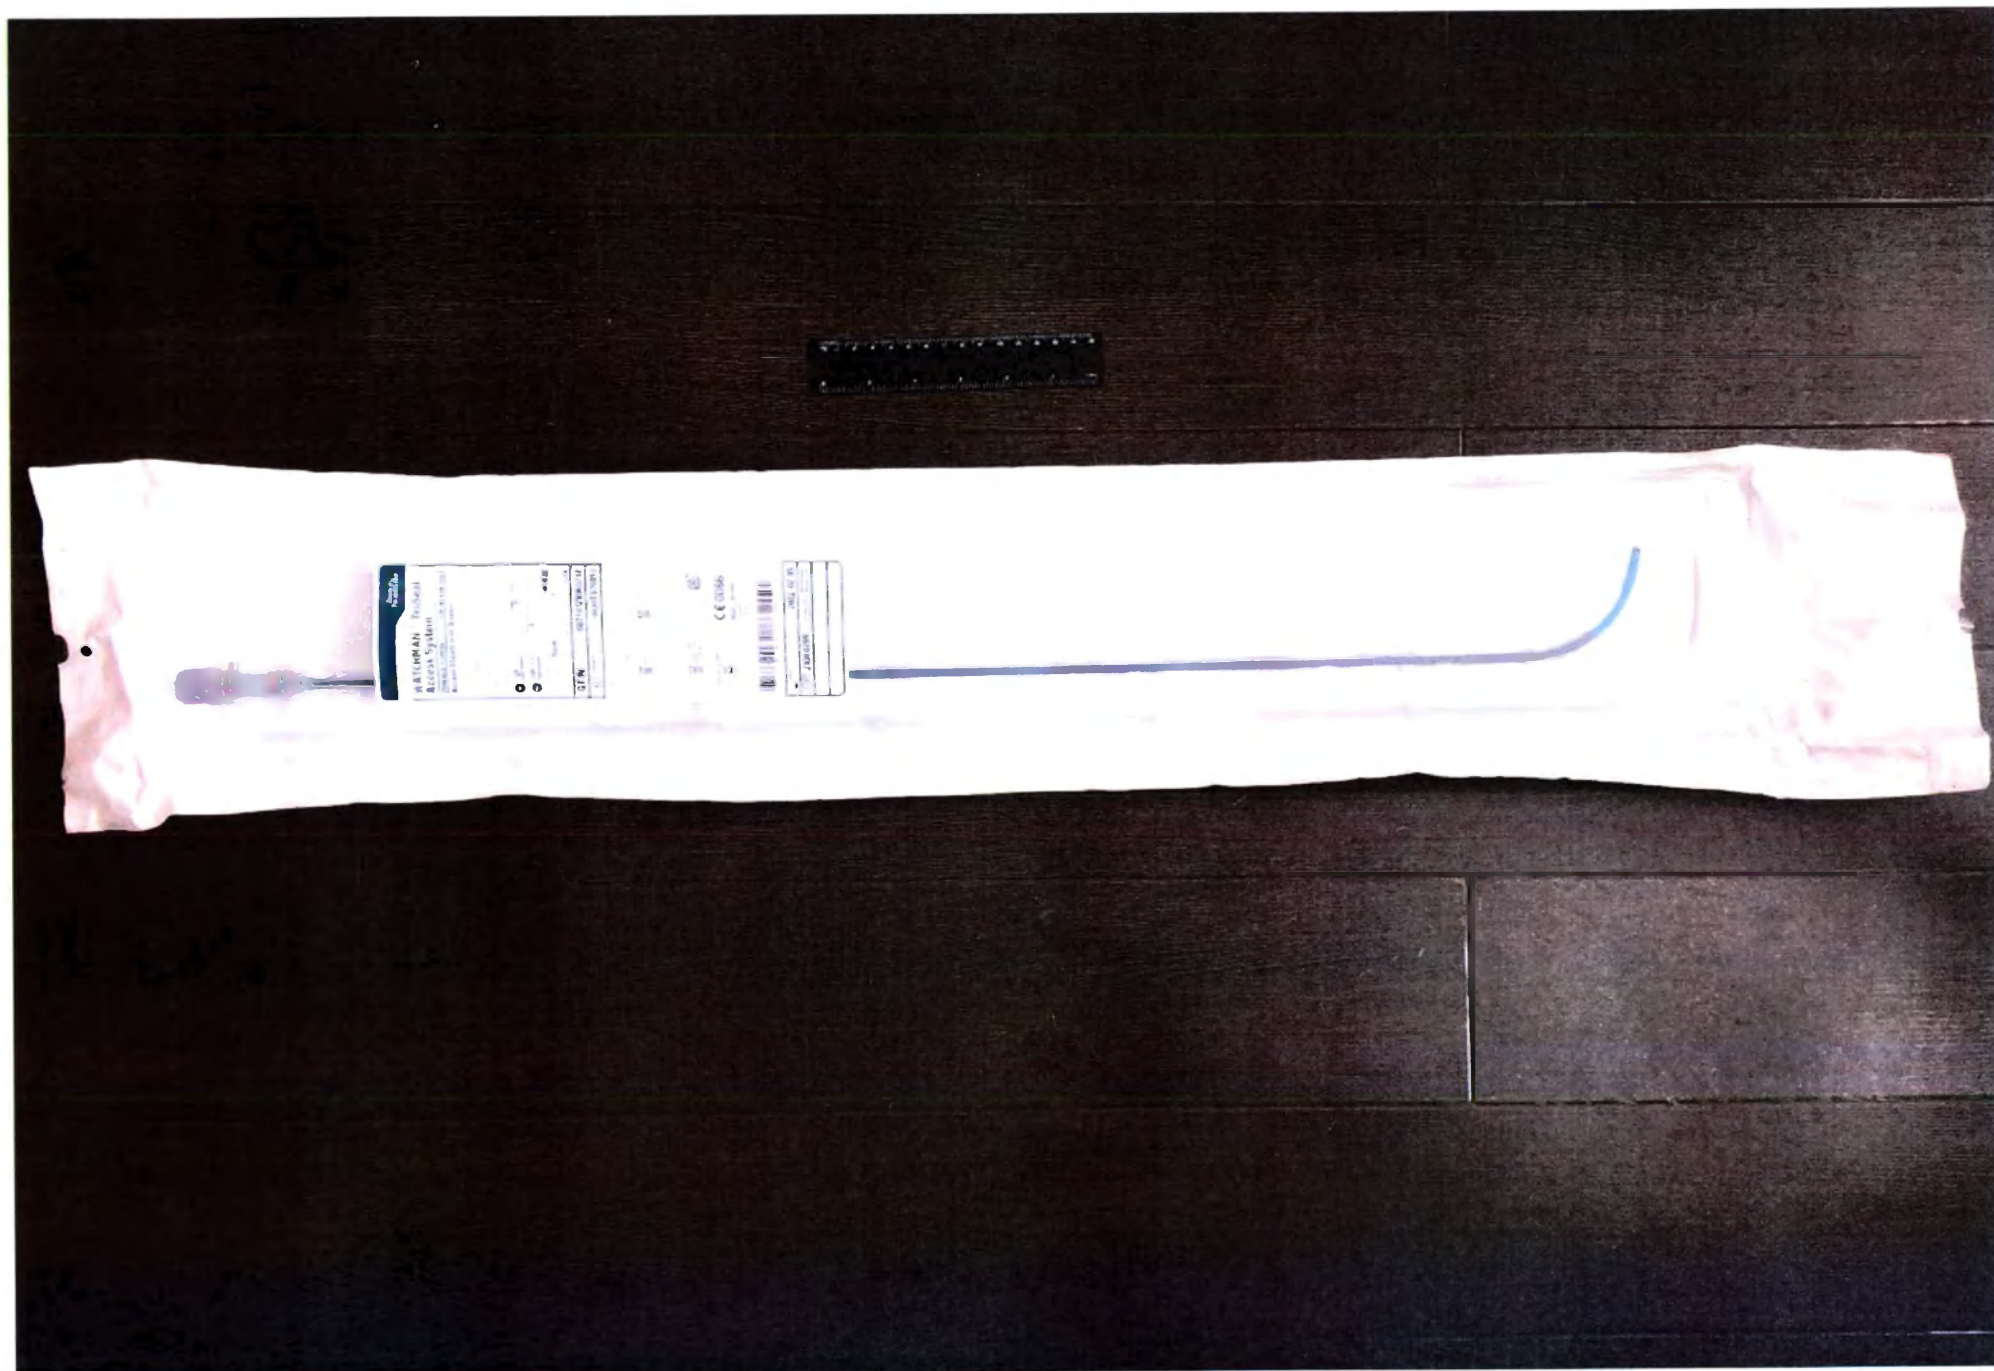

Этикетка запечатываемого пакета системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 1) Система доступа Watchman TruSeal, с одним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке , LOT 23304299 , Срок годности 05.02.2022 г.



WATCHMAN™ TruSeal™

Access System

SINGLE CURVE


12F ID/14F OD

Access Sheath with Dilator

Vaina de acceso con dilator, Gaine d'accès avec dilateur, Zugangsschleuse mit Dilator, Guaina di accesso con dilatore, Toegangshuis met dilator, Adgangshylster med dilator, enkhori proboronas je diastodze, Bainha de Acesso com Dilator, Aksesstijl met dilator, Bevezetshijvelu idgfoval, Pristupové pouzdro s dilatátorem, Koszulka do dostępu z rozszerzaczem, Tligangshylse med dilator, Diaforio Ergim Kimi, Sisäventtiilölkki ja laajennin, Teca de acceso cu dilator, Zavádzacie puždro s dilatátorom

12F (4.2mm)

Inner Diameter

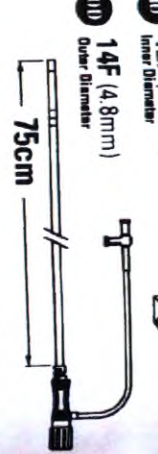

14F (4.8mm)

Outer Diameter

75cm

GTIN

08714729965732

REF

Serial No.

M635TS70010

Boston Scientific

WATCHMAN™ TruSeal™

Access System

SINGLE CURVE 12F ID/14F OD

GTIN 08714729965732

REF M635TS70010

LOT 23304299

Boston Scientific

WATCHMAN™ TruSeal™

Access System

SINGLE CURVE 12F ID/14F OD

GTIN 08714729965732

REF M635TS70010

LOT 23304299

Internal BSC Bar Code

50575563-01

CE 0086

Made in IRELAND

Ballybrit Business Park

Galway, IRELAND

9216530-01A

0108714729965732 172202051023304299

Use By


2022-02-05

LOT 23304299

STERILE

Sterilized using ethylene oxide.

Этикетка запечатываемого пакета системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 2) Система доступа Watchman TruSeal, с с двумя изгибами, внутренний диаметр 12 F (4,2мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке. LOT 23405234 , Срок годности 25.02.2022 г.




WATCHMAN™ TruSeal™

Access System

DOUBLE CURVE 12F ID/14F OD

Access Sheath with Dilator

Valve de acesso con dilator. Valve d'accès avec dilateur. Zugangserschäule mit Dilator. Guaina di accesso con dilatatore. Toegangshulst met dilator. Adgangshulst med dilator. Øndkørt introduktør med dilator. Valvina de Acesso con Dilator. Akseszűrűs dilatátor. Введучий інструмент з розширювачем. Тігунгачівка мед дилатор. Дилатори Ентрин Киди. Sisällyntäjäruutios dilatatorim. Teesä de akses cu dilator. Zavádacie ručisko s dilatátorem.

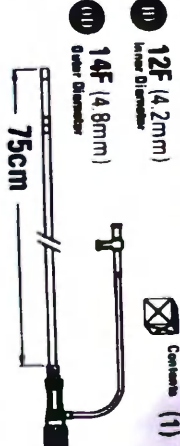

75cm

 **Contents (1)**
 12F (4.2mm)
 Inner Dilator
 14F (4.8mm)
 Outer Dilator

REF **Serial No**

GTIN **08714729965749**

M635T S70020

Boston Scientific WATCHMAN™ TruSeal™

Access System Access System

DOUBLE CURVE 12F ID/14F OD DOUBLE CURVE 12F ID/14F OD

GTIN 08714729965749 GTIN 08714729965749

REF M635T S70020 REF M635T S70020

LOT 23405234 LOT 23405234

Boston Scientific WATCHMAN™ TruSeal™

Access System Access System

DOUBLE CURVE 12F ID/14F OD DOUBLE CURVE 12F ID/14F OD

GTIN 08714729965749 GTIN 08714729965749

REF M635T S70020 REF M635T S70020

LOT 23405234 LOT 23405234

CE 0086

Made in IRELAND

Ballybirt Business Park

Galway, IRELAND

Internal WSC Bar Code

5057953-01


92165930-0724

LOT 23405234


2022-02-25

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide

Этикетка запечатываемого пакета системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения 3) Система доступа Watchman TruSeal с передним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, LOT 23380931 , Срок годности 20.02.2022 г.

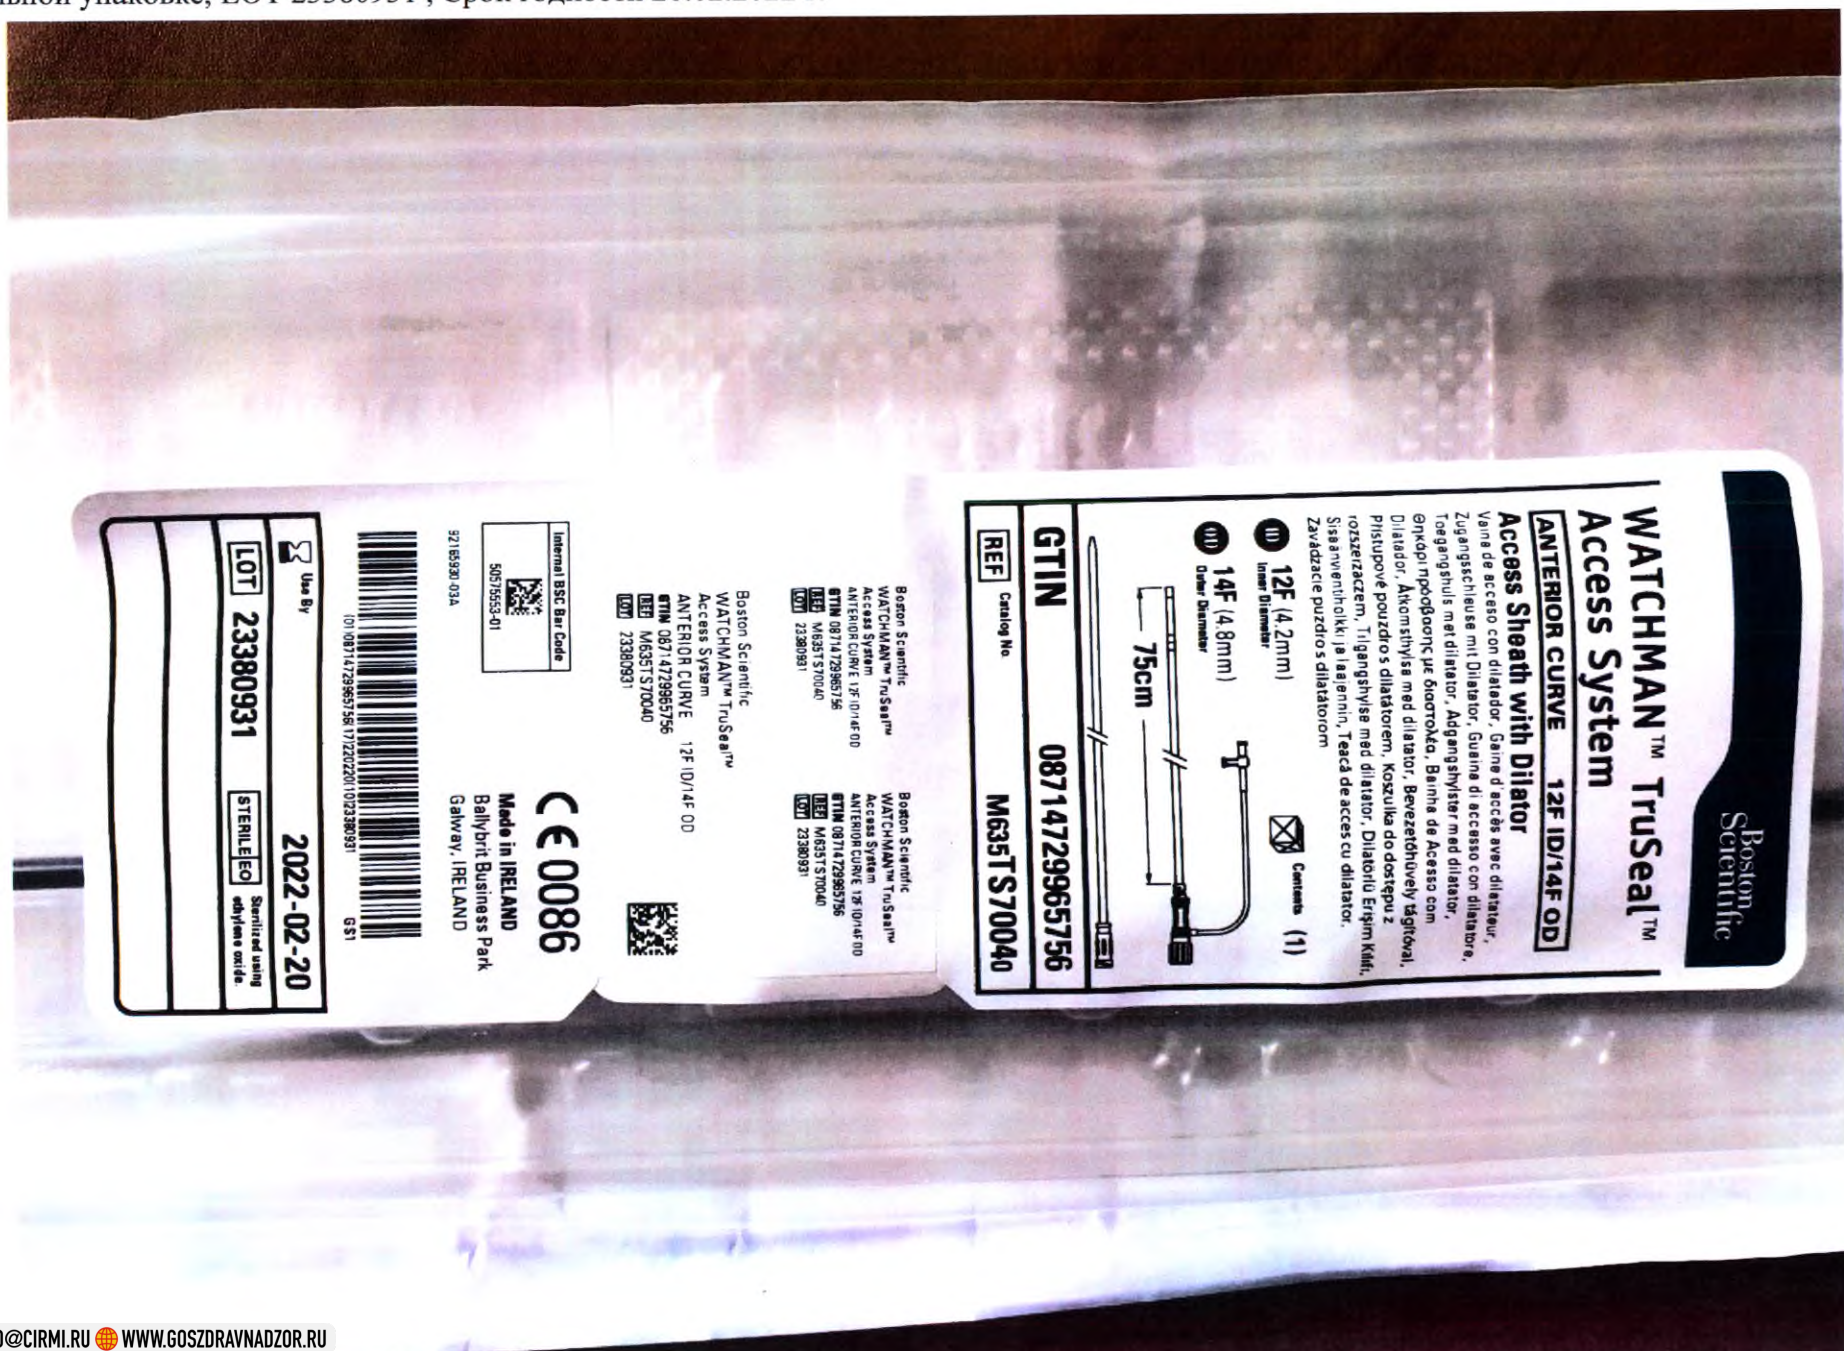

Запечатываемый пакет (обратная сторона) системы доступа Watchman TruSeal

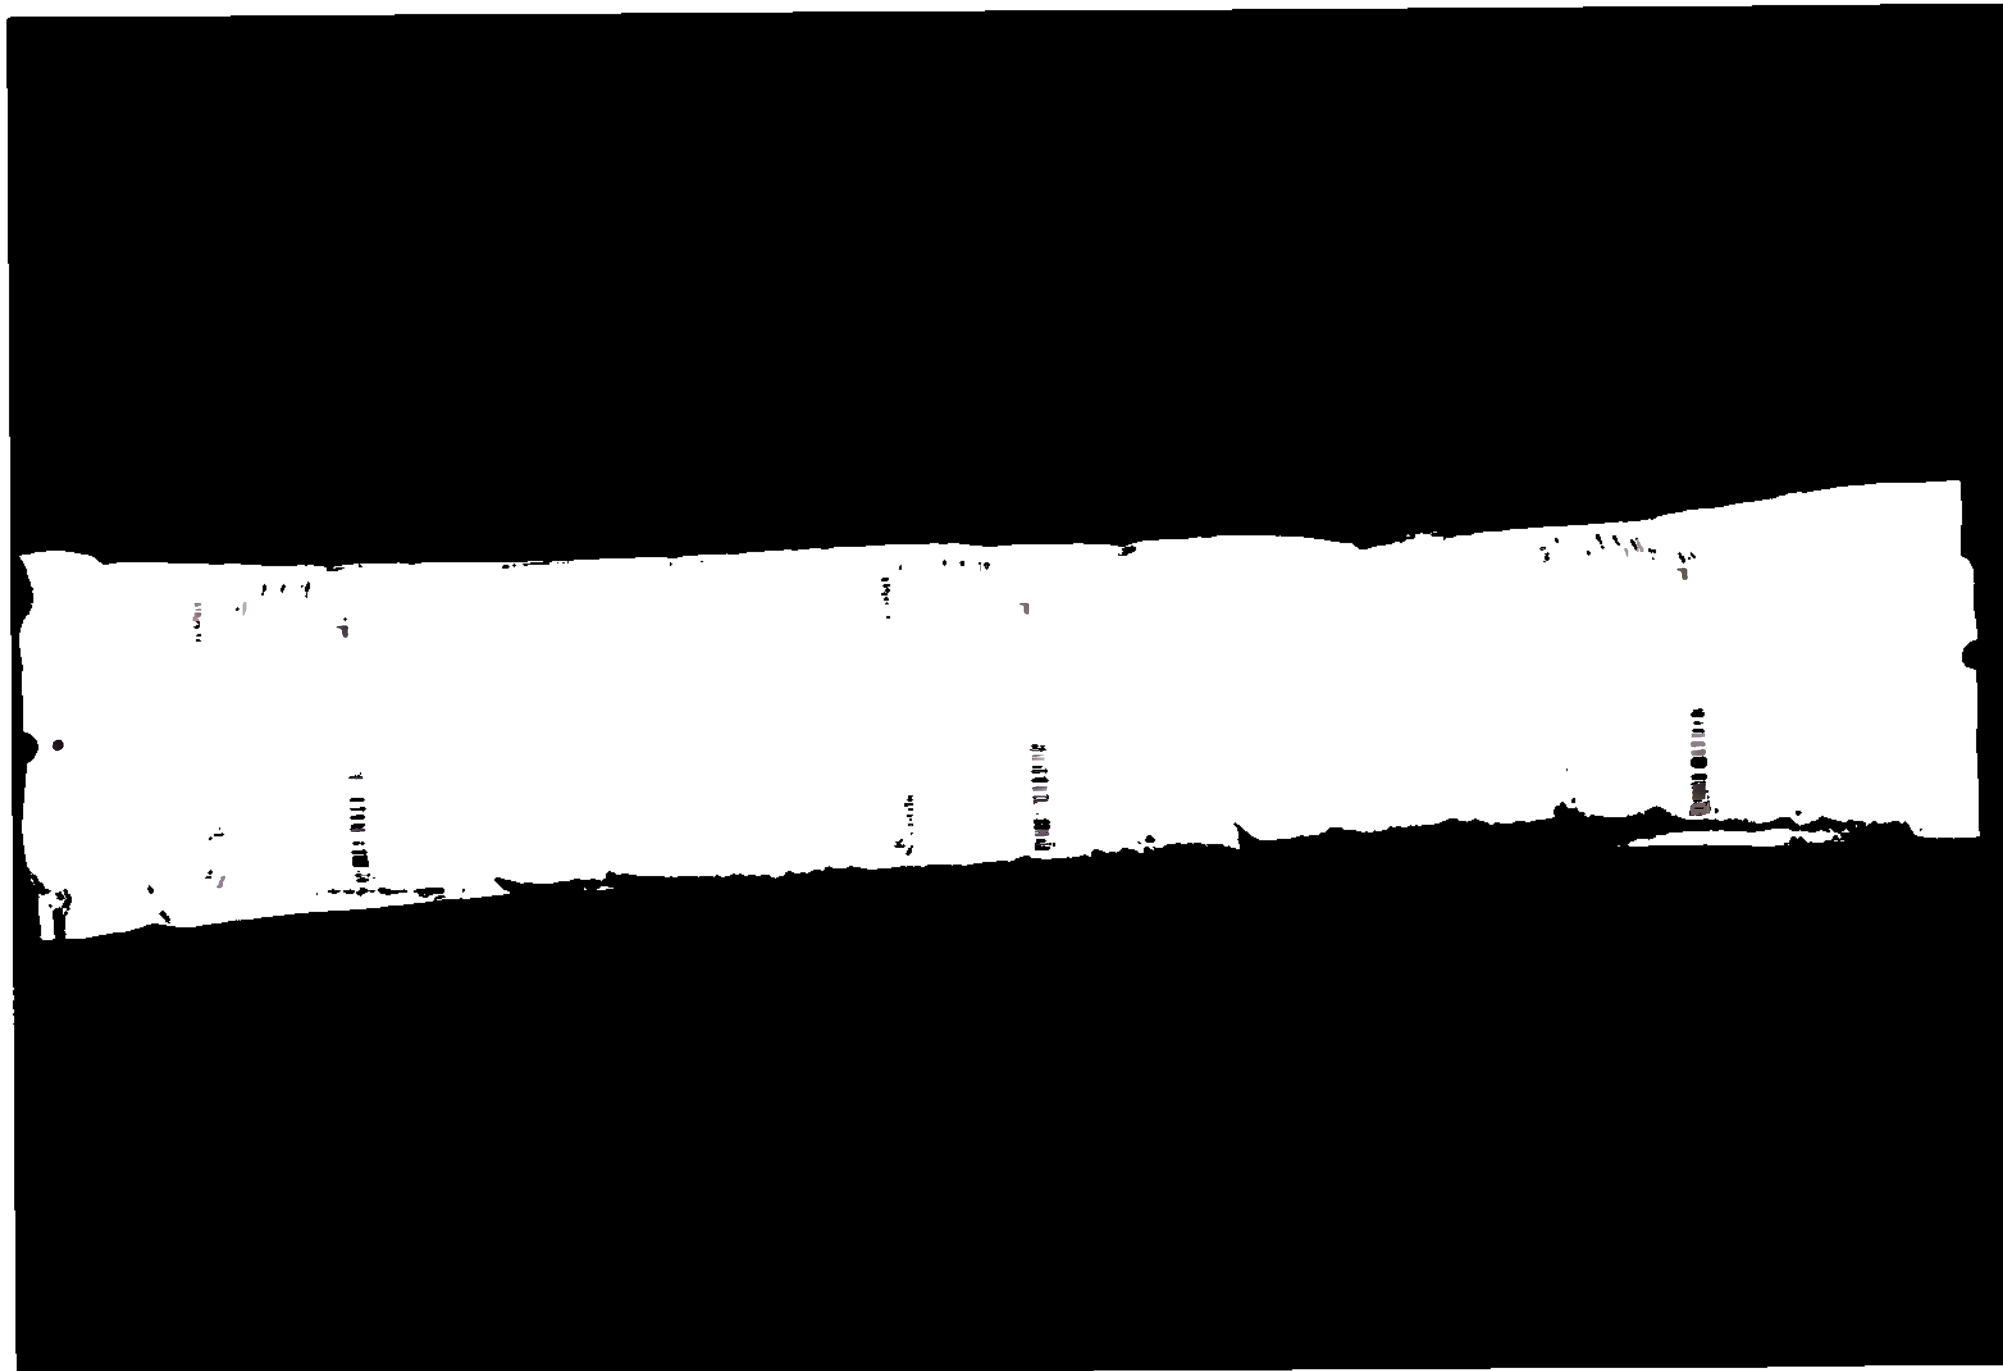

Маркировка запечатываемого пакета (обратной стороны) системы доступа Watchman TruSeal

**Boston
Scientific**



Rx ONLY



**For single use only.
Do not reuse.**




**Do Not
Resterilize**



**Consult instruction
for use.**



**Do not use if package
is damaged.**



**EU Authorized
Representative**


**Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND**




**Legal
Manufacturer**

**Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001**

Отдельная коробка (лицевая сторона) системы доступа Watchman TruSeal

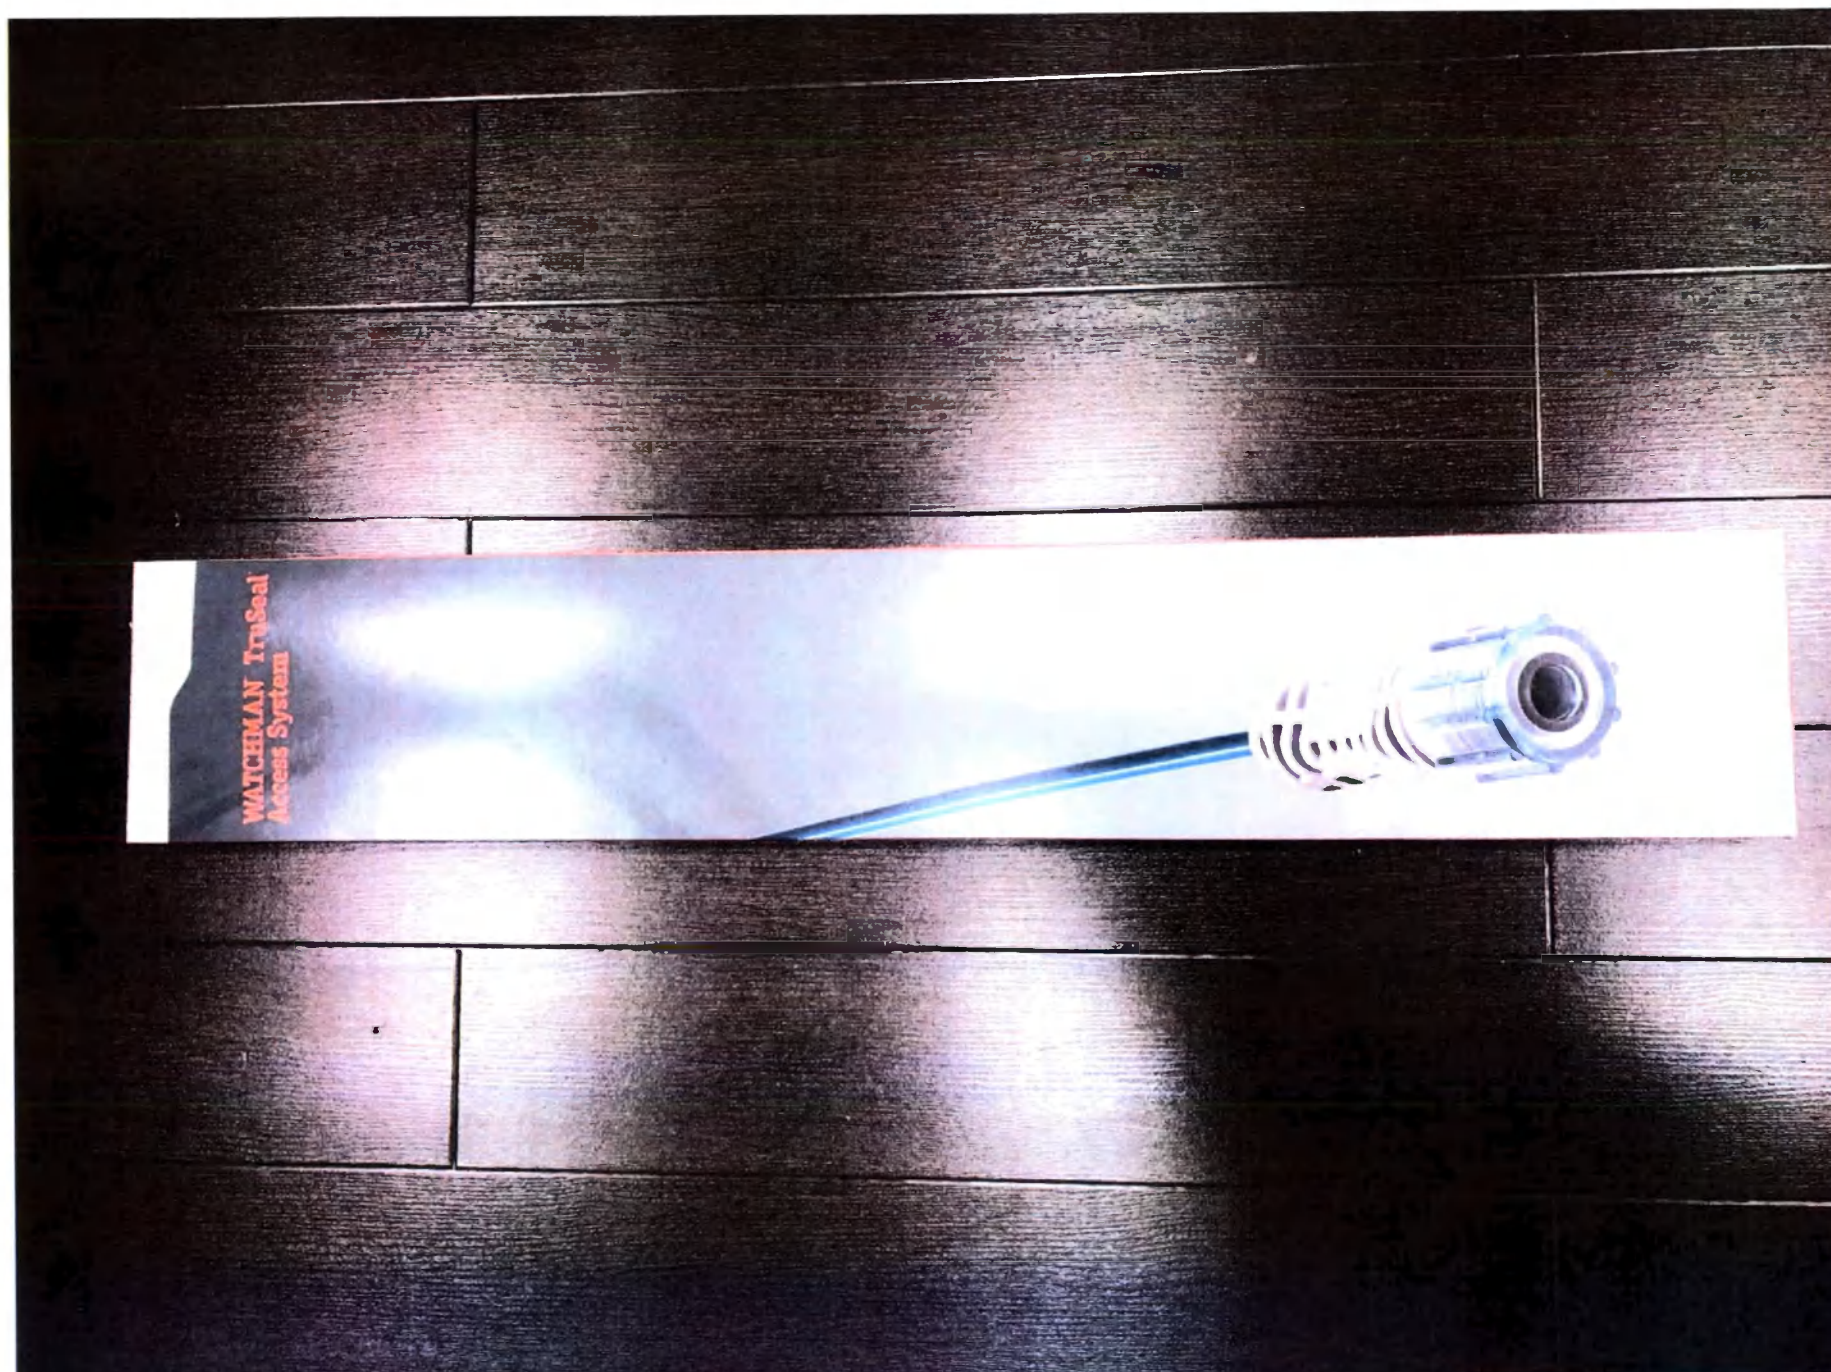

Отдельная коробка (боковая сторона) системы доступа Watchman TruSeal

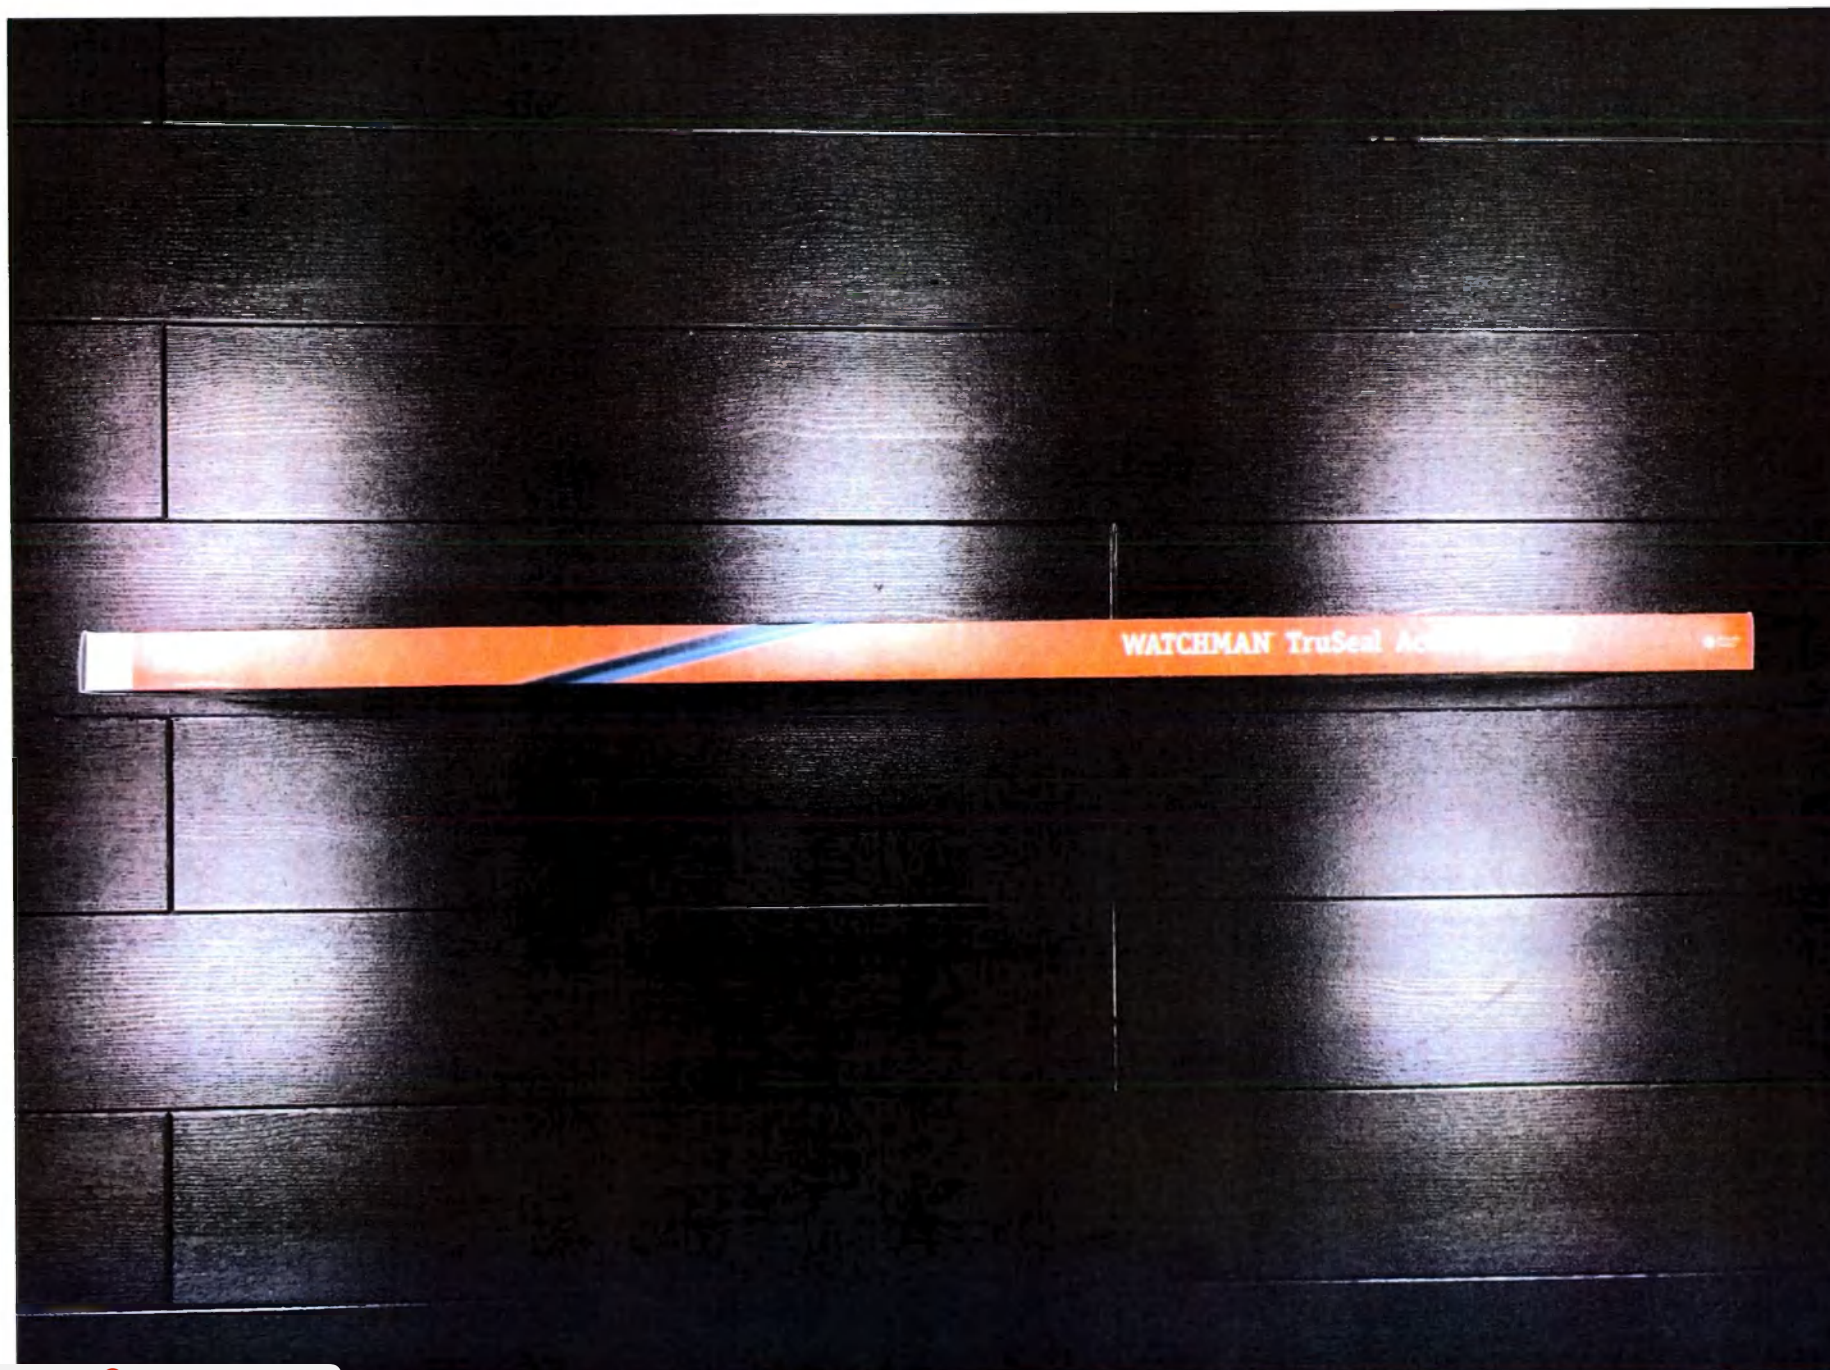

The image shows a rectangular box for the 'WATCHMAN YuSeal Access System' by Medtronic. The box is white with blue and red accents. It features a large blue arrow pointing upwards, a barcode, and various regulatory markings including CE, FDA, and ISO. The box is placed on a dark wooden surface.

Этикетка отдельной коробки (обратная сторона) системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 1) Система доступа Watchman TruSeal, с одним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, - инструкция по применению; LOT 23304299 , Срок годности 05.02.2022 г.

WATCHMAN™ TruSeal™

Access System

SINGLE CURVE 12F ID/14F OD

Access Sheath with Dilator


Vaina de acceso con dilator, Gaine d'accès avec dilateur,
Zugangsschleuse mit Dilator, Guaina di accesso con
dilatore, Toegangshuis met dilator, Adgangshylster med
dilator, Оγκρό προσβάσις με διαστολέα, Vainha de
Accesso com Dilator, Atkomsthuisa med dilator,
Bevezetdhively tagítóval, Přístupové pouzdro s dilatátorem,
Koszulka do dostępu z rozszerzaczem, Tilgangshylse med
dilator, Dilatorliu Enişim Kılıfı, Sisâhventhoikkii laajennin,
Teacă de acces cu dilator, Zavádzacie puzdro s dilatátorom

☒ Contents (1)

ID 12F (4.2mm)
Inner Dilator

OD 14F (4.8mm)
Outer Dilator

75cm

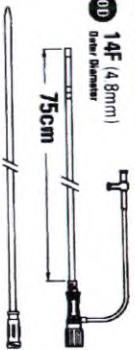

GTIN 08714729965732	LOT 23304299
REF Coding No. M635TS70010	Use By 2022-02-05

WATCHMAN™ TruSeal™

Boston Scientific

WATCHMAN™ TruSeal™

Access System

SINGLE CURVE

GTIN 08714729965732

REF M635TS70010

LOT 23304299

Boston Scientific

WATCHMAN™ TruSeal™

Access System

SINGLE CURVE

GTIN 08714729965732

REF M635TS70010

LOT 23304299

Boston Scientific

WATCHMAN™ TruSeal™

Access System

SINGLE CURVE

GTIN 08714729965732

REF M635TS70010

LOT 23304299

Made in IRELAND

Ballybert Business Park

Galway, IRELAND

CE 0086

Boston Scientific

WATCHMAN™ TruSeal™

Access System

SINGLE CURVE

GTIN 08714729965732

REF M635TS70010

LOT 23304299

STERILE


Sealed and
sterile until
opened




GTIN 08714729965732 LOT 23304299

LOT 23304299


Этикетка отдельной коробки (боковая сторона) системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 1) Система доступа Watchman TruSeal, с одним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, - инструкция по применению; LOT 23304299, Срок годности 05.02.2022 г.

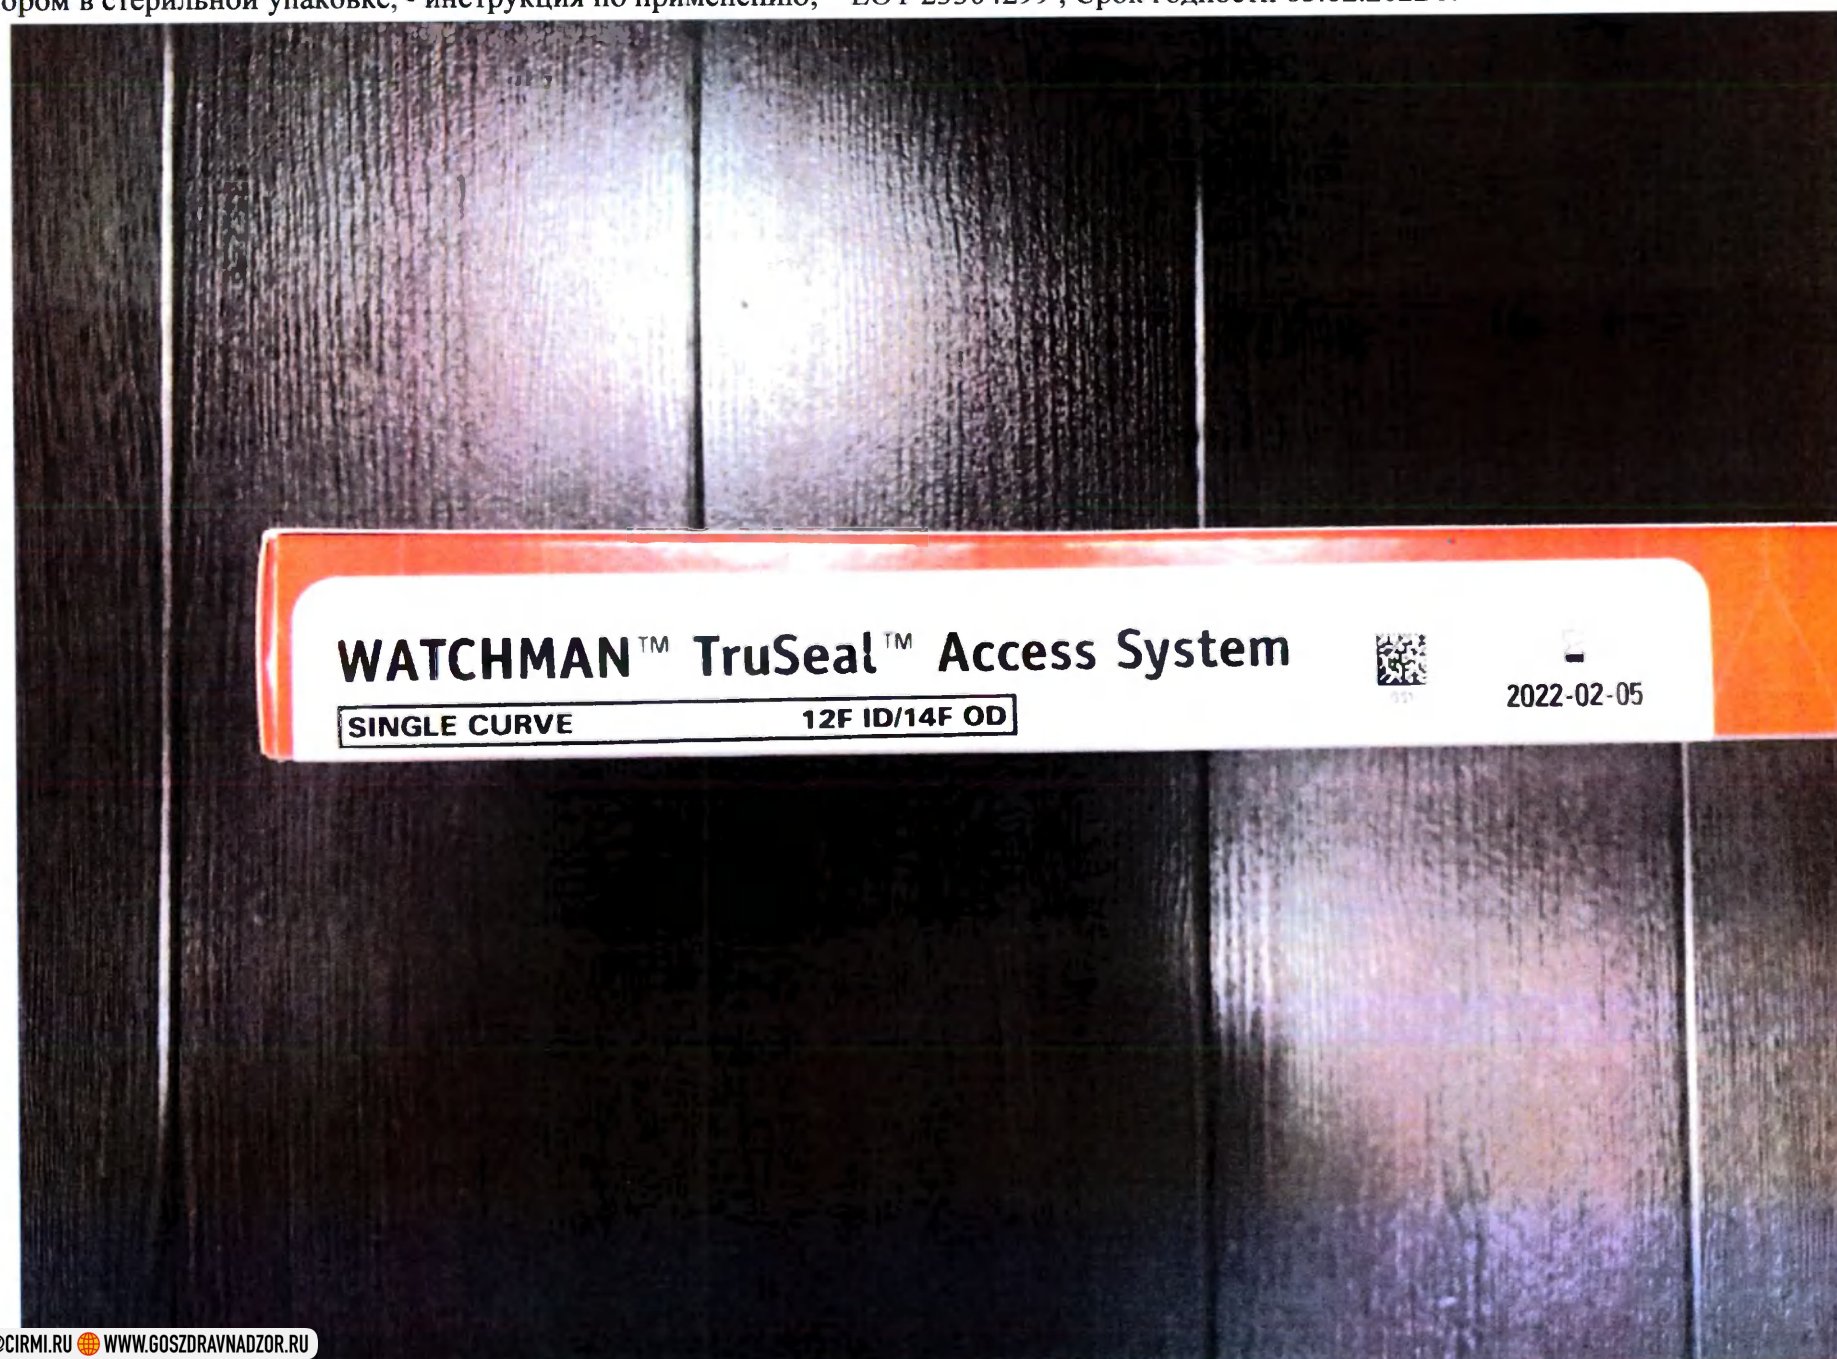

Этикетка отдельной коробки (верхняя сторона) системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 1) Система доступа Watchman TruSeal, с одним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, - инструкция по применению; LOT 23304299, Срок годности 05.02.2022 г.

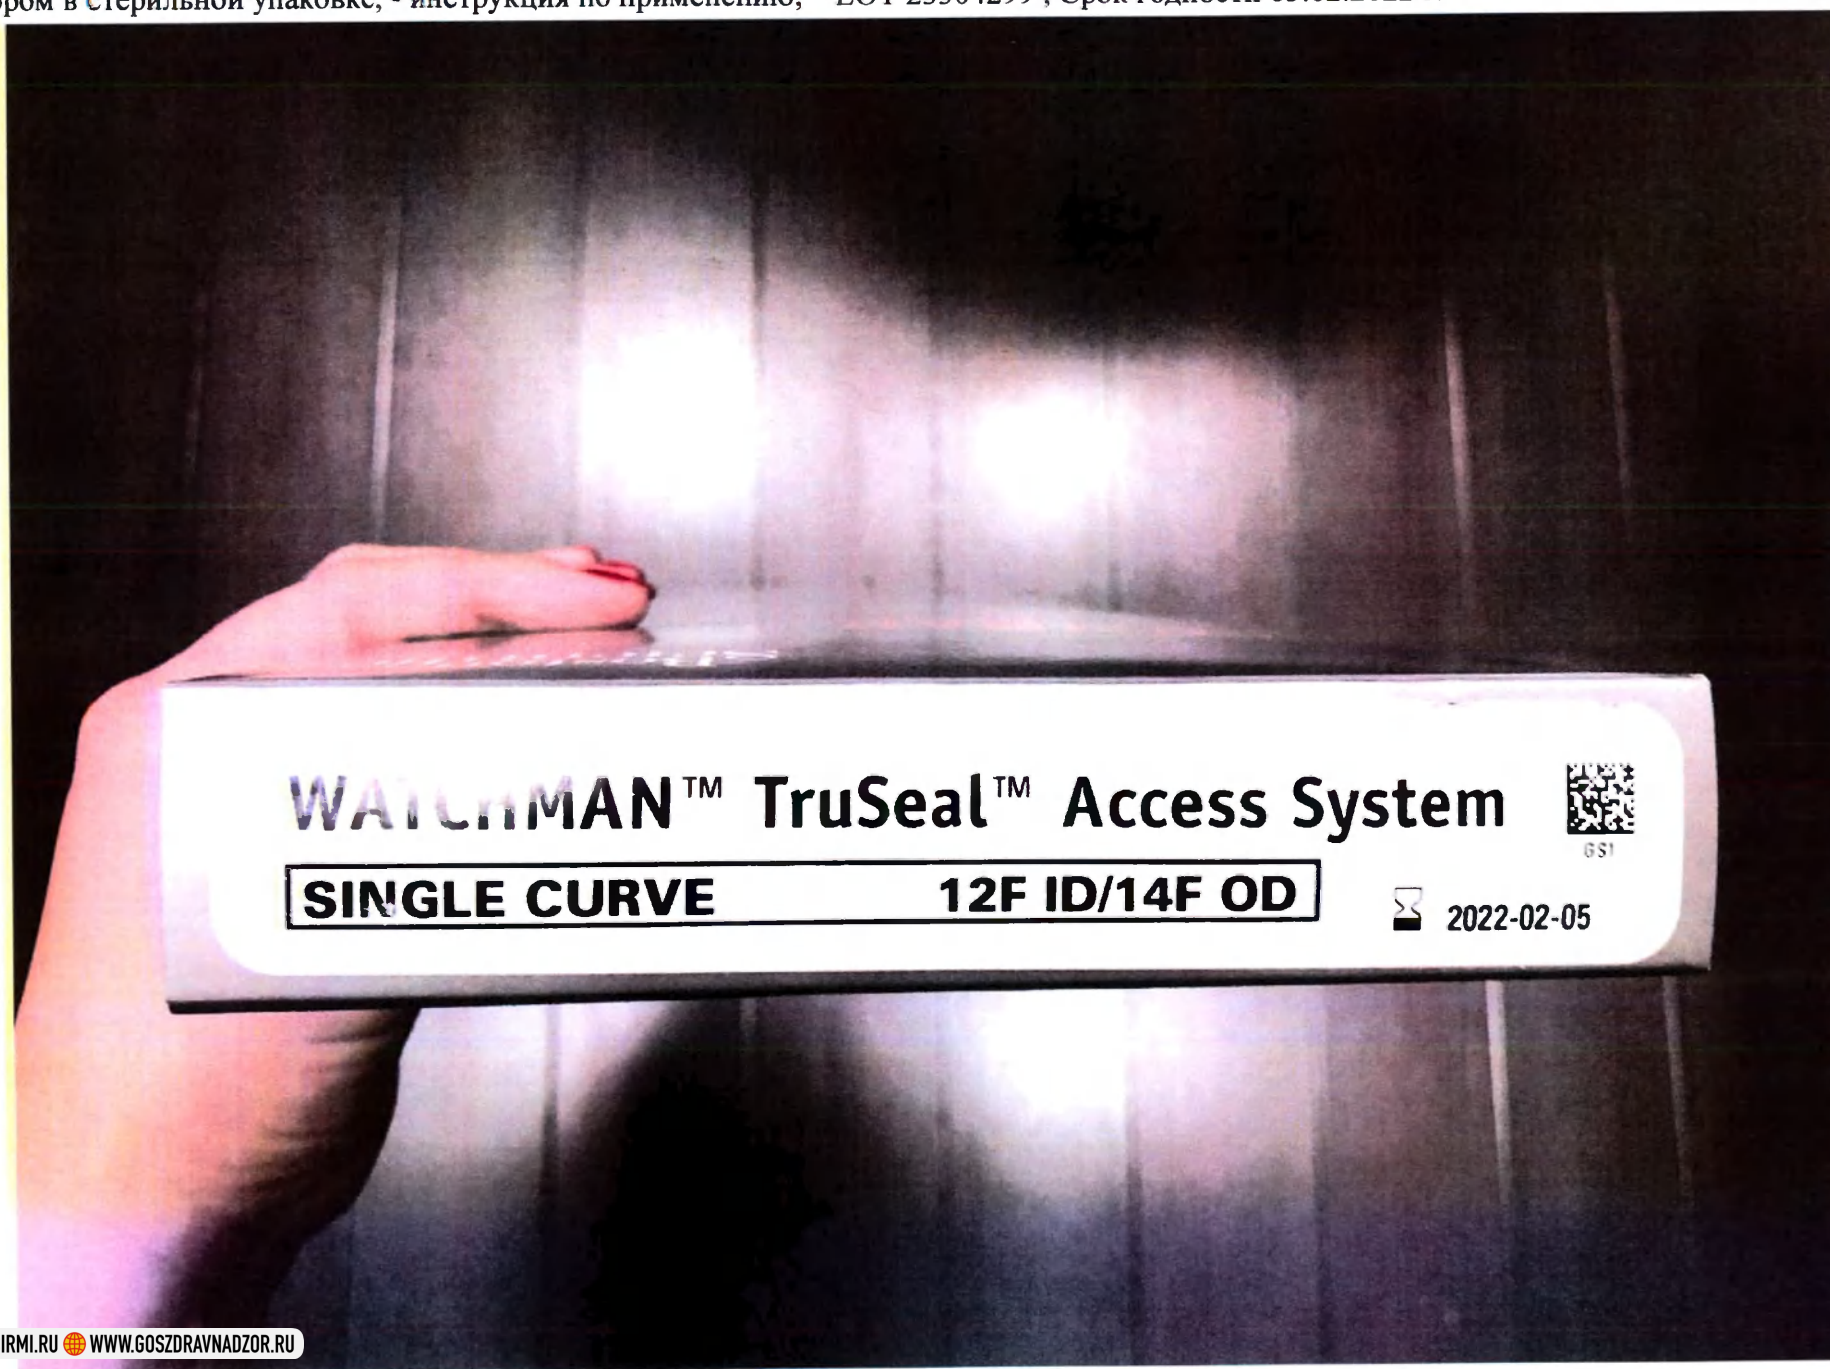

Этикетка отдельной коробки (нижняя сторона) системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 1) Система доступа Watchman TruSeal, с одним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, - инструкция по применению; LOT 23304299, Срок годности 05.02.2022 г.

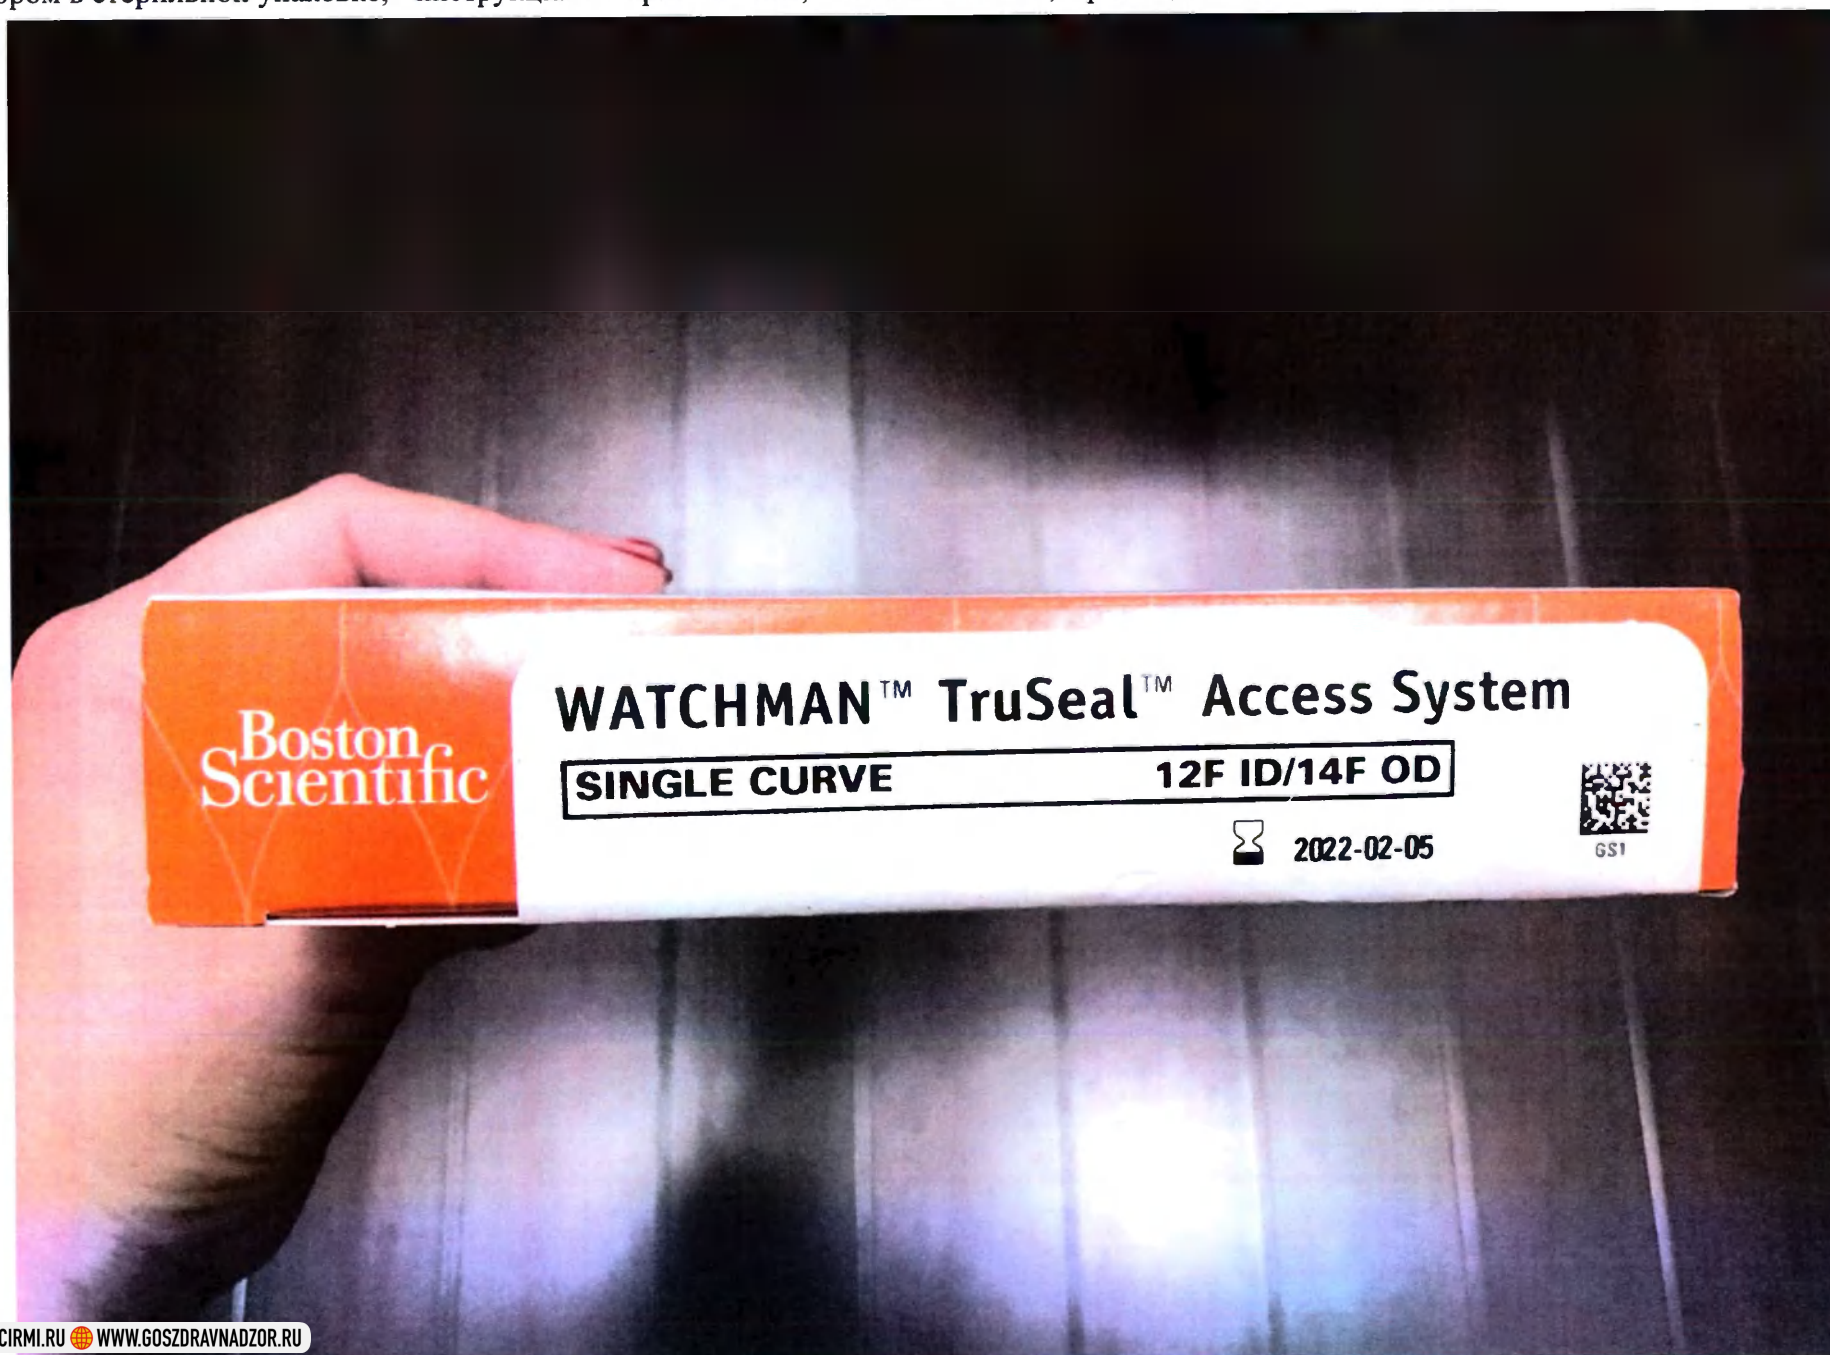

Этикетка отдельной коробки (обратная сторона) системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 2) Система доступа Watchman TruSeal, с двумя изгибами, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, - инструкция по применению; LOT 23405234, Срок годности 25.02.2022 г.

WATCHMAN™ TruSeal™ Access System


DOUBLE CURVE

12F ID/14F OD

Access Sheath with Dilator

Vaina de acceso con dilatador, Gaine d'acces avec dilateur, Zugangsschleuse mit Dilator, Guaina di accesso con dilatatore, Toegangshuls met dilator, Adgangshylster med dilator, Θηκάρι πρόσβασης με διαστολέα, Bainha de Acesso com Dilator, Ätkomsthylsa med dilator, Bevezetőhüvely tágitóval, Přístupové pouzdro s dilatátorem, Koszulka do dostępu z rozszerzaczem, Tilgangshylse med dilator, Dillatörlü Erişim Kılıfı, Sisäärvientiholkki ja laajennin, Teacă de acces cu dilatator, Závádzacie puzdro s dilatátorom

 Contents (1)

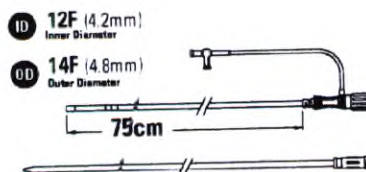

GTIN 08714729965749

LOT

23405234

REF

Catalog No

M635TS70020

 Use By

2022-02-25



921451021-024

Boston Scientific
WATCHMAN™ TruSeal™
Access System
DOUBLE CURVE 12F ID/14F OD
GTIN 08714729965749
REF M635TS70020
LOT 23405234



Boston Scientific
WATCHMAN™ TruSeal™
Access System
DOUBLE CURVE 12F ID/14F OD
GTIN 08714729965749
REF M635TS70020
LOT 23405234



Boston Scientific
WATCHMAN™ TruSeal™
Access System
DOUBLE CURVE 12F ID/14F OD
GTIN 08714729965749
REF M635TS70020
LOT 23405234



CE 0086

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND



01 08714729965749 17 022225 11 23405234

GSI

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide

Этикетка отдельной коробки (боковая сторона) системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 2) Система доступа Watchman TruSeal, с двумя изгибами, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, - инструкция по применению; LOT 23405234, Срок годности 25.02.2022 г.

WATCHMAN™ TruSeal™ Access System


DOUBLE CURVE

12F ID/14F OD





2022-02-25

Этикетка отдельной коробки (верхняя сторона) системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 2) Система доступа Watchman TruSeal, с двумя изгибами, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, - инструкция по применению; LOT 23405234, Срок годности 25.02.2022 г.

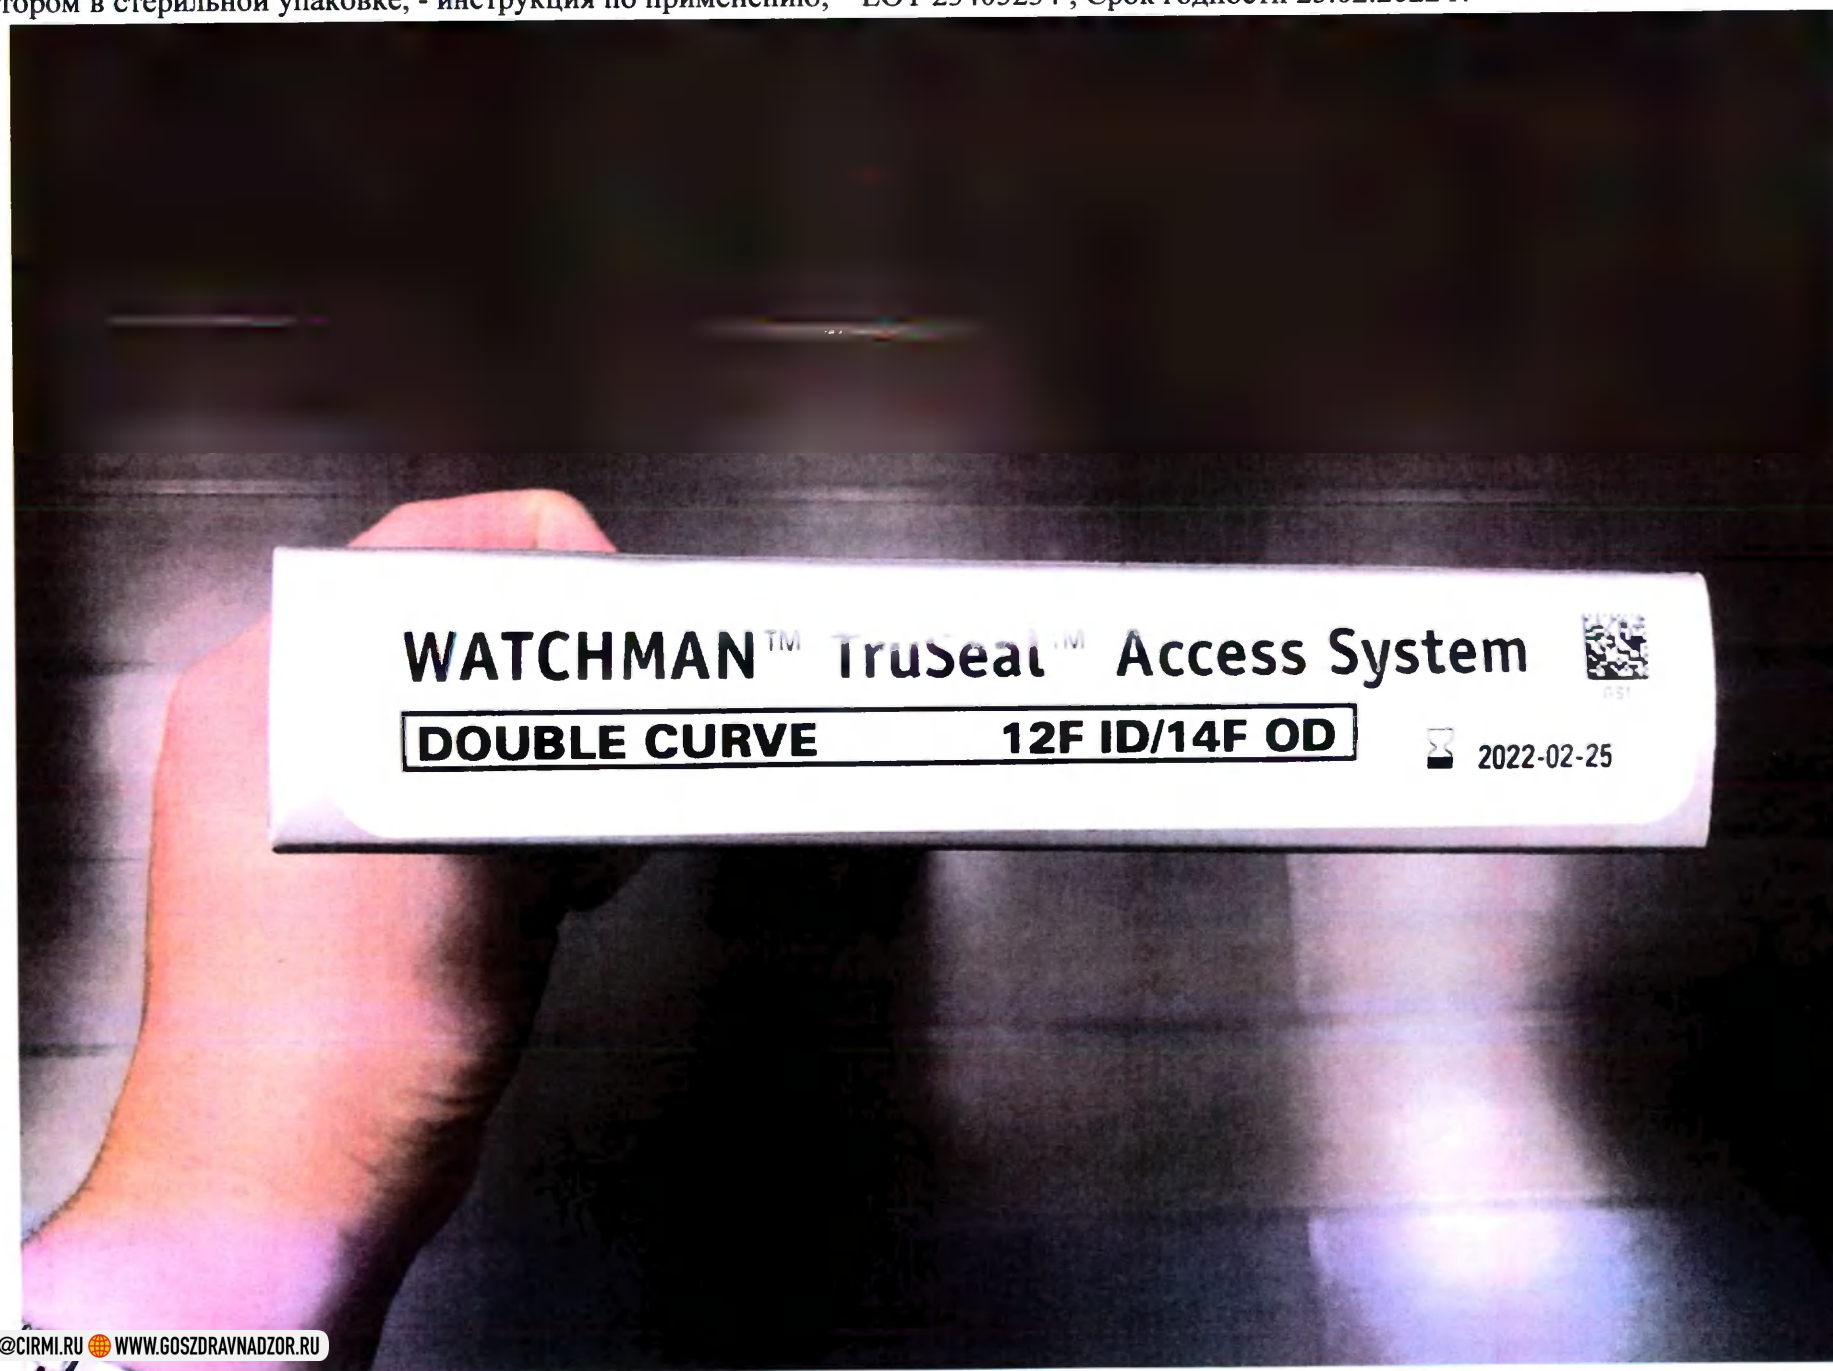

Этикетка отдельной коробки (нижняя сторона) системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 2) Система доступа Watchman TruSeal, с двумя изгибами, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, - инструкция по применению; LOT 23405234, Срок годности 25.02.2022 г.

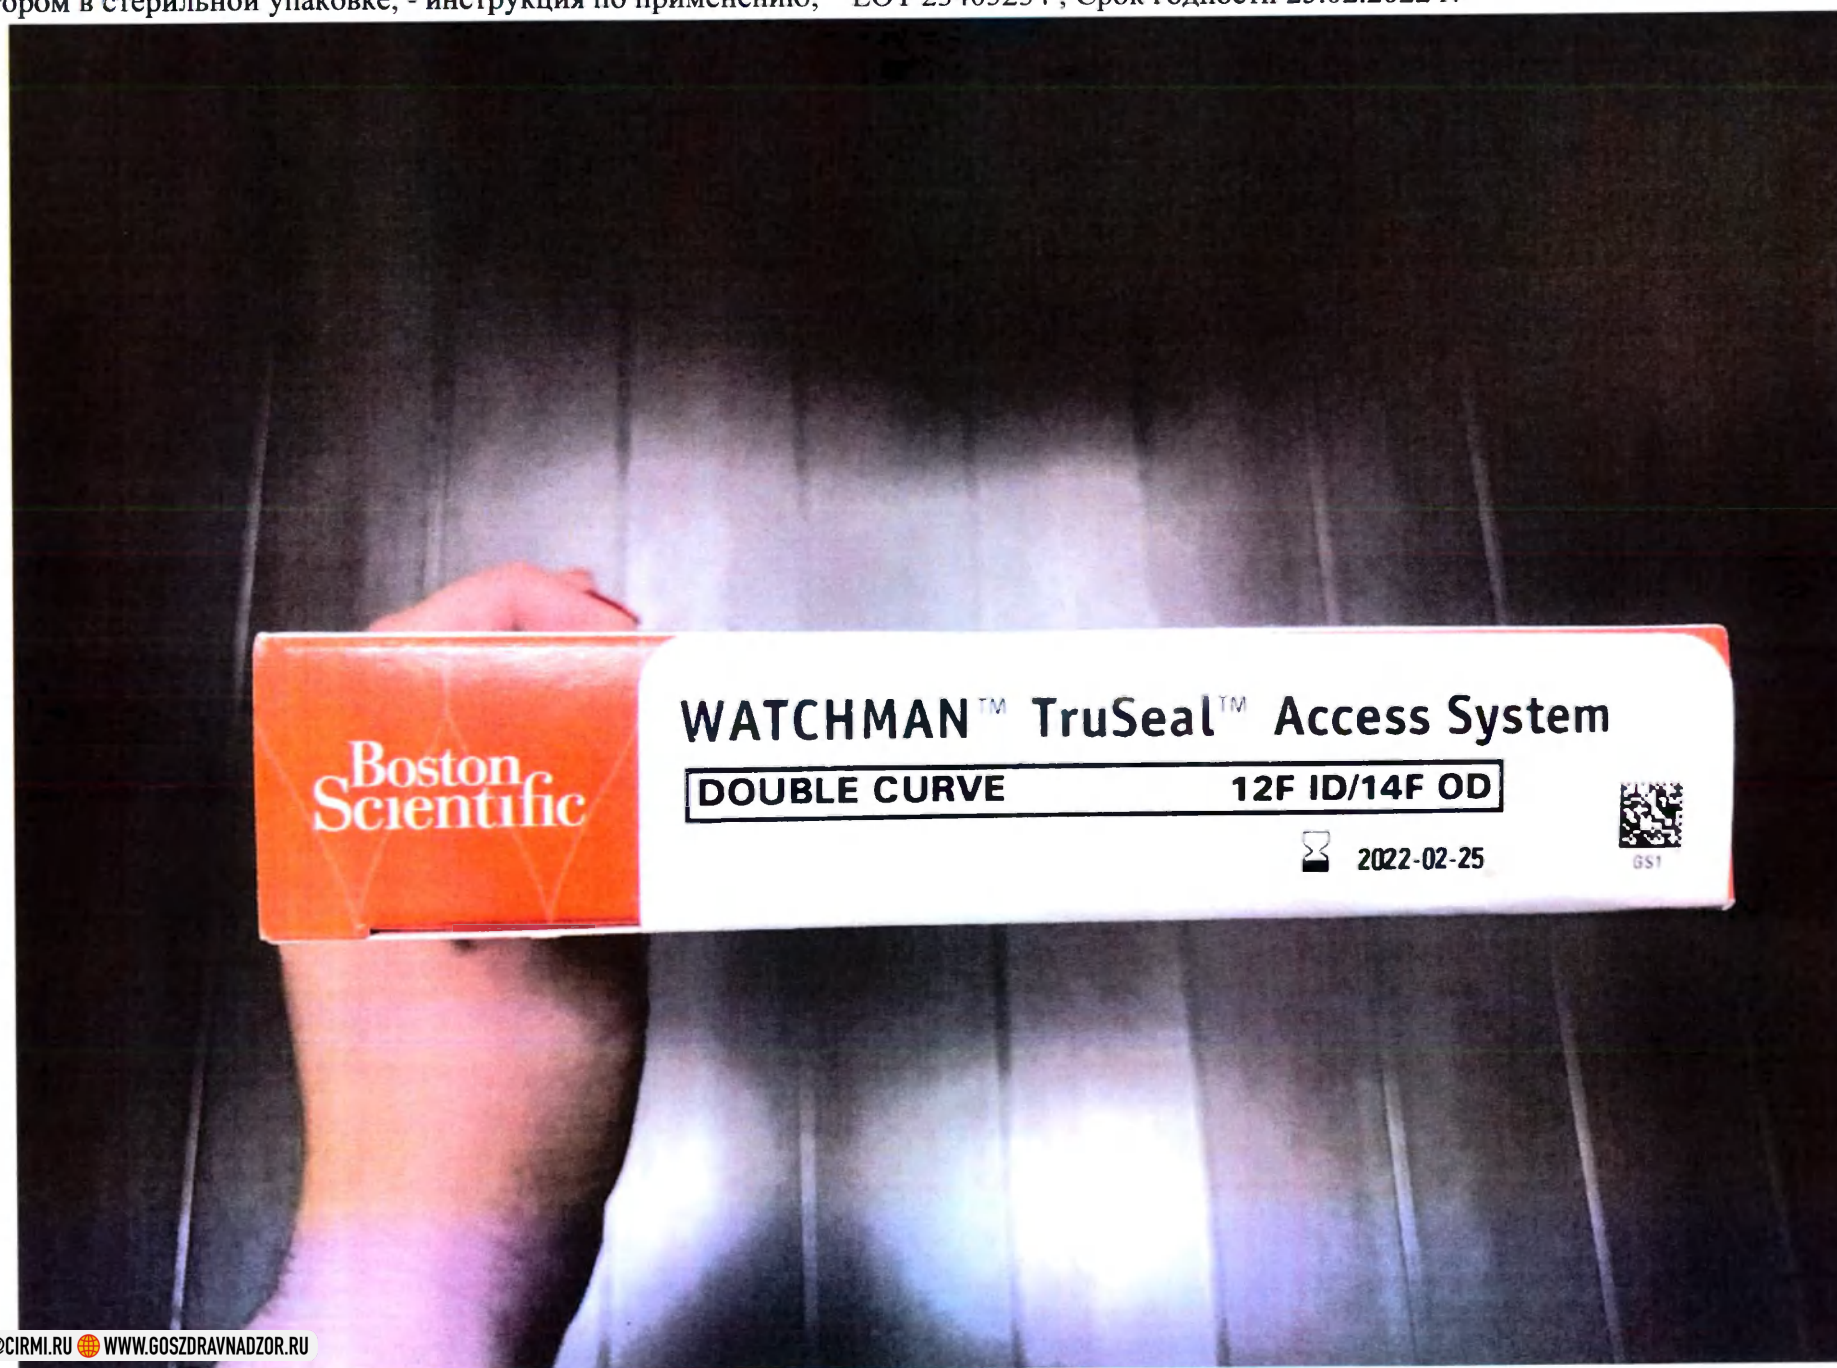

Этикетка отдельной коробки (обратная сторона) системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 3) Система доступа Watchman TruSeal, с передним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, - инструкция по применению; LOT 23380931, Срок годности 20.02.2022 г.

WATCHMAN™ TruSeal™ Access System

ANTERIOR CURVE 12F ID/14F OD


Access Sheath with Dilator

Vaina de acceso con dilatador, Gaine d'accès avec dilateur, Zugangsschleuse mit Dilatator, Guaina di accesso con dilatatore, Toegangshuls met dilatator, Adgangshylster med dilatator, Θηκάρι πρόσβασης με διαστολέα, Baina de Acesso com Dilatador, Åtkomsthylsa med dilatator, Bevezetőhüvely tágitóval, Přístupové pouzdro s dilatátorem, Koszulka do dostępu z rozszerzaczem, Tilgangshylse med dilatator, Dilatörlü Erişim Kilifi, Sisäänvientiholkki ja laajennin, Teacă de acces cu dilatator, Zavádzacie puzdro s dilatátorom

 Contents (1)

ID 12F (4.2mm)
Inner Diameter

OD 14F (4.8mm)
Outer Diameter

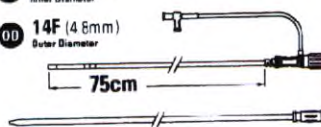

GTIN 08714729965756

LOT

23380931

REF

Catalog No

M635TS70040

Use By

2022-02-20



32 165 921 070

Boston Scientific
WATCHMAN™ TruSeal™
Access System
ANTERIOR CURVE 12F ID/14F OD
GTIN 08714729965756
REF M635TS70040
LOT 23380931



Boston Scientific
WATCHMAN™ TruSeal™
Access System
ANTERIOR CURVE 12F ID/14F OD
GTIN 08714729965756
REF M635TS70040
LOT 23380931



Boston Scientific
WATCHMAN™ TruSeal™
Access System
ANTERIOR CURVE 12F ID/14F OD
GTIN 08714729965756
REF M635TS70040
LOT 23380931



CE 0086

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND




08714729965756 17 220220 23380931

951

STERILE

Sterilized using
ethylene oxide

Этикетка отдельной коробки (боковая сторона) системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 3) Система доступа Watchman TruSeal, с передним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, - инструкция по применению; LOT 23380931, Срок годности 20.02.2022 г.

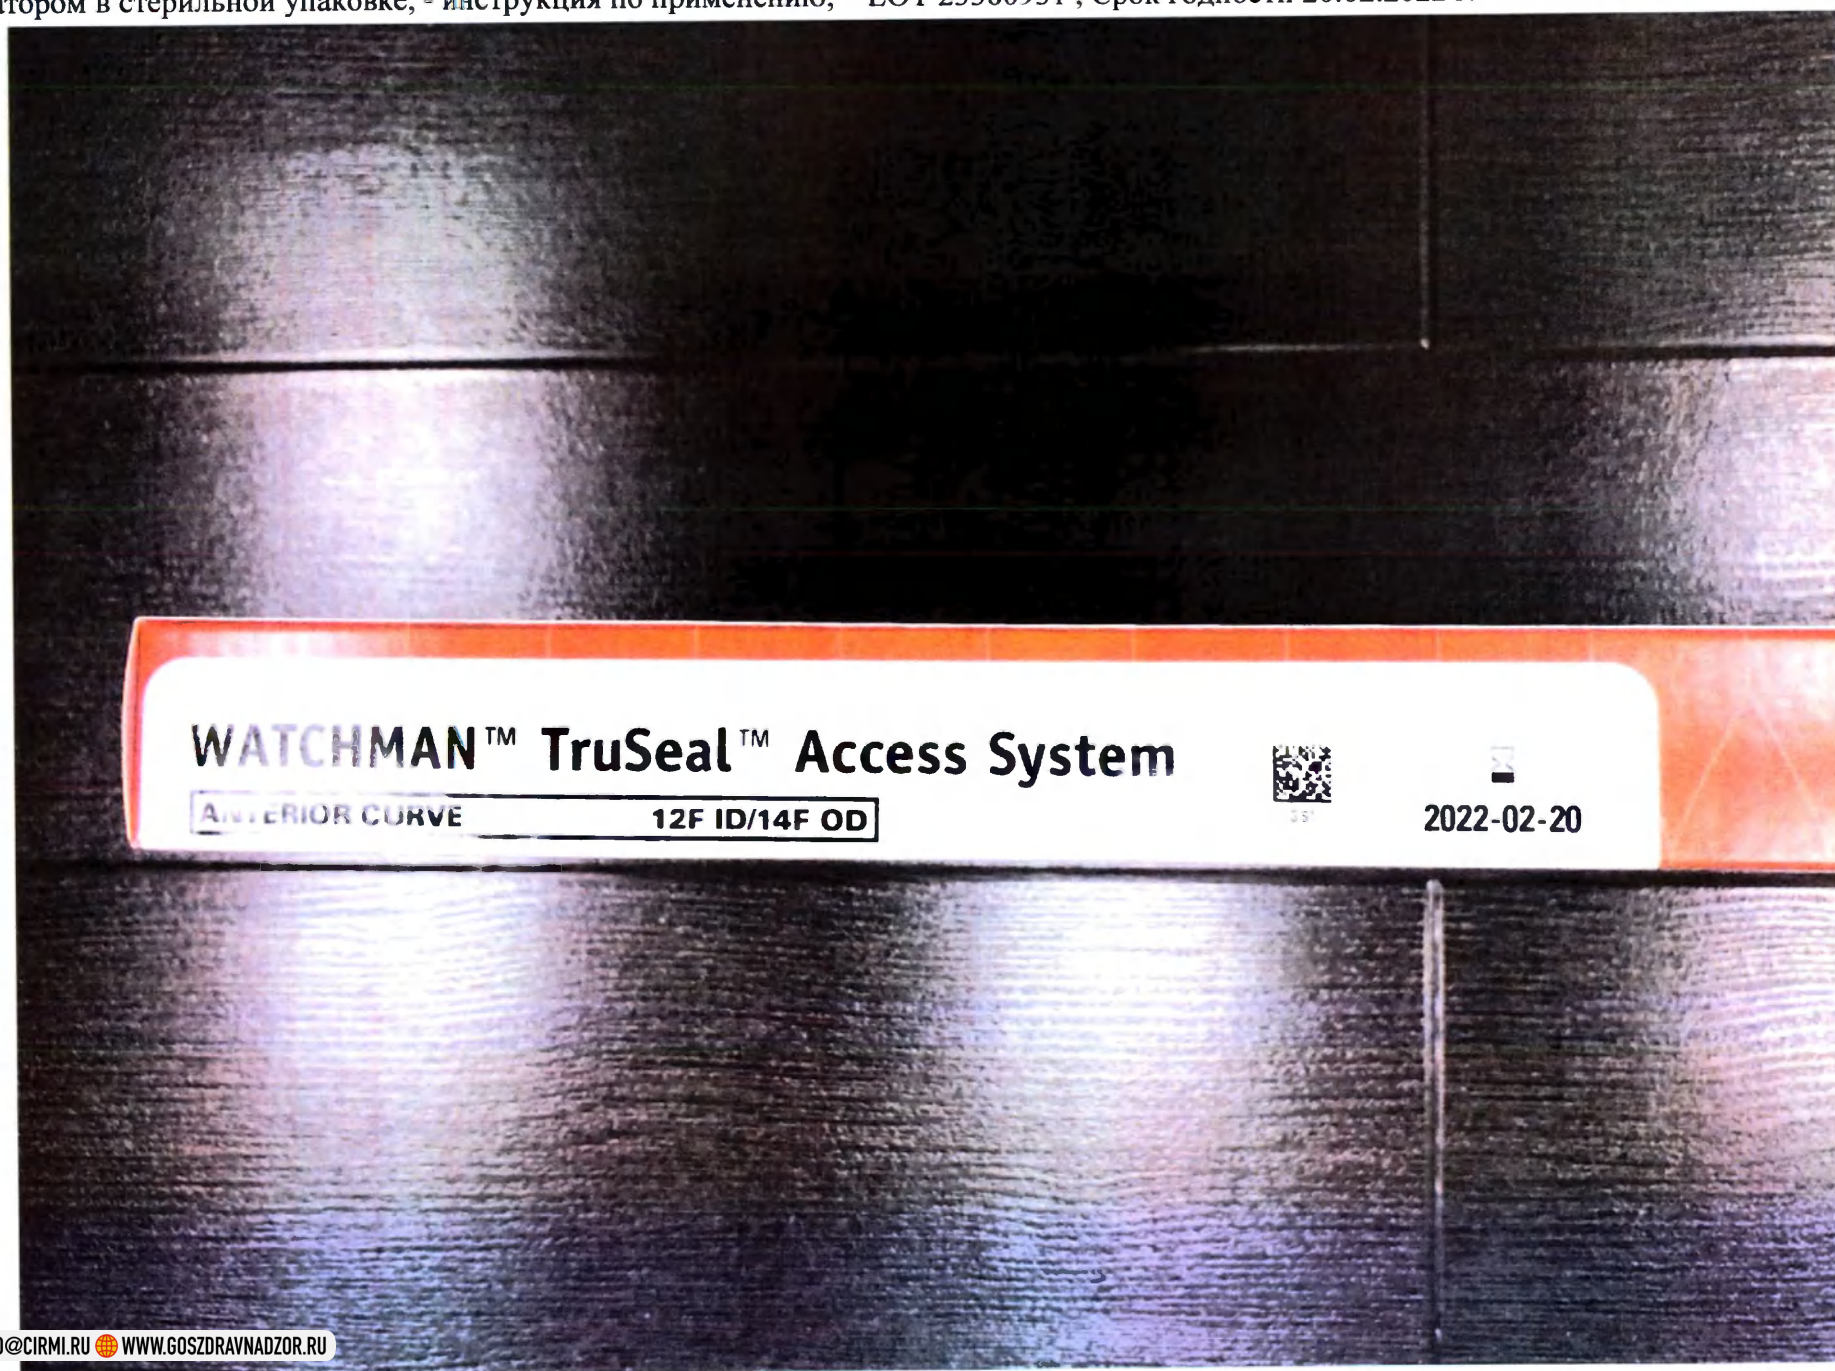

Этикетка отдельной коробки (верхняя сторона) системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 3) Система доступа Watchman TruSeal, с передним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, - инструкция по применению; LOT 23380931, Срок годности 20.02.2022 г.

WATCHMAN™ TruSeal™ Access System



GS1


ANTERIOR CURVE

12F ID/14F OD



2022-02-20

Этикетка отдельной коробки (нижняя сторона) системы доступа Watchman TruSeal в варианте исполнения: 3) Система доступа Watchman TruSeal, с передним изгибом, внутренний диаметр 12 F (4,2 мм), наружный диаметр 14 F (4,8 мм), в составе: - интродьюсер доступа с дилататором в стерильной упаковке, - инструкция по применению; LOT 23380931, Срок годности 20.02.2022 г.

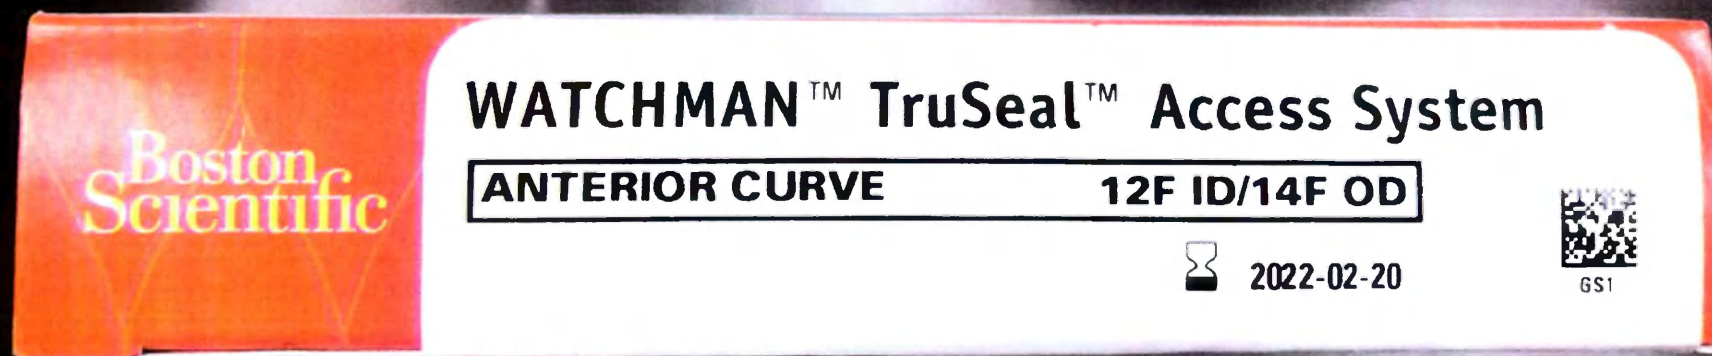



Инструкция по применению системы доступа Watchman TruSeal (обратная сторона)



Генеральный директор
Шевчук Е.В.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 10 листах

