

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Носова Т.А.




2019 г.

Фотографические изображения изделия:

Набор калибраторов для количественного определения общего тироксина (Total Thyroxine (T4 CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.»), Китай

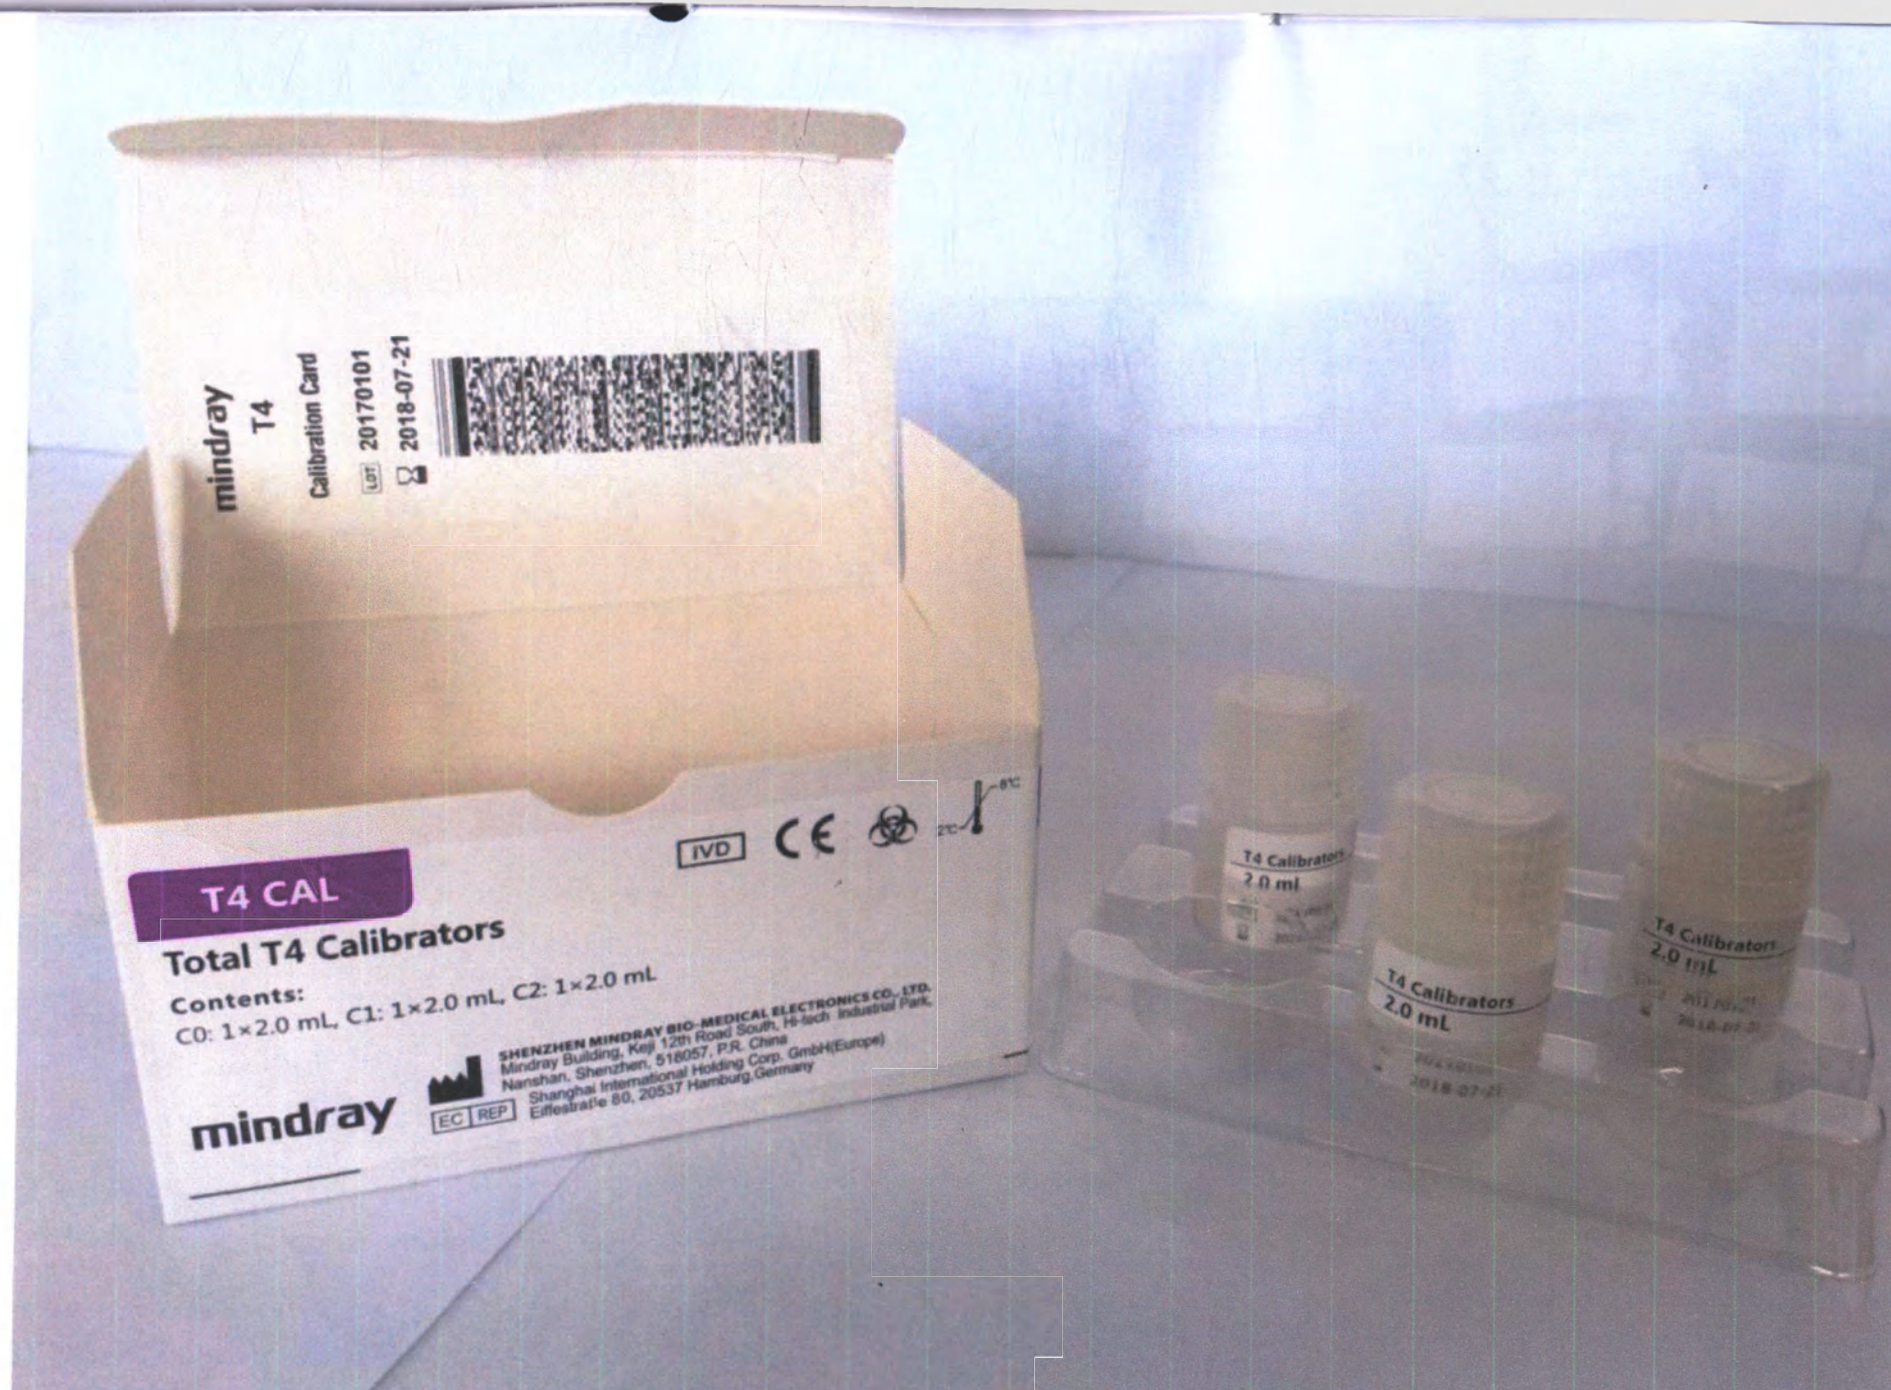

Общий вид медицинского изделия (Набор калибраторов для количественного определения общего тироксина (Total Thyroxine (T4 CAL))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 2 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова Т.А.
М.П.



11