


Спирали эмболизационные для сосудистой эмболизации

Варианты исполнения:

DCS-11-2-2-HL-SPIRAL; DCS-11-2-4-HL-SPIRAL; DCS-11-3-4-HL-SPIRAL; DCS-11-3-6-HL-SPIRAL; DCS-11-4-12-HL-SPIRAL; DCS-11-4-5-HL-SPIRAL; DCS-11-4-8-HL-SPIRAL; DCS-11-5-10-HL-SPIRAL; DCS-11-5-15-HL-SPIRAL; DCS-11-5-6-HL-SPIRAL; DCS-11-6-12-HL-SPIRAL; DCS-11-6-20-HL-SPIRAL; DCS-18-10-15-HL-SPIRAL; DCS-18-10-30-HL-SPIRAL; DCS-18-12-20-HL-SPIRAL; DCS-18-12-30-HL-SPIRAL; DCS-18-4-12-HL-SPIRAL; DCS-18-4-6-HL-SPIRAL; DCS-18-6-10-HL-SPIRAL; DCS-18-6-20-HL-SPIRAL; DCS-18-8-10-HL-SPIRAL; DCS-18-8-20-HL-SPIRAL; DCS-18-8-30-HL-SPIRAL; DCS-11-6-8-HL-SPIRAL; DCS-18-8/3-14-HL-TORNADO; DCS-18S-10-20-HL-SPIRAL; DCS-18S-14-30-HL-SPIRAL; DCS-18S-16-50-HL-SPIRAL; DCS-18S-18-50-HL-SPIRAL; DCS-18S-20-50-HL-SPIRAL; DCS-18S-3-6-HL-SPIRAL; DCS-18S-3-9-HL-SPIRAL; DCS-18S-4-10-HL-SPIRAL; DCS-18S-4-5-HL-SPIRAL; DCS-18S-5-12-HL-SPIRAL; DCS-18S-5-7-HL-SPIRAL; DCS-18S-6-15-HL-SPIRAL; DCS-18S-6-8-HL-SPIRAL; DCS-18S-8-10-HL-SPIRAL; DCS-18S-8-20-HL-SPIRAL; DCS-18SF-10-15-HL-SPIRAL; DCS-18SF-10-20-HL-SPIRAL; DCS-18SF-10-30-HL-SPIRAL; DCS-18SF-12-30-HL-SPIRAL; DCS-18SF-14-30-HL-SPIRAL; DCS-18SF-16-30-HL-SPIRAL; DCS-18SF-18-30-HL-SPIRAL; DCS-18SF-20-30-HL-SPIRAL; DCS-18SF-3-6-HL-SPIRAL; DCS-18SF-3-9-HL-SPIRAL; DCS-18SF-4-10-HL-SPIRAL; DCS-18SF-4-6-HL-SPIRAL; DCS-18SF-5-12-HL-SPIRAL; DCS-18SF-5-7-HL-SPIRAL; DCS-18SF-6-10-HL-SPIRAL; DCS-18SF-6-15-HL-SPIRAL; DCS-18SF-8-10-HL-SPIRAL; DCS-18SF-8-20-HL-SPIRAL; DCS-18SF-8-30-HL-SPIRAL

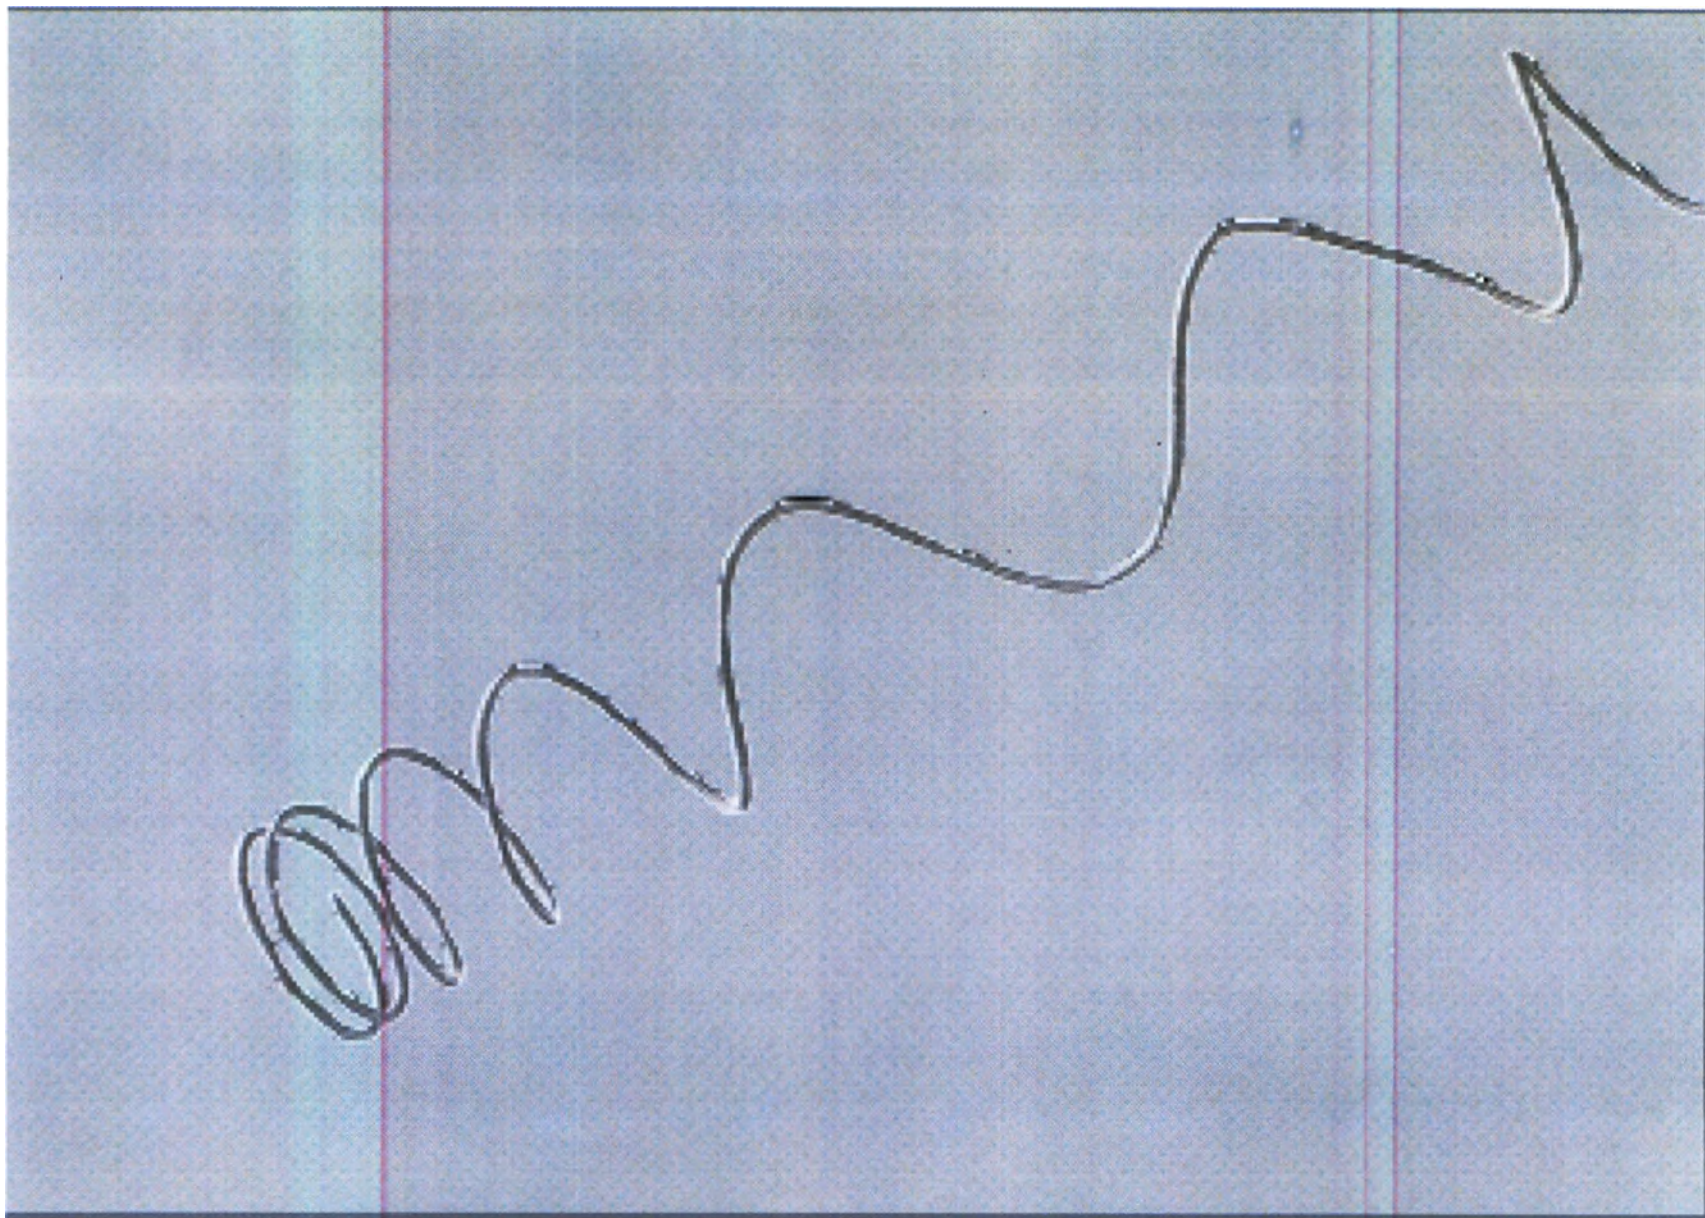

DETACH™


COOK MEDICAL

Detach-18®

Spiral Soft Platinum Coil Hydrophilic Lock

REF DCS-18S-5-7-HL-SPIRAL

REF G33313



Ref: 0010



©2010 Cook Medical
Lombard, IL 60148
Bioscience Division
Cook Medical
www.cookmedical.com



2797



COOK®

PEEL HERE

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Спирали эмболизационные для сосудистой эмболизации

Варианты исполнения: DCS-11-4-10-HL-J; DCS-11-4-15-HL-J; DCS-11-4-20-HL-J; DCS-11-4-30-HL-J; DCS-11-6-15-HL-J; DCS-11-6-20-HL-J; DCS-11-6-30-HL-J; DCS-11-8-15-HL-J; DCS-11-8-30-HL-J; DCS-18-10-30-HL-J; DCS-18-12-30-HL-J; DCS-18-12-50-HL-J; DCS-18-20-50-HL-J; DCS-18-6-20-HL-J; DCS-18-6-30-HL-J; DCS-18-6-30-HL-MCJ; DCS-18-8-20-HL-J; DCS-18-8-30-HL-J; DCS-18S-10-50-6HL-J; DCS-18S-15-50-HL-J; DCS-18S-4-15-HL-J; DCS-18S-4-25-HL-J; DCS-18S-4-50-HL-J; DCS-18S-6-15-HL-J; DCS-18S-6-25-HL-J; DCS-18S-6-50-HL-J; DCS-18S-8-15-HL-J; DCS-18S-8-25-HL-J; DCS-18S-8-50-HL-J; DCS-11-ANG-3-HL-J; DCS-11-ANG-6-HL-J; DCS-11F-4-10-HL-J; DCS-11F-4-15-HL-J; DCS-11F-4-20-HL-J; DCS-11F-6-15-HL-J; DCS-11F-6-20-HL-J; DCS-11F-8-15-HL-J; DCS-11F-8-25-HL-J

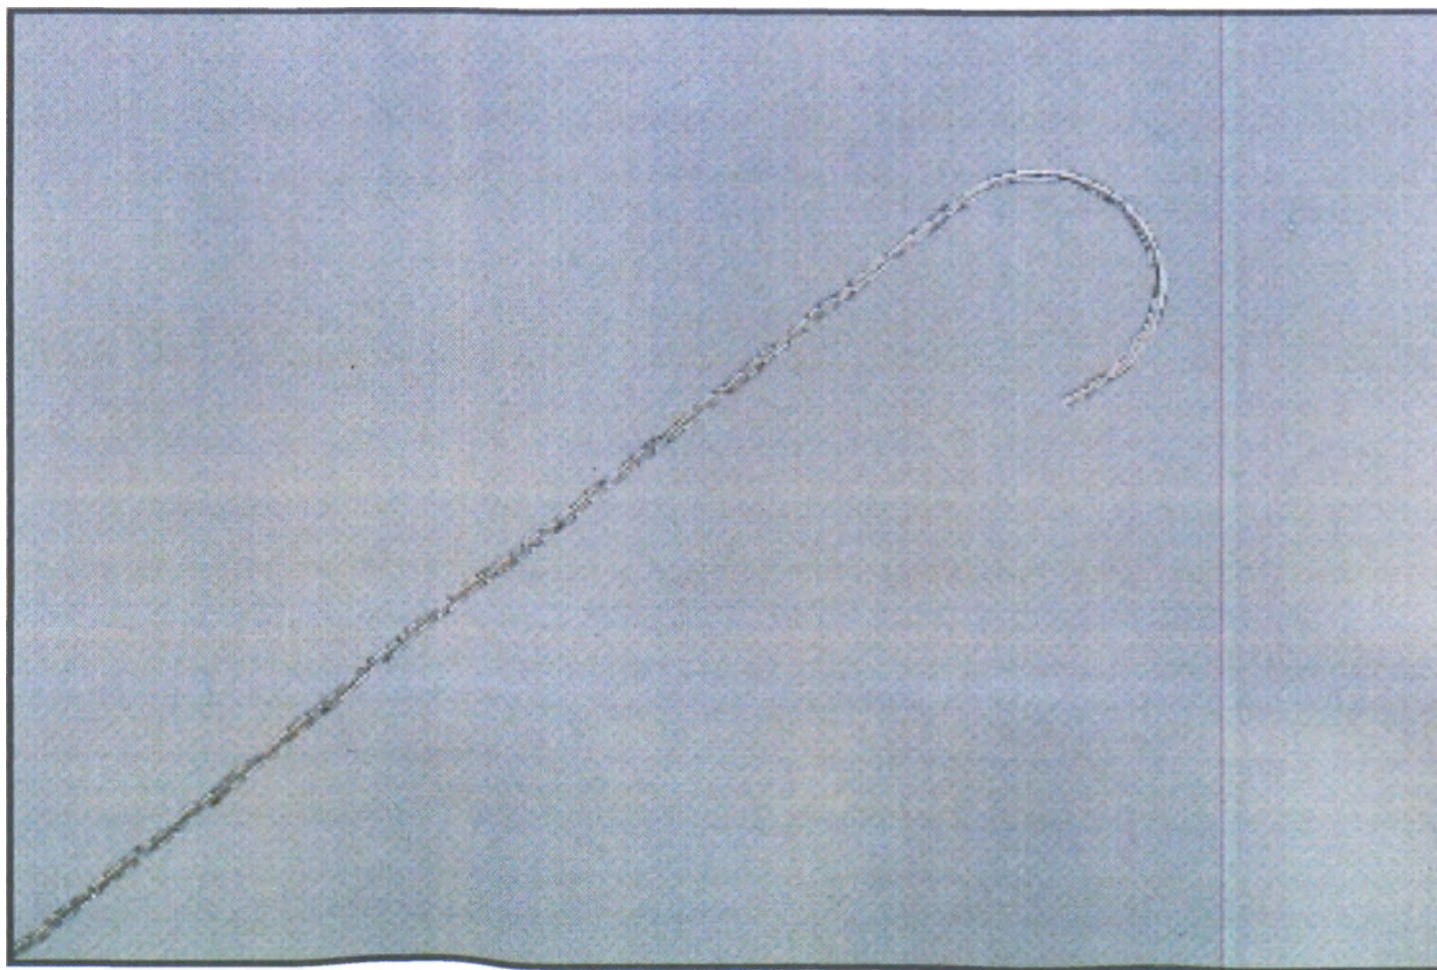

DETACH™


COOK MEDICAL

Detach-11™

Single-Spiral Platinum J-Coil® Hydrophilic Lock

REF DCS-11-8-15-HL-J

REF



REF DCS-11-8-15-HL-J
REF
www.cookmedical.com



www.cookmedical.com



COOK®

PEEL HERE

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Спирали эмболизационные для сосудистой эмболизации

Варианты исполнения: DCS-18SF-10-25-HL-J; DCS-18SF-10-30-HL-J; DCS-18SF-12-30-HL-J; DCS-18SF-4-15-HL-J; DCS-18SF-6-15-HL-J; DCS-18SF-8-15-HL-J

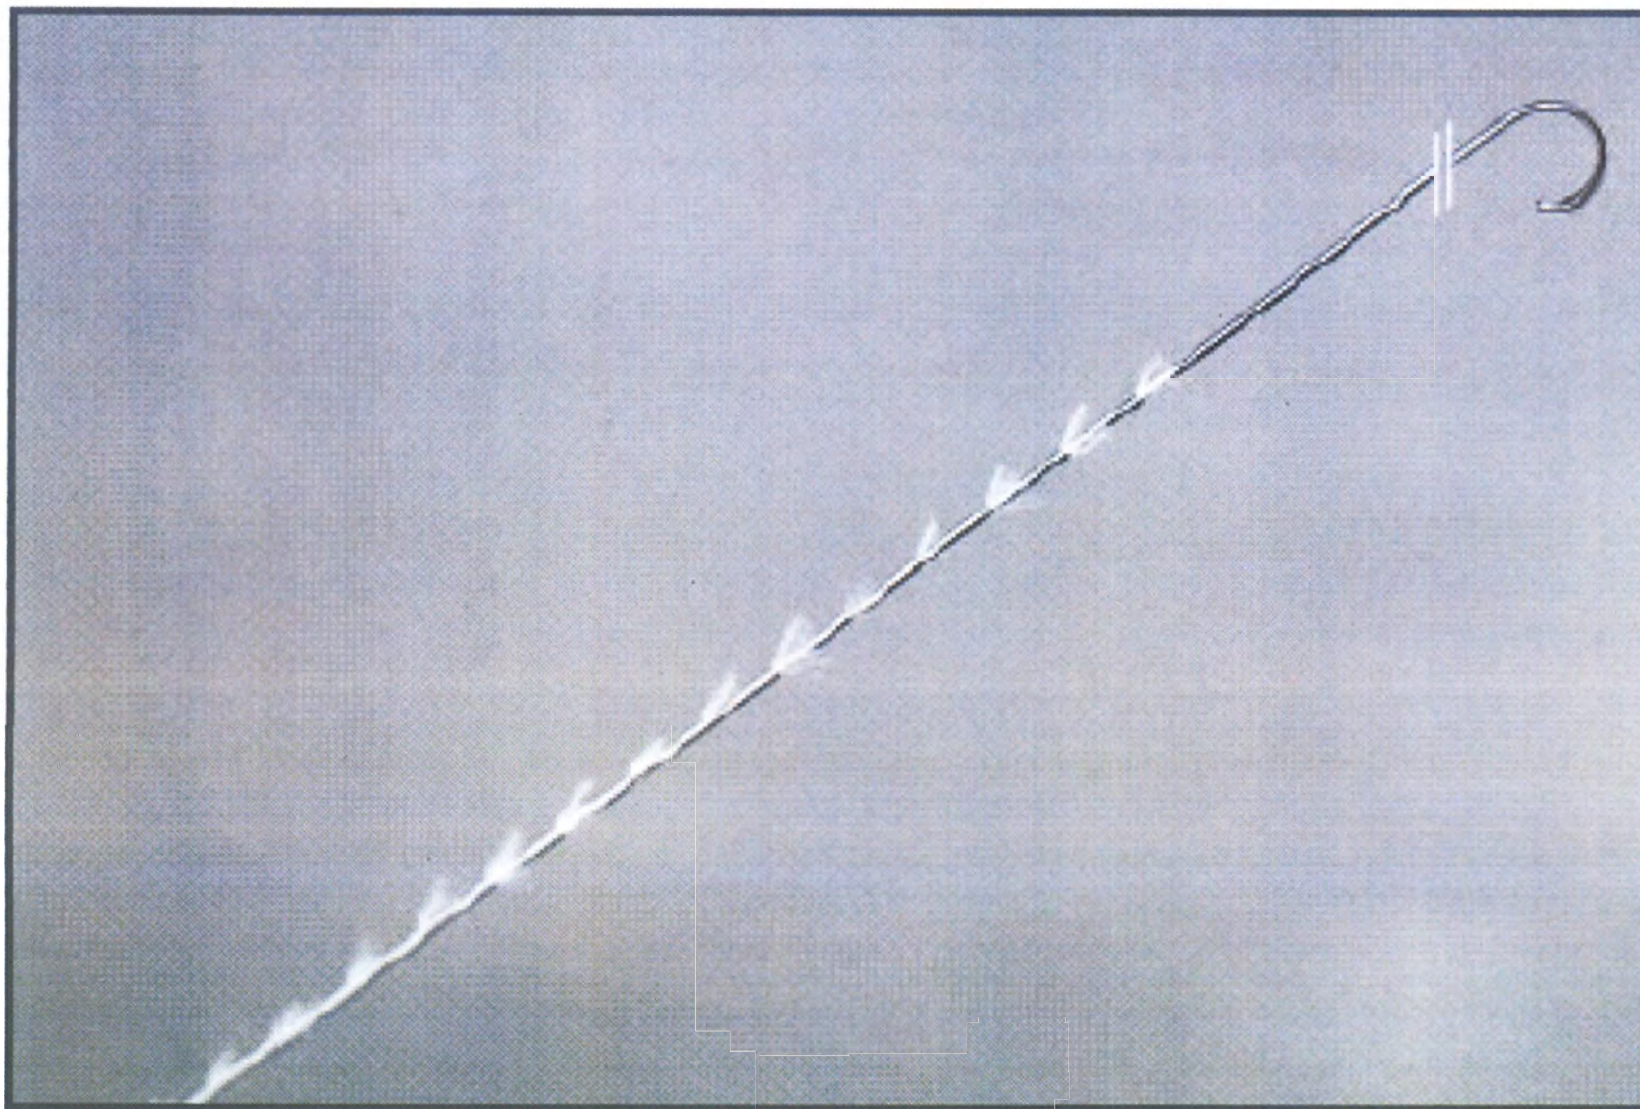

Single-Spiral Soft Platinum J-Coil® Hydrophilic Lock with Fibers

NEW



424



1

FILE NO.

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Спирали эмболизационные для сосудистой эмболизации

Варианты исполнения: DCS-18-10-30-HL-MCJ; DCS-18-15-30-HL-MCJ; DCS-18-8-30-HL-MCJ; DCS-18S-10-25-HL-MCJ; DCS-18S-10-30-HL-MCJ; DCS-18S-6-15-HL-MCJ; DCS-18S-8-20-HL-MCJ; DCS-18SF-10-25-HL-MCJ; DCS-18SF-6-15-HL-MCJ; DCS-18SF-8-25-HL-MCJ; DCS-18SF-6-25-HL-MCJ; DCS-18SF-8-15-HL-MCJ; DCS-18SF-8-25-HL-J; DCS-11F-4-15-HL-MCJ; DCS-11F-4-20-HL-MCJ; DCS-11F-6-15-HL-MCJ; DCS-11F-6-20-HL-MCJ

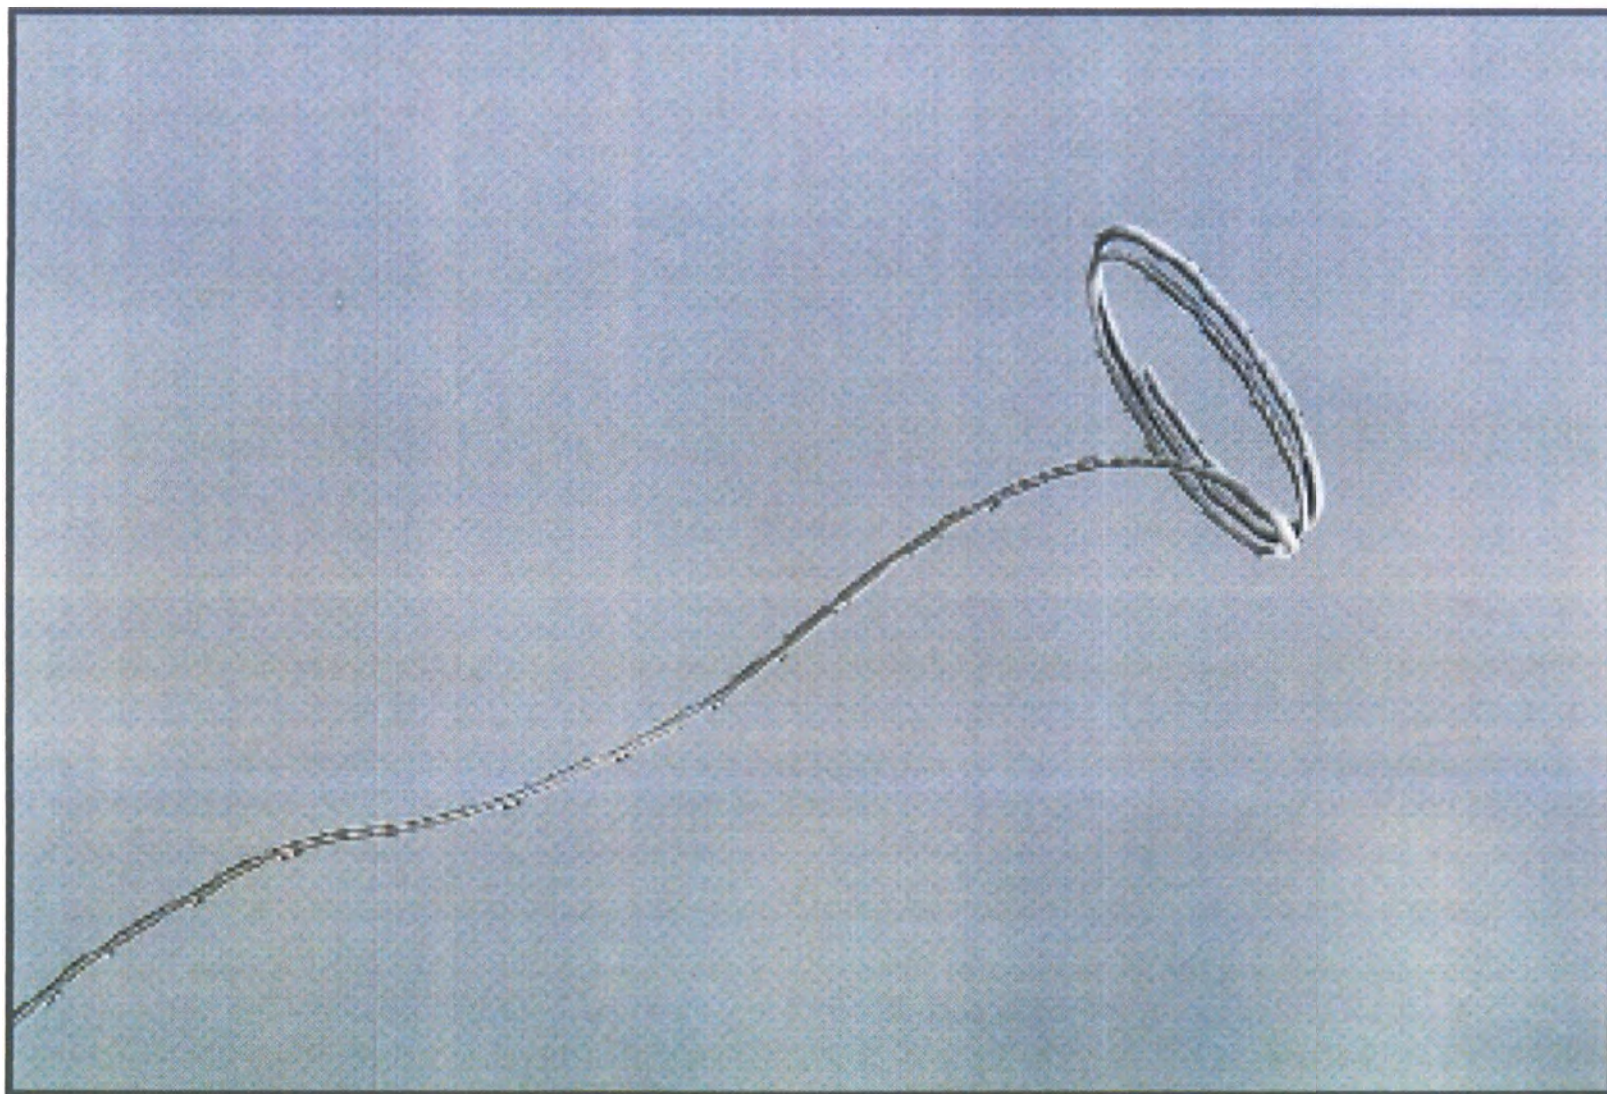

Multi-Spiral Soft Platinum J-Coil® Hydrophilic Lock

W



1997



10

PUBLISHED BY

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортёр ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Спиральи эмболизационные для сосудистой эмболизации

Варианты исполнения: IMWCE-3-PDA3; IMWCE-3-PDA4; IMWCE-3-PDA5; IMWCE-5-PDA3; IMWCE-5-PDA4; IMWCE-5-PDA5; IMWCE-6.5-PDA3; IMWCE-6.5-PDA4; IMWCE-6.5-PDA5; IMWCE-8-PDA3; IMWCE-8-PDA4; IMWCE-8-PDA5;

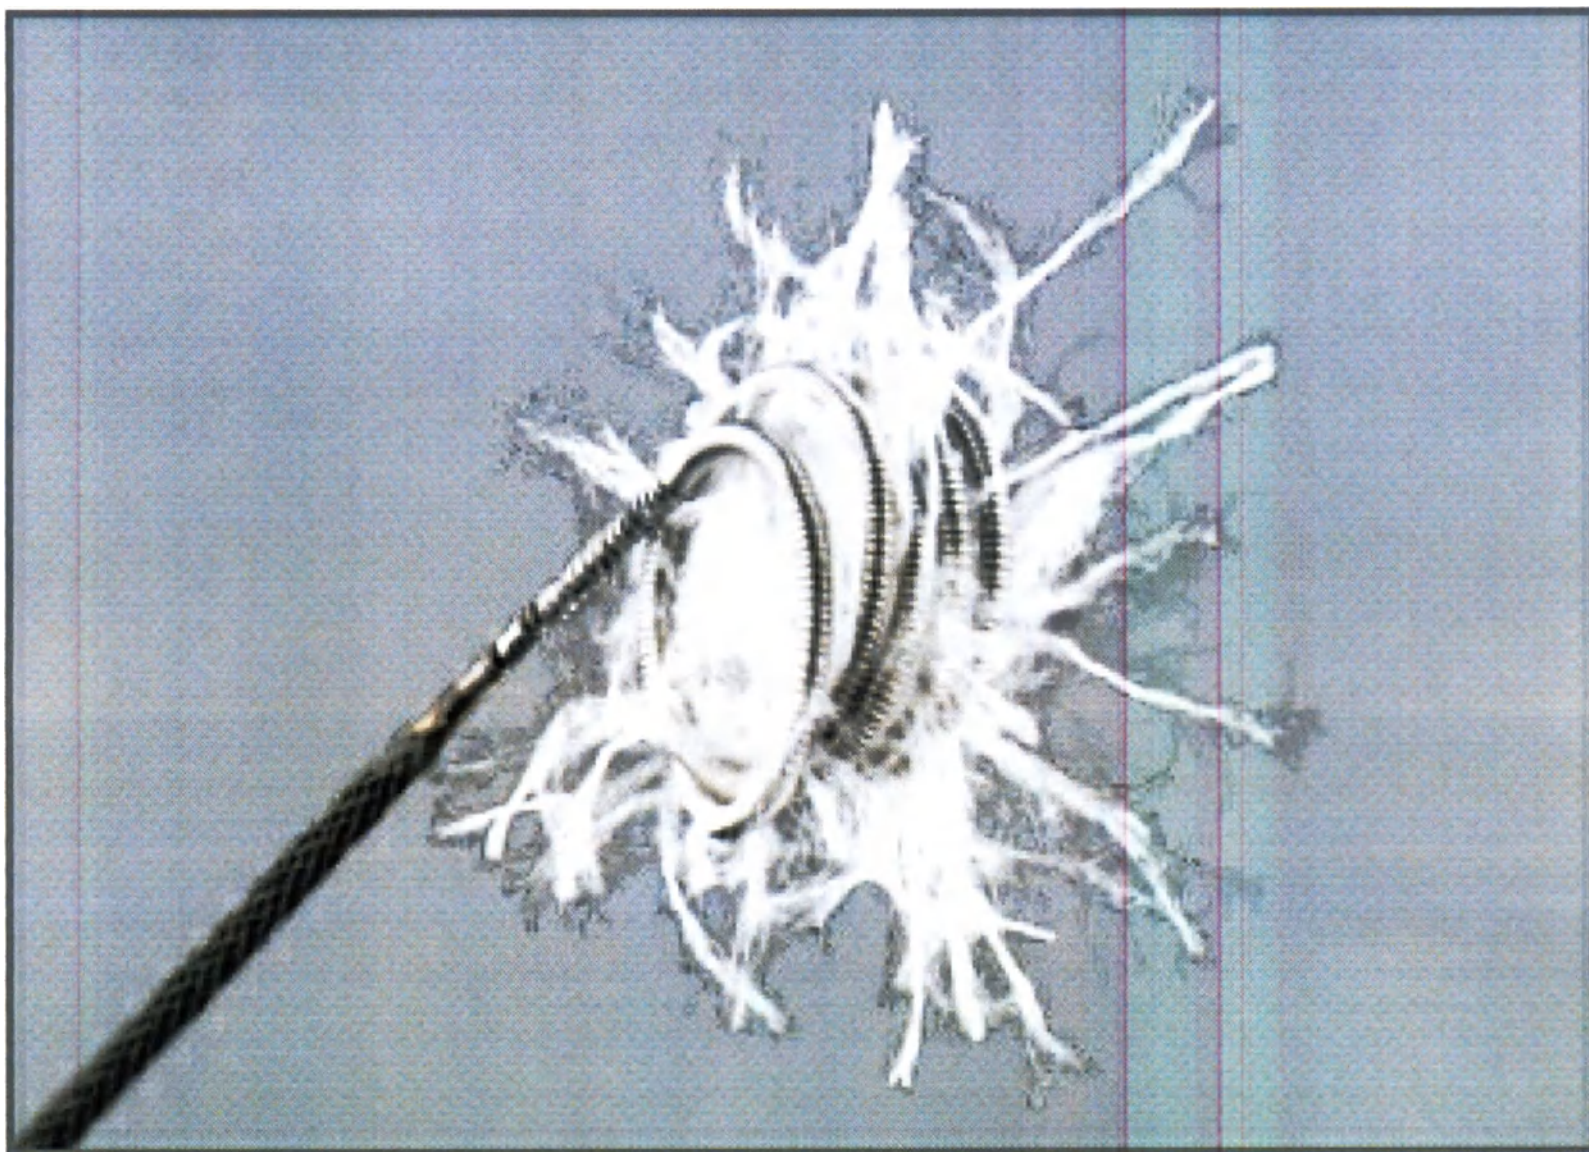



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Спиральи эмболизационные для сосудистой эмболизации

Варианты исполнения: MWCE-18S-1.2-2-A; MWCE-18S-1.8-3-A; MWCE-18S-2.0-5-B; MWCE-18S-2.4-4-A; MWCE-18S-2.6-3-C; MWCE-18S-3.0-7-B; MWCE-18S-3.5-4-C; MWCE-18S-4.2-10-B; MWCE-18S-5.2-12-B;

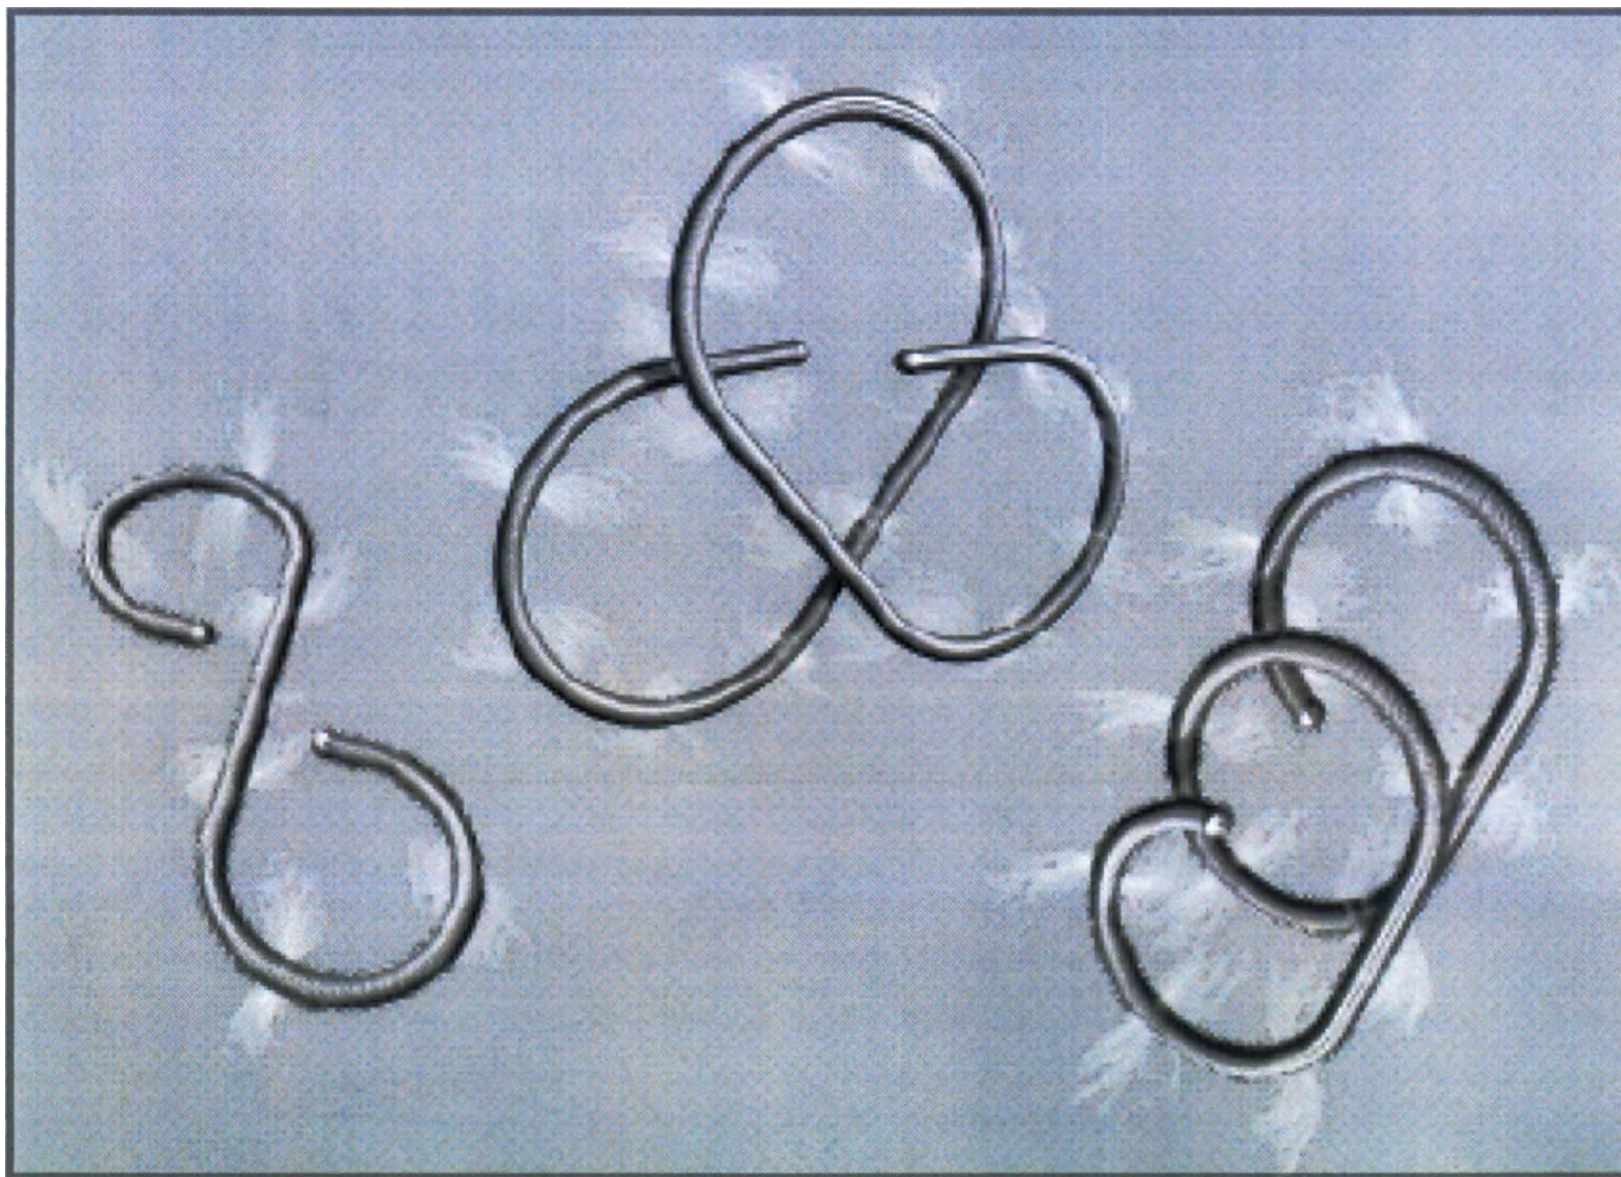



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Спирали эмболизационные для сосудистой эмболизации

Варианты исполнения: MWCE-18S-0.5-0-HILAL; MWCE-18S-0.7-0-HILAL; MWCE-18S-1.0-0-HILAL; MWCE-18S-1.0-3-HILAL; MWCE-18S-1.5-0-HILAL; MWCE-18S-1.5-5-HILAL; MWCE-18S-2.0-2-HILAL; MWCE-18S-2.0-4-HILAL; MWCE-18S-2.1-7-HILAL; MWCE-18S-3.0-10-HILAL; MWCE-18S-3.0-3-HILAL; MWCE-18S-3.0-4-HILAL; MWCE-18S-4.0-6-HILAL; MWCE-18S-4.0-7-HILAL; MWCE-18S-6.0-5-HILAL; MWCE-18S-6.0-7-HILAL; MWCE-18-0.5-0-HILAL; MWCE-18-0.7-0-HILAL; MWCE-18-1.0-0-HILAL; MWCE-18-1.0-2-HILAL; MWCE-18-1.0-3-HILAL; MWCE-18-1.5-0-HILAL; MWCE-18-1.5-5-HILAL; MWCE-18-2.0-2-HILAL; MWCE-18-2.0-3-HILAL; MWCE-18-2.0-4-HILAL; MWCE-18-2.1-7-HILAL; MWCE-18-3.0-10-HILAL; MWCE-18-3.0-3-HILAL; MWCE-18-3.0-4-HILAL; MWCE-18-4.0-6-HILAL; MWCE-18-4.0-7-HILAL; MWCE-18-6.0-10-HILAL; MWCE-18-6.0-5-HILAL; MWCE-18-6.0-7-HILAL

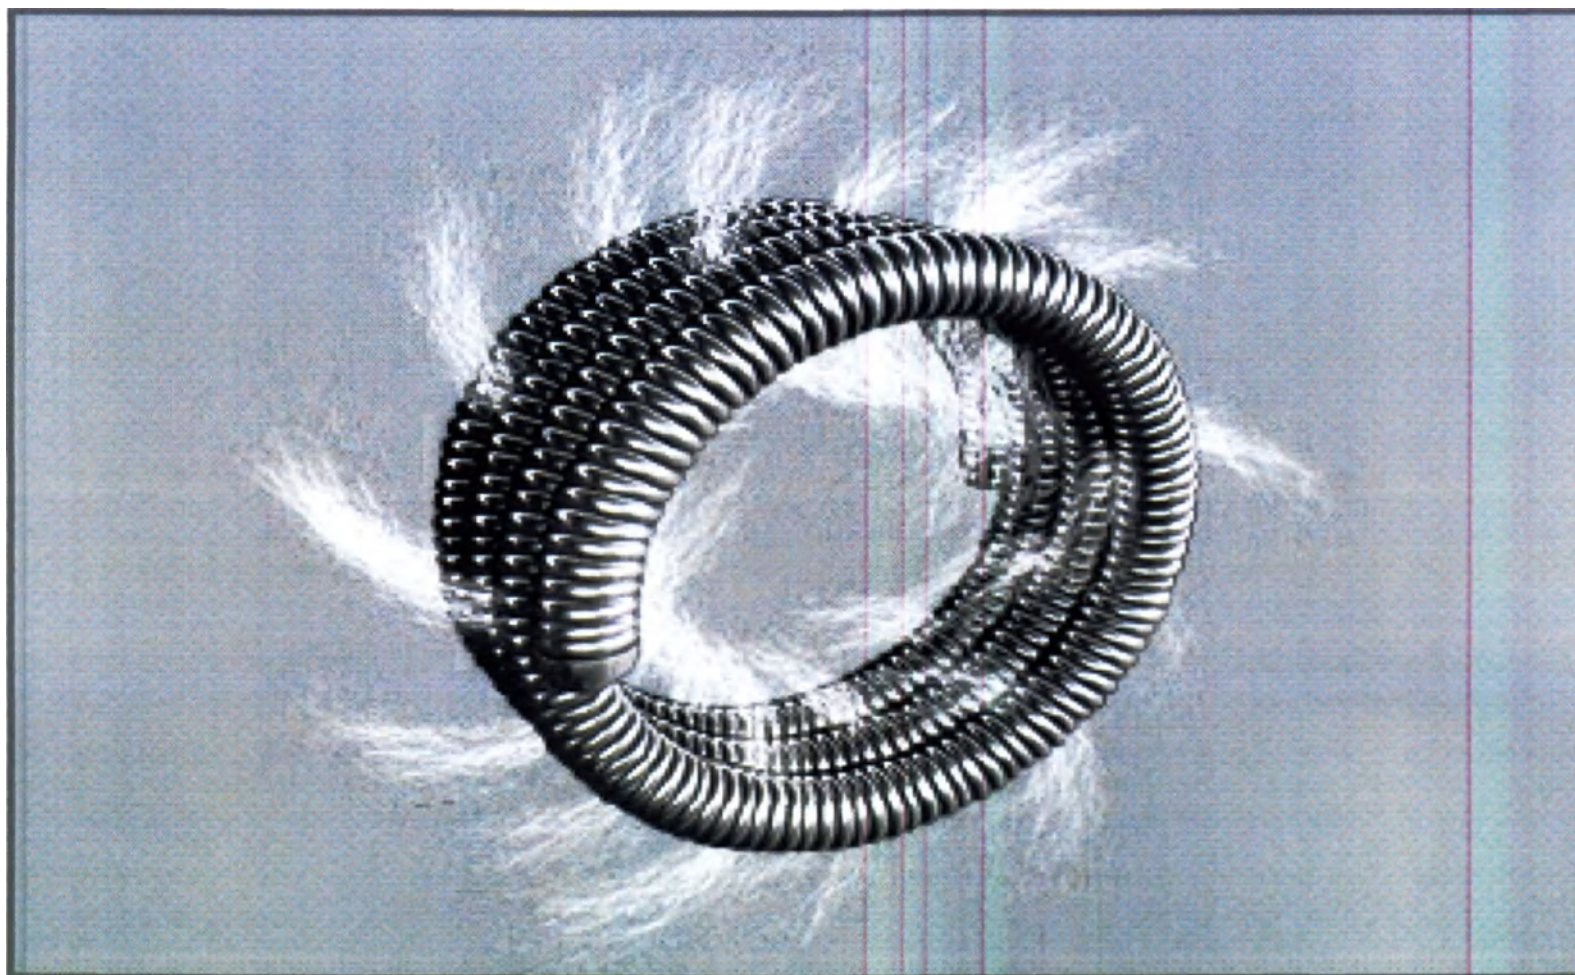



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Спирали эмболизационные для сосудистой эмболизации

Варианты исполнения: IMWCE-25-1.2-2; IMWCE-25-2.5-2; IMWCE-25-2-2; IMWCE-25-2-3; IMWCE-25-3-2; IMWCE-25-3-3; IMWCE-25-3-5; IMWCE-25-4-3; IMWCE-25-5-5; IMWCE-25-5-8; IMWCE-35-1.5-3; IMWCE-35-1.5-5; IMWCE-35-10-10; IMWCE-35-10-12; IMWCE-35-10-15; IMWCE-35-10-20; IMWCE-35-10-4; IMWCE-35-10-5; IMWCE-35-10-6; IMWCE-35-10-8; IMWCE-35-1-2; IMWCE-35-12-10; IMWCE-35-12-5; IMWCE-35-12-8; IMWCE-35-1-3; IMWCE-35-14-12; IMWCE-35-14-3; IMWCE-35-14-5; IMWCE-35-14-6; IMWCE-35-14-8; IMWCE-35-1-5; IMWCE-35-15-10; IMWCE-35-15-12; IMWCE-35-15-15; IMWCE-35-15-20; IMWCE-35-15-5; IMWCE-35-2.5-5; IMWCE-35-20-10; IMWCE-35-20-15; IMWCE-35-20-20; IMWCE-35-2-2; IMWCE-35-2-3; IMWCE-35-2-4; IMWCE-35-2-5; IMWCE-35-2-8; IMWCE-35-3-10; IMWCE-35-3-2; IMWCE-35-3-3; IMWCE-35-3-4; IMWCE-35-3-5; IMWCE-35-3-6; IMWCE-35-3-7; IMWCE-35-3-8; IMWCE-35-4-2; IMWCE-35-4-3; IMWCE-35-4-4; IMWCE-35-4-5; IMWCE-35-4-6; IMWCE-35-4-7; IMWCE-35-4-8; IMWCE-35-5-10; IMWCE-35-5-12; IMWCE-35-5-15; IMWCE-35-5-2; IMWCE-35-5-3; IMWCE-35-5-4; IMWCE-35-5-5; IMWCE-35-5-6; IMWCE-35-5-7; IMWCE-35-5-8; IMWCE-35-6-10; IMWCE-35-6-3; IMWCE-35-6-4; IMWCE-35-6-5; IMWCE-35-6-6; IMWCE-35-6-7; IMWCE-35-6-8; IMWCE-35-7-3; IMWCE-35-7-5; IMWCE-35-8-10; IMWCE-35-8-12; IMWCE-35-8-15; IMWCE-35-8-4; IMWCE-35-8-5; IMWCE-35-8-6; IMWCE-35-8-8; IMWCE-38-1.5-3; IMWCE-38-1.5-5; IMWCE-38-10-10; IMWCE-38-10-12; IMWCE-38-10-15; IMWCE-38-10-20; IMWCE-38-10-5; IMWCE-38-10-6; IMWCE-38-10-7; IMWCE-38-10-8; IMWCE-38-1-2; IMWCE-38-12-10; IMWCE-38-12-12; IMWCE-38-12-14; IMWCE-38-12-5; IMWCE-38-12-8; IMWCE-38-1-3; IMWCE-38-13-8; IMWCE-38-15-10; IMWCE-38-15-12; IMWCE-38-15-15; IMWCE-38-15-2; IMWCE-38-15-20; IMWCE-38-15-25; IMWCE-38-15-30; IMWCE-38-15-8; IMWCE-38-16-45; IMWCE-38-2.5-5; IMWCE-38-20-15; IMWCE-38-2-2; IMWCE-38-2-3; IMWCE-38-2-4; IMWCE-38-2-5; IMWCE-38-2-6; IMWCE-38-2-8; IMWCE-38-3-2; IMWCE-38-3-3; IMWCE-38-3-4; IMWCE-38-3-5; IMWCE-38-3-7; IMWCE-38-3-8; IMWCE-38-4-10; IMWCE-38-4-12; IMWCE-38-4-3; IMWCE-38-4-4; IMWCE-38-4-5; IMWCE-38-4-6; IMWCE-38-4-7; IMWCE-38-4-8; IMWCE-38-5-10; IMWCE-38-5-12; IMWCE-38-5-15; IMWCE-38-5-2; IMWCE-38-5-20; IMWCE-38-5-3; IMWCE-38-5-4; IMWCE-38-5-5; IMWCE-38-5-6; IMWCE-38-5-7; IMWCE-38-5-8; IMWCE-38-5-9; IMWCE-38-6-10; IMWCE-38-6-12; IMWCE-38-6-15; IMWCE-38-6-3; IMWCE-38-6-4; IMWCE-38-6-5; IMWCE-38-6-6; IMWCE-38-6-8; IMWCE-38-7-5; IMWCE-38-8-10; IMWCE-38-8-12; IMWCE-38-8-15; IMWCE-38-8-3; IMWCE-38-8-4; IMWCE-38-8-5; IMWCE-38-8-6; IMWCE-38-8-8; IMWCE-38-9-5; MWCE-25-1.2-2; MWCE-25-2.5-2; MWCE-25-2-3; MWCE-25-2-5; MWCE-25-3-2; MWCE-25-3-3; MWCE-25-3-4; MWCE-25-3-5; MWCE-25-4-3; MWCE-25-5-5; MWCE-35-1.2-2; MWCE-35-1.5-2; MWCE-35-10-10; MWCE-35-10-12; MWCE-35-10-15; MWCE-35-10-4; MWCE-35-10-5; MWCE-35-10-8; MWCE-35-1-2; MWCE-35-12-10; MWCE-35-12-5; MWCE-35-1-3; MWCE-35-14-12; MWCE-35-14-5; MWCE-35-14-6; MWCE-35-14-8; MWCE-35-15-10; MWCE-35-15-12; MWCE-35-15-15; MWCE-35-15-20; MWCE-35-2.5-2; MWCE-35-2-2; MWCE-35-2-3; MWCE-35-2-4; MWCE-35-2-5; MWCE-35-2-8; MWCE-35-3-10; MWCE-35-3-2; MWCE-35-3-3; MWCE-35-3-4; MWCE-35-3-5; MWCE-35-3-6; MWCE-35-3-7; MWCE-35-3-8; MWCE-35-4-2; MWCE-35-4-3; MWCE-35-4-4; MWCE-35-4-5; MWCE-35-4-6; MWCE-35-4-7; MWCE-35-4-8; MWCE-35-5-10; MWCE-35-5-12; MWCE-35-5-15; MWCE-35-5-2; MWCE-35-5-3; MWCE-35-5-4; MWCE-35-5-5; MWCE-35-5-6; MWCE-35-5-7; MWCE-35-5-8; MWCE-35-6-10; MWCE-35-6-3; MWCE-35-6-4; MWCE-35-6-5; MWCE-35-6-6; MWCE-35-7-3; MWCE-35-7-5; MWCE-35-8-10; MWCE-35-8-12; MWCE-35-8-15; MWCE-35-8-4; MWCE-35-8-5; MWCE-35-8-6; MWCE-35-8-8; MWCE-38-1.2-2; MWCE-38-10-10; MWCE-38-10-12; MWCE-38-10-15; MWCE-38-10-20; MWCE-38-10-5; MWCE-38-10-6; MWCE-38-10-7; MWCE-38-10-8; MWCE-38-12-10; MWCE-38-12-14; MWCE-38-12-5; MWCE-38-12-8; MWCE-38-1-3; MWCE-38-13-8; MWCE-38-15-10; MWCE-38-15-12; MWCE-38-15-15; MWCE-38-15-2; MWCE-38-15-20; MWCE-38-15-25; MWCE-38-15-30; MWCE-38-15-8; MWCE-38-16-45; MWCE-38-2.5-2; MWCE-38-2-2; MWCE-38-2-3; MWCE-38-2-5; MWCE-38-2-8; MWCE-38-3-2; MWCE-38-3-3; MWCE-38-3-4; MWCE-38-3-5; MWCE-38-3-8; MWCE-38-4-12; MWCE-38-4-3; MWCE-38-4-3-HMC-030398; MWCE-

38-4-4; MWCE-38-4-5; MWCE-38-4-6; MWCE-38-4-7; MWCE-38-5-10; MWCE-38-5-12; MWCE-38-5-15; MWCE-38-5-2; MWCE-38-5-20; MWCE-38-5-3; MWCE-38-5-4; MWCE-38-5-5; MWCE-38-5-6; MWCE-38-5-7; MWCE-38-5-8; MWCE-38-6-5; MWCE-38-6-3; MWCE-38-6-4; MWCE-38-6-4-HMC-030398; MWCE-38-6-5; MWCE-38-6-6; MWCE-38-6-8; MWCE-38-7-5; MWCE-38-8-10; MWCE-38-8-12; MWCE-38-8-15; MWCE-38-8-3; MWCE-38-8-4; MWCE-38-8-5; MWCE-38-8-6; MWCE-38-8-8; MWCE-38-9-5; MWCE-52-10-10; MWCE-52-10-15; MWCE-52-10-6; MWCE-52-10-8; MWCE-52-15-10; MWCE-52-15-12; MWCE-52-15-15; MWCE-52-15-20; MWCE-52-5-5; MWCE-52-5-6; MWCE-52-5-8; MWCE-52-6-5; MWCE-52-6-6; MWCE-52-8-5; MWCE-52-8-6; MWCE-52-8-8

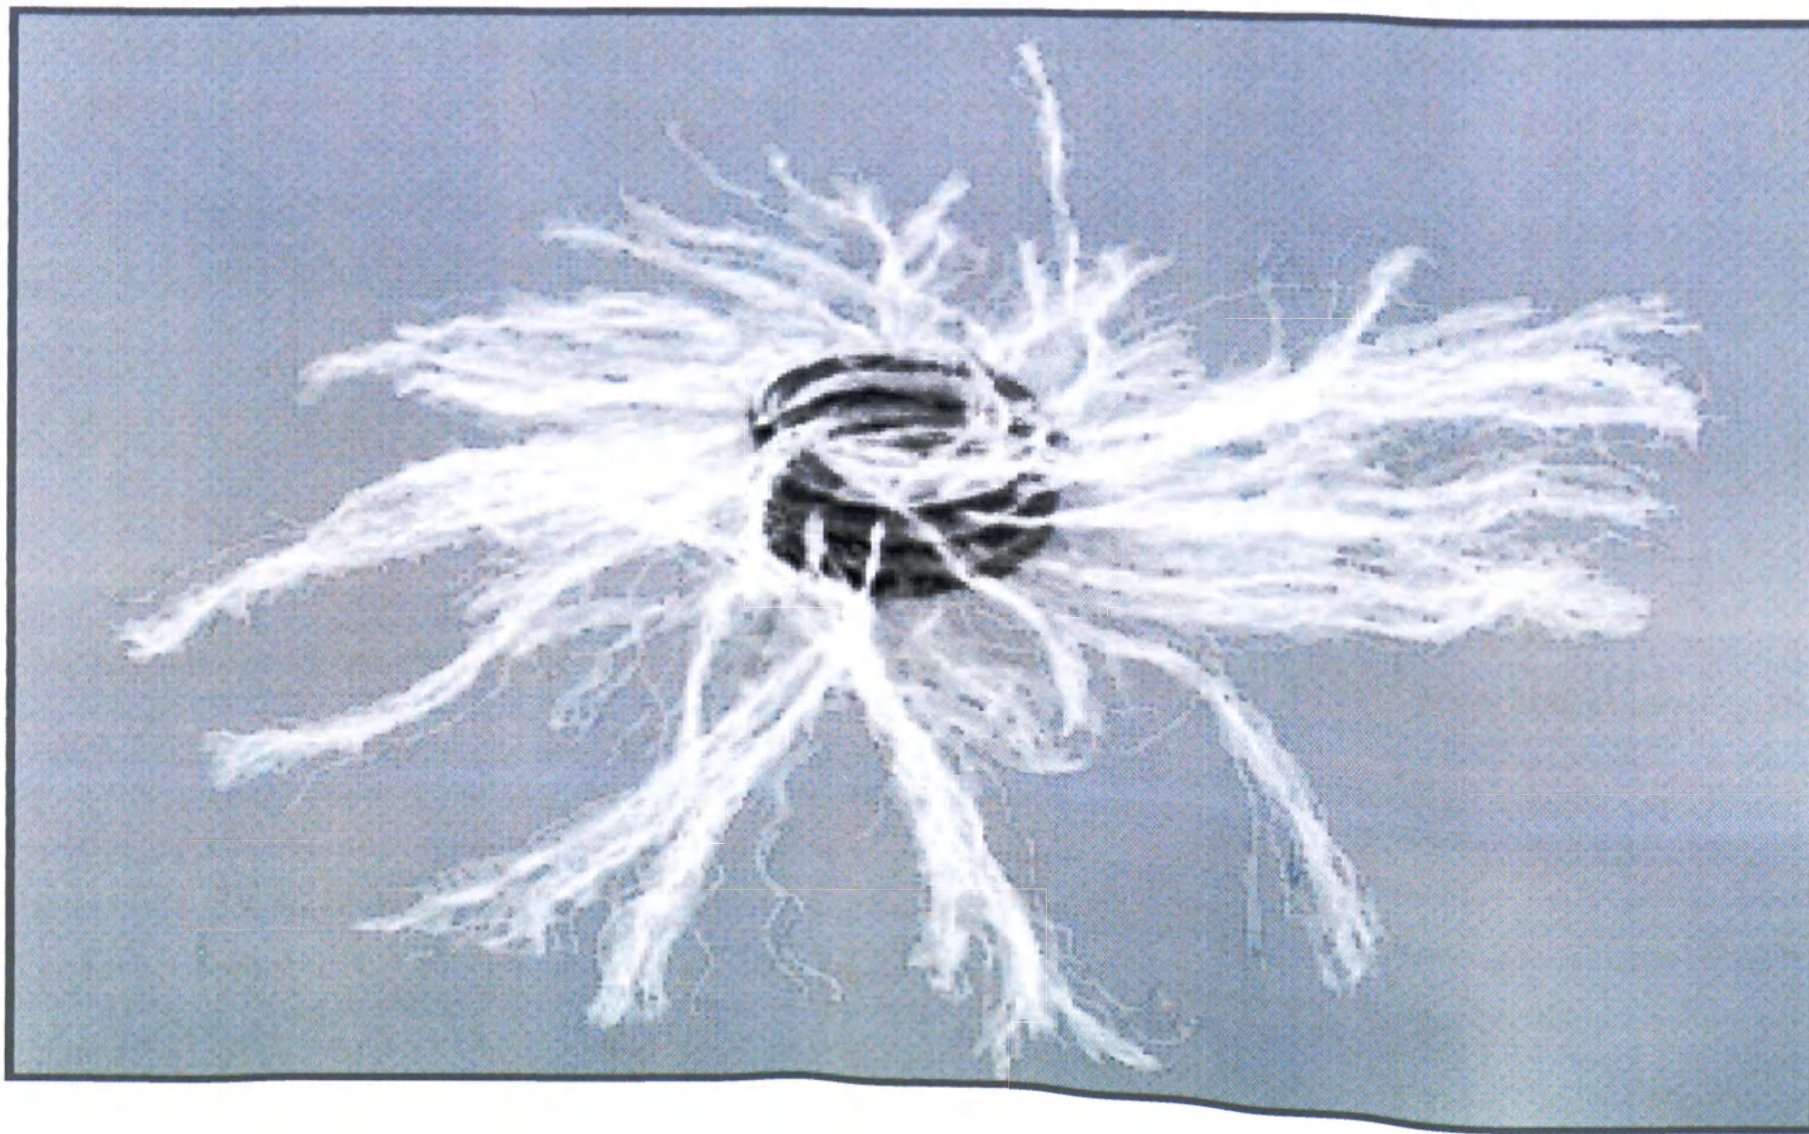



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Спирали эмболизационные для сосудистой эмболизации

Варианты исполнения: MWCE-18-14-10-NESTER; MWCE-18-14-3-NESTER; MWCE-18-14-4-NESTER; MWCE-18-14-6-NESTER; MWCE-18-14-8-NESTER; MWCE-18-3-2-NESTER; MWCE-18-3-3-NESTER; MWCE-18-4-3-NESTER; MWCE-18-5-2-NESTER; MWCE-18-5-3-NESTER; MWCE-18-7-10-NESTER; MWCE-18-7-2-NESTER; MWCE-18-7-3-NESTER; MWCE-18-7-4-NESTER; MWCE-18-7-6-NESTER; MWCE-18-7-8-NESTER; MWCE-35-14-10-NESTER; MWCE-35-14-12-NESTER; MWCE-35-14-14-NESTER; MWCE-35-14-16-NESTER; MWCE-35-14-18-NESTER; MWCE-35-14-20-NESTER; MWCE-35-14-4-NESTER; MWCE-35-14-6-NESTER; MWCE-35-14-8-NESTER; MWCE-35-20-18-NESTER; MWCE-35-20-20-NESTER; MWCE-35-4-4-NESTER; MWCE-35-4-5-NESTER; MWCE-35-6-6-NESTER; MWCE-35-7-10-NESTER; MWCE-35-7-12-NESTER; MWCE-35-7-14-NESTER; MWCE-35-7-16-NESTER; MWCE-35-7-18-NESTER; MWCE-35-7-20-NESTER; MWCE-35-7-4-NESTER; MWCE-35-7-6-NESTER; MWCE-35-7-8-NESTER; MWCE-35-8-8-NESTER; MWCE-38-14-10-NESTER; MWCE-38-14-12-NESTER; MWCE-38-14-14-NESTER; MWCE-38-14-16-NESTER; MWCE-38-14-18-NESTER; MWCE-38-14-20-NESTER; MWCE-38-14-4-NESTER; MWCE-38-14-6-NESTER; MWCE-38-14-8-NESTER; MWCE-38-20-18-NESTER; MWCE-38-20-20-NESTER; MWCE-38-4-4-NESTER; MWCE-38-4-6-NESTER; MWCE-38-6-6-NESTER; MWCE-38-7-10-NESTER; MWCE-38-7-12-NESTER; MWCE-38-7-14-NESTER; MWCE-38-7-16-NESTER; MWCE-38-7-18-NESTER; MWCE-38-7-20-NESTER; MWCE-38-7-4-NESTER; MWCE-38-7-6-NESTER; MWCE-38-7-8-NESTER; MWCE-38-8-8-NESTER;

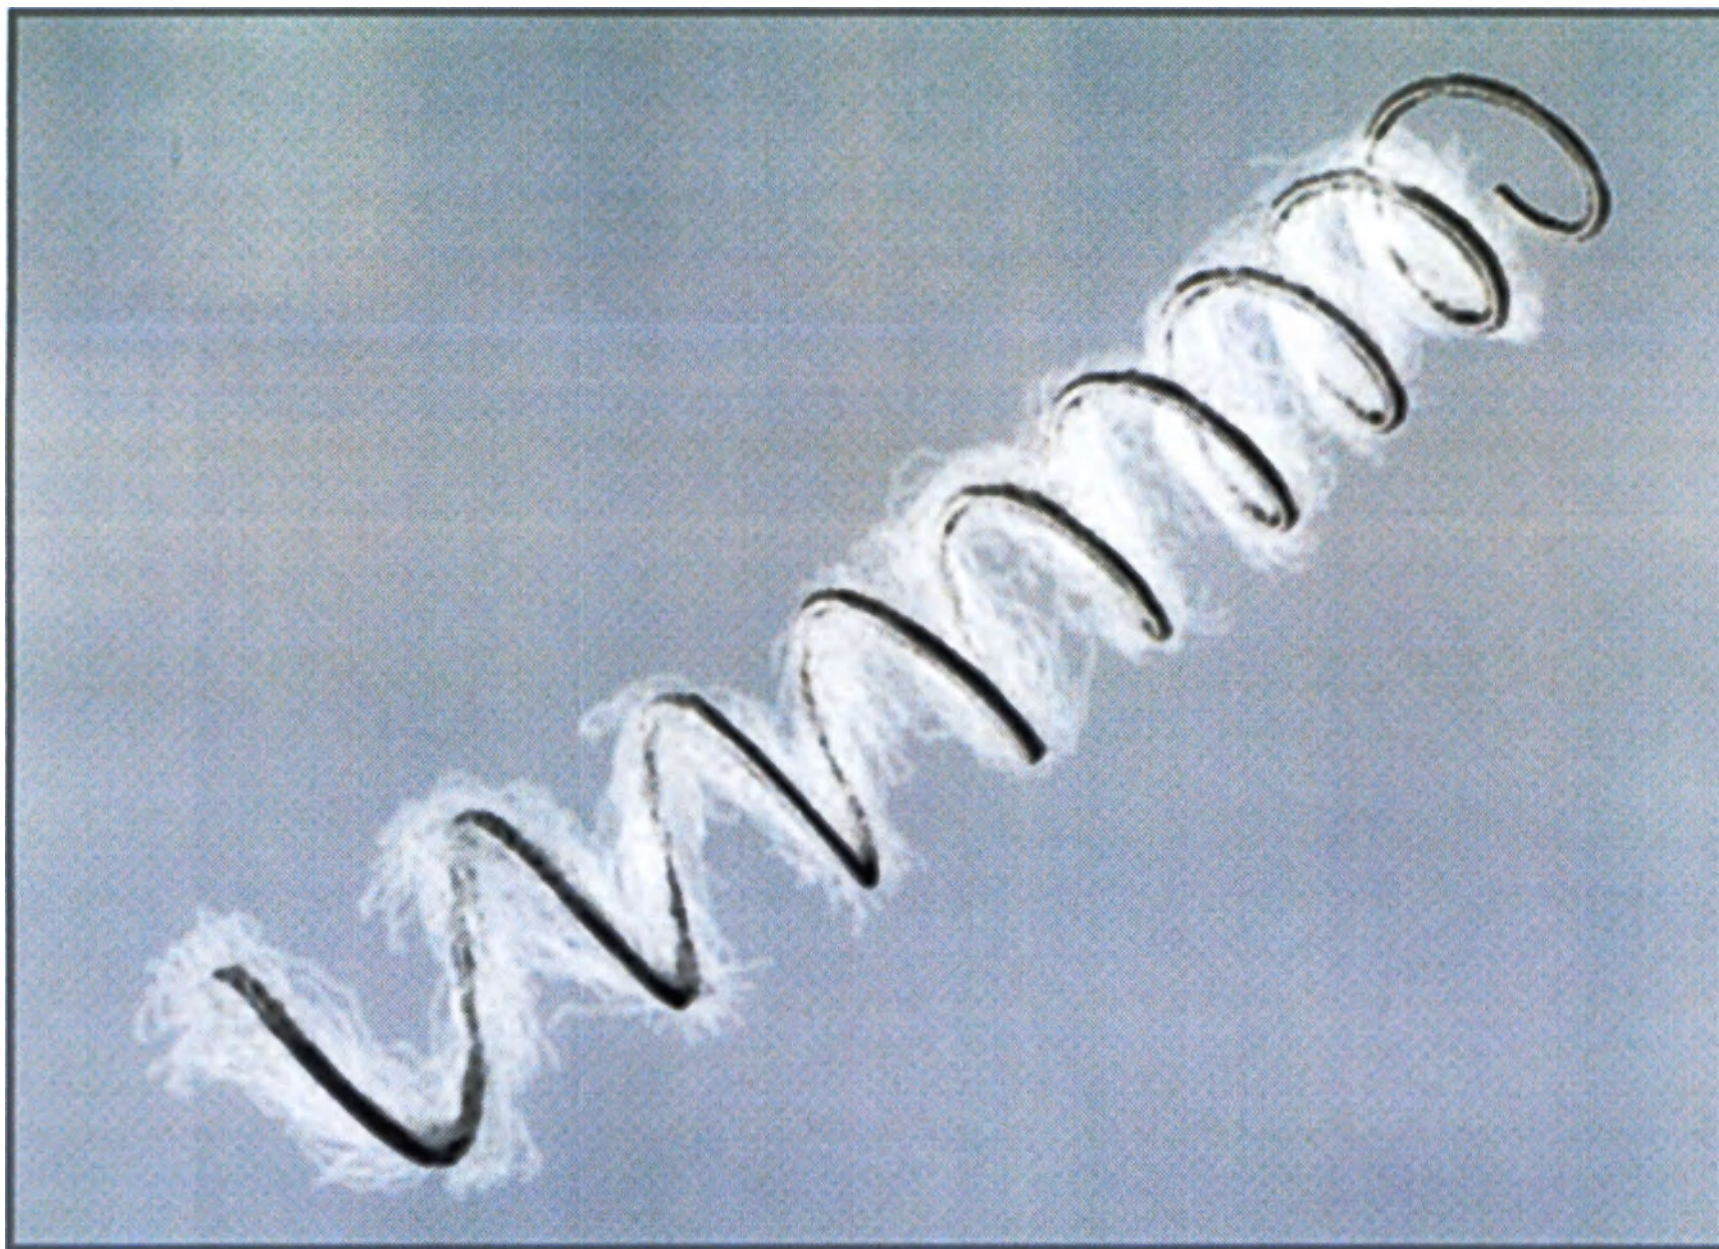



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____





Импортёр ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Спирали эмболизационные для сосудистой эмболизации

Варианты исполнения: MWCE-18S-10/4-TORNADO; MWCE-18S-10/5-TORNADO; MWCE-18S-3/2-TORNADO; MWCE-18S-4/2-TORNADO; MWCE-18S-4/3-TORNADO; MWCE-18S-5/2-TORNADO; MWCE-18S-6/2-TORNADO; MWCE-18S-7/2-TORNADO; MWCE-18S-7/3-TORNADO; MWCE-18S-8/4-TORNADO; MWCE-18S-8/5-TORNADO; MWCE-35-10/3-TORNADO; MWCE-35-10/4-TORNADO; MWCE-35-10/5-TORNADO; MWCE-35-4/3-TORNADO; MWCE-35-5/3-TORNADO; MWCE-35-6/3-TORNADO; MWCE-35-7/3-TORNADO; MWCE-35-8/4-TORNADO; MWCE-35-8/5-TORNADO; MWCE-38-10/3-TORNADO; MWCE-38-10/4-TORNADO; MWCE-38-10/5-TORNADO; MWCE-38-4/3-TORNADO; MWCE-38-5/3-TORNADO; MWCE-38-6/3-TORNADO; MWCE-38-7/3-TORNADO; MWCE-38-8/4-TORNADO; MWCE-38-8/5-TORNADO; MWCE-18S-2/3-TORNADO-LEF; MWCE-18S-2/4-TORNADO-LEF; MWCE-18S-2/5-TORNADO-LEF; MWCE-18S-2/6-TORNADO-LEF; MWCE-18S-2/7-TORNADO-LEF; MWCE-18S-3/7-TORNADO-LEF; MWCE-18S-4/10-TORNADO-LEF; MWCE-18S-4/8-TORNADO-LEF; MWCE-18S-5/10-TORNADO-LEF; MWCE-18S-5/8-TORNADO-LEF; MWCE-35-3/10-TORNADO-LEF; MWCE-35-3/4-TORNADO-LEF; MWCE-35-3/5-TORNADO-LEF; MWCE-35-3/6-TORNADO-LEF; MWCE-35-3/7-TORNADO-LEF; MWCE-35-4/10-TORNADO-LEF; MWCE-35-4/8-TORNADO-LEF; MWCE-35-5/10-TORNADO-LEF; MWCE-35-5/8-TORNADO-LEF; MWCE-38-3/6-TORNADO-LEF; MWCE-38-4/8-TORNADO-LEF; MWCE-38-5/10-TORNADO-LEF;

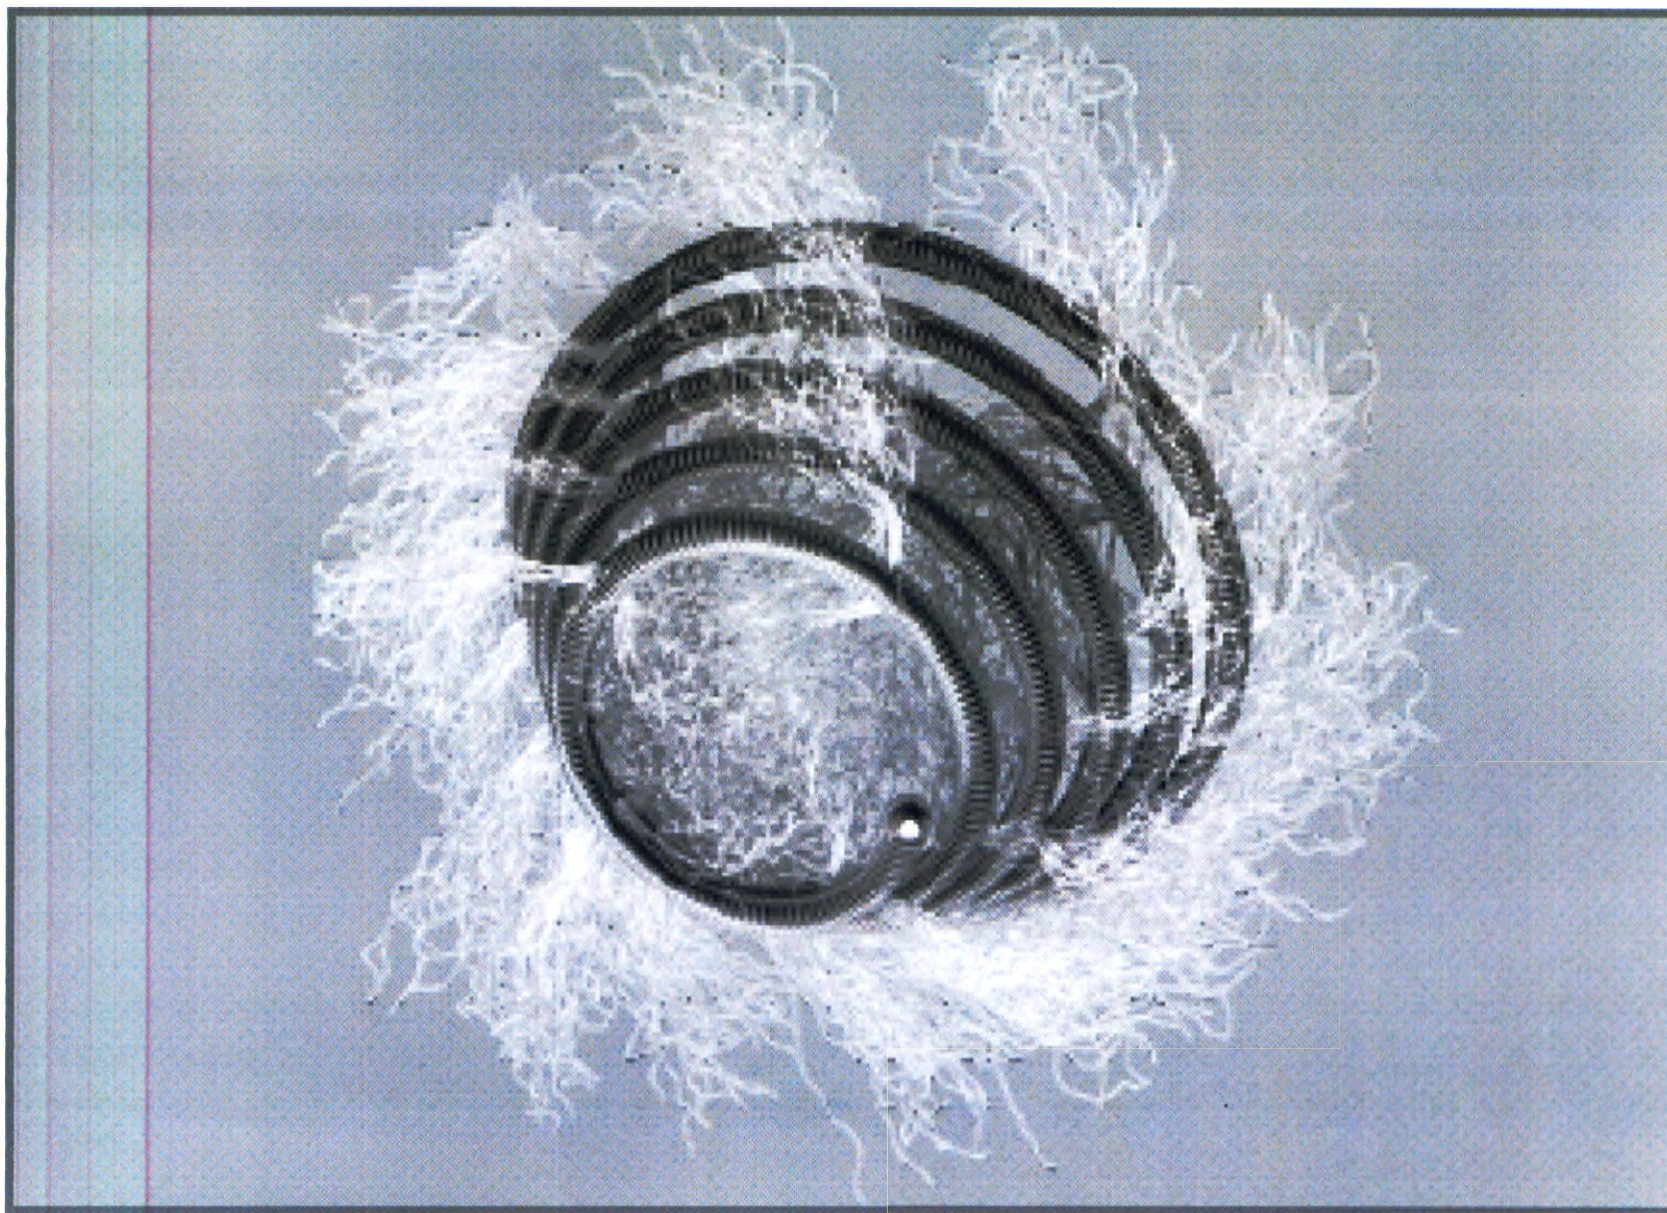

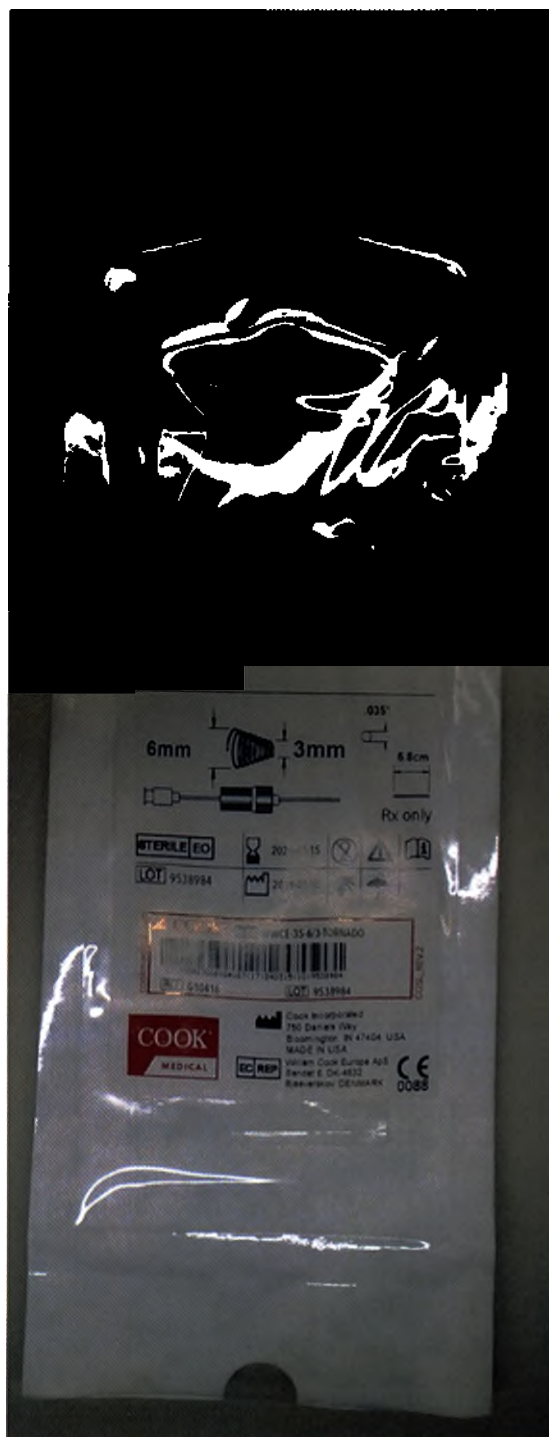

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Спиральи эмболизационные для сосудистой эмболизации

Варианты исполнения: MWCER-35-14-10; MWCER-35-14-12; MWCER-35-14-14; MWCER-35-14-16; MWCER-35-14-18; MWCER-35-14-20; MWCER-35-14-4; MWCER-35-14-6; MWCER-35-14-8; MWCER-35-7-10; MWCER-35-7-12; MWCER-35-7-14; MWCER-35-7-16; MWCER-35-7-18; MWCER-35-7-20; MWCER-35-7-4; MWCER-35-7-6; MWCER-35-7-8.

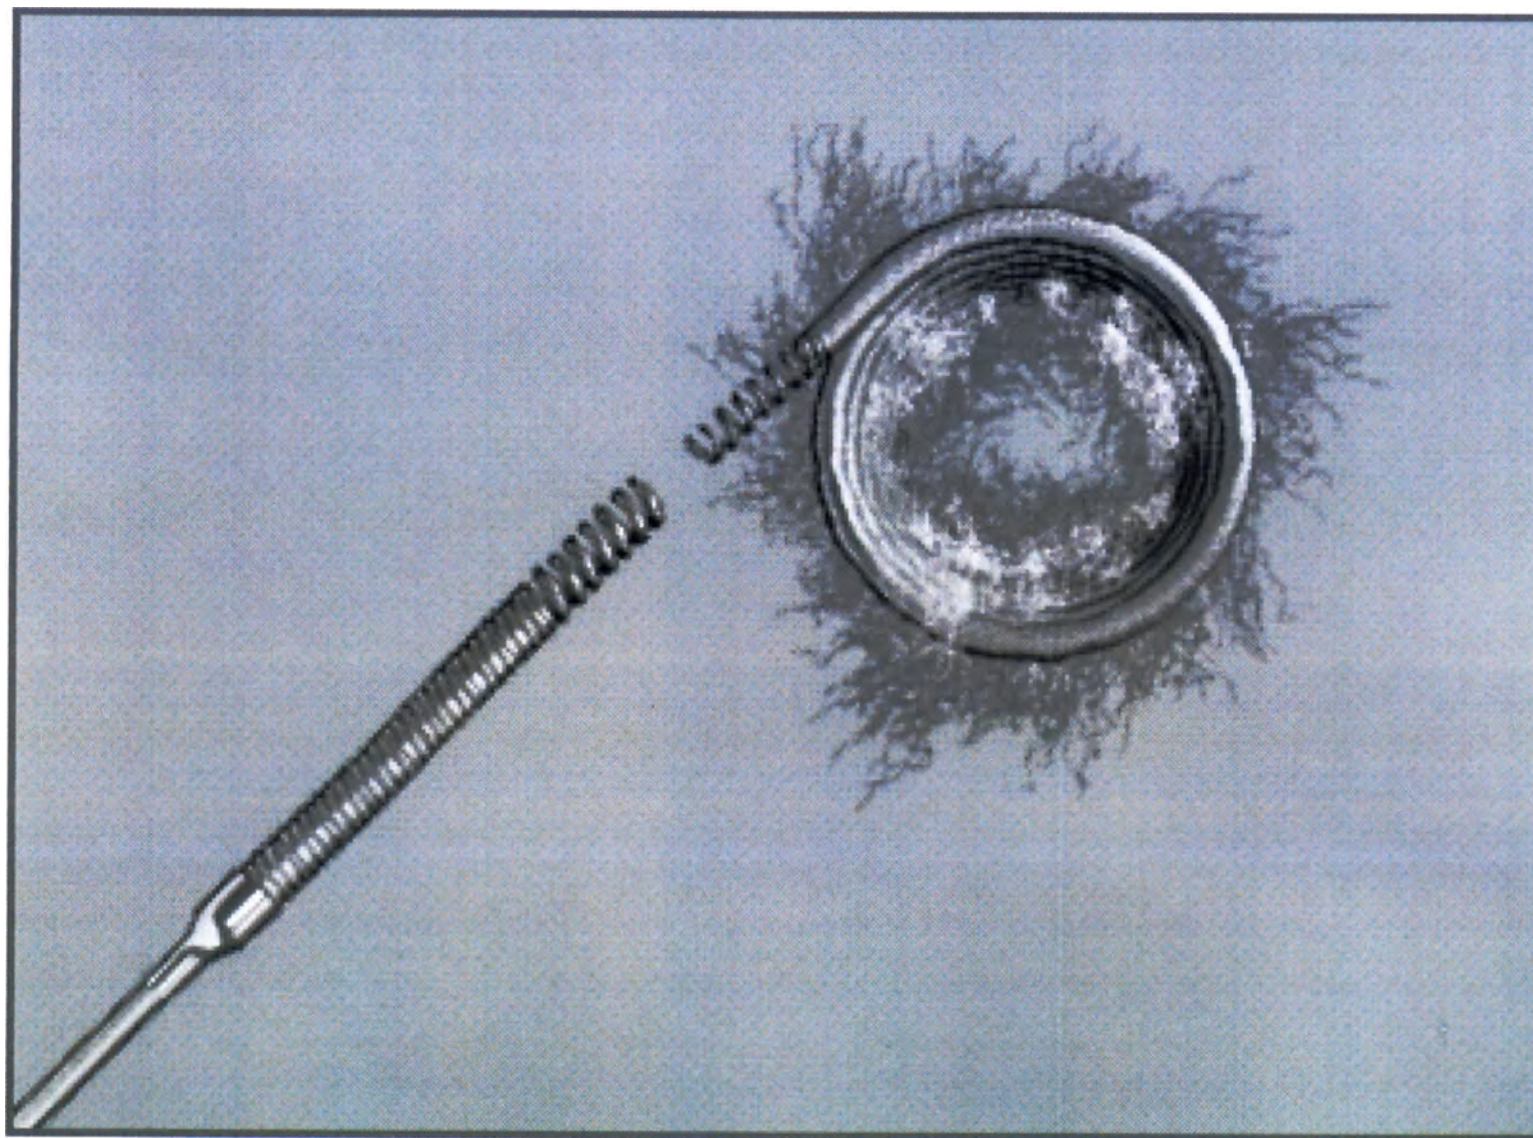



Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____




Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09



Спирали эмболизационные для сосудистой эмболизации

Варианты исполнения: IMWCE-35-4-3-JACKSON; IMWCE-35-4-4-JACKSON; IMWCE-35-5-5-JACKSON; IMWCE-35-5-6-JACKSON; IMWCE-35-5-8-JACKSON; IMWCE-35-6-10-JACKSON; IMWCE-35-6-12-JACKSON; IMWCE-38-4-3-JACKSON; IMWCE-38-4-4-JACKSON; IMWCE-38-5-5-JACKSON; IMWCE-38-5-6-JACKSON; IMWCE-38-5-8-JACKSON; IMWCE-38-6-10-JACKSON; IMWCE-38-6-12-JACKSON

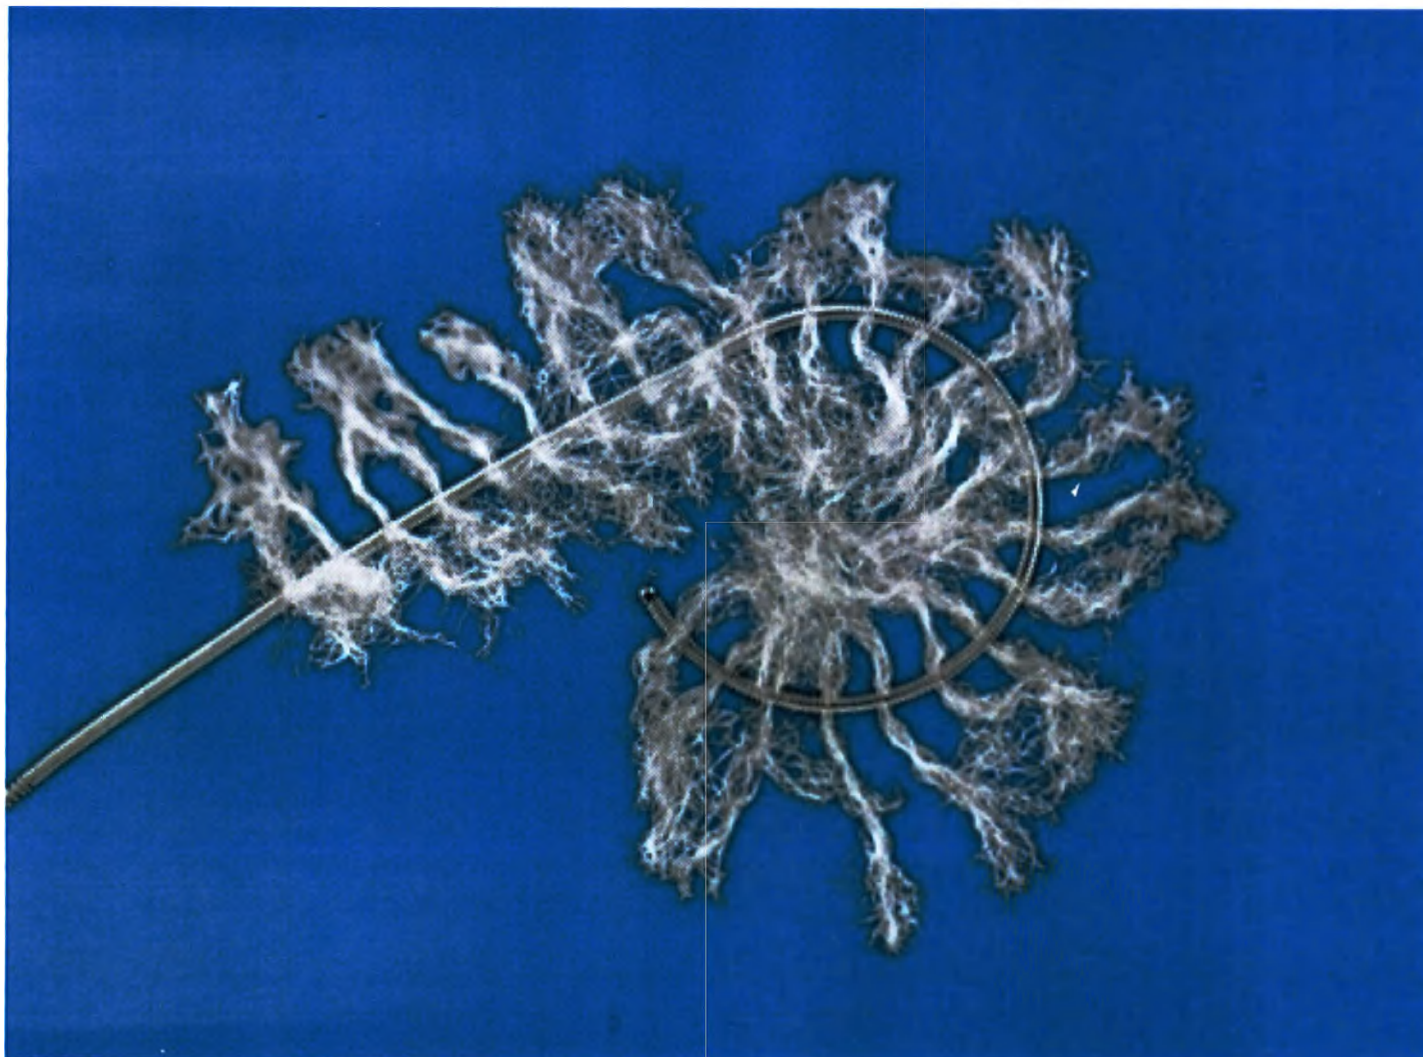

Макет маркировки:

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

Наименование

Производитель: _____

Срок годности: _____ Партия: _____

Рег.уд.: _____



Импортер ЗАО "ШАГ" тел: (495) 956-13-09

