

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Мерит Текнолоджис»



Шаламов А.В.

Фотографические изображения «Иглы для ангиографии с принадлежностями»

Производитель: Merit Medical Systems, Inc./ Мерит Медикал Системс, Инк
1600 West Merit Parkway South Jordan, Utah, 84095, USA

- Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)

ANGIOGRAPHIC NEEDLES

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис»
Россия, 119017 г. Москва
1-й Казачий переулок, дом 7
1 этаж, ком.6
Телефон / факс +7 495 221 89 02



Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12606 от 29.12.2017

Номер по каталогу: AD18T71W 09.01.2019
Иглы для ангиографии: Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)
18G (1,2мм)х70мм, тонкостенная. Нетоксично.
Усл.хран. +5°до+27°С/Усл.трансп-ки от -35°до+55°С

MERITMEDICA™

REF AD18T71W

LOT H1493024

Use By:
2021-12-31

Single Use

STERILE EO

Caution: Consult
accompanying
documents.

Do not use if
package is damaged

Non-pyrogenic



(01)10884450008185



(01)10884450008185(17)211231(10)H1493024

Merit Advance®
ANGIOGRAPHIC NEEDLES

Needle

18G

7.0 cm
2 3/4"

MAX GUIDE WIRE
0.038" (0.97 mm)



Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah
84095 U.S.A. 1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-358-3748
Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway,
Ireland. European Customer Service +31 43 358 82 22
www.merit.com

EC REP

MERITMEDICA™

MERIT

Merit Advance®
ANGIOGRAPHIC NEEDLES

Needle

18G

7.0 cm
2 3/4"

MAX GUIDE WIRE
0.038" (0.97 mm)



Rx ONLY

CE 0086

25 Units

Made in U.S.A.

111 01/08/19

11:57:01

LPNEZ0027 REV 001 05/15

ID 081511 402256002/A


NEEDLE



Маркировка на картонной коробке

- Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)

Merit Advance®
ANGIOGRAPHIC NEEDLES



18G 7.0 cm
2 3/4"

0.038" (0.97 mm)
MAX GUAGE WHITE

REF AD18T71W

LOT H1493024

Use By: 2021-12-31

STERILE EO CE 0086

Single Use ONLY

Do not use if
package is damaged

Non-pyrogenic

Caution: Consult
accompanying documents.

MERITMEDICAL®

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway, South Jordan
Utah 84095 U.S.A. 1-801-253-1600
U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748

(Ireland) Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland +31 43 358 82 22

01/09/2019

05:10:41

00967

01/09/19 LFNEM0007 REV 002 09/16

1 Unit

www.merit.com

Made in U.S.A.



УПД: ООО «Мерит Текнолоджис»
Россия, 119017 г. Москва
1-й Казачий переулок, дом 7
1 этаж, ком.6
Телефон / факс +7 495 221 89 02

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12606 от 29.12.2017

Номер по каталогу: AD18T71W 09.01.2019

Иглы для ангиографии: Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)

18G(1,2мм)х70мм, тонкостенная. Нетоксично.


Усл.хран.+5°до+27°С/Усл.трансп-ки от -35°до+55°С

Маркировка на индивидуальной стерильной упаковке изделия



Изделие в индивидуальной стерильной упаковке

- Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)

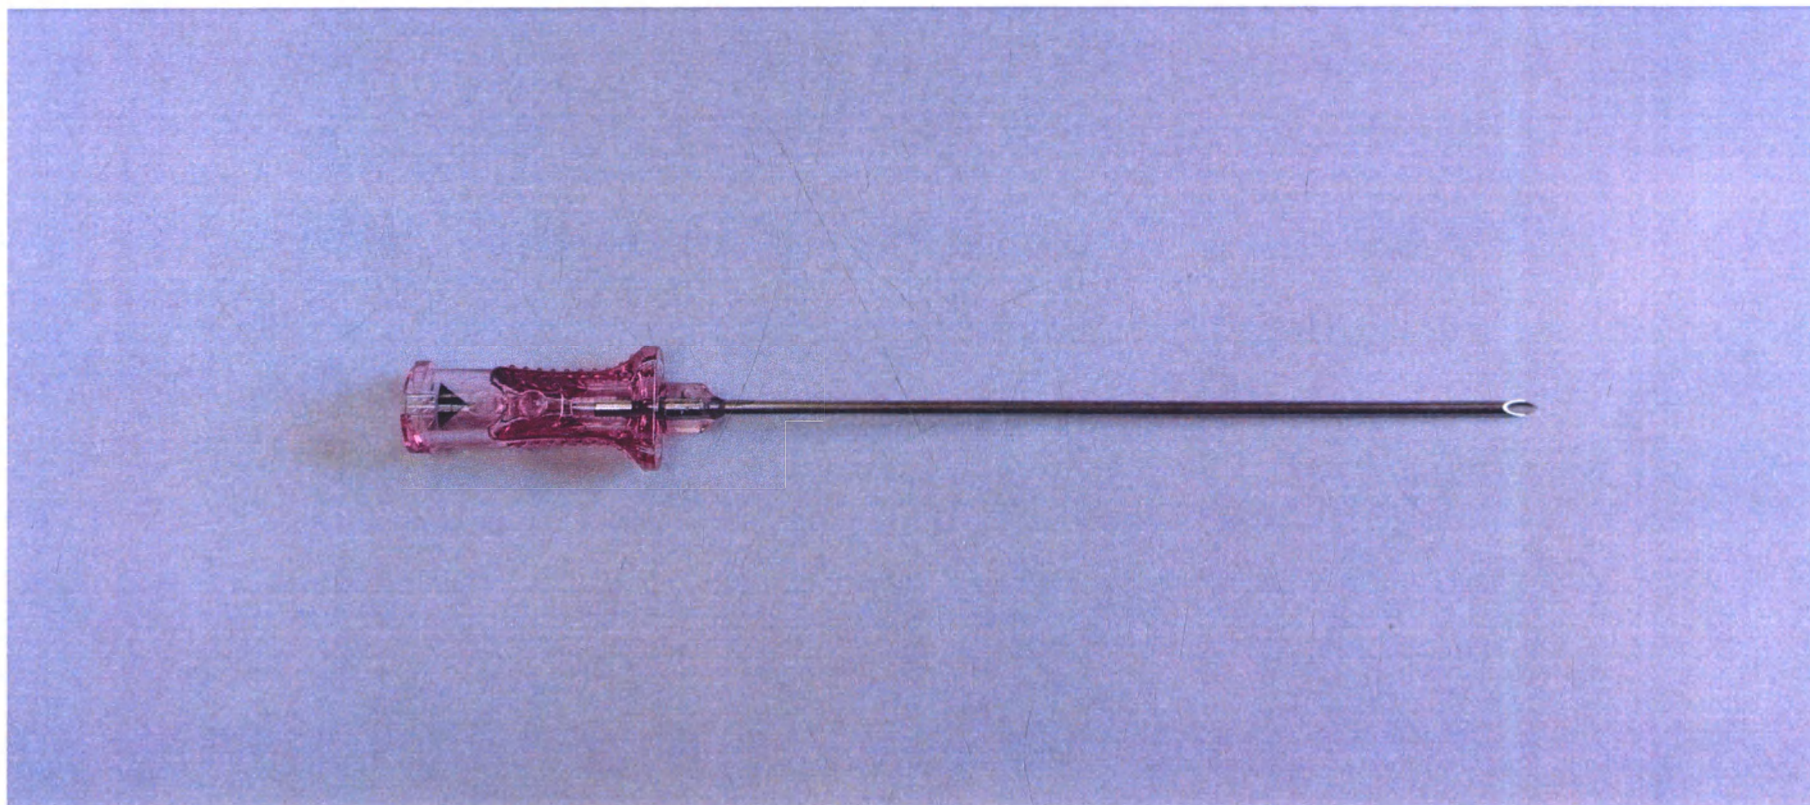

Общий вид изделия

- Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)

ANGIOGRAPHIC NEEDLES

УПП: ООО «Мерит Текнолджис»
Россия, 119017 г. Москва
1-й Казачий переулок, дом 7
1 этаж, ком.6
Телефон / факс +7 495 221 89 02



Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12606 от 29.12.2017

Номер по каталогу: AD19U71WC 28.07.2017
Иглы для ангиографии: Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)
19G (1,1 мм) x 70 мм, экстратонкостенная. Нетоксично.
Усл.хран. +5° до +27°С / усл.трансп.-ки от -35° до +55°С

MERITMEDICA™

REF AD19U71WC

LOT H1177245

Use By:
2020-07-31

Single Use

STERILE EO

Caution: Consult
accompanying
documents.

Do not use if
package is damaged

Non-pyrogenic

Merit Advance®
ANGIOGRAPHIC NEEDLES

Needle

19G

7.0 cm
2 3/4"

MAX GUIDE WIRE
0.035" (0.89 mm)



(01)10884450009007



(01)10884450009007(17)200731(10)H1177245



Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah
84095 U.S.A. 1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748
Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway,
Ireland. European Customer Service +31 43 358 82 22
www.merit.com

EC REP

MERITMEDICA™



Merit Advance®
ANGIOGRAPHIC NEEDLES

Needle

19G

7.0 cm
2 3/4"

MAX GUIDE WIRE
0.035" (0.89 mm)



Rx ONLY

CE 0086

25 Units

Made in U.S.A.

12:10:32 AM LFNZ0027 REV 001 05/15


ID 081511 402256002/A

Маркировка на картонной коробке

- Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)




Маркировка на индивидуальной стерильной упаковке изделия

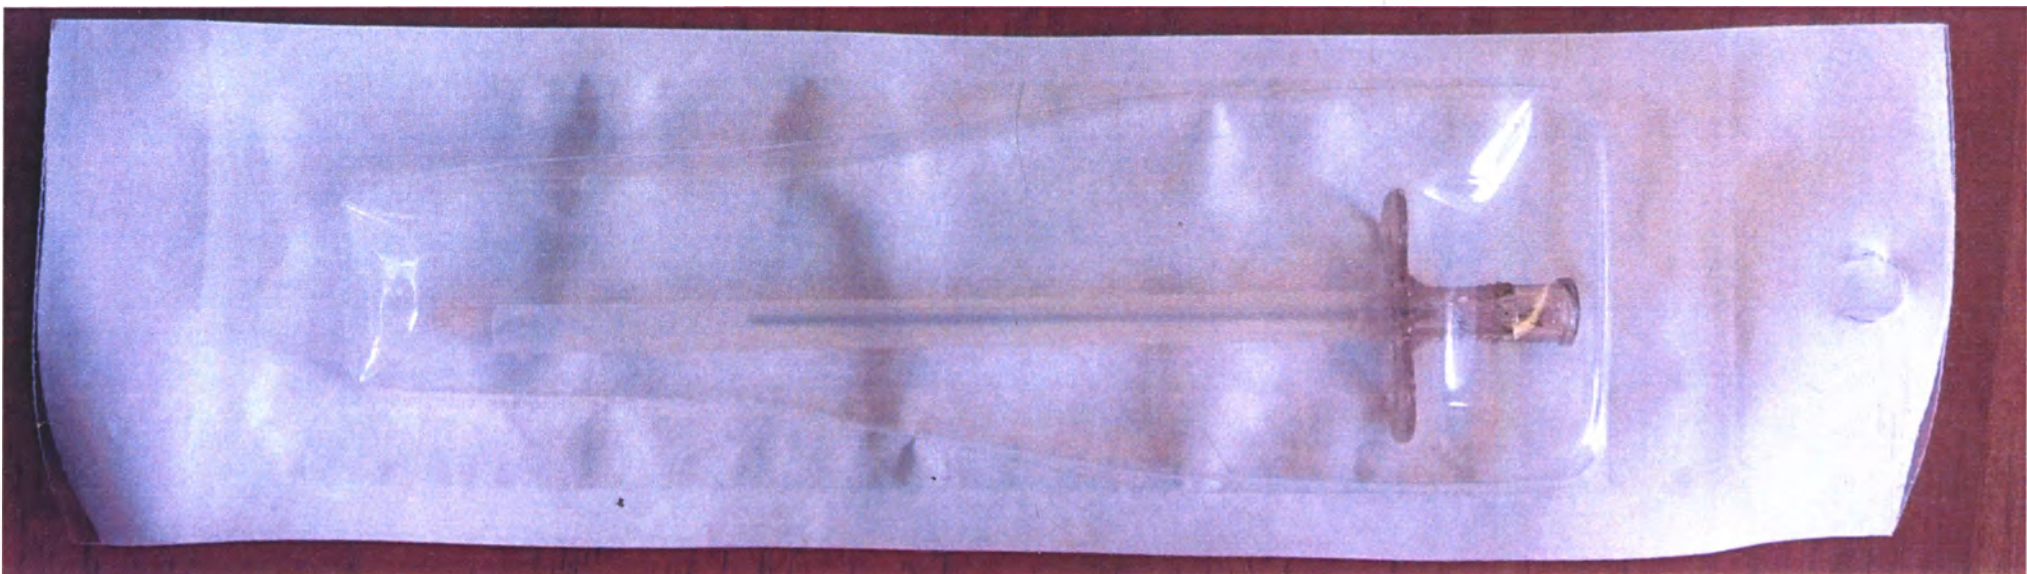

Изделие в индивидуальной стерильной упаковке

- Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)

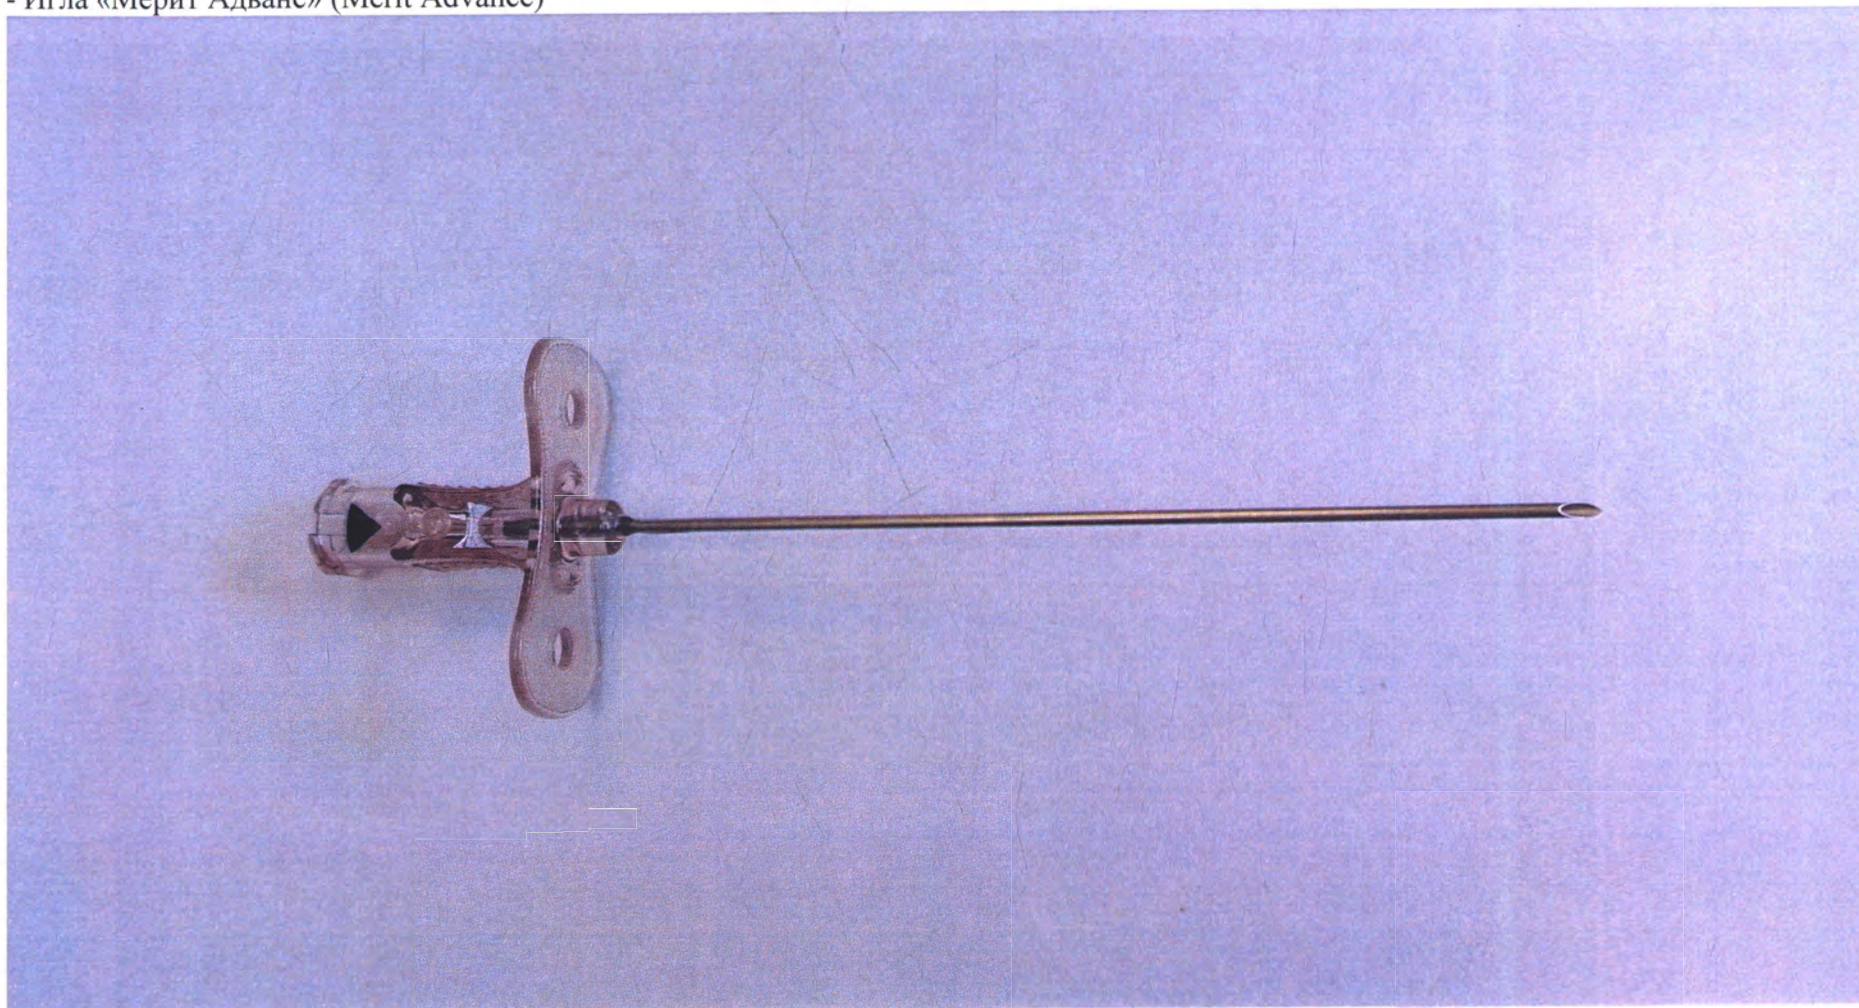

Общий вид изделия

- Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)

ANGIOGRAPHIC NEEDLES

УПД: ООО «Мерит Текнолоджис»
Россия, 119017 г. Москва
1-й Казачий переулок, дом 7
1 этаж, ком.6
Телефон / факс +7 495 221 89 02



Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12606 от 29.12.2017

Номер по каталогу: AD19U71WS 29.11.2018
Игла для ангиографии: Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)
19G(1.1мм)х70мм, экстратонкостенная. Нетоксично.
Усл.хран.+5°до+27°С/Усл.трансп-ки от -35°до+55°С

MERITMEDICAL™

REF AD19U71WS

LOT H1454762

Use By:
2021-11-30

Single Use

STERILE EO

Caution: Consult
accompanying
documents.

Do not use if
package is damaged

Non-pyrogenic

Needle
19G
7.0 cm
2 3/4"
MAX GUIDE WIRE
0.035" (0.89 mm)



(01)10884450009014



(01)10884450009014(17)211130(10)H1454762



Merit Medical Systems, Inc., 1800 West Merit Parkway, South Jordan, Utah
84095 U.S.A. 1-801-253-1800 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748
EC REP Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway,
Ireland. European Customer Service +31 43 358 82 22
www.merit.com

MERITMEDICAL™



Merit Advance®
ANGIOGRAPHIC NEEDLES

Needle
19G
7.0 cm
2 3/4"
MAX GUIDE WIRE
0.035" (0.89 mm)



Rx ONLY

CE 0086

25 Units
Made in U.S.A.
4 11/28/18

16:07:07

LPNE20027 REV 001 05/15

ID 081511 402256002/A

NEEDLE

Маркировка на картонной коробке

- Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)

Merit Advance®
ANGIOGRAPHIC NEEDLES



19G 7.0 cm
2 3/4"

0.035" (0.89 mm)
MAX GUIDE WIRE

REF AD19U71WS

LOT H1454762

Use By: 2021-11-30

STERILE **EO** **CE** 0086

Single Use **Rx ONLY**

Do not use if
package is damaged

Non-pyrogenic

Caution: Consult
accompanying documents.

MERITMEDICAL®

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway, South Jordan
Utah 84095 U.S.A. 1-801-253-1600
U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748

EC/REP Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West
Galway, Ireland +31 43 358 82 22

11/29/2018

08:26:53

00198

11/29/18 LFNE00007 REV 002 09/16

1 Unit

www.merit.com

Made in U.S.A.

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис»
Россия, 119017 г. Москва
1-й Казачий переулок, дом 7
1 этаж, ком.6
Телефон / факс +7 495 221 89 02

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12606 от 29.12.2017

Номер по каталогу: AD19U71WS 29.11.2018

Иглы для ангиографии: Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)

19G(1.1мм)x70мм, экстраонкостенная. Нетоксично.


Усл.хран.+5°до+27°С/Усл.трансп-ки от -35°до+55°С



Маркировка на индивидуальной стерильной упаковке изделия

Изделие в индивидуальной стерильной упаковке

- Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)

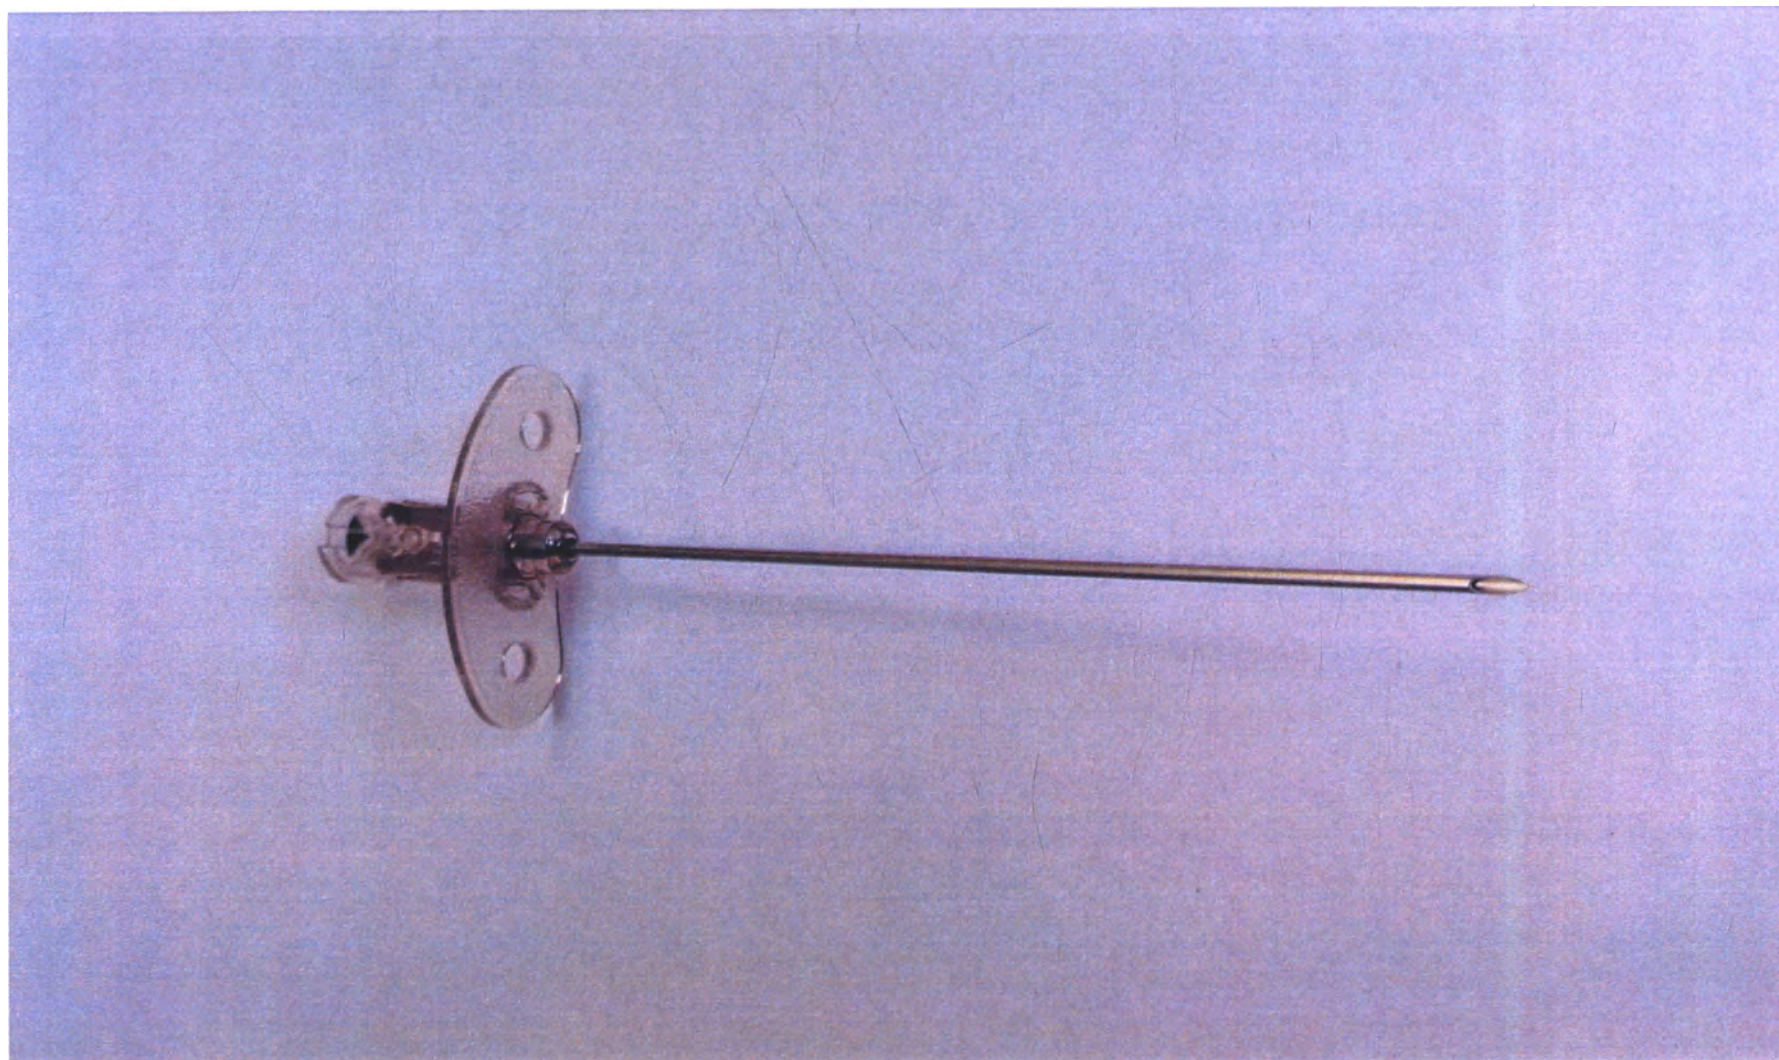

Общий вид изделия

- Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)

ANGIOGRAPHIC NEEDLES

УПД: ООО «Мерит Текнолоджис»
Россия, 119017 г. Москва
1-й Казачий переулок, дом 7
1 этаж, ком.6
Телефон / факс +7 495 221 89 02



Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12606 от 29.12.2017
Номер по каталогу: AD20T41W 16.01.2019
Иглы для ангиографии: Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)
20G(0.9мм)х40мм, тонкостенная. Нетоксично.
Усл.хран.+5°до+27°С/Усл.трансп-ки от -35°до+55°С

MERITMEDICA™

REF AD20T41W

LOT H1501738

Use By:
2021-12-31

Single Use

STERILE EO

Caution: Consult
accompanying
documents.

Do not use if
package is damaged

Non-pyrogenic

Merit Advance®
ANGIOGRAPHIC NEEDLES

Needle

20G

4.0 cm
1 9/16"

MAX GUIDE WIRE
0.025" (0.64 mm)



(01)10884450009021



(01)10884450009021(17)211231(10)H1501738



EC REP
Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah
84095 U.S.A. 1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748
Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway,
Ireland. European Customer Service +31 43 358 82 22
www.merit.com



Merit Advance®
ANGIOGRAPHIC NEEDLES

Needle

20G

4.0 cm
1 9/16"

MAX GUIDE WIRE
0.025" (0.64 mm)



R ONLY

CE 0086

25 Units

Made in U.S.A.

43 01/16/19

17-18-27

LFNEZ0027 REV 001 05/15

ID 081511 402256002/A

NEEDLE




Маркировка на картонной коробке


- Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)



Маркировка на индивидуальной стерильной упаковке изделия

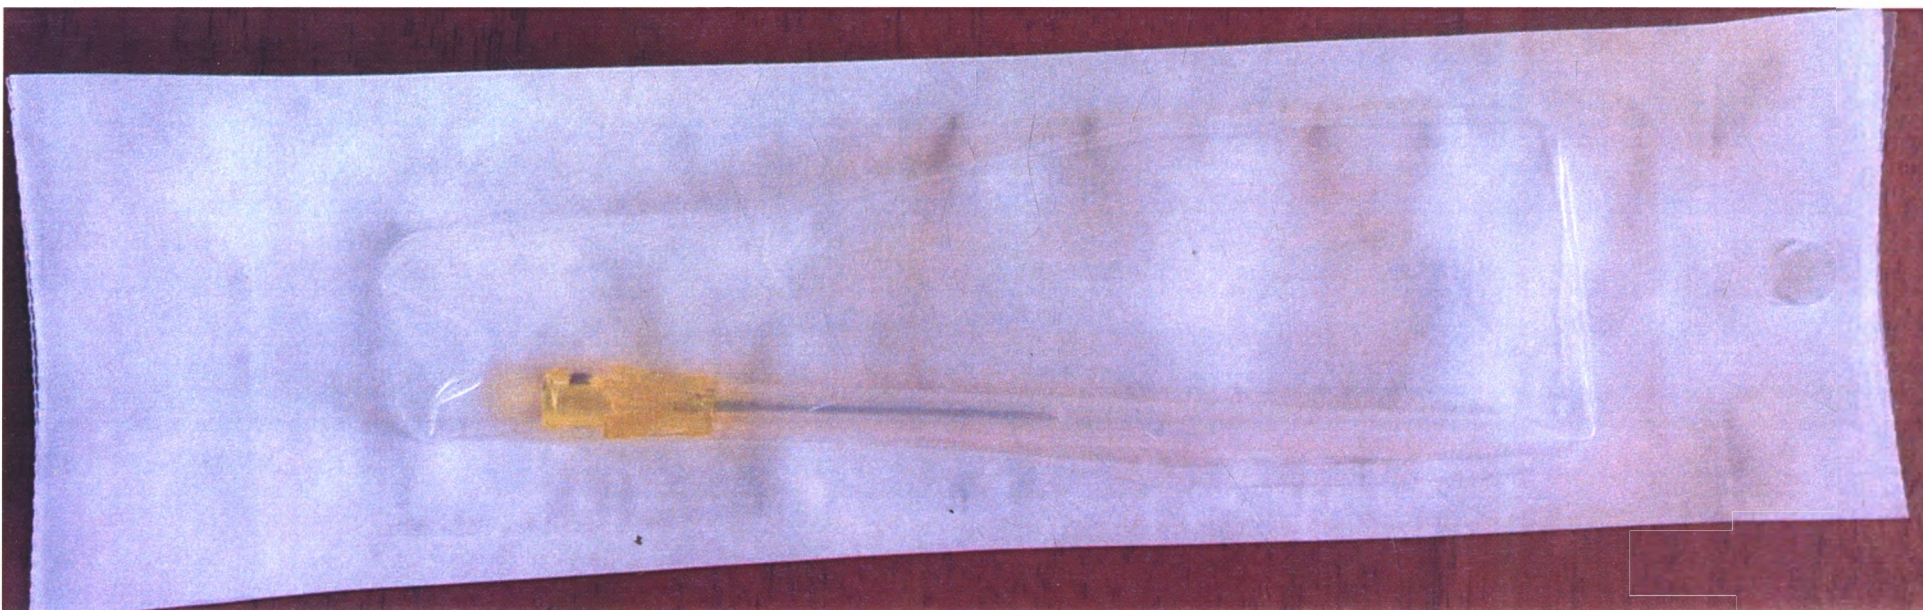

- Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance)

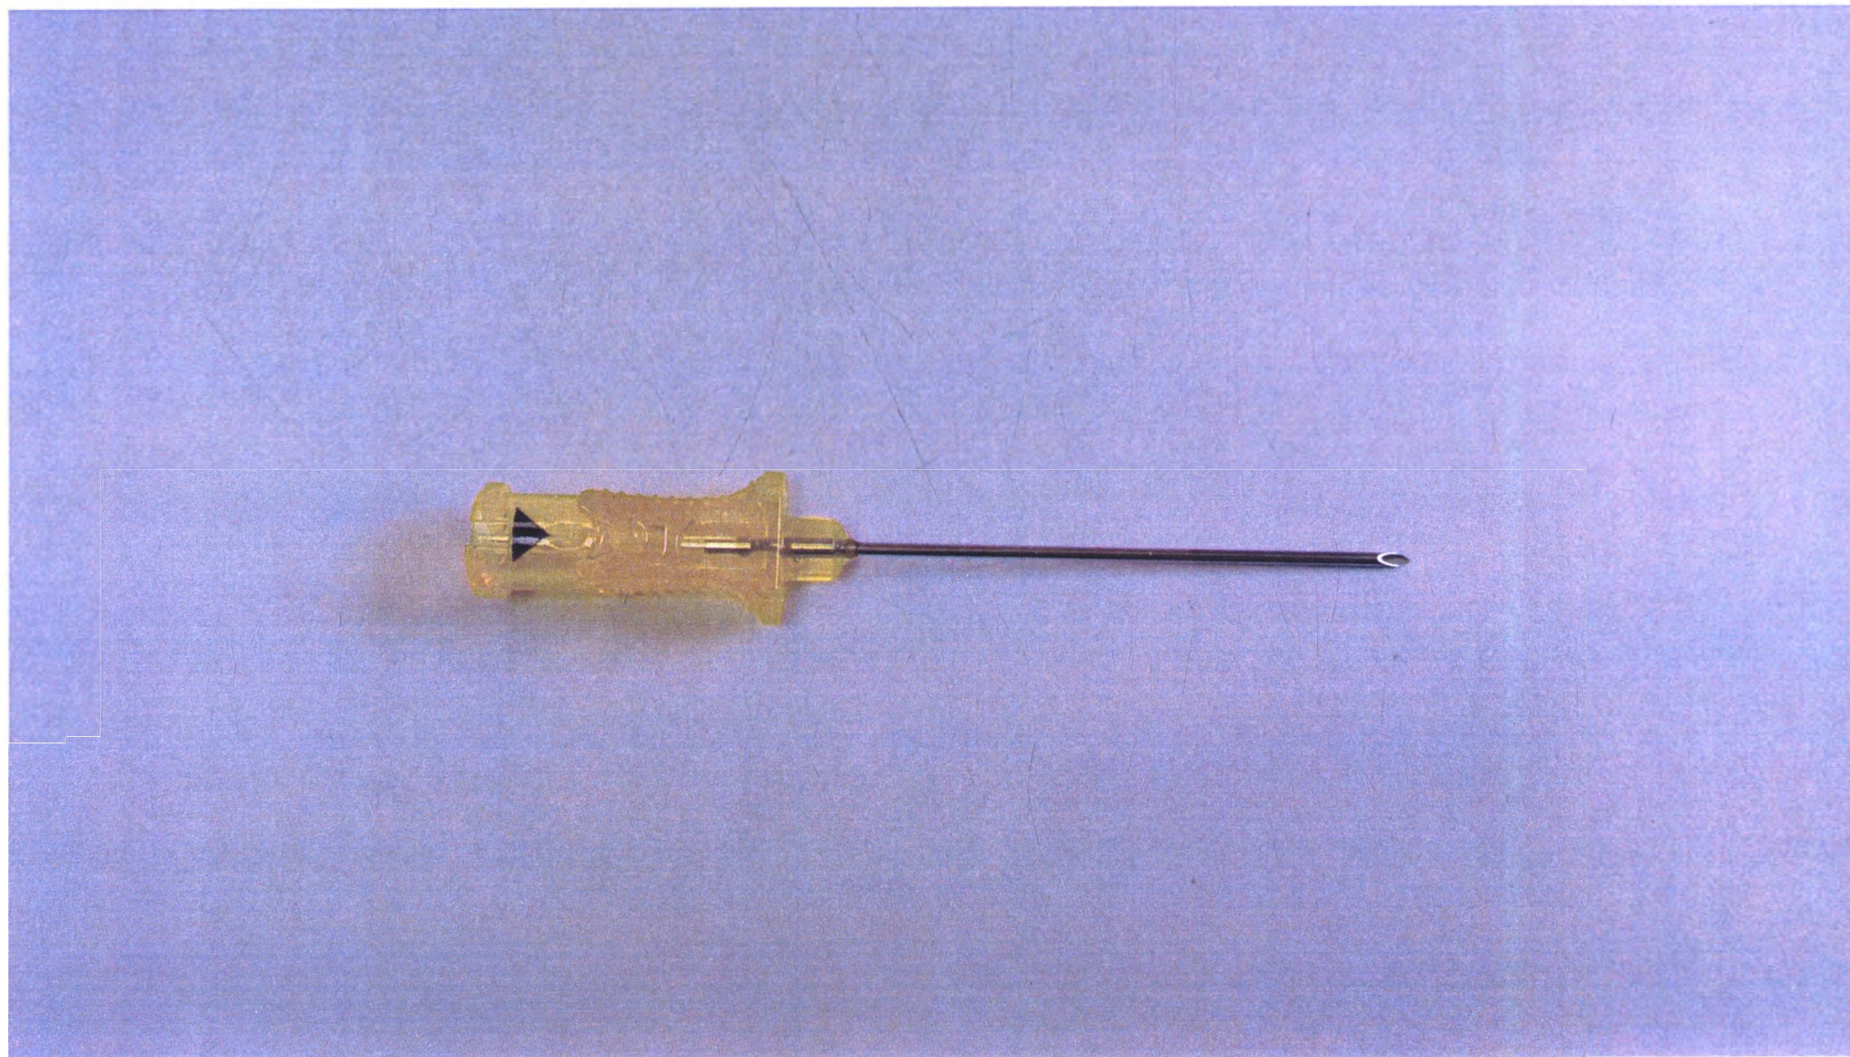

Общий вид изделия

- Игла «Мерит Адванс» изогнутая (Merit Advance® Curved).

REF AD21T91R
LOT H1267472
Use By: 2020-12-31
Single Use **RX ONLY**
Do not use if package is damaged
STERILE EO
Caution: Consult accompanying documents.
Non-pyrogenic
10 Units
Made in U.S.A.
Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748
Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
European Customer Service +31 43 358 82 22
www.merit.com
CE 0086
0002 01/04/18 10:46:10 AM
LFNEZ0036 REV 001 02/16

Merit Advance®
ANGIOGRAPHIC NEEDLES
21G 9.0 cm 3 1/2"
0.021" (0.53 mm)
MAX GUIDE WIRE
000026727221
0110884450015688
0110884450015688(17)201231(10)H1267472


МЕРИТ МЕДИКАЛ

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис»
Россия, 119017 г. Москва
1-й Казачий переулок, дом 7
1 этаж, ком.6
Телефон / факс +7 495 221 89 02
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12606 от 29.12.2017
03.01.2018
Номер по каталогу: AD21T91R
Иглы для ангиографии: Игла «Мерит Адванс» изогнутая (Merit Advance® Curved) 21G(0,8мм)х90мм, тонкостенная. Нетоксично.
Усл.хран.+5°до+27°С/Усл.трансп-ки от -35°до+55°С

PC

Маркировка на картонной коробке (лицевая сторона)

- Игла «Мерит Адванс» изогнутая (Merit Advance® Curved).

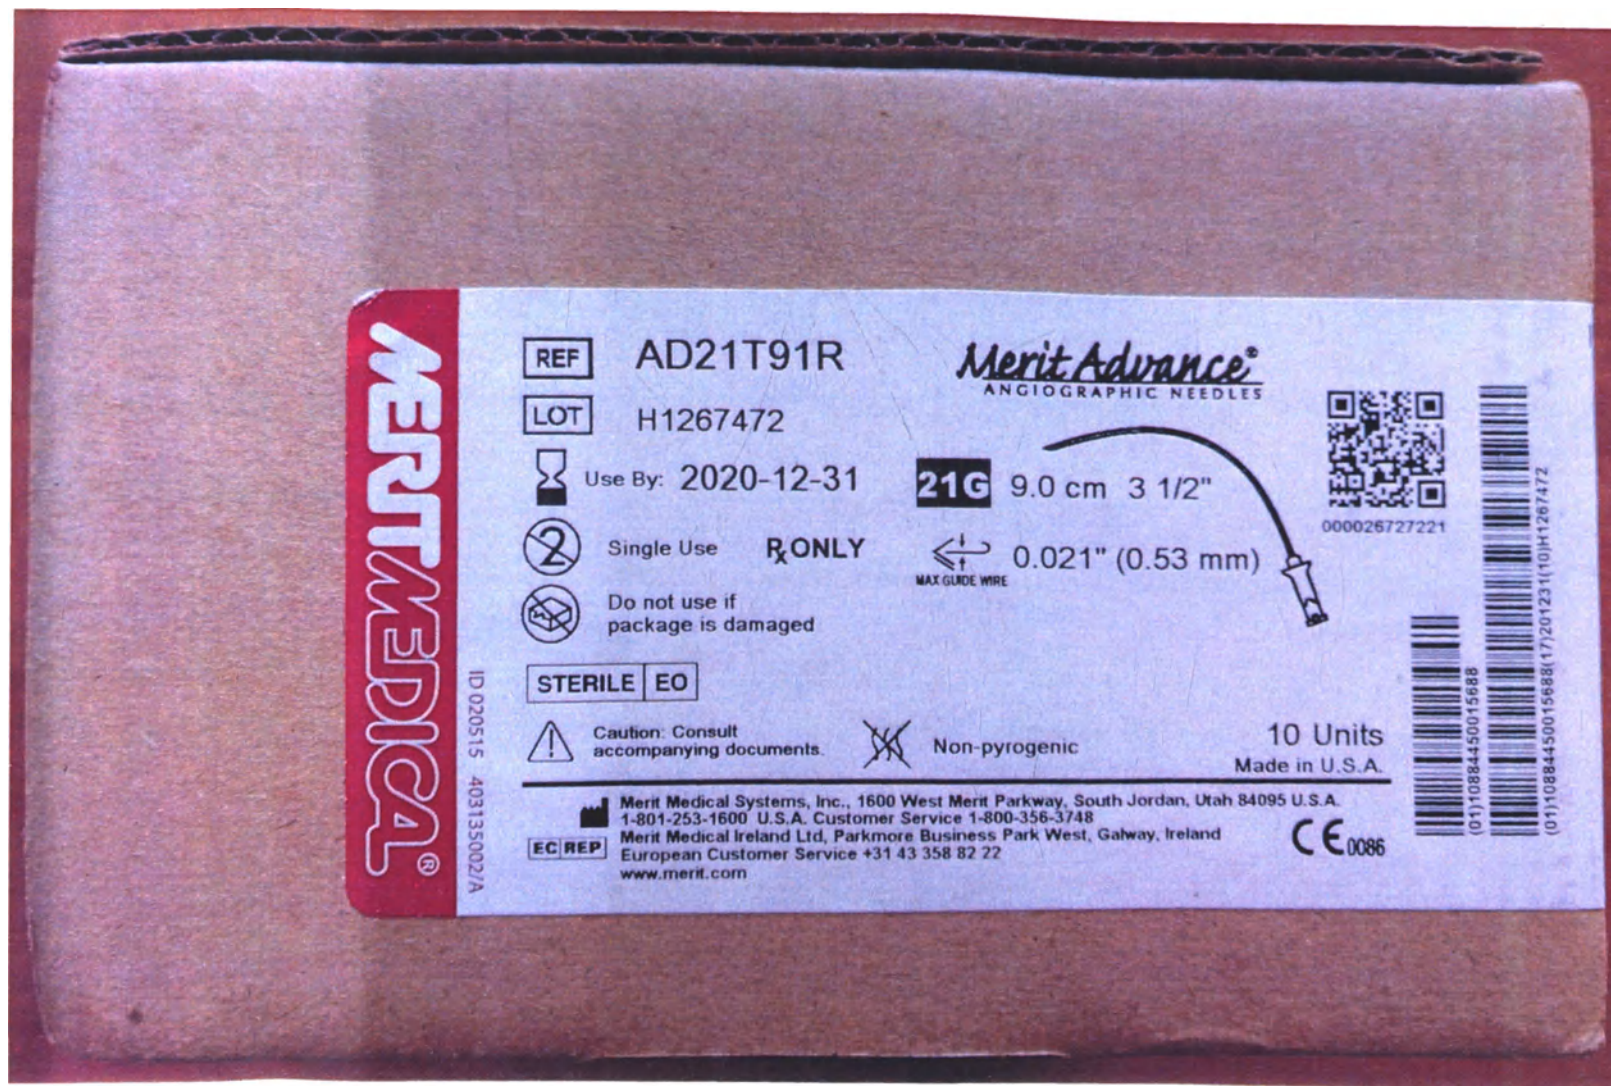

Маркировка на картонной коробке (боковая сторона)

- Игла «Мерит Адванс» изогнутая (Merit Advance® Curved).

MERIT MEDICAL

REF AD21T91R

LOT H1267472

Use By: 2020-12-31

Single Use ~~Non-pyrogenic~~

Do not use if package is damaged

STERILE EO

Caution: Consult accompanying documents.

CE 0086

R ONLY

Merit Advance®
ANGIOGRAPHIC NEEDLES

21G 9.0 cm 3 1/2"

0.021" (0.53 mm)
MAX GUIDE WIRE



000025648833



(01)00884450015681



(01)00884450015681(17)201231(10)H1267472

1 Unit

0012 01/03/18 10:29:53 AM LFNEZ0037 REV 001 02/16

EC REP

Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095 U.S.A.

1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748

Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland

European Customer Service +31 43 358 82 22

www.merit.com

Made in U.S.A.

ID 091813 402256005/B



УПП: ООО «Мерит Текнолоджис»

Россия, 119017 г. Москва

1-й Казачий переулок, дом 7

1 этаж, ком.6

Телефон / факс +7 495 221 89 02

Регистрационное удостоверение



№ ФСЗ 2012/12606 от 29.12.2017

Номер по каталогу: AD21T91R 03.01.2018

Иглы для ангиографии: Игла «Мерит Адванс» изогнутая (Merit Advance® Curved) 21G(0.8мм)x90мм, тонкостенная. Нетоксично.

Усл.хран. +5° до +27°С/Усл.трансп-ки от -35° до +55°С

- Игла «Мерит Адванс» изогнутая (Merit Advance® Curved).

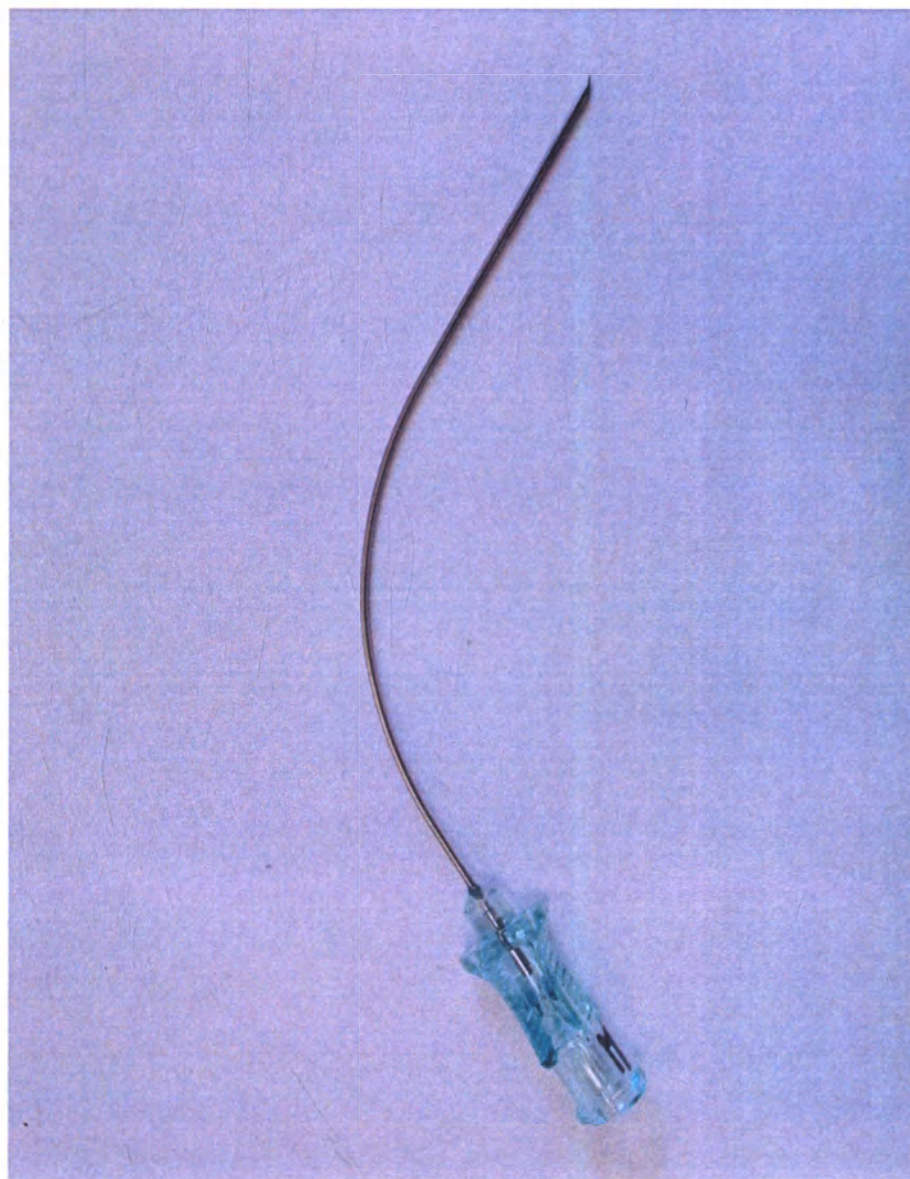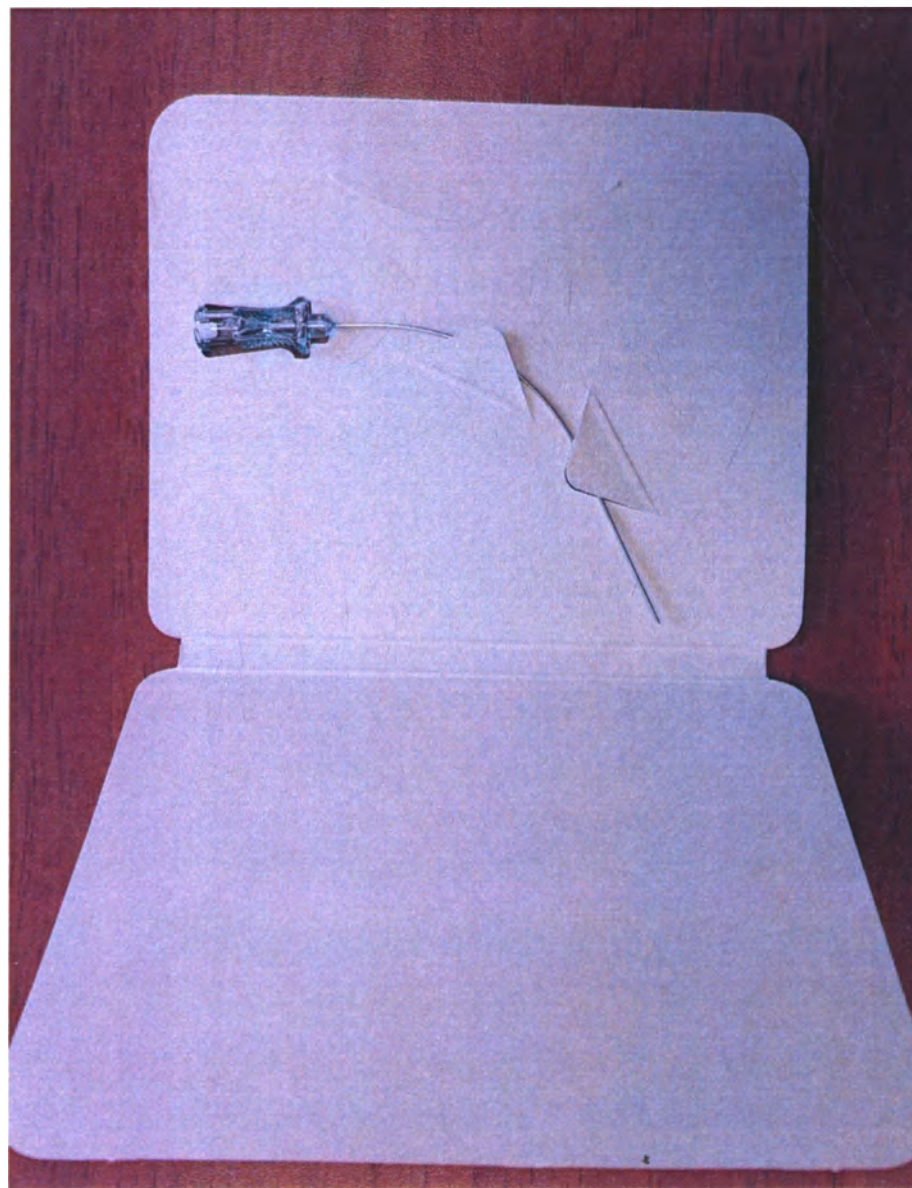

Общий вид изделия

- Игла «Маджестик» (Majestik).

ANGIOGRAPHIC NEEDLES

УПП: ООО «Мерит Текнолоджис»
Россия, 119017 г. Москва
1-й Казачий переулок, дом 7
1 этаж, ком.6
Телефон / факс +7 495 221 89 02



Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12606 от 29.12.2017

Номер по каталогу: AN19U72S-25 14.11.2018
Иглы для ангиографии: Игла «Маджестик» (Majestik)
19G (1,1 мм) x 70 мм, свертонкостенная. Нетоксично.
Усл.хран. +5° до +27°С / сл.трансп-ки от -35° до +55°С

MERITMEDICA™

REF AN19U72S-25

LOT H1454772



Use By:
2021-10-31



Single Use



STERILE

EO



Caution: Consult
accompanying
documents.



Do not use if
package is damaged



Non-pyrogenic

MAJESTIK® SERIES
ANGIOGRAPHIC NEEDLES

Needle

19G

7.0 cm
2 3/4"



MAX GUIDE WIRE
0.035" (0.89 mm)



(01)10884450008550



(01)10884450008550(17)211031(10)H1454772



EC REP Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah
84095 U.S.A. 1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748
Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway,
Ireland. European Customer Service +31 43 358 82 22
www.merit.com



MAJESTIK® SERIES
ANGIOGRAPHIC NEEDLES

Needle

19G

7.0 cm
2 3/4"



MAX GUIDE WIRE
0.035" (0.89 mm)



Rx ONLY

CE 0086

25 Units

Made in U.S.A.

11-35-48

LFNE20027 REV 001 05/15

ID 081511 402256002/A

NEEDLE




Маркировка на картонной коробке

- Игла «Маджестик» (Majestik).




Маркировка на индивидуальной стерильной упаковке изделия

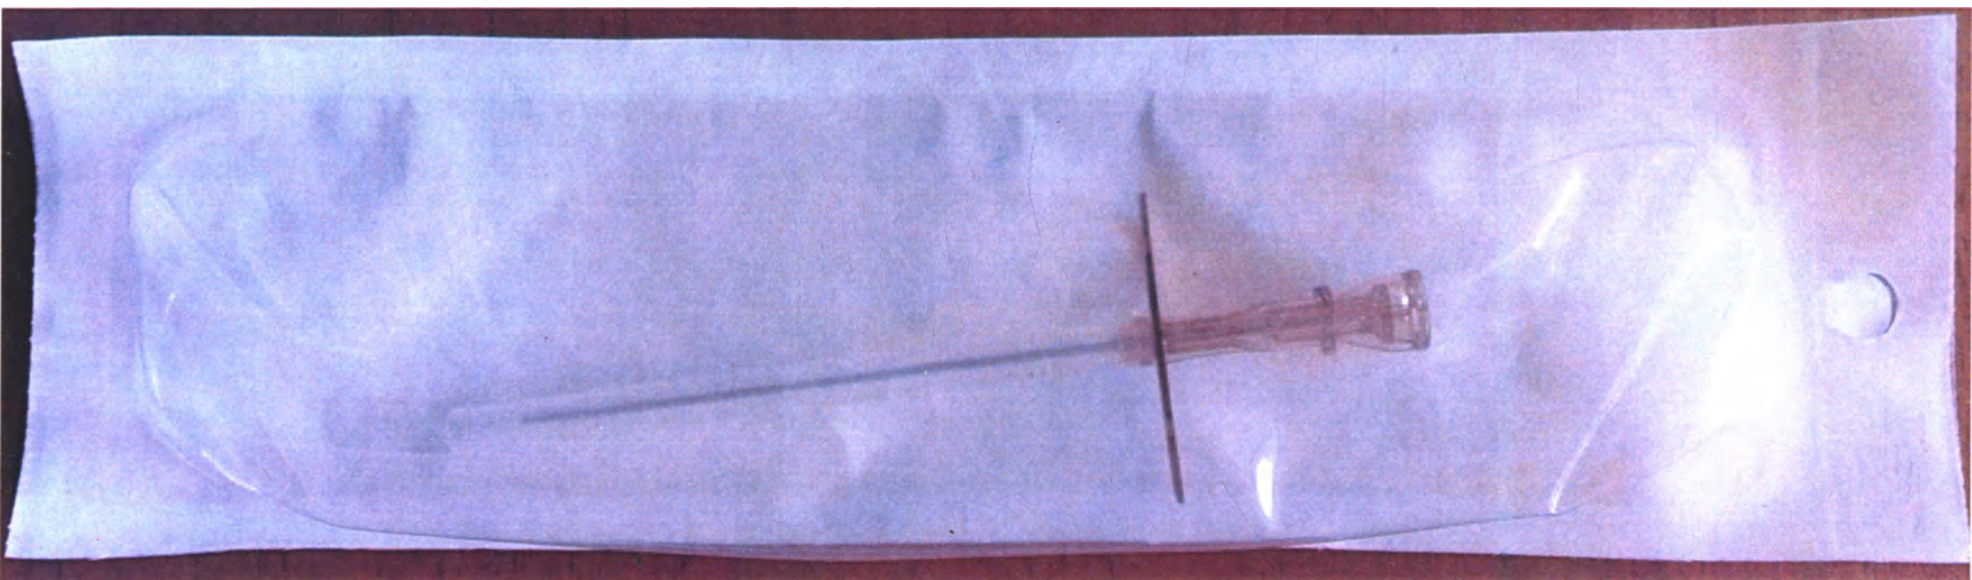


Изделие в индивидуальной стерильной упаковке

- Игла «Маджестик» (Majestik).

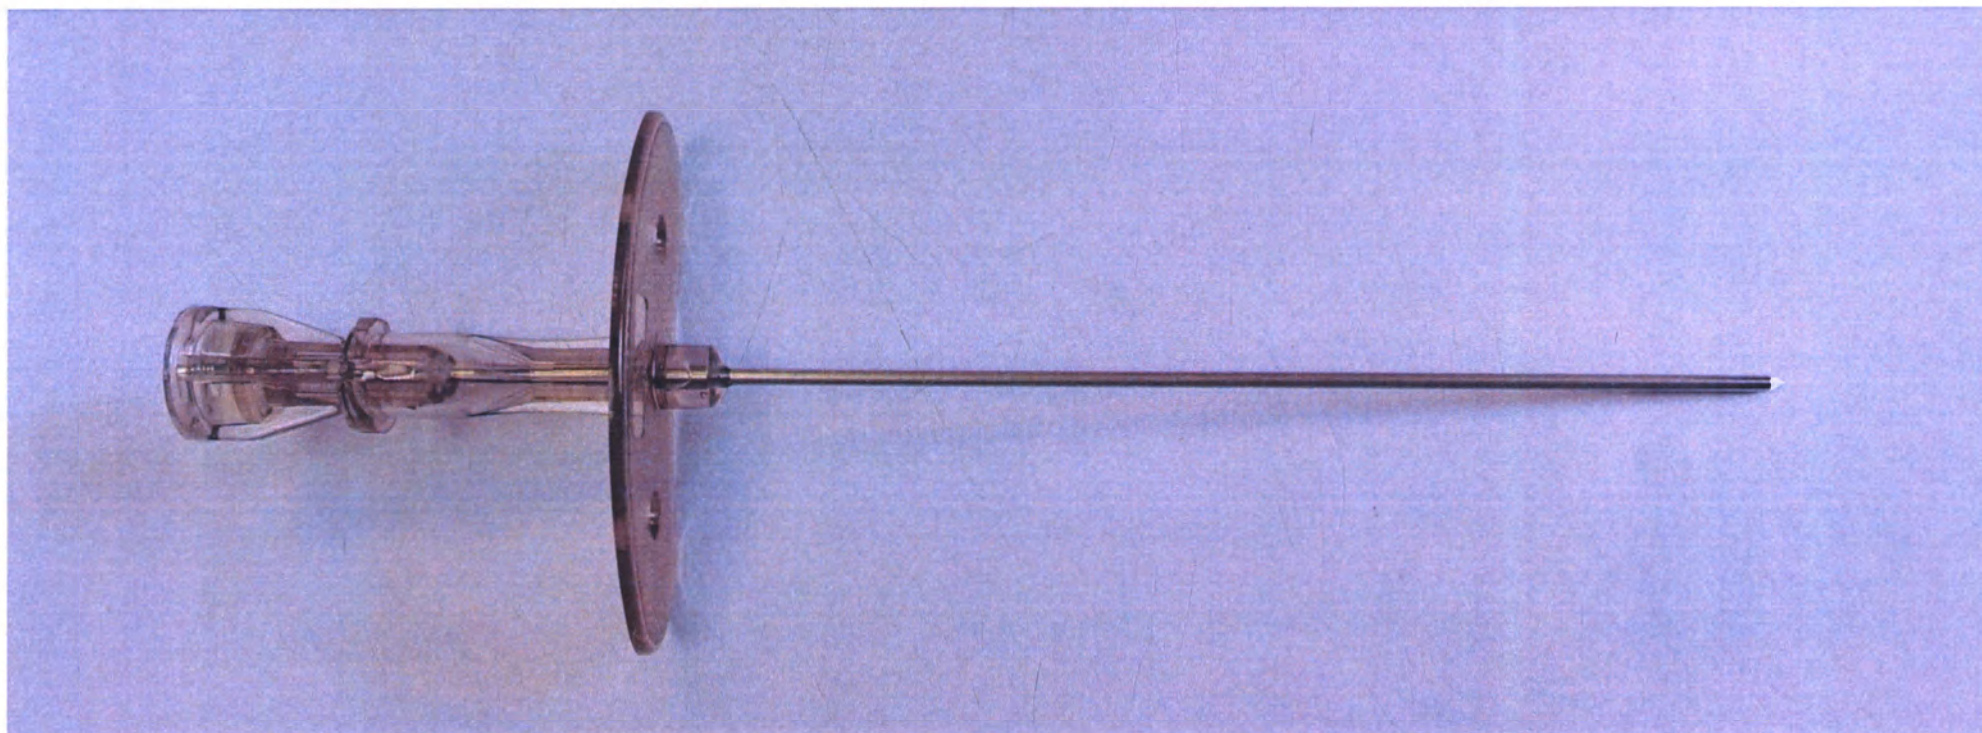


Общий вид изделия в собранном виде

- Игла «Маджестик» (Majestik).

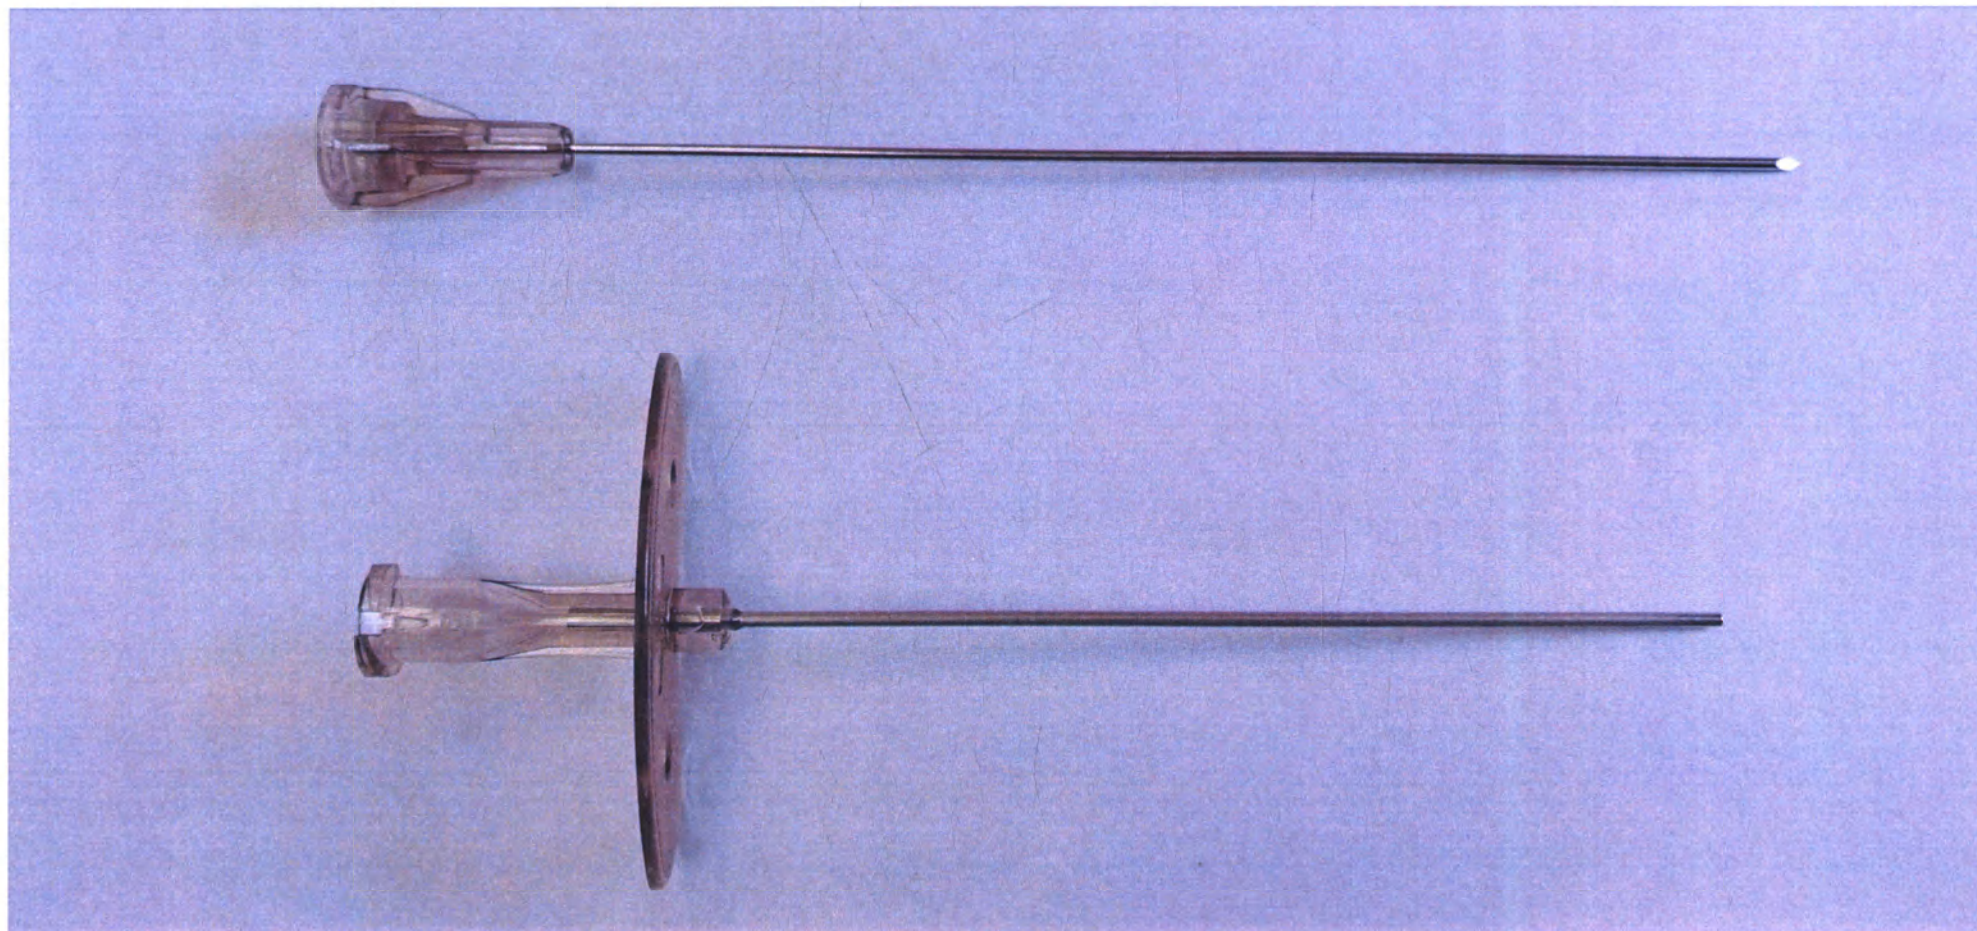

Общий вид изделия. Сверху: стилет, снизу: канюля

- Игла безопасная ангиографическая «Мерит Адванс» (Merit Advance Angiographic Safety Needle).

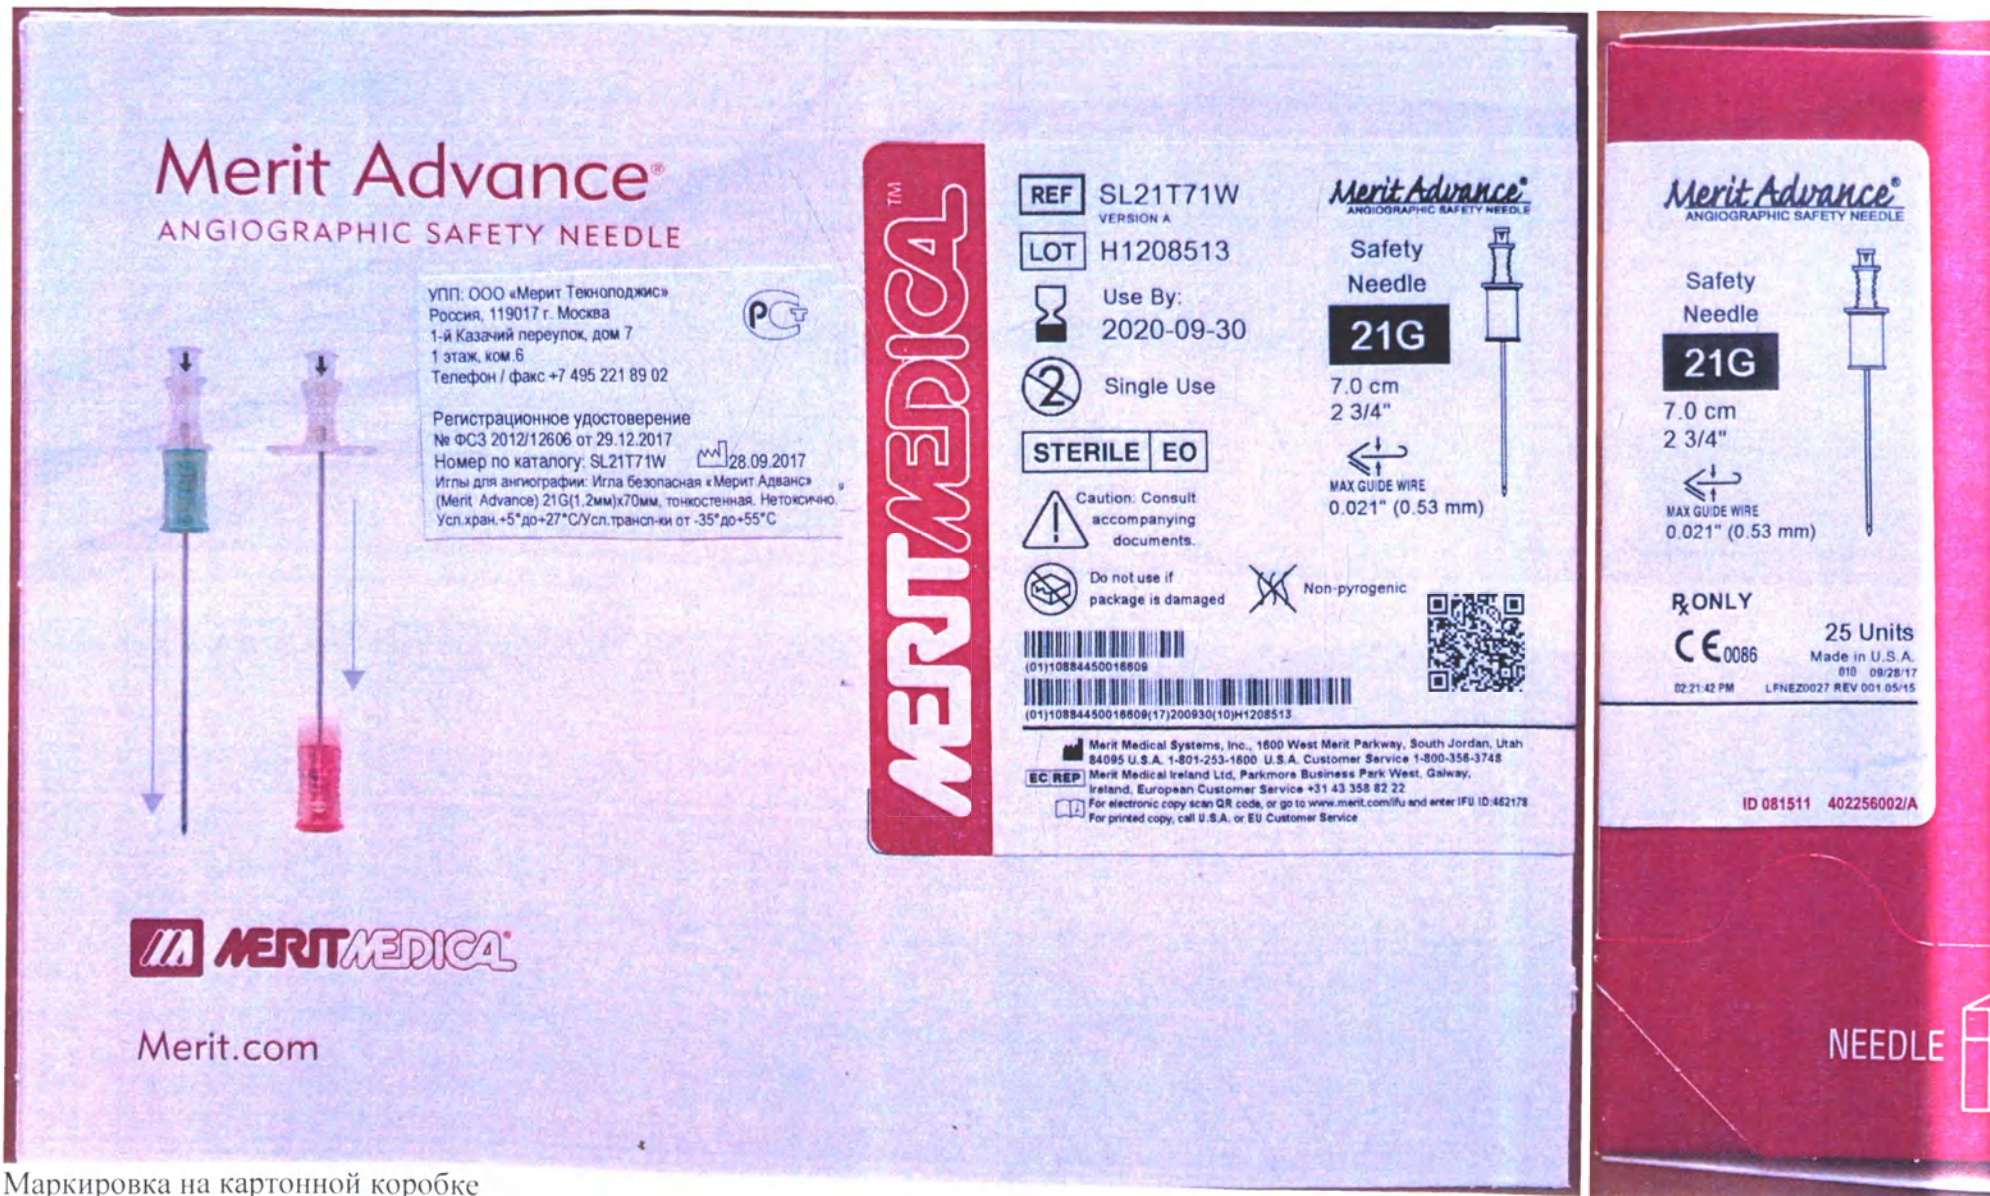


Маркировка на картонной коробке

- Игла безопасная ангиографическая «Мерит Адванс» (Merit Advance Angiographic Safety Needle).




Маркировка на индивидуальной стерильной упаковке изделия

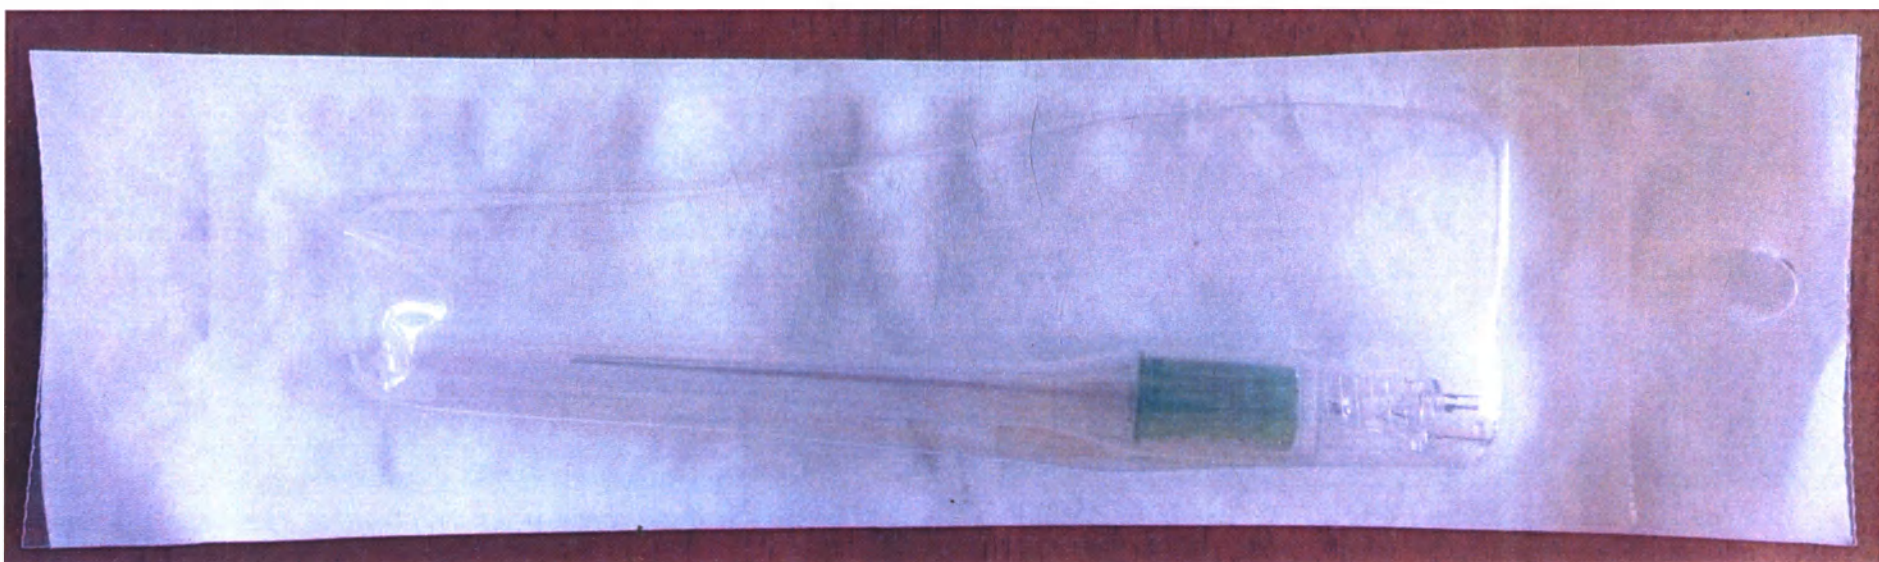


Изделие в индивидуальной стерильной упаковке

- Игла безопасная ангиографическая «Мерит Адванс» (Merit Advance Angiographic Safety Needle).

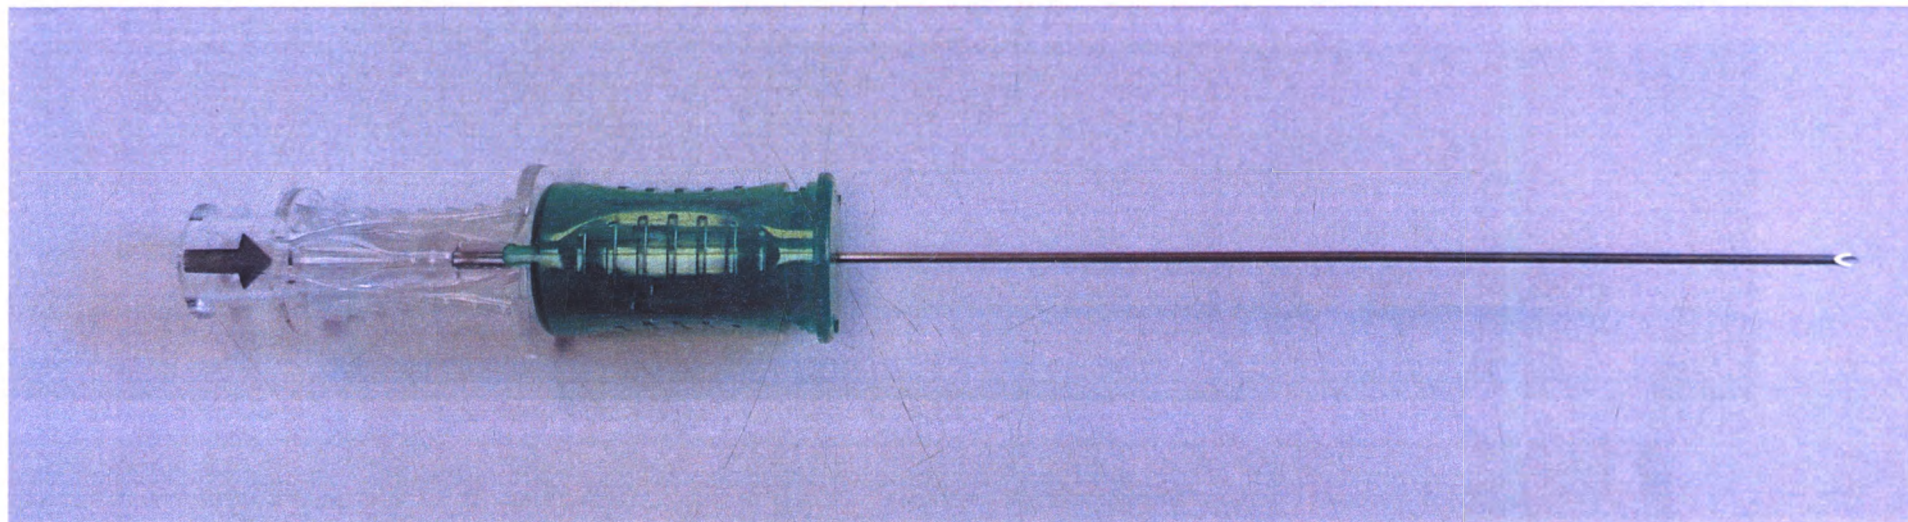


Общий вид изделия

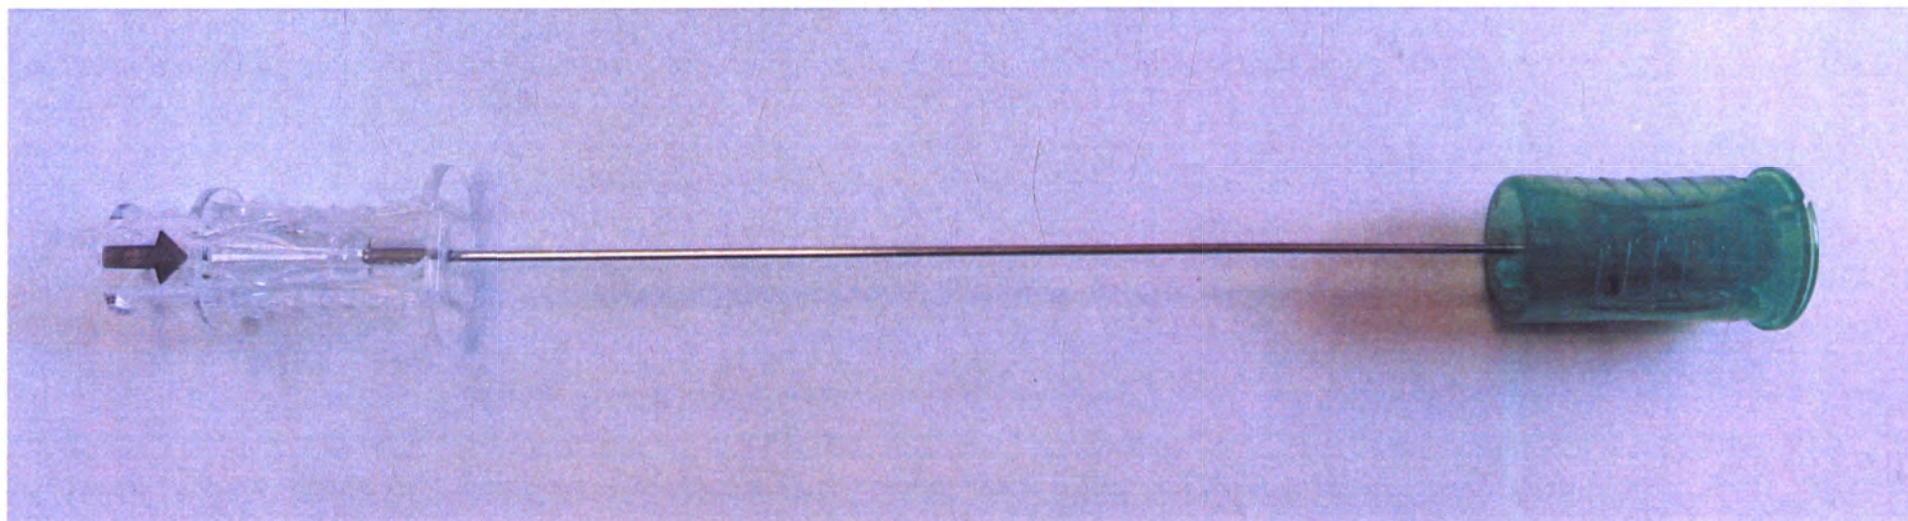



Общий вид изделия в заблокированном положении

Принадлежности:

- Безопасный скальпель «Футура» (Futura).

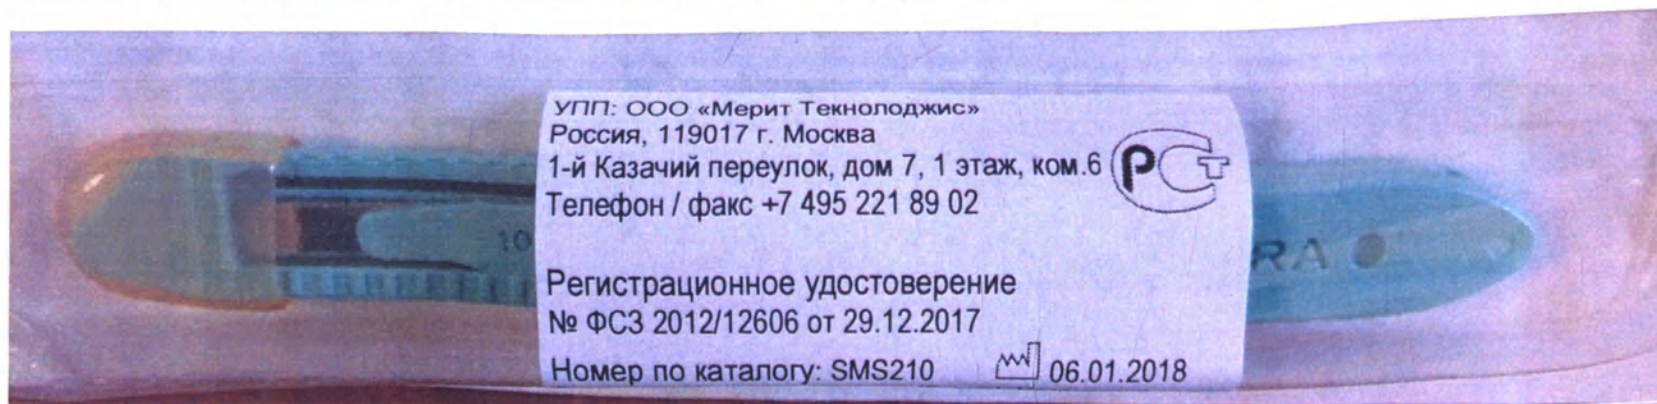

Маркировка принадлежности

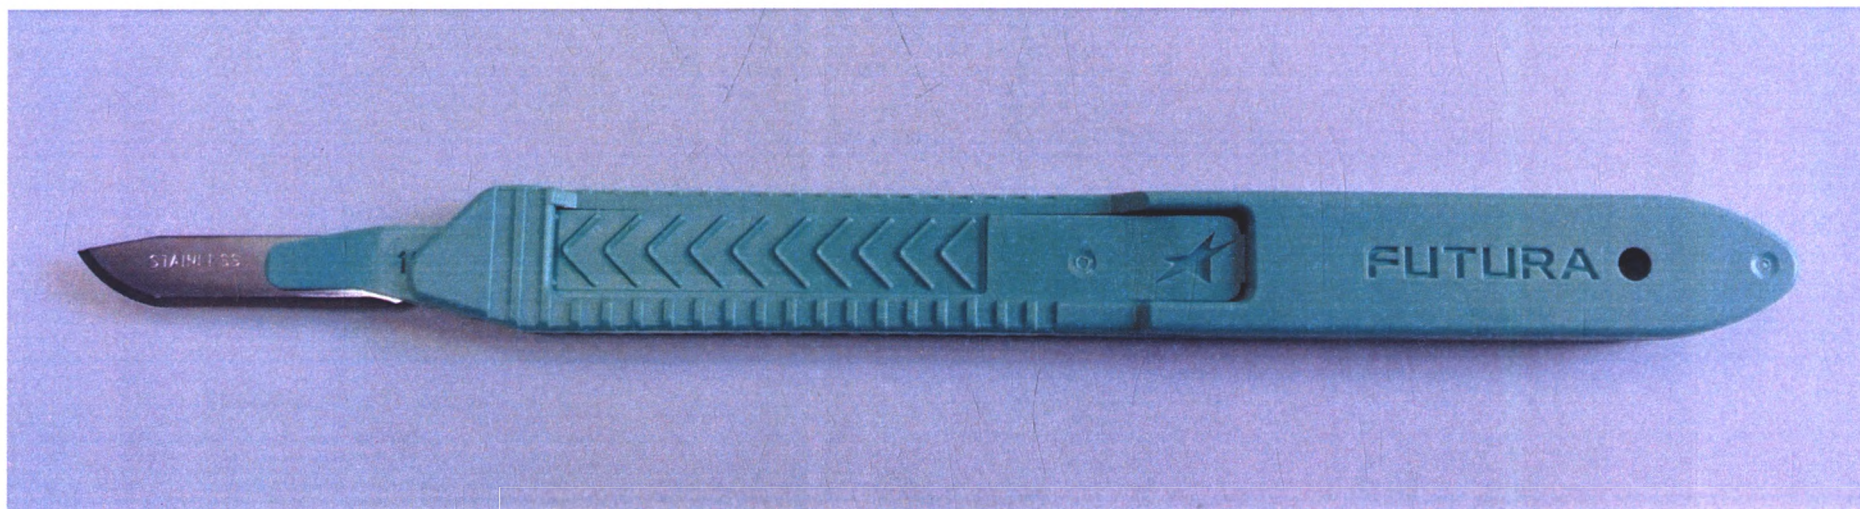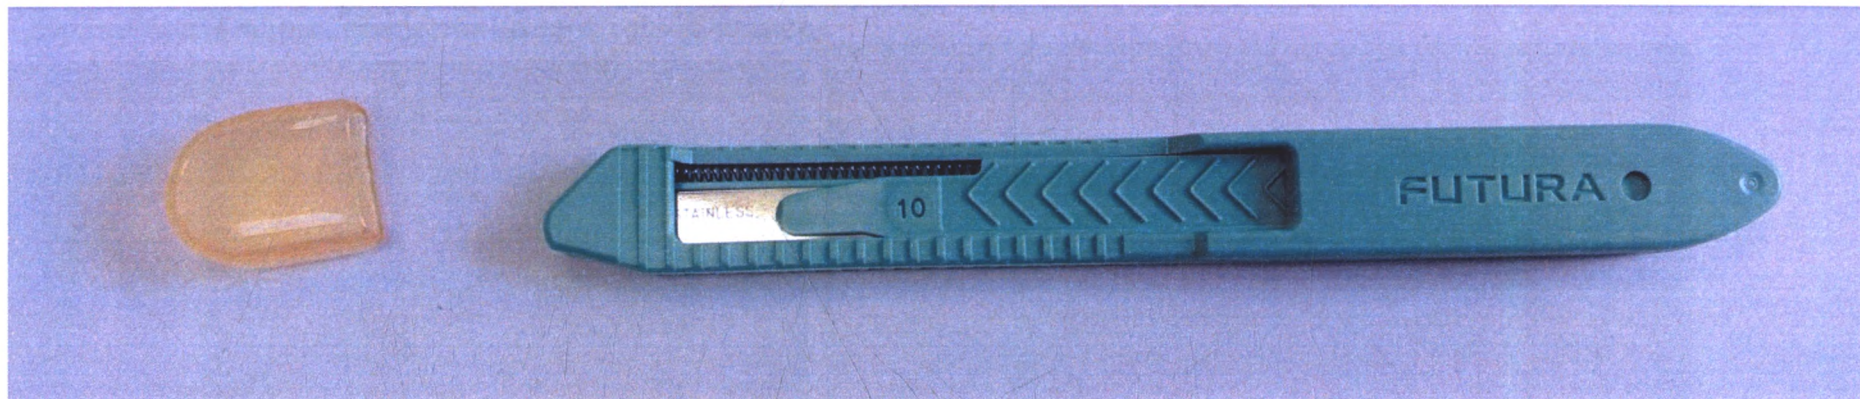


Общий вид принадлежности

- Держатель для острых предметов «ШортСтоп» (Shortstop).



Маркировка принадлежности

- Держатель для острых предметов «ШортСтоп» (Shortstop).

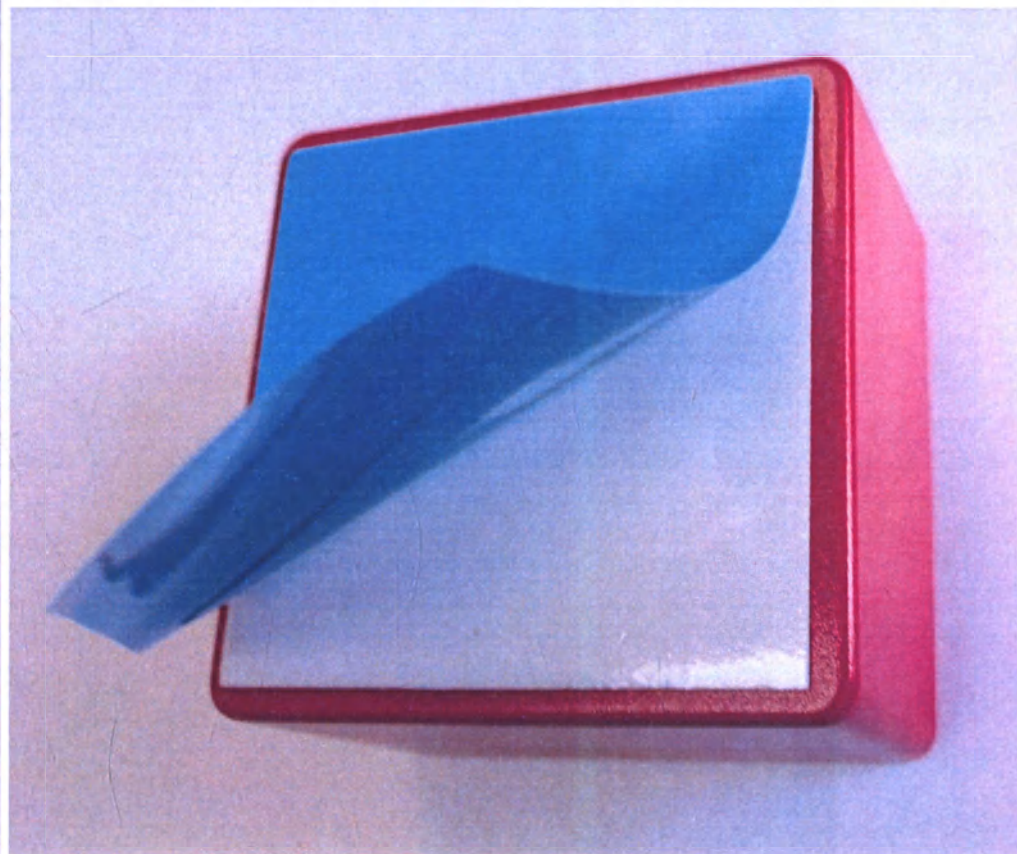

Общий вид принадлежности

- Держатель для острых предметов «ШортСтоп Эдвэнтейдж» (ShortStop Advantage).



Маркировка принадлежности

- Держатель для острых предметов «ШортСтоп Эдвэнтайдж» (ShortStop Advantage).



Общий вид принадлежности

УПП: ООО «Мерит Текноподжис»
Россия, 119017 г. Москва
1-й Казачий переулок, дом 7
1 этаж, ком.6
Телефон / факс +7 495 221 89 02



Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/12606 от 29.12.2017


Номер по каталогу: SS30 23.01.2019

Держатель для острых предметов Грандстэнд (Grandstand).
Нетоксично. Транспортировать при температуре от -35°C до
+55°C. Хранить при температуре от +5°C до +27°C




GRANDSTAND[®]

ShortStop[™]



Temporary Sharps Holder

CAUTION: All needles should be flushed prior to use.



Do not use if
package is damaged

CE 0086

STERILE EO



Do not
resterilize



Caution: Consult
accompanying
documents

CATALOG NUMBER

REF

SS30

カタログ番号

USE BEFORE

2022-01-31

LOT NUMBER

LOT

H1505879



ロット番号



Use once and destroy.
一回使用後、一回に限り廃棄。

Rx ONLY

1 UNIT
MADE IN USA



Manufacturer
Merit Medical Systems, Inc., South Jordan,
Utah 84095 U.S.A. 1-801-250-1900
U.S.A. Customer Service 1-800-535-3748

EC REP

Authorized Representative
Merit Medical Ireland Ltd
Parkmore Business Park, Freetown,
Galway, Ireland

www.merit.com

800581000-0
© 000000



Q4s7:50 LFWNM0007 REV 005 02/17


0010

01/23/2019



www.merit.com

- Держатель для острых предметов «Грэндстэнд» (Grandstand).

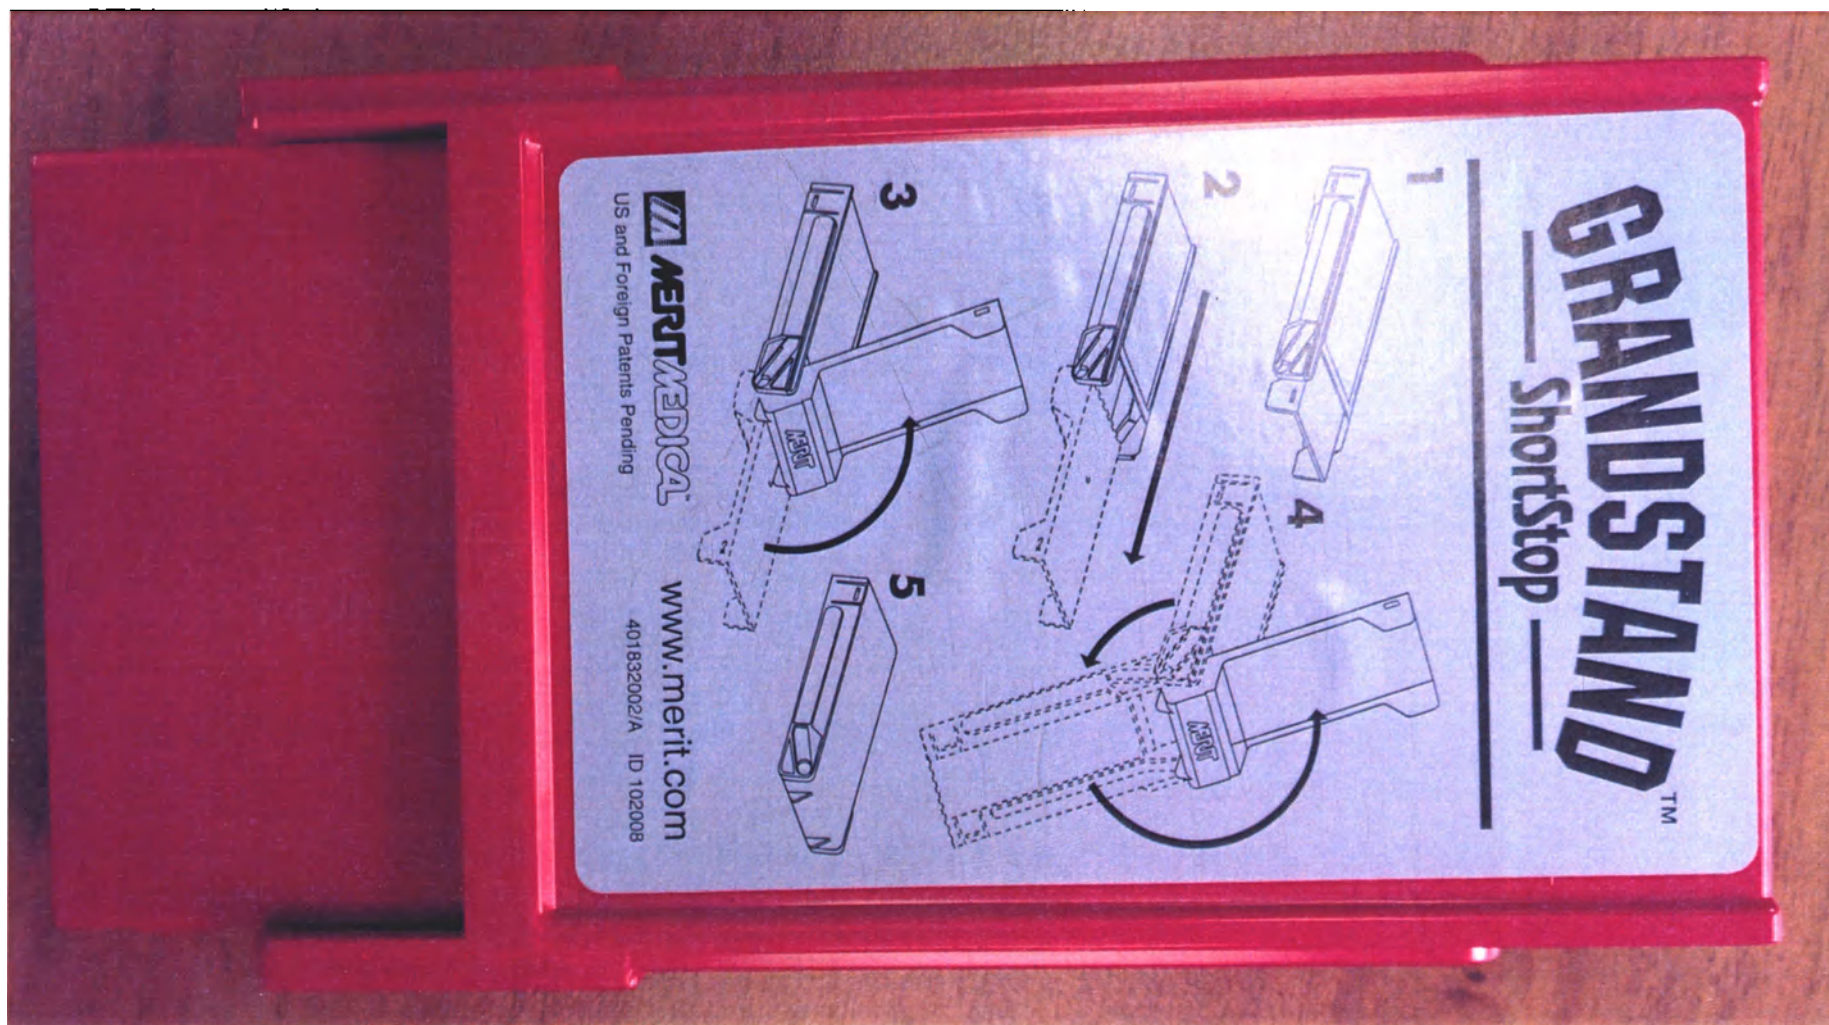

Общий вид принадлежности в собранном виде

- Держатель для острых предметов «Грэндстэнд» (Grandstand).



Общий вид принадлежности в собранном состоянии

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ШАЛАМОВ А.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью и подписью

33

листа / листов

