

Фотографические изображения МИ

«Реагенты, контрольные и расходные материалы для анализаторов газов крови и электролитов»



ООО «Рош Диагностика Рус»

Россия, 115114, Москва
ул. Летниковская, дом 2, стр. 3
Бизнес-центр "Вивальди Плаза"

Тел.: +7 (495) 229 69 99
Факс: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru

Roche Diagnostics Rus LLC

2, Letnikovskaya street, bld. 3
Business Center "Vivaldi Plaza"
115114, Moscow, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 99
Fax: +7 (495) 229 62 64


www.roche.ru

Snappak

REF 03112349 180



During and after use the fluid pack is contaminated. / Während und nach dem Gebrauch ist das Fluid Pack kontaminiert. /
Le fluid pack est contaminé pendant et après l'usage. / Durante y después del uso, el Fluid Pack está contaminado. /
Durante e dopo l'uso il Fluid Pack è contaminato. / Durante e após da utilização, o Fluid Pack está contaminado. /
Risegospakken er kontaminert under og etter bruk. / Under och efter användning är läsningspöckningen kontaminerad. /
Under og etter bruk vil væsken være kontaminert. / De vloeistofverpakking is tijdens en na gebruik gecontamineerd. /
Bahen použití a po něm je fluid pack kontaminován. / Počas a po použití je fluid pack kontaminovaný. / W trakcie
używania i po użyciu fluid pack ulega kontaminacji. / A felhasználás során és az használat után a folyadékpaczta (fluid pack)
szennyezett anyagként kezelendő. / Kauti na dopoužití seka jmo na jichon n poukovaosa ombezoprtuov tvoj jvolovjeln. /
Kullanım sırasında ve sonrasında sıvı paketi kontamine edilmiştir. / По време на и след употреба, флуидният пакет е замърсен. /
使用中及び使用後の本品は、微生物などによる感染の可能性があるのでご注意ください。 /
使用或使用过的液体试剂包已被污染



IVD

CE

15-30 °C

cobas®

04471750001 (03)

LOT

791411

2021-04-01

Реагенты, контрольные и расходные материалы для анализаторов газов крови и электролитов:

5. Реагенты в контейнере "SnapPac" 9180, 9181 (SnapPac 9180, 9181)

Регистрационное удостоверение № ФСЦ 2009/04530 от _____

Хранить при 15-30 °С. См. дату истечения срока годности на этикетке (максимальный срок годности - 24 месяца. Дату производства см. в сертификате анализа (по запросу)).
Номер лота см. на упаковке

Производитель: "Рош Диагностикас ГмбХ", Германия, Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

Во время и после использования контейнер с реагентом загрязнен

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностикас Рус» (ООО «Рош Диагностикас Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.1 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow_reception_dia@roche.com

Кат. номер: 03112349180

SnapPak

REF 03112349 180

Na⁺, K⁺, Cl⁻/Ca²⁺/Li⁺

AVL 9180, AVL 9181, 9180 EA



For USA: CONTENTS:

Standard A 350 mL
Standard B 85 mL
Standard C 85 mL
Reference Solution 100 mL

Rx only

COBAS and SNAPPAK are trademarks of Roche.
AVL is a trademark of AVL List GmbH.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
www.roche.com

Assembled for and distributed in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in USA



GTIN 04015630016488

REF 03112349180

LOT 791411

890396 RA


2021-04-01



cobas®


04011700001 (003)

Материал контрольный ISE-трол, уровни 1, 2, 3 (ISETROL, level 1, 2, 3)

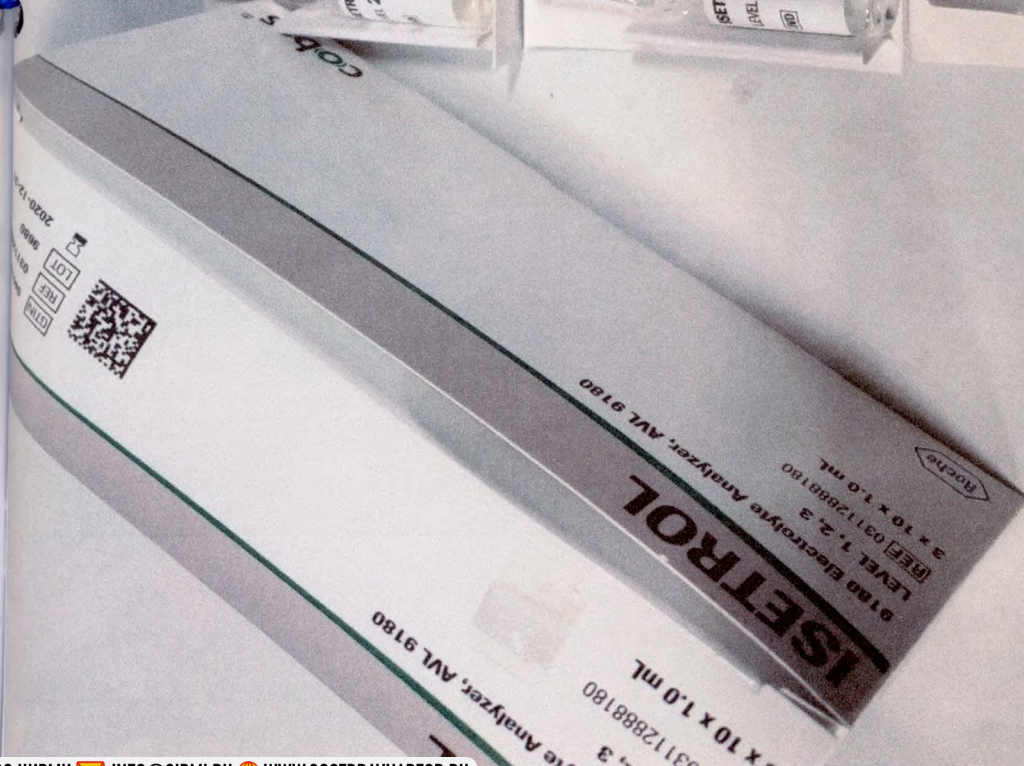





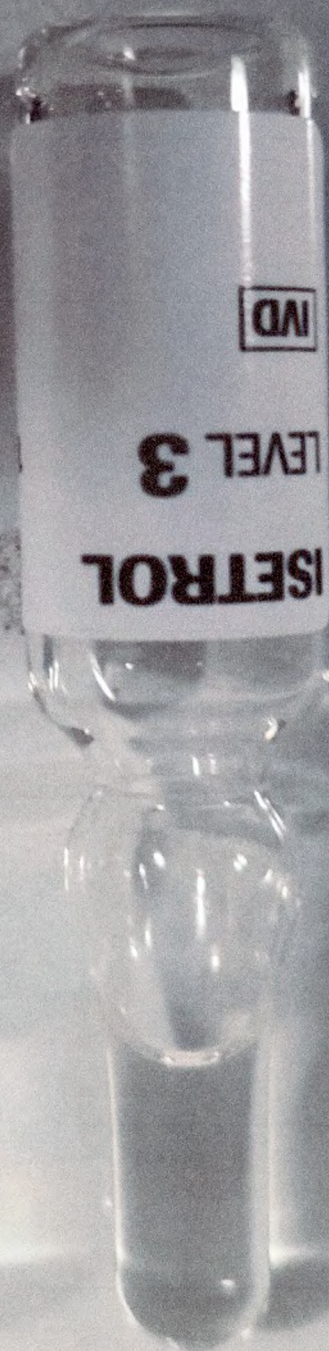

ISETROL

9180 Electrolyte Analyzer, AVL 9180

LEVEL 1, 2, 3

REF 03112888180

3 x 10 x 1.0 mL



Реагенты, контрольные и расходные материалы для анализаторов газов крови и электролитов:

7. Материал контрольный ISE-трал, уровень 1, 2, 3
(ISETROL level 1, 2, 3)

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04530 от _____

Хранить при 15-30 °С. См. дату истечения срока годности на этикетке (максимальный срок годности – 24 месяца. Дату производства см. в сертификате анализа (по запросу))

Номер лота см. на упаковке

Производитель: "Рош Диагностикас ГмбХ", Германия, Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер: 03112888180

cobas®

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
9 листа (ов)

Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 июля 2018