

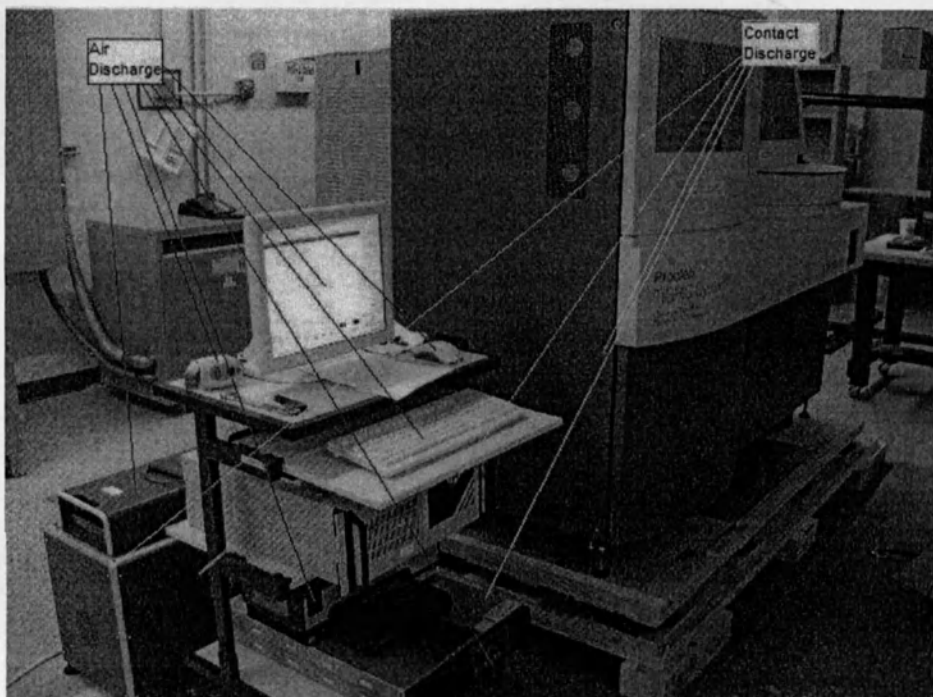


Фото 2

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технические характеристики испытанного образца: «Система аналитическая автоматическая Проклеикс Тигрис (Procleix Tigris) для молекулярно-диагностических исследований с принадлежностями», производства Gen-Probe Incorporated, USA, соответствуют требованиям ГОСТ Р 50267.0.2-2005, применимым к изделиям данного вида.

Ведущий по испытаниям

Ст. инженер

Инженер

Казаманов В.А.

Новичков А.Н.

**Протокол технических испытаний № 048/ЭМС-12**

от 21.03.2012 г. на 13 листах

Настоящий протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.  
Не допускается частичная или полная перепечатка настоящего протокола без разрешения  
ИЛЦ ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА России