

**«Система для СВЧ-обезвреживания
медицинских отходов «УОМО», в вариантах
исполнения по ТУ 32.50.50-001-75479167-2019»**

Фотографические изображения



Рис. 1 – Система для СВЧ-обезвреживания медицинских отходов «УОМО», в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-75479167-2019

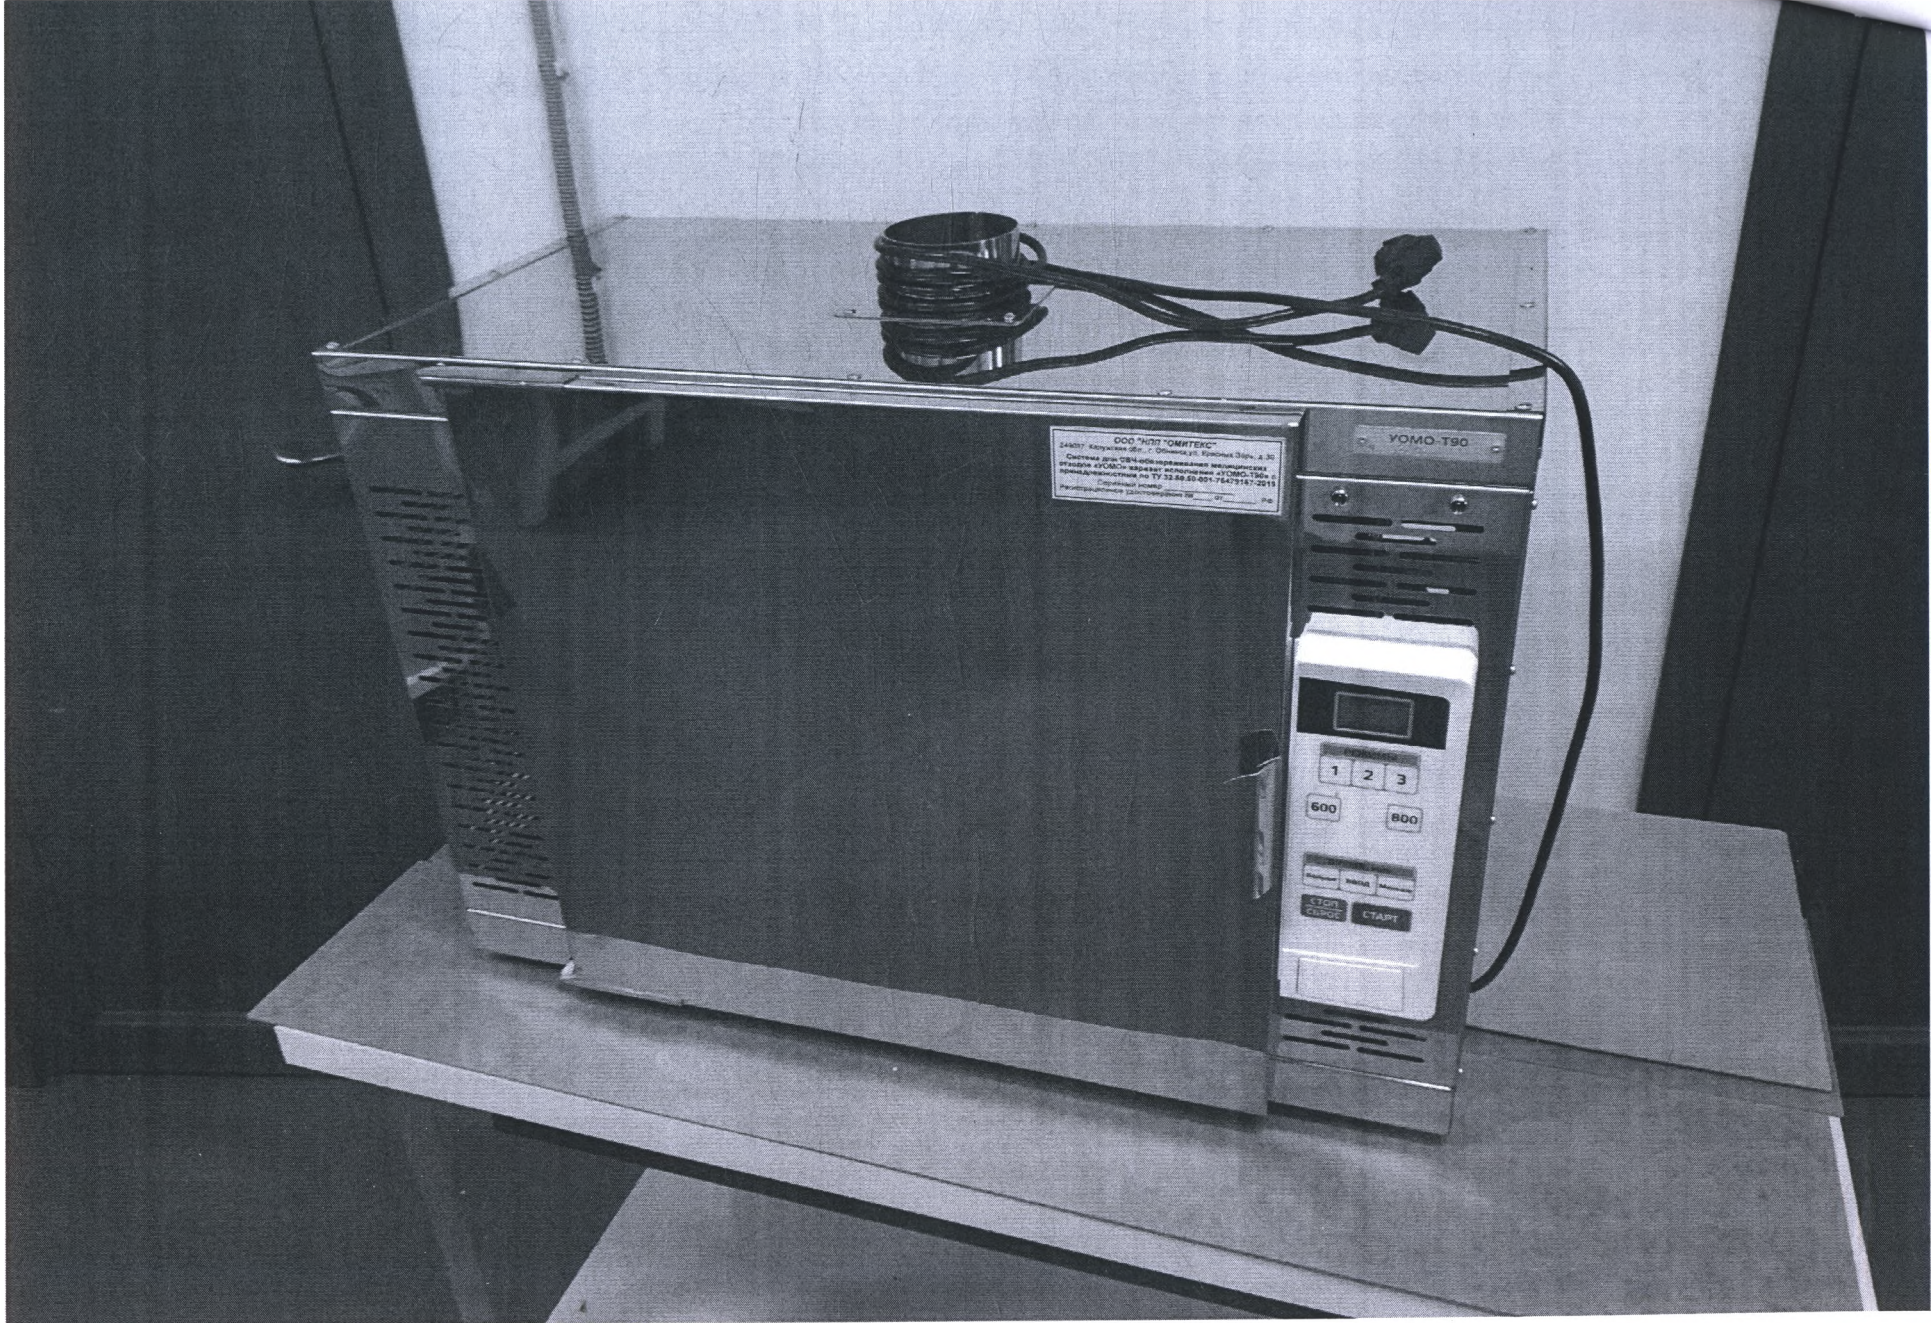


Рис. 2 – Установка для СВЧ-обезвреживания медицинских отходов УОМО-T90


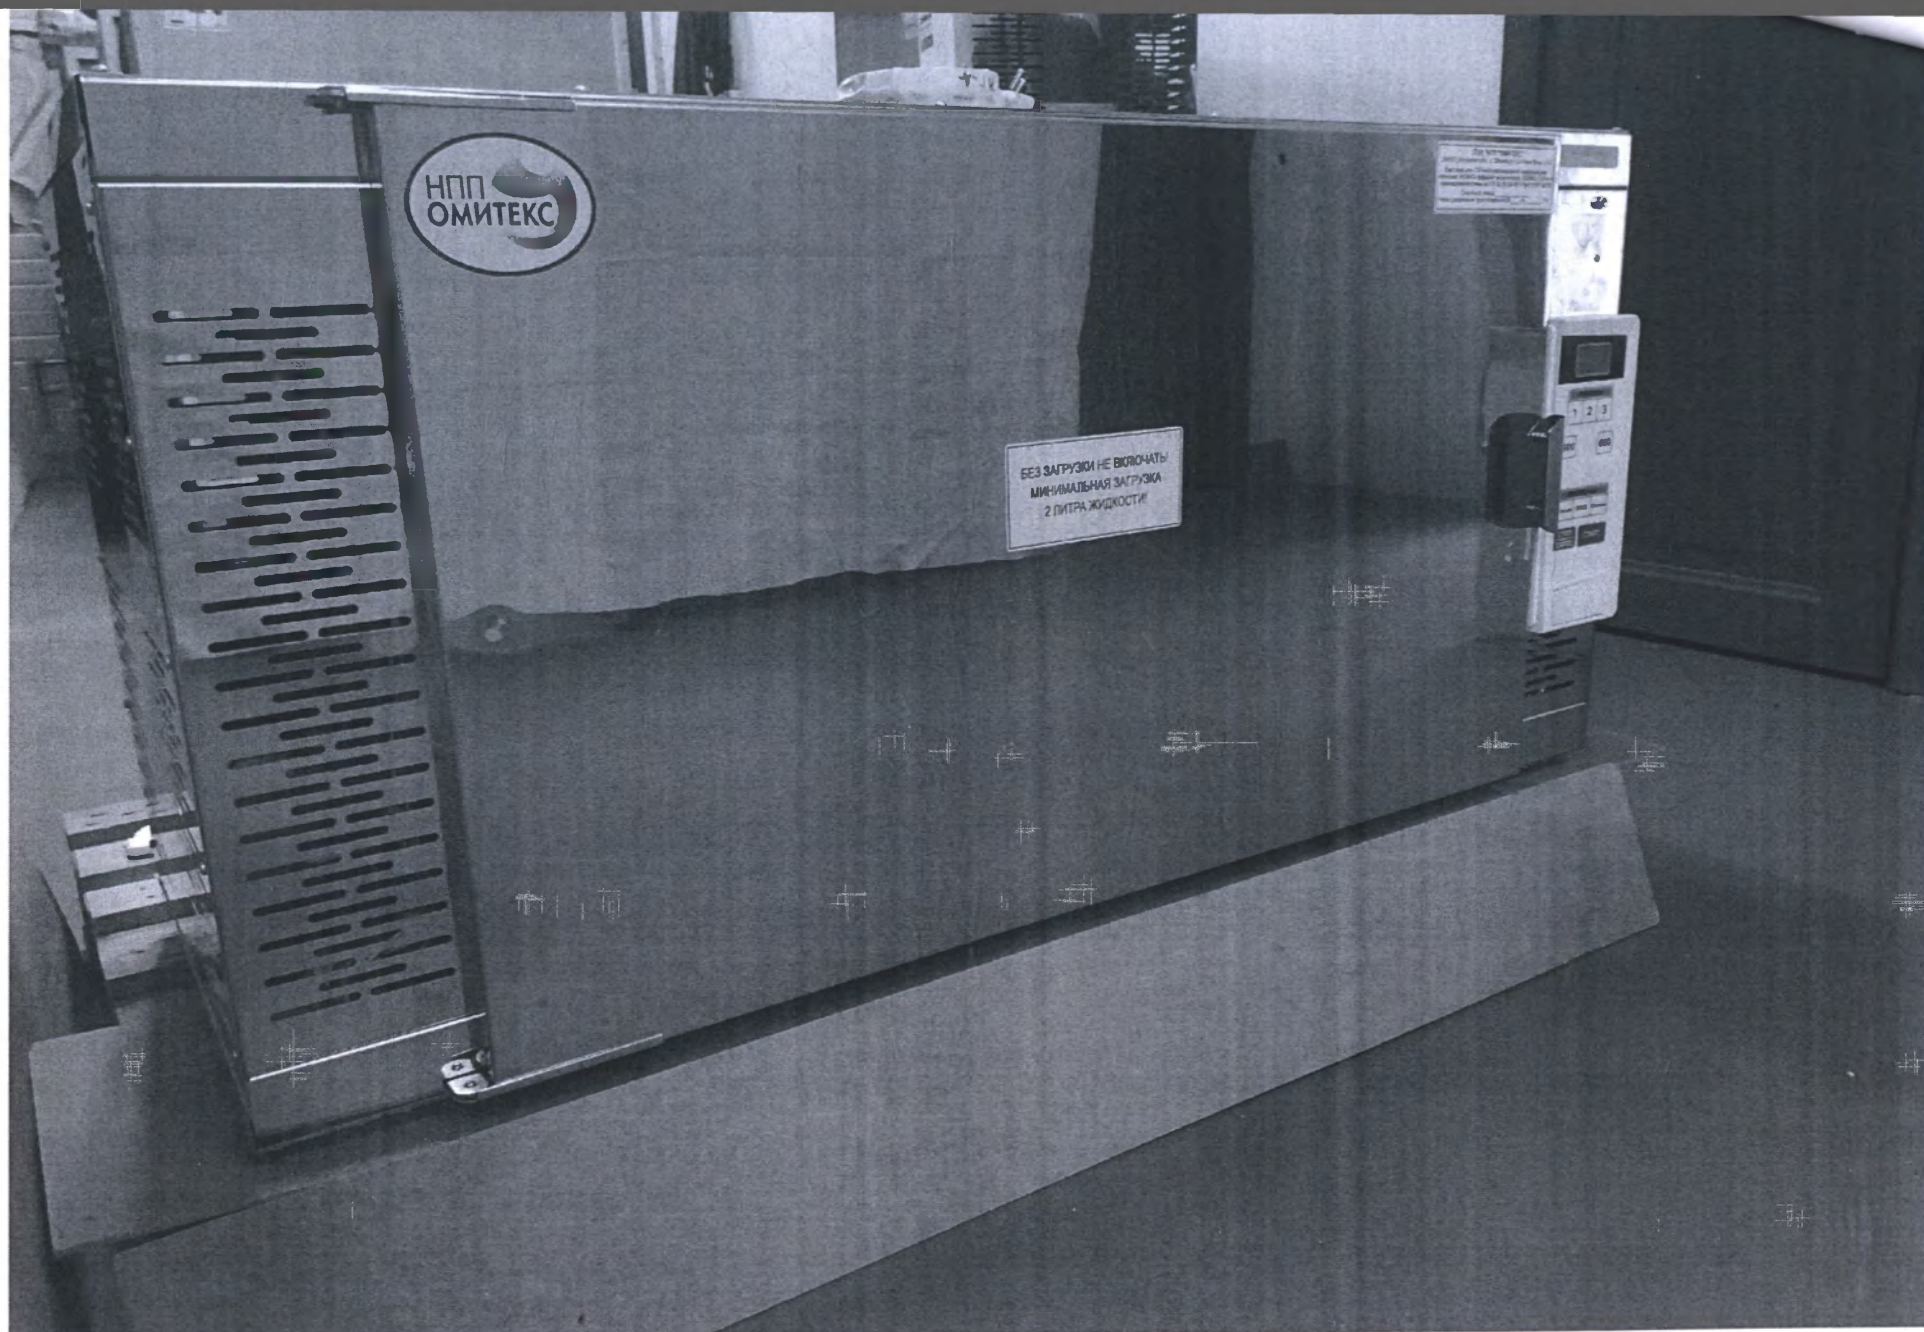


Рис. 3 – Установка для СВЧ-обезвреживания медицинских отходов УОМО-Т150



Рис. 4 – Маркировка. Установка для СВЧ-обезвреживания медицинских отходов УОМО-Т90

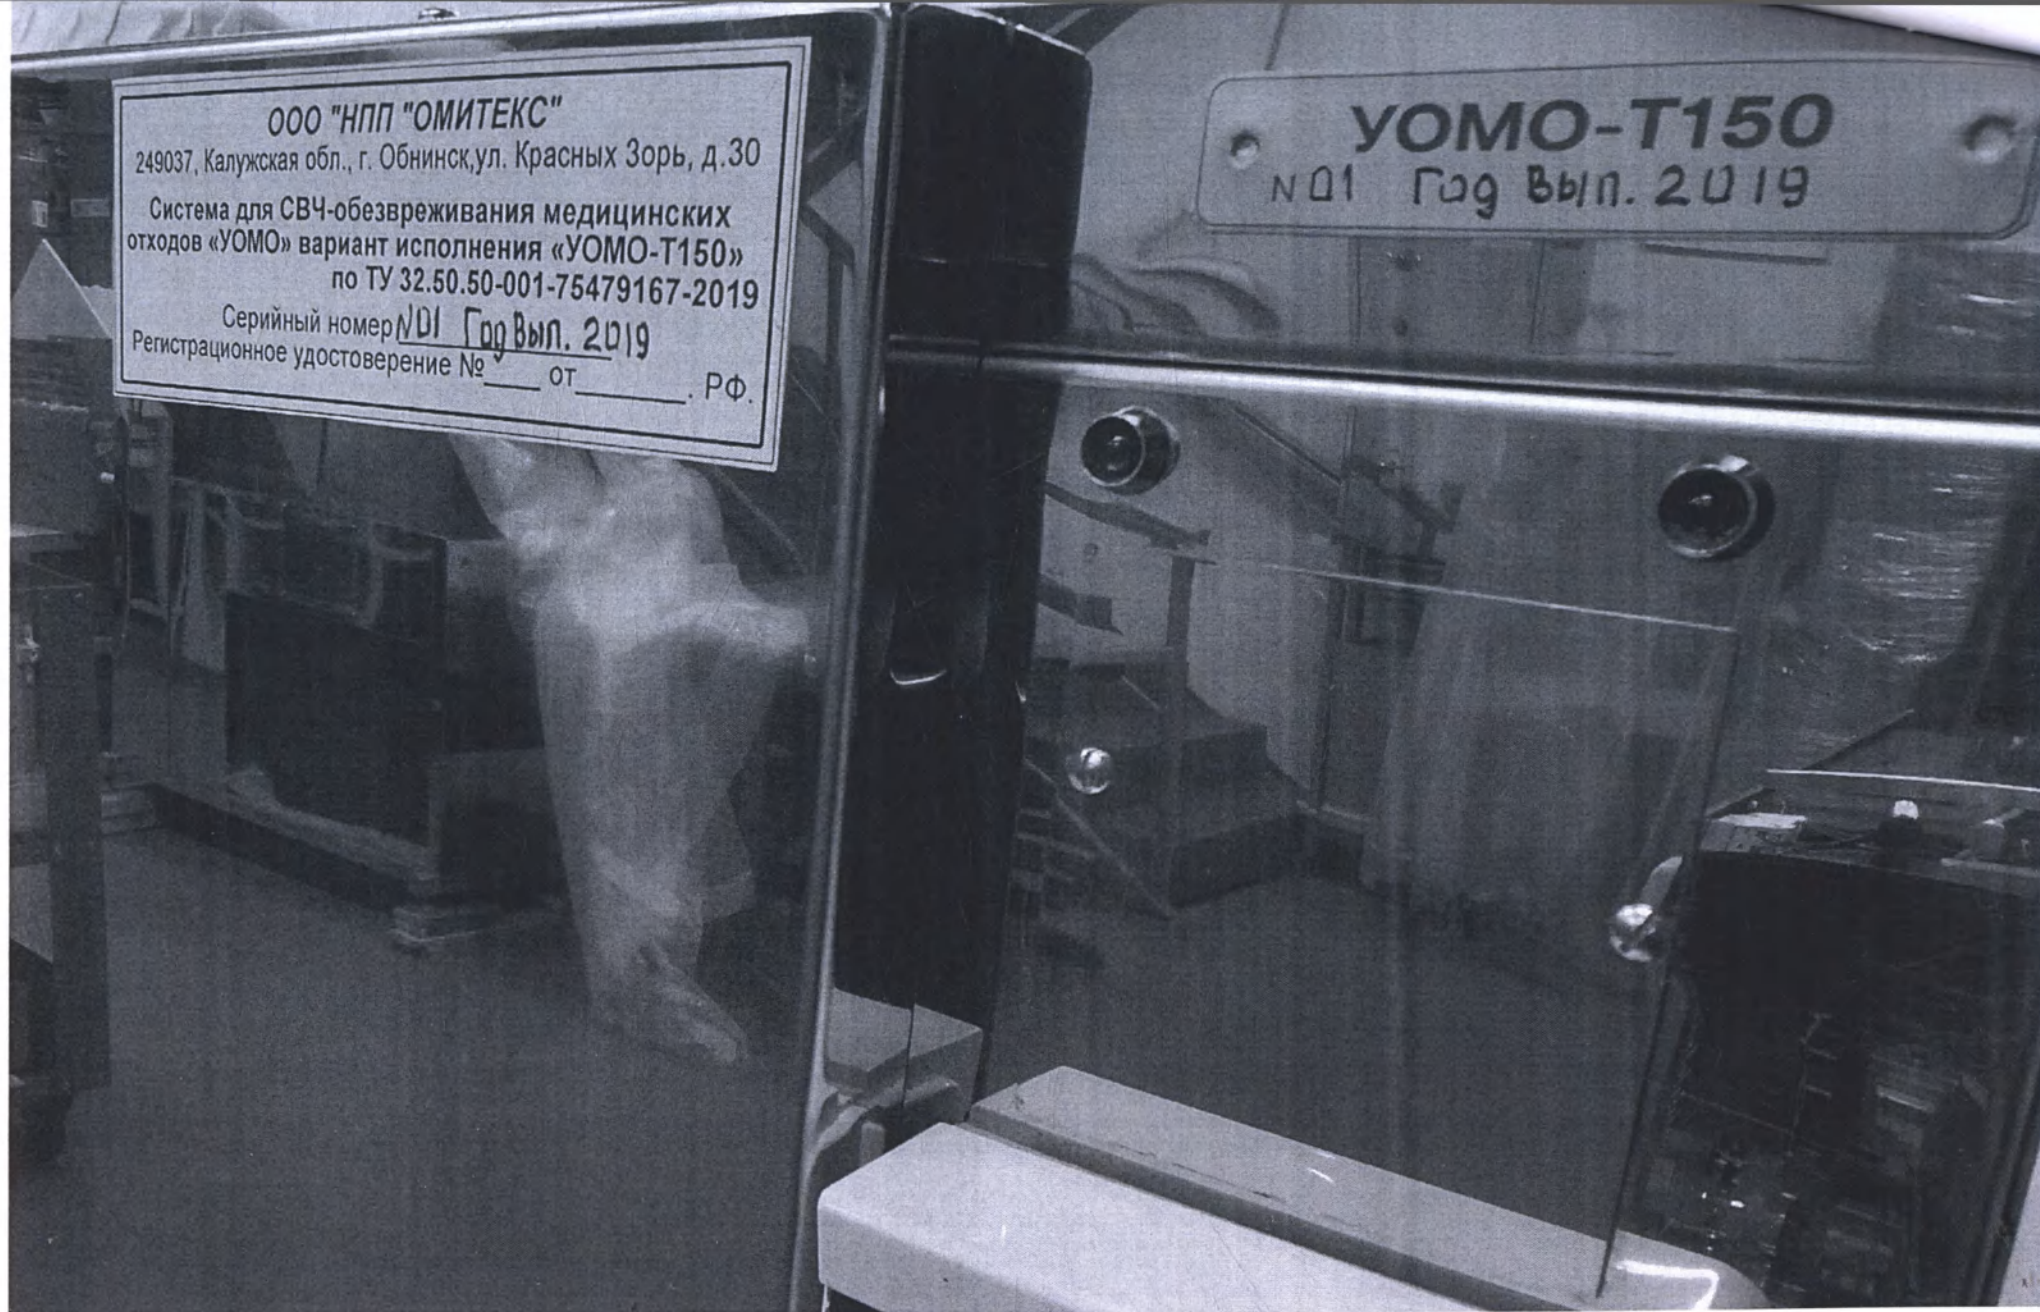

ООО "НПП "ОМИТЕКС"
249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д.30
Система для СВЧ-обезвреживания медицинских
отходов «YOMO» вариант исполнения «YOMO-T150»
по ТУ 32.50.50-001-75479167-2019
Серийный номер №1 Год Вып. 2019
Регистрационное удостоверение № _____ от _____. РФ.

YOMO-T150
№1 Год Вып. 2019

Рис. 5 – Маркировка. Установка для СВЧ-обезвреживания медицинских отходов YOMO-T150

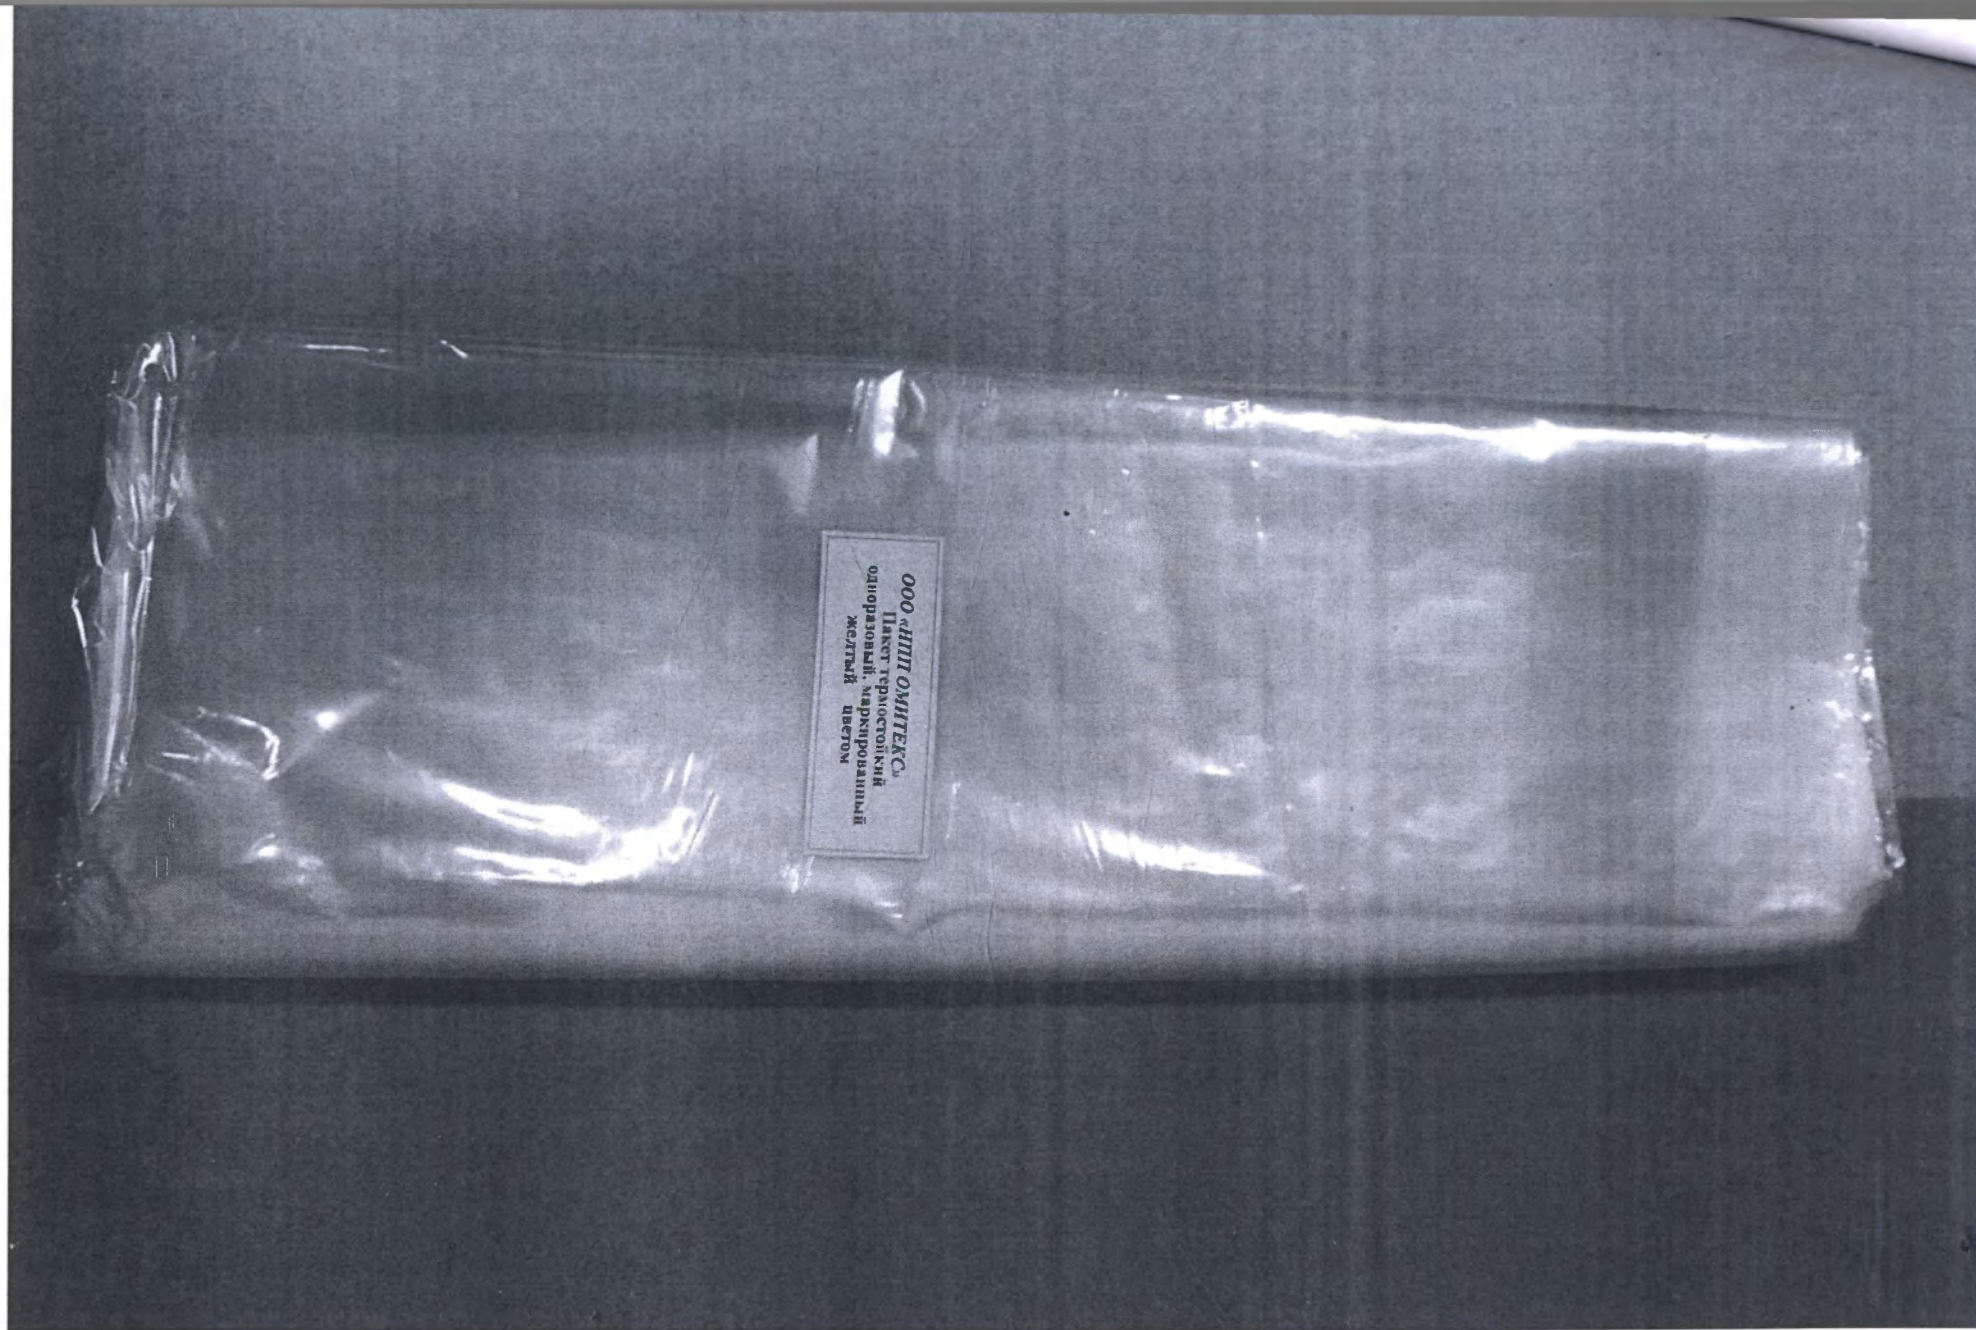


Рис.6 – Пакет термостойкий одноразовый, маркированный желтым цветом


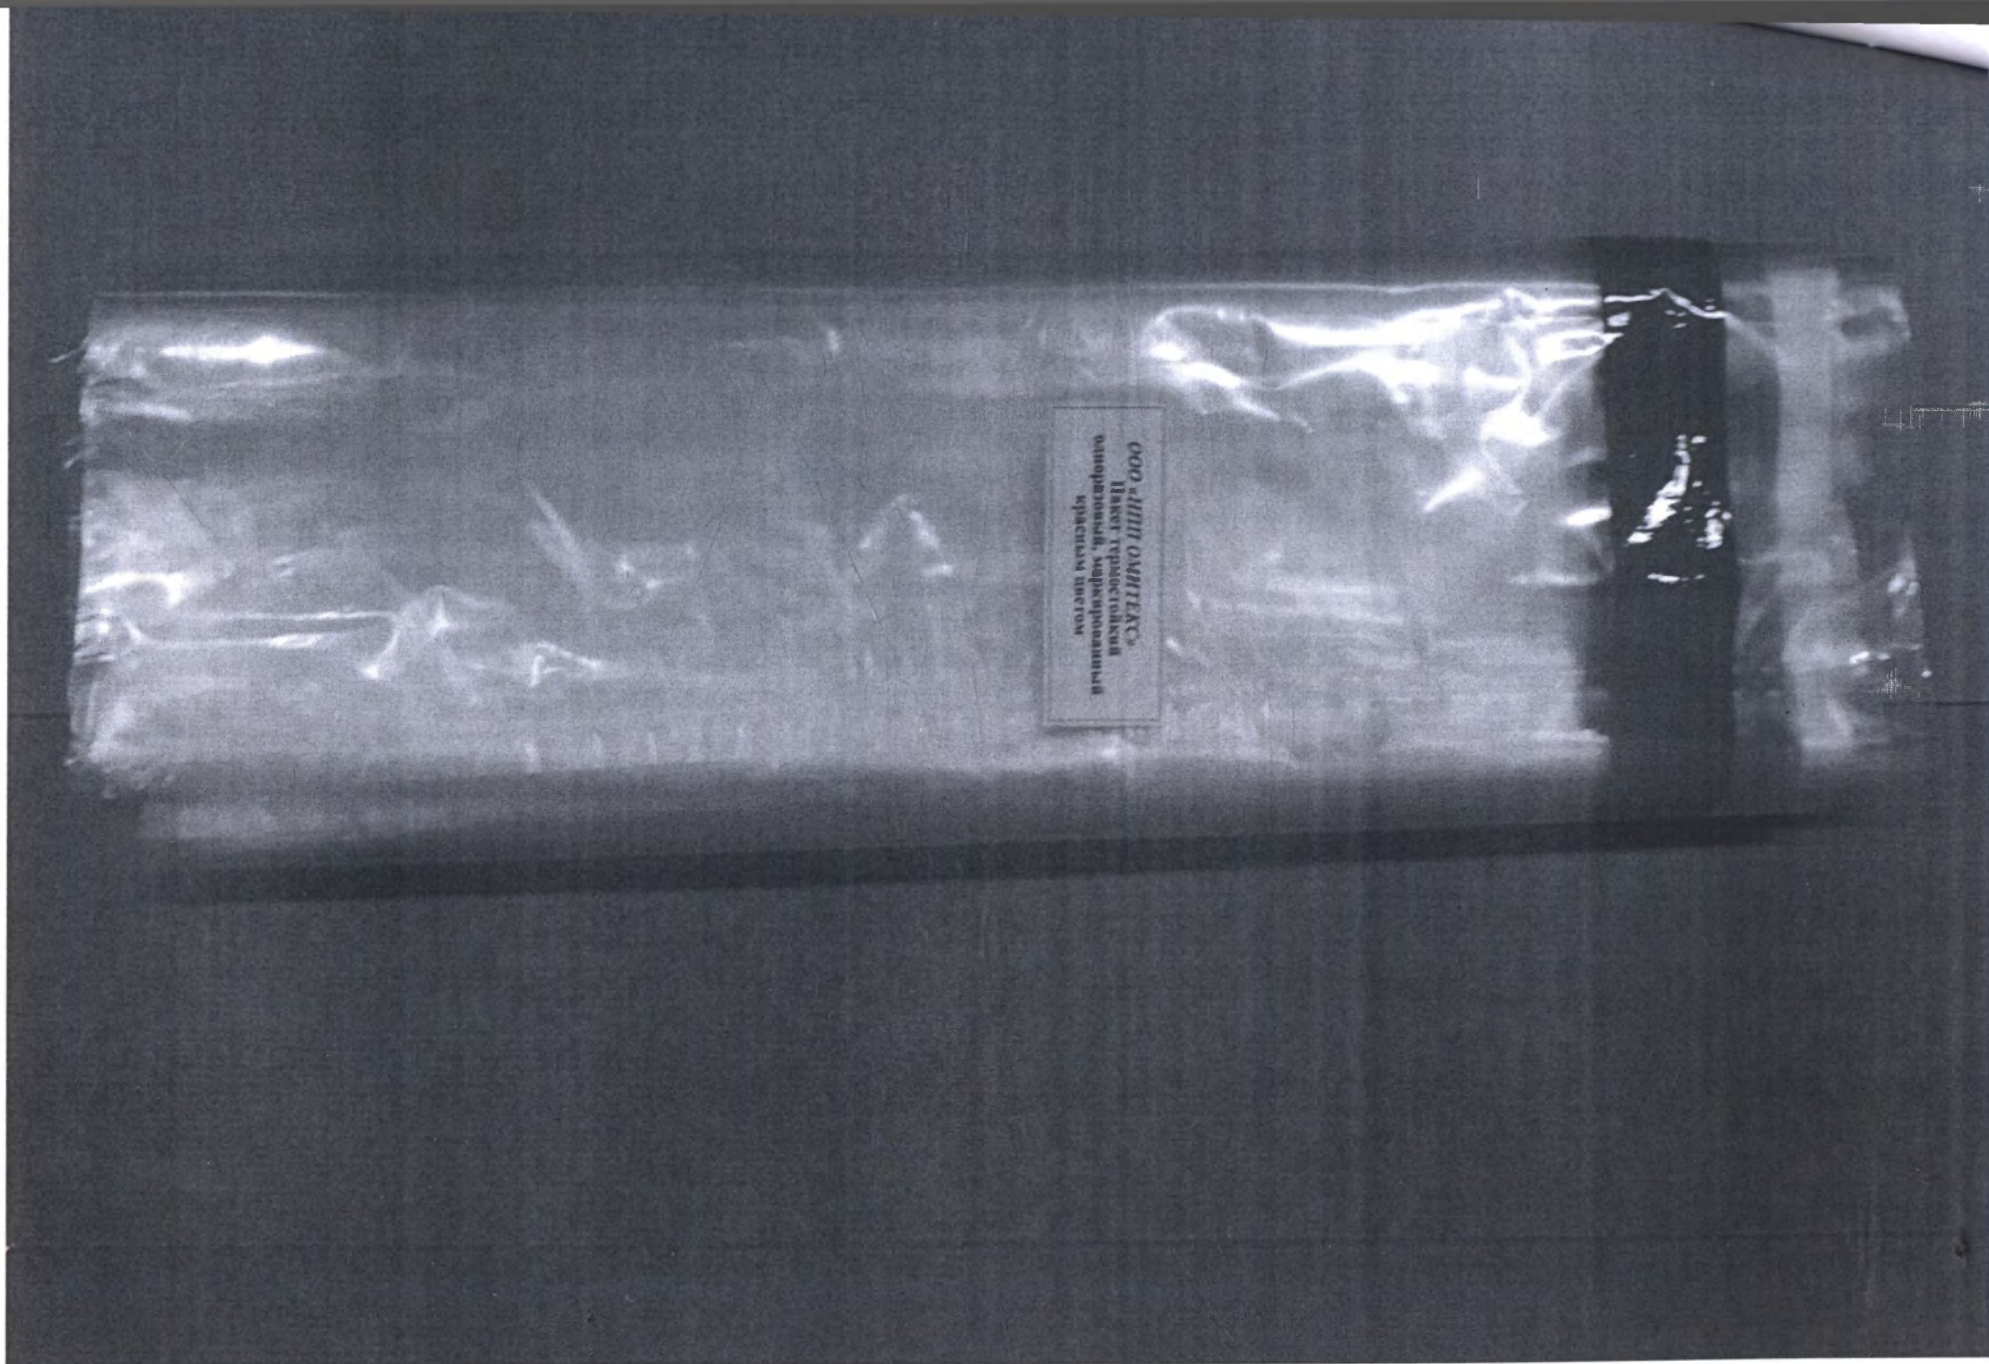


Рис.7 – Пакет термостойкий одноразовый, маркированный красным цветом

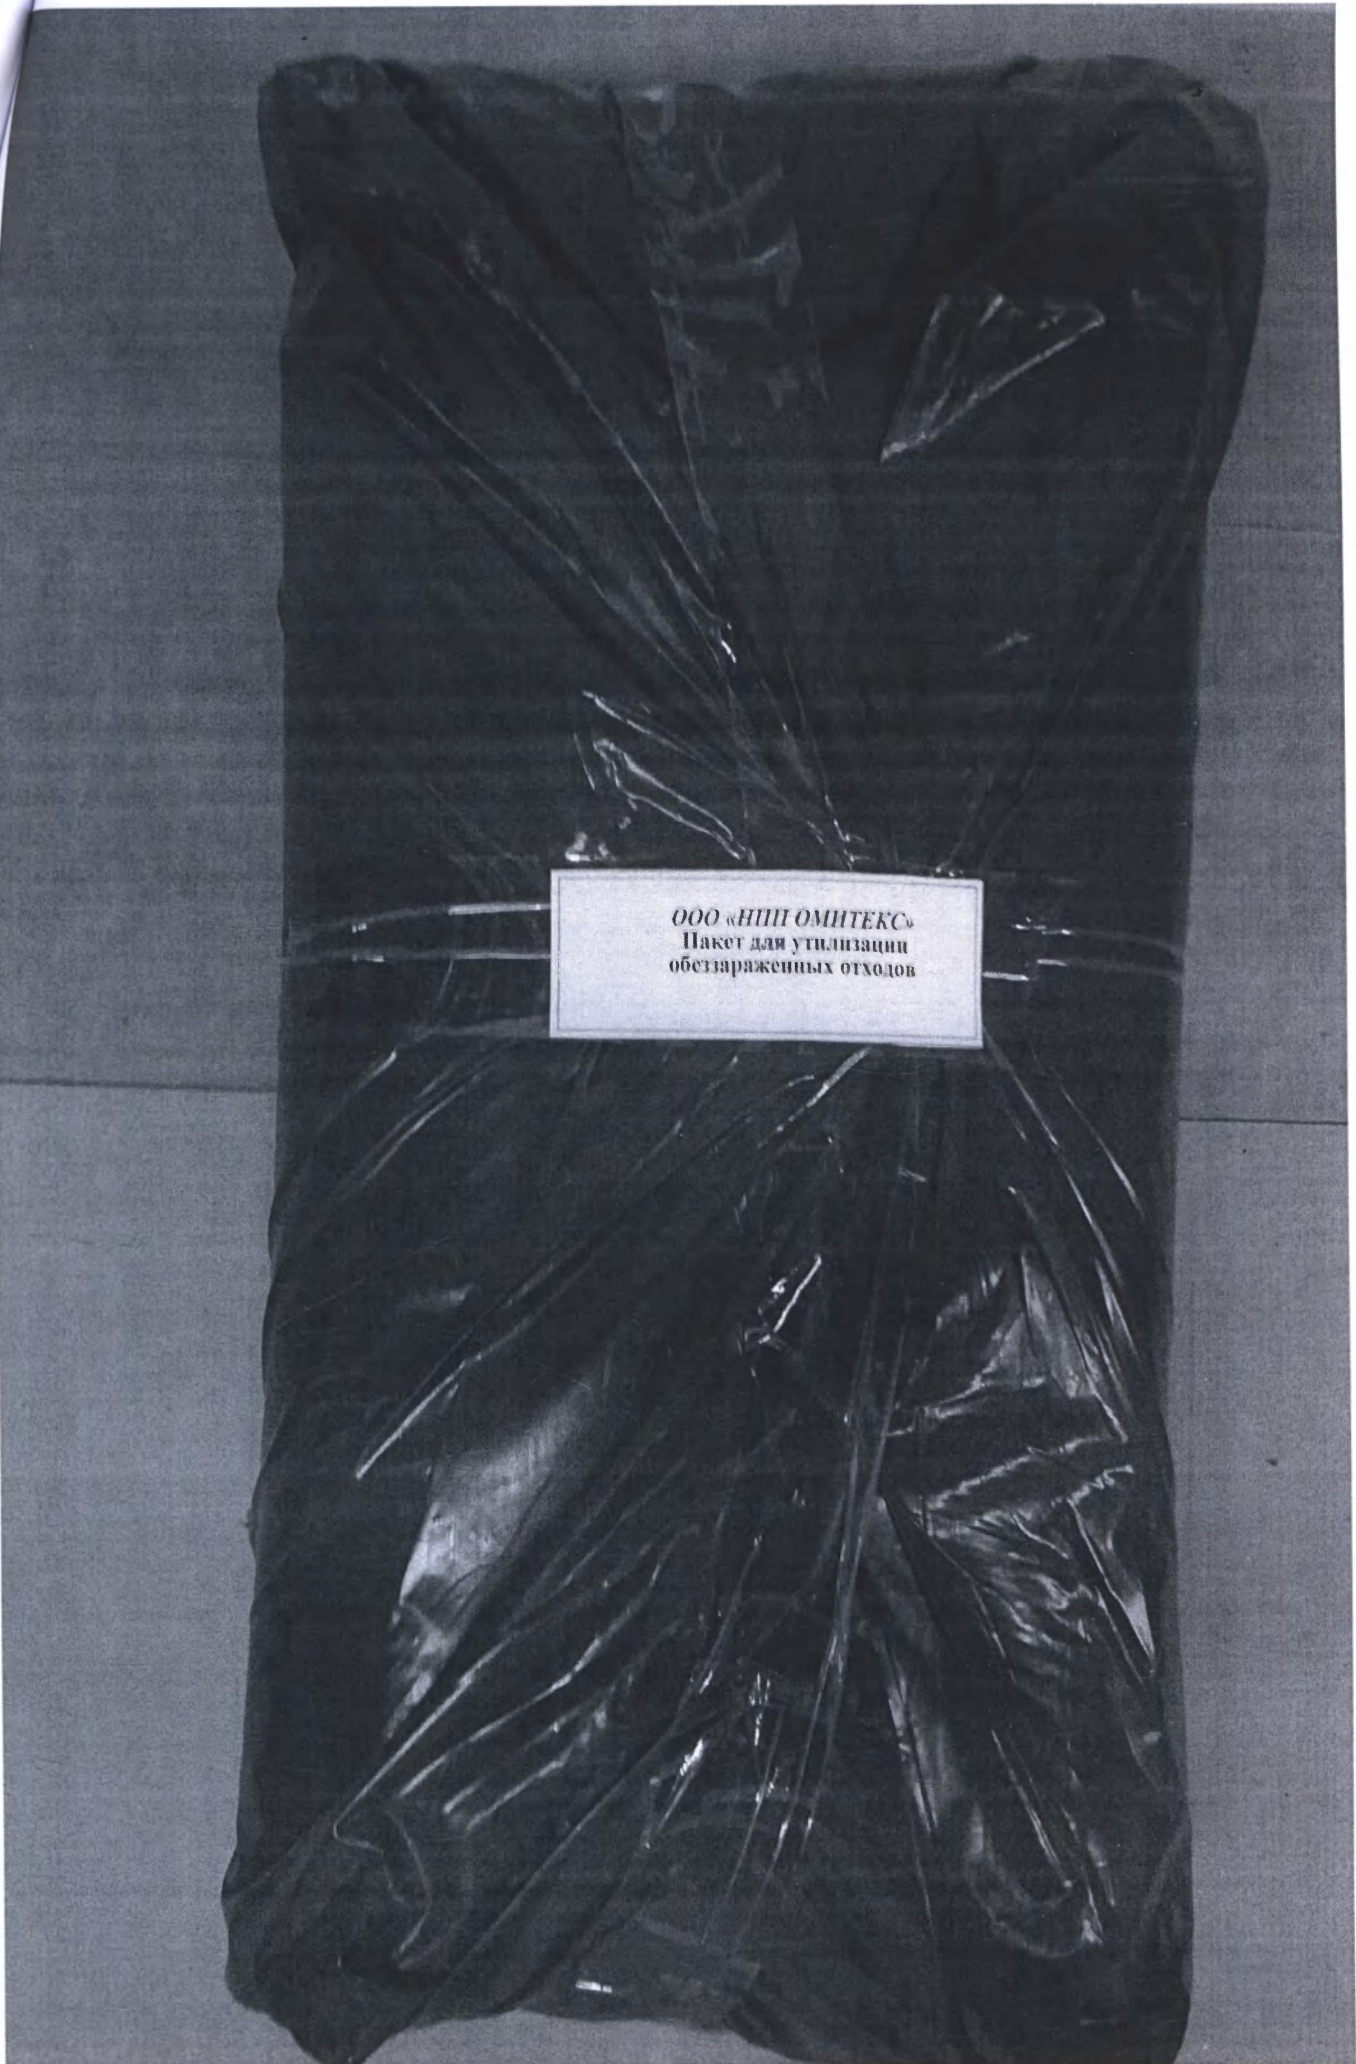


ООО «НПП ОМНТЕКС»
Пакет для утилизации
обеззараженных отходов

Рис 8 – Пакет для утилизации обеззараженных отходов



Рис.9 – Бак эксплуатационный термостойкий с крышкой, содержащий фильтр-насадку

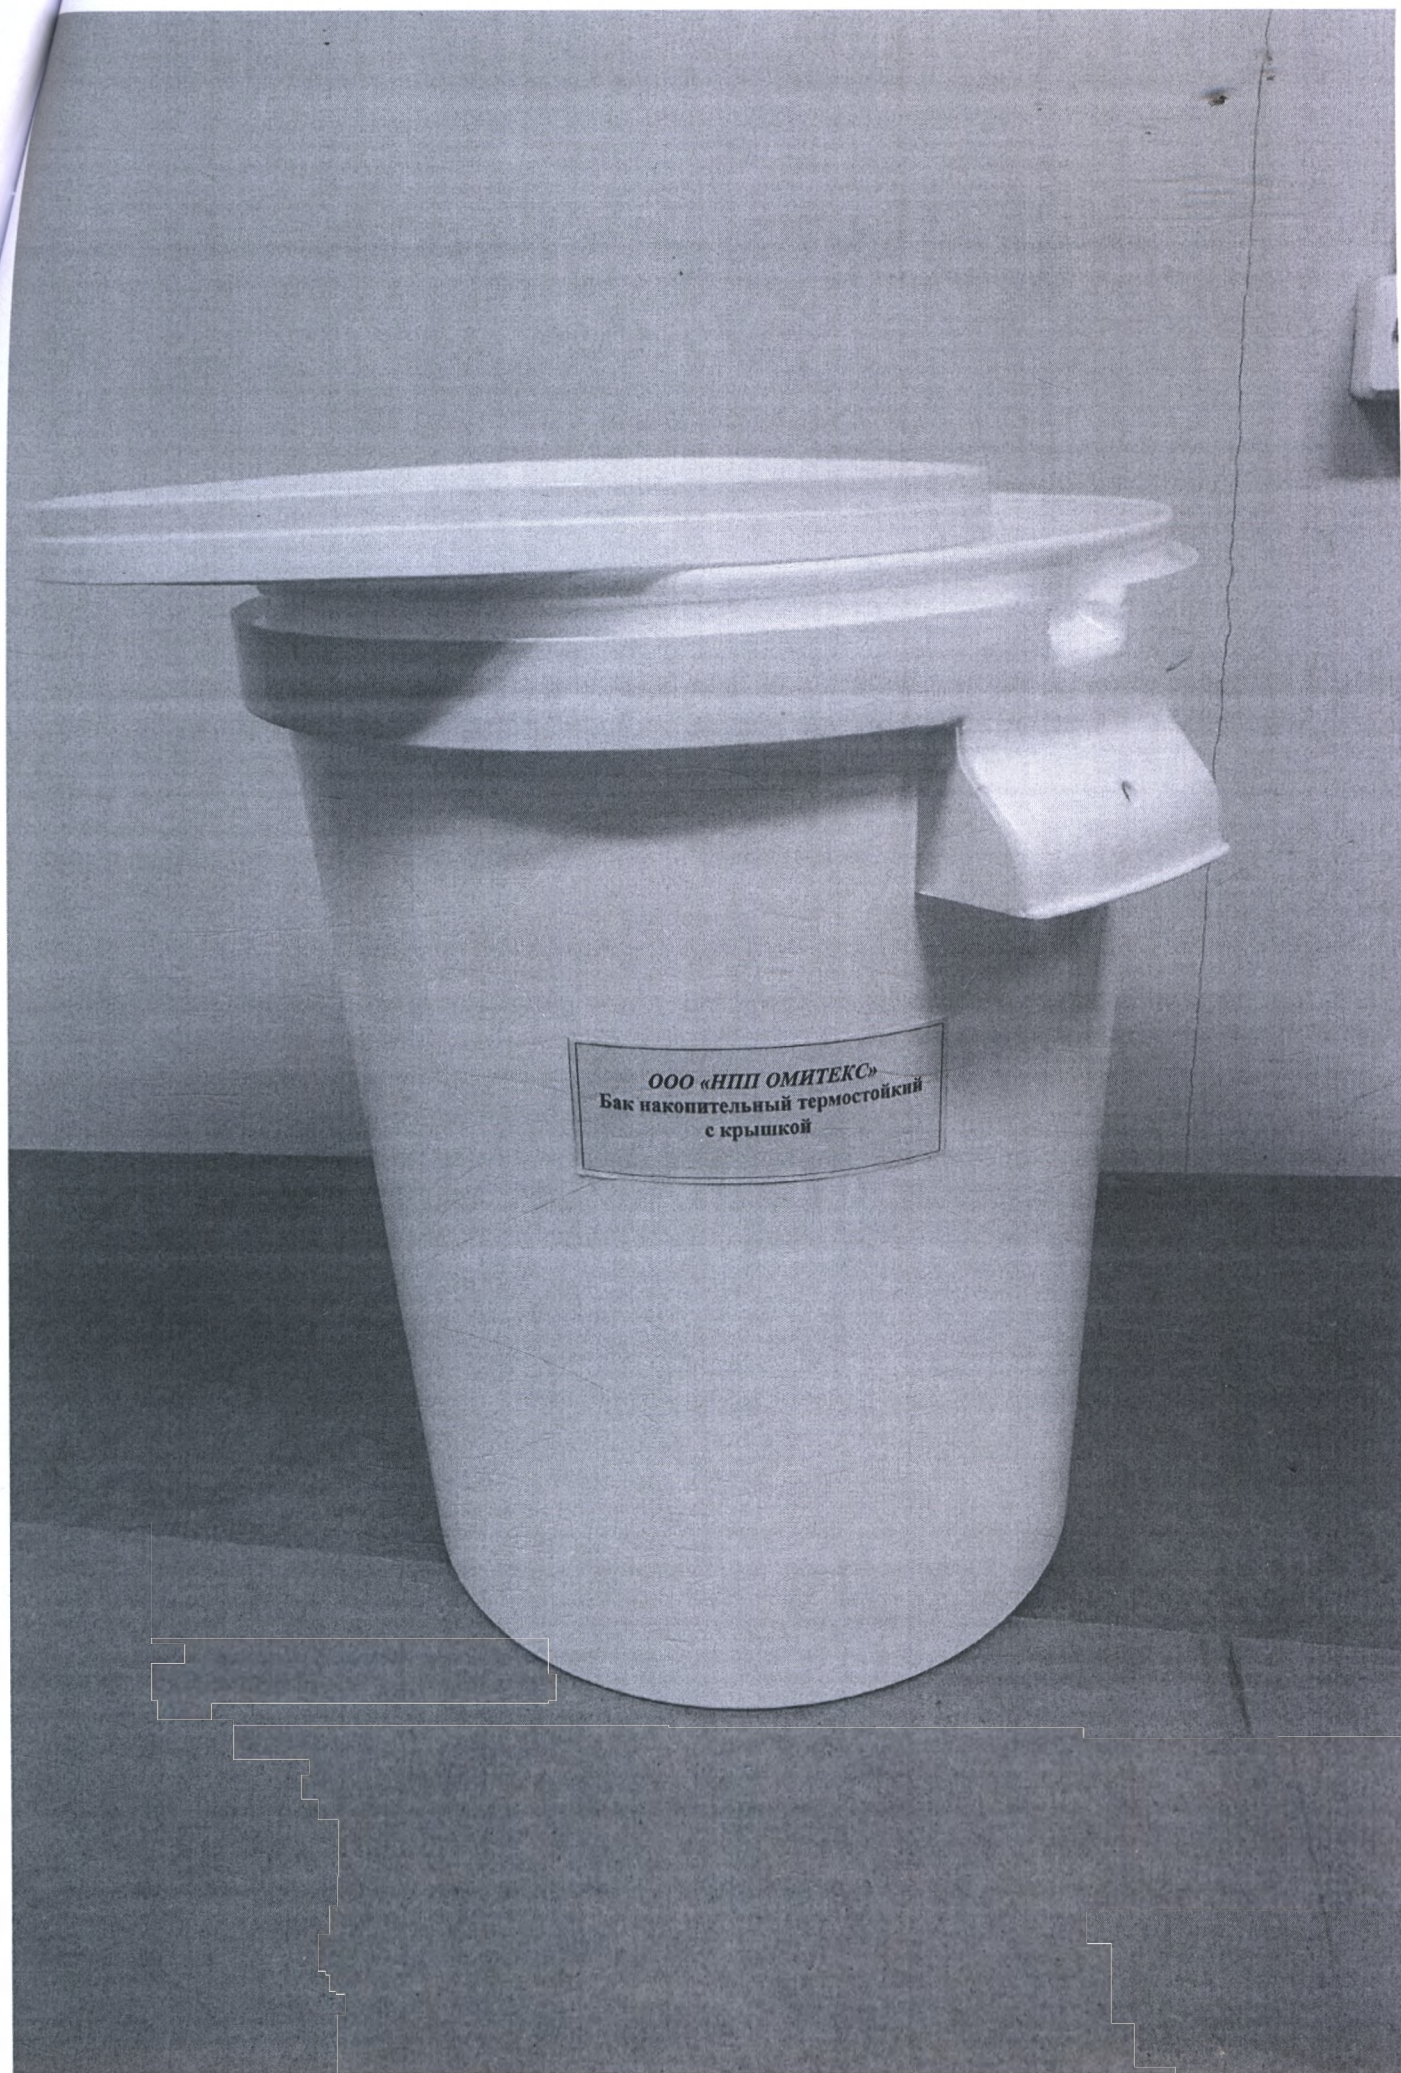

ООО «НПП ОМИТЕКС»
Бак накопительный термостойкий
с крышкой

Рис.10 – Бак накопительный термостойкий с крышкой



Рис.11 – Контейнер для дезинфекции 0,12 л



Рис.12 – Контейнер для дезинфекции 1,0 л

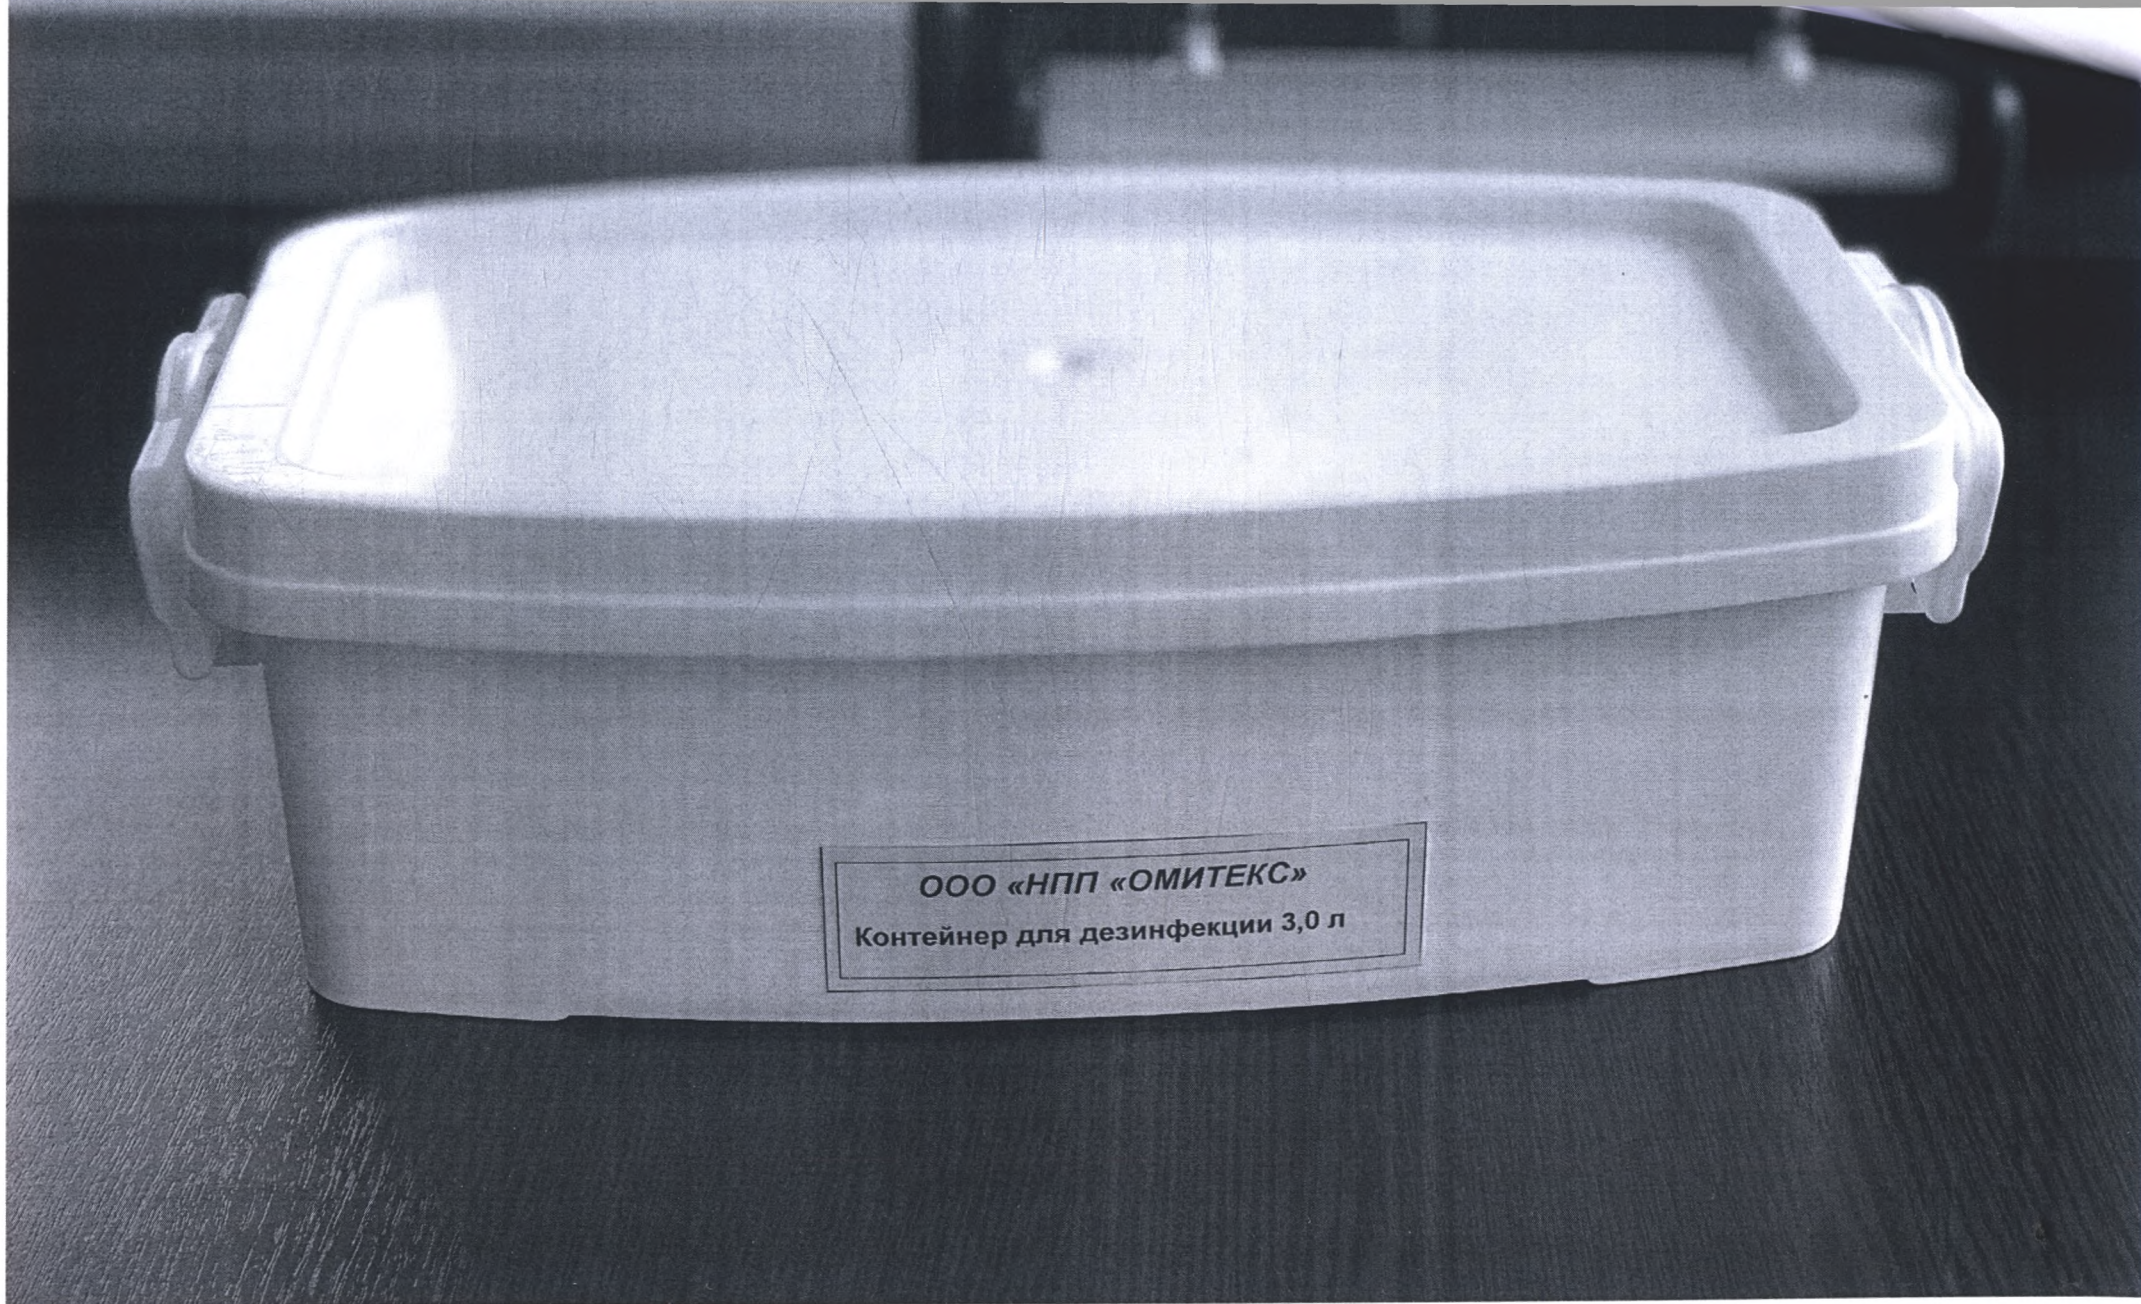
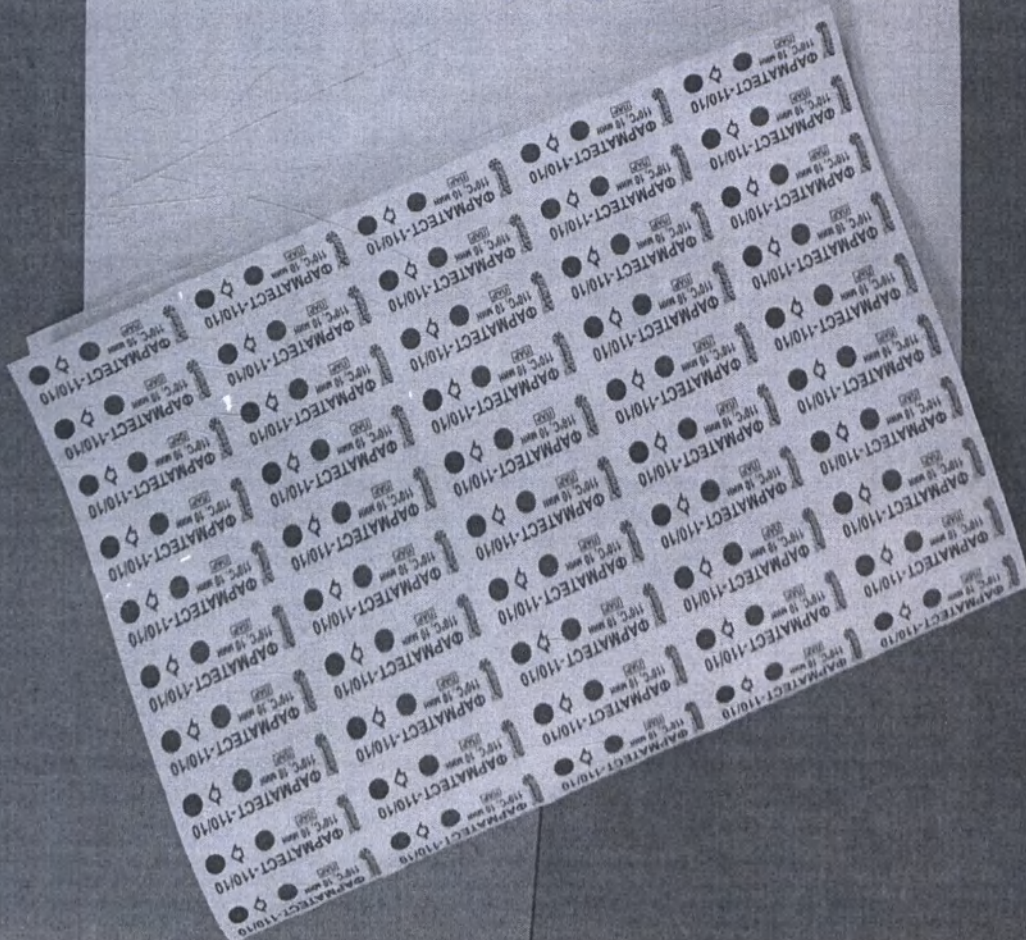


Рис.13 – Контейнер для дезинфекции 3,0 л



Рис.14 – Раствор сенсibilизатора СВЧ-обеззараживания

ООО «НПШ ОМИТЕКС»
Индикатор «Фарматест-110/10»



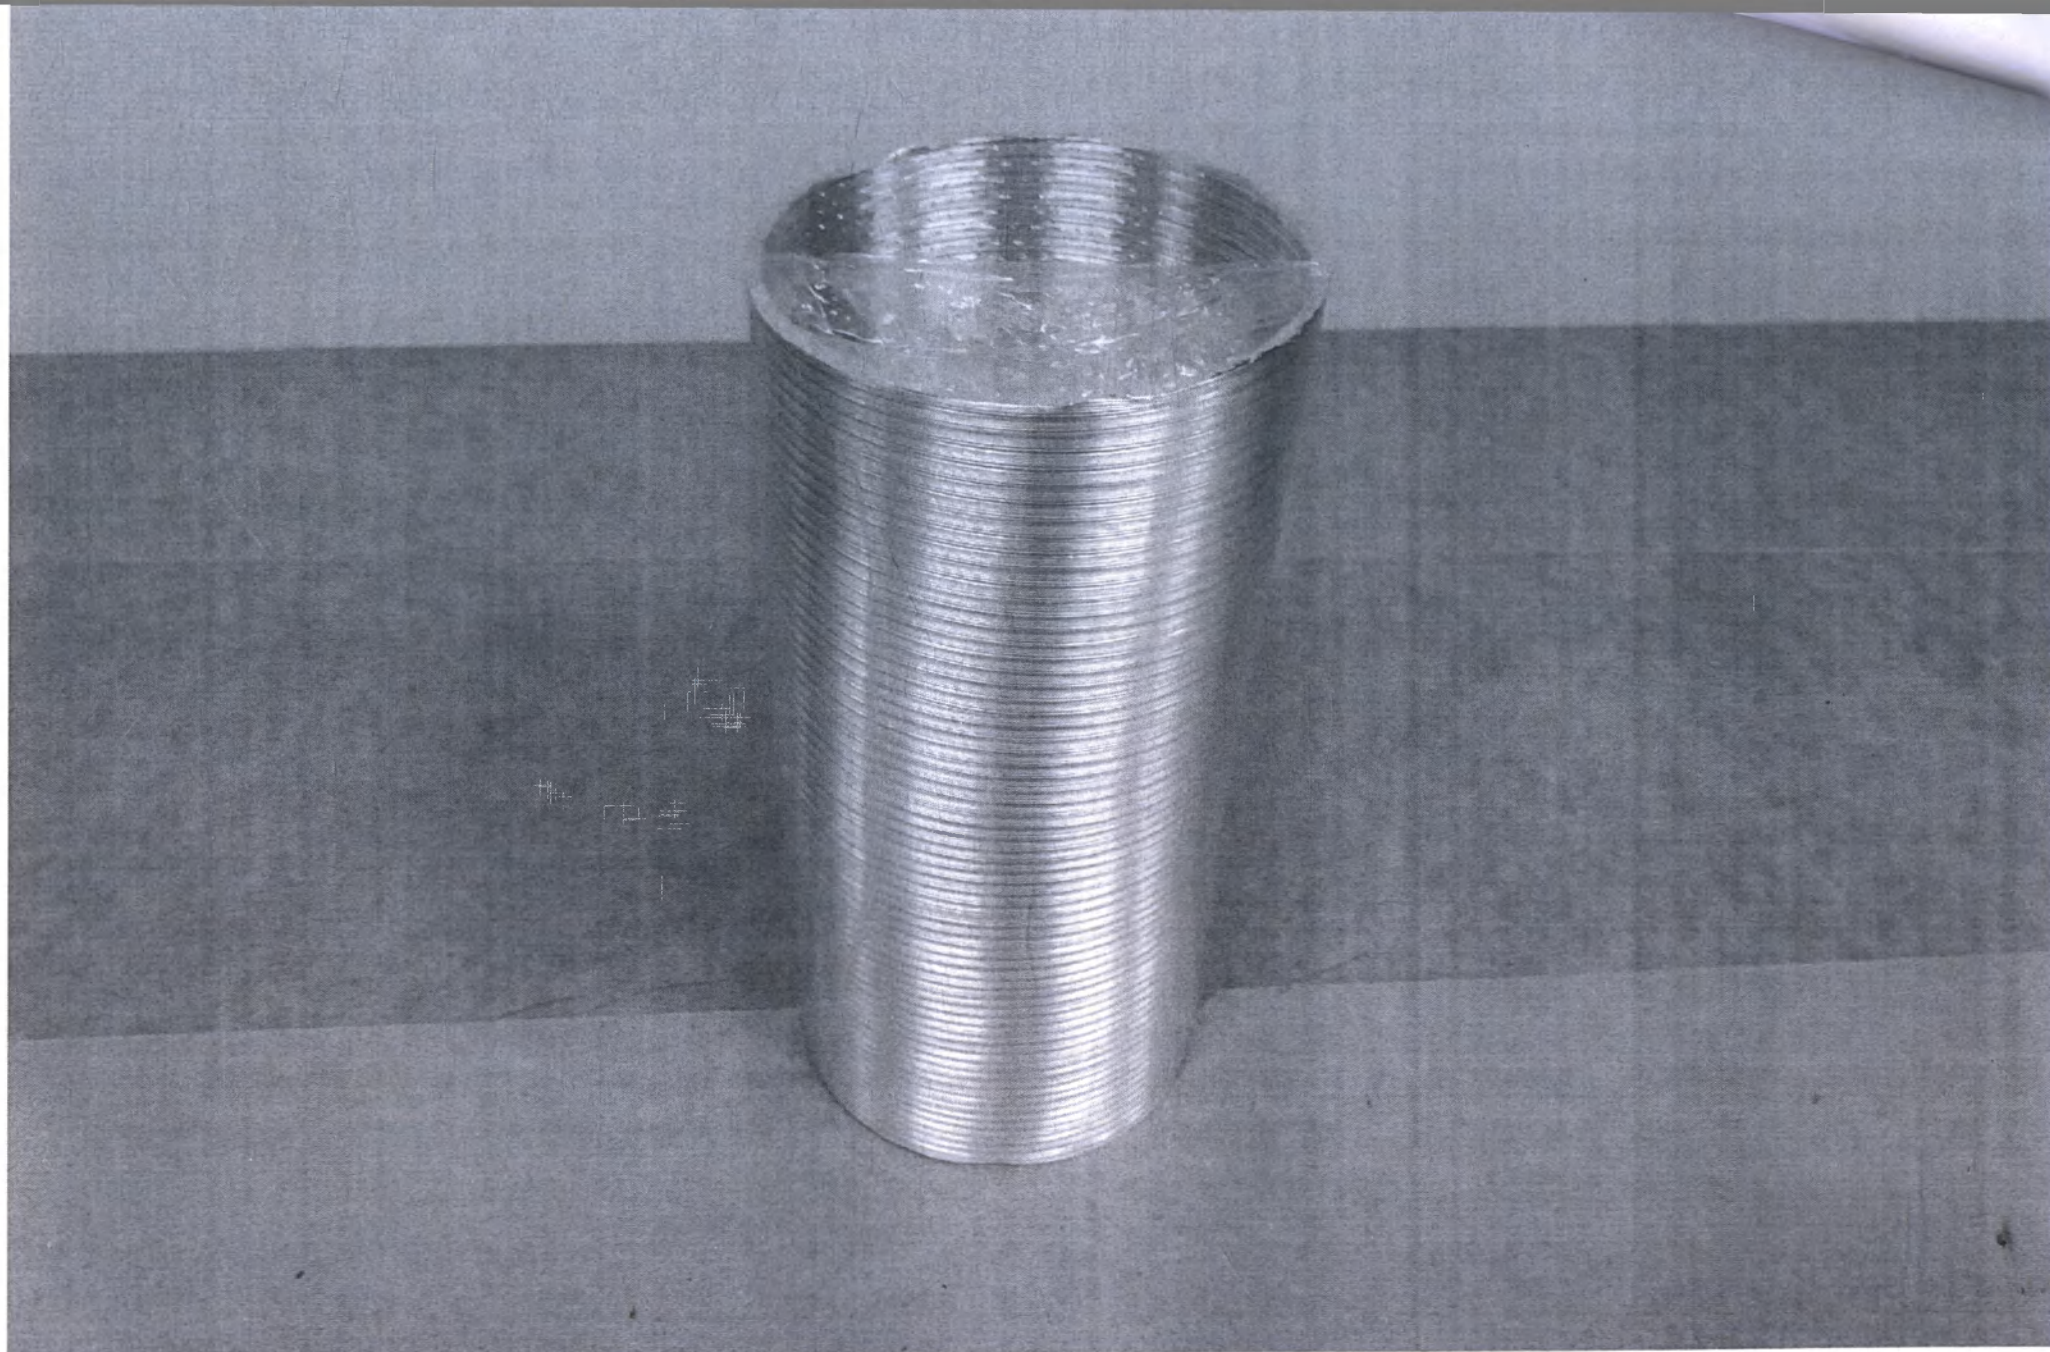


Рис.16 – Труба гофрированная вытяжная

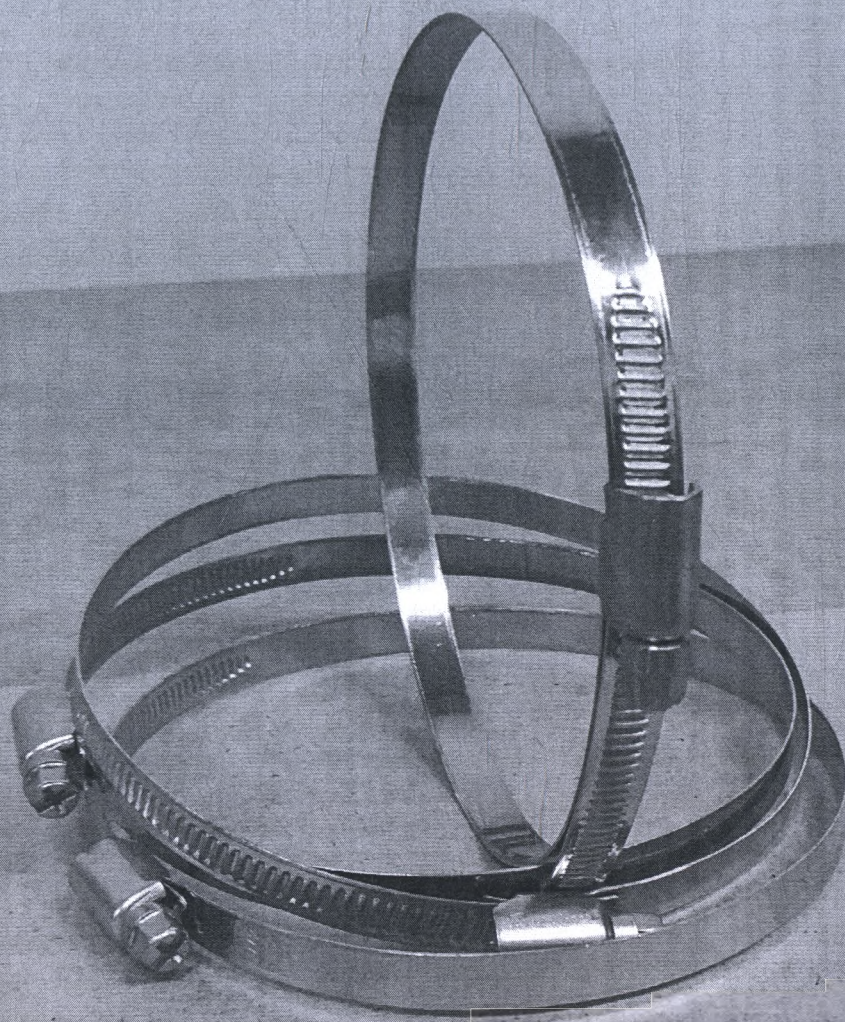


Рис.17 – Хомут для трубы

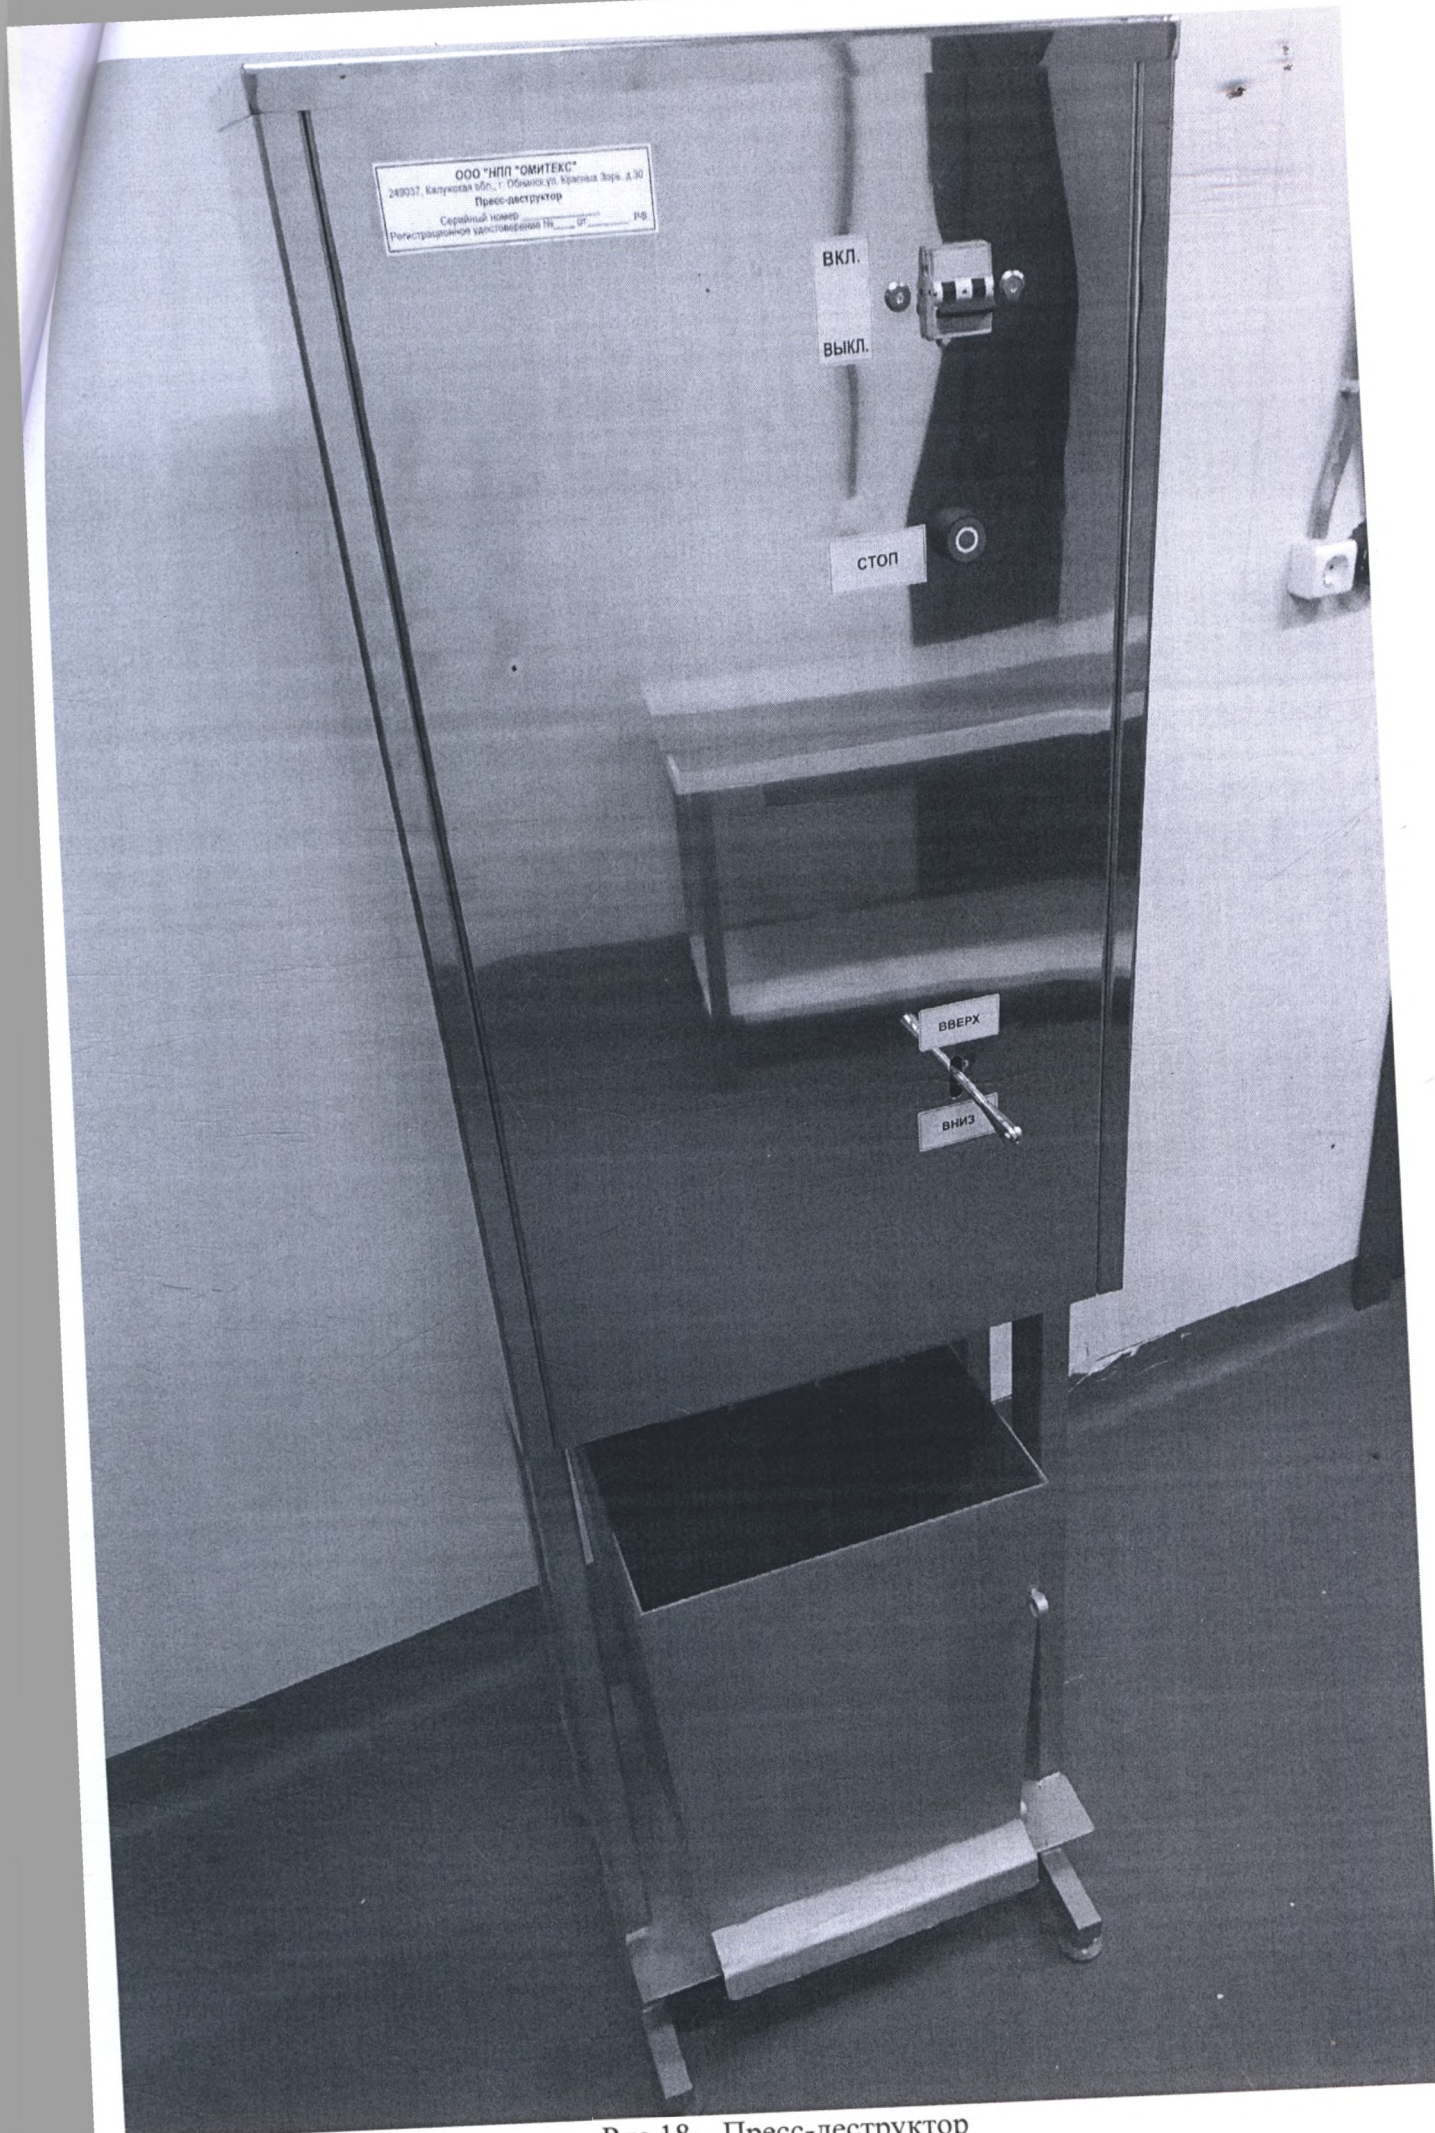
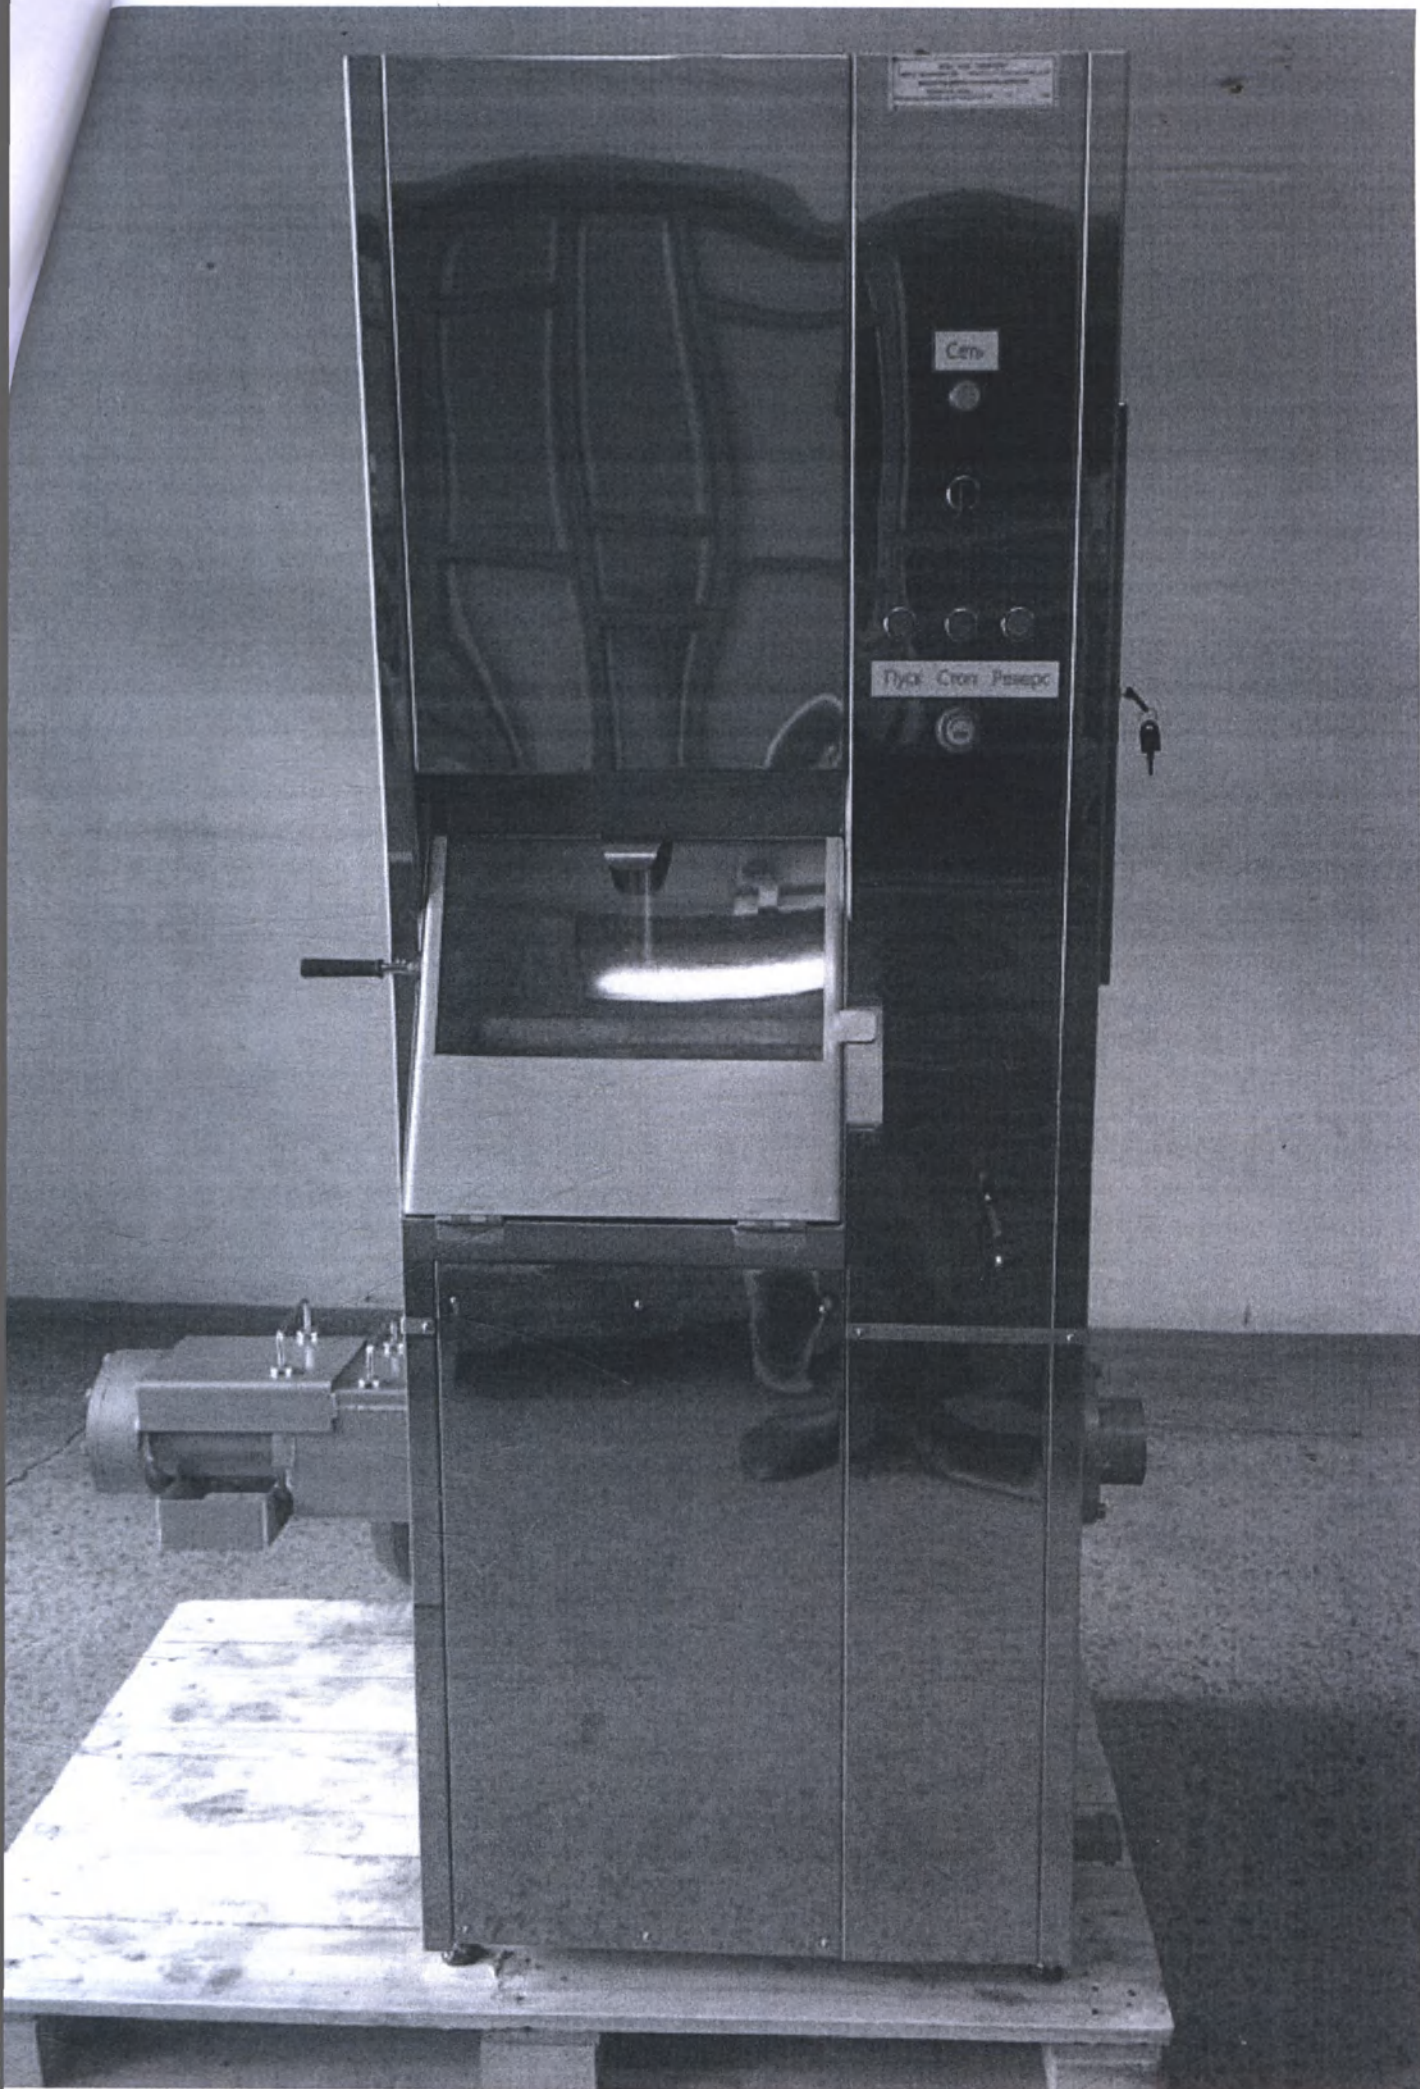


Рис.18 – Пресс-деструктор





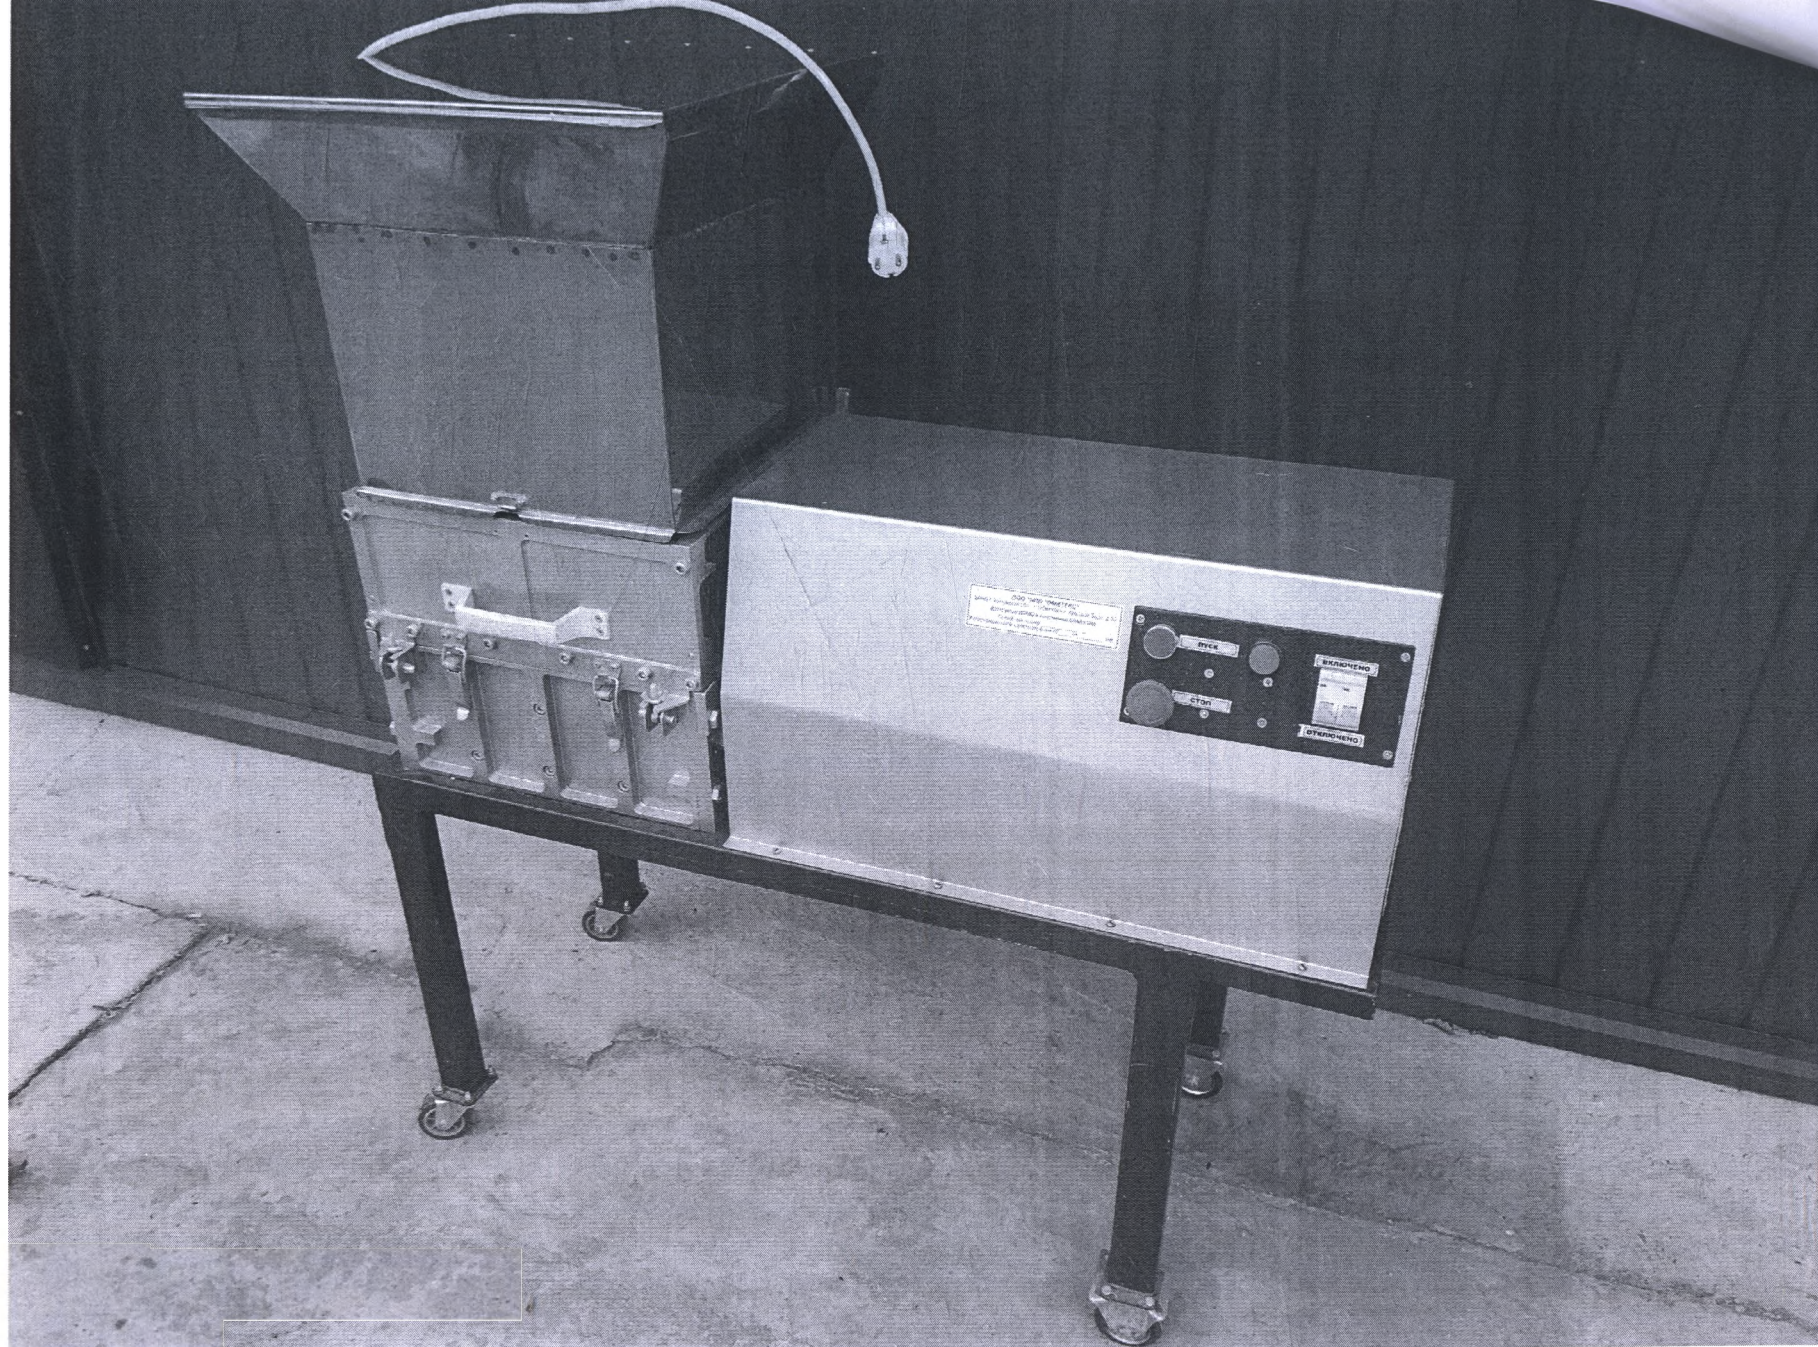


Рис.21 – Деструктор ДОМО в исполнении ДОМО-ИМ

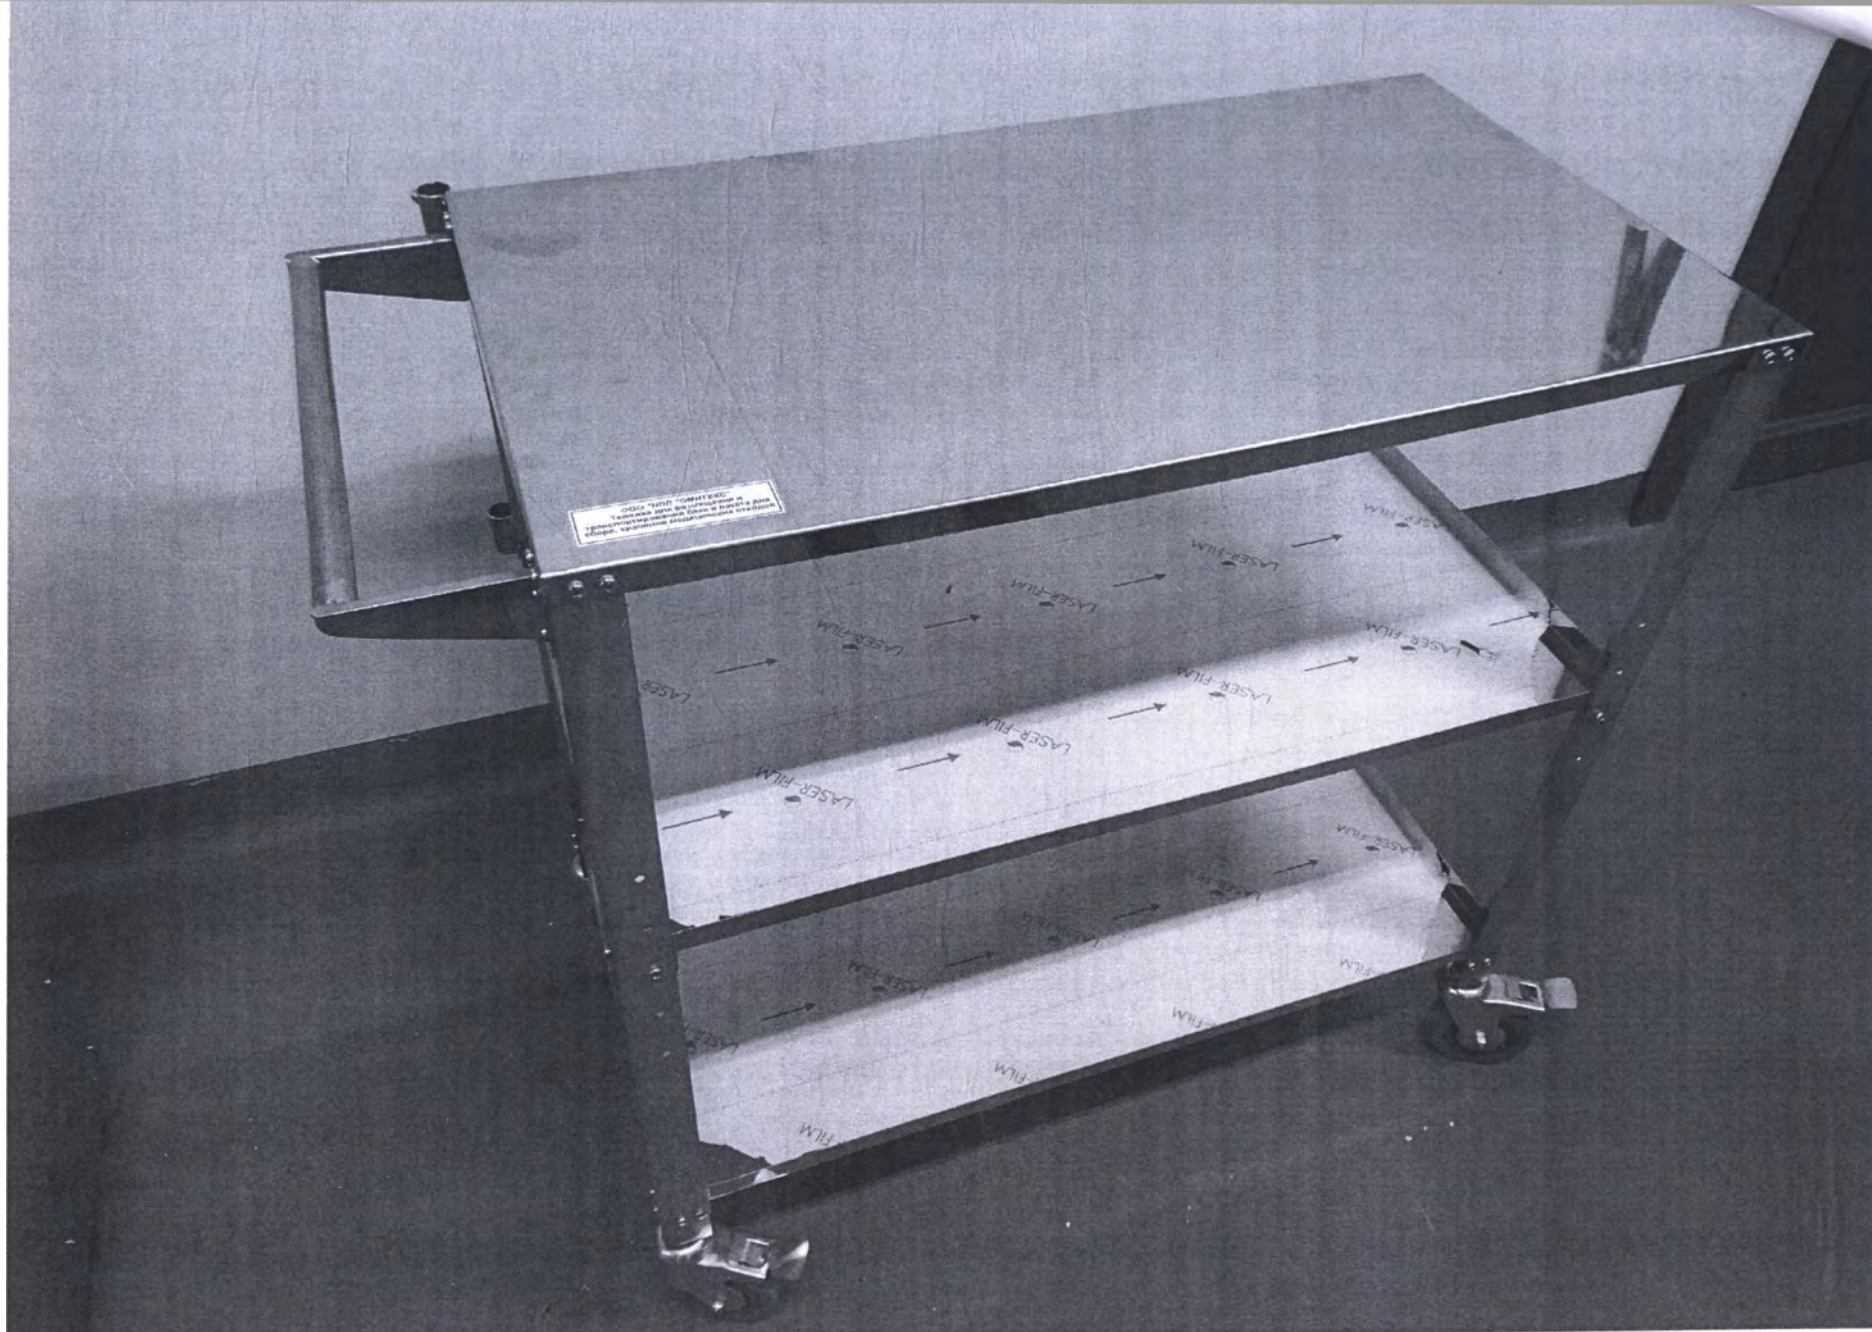


Рис.22 – Тележка для размещения и транспортирования бака и пакета для сбора, хранения медицинских отходов



Рис.23 – Стеллаж

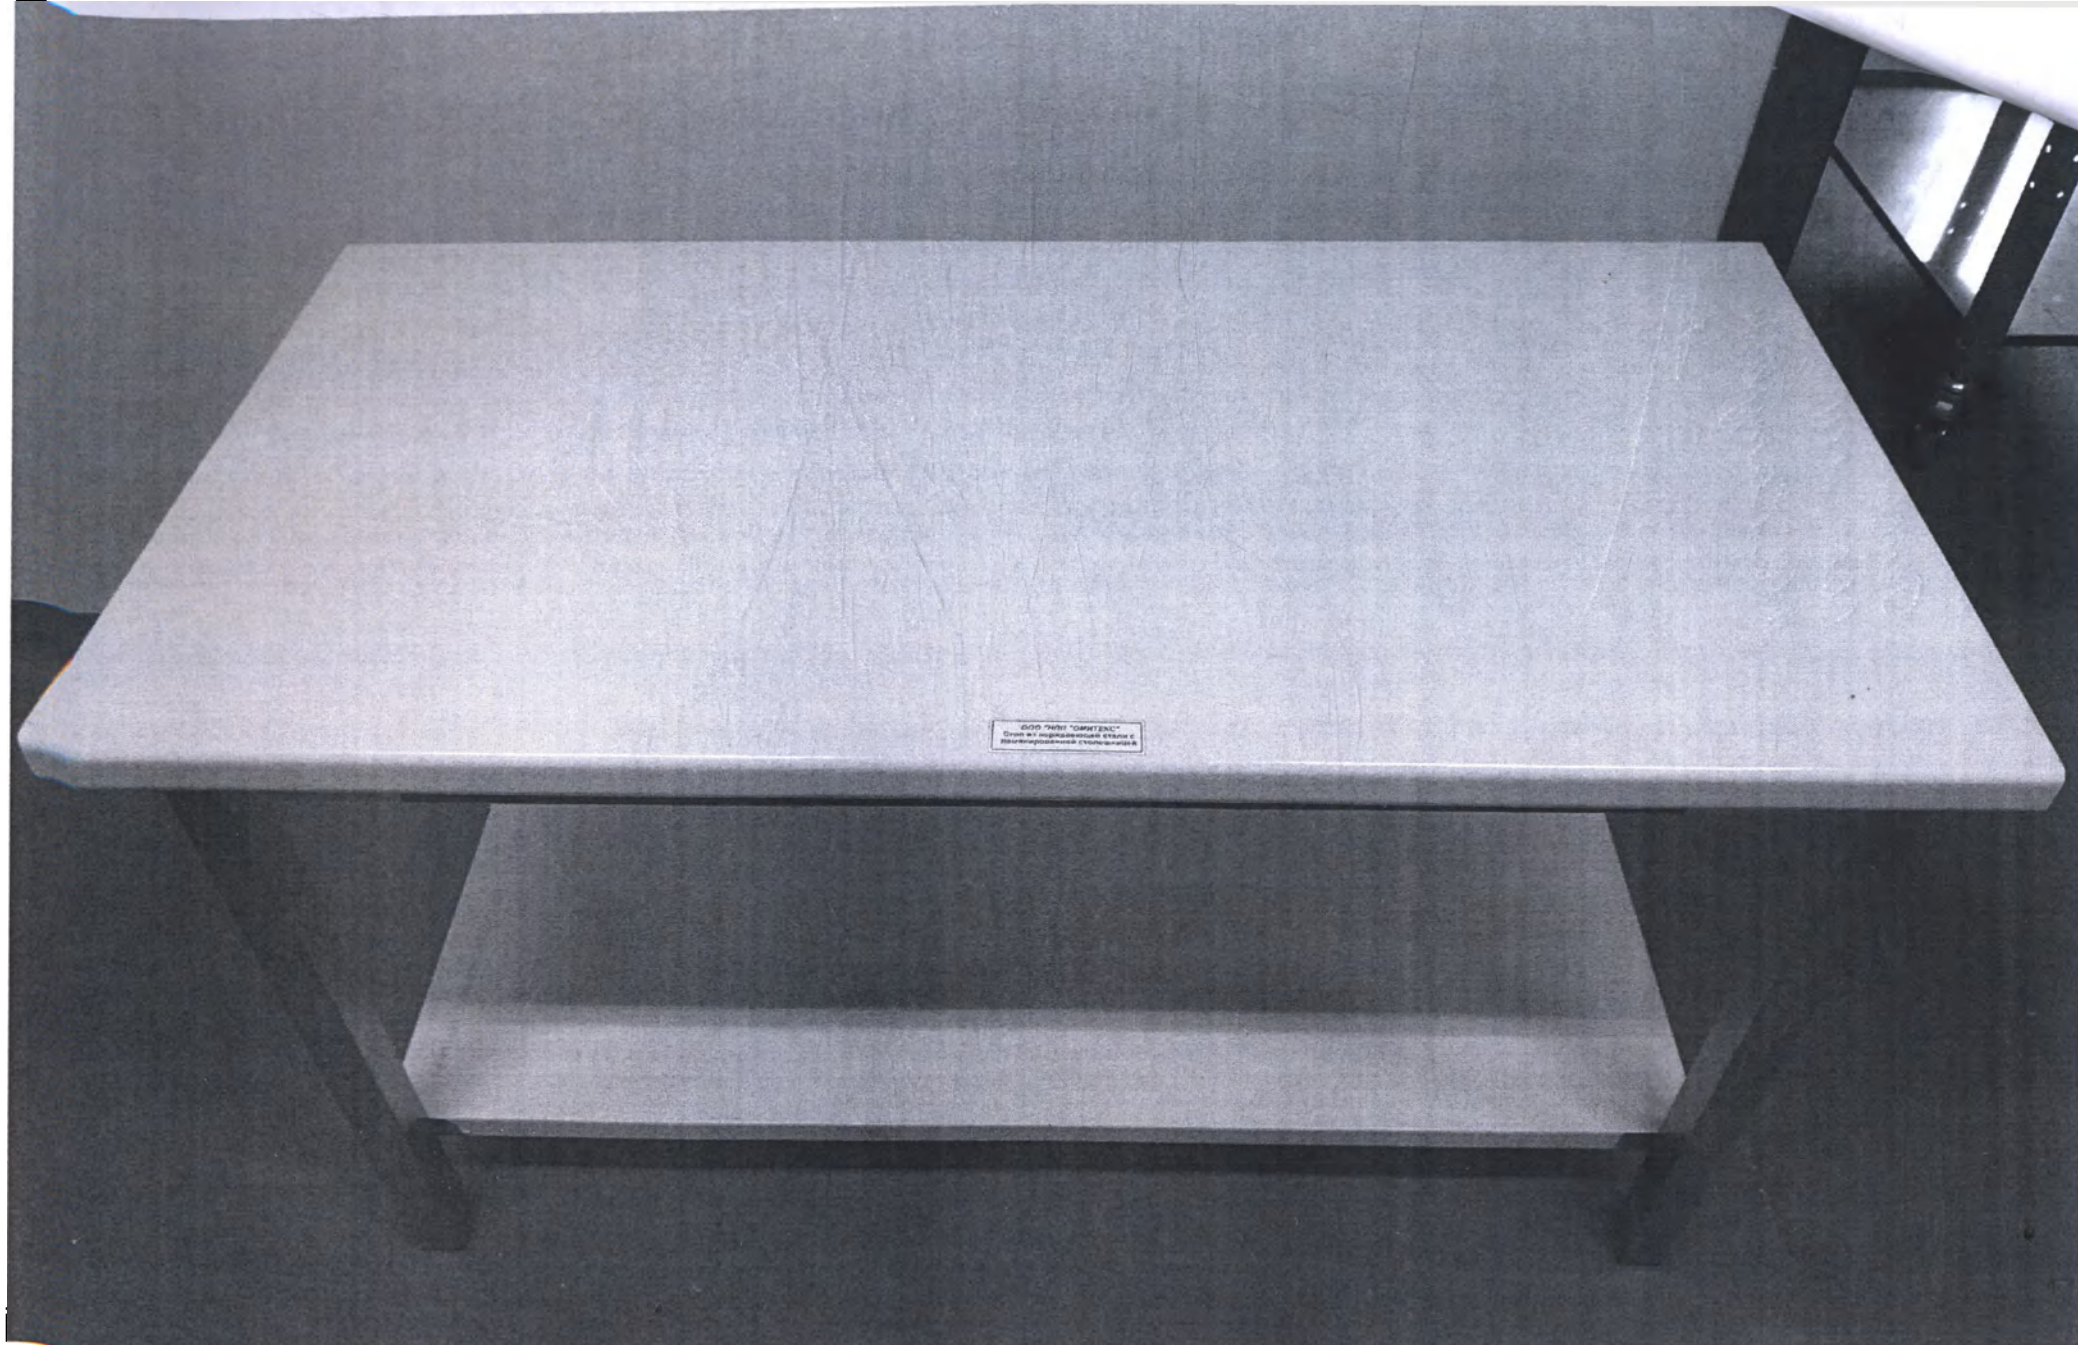


Рис.24 – Стол из нержавеющей стали с ламинированной столешницей

Всего в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 25 листов.

Генеральный директор УК
ООО «НПТ «ОМИТЕКС»
Л.Ф. Катусова

