

Руководитель направления по регистрации  
продукции для in vitro диагностики,  
иммунохимия, гематология и гемостаз



Чигринец Е.А.

«15» марта 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Раствор промывающий ADVIA Centaur Probe Wash 4 (ADVIA Centaur PW4 (PW4))

2023

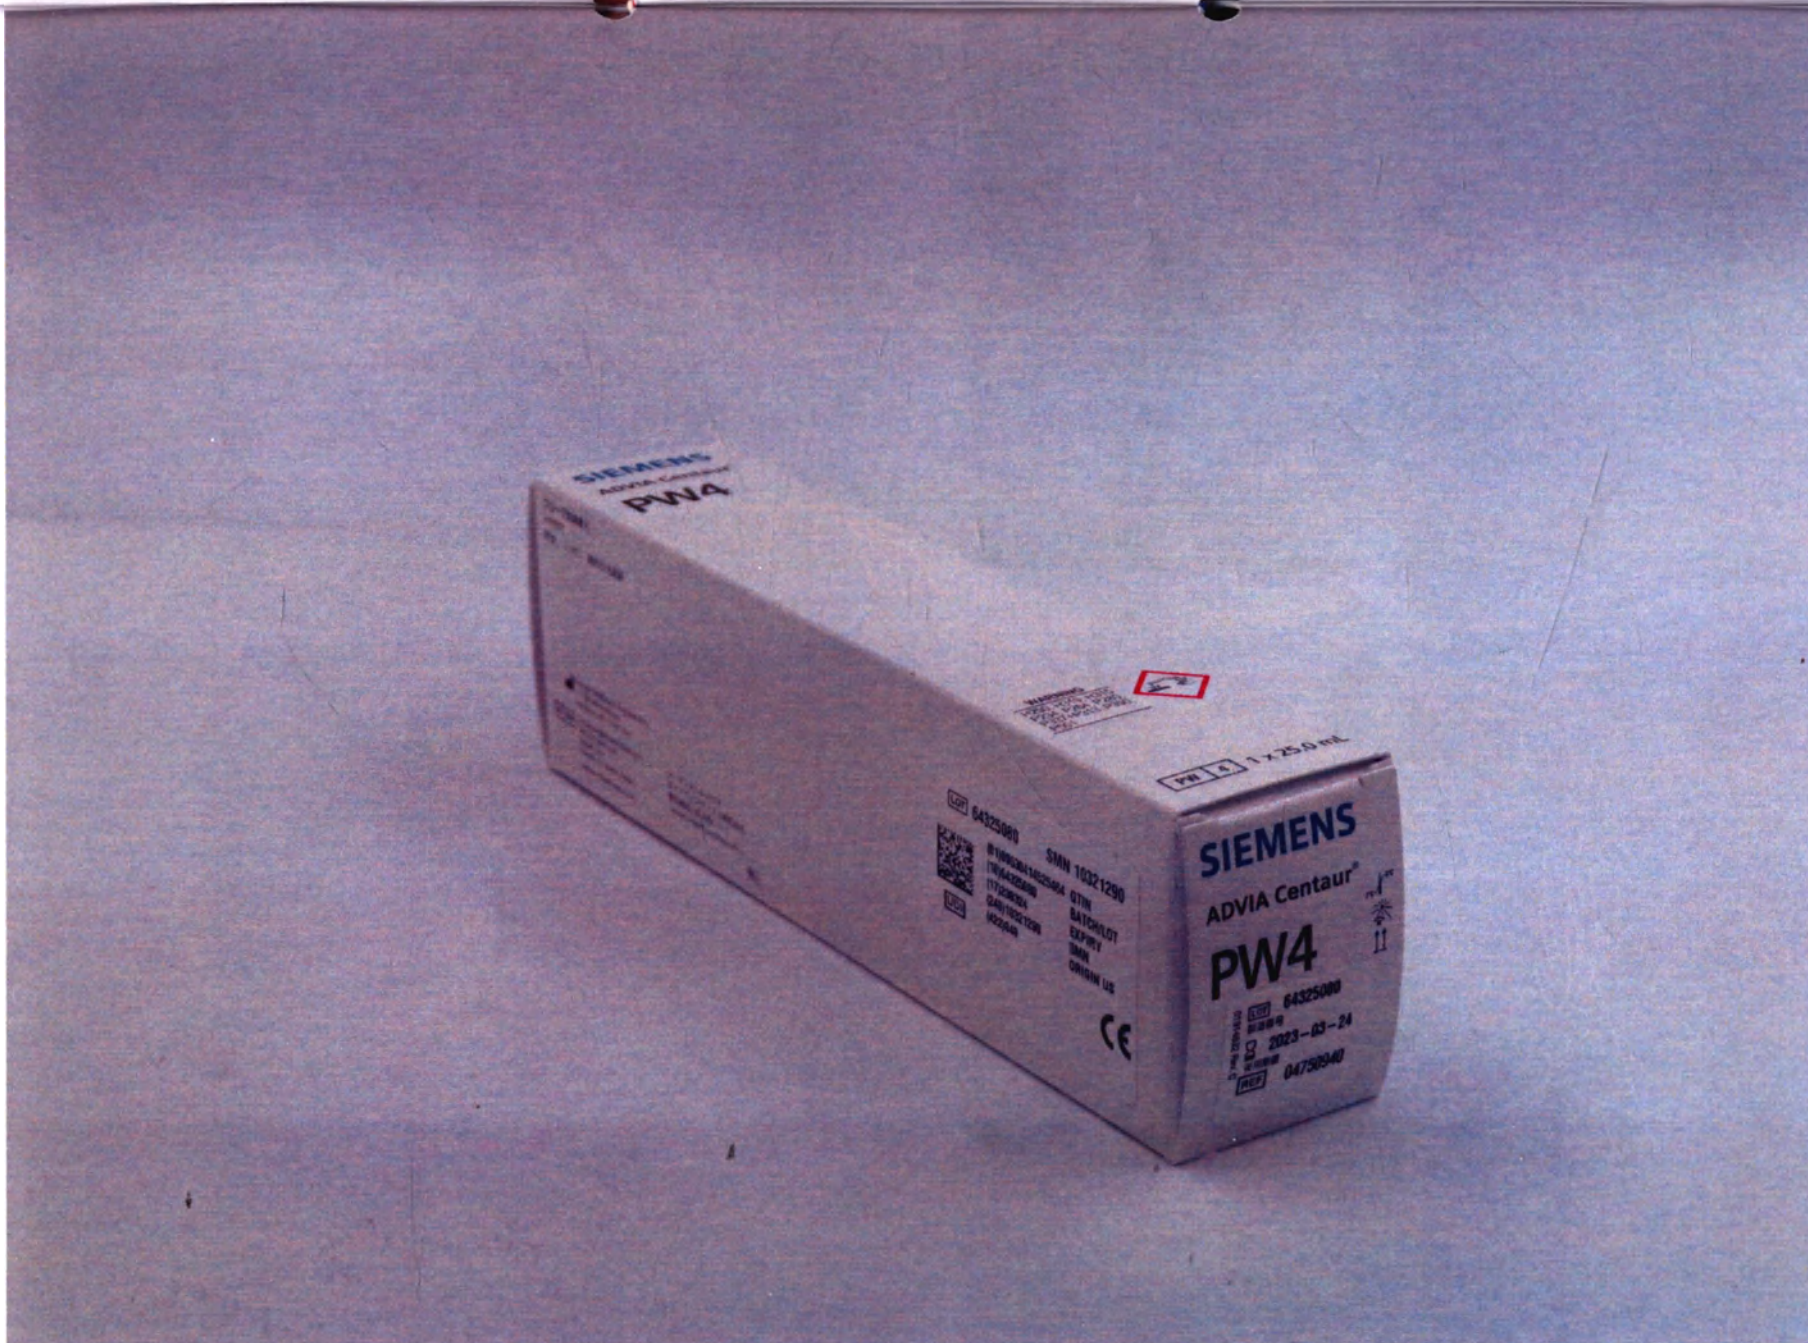


Рисунок 1 Раствор промывающий ADVIA Centaur Probe Wash 4 (ADVIA Centaur PW4 (PW4)) (общий вид упаковки)

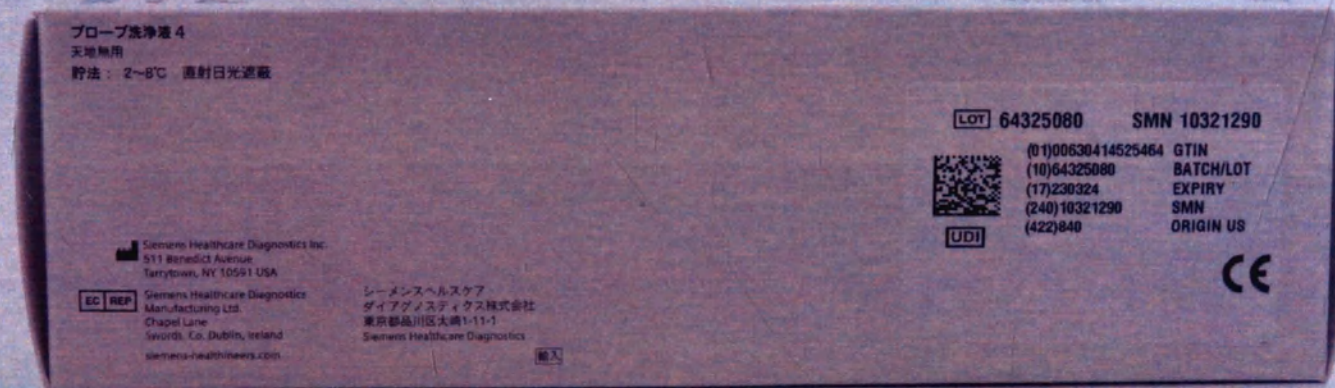


Рисунок 2 Раствор промывающий ADVIA Centaur Probe Wash 4 (ADVIA Centaur PW4 (PW4)) (общий вид упаковки сбоку 1)

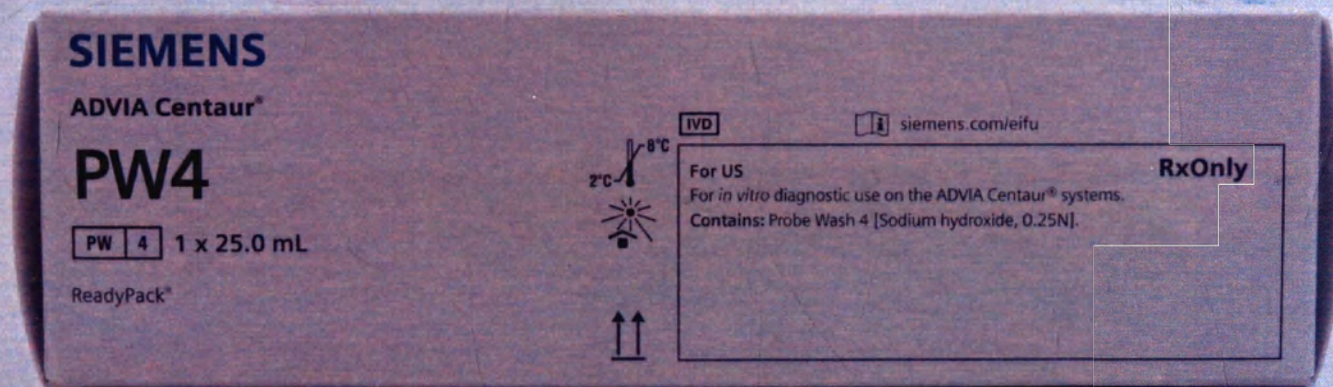


Рисунок 3 Раствор промывающий ADVIA Centaur Probe Wash 4 (ADVIA Centaur PW4 (PW4)) (общий вид упаковки сбоку 2)

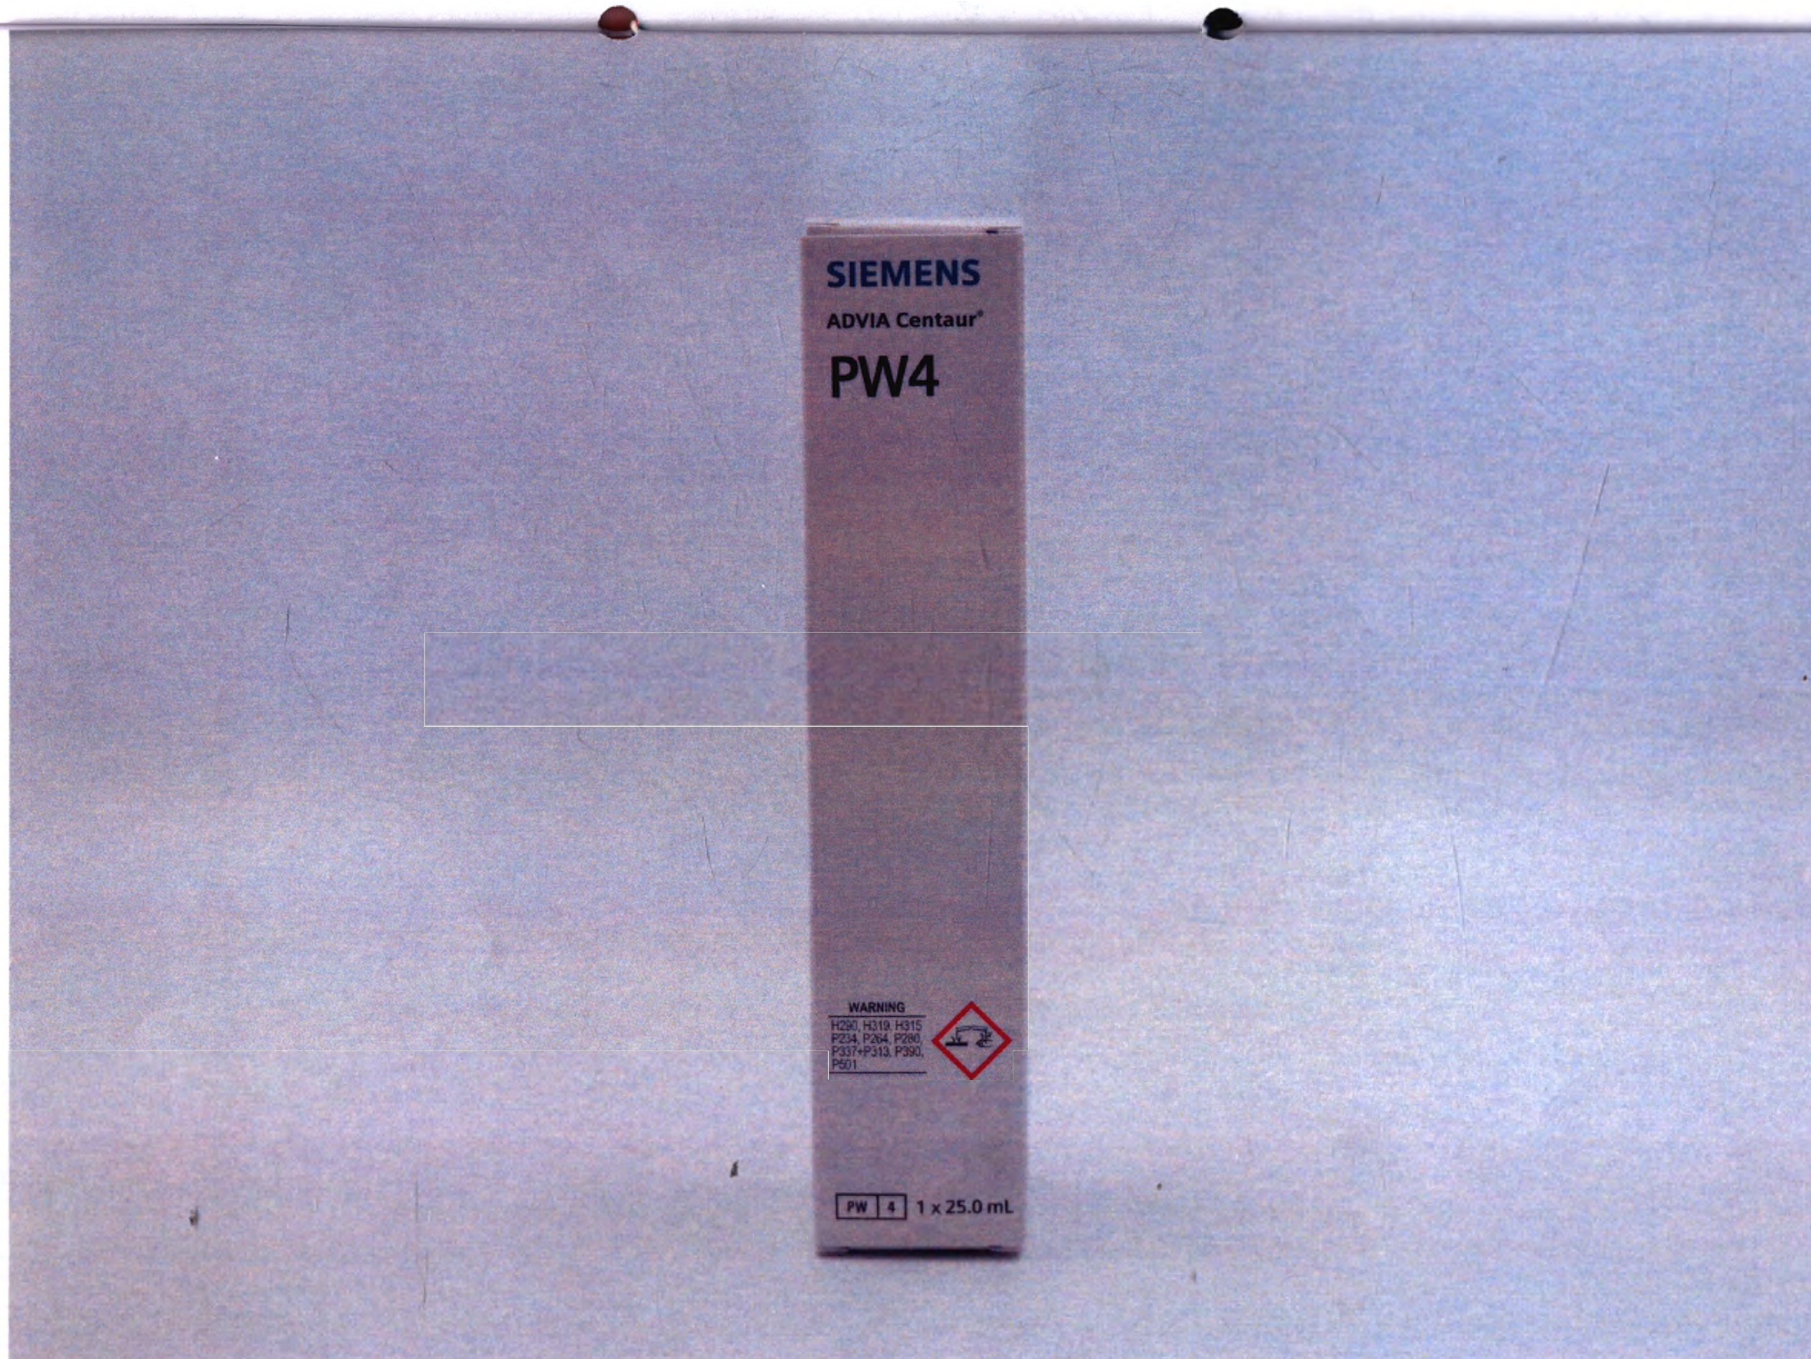


Рисунок 4 Раствор промывающий ADVIA Centaur Probe Wash 4 (ADVIA Centaur PW4 (PW4)) (общий вид упаковки сверху)

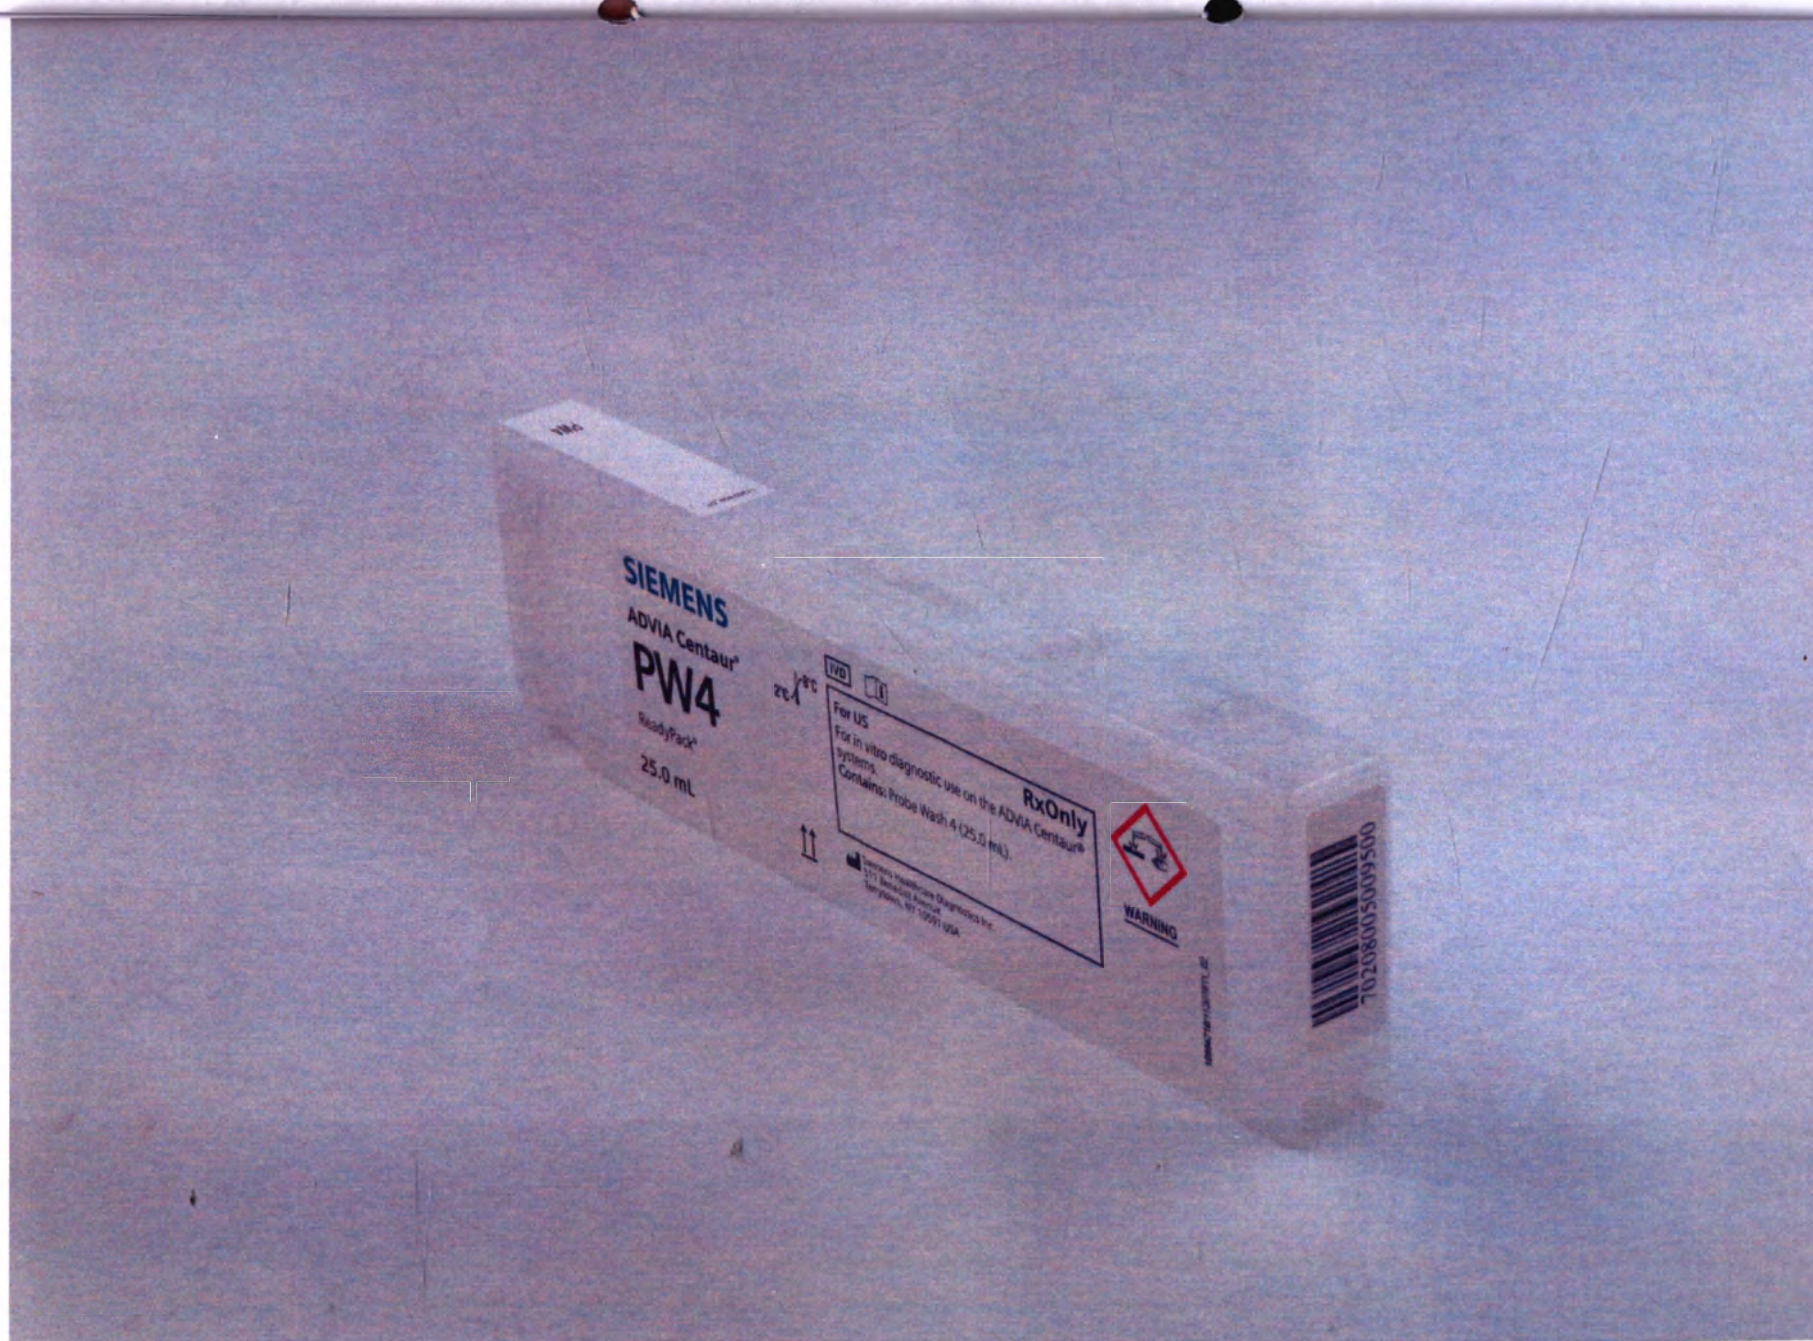
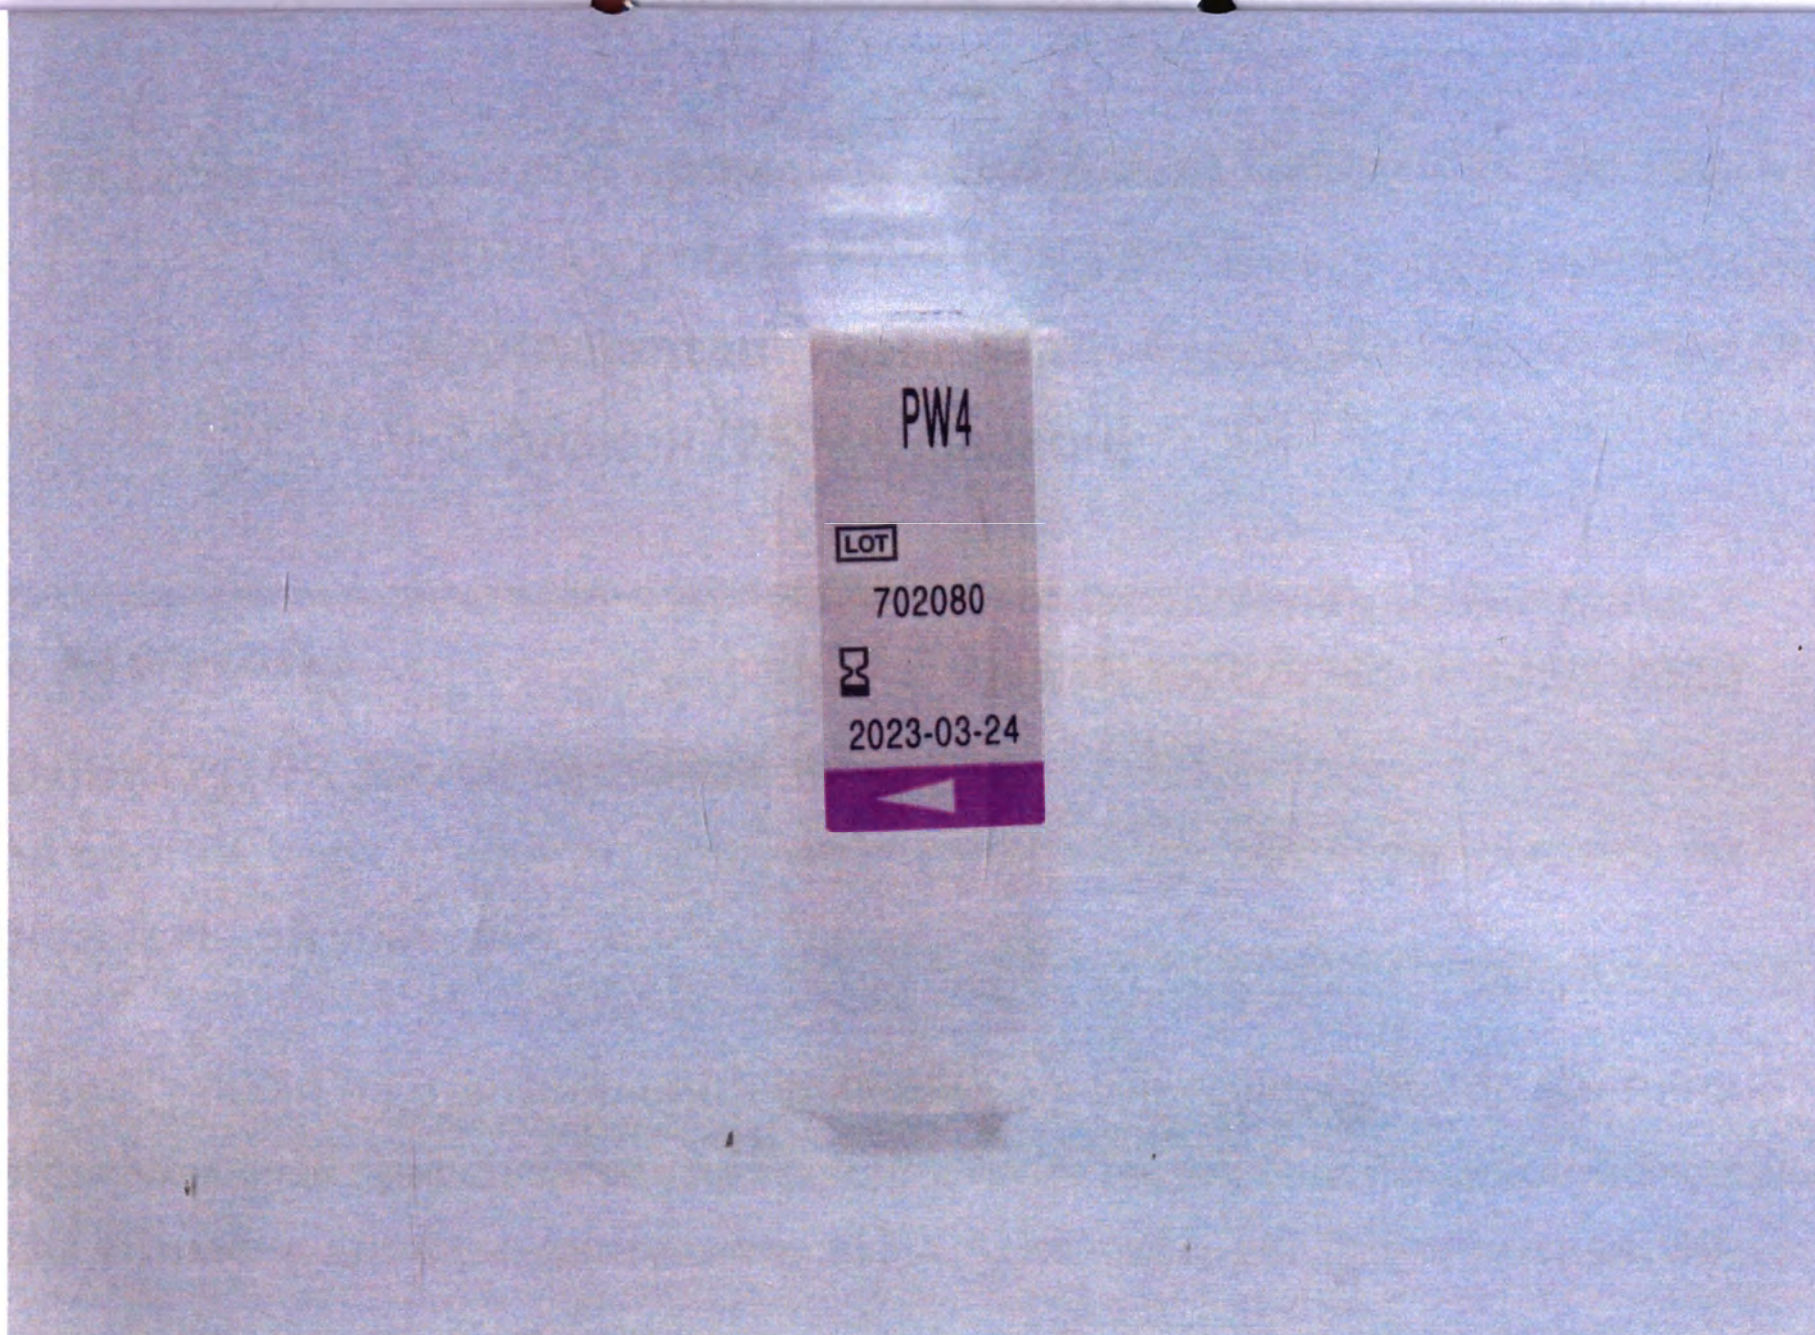


Рисунок 5 Раствор промывающий ADVIA Centaur Probe Wash 4 (ADVIA Centaur PW4 (PW4)) - 1 флакон (25 мл/флакон)



**Рисунок 6** Раствор промывающий ADVIA Centaur Probe Wash 4 (ADVIA Centaur PW4 (PW4)) - 1 флакон (25 мл/флакон) – боковая маркировка

10321290      Раствор промывающий ADVIA Centaur Probe Wash 4 (ADVIA Centaur PW4 (PW4)): Раствор промывающий ADVIA Centaur Probe Wash 4 (ADVIA Centaur PW4 (PW4)) – 1 флакон (25 мл/флакон)

Информация о производителе и стране производства: см. на упаковке      Регистрационное удостоверение: № P3H 2020/9745 от 10.03.2020

## **ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

**Состав:** указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению  
**Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:**  
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 7 Раствор промывающий ADVIA Centaur Probe Wash 4 (ADVIA Centaur PW4 (PW4)): макет русскоязычной маркировки

Всего прошито и пронумеровано  
8 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

