

**3M Россия**

108811, г. Москва, п. Московский,
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1
Тел.: 8 800 250 84 74
www.3MRussia.ru

3M Russia

108811, Moscow, p. Moskovskiy,
Kievskoe shosse, 22 km, 6, bld. 1
Phone: 8 800 250 84 74
www.3MRussia.ru

«11» декабря 2020 года

Фотографические изображения медицинского изделия

Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™*

*Только маркировка для «Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™ DeepCure-L» и «Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™ DeepCure-S» подлежит обновлению, маркировка упаковки «Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™ S10» остается неизменной.

Старший эксперт по
сертификации и регистрации
отдела Здравоохранения АО «3М Россия»



Ганич Д.В.



Elipar™ DeepCure-S

CONTENTS

1 LED Curing Light

ru

3M Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™

Вариант исполнения: Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™ DeepCure-S в составе: Ручной блок (Handpiece); Защитный щиток (Eye Shield); Батарея (Li-ion Battery); Зарядное устройство (Charging base); Световод, диаметром 10 мм (Light Guide). Производитель: "3M Дойчланд ГмбХ", Германия, 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany. Назначение: Полимеризация стоматологических материалов, чувствительных к диапазону длины волны 430-480 нм. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Условия хранения: см. в инструкции по применению. Гарантийный срок: 24 месяца. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ № ФСЗ 2009/05269 от 12.03.2020г. Срок действия не ограничен



EAC

Уполномоченный представитель производителя в РФ: АО "3М Россия" 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1, тел.: +7 495 784 74 74

Изготовлено: см. на упаковке

pl

ro

Lampă de fotopolimerizare LED

sk

LED Polymerizačná lampa

sl

Polimerizacijska LED luč

cs

LED polymerační lampa

tr

LED Işık Cihazı

et

LED-valguslamp

lv

Gaismas diodes lampa

lt

Diodinis švitintuvas

uk

Світлодіодна фотополімерна лампа





Рисунок 1 - Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™ DeepCure-S в составе (внешний вид изделия в упаковке)



Рисунок 2 - Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™ DeerCure-S в составе (информация о производителе)



Рисунок 3 - Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™ DeepCure-S в составе (общий вид изделия)



Рисунок 4 - Ручной блок (Handpiece): общий вид и вид с обратной стороны



Рисунок 5 - Защитный щиток (Eye Shield)

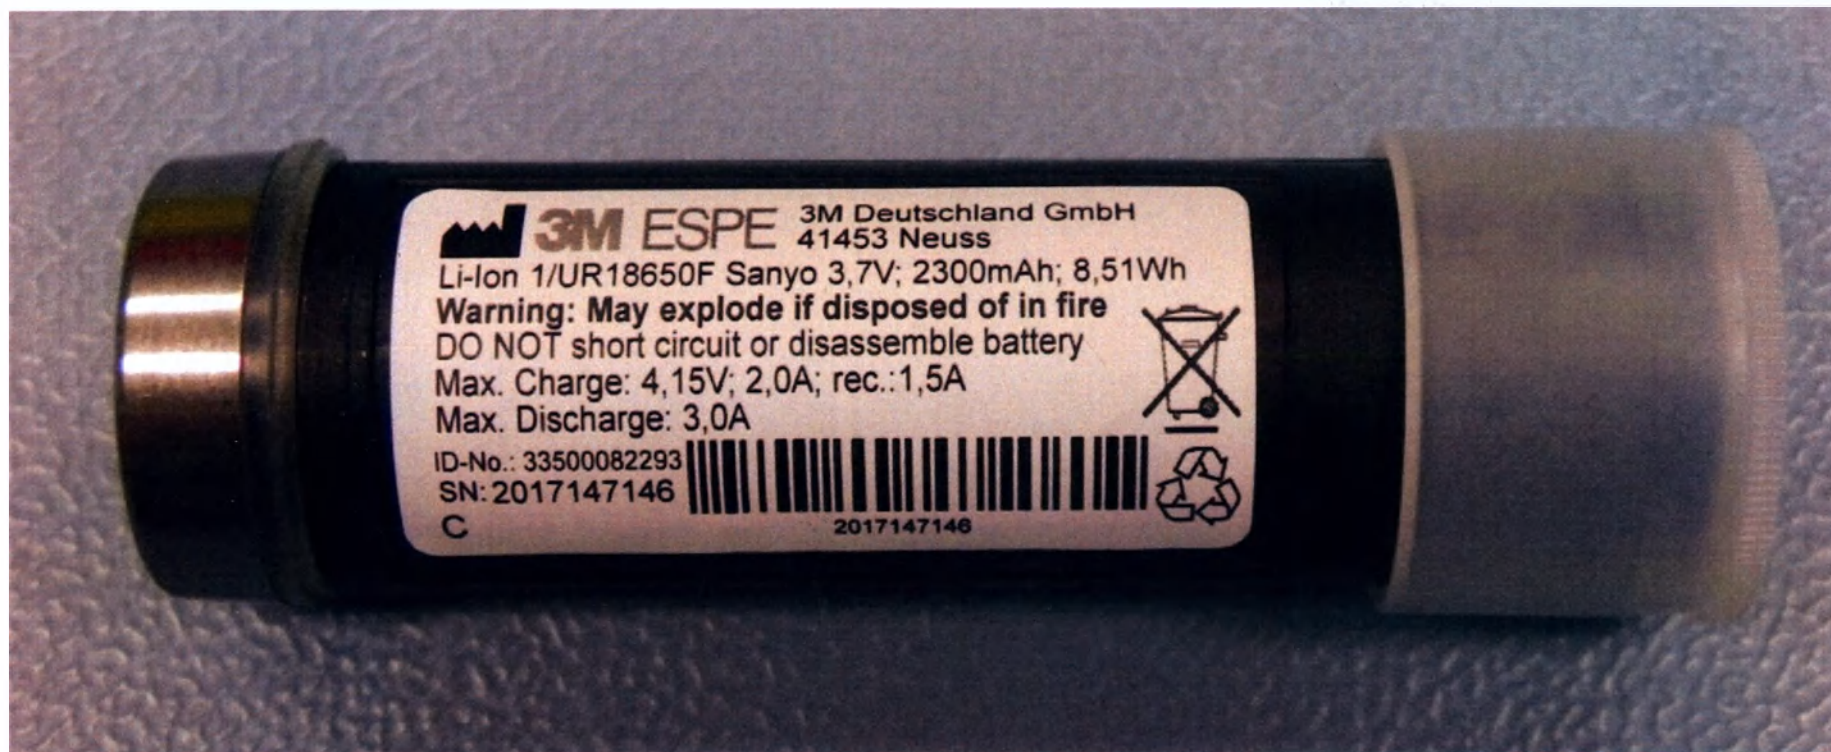


Рисунок 6 - Батарея (Li-ion Battery)

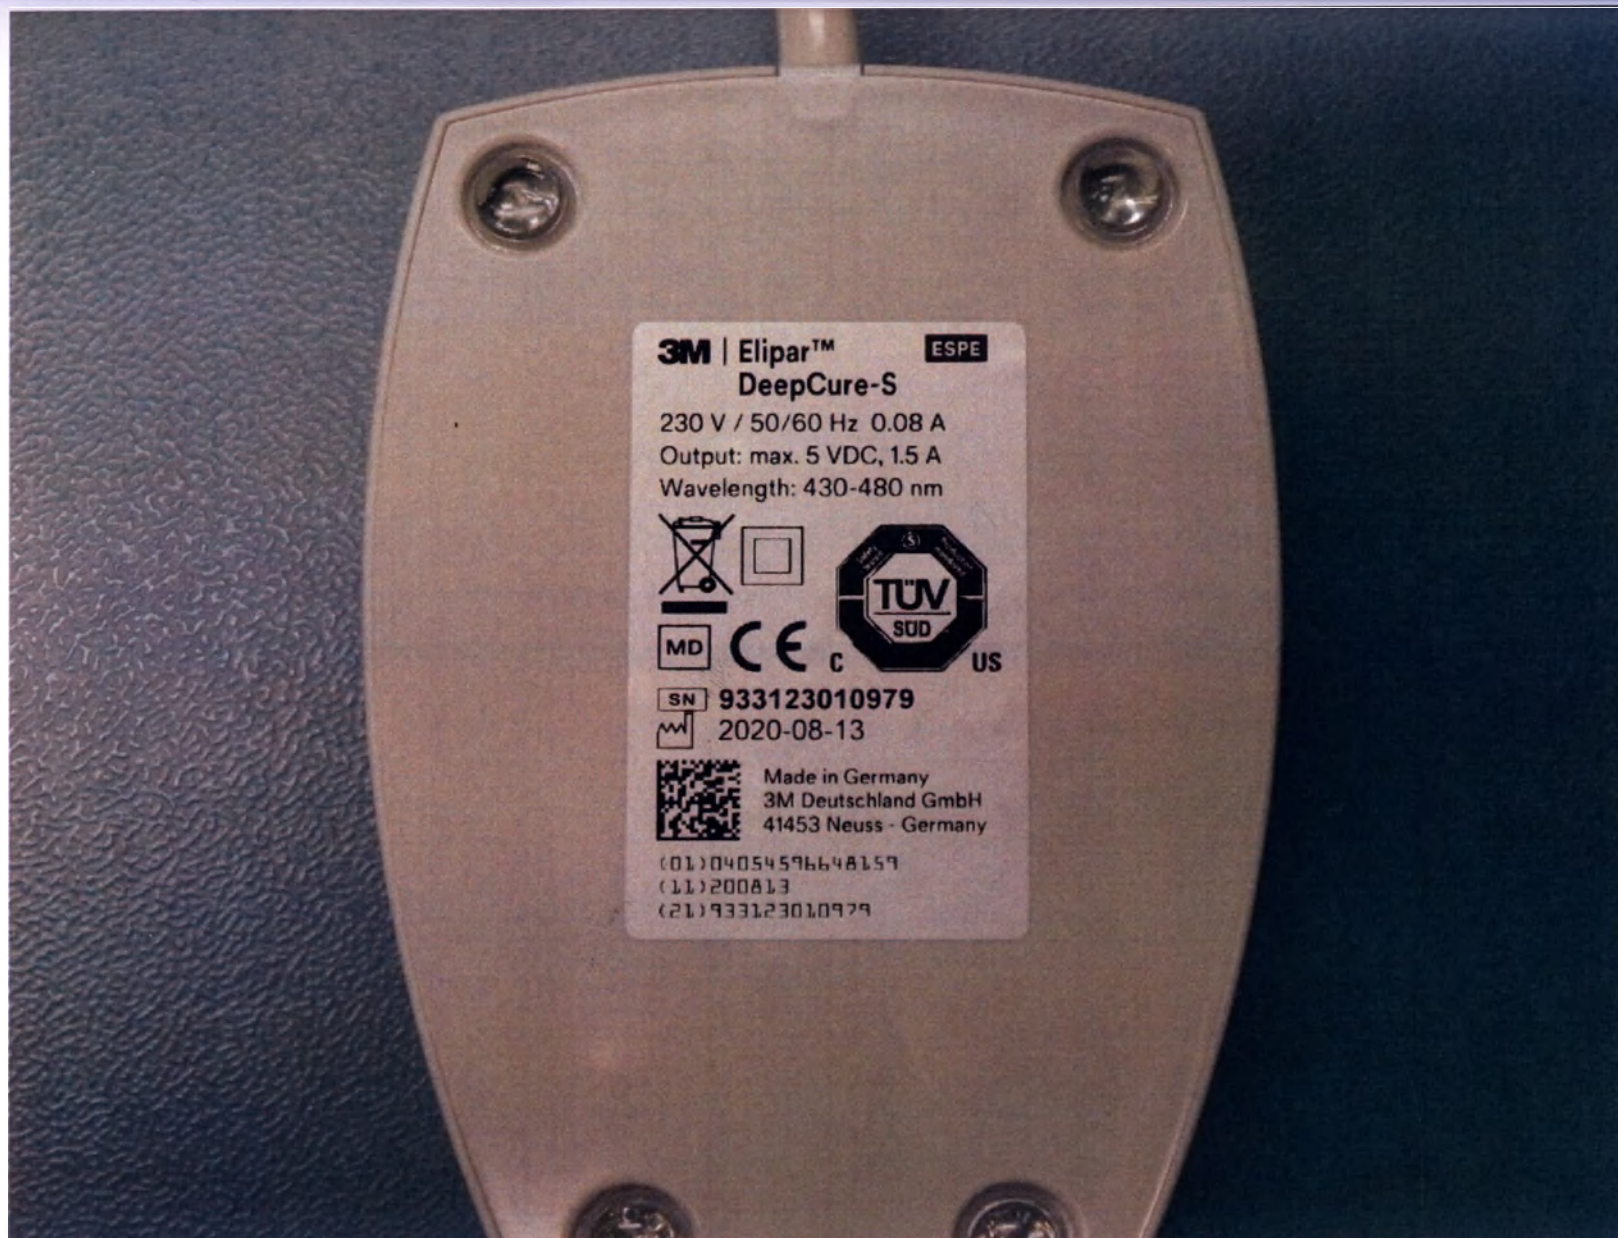


Рисунок 7 - Зарядное устройство (Charging base)



Рисунок 8 - Световод, диаметром 10 мм (Light Guide)



Elipar™ DeepCure-L

CONTENTS

1 LED Curing Light

ru

3M Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™

Вариант исполнения: Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™ DeepCure-L в составе: Ручной блок (Handpiece); Защитный щиток (Eye Shield); Зарядное устройство (Charger); Световод, диаметром 10 мм (Light Guide); Шаблон для проверки глубины полимеризации (Curing disks) 3 шт. Производитель: "3M Дойчланд ГмбХ", Германия, 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany. Назначение: Полимеризация стоматологических материалов, чувствительных к диапазону длины волны 430-480 нм. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Условия хранения: см. в инструкции по применению. Гарантийный срок: 24 месяца. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ № ФСЗ 2009/05269 от 12.03.2020г. Срок действия не ограничен

bg

hr

hu



EAC

Уполномоченный представитель производителя в РФ: АО "3М Россия" 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1, тел.: +7 495 784 74 74

Изготовлено: см. на упаковке

pl

Diodowa lampa do polimeryzacji

ro

Lampă de fotopolimerizare LED

sk

LED Polymerizačná lampa

sl

Polimerizacijska LED luč

cs

LED polymerační lampa

tr

LED Işık Cihazı

et

LED-valguslamp

lv


Gaismas diodes lampa

lt

Diodinis švitintuvas

uk

Світлодіодна фотополімерна лампа



REF 76973

Рисунок 9 - Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™ DeepCure-L в составе (внешний вид изделия в упаковке)



Рисунок 10 - Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™ DeepCure-L в составе (информация о производителе)



Рисунок 11 - Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar™ DeepCure-L в составе (общий вид изделия)



Рисунок 12 - Ручной блок (Handpiece): общий вид и вид с обратной стороны



Рисунок 13 - Защитный щиток (Eye Shield)



Рисунок 14 - Зарядное устройство (Charger)



Рисунок 15 - Световод, диаметром 10 мм (Light Guide)

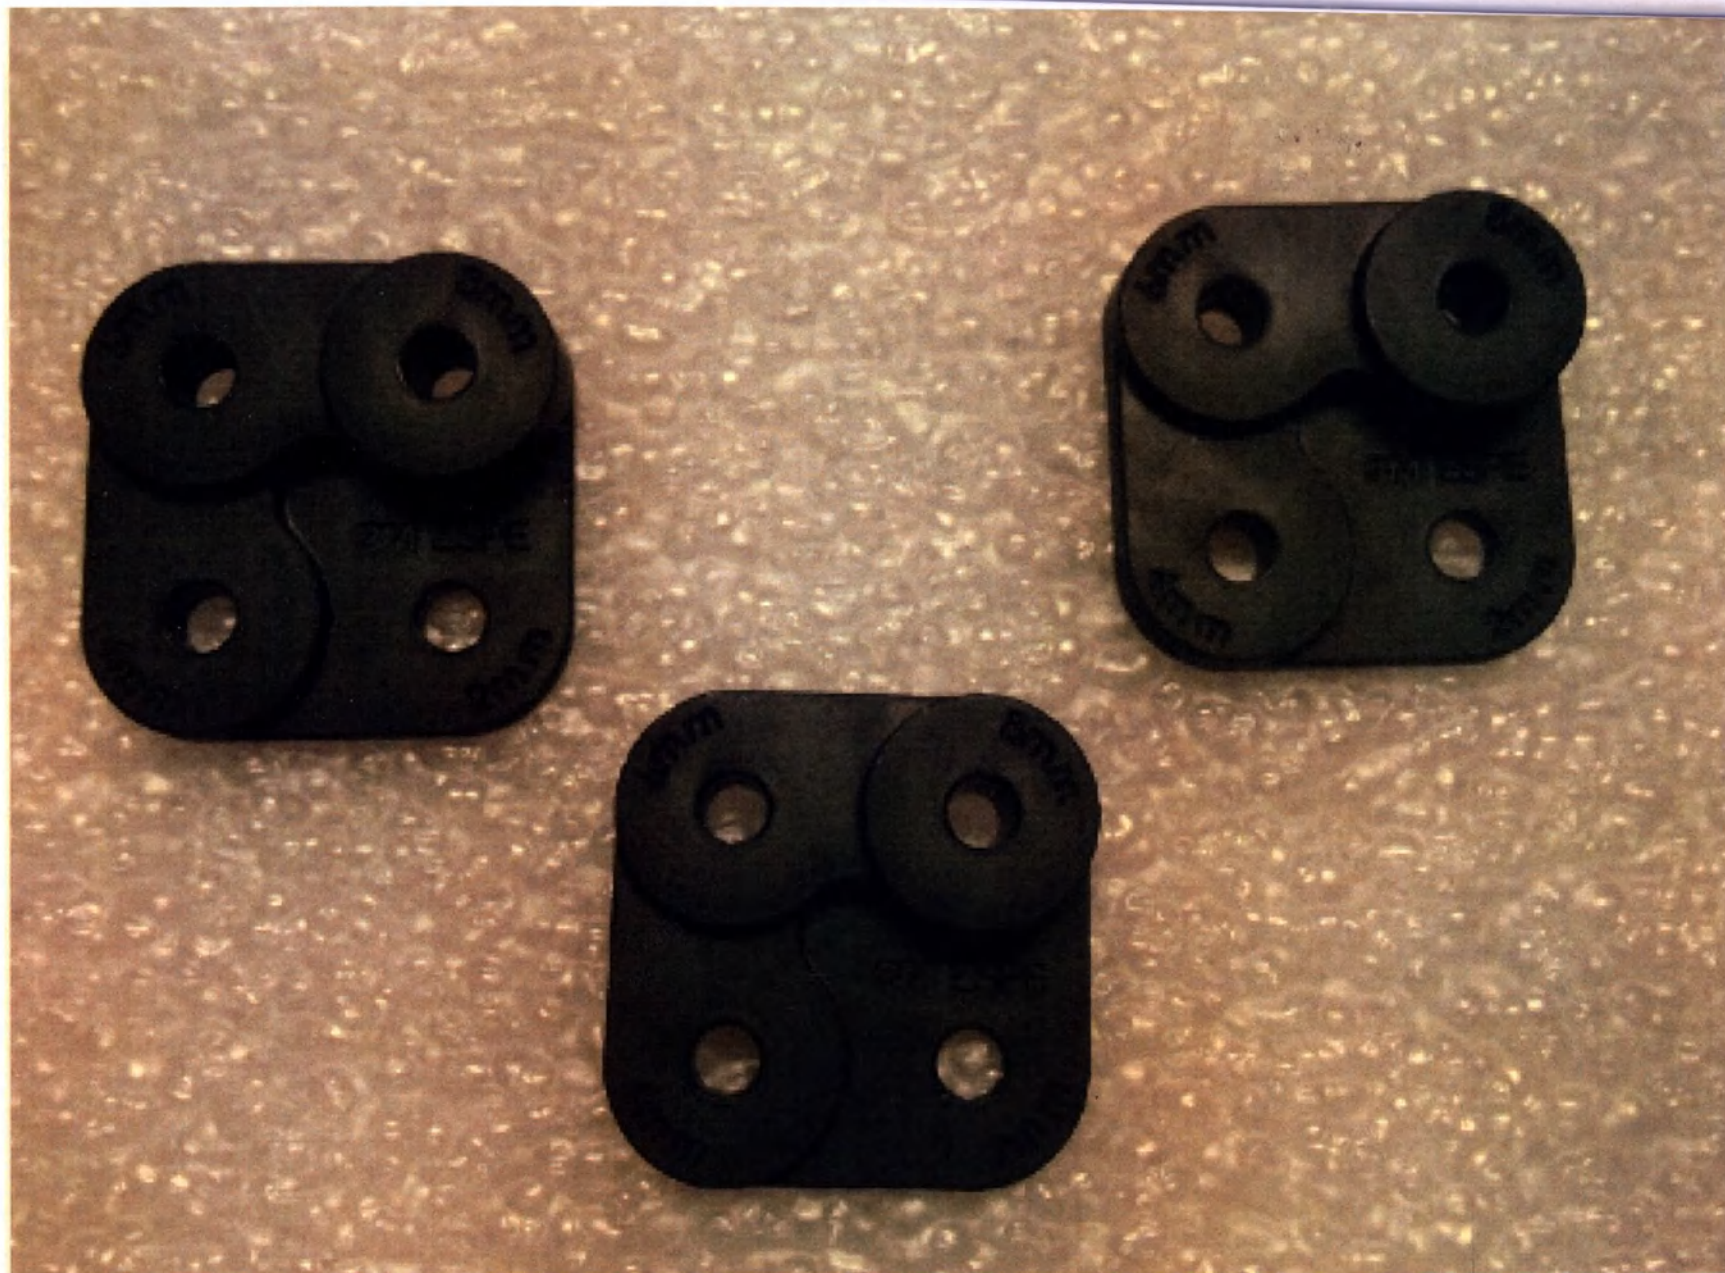


Рисунок 16 - Шаблон для проверки глубины полимеризации (Curing disks) 3 шт.

Рис. 17 Устройство стоматологическое для световой полимеризации Elipar S10 в составе

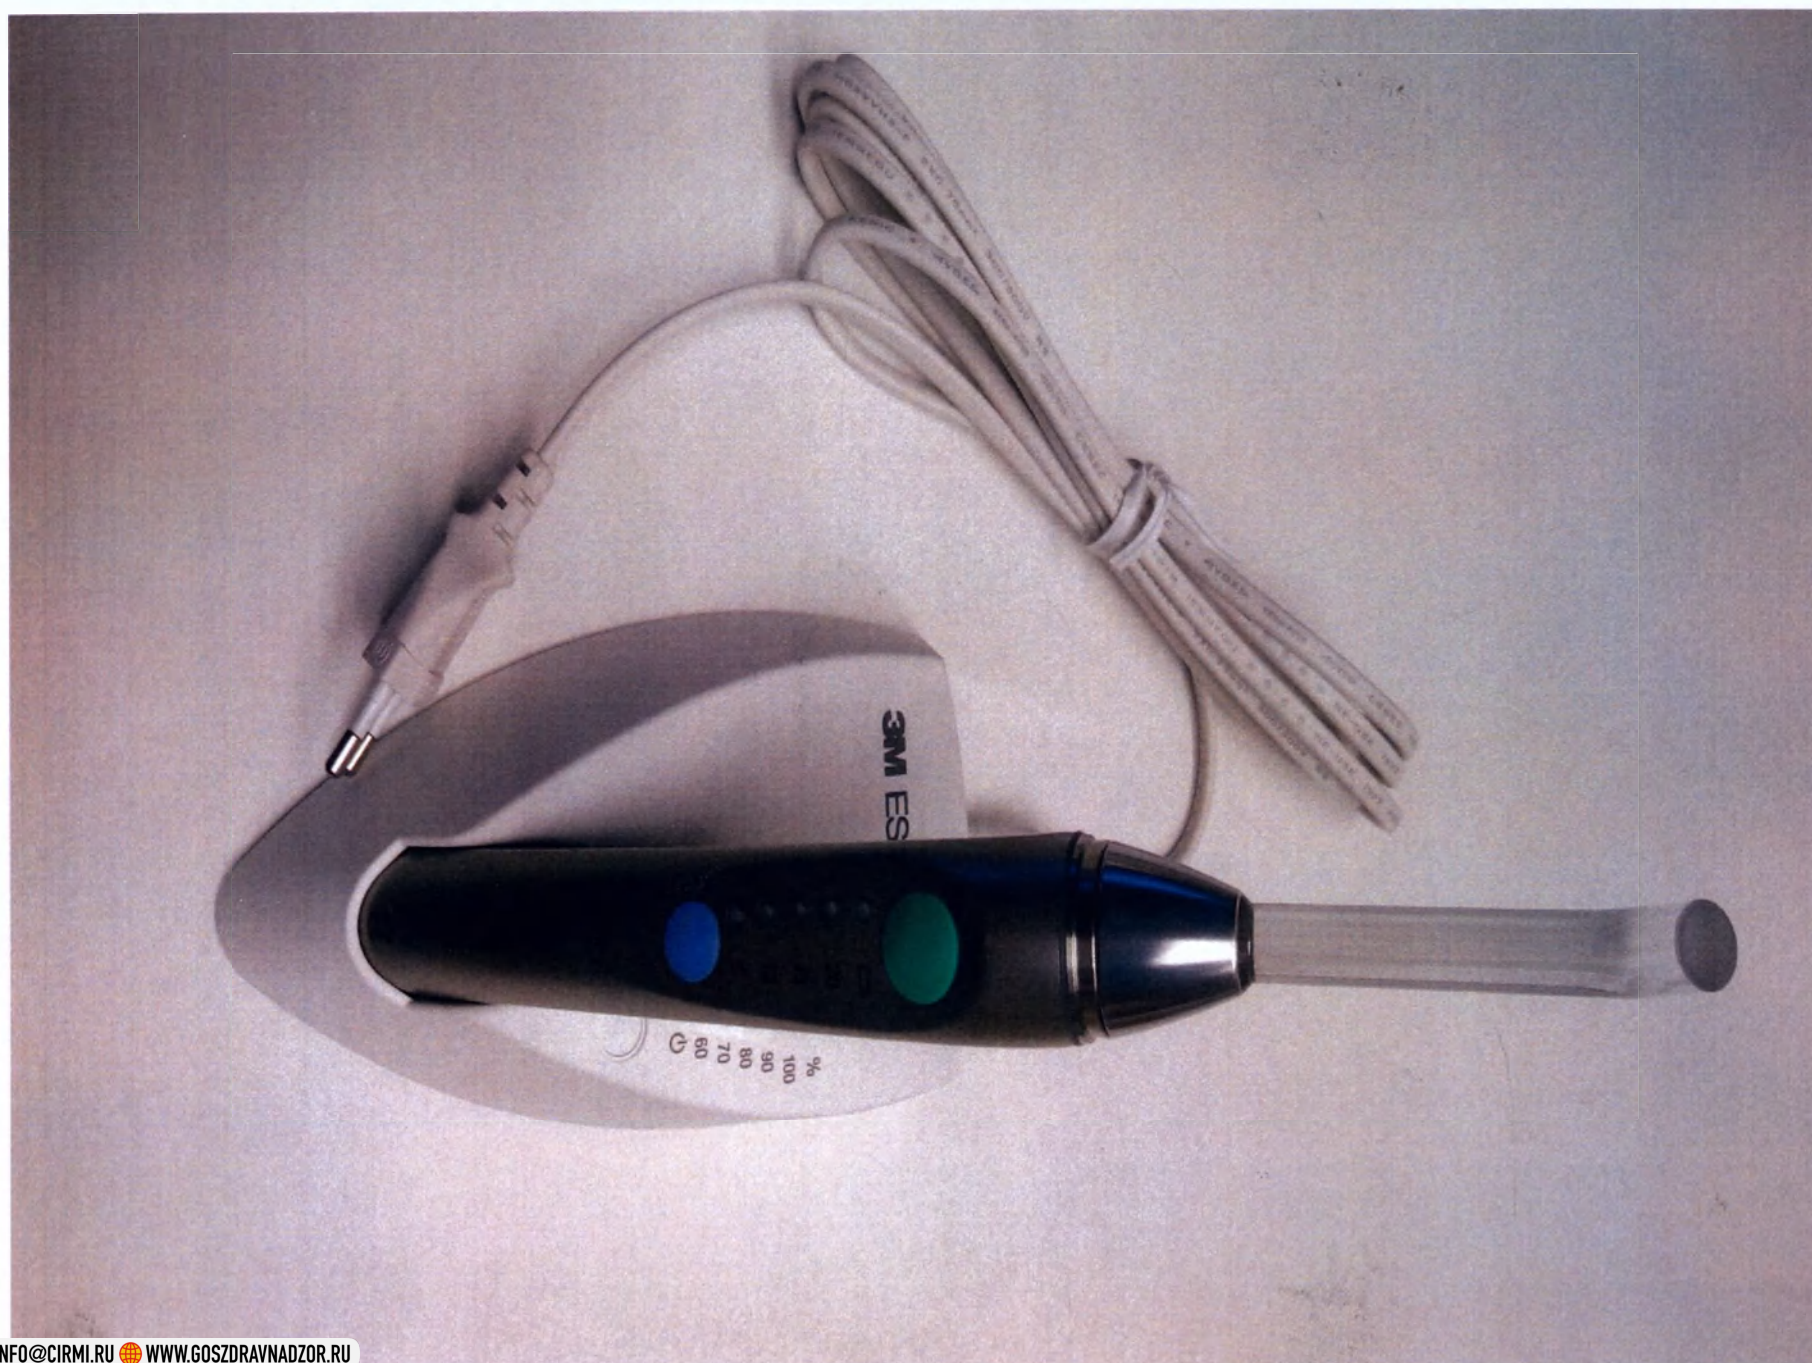


Рис. 18 Ручной блок (Handpiece).

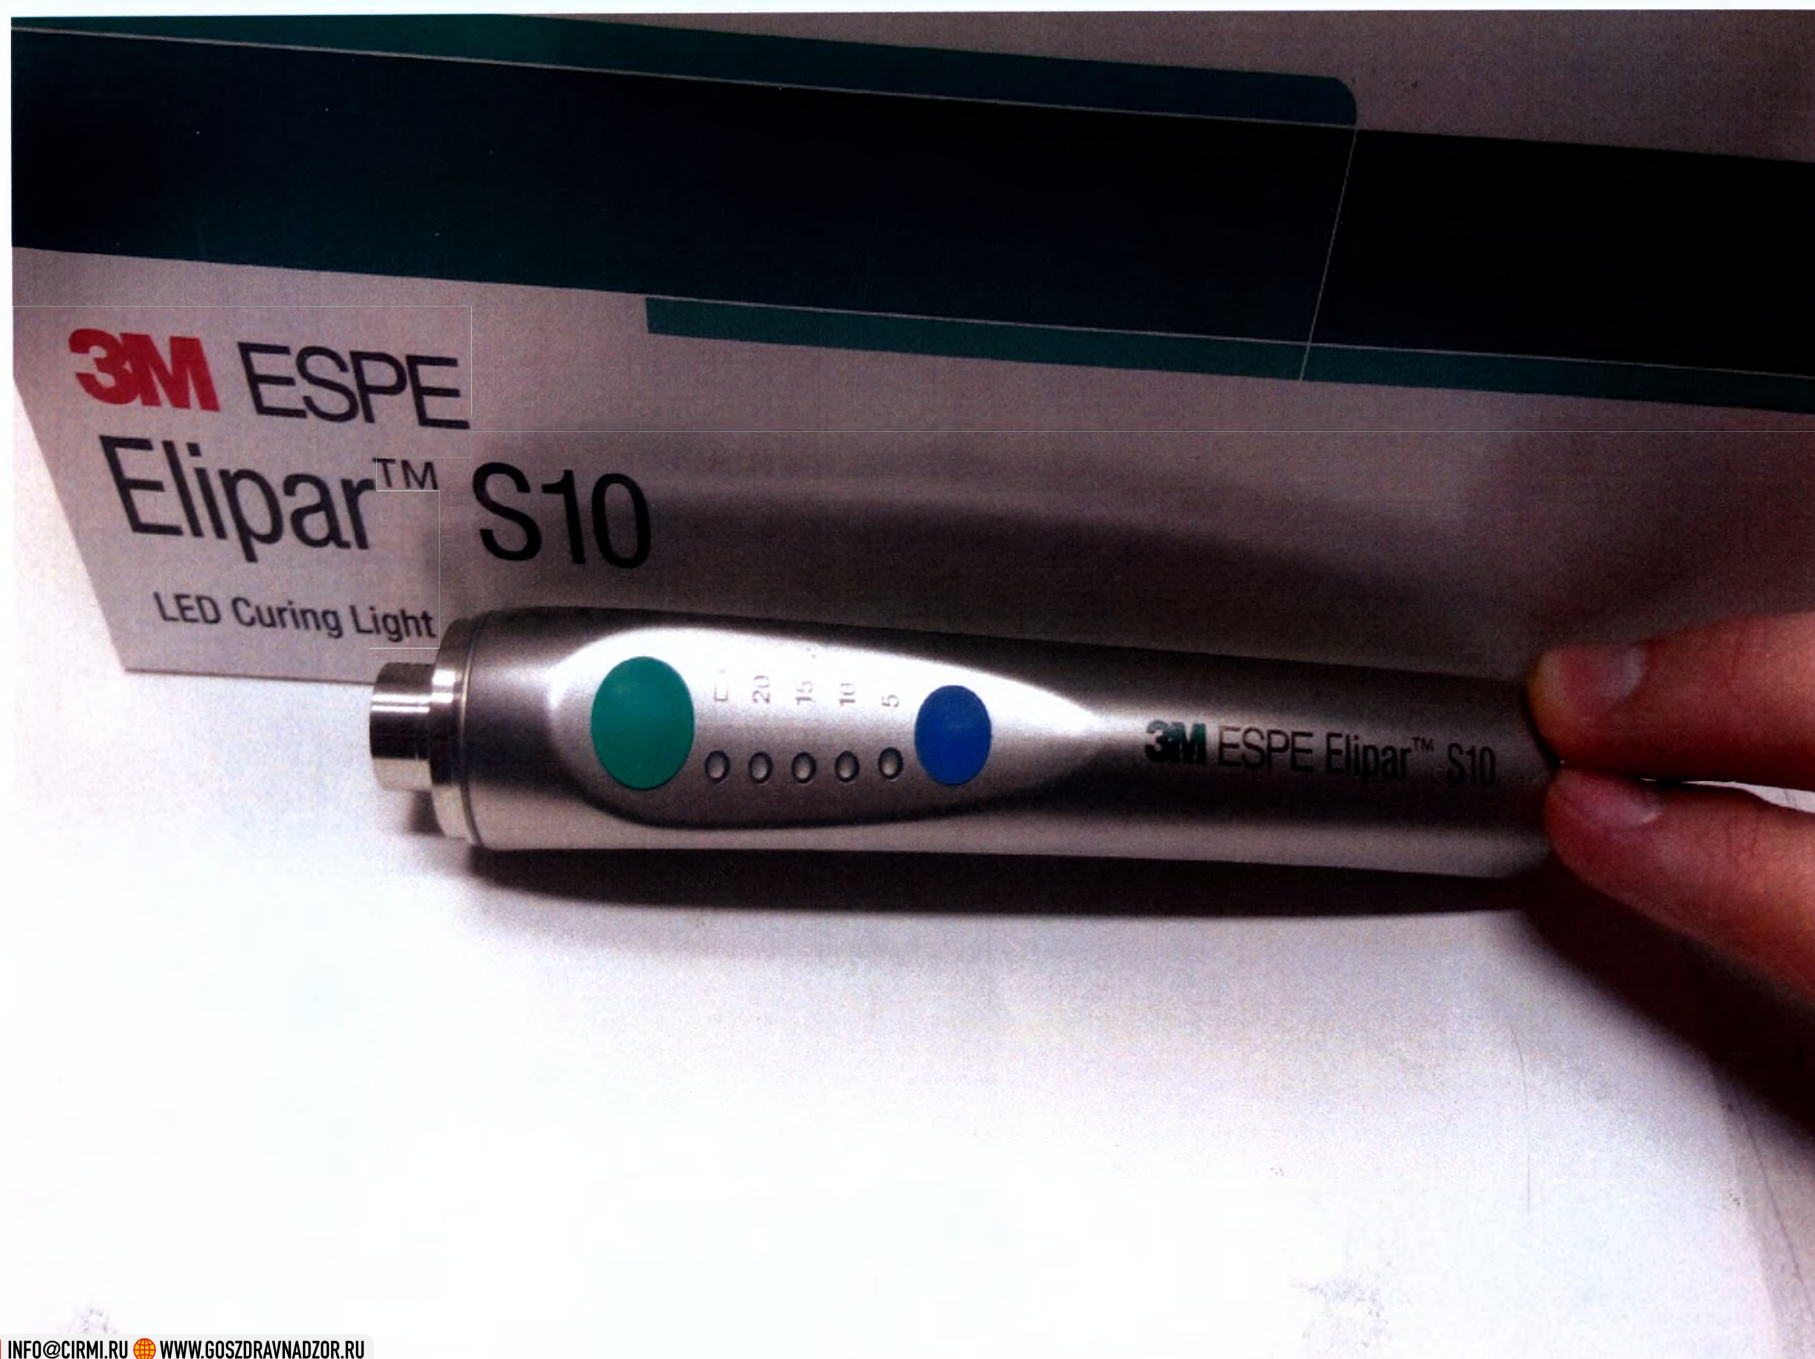


Рис. 19 Защитный щиток (Eye Shield).

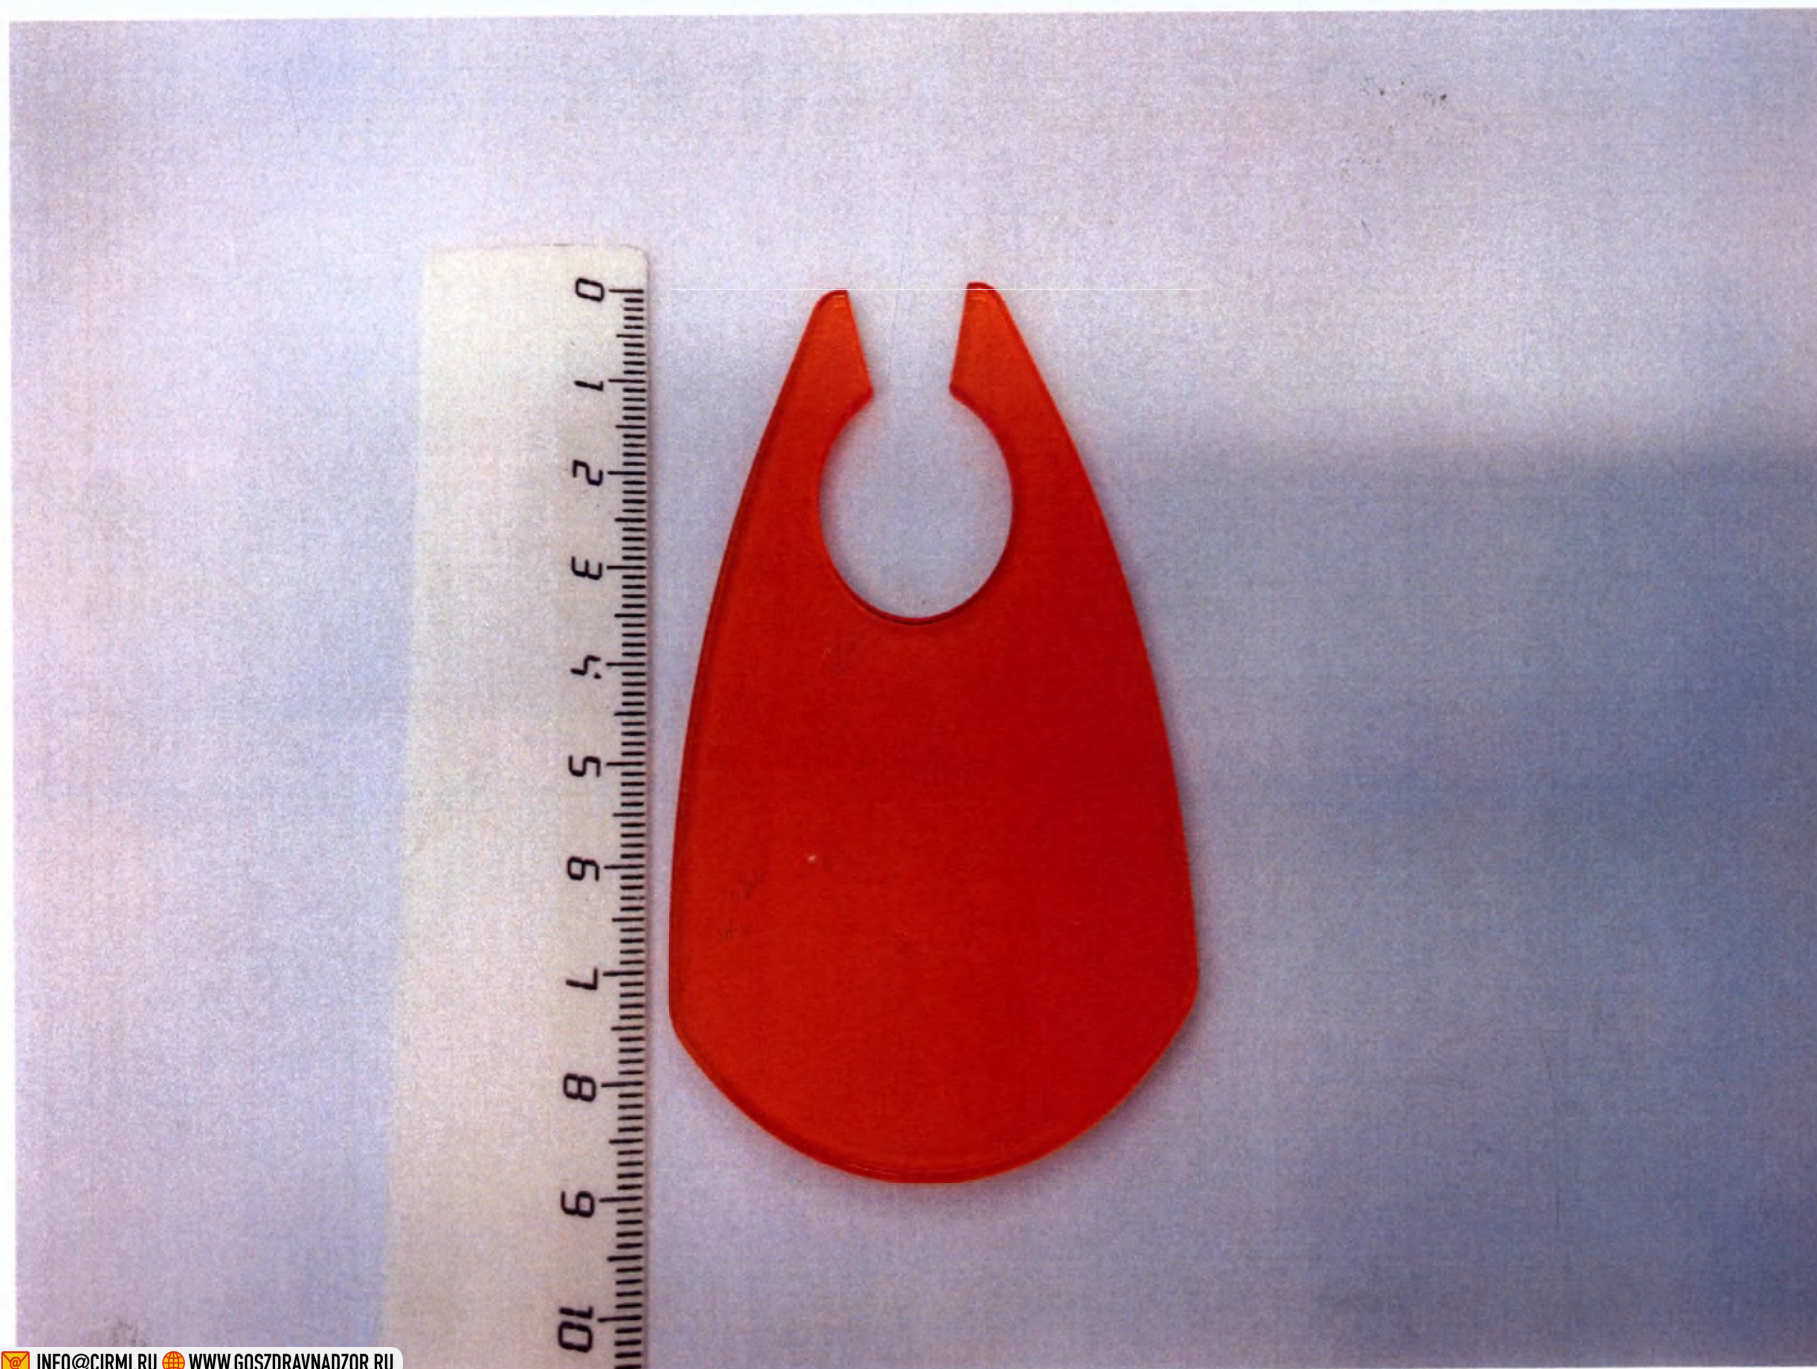


Рис.20 Батарея (Li-ion Battery).



Рис.21 Зарядное устройство (Charging base).



Рис.22 Световод, диаметром 10 мм (Light Guide). (установлен на ручной блок)

