





«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ФОТОН-БИО»
В.И. Кукушкин
«20» декабря 2019 г.


Фотографические изображения медицинского изделия
НАСАДКА СВЕТОВОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ «ФОТОН-БИО»
СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
по ТУ 26.70.23-001-32427177-2019

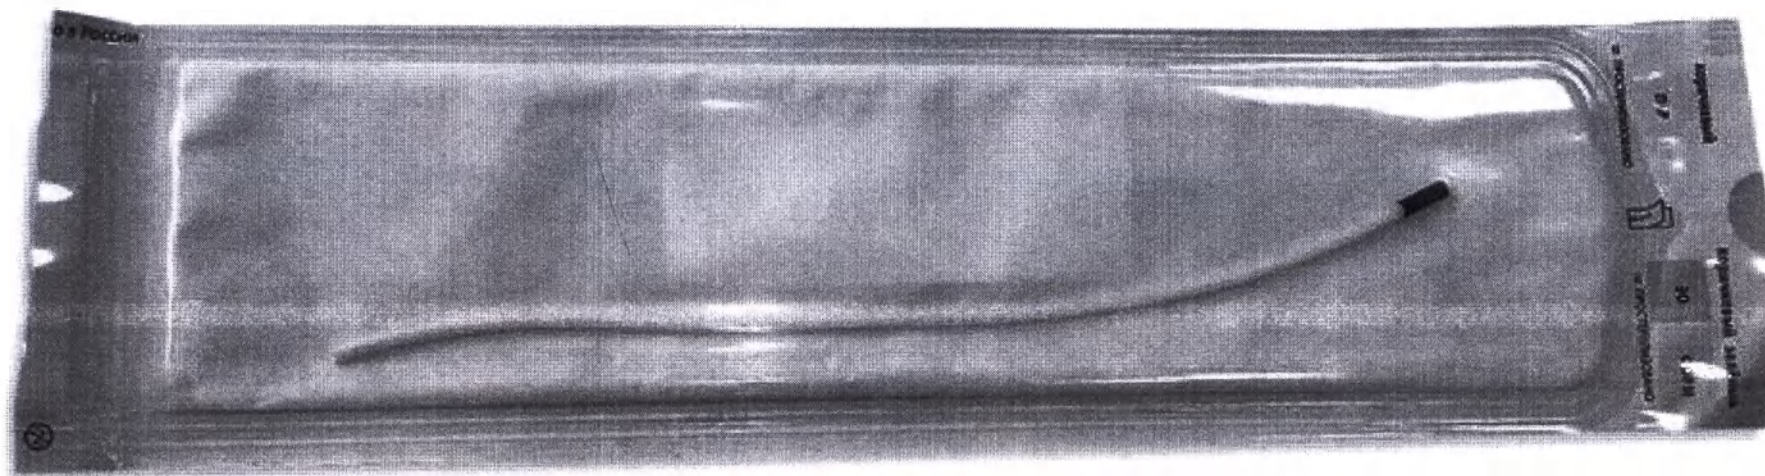


Общий вид медицинского изделия: «Насадка световодная медицинская «ФОТОН-БИО» стерильная однократного применения» по ТУ 26.70.23-001-3247177-2019, вариант исполнения ФОТОН-БИО Д

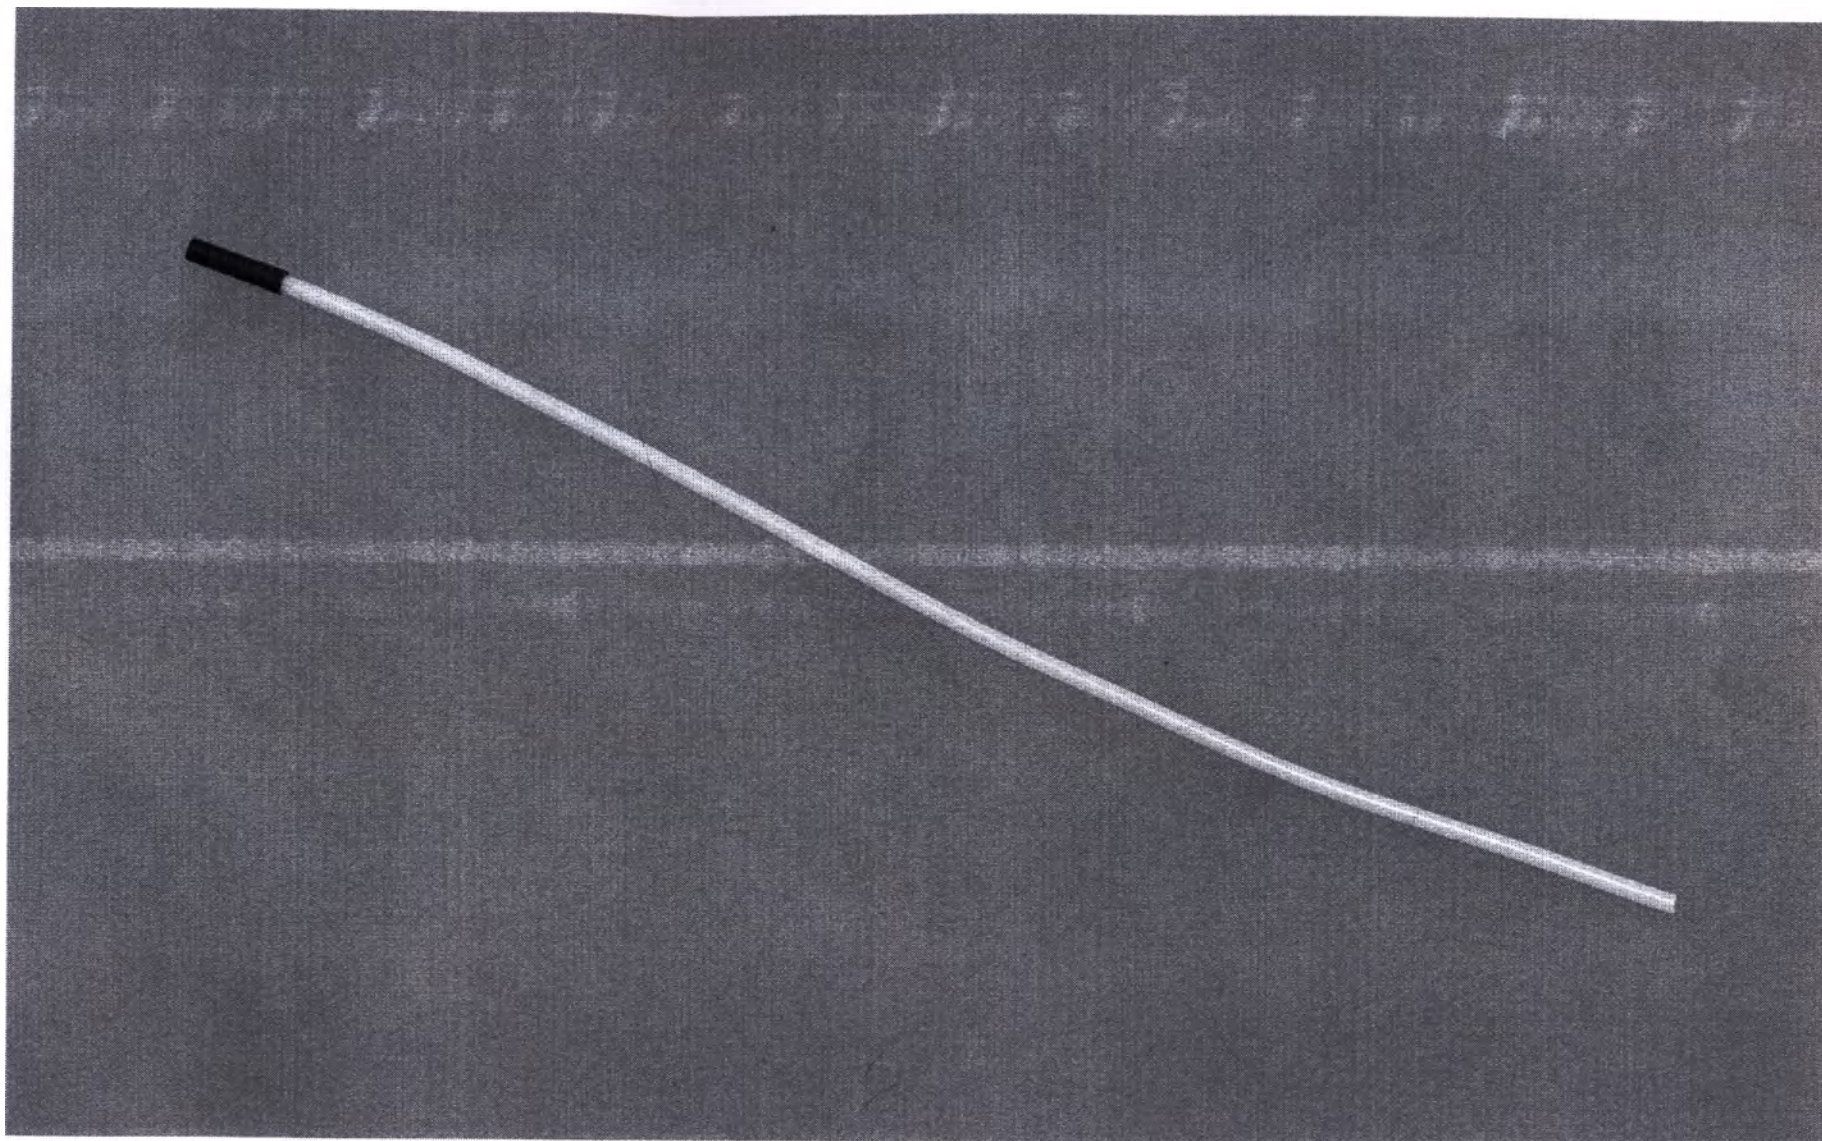


Общий вид медицинского изделия: «Насадка световодная медицинская «ФОТОН-БИО» стерильная однократного применения» по ТУ 26.70.23-001-3247177-2019, вариант исполнения ФОТОН-БИО Д

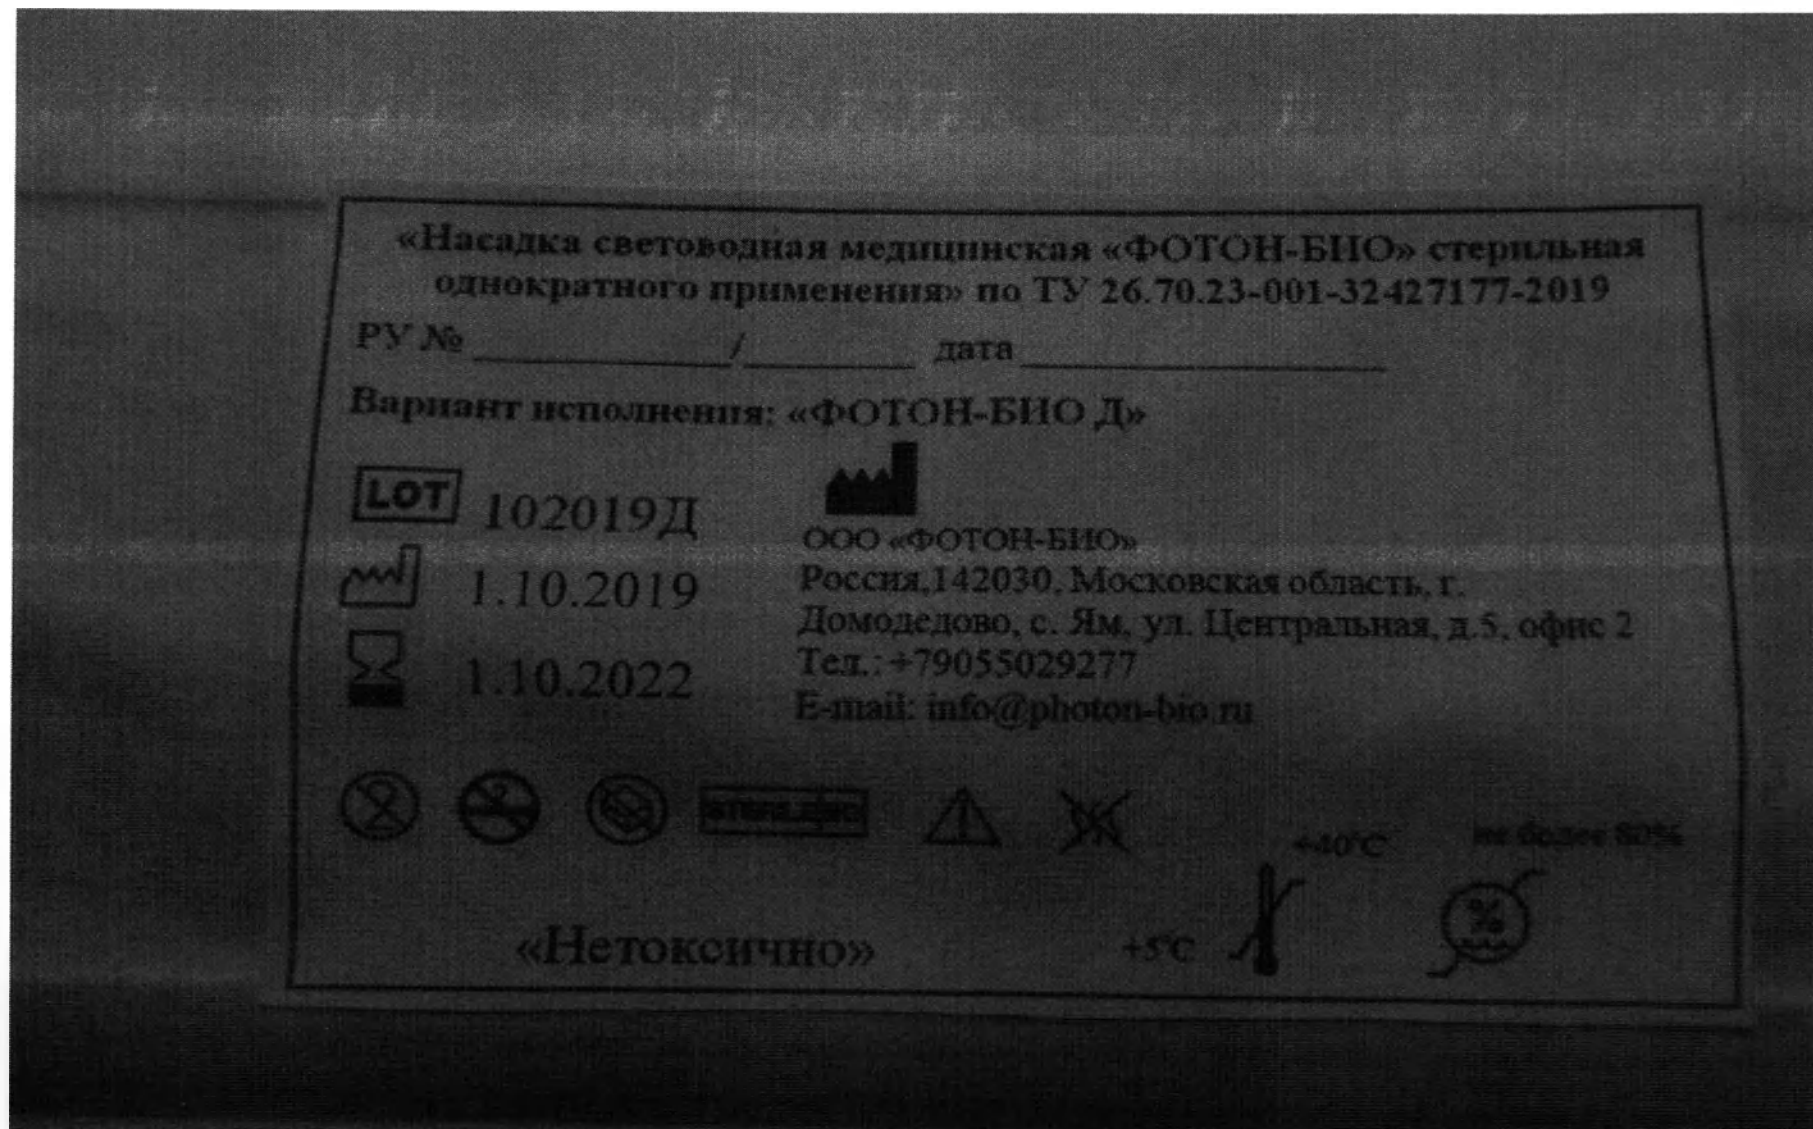

Маркировка медицинского изделия «Насадка световодная медицинская «ФОТОН-БИО» стерильная однократного применения» по ТУ 26.70.23-001-3247177-2019, вариант исполнения ФОТОН-БИО Д

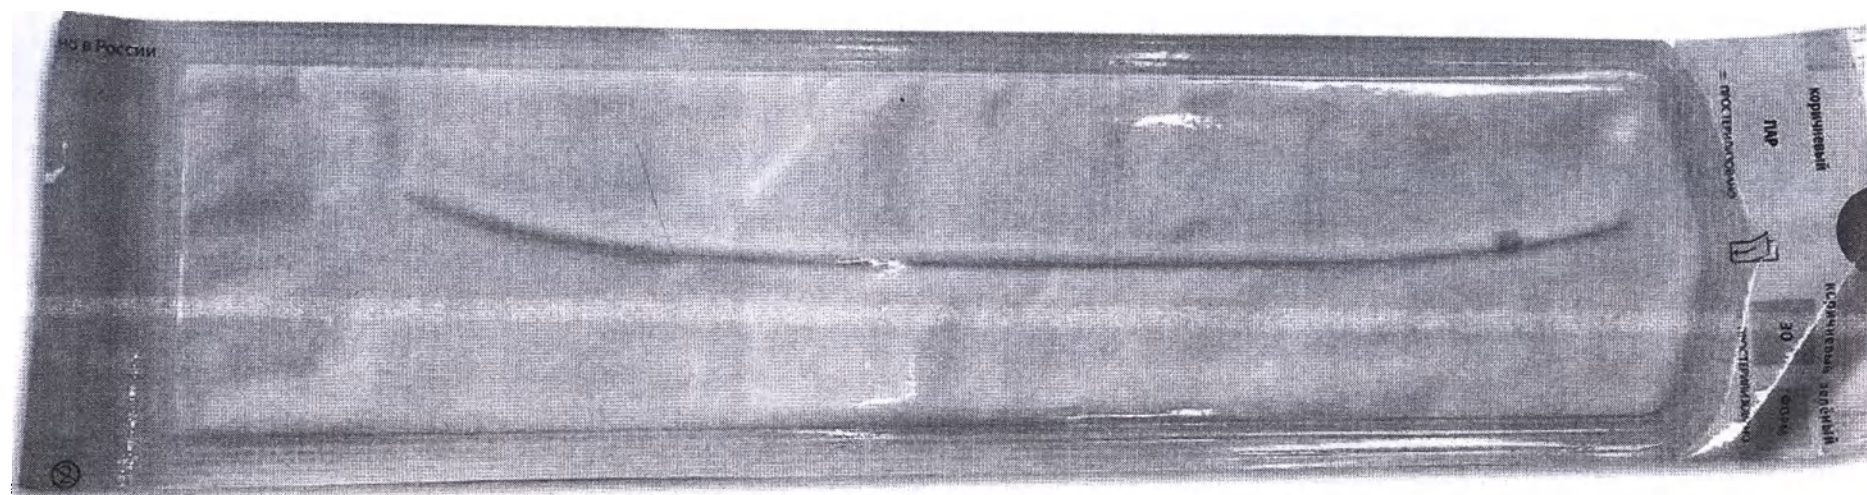

Общий вид медицинского изделия: «Насадка световодная медицинская «ФОТОН-БИО» стерильная однократного применения» по ТУ 26.70.23-001-3247177-2019, вариант исполнения ФОТОН-БИО Л

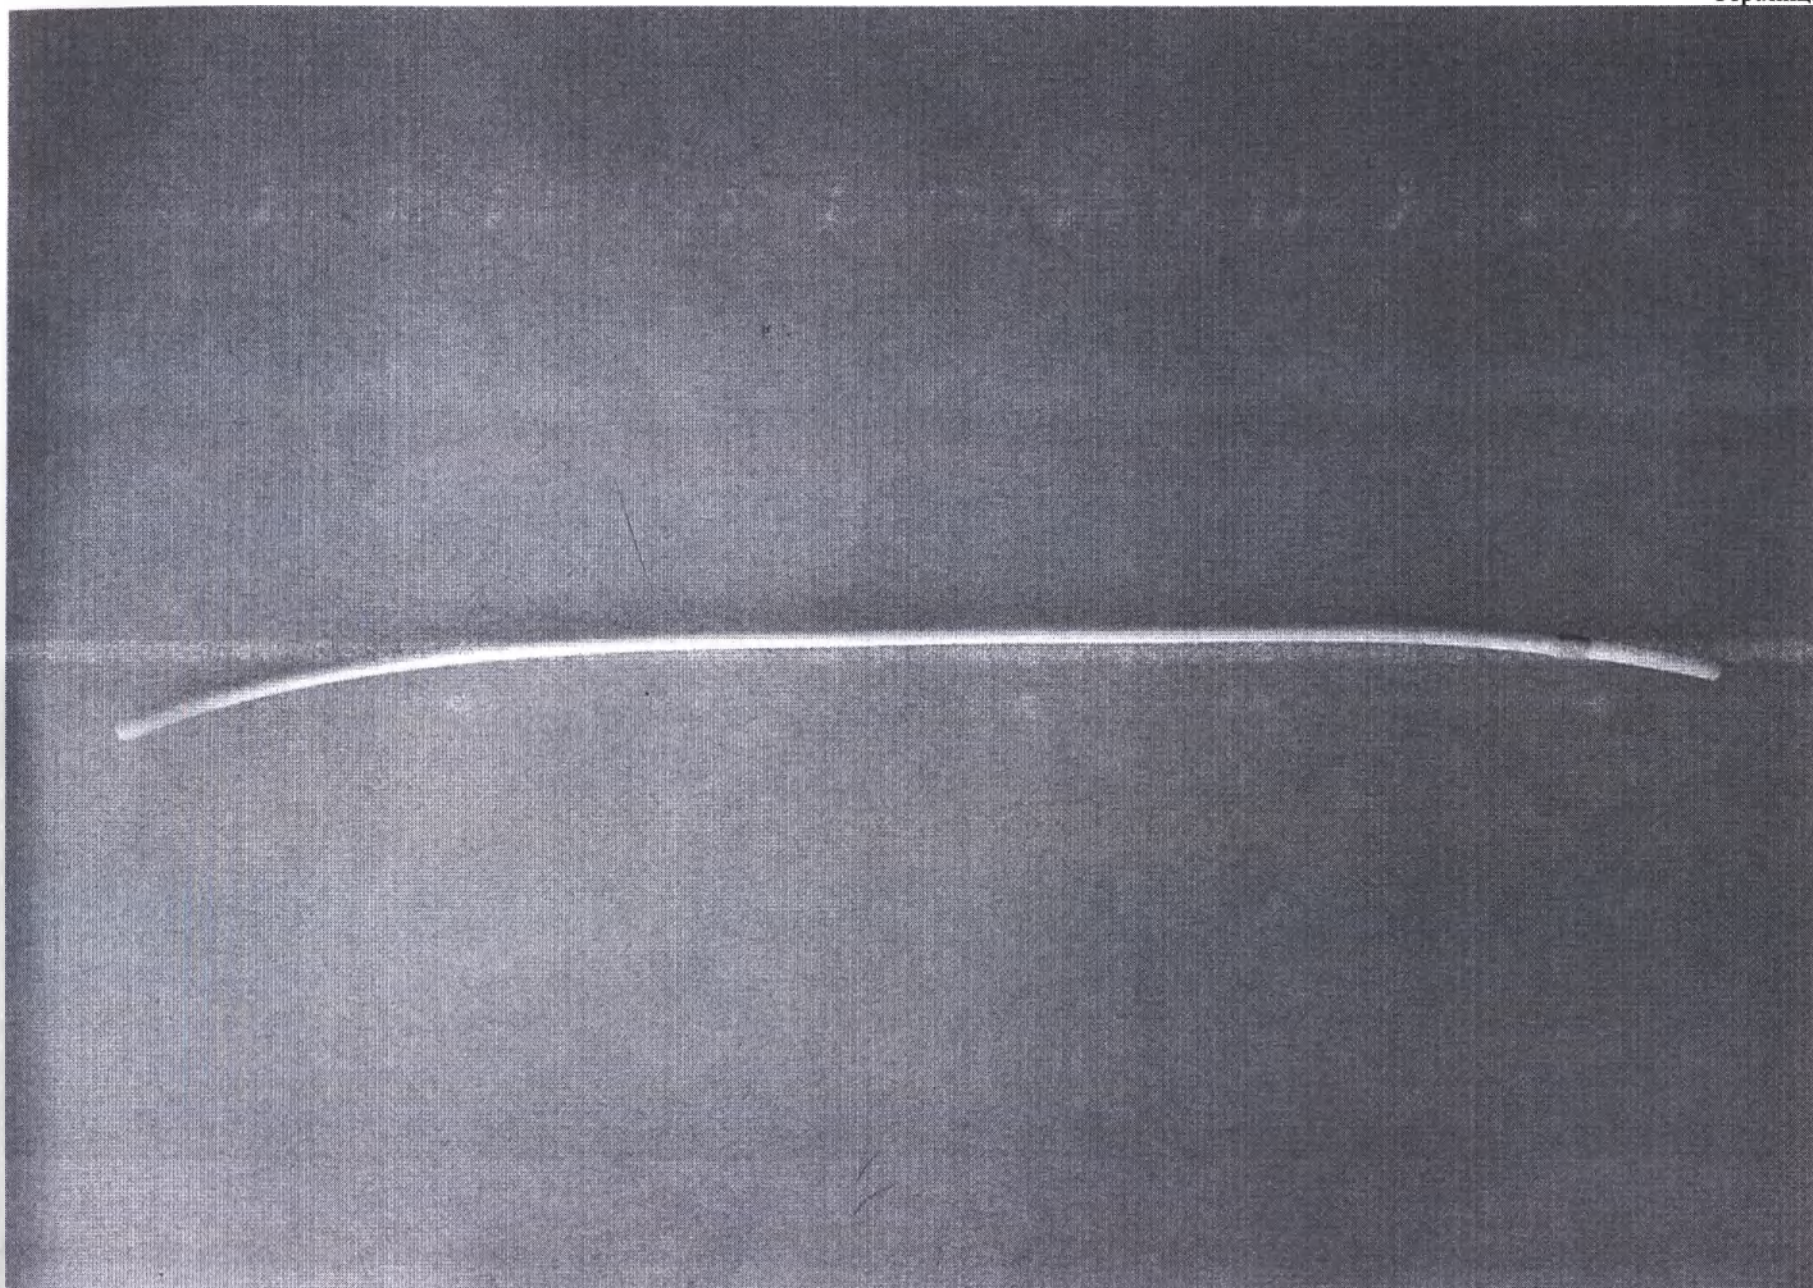

Общий вид медицинского изделия: «Насадка световодная медицинская «ФОТОН-БИО» стерильная однократного применения» по ТУ 26.70.23-001-3247177-2019, вариант исполнения ФОТОН-БИО Л

«Насадка световодная медицинская «ФОТОН-БИО» стерильная
однократного применения» по ТУ 26.70.23-001-32427177-2019

РУ № _____ / _____ дата _____

Вариант исполнения: «ФОТОН-БИО Л»

LOT 102019Л

1.10.2019

1.10.2022



ООО «ФОТОН-БИО»

Россия, 142030, Московская область, г.

Домодедово, с. Ям, ул. Центральная, д.5, офис 2

Тел.: +79055029277

E-mail: info@photon-bio.ru



STERILE



+40°C

не более 80%

«Нетоксично»

+5°C



Маркировка медицинского изделия «Насадка световодная медицинская «ФОТОН-БИО» стерильная однократного применения» по ТУ 26.70.23-001-3247177-2019, вариант исполнения ФОТОН-БИО Л



«Насадка световодная «ФОТОН-БИО» стерильная однократного применения» по ТУ 26.70.23-001-32427177-2019

Вариант исполнения: «ФОТОН-БИО Л»

Условия транспортирования:

Температура воздуха: от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха 100% при $+25^{\circ}\text{C}$

Условия хранения:

Температура воздуха: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха 80 % при $+25^{\circ}\text{C}$

Масса нетто: 3,3 кг

Масса брутто: 3,5 кг

Размеры транспортной упаковки (Ш×Г×В) 450×300×200 мм

Количество потребительских упаковок в транспортной: 20



ООО «ФОТОН-БИО»

Россия, 142030, Московская область, г. Домодедово, с. Ям,

ул. Центральная, д.5, офис 2

Тел. +79055029277

E-mail: info@photon-bio.ru

Маркировка транспортной тары медицинского изделия «Насадка световодная медицинская «ФОТОН-БИО» стерильная однократного применения» по ТУ 26.70.23-001-3247177-2019, вариант исполнения ФОТОН-БИО Л



«Насадка световодная «ФОТОН-БИО» стерильная однократного применения» по ТУ 26.70.23-001-32427177-2019

Вариант исполнения: «ФОТОН-БИО Д»

Условия транспортирования:

Температура воздуха: от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха 100% при $+25^{\circ}\text{C}$

Условия хранения:

Температура воздуха: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха 80 % при $+25^{\circ}\text{C}$

Масса нетто: 3,3 кг

Масса брутто: 3,5 кг

Размеры транспортной упаковки (Ш×Г×В): 450×300×200 мм

Количество потребительских упаковок в транспортной: 20



ООО «ФОТОН-БИО»

Россия, 142030, Московская область, г. Домодедово, с. Ям.

ул. Центральная, д.5, офис 2

Тел. +79055029277

E-mail: info@photon-bio.ru

Маркировка транспортной тары медицинского изделия «Насадка световодная медицинская «ФОТОН-БИО» стерильная однократного применения» по ТУ 26.70.23-001-3247177-2019, вариант исполнения ФОТОН-БИО Д

Всего в данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью 9 листа
Генеральный директор ООО «ФОТОН-БИО»
 В.И. Кукушкин

