


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Аппарат физиотерапевтический для диатермии Human Tescar HCR,
модель HCR 1002**

производства

Unibell S.r.l., Via Indipendenza 27, 23885 Calco (LC), Italy


Блок управления: HCR 1002

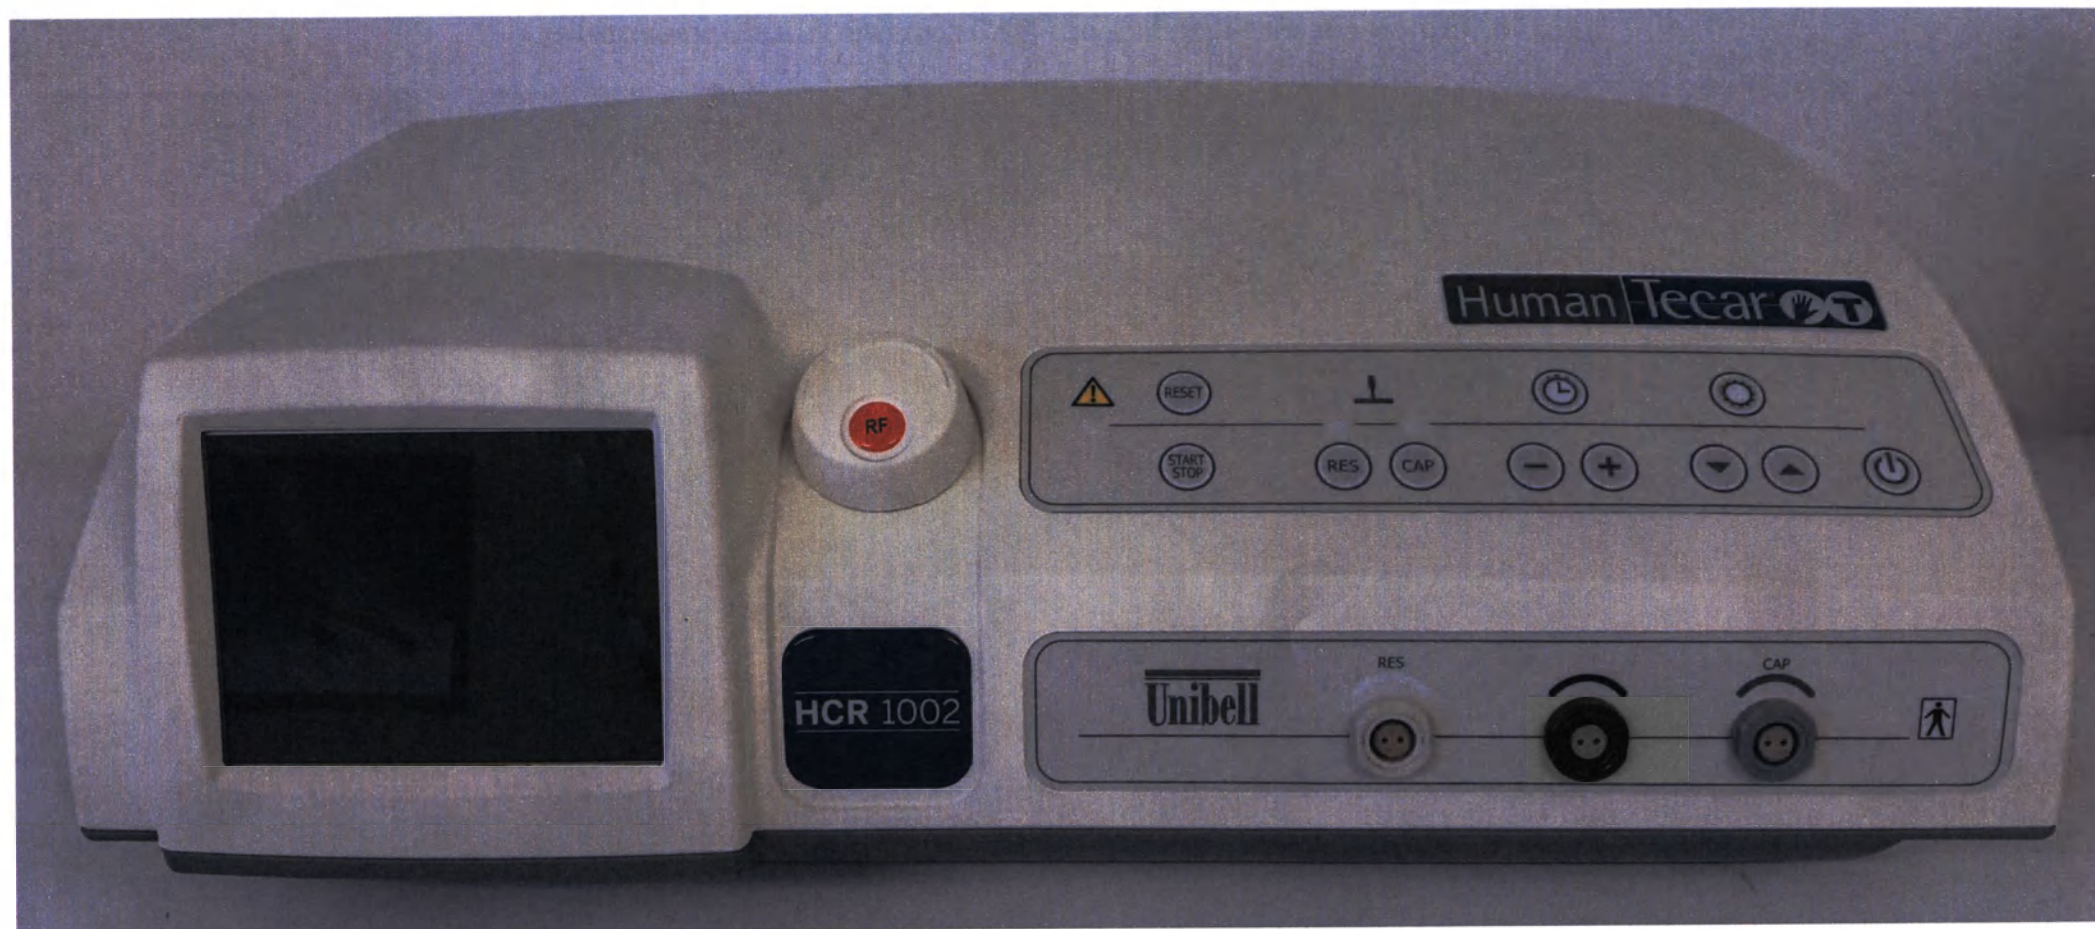


Высокоимпедансный электрод САР, плоский, термодинамический Ø 30 мм, Высокоимпедансный электрод САР, плоский, термодинамический Ø 40 мм,
Высокоимпедансный электрод САР, плоский, термодинамический Ø 55 мм, Высокоимпедансный электрод САР, плоский, термодинамический Ø 65 мм,
Высокоимпедансный электрод САР, плоский, термодинамический Ø 80 мм



Высокоимпедансный САР-электрод, плоский, утолщенный и лимфодинамический (для лица) Ø 55 мм

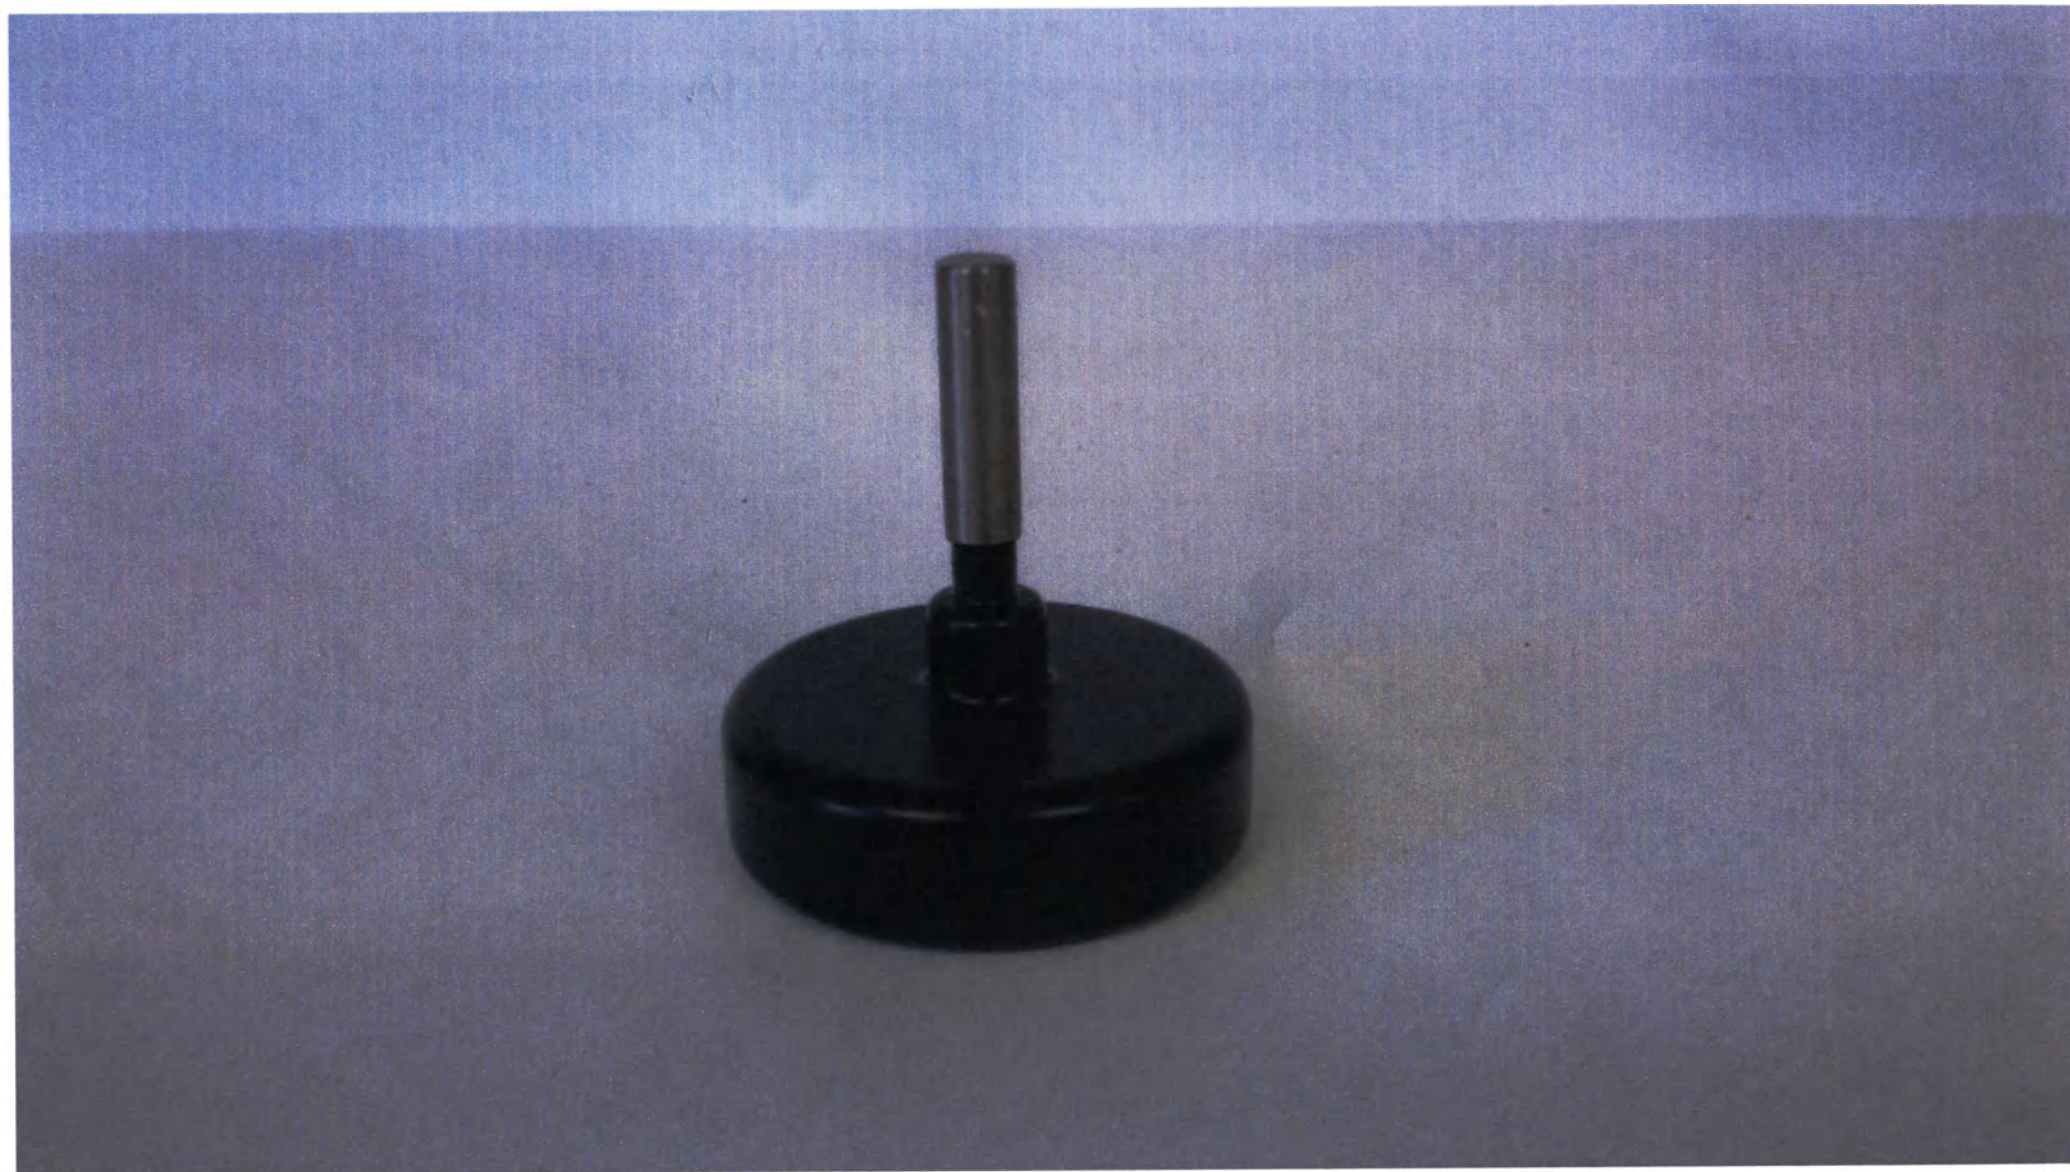

Высокоимпедансный САР-электрод, выпуклый, термодинамический Ø 30 мм, Высокоимпедансный САР-электрод, выпуклый, термодинамический Ø 40 мм, Высокоимпедансный САР-электрод, выпуклый, термодинамический Ø 55 мм, Высокоимпедансный САР-электрод, выпуклый, термодинамический Ø 65 мм

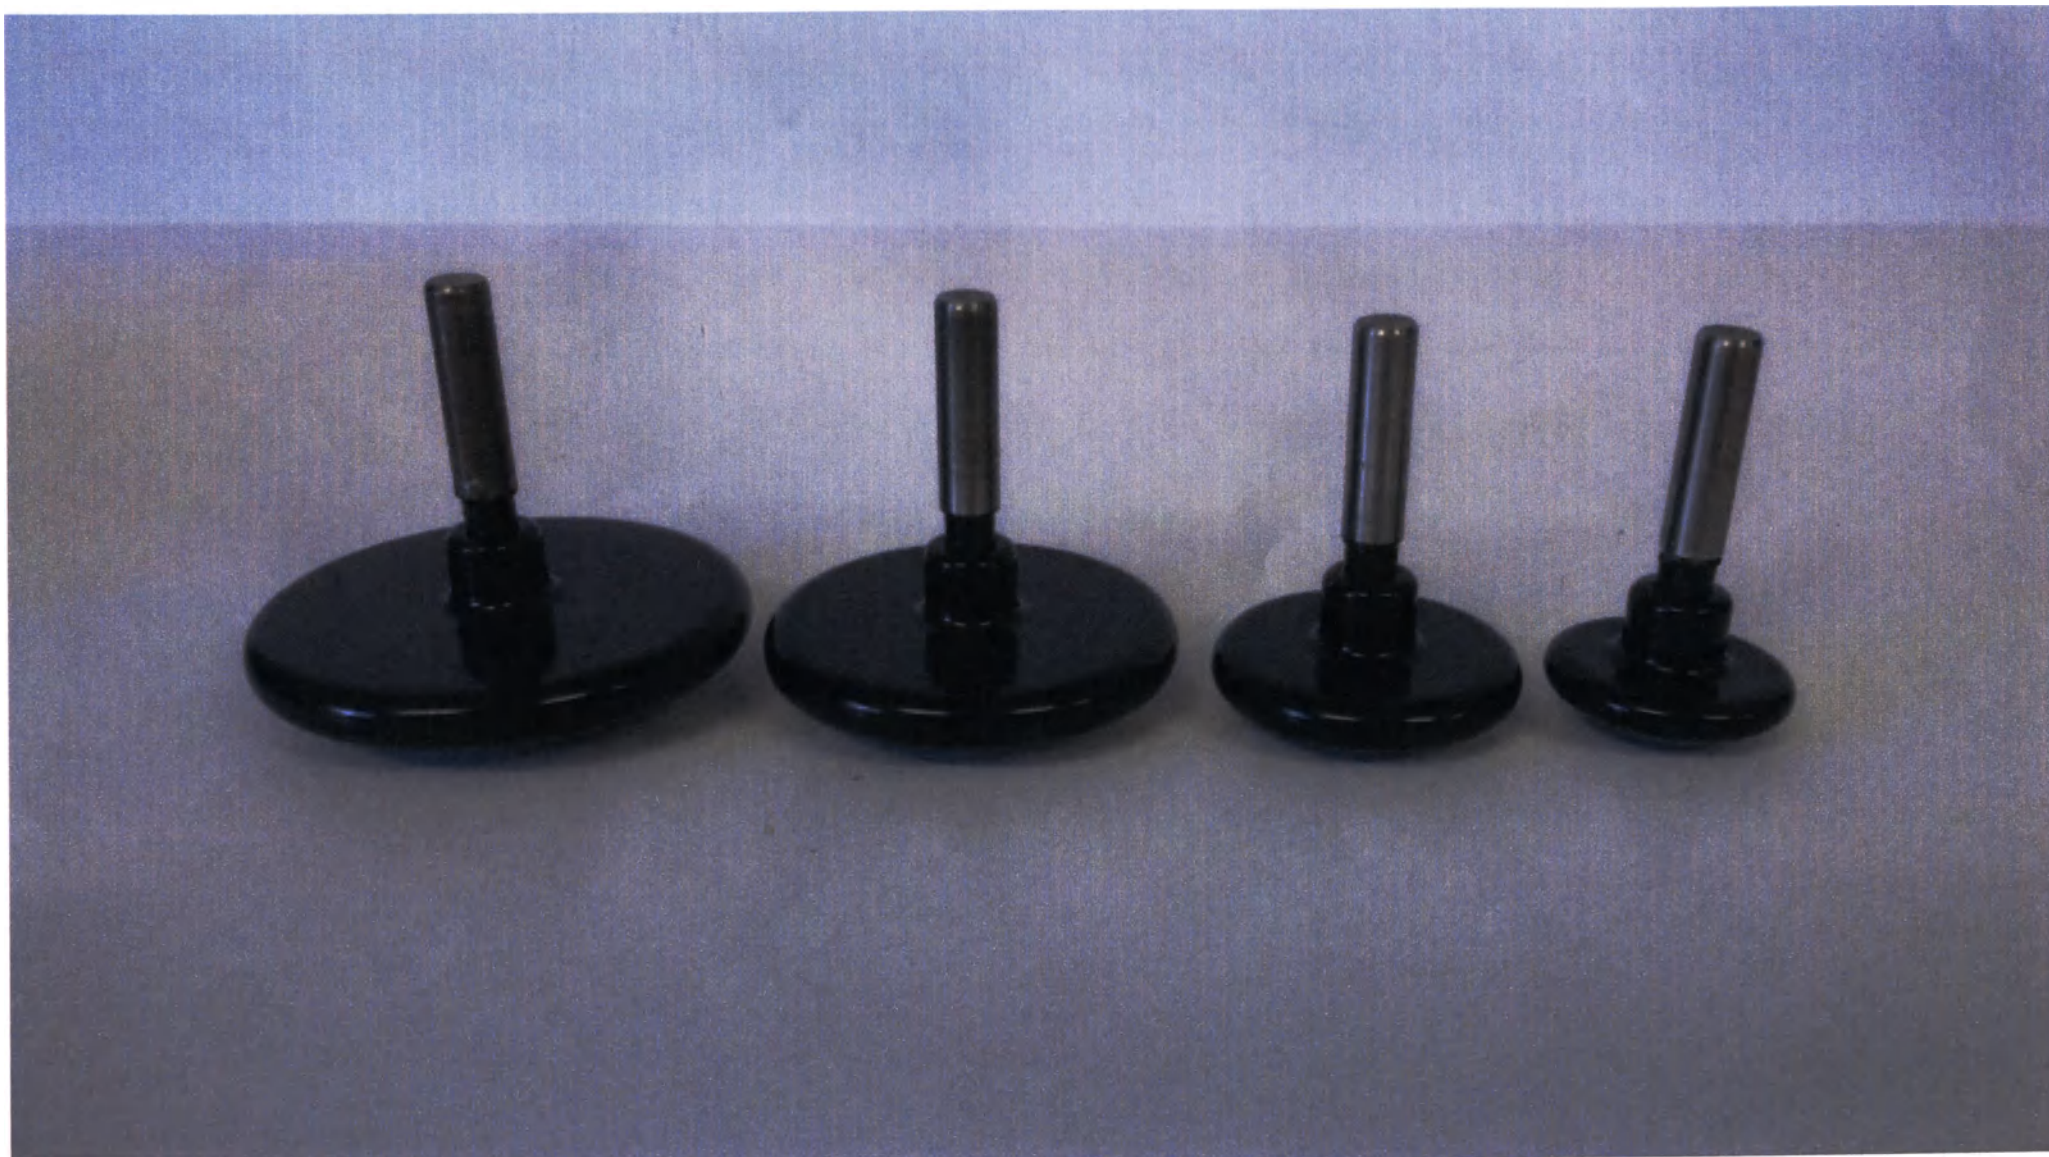

Высокоимпедансный САР-электрод, выпуклый, лимфодинамический Ø 40 мм
Высокоимпедансный САР-электрод, выпуклый, лимфодинамический Ø 55 мм



Электрод с низким сопротивлением RES 35 мм, Электрод с низким сопротивлением RES 50 мм, Электрод с низким сопротивлением RES 65 мм, Электрод с низким сопротивлением RES 90 мм.



Изогнутый держатель с кабелем для электродов САР



Прямой держатель с кабелем для электродов САР



Изогнутый держатель с кабелем для электродов RES



Прямой держатель с кабелем для электродов RES



Цилиндрический нейтральный электрод с кабелем




Плоский нейтральный электрод



Пульт дистанционного управления




Руководство пользователя (USB-накопитель)
Руководство по эксплуатации

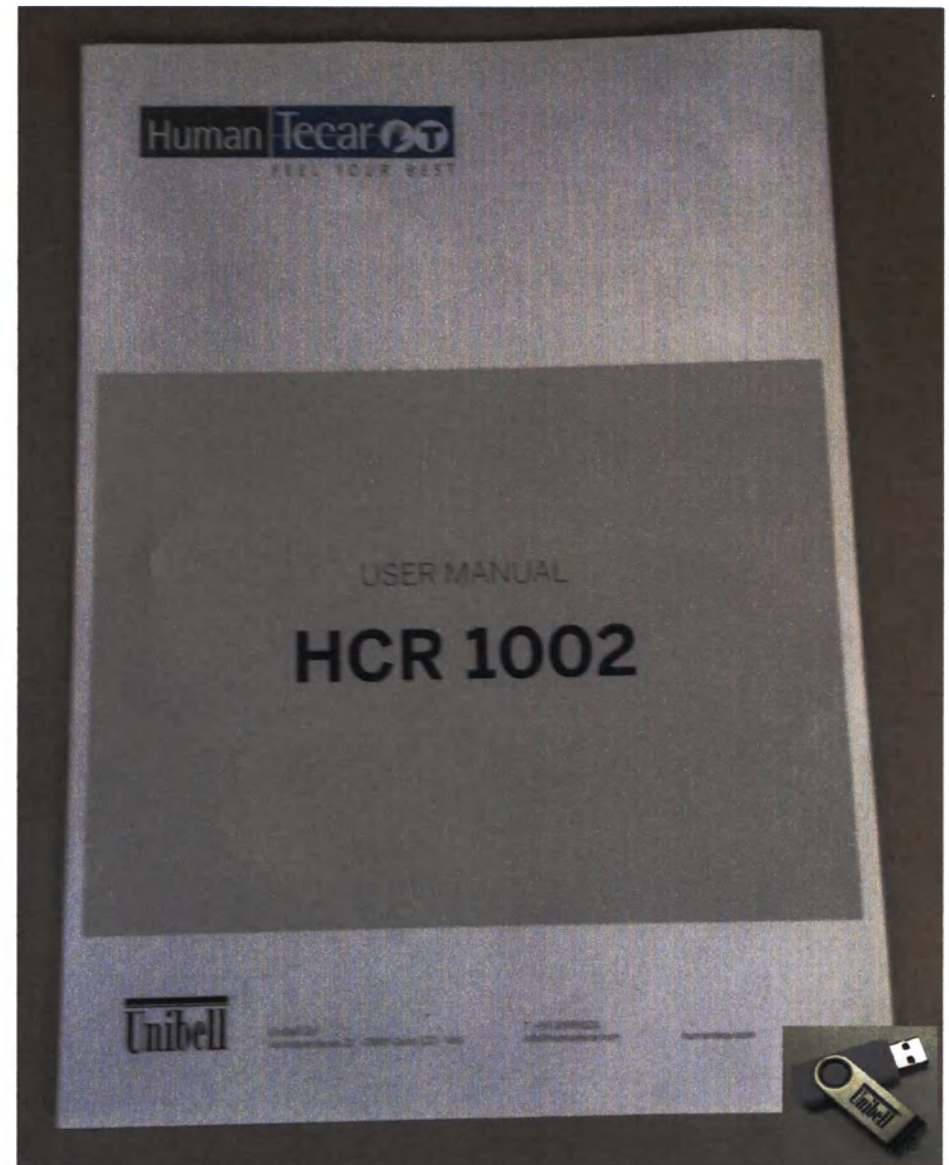

Сетевой фильтр



Шнур питания

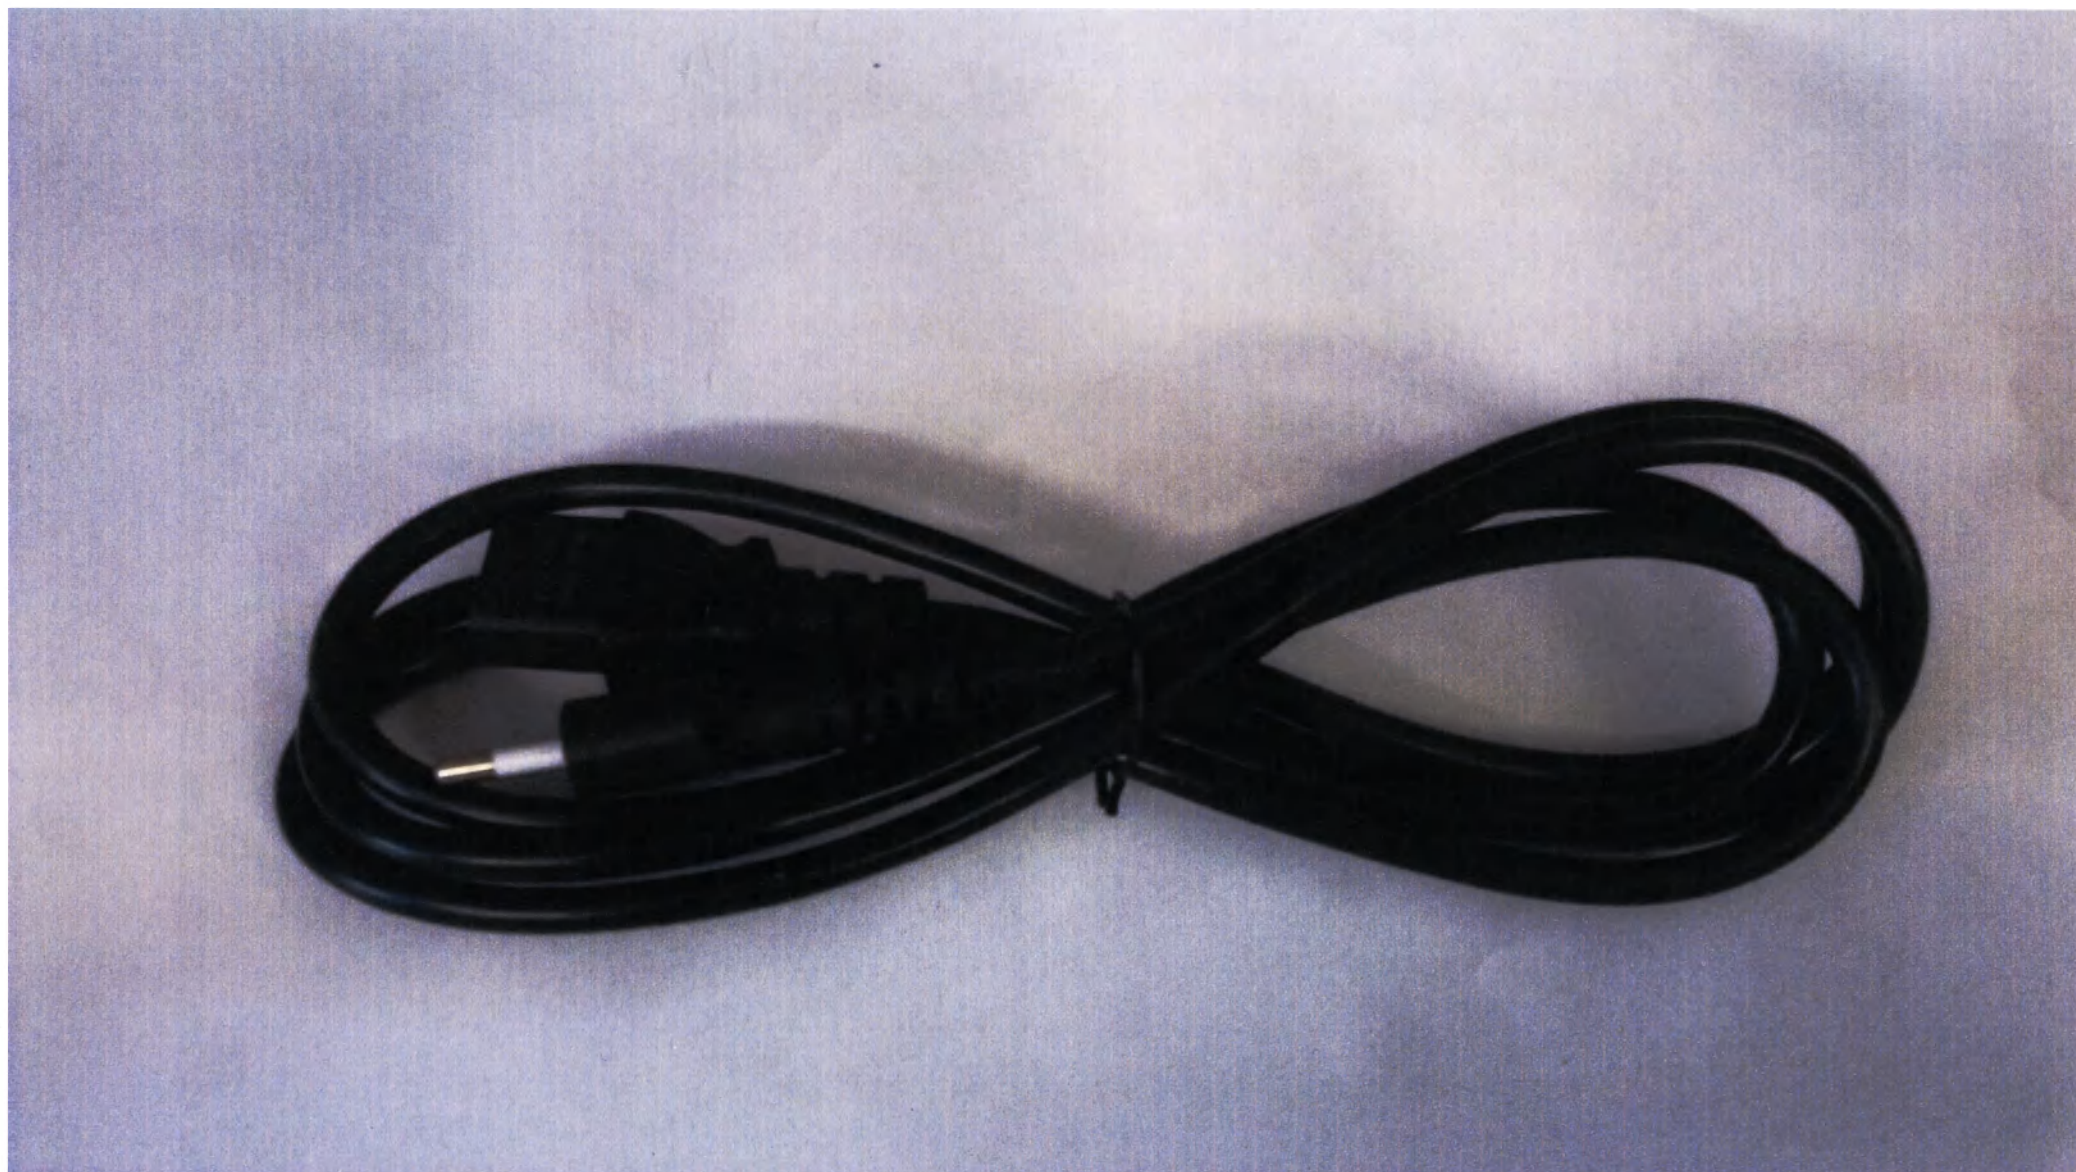

Упаковка



Human Tecar 

ome nergetica

Art. 16576



UNIBELL S.r.l.

Via Indipendenza, 27
23885 CALCO (LC) ITALY
P.Iva IT03103780130

Matricola/SN 171093392




171093392



**Norme per lo stoccaggio/
Rules for storage**

- Temperatura ambiente/
Room temperature -30/+70 °C
- Umidità relativa/Relative
humidity 10/75%
- Pressione atmosferica/
Atmospheric pressure 50/106 kPa

Human Tecar  CE 1936

HCR 1002

REF 16576

100 - 240 V 50 - 60 Hz 380VA

2 x T5A H250V

SN 171093392

2017

Unibel Srl
via Indipendenza, 27 - 23885 - Calco (LC) - Italy
info@humantecar.com - www.humantecar.com



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью на 19

дедетиализации листах

Генеральный директор
ООО «Терапевт»

 Понарина И.В.

