

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
_____ А.Г.Плехов



_____ 2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA)
в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом
«ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-083-94568735-2019**

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.11

Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови имунотурбидиметрическим методом

ТУ 21.20.23-083-94568735-2019
РЗН 2020/9978 от 09.04.2020

Реагент №1: 1 x 90 мл
Реагент №2: 1 x 3 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0045 Дата выпуска: 2023-05 Годен до: 2025-05
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK IgA-VITAL
R1: 1 x 90 мл
R2: 1 x 3 мл
Calibrator: 1 x 0,5 мл

LOT 0045

2025-05

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



43112305810045

ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ

REF B 43.11
REF B 43.41
REF B 43.51

90 мл
буфер

LOT 0045

Годен до: 2025-05



только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ

REF B 43.11
REF B 43.41
REF B 43.51

3 мл
антисыворотка

LOT 0045

Годен до: 2025-05



только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ

0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)
LOT 6138

Годен до: 2025-05




только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.31

Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 2 x 180 мл
Реагент №2: 1 x 12 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл

ТУ 21.20.23-083-94568735-2019
РЗН 2020/9978 от 09.04.2020

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0045 Дата выпуска: 2023-05 Годен до: 2025-05
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK IgA-VITAL

R1: 2 x 180 ml

R2: 1 x 12 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0045

2025-05

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



43312212610044

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.31
REF B 43.53

РЕАГЕНТ 1

180 мл

буфер

LOT 0045

Годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.31
REF B 43.53

РЕАГЕНТ 1

180 мл

буфер

LOT 0045

Годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.31
REF B 43.53

РЕАГЕНТ 2

12 мл

антисыворотка

LOT 0045

Годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 g/l)

LOT 6138

Годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.41

Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 90 мл
 Реагент №2: 1 x 3 мл
 Калибратор: 1 x 0,5 мл
 Контроль(высокий уровень): 1 x 1,0 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Серия: 0045
 Дата выпуска: 2023-05
 Годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK IgA-VITAL

R1: 1 x 90 ml
 R2: 1 x 3 ml
 Calibrator: 1 x 0,5 ml
 Control high: 1 x 1,0 ml

LOT 0045

2025-05

IVD



43612212610044

ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ

REF B 43.11
 REF B 43.41
 REF B 43.51

90 мл

буфер

LOT 0045

Годен до: 2025-05

2°C 8°C

только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ

REF B 43.11
 REF B 43.41
 REF B 43.51

3 мл

антисыворотка

LOT 0045

Годен до: 2025-05

2°C 8°C

только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ

0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 g/l)

LOT 6138

Годен до: 2025-05

2°C 8°C

только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ

1,0 мл

278(236-320) мг/дл
 (2,78(2,36-3,20) g/l)

высокий уровень

LOT 6221

Годен до: 2025-05

2°C 8°C

только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.51

Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 90 мл
Реагент №2: 1 x 3 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл
Калибратор: 1 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-083-94568735-2019
РЗН 2020/9978 от 09.04.2020

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0045 Дата выпуска: 2023-05 Годен до: 2025-05
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 55, литера А

UK IgA-VITAL
R1: 1 x 90 ml
R2: 1 x 3 ml
Calibrator: 1 x 0,5 ml
Calibrator : 1 x 1,0 ml

LOT 0045

2025-05

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 55 A 194356
St. Petersburg, Russia



43712201720038

ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ

ВИТАЛ REF B 43.11
REF B 43.41
REF B 43.51

90 мл
буфер

LOT 0045

Годен до: 2025-05



только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ

ВИТАЛ REF B 43.11
REF B 43.41
REF B 43.51

3 мл
антисыворотка

LOT 0045

Годен до: 2025-05



только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ

0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)

LOT 6138

Годен до: 2025-05



только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ

1,0 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)

LOT 6138

Годен до: 2025-05




только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.53

Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 2 x 180 мл
Реагент №2: 1 x 12 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл
Калибратор: 1 x 1,0 мл

ТУ 21.20.23-083-94568735-2019
РЗН 2020/9978 от 09.04.2020

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0045 Дата выпуска: 2023-05 Годен до: 2025-05
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK IgA-VITAL
R1: 2 x 180 ml
R2: 1 x 12 ml
Calibrator: 1 x 0,5 ml
Calibrator: 1 x 1,0 ml

LOT 0045

2025-05

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



43732203720039

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.31
REF B 43.53

180 мл

буфер

LOT 0045



Годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.31
REF B 43.53

12 мл

антисыворотка

LOT 0045



Годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)

LOT 6138

Годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

1,0 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)

LOT 6138

Годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики



REF B 43.71-1.150

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 39 мл ТУ 21.20.23-083-94568735-2019

Реагент №2: 1 x 5,5 мл РЗН 2020/9978 от 09.04.2020

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0045Дата выпуска:
2023.05Годен до:
2025.05

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK IgA-VITAL

R1: 1 x 39 ml

R2: 1 x 5,5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT

0045



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

Годен до:
2025.05

IVD



437111501802120230



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.71-1.150

РЕАГЕНТ 1

39 мл



LOT 0045

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНО-
ГЛОБУЛИН А-
ВИТАЛ

REF B 43.71-1.150

РЕАГЕНТ 2

5.5 мл



LOT 0045

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)

LOT 6138

Годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР



REF B 43.711-1.150

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 3 x 39 мл ТУ 21.20.23-083-94568735-2019

Реагент №2: 3 x 5,5 мл РЗН 2020/9978 от 09.04.2020

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0045Дата выпуска:
2023.05Годен до:
2025.05

голько для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK IgA-VITAL

R1: 3 x 39 ml

R2: 3 x 5,5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT

0045



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

Годен до: 2025.05

IVD



437111501802120230

ИММУНО-
ГЛОБУЛИН А-
ВИТАЛ

REF B 43.711-1.150

РЕАГЕНТ 2 5.5 мл



LOT 0045

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ИММУНО-
ГЛОБУЛИН А-
ВИТАЛ

REF B 43.711-1.150

РЕАГЕНТ 2 5.5 мл



LOT 0045

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ИММУНО-
ГЛОБУЛИН А-
ВИТАЛ

REF B 43.711-1.150

РЕАГЕНТ 2 5.5 мл



LOT 0045

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.711-1.150

РЕАГЕНТ 1

39 мл



LOT

0045

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.711-1.150

РЕАГЕНТ 1

39 мл



LOT

0045

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.711-1.150

РЕАГЕНТ 1

39 мл



LOT

0045

Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)

LOT 6138

Годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



REF В 43.71-1.200

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 19 мл ТУ 21.20.23-083-94568735-2019

Реагент №2: 1 x 3,5 мл РЗН 2020/9978 от 09.04.2020

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0045 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK IgA-VITAL

R1: 1 x 19 ml

R2: 1 x 3,5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0045

2025.05

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 56 A, 194355
St. Petersburg, Russia

IVD



437111501802120230

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ REF В 43.71-1.200

РЕАГЕНТ 1

19 мл

LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



РЕАГЕНТ 2

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ REF В 43.71-1.200


3,5 мл

LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР 0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)

LOT 6138

годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



REF В 43.711-1.200

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 3 x 19 мл
 Реагент №2: 3 x 3,5 мл
 Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Серия: 0045
 Дата выпуска: 2023.05
 Годен до: 2025.05
 АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK IgA-VITAL
 R1: 3 x 19 ml
 R2: 3 x 3,5 ml
 Calibrator: 1 x 0,5 ml
 2025.05

IVD



437111501802120230



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ REF В 43.711-1.200

РЕАГЕНТ 1 19 мл
 LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



РЕАГЕНТ 1

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ REF В 43.711-1.200

РЕАГЕНТ 1 19 мл
 LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



РЕАГЕНТ 1

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ REF В 43.711-1.200

РЕАГЕНТ 1 19 мл
 LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



РЕАГЕНТ 1

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР 0,5 мл
 6100 мг/дл (61,0 г/л)
 LOT 6138

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ REF В 43.711-1.200

РЕАГЕНТ 2 3,5 мл
 LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



РЕАГЕНТ 2

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ REF В 43.711-1.200

РЕАГЕНТ 2 3,5 мл
 LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
 Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



РЕАГЕНТ 2

REF В 43.71-1.300

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 36 мл ТУ 21.20.23-083-94568735-2019

Реагент №2: 1 x 5 мл РЗН 2020/9978 от 09.04.2020

Калибратор: 1 x 0,5 мл



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0045 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK IgA-VITAL

R1: 1 x 36 ml

R2: 1 x 5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0045



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2025.05

IVD



437111501802120230

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF В 43.71-1.300



РЕАГЕНТ 1

36 мл

LOT 0045



годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНО- ГЛОБУЛИН А- ВИТАЛ

REF В 43.71-1.300

РЕАГЕНТ 2

5 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)

LOT 6138

годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики



REF В 43.711-1.300

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови имунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 3 x 36 мл ТУ 21.20.23-083-94568735-2019

Реагент №2: 3 x 5 мл РЗН 2020/9978 от 09.04.2020

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0045 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK IgA-VITAL

R1: 3 x 36 ml

R2: 3 x 5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0045

2025.05

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194358
St. Petersburg, Russia

IVD

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF В 43.711-1.300



РЕАГЕНТ 1

36 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF В 43.711-1.300



РЕАГЕНТ 1

36 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF В 43.711-1.300



РЕАГЕНТ 1

36 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНО-ГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF В 43.711-1.300

РЕАГЕНТ 2 5 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНО-ГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF В 43.711-1.300

РЕАГЕНТ 2 5 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНО-ГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF В 43.711-1.300

РЕАГЕНТ 2 5 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР 0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)

LOT 6138

годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



REF B 43.71-1.420

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови имунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 51 мл ТУ 21.20.23-083-94568735-2019

Реагент №2: 1 x 5 мл РЗН 2020/9978 от 09.04.2020

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0045 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK IgA-VITAL

R1: 1 x 51 ml

R2: 1 x 5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0045

2025.05

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



437111601802120230



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.71-1.420



РЕАГЕНТ 1

51 мл

LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНО-ГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.71-1.420



РЕАГЕНТ 2

5 мл

LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 g/l)

LOT 6138

годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики



REF B 43.711-1.420

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 4 x 51 мл ТУ 21.20.23-083-94568735-2019

Реагент №2: 4 x 5 мл РЗН 2020/9978 от 09.04.2020

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0045 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK IgA-VITAL

R1: 4 x 51 ml

R2: 4 x 5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0045

2025.05

IVD


Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194355
St. Petersburg, Russia

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.711-1.420

РЕАГЕНТ 1

51 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.711-1.420

РЕАГЕНТ 1

51 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)

LOT 6138

годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.711-1.420

РЕАГЕНТ 1

51 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.711-1.420

РЕАГЕНТ 1

51 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНО-
ГЛОБУЛИН А-
ВИТАЛ

REF B 43.711-1.420

РЕАГЕНТ 2

5 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНО-
ГЛОБУЛИН А-
ВИТАЛ

REF B 43.711-1.420

РЕАГЕНТ 2

5 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНО-
ГЛОБУЛИН А-
ВИТАЛ

REF B 43.711-1.420

РЕАГЕНТ 2

5 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНО-
ГЛОБУЛИН А-
ВИТАЛ

REF B 43.711-1.420

РЕАГЕНТ 2

5 мл



LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF B 43.71-2.200

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 38 мл ТУ 21.20.23-083-94568735-2019

Реагент №2: 1 x 9 мл РЗН 2020/9978 от 09.04.2020

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Серия: 0045 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK IgA-VITAL

R1: 2 x 38 ml

R2: 1 x 9 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0045

годен до: 2025.05

IVD

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.71-2.200

РЕАГЕНТ 1

38 мл

LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.71-2.200

РЕАГЕНТ 1

38 мл

LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



437111501802120230



ИММУНО-ГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.71-2.200

РЕАГЕНТ 2

9 мл

LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)

LOT 6138

годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF B 43.71-2.300

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 34 мл
 Реагент №2: 1 x 8,2 мл
 Калибратор: 1 x 0,5 мл

ТУ 21.20.23-083-94568735-2019
 РЗН 2020/9978 от 09.04.2020



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0045 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK IgA-VITAL

R1: 2 x 34 ml
 R2: 1 x 8,2 ml
 Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0045
 2025.05

Vital Development Corporation
 Doroga v Kamenu 56 A, 194355
 St. Petersburg, Russia

IVD



437111501802120230



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.71-2.300

РЕАГЕНТ 1

34 мл

LOT 0045 2°C 8°C

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.71-2.300

РЕАГЕНТ 1

34 мл

LOT 0045 2°C 8°C

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНО-ГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF B 43.71-2.300

РЕАГЕНТ 2

8,2 мл

2°C 8°C
 LOT 0045

годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

0,5 мл

6100 мг/дл (61,0 г/л)

LOT 6138

годен до: 2025-05

только для in vitro диагностики



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 16 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов



2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA)
в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом
«ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-083-94568735-2019**

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

REF B 43.11

ТУ 21.20.23-083-94608735-2019
РФ

Реагент №1: 1 x 90 мл
Реагент №2: 1 x 3 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серии: 0016

Дата выпуска: 2019-07

Годен до: 2021-07

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
191356 Санкт-Петербург, Дорога в Клименту,
дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK IgA-VITAL

LOT 0015

R1: 1 x 90 ml

R2: 1 x 3 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

2021-07

Vital Development Corporation
Doroga v Klimentu 56 k 191356
St. Petersburg, Russia



43111900000005



ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ
 Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом
 Реагент №1: 1 x 90 мл
 Реагент №2: 1 x 3 мл
 Капиратор: 1 x 0,5 мл
 Контроль (высокий уровень): 1 x 1,0 мл
 Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBeAg отсутствуют
 Годен до: 2021-07
 Серия: 0015
 Дата выпуска: 2019-07
 АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
 191356 Санкт-Петербург, Дорога в Колпино, дом 55, литера А
 ТУ 21.20.23-093-94868735-2019
 ru

только для in vitro диагностики

UK IgA-VITAL
 R1: 1 x 90 ml
 R2: 1 x 3 ml
 Calibrator: 1 x 0,5 ml
 Control high: 1 x 1,0 ml


LOT 0015

2021-07

MD



43811908000030

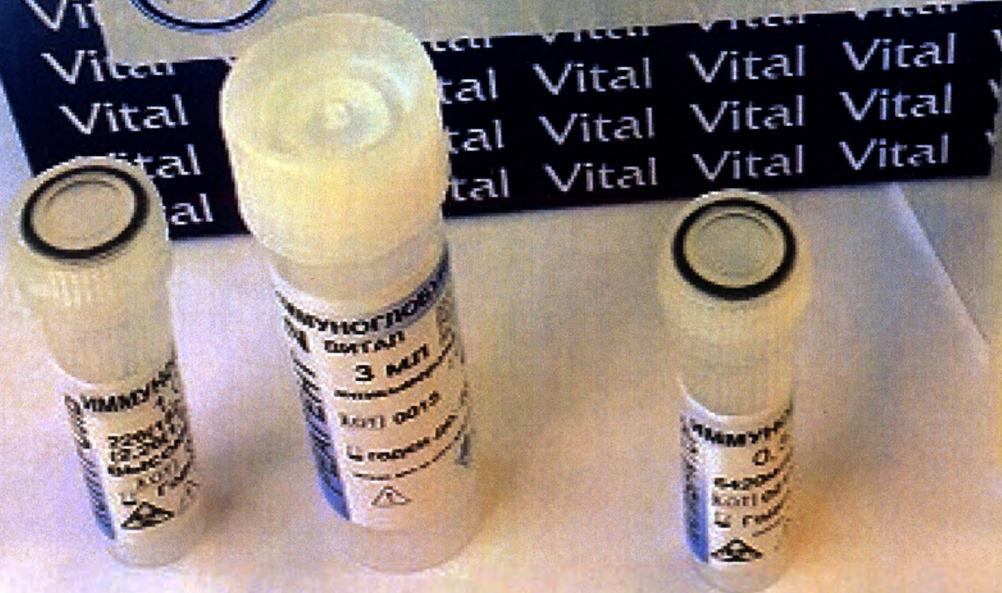

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ
 РЕАГЕНТ 1
 REF B 43.11
 REF B 43.41
 REF B 43.51
 90 мл
 буфер
 LOT 0015
 Годен до: 2021-07
 25 30 C
 Vital

ИММУНОГЛОБУЛИН А-
ВИТАЛ

REF B 43.51

Набор реактивов для определения концентрации иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1 1 x 90 мл
Реагент №2 1 x 3 мл
Калибратор 1 x 0,5 мл
Калибратор 1 x 1,0 мл

TV 21.20.23-063-9456RT38-2210
PV

Антигела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HbSAd отсутствуют

Серия: 0015

Дата выпуска
1988-07

Годен до:
2021-07

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия,
124356 Санкт-Петербург, Дорога в Коминку,
дом 66, литера А

только для *in vitro* диагностики

UK 10A-VITAL

R1: 1 x 90 ml

R2: 1 x 3 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml
Calibrator: 1 x 1,0 ml

LOT 0015

2021-07

(VD)

Development Consultant
George K. Karamanidis, P.E.
St. Petersburg, Russia



4371 10015070035

ИММУНОГЛОБУЛИН-А
ВИТАЛ WALBY 40 mg

ВИТАЛ

90 мл

547

LOT 0015

Годен до: 2024-07

20

PEATEHT 1







1.0 MET
0015

ВЫТАП
3 МЛ
100% ОЧИЩ.
4 ГОДА И БОЛЕЕ

0.5 MPT



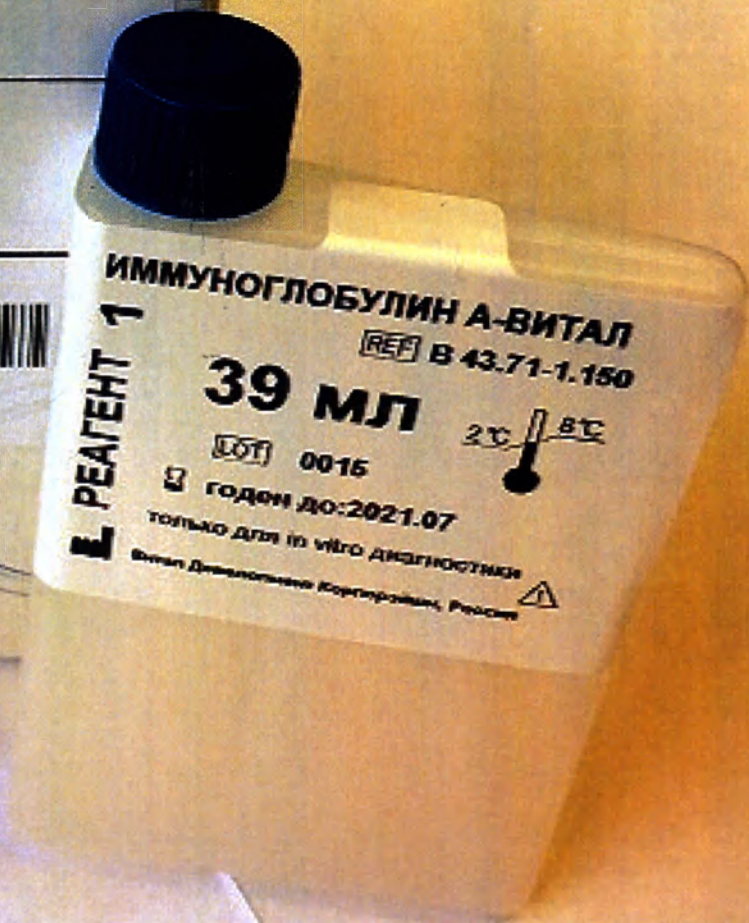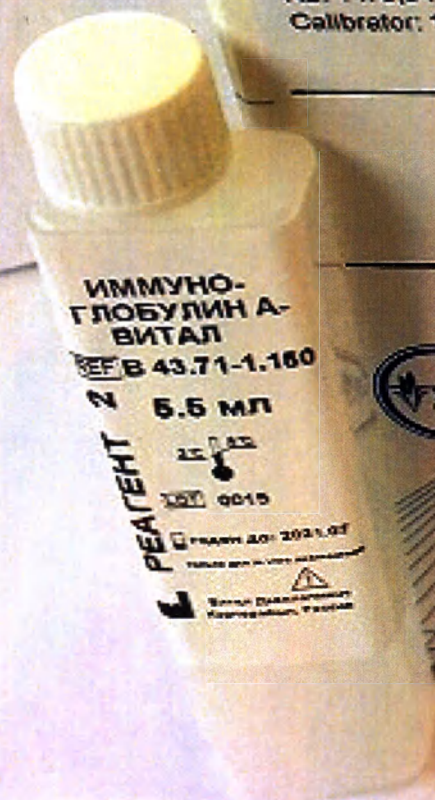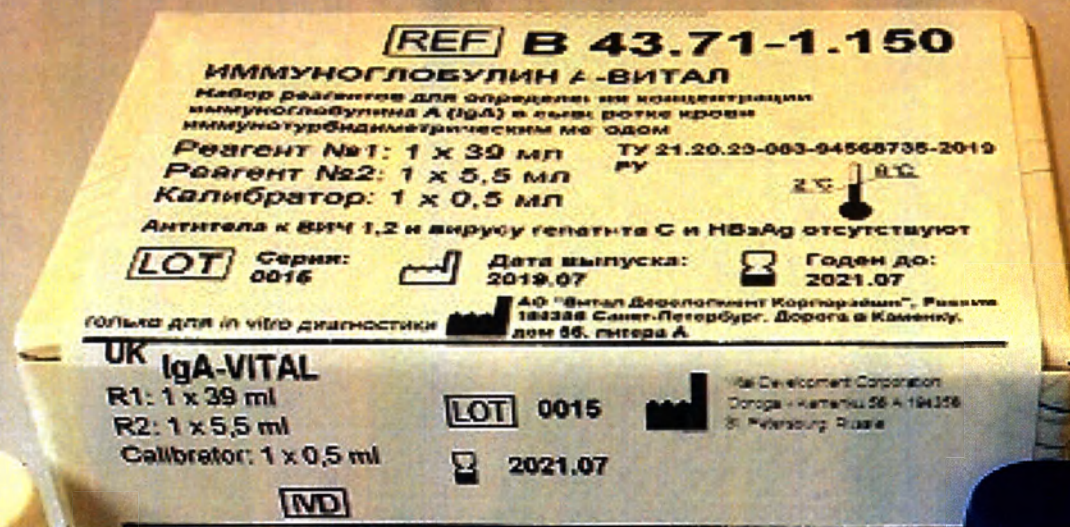

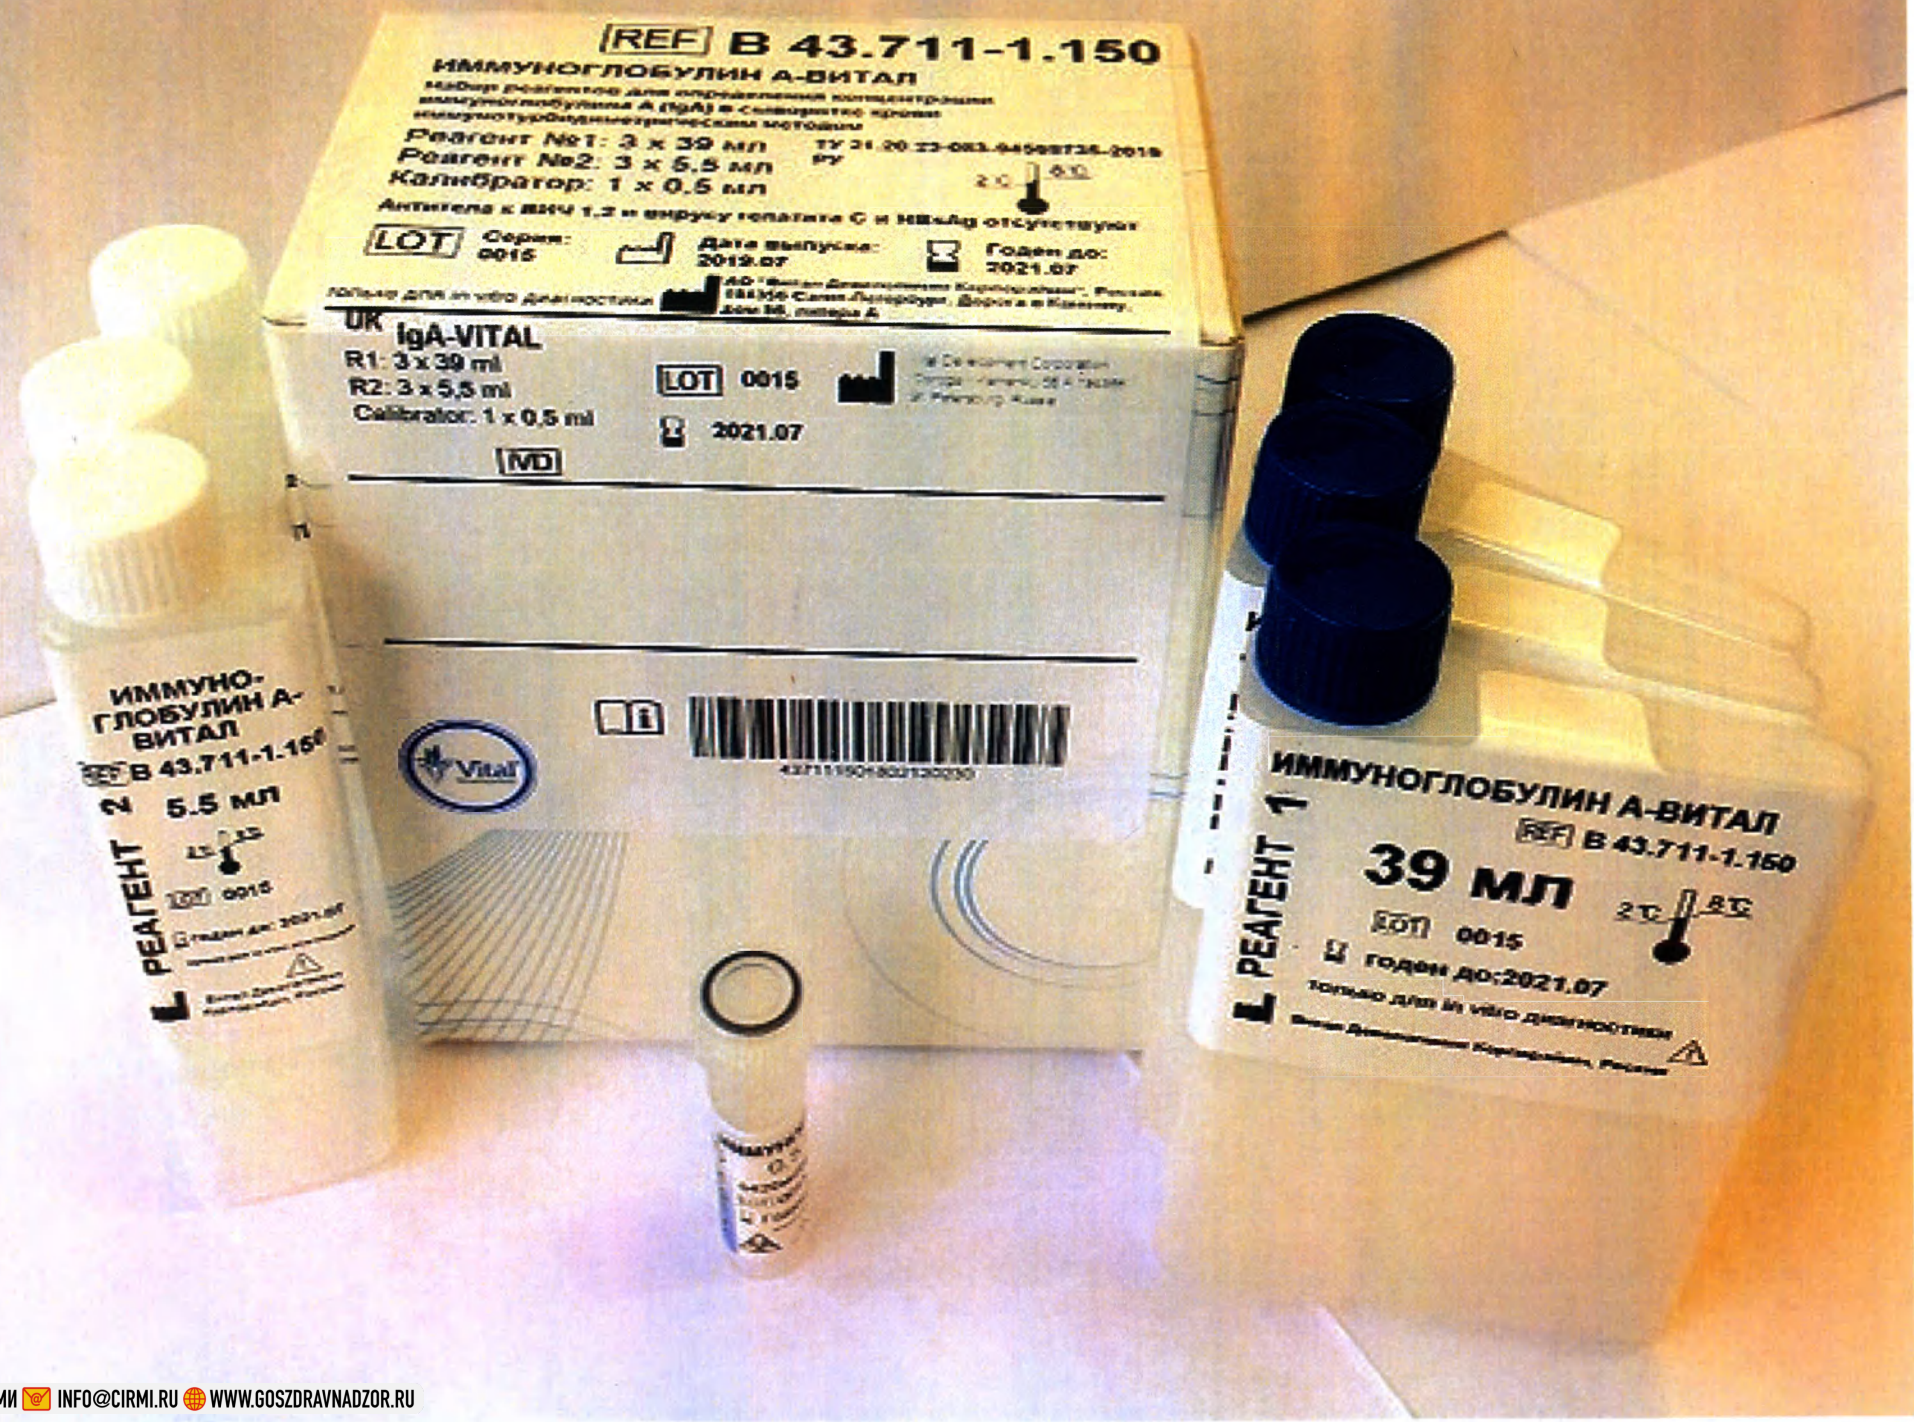

REF В 43.711-1.150

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ
Иммунопрепарат для определения концентрации
иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 3 x 39 мл
Реагент №2: 3 x 5,5 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1.2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT 0015
Серия: 0015
Дата выпуска: 2019.07
Годен до: 2021.07

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
154356 Санкт-Петербург, Дворца в Карлсбургу,
Зона 36, палата А

UK IgA-VITAL

R1: 3 x 39 ml
R2: 3 x 5,5 ml
Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0015

2021.07

MD



437111501802130230

ИММУНО-ГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ
REF В 43.711-1.150

РЕАГЕНТ 2 5.5 МЛ

LOT 0015

Годен до: 2021.07

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия


ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ
REF В 43.711-1.150


РЕАГЕНТ 1 39 МЛ




LOT 0015

Годен до: 2021.07

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия

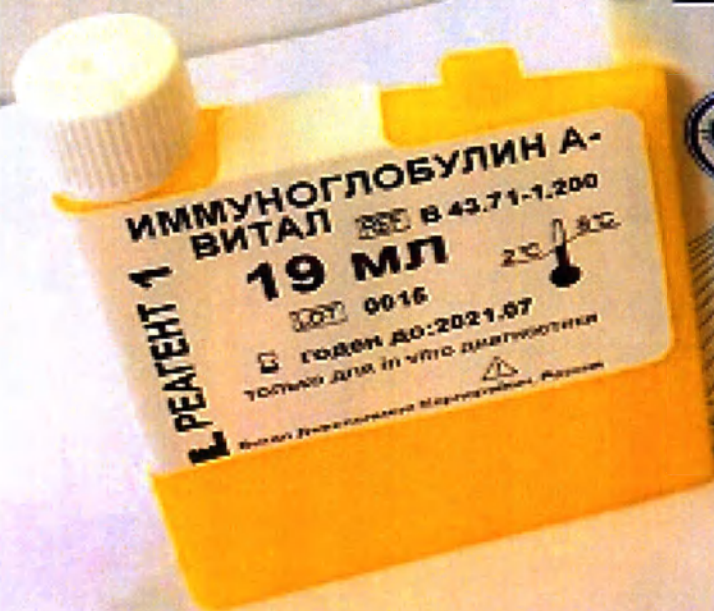

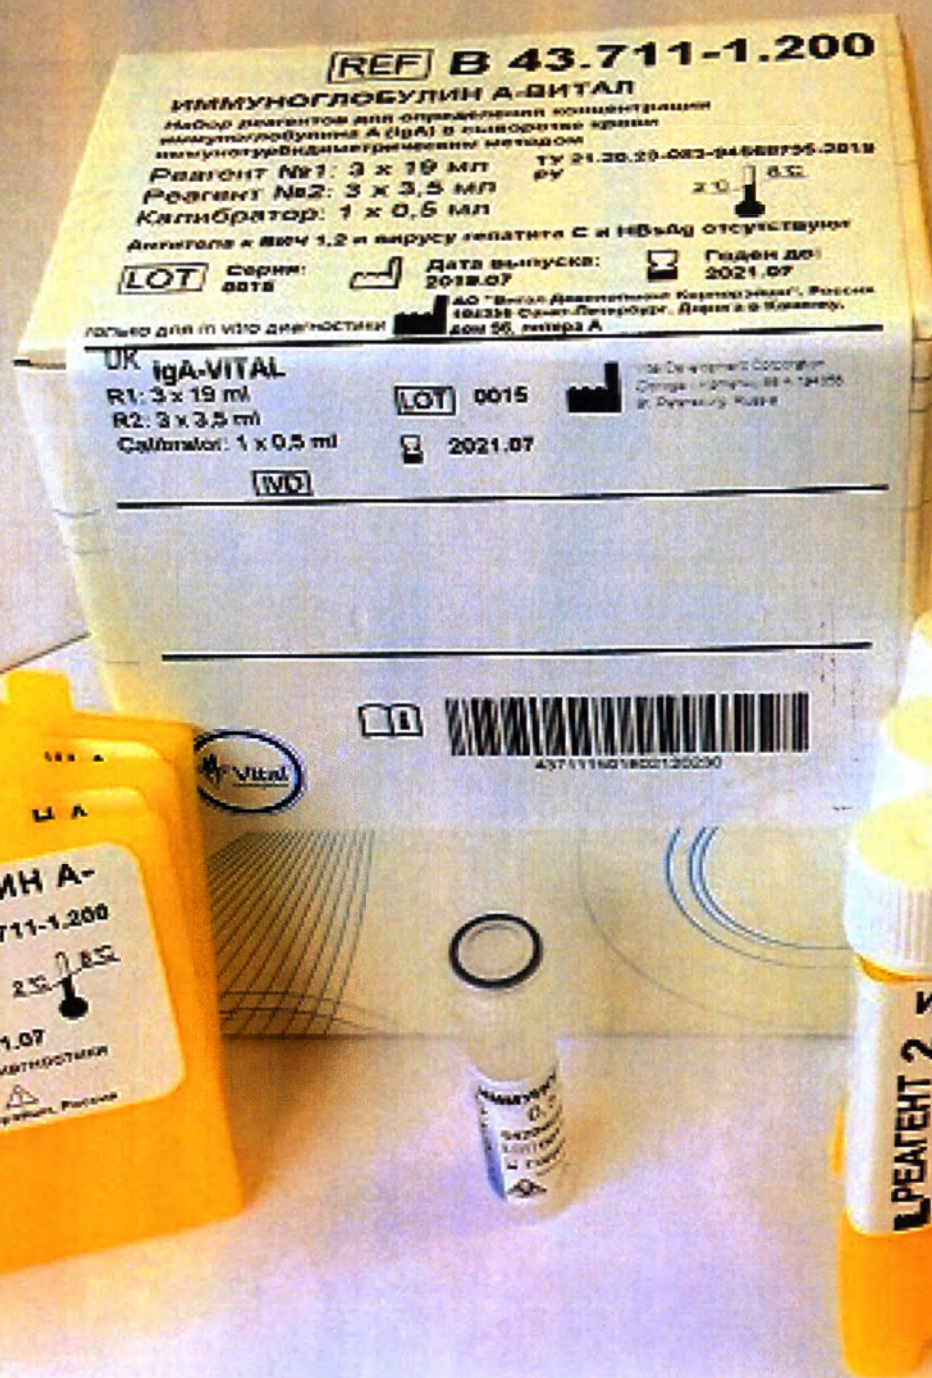

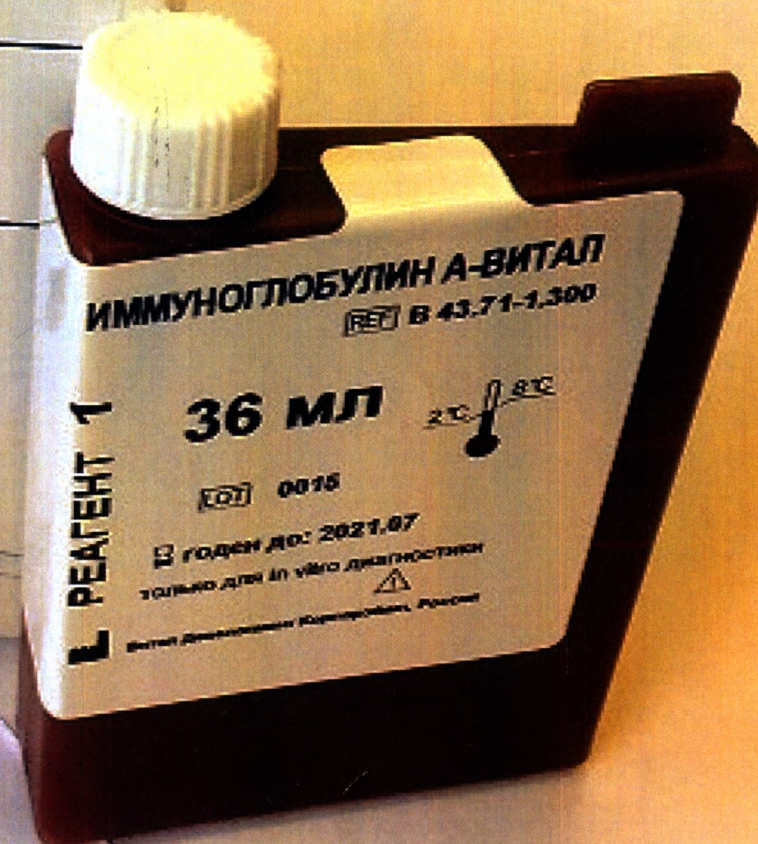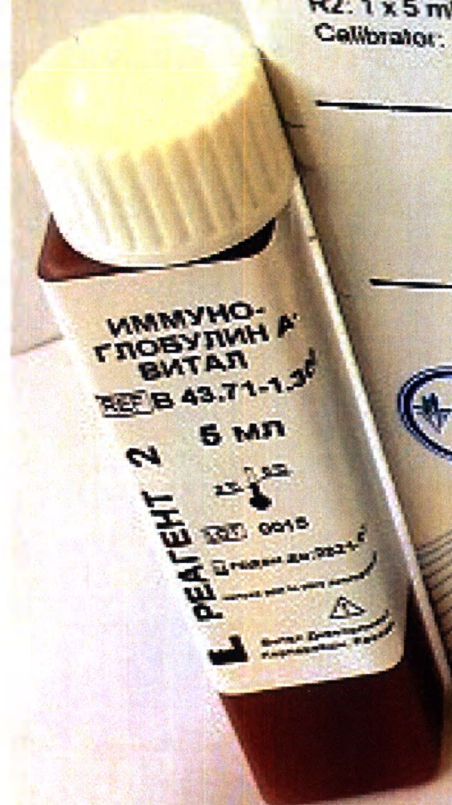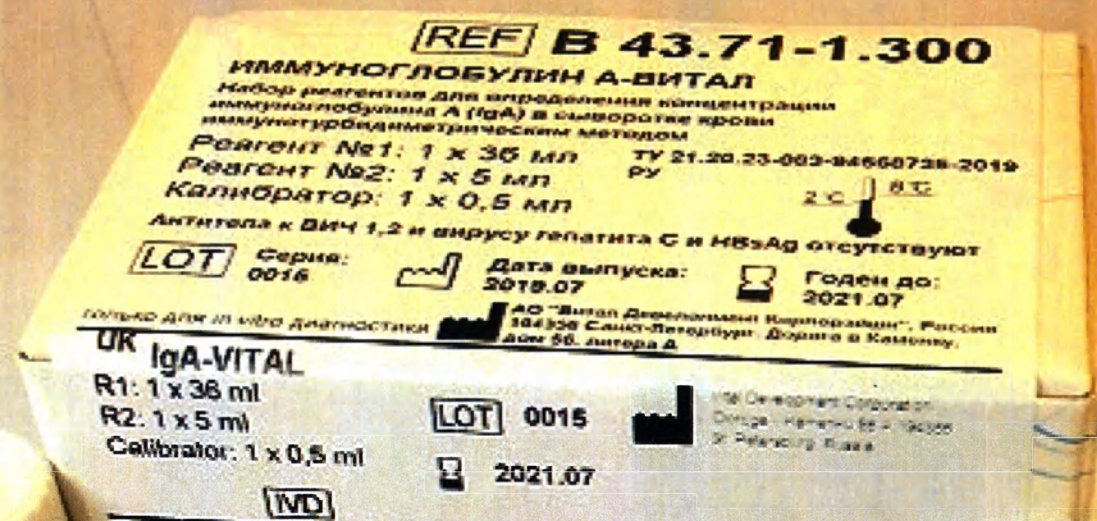



REF В 43.71-1.420

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
иммуноглобулина А (IgA) в сыворотке крови
иммуноферментным методом

Реагент №1: 1 x 51 мл

ТУ 21.20.20.003-84000700-2019

Реагент №2: 1 x 5 мл

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBeAg отсутствуют

LOT

Серия:

0015



Дата выпуска:

2019.07



Годен до:

2021.07

ГОЛЬМО ДЛЯ И ВИРО ДИAGНОСТИКИ

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
124356 Санкт-Петербург, Дворцово-парковый
дом 35, литера А

UK IgA-VITAL

R1: 1 x 51 ml

R2: 1 x 5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0015

Vital Development Corporation
Sergey Yermakov St. 35-1140356
St. Petersburg, Russia

2021.07

IND



437111501502120220

ИММУНО-
ГЛОБУЛИН А-
ВИТАЛ

REF В 43.71-1.420

РЕАГЕНТ 2

5 мл



LOT 0015

Годен до: 2021.07

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия

Vital Development Corporation, Russia

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ

REF В 43.71-1.420

РЕАГЕНТ 1

51 мл



LOT 0015

Годен до: 2021.07

ГОЛЬМО ДЛЯ И ВИРО ДИAGНОСТИКИ

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия




[REF] В 43.711-1.420
ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ
 Набор реагентов для иммунохимической конформации
 иммуноглобулина А (IgA) в Спектрометре
 Реагент №1: 4 x 51 мл
 Реагент №2: 4 x 5 мл
 Калибратор: 1 x 0,5 мл
 Антитела к вирусу гепатита В и HbAg отсутствуют
 LOT 0015
 Дата выпуска: 2021.07
 Годен до: 2021.07
 АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
 184305 Санкт-Петербург, Дорога в Колонию,
 дом 56, литера А

ИММУНО-
ГЛОБУЛИН А-
ВИТАЛ
REF В 43.711-1.420
РЕАГЕНТ 2 5 мл
LOT 0015
Годен до: 2021.07

ИММУНО-
ГЛОБУЛИН А-
ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 2 5 мл
LOT 0015
Годен до: 2021.07

ИММУНОГЛОБУЛИН А-ВИТАЛ
[REF] В 43.711-1.420
РЕАГЕНТ 1
51 мл
 LOT 0015
 Годен до: 2021.07
 АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
 184305 Санкт-Петербург, Дорога в Колонию,
 дом 56, литера А

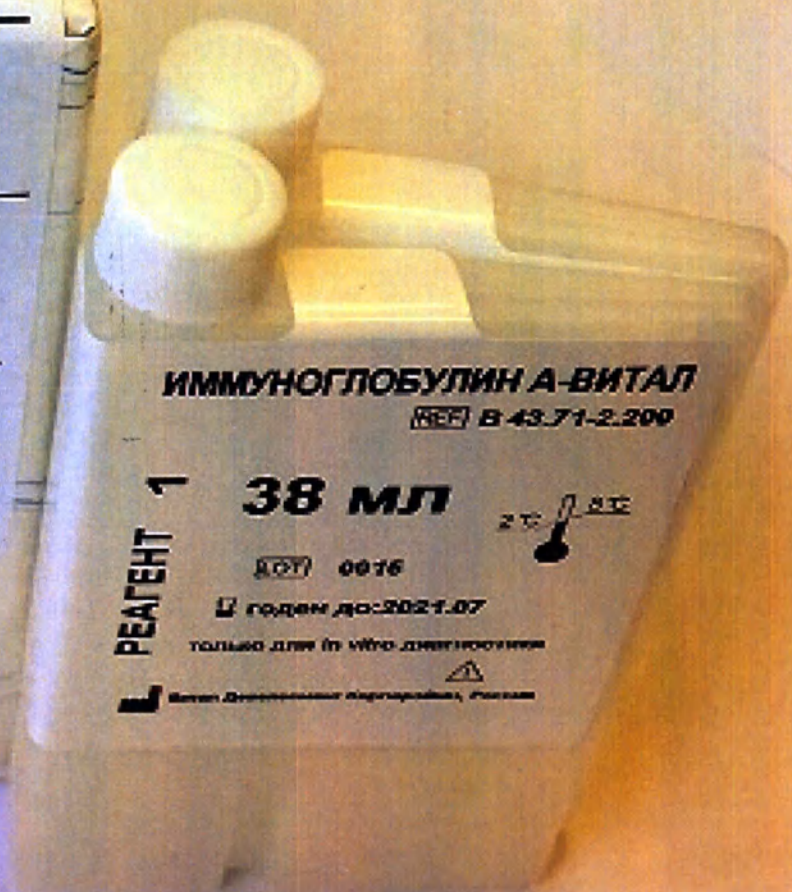



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего 16 листа(ов)

Иск. директор

Плехов А.Г.