

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»

С.А. Самарин

« 14 » ноября 2019 г.



ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO*

Набора реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)

по ТУ 9398-088-46482062-2016

2019 г.

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016

Комплектация: ПРОБА-МЧ-НК, фасовка N
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

Связывающий раствор
1 флакон

Лизирующий раствор
1 флакон

Промывочный раствор
3 флакона

Сорбент
1 пробирка

Паспорт качества

Элюирующий раствор
1 флакон

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)

ПРОБА-МЧ-НК

Состав:
Лизирующий раствор 1 флакон
Сорбент 1 пробирка
Связывающий раствор 1 флакон
Промывочный раствор 3 флакона
Элюирующий раствор 1 флакон
Магнитные пестики 2 блистера

ИД
REF P-114-M4
LOT E01Nm-2
2019-11-01
2020-11-01
Фасовка N

ТУ 9398-088-46482062-2016
Предназначено для профессионального применения

ИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

выделения нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ)

18-088-46482062-2016

ИДНК: ПРОБА-МЧ-НК

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ
Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)
Магнитные пестики
2 блистера по 16 пестиков
LOT E01Nm
2020-11-01

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ
Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)
Магнитные пестики
1 блистер 16 пестиков
LOT E01Nm
2020-11-01

Магнитные пестики
2 блистера по 16 пестиков

Магнитные пестики
1 блистер 16 пестиков

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016

Комплектация: ПРОБА-МЧ-НК, фасовка N
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»





Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016

Комплектация: ПРОБА-МЧ-НК, фасовка А
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

Картридж с растворами
2 шт.

Паспорт качества

Магнитные пестики
2 блистера по 16 пестиков

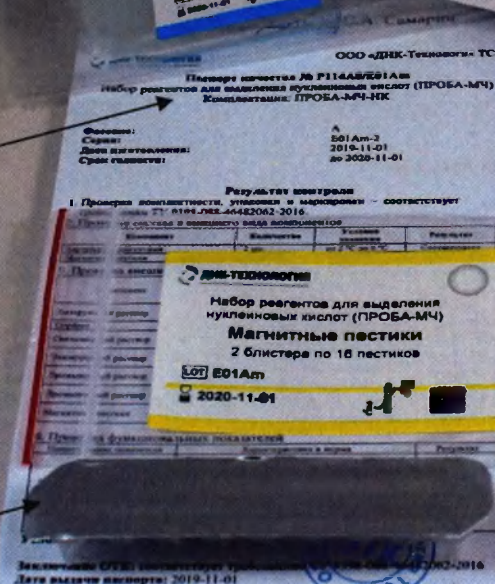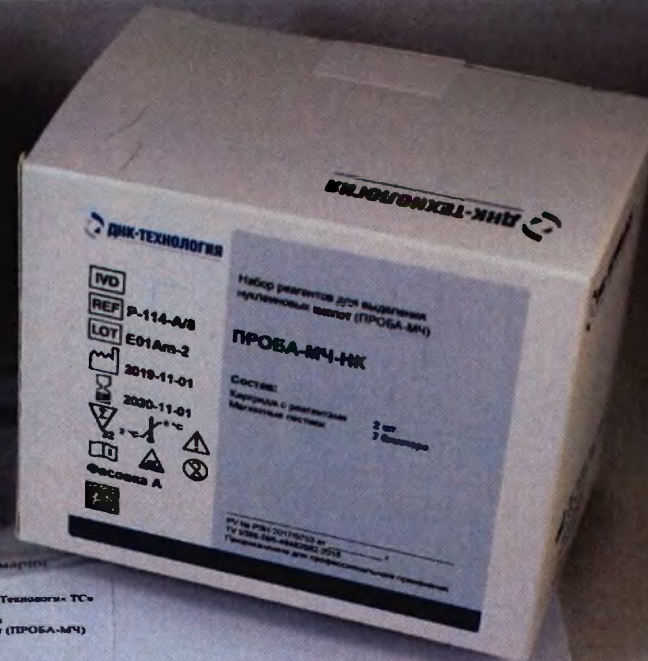

ПО ПРИМЕНЕНИЮ

выделения нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ)
P-088-46482062-2016
или: ПРОБА-МЧ-НК

2019 г.

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016

Комплектация: ПРОБА-МЧ-НК, фасовка А
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»



ООО «ДНК-Технология ТС»
Паспорт качества № P114AB/E01Am
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)
Комплектация: ПРОБА-МЧ-НК

Фасовка: А
Сериал: 101 Ам-2
Дата изготовления: 2019-11-01
Срок годности: до 2020-11-01

Результат контроля

1. Проверка комплектности, упаковки и маркировки – соответствует

2. Проверка срока годности компонентов – соответствует

Компонент	Количество	Единица измерения	Результат
Магнитные пестики	2 шт.	шт.	Соответствует

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)
Магнитные пестики
2 блистера по 16 пестиков
LOT E01Am
2020-11-01

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

Выделения нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ)
8-088-46482062-2016
ИЛИ: ПРОБА-МЧ-НК

2019 г.

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016

Комплектация: ПРОБА-МЧ-РАПИД, фасовка N
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

Паспорт качества

Магнитные пестики
2 блистера по 16 пестиков

Лизирующий раствор
1 флакон

Связывающий раствор
1 флакон

Промывочный раствор
1 флакона

Элюирующий раствор
1 флакон


Сорбент
1 пробирка

Отрицательный
контрольный образец
2 пробирки

Магнитные пестики
1 блистер 16 пестиков

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016

Комплектация: ПРОБА-МЧ-РАПИД, фасовка N
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

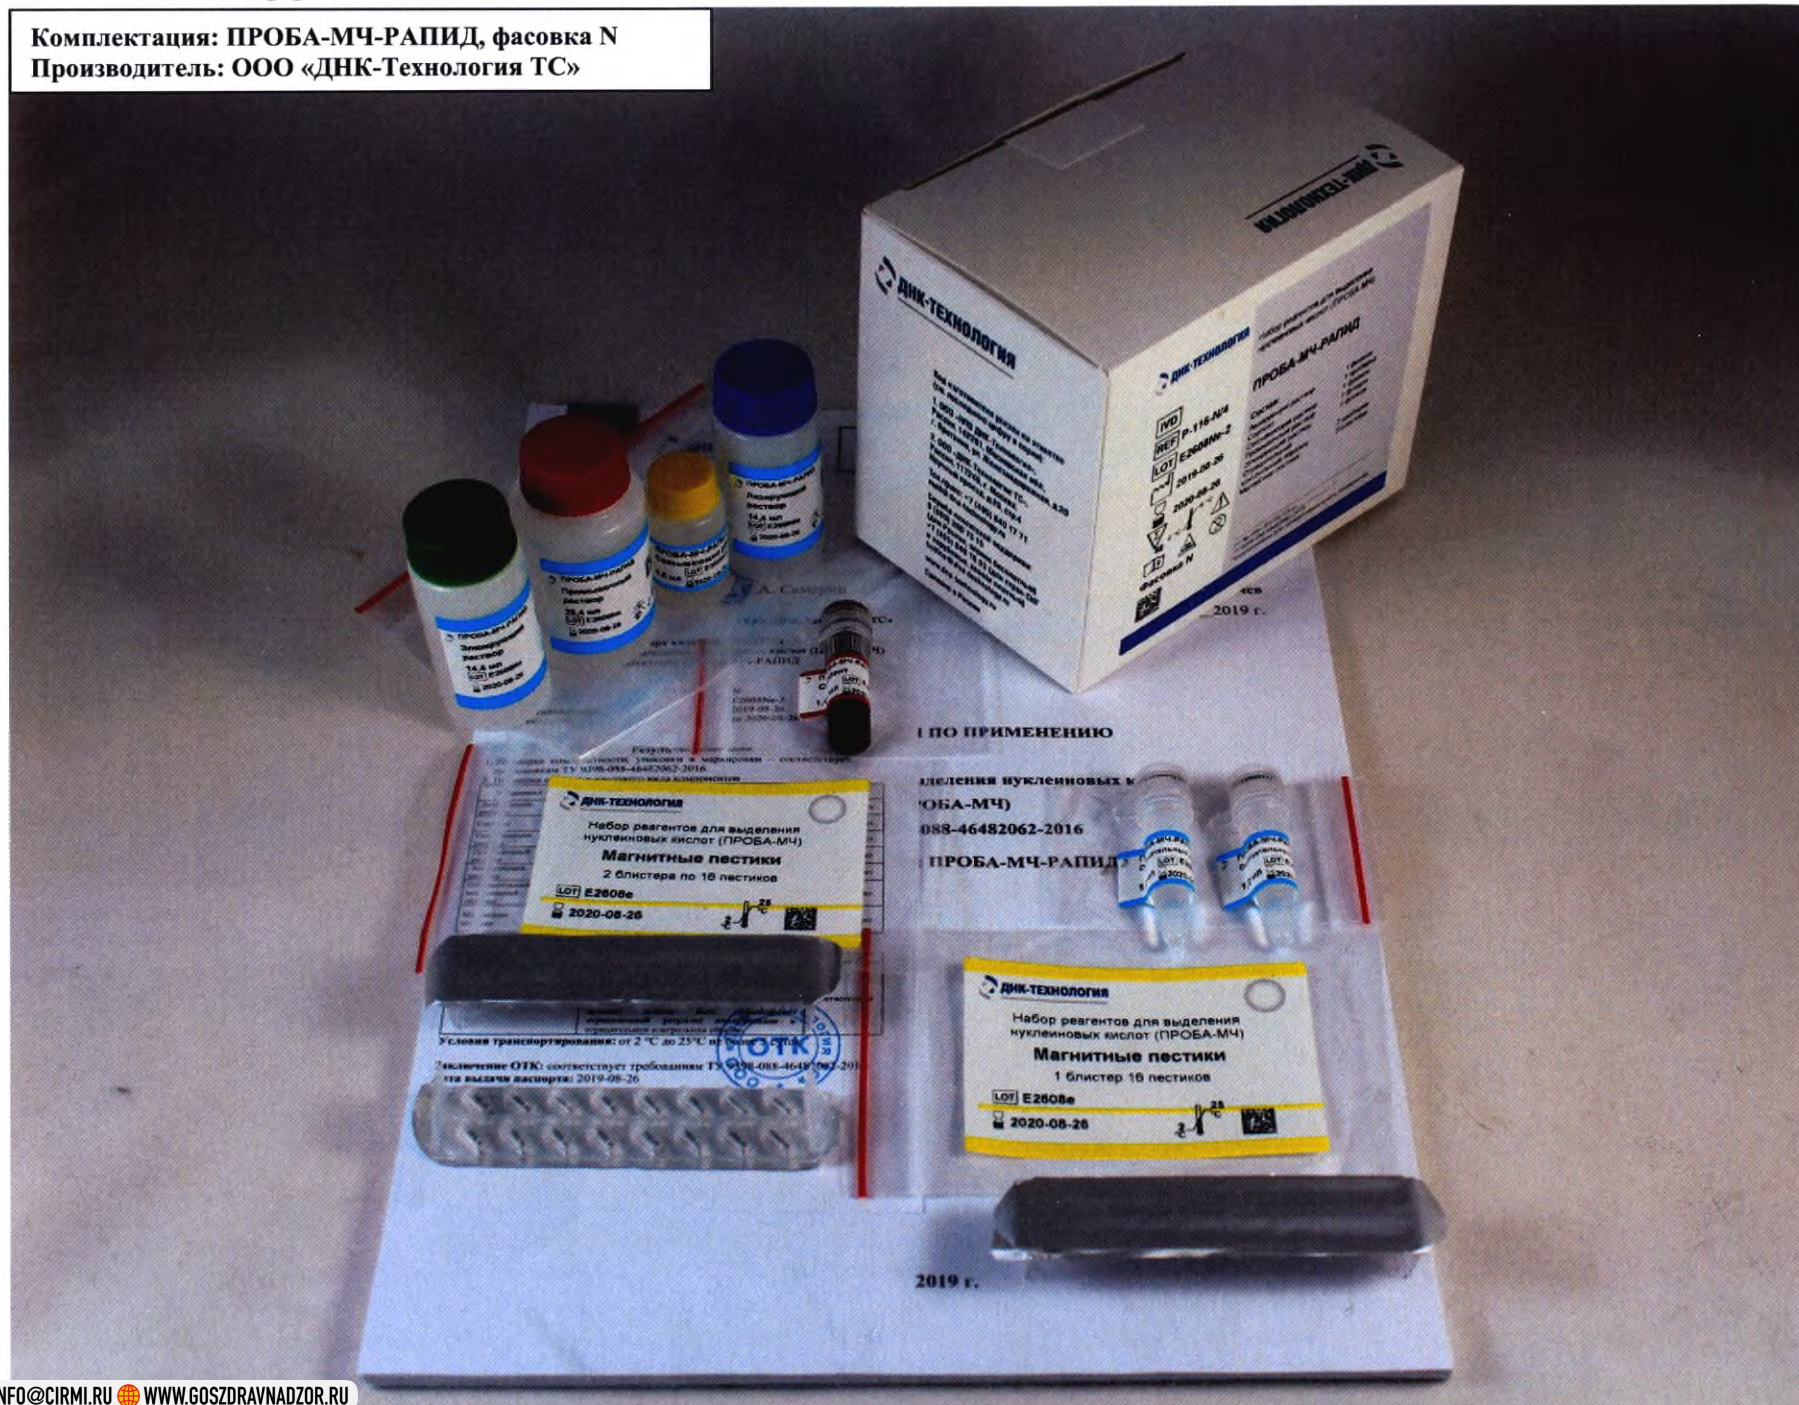

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016

Комплектация: ПРОБА-МЧ-РАПИД, фасовка А
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

Картридж с реагентами
1 шт.

Паспорт качества

Магнитные пестики
2 блистера по 16 пестиков

Отрицательный
контрольный образец
1 пробирка

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

ИД
REF P-116-A/3
LOT E2608Ae-2
2019-06-26
2020-08-26
33
5 °C
10
Фасовка А

Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)

ПРОБА-МЧ-РАПИД

Состав:
Картридж с реагентами 1 шт.
Отрицательный контрольный образец 1 пробирка
Магнитные пестики 2 блистера

ТУ 9398-088-46482062-2016
Год выпуска: 2019
Год окончания срока годности: 2020

ПО ПРИМЕНЕНИЮ

деления нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ)



088-46482062-2016

ПРОБА-МЧ-РАПИД

2019 г.

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016

Комплектация: ПРОБА-МЧ-РАПИД, фасовка А
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

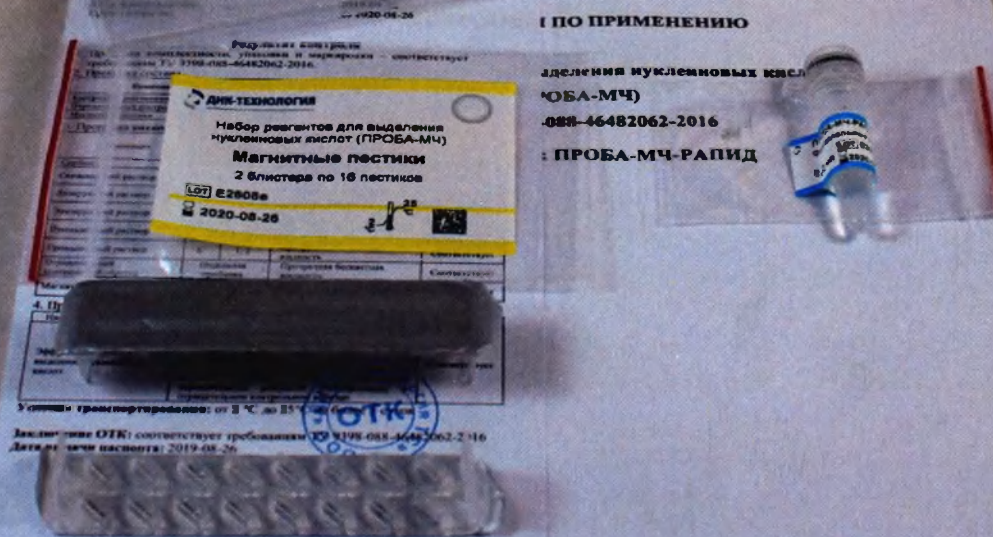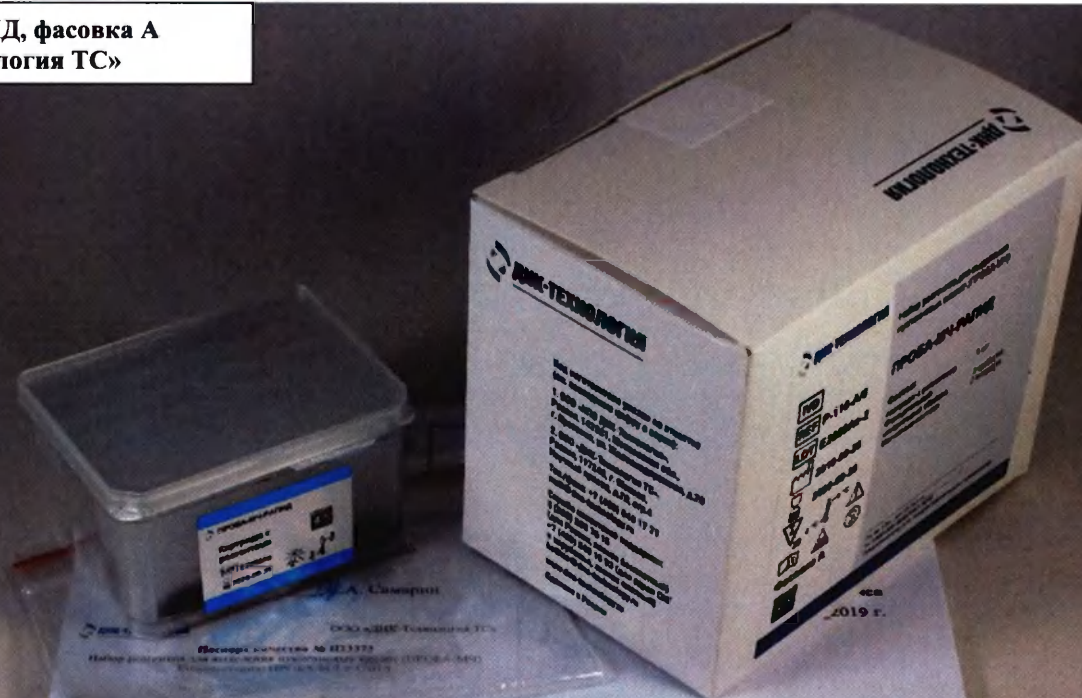

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9

(губин) листа (ов)
специалист по регистрации
Щербакова Н.И.



**Маркировка набора реагентов
ПРОБА-МЧ**

Организация-производитель

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»



Самарин С.А.

« 14 » ноября 2019 г.

**МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот

(ПРОБА-МЧ)

по ТУ 9398-088-46482062-2016

2019 г.

Маркировка изделия

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016» соответствует требованиям:

- п.6.2 ГОСТ Р 51088-2013 «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации»;

- п.5 и п.6 ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики *in vitro* для профессионального применения»;

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Ч.1. Основные требования»;

- требованиям п. 1.5 ТУ 9398-088-46482062-2016.

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016» выполнена печатным способом и включает:

- **информацию непосредственно на коробке**, нанесенную типографским способом, содержащую:

- логотип;
- адрес изготовителя и его контактные данные (см. развертку макета коробки, лист 12, 14, 16, 18);

- **этикетку на коробку**, содержащую информацию (образцы см. лист 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17):

- логотип;
- полное и сокращенное наименование набора;
- вариант комплектации;
- вариант фасовки;
- каталожный номер;
- количество определений;
- состав изделия;
- номер серии набора;
- дату изготовления набора;
- срок годности набора;
- условия хранения набора;
- символ «Не стерильно»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Одноразовое использование»;
- надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD»;
- надпись «Предназначено для профессионального применения»;
- номер технических условий;
- номер и дату регистрационного удостоверения;
- знак токсичности, агрессивности или другой опасности (при необходимости).

- **этикетку на блок компонентов (полиэтиленовый пакет (гриппер) или флакон/пробирку)**, содержащую следующую информацию (образцы см. лист 5, 6, 7, 8, 9, 10):

- логотип;
- сокращенное наименование варианта комплектации набора;

- наименование компонента;
- объём/количество компонента;
- номер серии;
- срок годности;
- условия хранения;
- символ «Не допускается воздействие солнечного света» (при необходимости);
- надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD»;
- знак токсичности, агрессивности или другой опасности (при необходимости).

Примечания

1. Размер внутренней упаковки не достаточен для размещения указанного содержания информации на этикетках компонентов, в связи с чем, надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD» опущены.
2. Требование об указании сокращенного наименования для магнитных пестиков в блистере не применимо (универсальный компонент, входящий в состав различных наборов реагентов).
3. Надписи при маркировке изделия частично заменены символами, соответствующими требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

Символы, используемые при маркировке набора

	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>		Каталожный номер
	Температурный диапазон		Адрес изготовителя
	Количество тестов		Не допускается воздействие солнечного света
	Годен до		Одноразовое использование
	Серия набора		Не стерильно
	Дата изготовления		Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Обратитесь к инструкции по применению		

- этикетку на транспортную тару, содержащую информацию (образцы см. лист 19, 20):

- торговое (при наличии) и полное наименование набора;
- наименование и адрес изготовителя;
- срок годности набора (год, месяц включительно);
- дату изготовления (год, месяц);
- требования к условиям хранения и транспортирования набора (при необходимости – особые условия обращения с набором);
- номер серии;
- предупреждения и меры предосторожности в отношении изделия, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи (при необходимости);
- количество изделий в транспортной таре;
- масса нетто и масса брутто на транспортной таре;
- масса нетто потребительской упаковки.

Примечания

1. Требование об указании знака обращения на рынке не применимо.
2. Надписи на транспортной таре, содержащие данные о числе изделий, дате изготовления и сроке годности, номера серии допускается выполнять от руки или с помощью клише (ГОСТ Р 51088, подпункт 6.2.4).

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016
Комплектация: ПРОБА-МЧ-НК
Фасовка А (для автоматизированного дозирования)
Этикетка на коробку
Этикетка на полиэтиленовый пакет (гриппер)


Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)

IVD
REF P-114-A/8

LOT E01Am-2

 2019-11-01

 2020-11-01

 32 2 °C 8 °C


Фасовка А

ПРОБА-МЧ-НК
Состав:

Картридж с реагентами 2 шт.
Магнитные пестики 2 блистера

ПУ № РЗН 2017/5753 от _____ г.
ТУ 9398-088-46482062-2016
Предназначено для профессионального применения

Магнитные пестики

2 блистера по 16 пестиков



Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)

Магнитные пестики

2 блистера по 16 пестиков

LOT E01Am

 2020-11-01

 25 °C


Условия хранения от 2°C до 25°C

**Этикетка на картридж
Картридж с реагентами**
 **ПРОБА-МЧ-НК**
**Картридж с
реагентами**
LOT E01Am

 2020-11-01


Условия хранения от 2°C до 8°C
в защищенном от света месте

Информация об изготовителе
нанесена типографским способом
на внешнюю упаковку изделия –
коробку.

Код изготовителя указан на этикетке
(см. последнюю цифру в серии):

1.ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

2.ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4

Тед./факс: +7 (495) 640 17 71
mail@dna-technology.ru

Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200 75 15
(для России, звонок бесплатный)

+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ
и зарубежья, звонок платный)


hotline@dna-technology.ru

www.dna-technology.ru

Сделано в России

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016

Комплектация: **ПРОБА-МЧ-РАПИД**
Фасовка А (для автоматизированного дозирования)

Этикетка на коробку	Этикетка на полиэтиленовый пакет (гриппер)						
 Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) IVD REF P-116-A/8 LOT E2608Ae-2 2019-08-26 2020-08-26      ПРОБА-МЧ-РАПИД Состав: <table> <tr> <td>Картридж с реагентами</td><td>1 шт.</td></tr> <tr> <td>Отрицательный контрольный образец</td><td>1 пробирка</td></tr> <tr> <td>Магнитные пестики</td><td>2 блистера</td></tr> </table> Фасовка А  ПУ № РЗН 2017/5753 от _____ г. ТУ 9398-088-46482062-2016 Предназначено для профессионального применения	Картридж с реагентами	1 шт.	Отрицательный контрольный образец	1 пробирка	Магнитные пестики	2 блистера	Магнитные пестики 2 блистера по 16 пестиков  Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) Магнитные пестики 2 блистера по 16 пестиков LOT E2608e 2020-08-26    Условия хранения от 2°C до 25°C
Картридж с реагентами	1 шт.						
Отрицательный контрольный образец	1 пробирка						
Магнитные пестики	2 блистера						
Этикетка на картридж Картридж с реагентами ПРОБА-МЧ-РАПИД Картридж с реагентами LOT E2608Ae 2020-08-26   Условия хранения от 2°C до 8°C в защищенном от света месте	Информация об изготовителе нанесена типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку. Код изготовителя указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии): 1.ООО «НПО ДНК-Технология», Россия, 142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20 2.ООО «ДНК-Технология ТС», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.4 Тед./факс: +7 (495) 640 17 71 mail@dna-technology.ru Служба клиентской поддержки: 8 (800) 200 75 15 (для России, звонок бесплатный) +7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный) hotline@dna-technology.ru www.dna-technology.ru Сделано в России Условия хранения от 2°C до 8°C						
Этикетка на пробирку Отрицательный контрольный образец 1,2 мл ПРОБА-МЧ-РАПИД Отрицательный контрольный образец LOT E2608e 2020-08-26  							

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016

Комплектация: ПРОБА-МЧ-НК
Фасовка N (для ручного дозирования)

Этикетка на коробку	Этикетка на пробирку												
 Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) ПРОБА-МЧ-НК Состав: <table> <tr> <td>Лизирующий раствор</td><td>1 флакон</td></tr> <tr> <td>Сорбент</td><td>1 пробирка</td></tr> <tr> <td>Связывающий раствор</td><td>1 флакон</td></tr> <tr> <td>Промывочный раствор</td><td>3 флакона</td></tr> <tr> <td>Элюирующий раствор</td><td>1 флакон</td></tr> <tr> <td>Магнитные пестики</td><td>3 блистера</td></tr> </table> ИВД REF P-114-N/4 LOT E01Nm-2 2019-11-01 2020-11-01 48 2 °C 8 °C i Фасовка N ПУ № РЗН 2017/5753 от _____ г. ТУ 9398-088-46482062-2016 Предназначено для профессионального применения	Лизирующий раствор	1 флакон	Сорбент	1 пробирка	Связывающий раствор	1 флакон	Промывочный раствор	3 флакона	Элюирующий раствор	1 флакон	Магнитные пестики	3 блистера	Сорбент 1,1 мл ПРОБА-МЧ-НК Сорбент 1,1 мл LOT E01Nm 2020-11-01 Условия хранения от 2°C до 8°C
Лизирующий раствор	1 флакон												
Сорбент	1 пробирка												
Связывающий раствор	1 флакон												
Промывочный раствор	3 флакона												
Элюирующий раствор	1 флакон												
Магнитные пестики	3 блистера												
	Связывающий раствор 17 мл ПРОБА-МЧ-НК Связывающий раствор 17 мл LOT E01Nm 2020-11-01 Условия хранения от 2°C до 8°C в защищенном от света месте												
	Промывочный раствор 40 мл ПРОБА-МЧ-НК Промывочный раствор 40 мл LOT E01Nm 2020-11-01 Условия хранения от 2°C до 8°C в защищенном от света месте												
Лизирующий раствор 30 мл ПРОБА-МЧ-НК Лизирующий раствор 30 мл LOT E01Nm 2020-11-01 Условия хранения от 2°C до 8°C в защищенном от света месте	Элюирующий раствор 15 мл ПРОБА-МЧ-НК Элюирующий раствор 15 мл LOT E01Nm 2020-11-01 Условия хранения от 2°C до 8°C												

Этикетка на гриппер
Магнитные пестики
2 блистера по 16 пестиков



Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)

Магнитные пестики

2 блистера по 16 пестиков

LOT E01Nm

2020-11-01



Условия хранения от 2°C до 25°C

Этикетка на гриппер
Магнитные пестики
1 блистер 16 пестиков



Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)

Магнитные пестики

1 блистер 16 пестиков

LOT E01Nm

2020-11-01



Условия хранения от 2°C до 25°C

Информация об изготовителе
нанесена типографским способом
на внешнюю упаковку изделия –
коробку.

Код изготовителя указан на этикетке
(см. последнюю цифру в серии):

1.000 «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

2.000 «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4

Тел./факс: +7 (495) 640 17 71
mail@dna-technology.ru

Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200 75 15
(для России, звонок бесплатный)

+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ
и зарубежья, звонок платный)






hotline@dna-technology.ru

www.dna-technology.ru


Сделано в России

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) по ТУ 9398-088-46482062-2016

Комплектация: ПРОБА-МЧ-РАПИД
Фасовка N (для ручного дозирования)

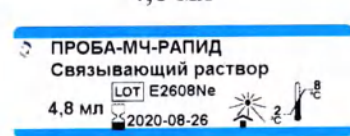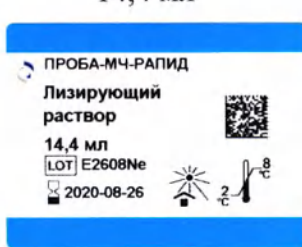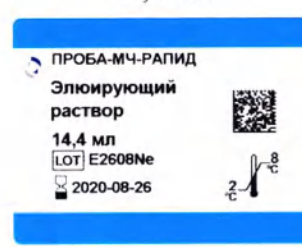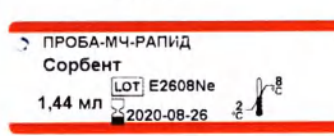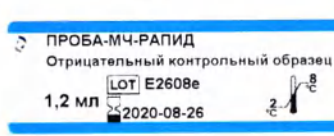Этикетка на коробку  Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ) ПРОБА-МЧ-РАПИД Состав: <table border="0"> <tr> <td>Лизирующий раствор</td> <td>1 флакон</td> </tr> <tr> <td>Сорбент</td> <td>1 пробирка</td> </tr> <tr> <td>Связывающий раствор</td> <td>1 флакон</td> </tr> <tr> <td>Промывочный раствор</td> <td>1 флакон</td> </tr> <tr> <td>Элюирующий раствор</td> <td>1 флакон</td> </tr> <tr> <td>Отрицательный контрольный образец</td> <td>2 пробирки</td> </tr> <tr> <td>Магнитные пестики</td> <td>3 блистера</td> </tr> </table> Фасовка N ТУ 9398-088-46482062-2016 Предназначено для профессионального применения	Лизирующий раствор	1 флакон	Сорбент	1 пробирка	Связывающий раствор	1 флакон	Промывочный раствор	1 флакон	Элюирующий раствор	1 флакон	Отрицательный контрольный образец	2 пробирки	Магнитные пестики	3 блистера	Этикетка на флакон Связывающий раствор 4,8 мл  ПРОБА-МЧ-РАПИД Связывающий раствор 4,8 мл Условия хранения от 2°C до 8°C в защищенном от света месте Этикетка на флакон Промывочный раствор 26,4 мл  ПРОБА-МЧ-РАПИД Промывочный раствор 26,4 мл Условия хранения от 2°C до 8°C в защищенном от света месте
Лизирующий раствор	1 флакон														
Сорбент	1 пробирка														
Связывающий раствор	1 флакон														
Промывочный раствор	1 флакон														
Элюирующий раствор	1 флакон														
Отрицательный контрольный образец	2 пробирки														
Магнитные пестики	3 блистера														
Этикетка на флакон Лизирующий раствор 14,4 мл  ПРОБА-МЧ-РАПИД Лизирующий раствор 14,4 мл Условия хранения от 2°C до 8°C в защищенном от света месте	Этикетка на флакон Элюирующий раствор 14,4 мл  ПРОБА-МЧ-РАПИД Элюирующий раствор 14,4 мл Условия хранения от 2°C до 8°C														
Этикетка на пробирку Сорбент 1,44 мл  ПРОБА-МЧ-РАПИД Сорбент 1,44 мл Условия хранения от 2°C до 8°C	Этикетка на пробирку Отрицательный контрольный образец 1,2 мл  ПРОБА-МЧ-РАПИД Отрицательный контрольный образец 1,2 мл Условия хранения от 2°C до 8°C														

Этикетка на гриппер
Магнитные пестики
2 блистера по 16 пестиков



Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)

Магнитные пестики

2 блистера по 16 пестиков

LOT E2608e

2020-08-26



Условия хранения от 2°C до 25°C

Этикетка на гриппер
Магнитные пестики
1 блистер 16 пестиков



Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)

Магнитные пестики

1 блистер 16 пестиков

LOT E2608e

2020-08-26



Условия хранения от 2°C до 25°C

Информация об изготовителе
нанесена типографским способом
на внешнюю упаковку изделия –
коробку.

Код изготовителя указан на этикетке
(см. последнюю цифру в серии):

1.ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

2.ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4

Тел./факс: +7 (495) 640 17 71
mail@dna-technology.ru

Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200 75 15
(для России, звонок бесплатный)


+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ
и зарубежья, звонок платный)

hotline@dna-technology.ru


www.dna-technology.ru

Сделано в России


Макет этикетки на набор реагентов ПРОБА-МЧ в комплектации ПРОБА-МЧ-НК фасовка А

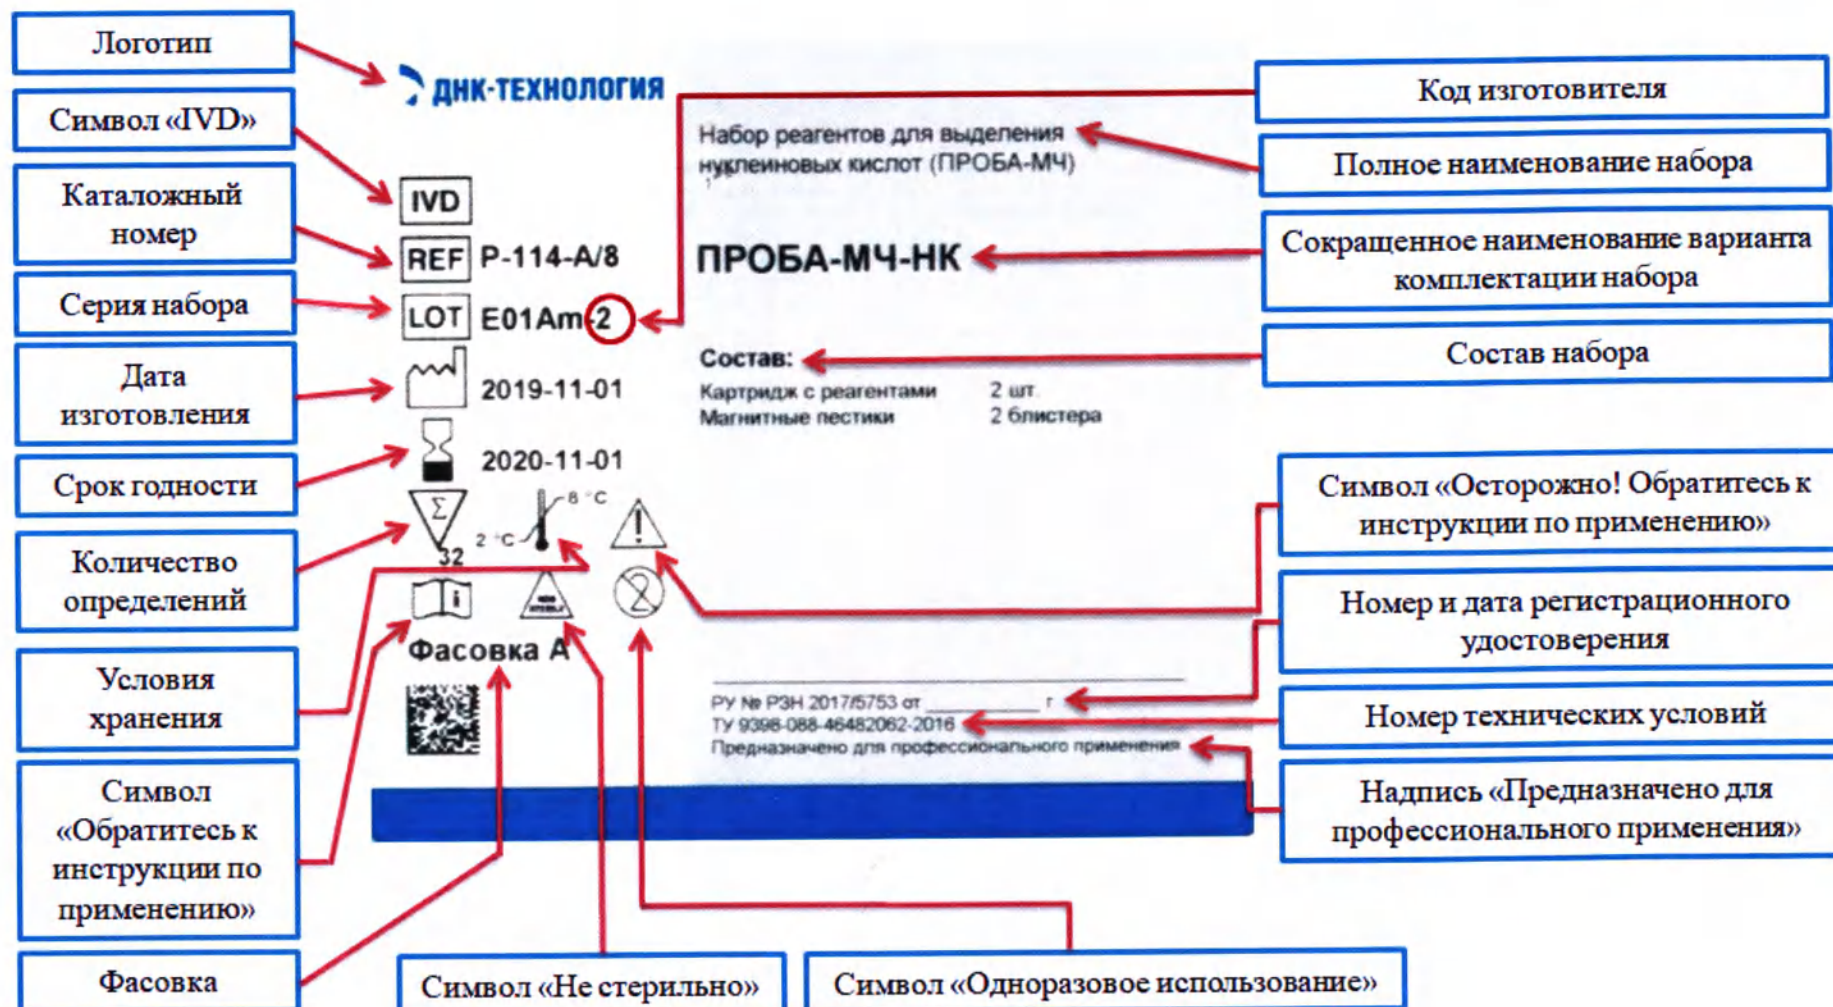


Код изготовителя
(надпись на
коробке)

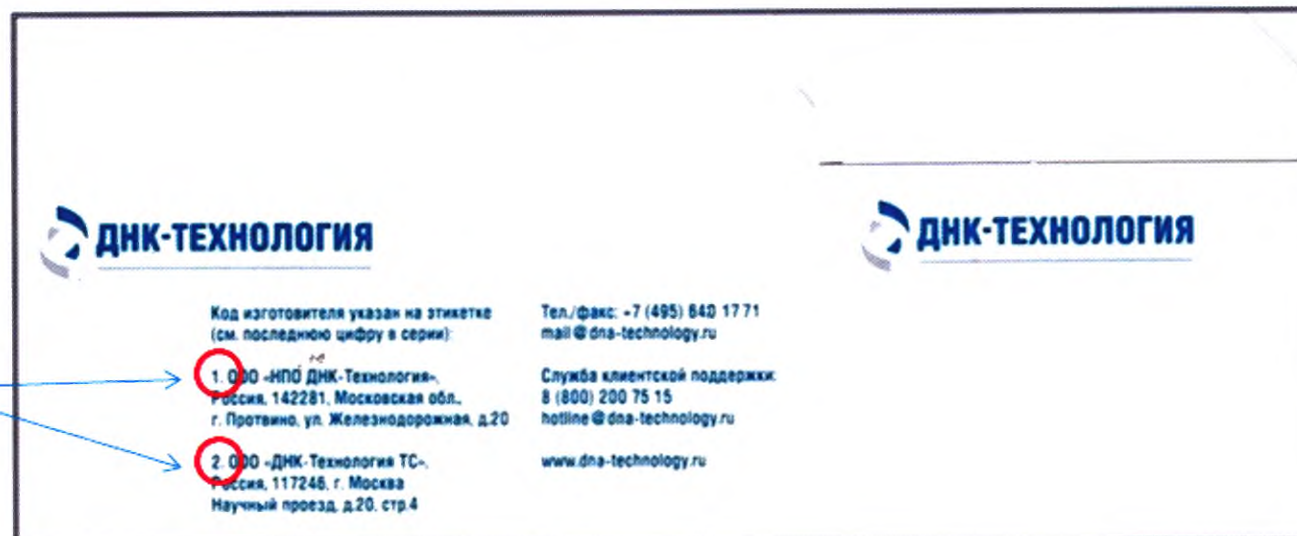

Код изготовителя
(код на этикетке)

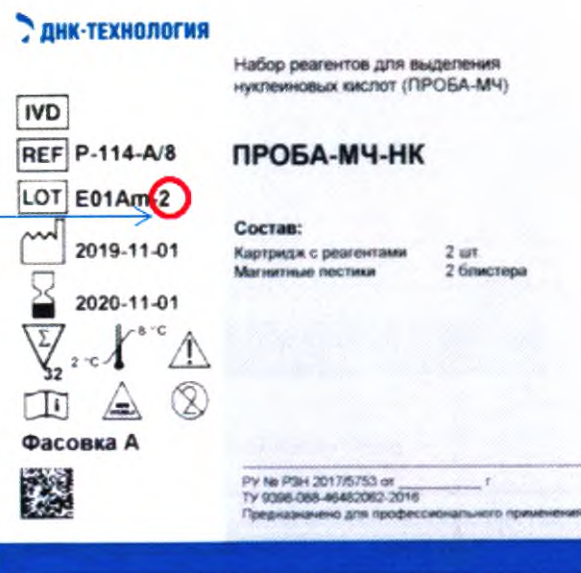

Макет этикетки на набор реагентов ПРОБА-МЧ в комплектации ПРОБА-МЧ-РАПИД фасовка А

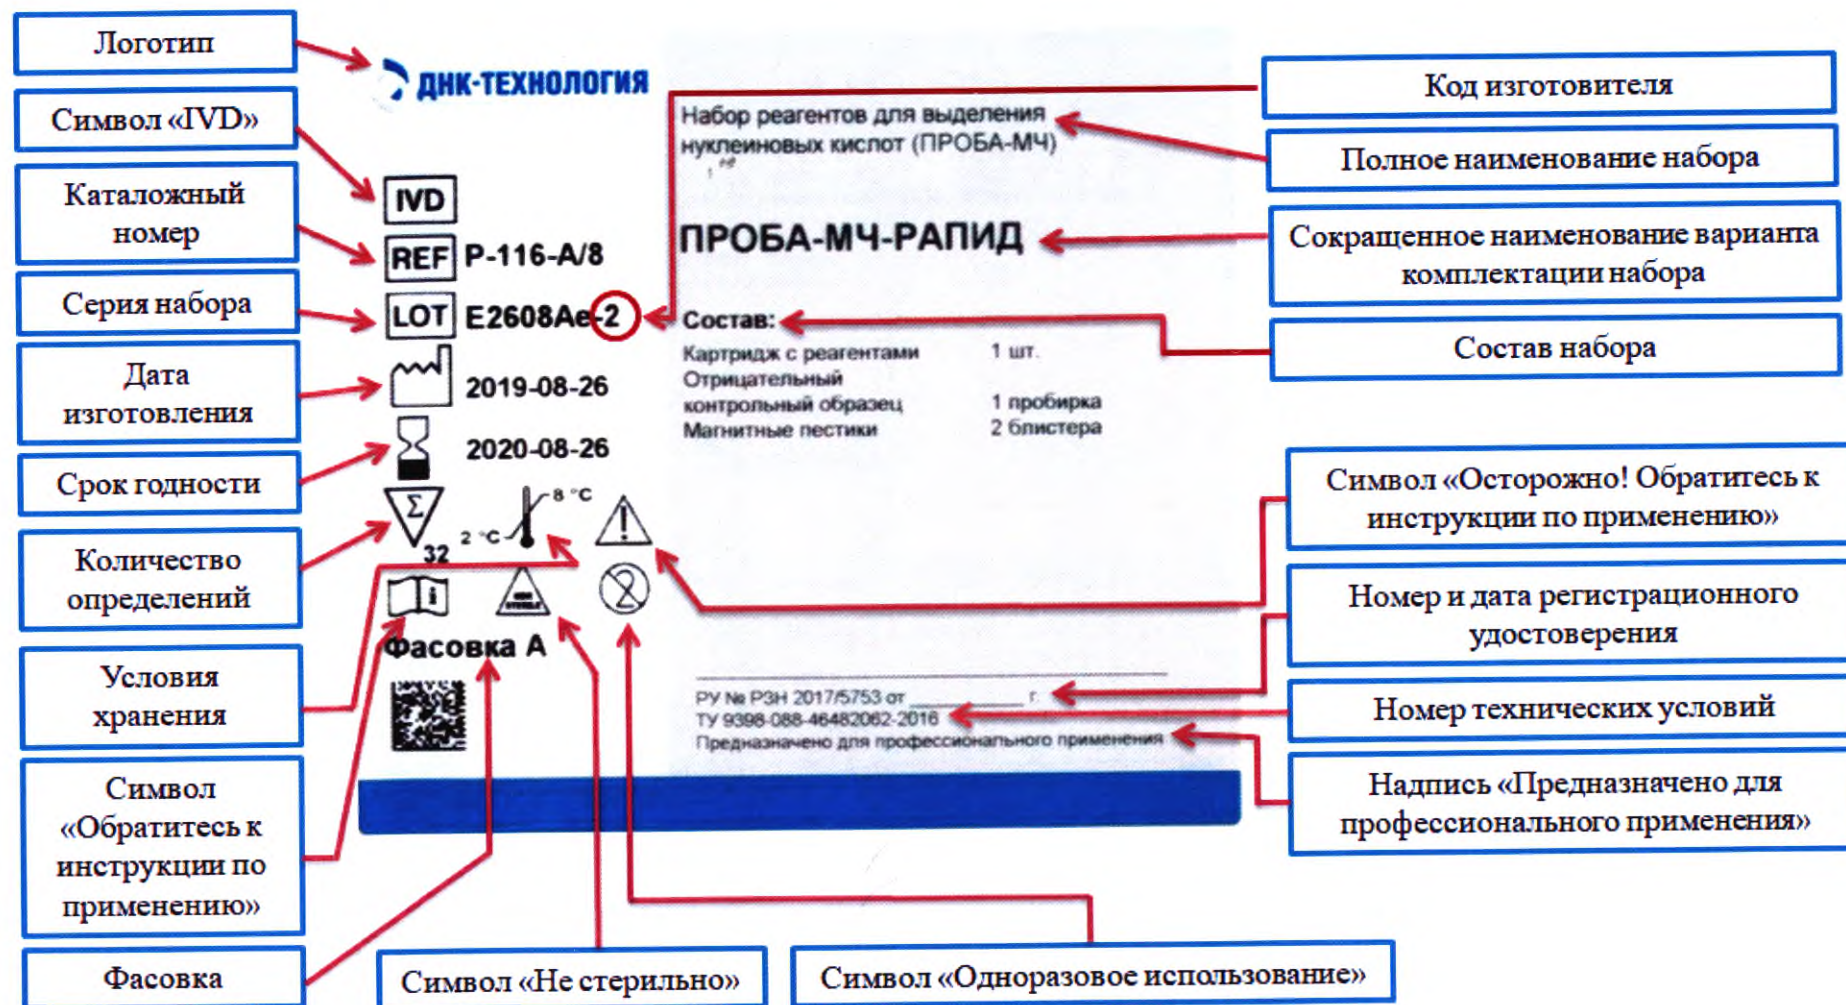

Код изготовителя
(надпись на
коробке)



Код изготовителя указан на этикетке
(см. последнюю цифру в серии):

1. ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20
2. ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117248, г. Москва
Научный проезд, д.20, стр.4

Тел./факс: +7 (495) 840 17 71
mail@dna-technology.ru

Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200 75 15
hotline@dna-technology.ru

www.dna-technology.ru



Код изготовителя
(код на этикетке)



Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ)


IVD

REF P-116-A/8

LOT E2608Ae-2

2019-08-26

2020-08-26



Фасовка А




ПРОБА-МЧ-РАПИД

Состав:


Картридж с реагентами	1 шт.
Отрицательный контрольный образец	1 пробирка
Магнитные пестики	2 блистера

РУ № РЗН 2017/5753 от _____ г.
ТУ 9398-089-46482062-2016
Предназначено для профессионального применения


Макет этикетки на набор реагентов ПРОБА-МЧ в комплектации ПРОБА-МЧ-НК фасовка N

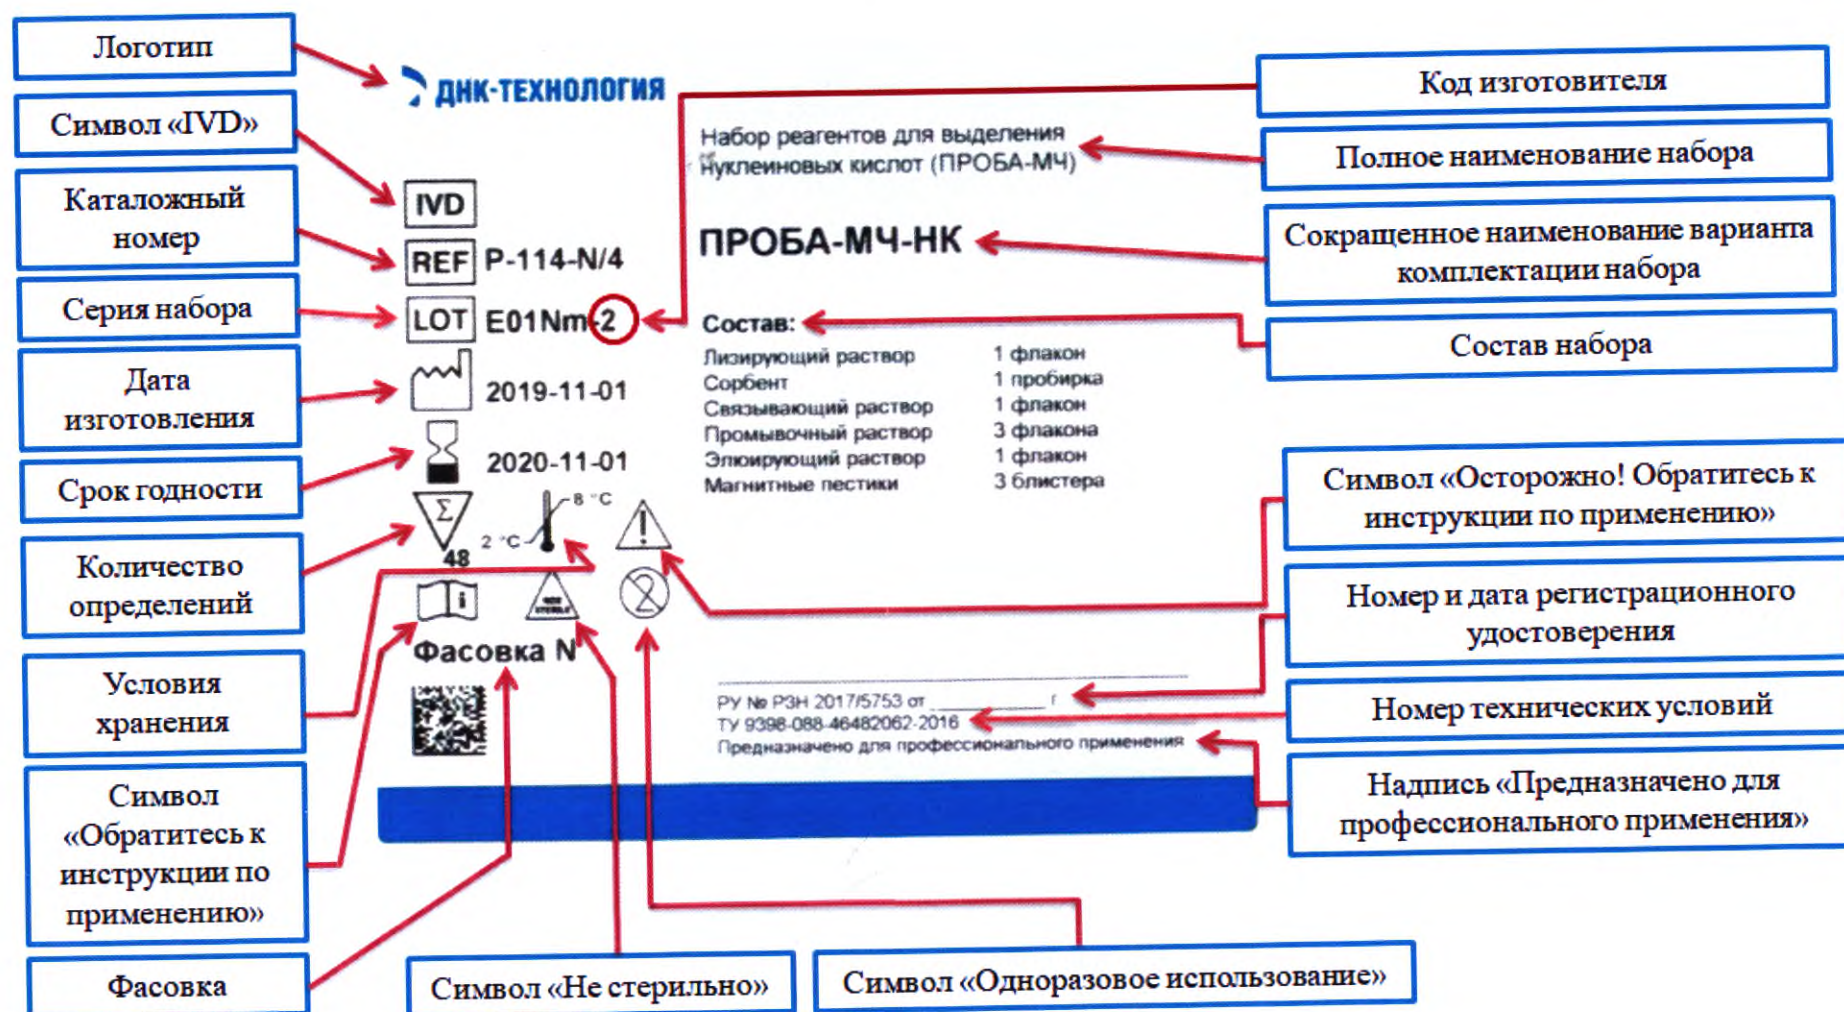


Код изготовителя
(надпись на
коробке)

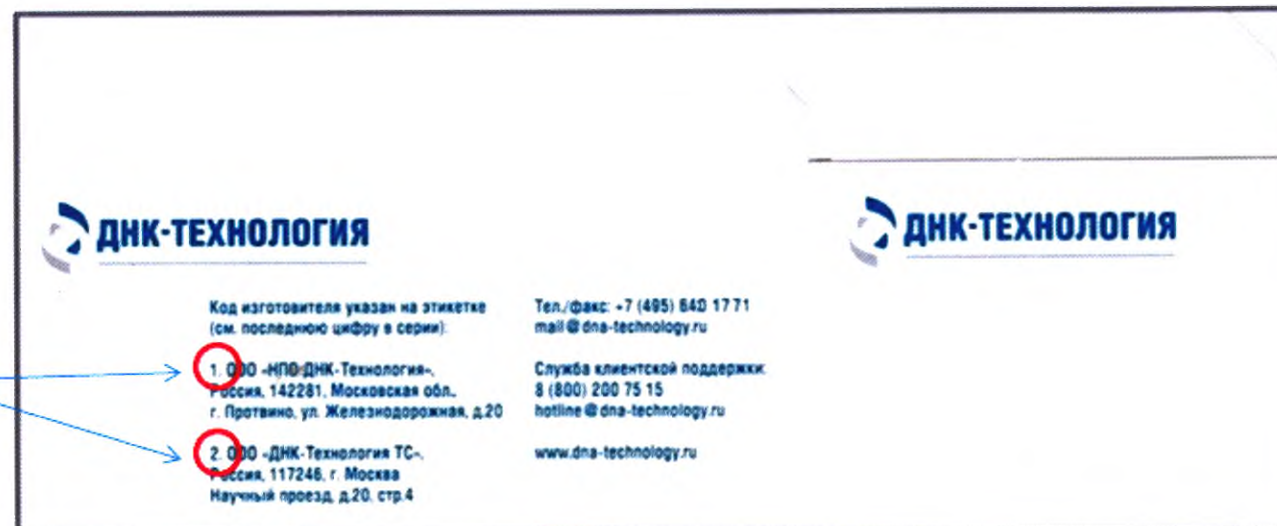

Код изготовителя
(код на этикетке)

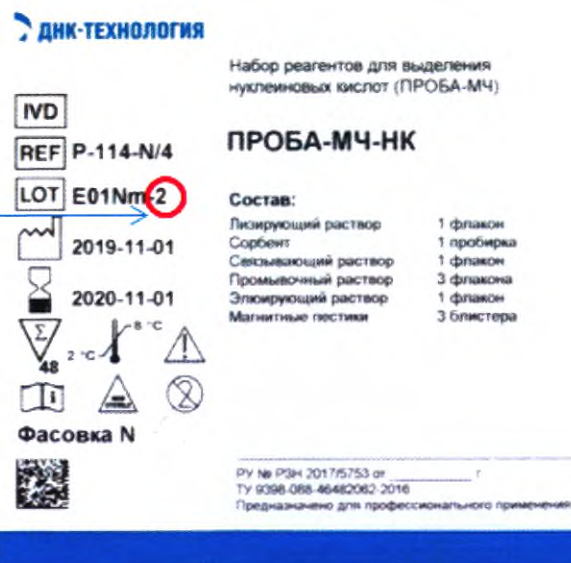


Макет этикетки на набор реагентов ПРОБА-МЧ в комплектации ПРОБА-МЧ-РАПИД фасовка N

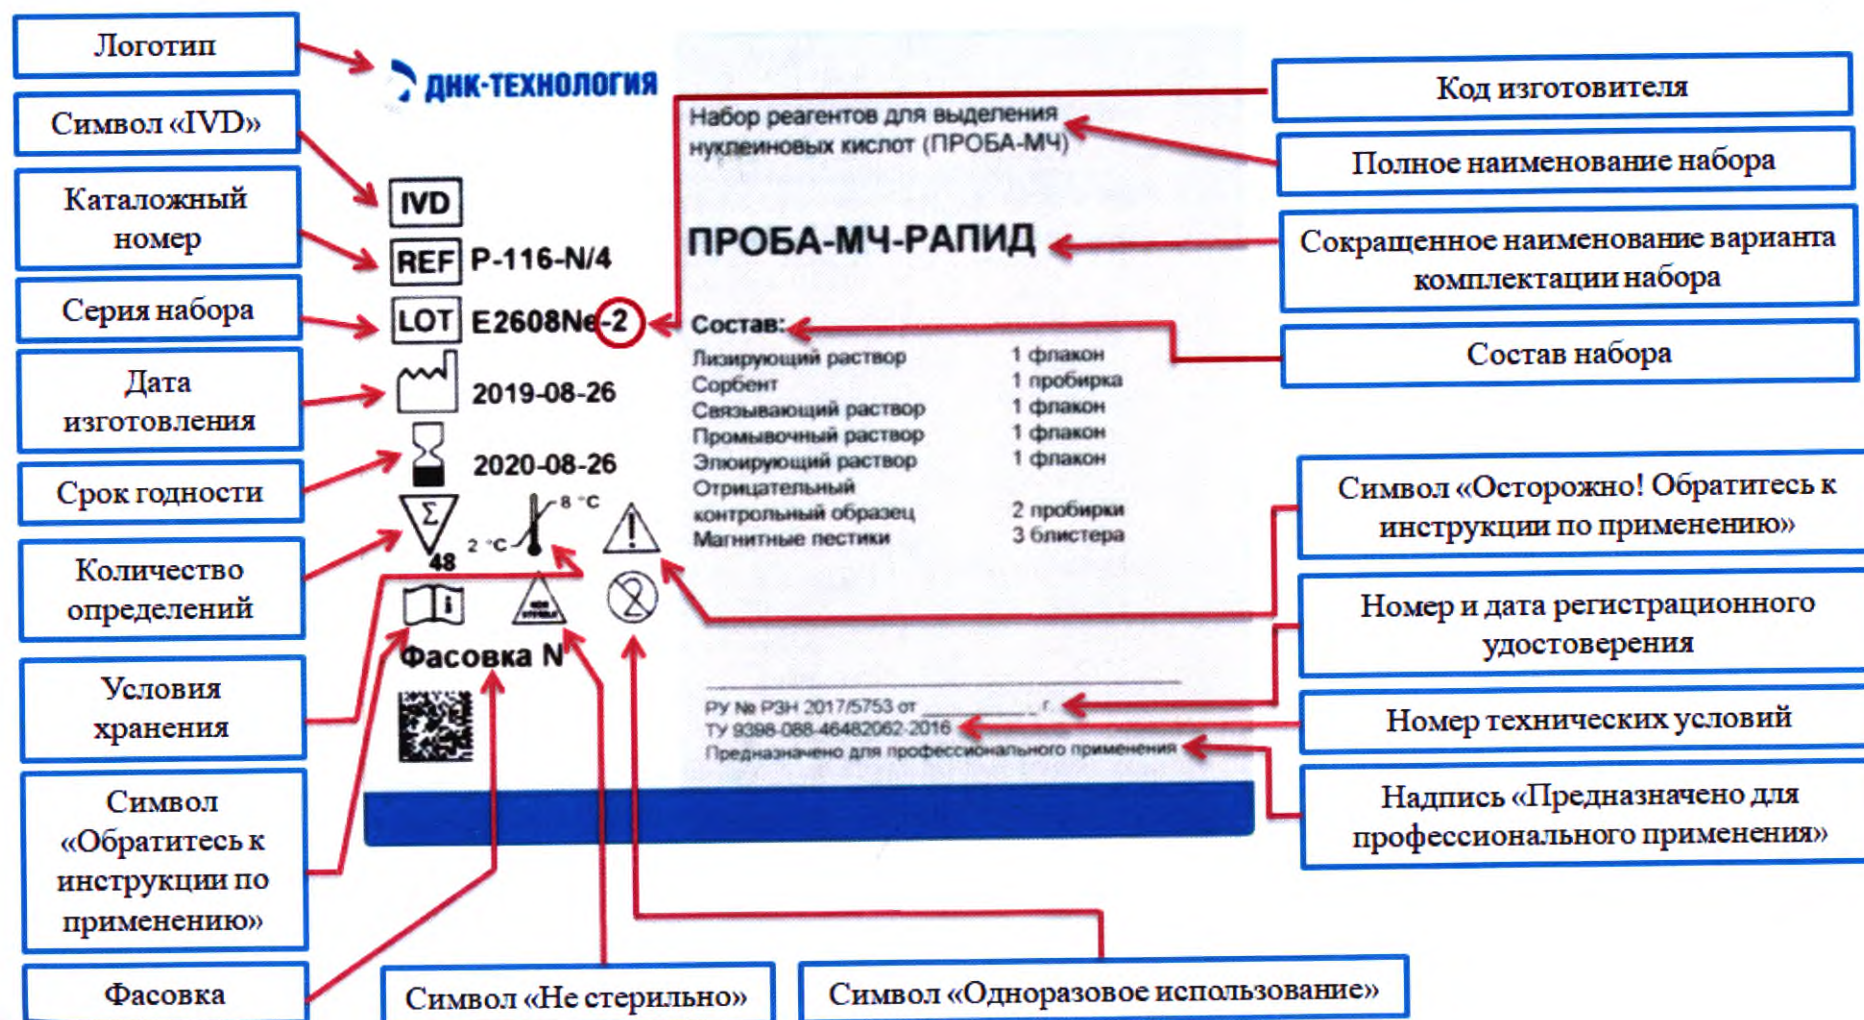

Код изготовителя
(надпись на
коробке)



Код изготовителя
(код на этикетке)

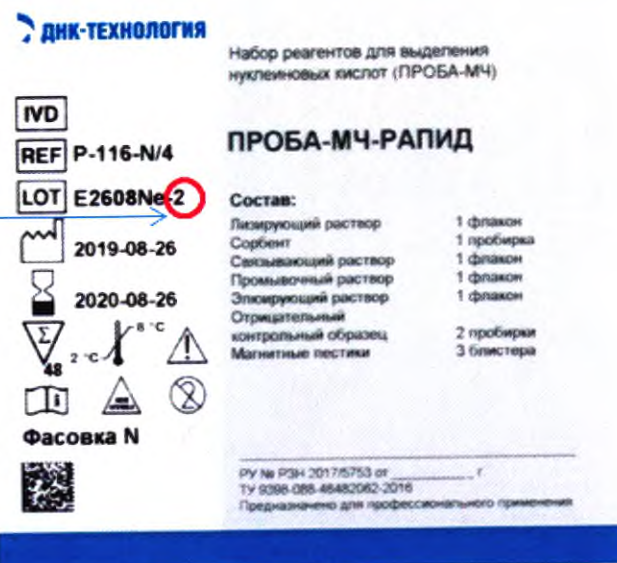



Макет этикетки на транспортную тару

**Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ) по ТУ 93-98-088-46482062-2016**

IVD	Комплектация: ПРОБА-МЧ-НК
 _____  _____ LOT _____  Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования 2 °C  8 °C

Масса нетто потребительской упаковки:
Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Код изготовителя указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии):

1.ООО «НПО ДНК-Технология», Россия
 142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20
 2.ООО «ДНК-Технология ТС». Россия
 117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.
 E-mail: mail@dna-technology.ru

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться
 по адресу: ООО «ДНК-Технология», 117587, Москва, Варшавское шоссе,
 д.125ж, к.6, этаж 5, ком. 14. тел./факс +7 (495) 640-17-71. www.dna-technology.ru

ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!



Макет этикетки на транспортную тару

**Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ) по ТУ 93-98-088-46482062-2016**

IVD	Комплектация: ПРОБА-МЧ-РАПИД
 _____  _____ LOT _____  Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования 2°C  25°C  не более 5 суток

Масса нетто потребительской упаковки:
Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Код изготовителя указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии):

1.ООО «НПО ДНК-Технология», Россия

142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20

2.ООО «ДНК-Технология ТС». Россия

117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.

 E-mail: mail@dna-technology.ru

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться по адресу: ООО «ДНК-Технология», 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, к.6, этаж 5, ком. 14, тел./факс +7 (495) 640-17-71, www.dna-technology.ru

ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 20

(двадцать) листа (ов)

специалист по регистрации

Щербакова Н.И.

