

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»

**С.А. Самарин**«**26**» **декабря** 2018 г.

**ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

**Набор реагентов для выявления и типирования возбудителей грибковых инфекций
рода *Candida*, *Malassezia*, *Saccharomyces* и *Debaryomyces*
методом ПЦР в режиме реального времени
(МикозоСкрин)
по ТУ 21.20.23-104-46482062-2018**

2018 г.

Набор реагентов для выявления и типирования возбудителей грибковых инфекций рода Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces методом ПЦР в режиме реального времени (МикозоСкрин) по ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

REF R1-P023-S3/S

LOT D2311S-2

23.11.2018

23.11.2019

2 °C

IVD

Фасовка S, стрипы



Набор реагентов для выявления и типирования возбудителей грибковых инфекций рода Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces методом ПЦР в режиме реального времени

МикозоСкрин

Состав:

Смеси для амплификации, запечатанные парафином	24 стрипы по 8 пробирок
Раствор Taq-полимеразы	4 пробирки
Минеральное масло	4 пробирки
Положительный контрольный образец	1 пробирка
Крышки для стрипов	24 шт.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН
ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

ИНСТРУКЦИЯ

Набор реагентов для выявления и типирования возбудителей грибковых инфекций рода Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces методом ПЦР в режиме реального времени

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

МикозоСкрин

Смеси для амплификации, запечатанные парафином

24 стрипы по 8 пробирок по 20 мкл

LOT D2311S

23.11.2019

2 °C



ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

ООО «ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ ТСО»

Паспорт качества № H21439

Набор реагентов для выявления и типирования возбудителей грибковых инфекций рода Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces методом ПЦР в режиме реального времени

Фасовка:
Серия:
Дата:
Срок:

раствор Taq-полимеразы
LOT D2311S
20 мкл

раствор Taq-полимеразы
LOT D2311S
20 мкл

минеральное масло
LOT D2311S
20 мкл

минеральное масло
LOT D2311S
20 мкл

1. Проверка работоспособности набора реагентов и маркировки

2. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

3. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

4. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

5. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

6. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

7. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

8. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

9. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

10. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

11. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

12. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

13. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

14. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

15. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

16. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

17. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

18. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

19. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

20. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

21. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

22. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

23. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

24. Проверка соответствия набора реагентов требованиям ТУ 21.20.23-104-46482062-2018


2018

Условия хранения: от -20 до +25 °C, более 5 суток

Заключение ОТК: соответствует
Дата выпуска: 27.11.20




Набор реагентов для выявления и типирования возбудителей грибковых инфекций рода Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces методом ПЦР в режиме реального времени (МикозоСкрин) по ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

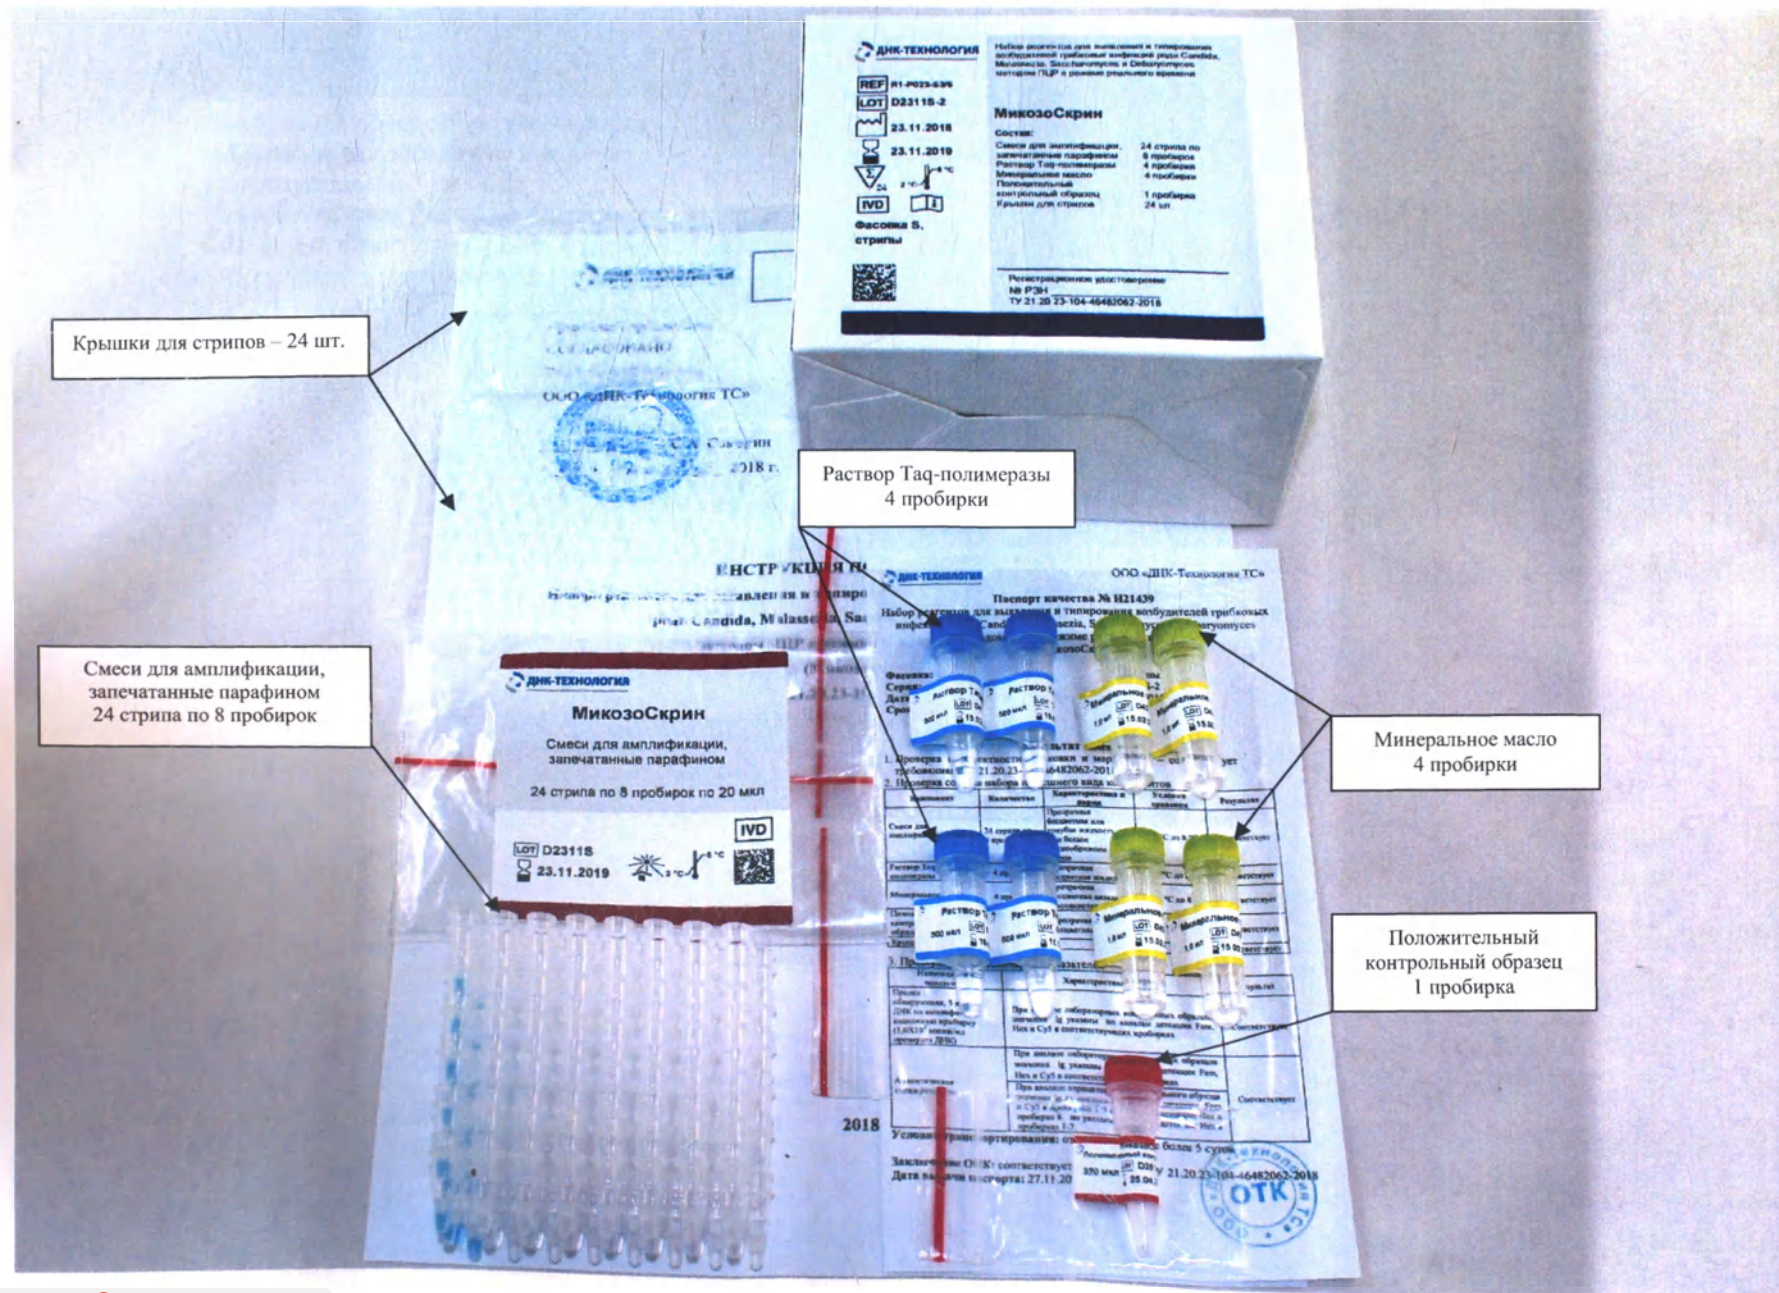

Набор реагентов для выявления и типирования возбудителей грибковых инфекций рода *Candida*, *Malassezia*, *Saccharomyces* и *Debaryomyces* методом ПЦР в режиме реального времени (МикозоСкрин) по ТУ 21.20.23-104-46482062-2018

Информация об изготовителе нанесена типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку.
Код изготовителя указан на этикетке набора (см. последнюю цифру в серии).

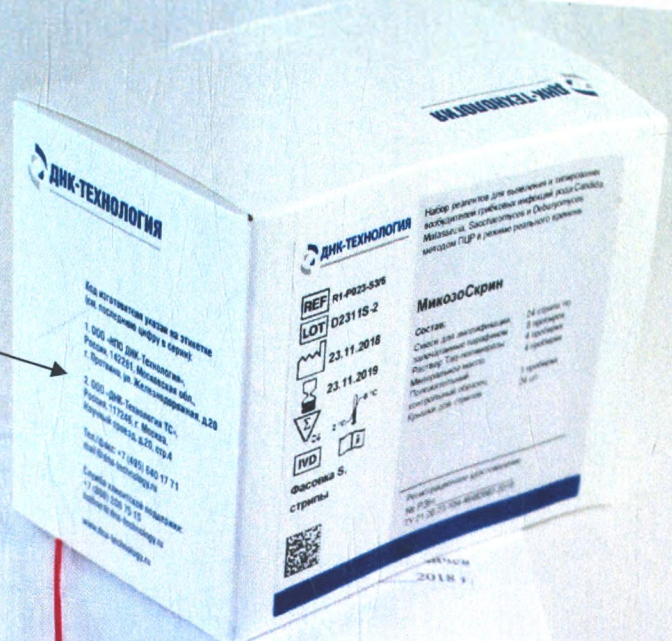

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4
(четыре) листа (ов)
специалист по регистрации
Щербакова Н.И. 