



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

Sin Chen

Син Чэнь

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 26.08.19г.

СЫСоева Н.В.

«09» декабря 2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тройной контроль ASO/CRP/RF для биохимических анализаторов


Тройной контроль ASO/CRP/RF для биохимических анализаторов

В составе:


Низкий уровень (L): 3 шт x 1 мл



Высокий уровень (H): 3 шт x 1 мл

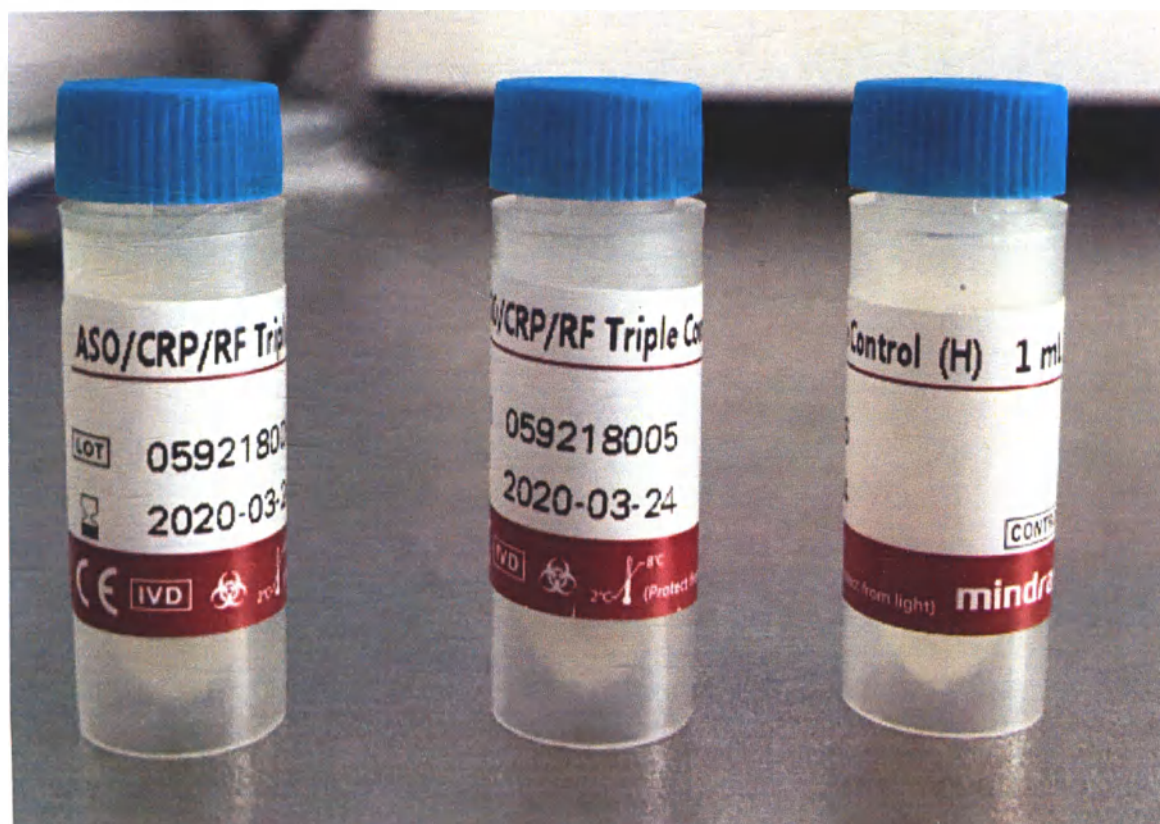

Пример маркировки медицинского изделия «Тройной контроль ASO/CRP/RF для биохимических анализаторов»

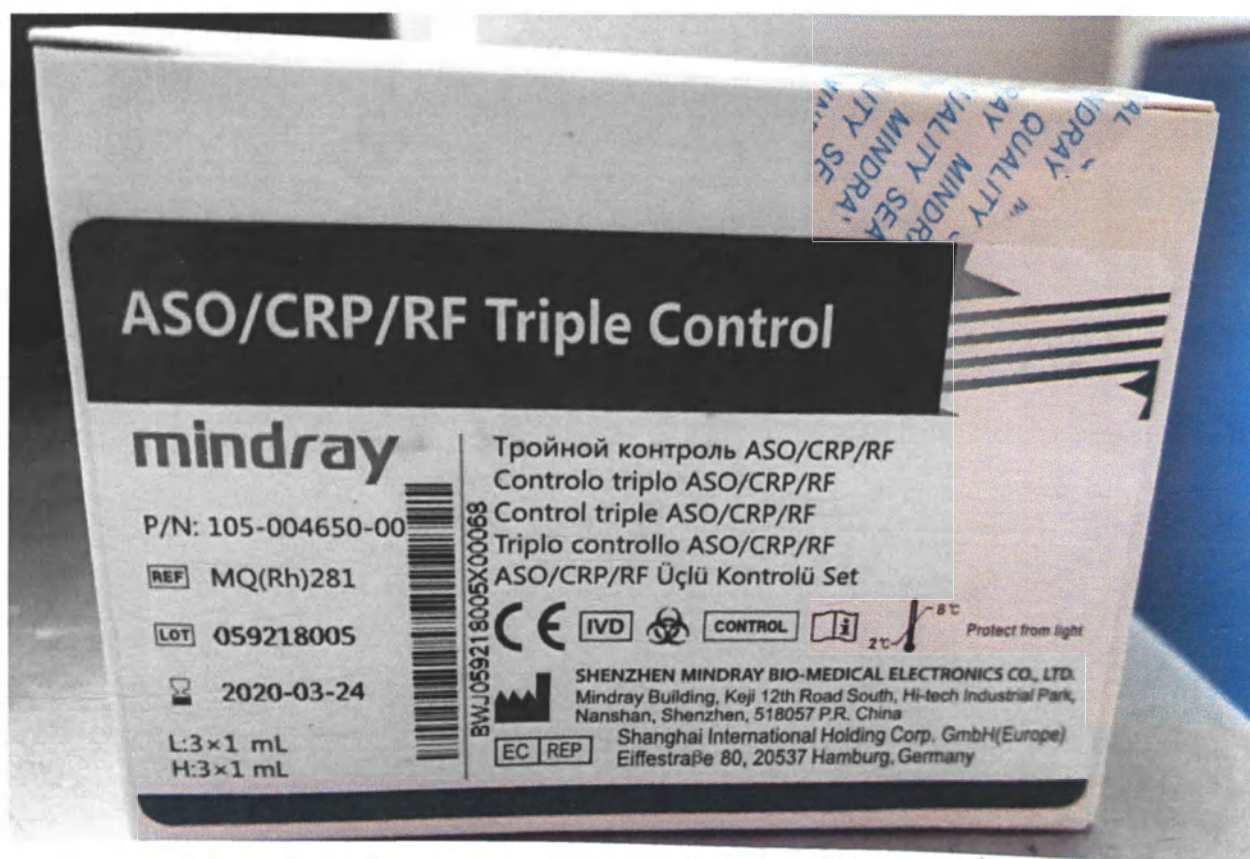



*сшего и
пропускается*

Заместитель

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 26.08.19Г
СЫСОНОВА Н.В.