

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ


Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой цветной доплеровский V7

(см. Приложение на 1 листе)

Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd.
(«Ухань Зонкее Био-медиал Электроникс Ко., Лтд.»), Китай



Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой цветной доплеровский V7 (Блок основной)

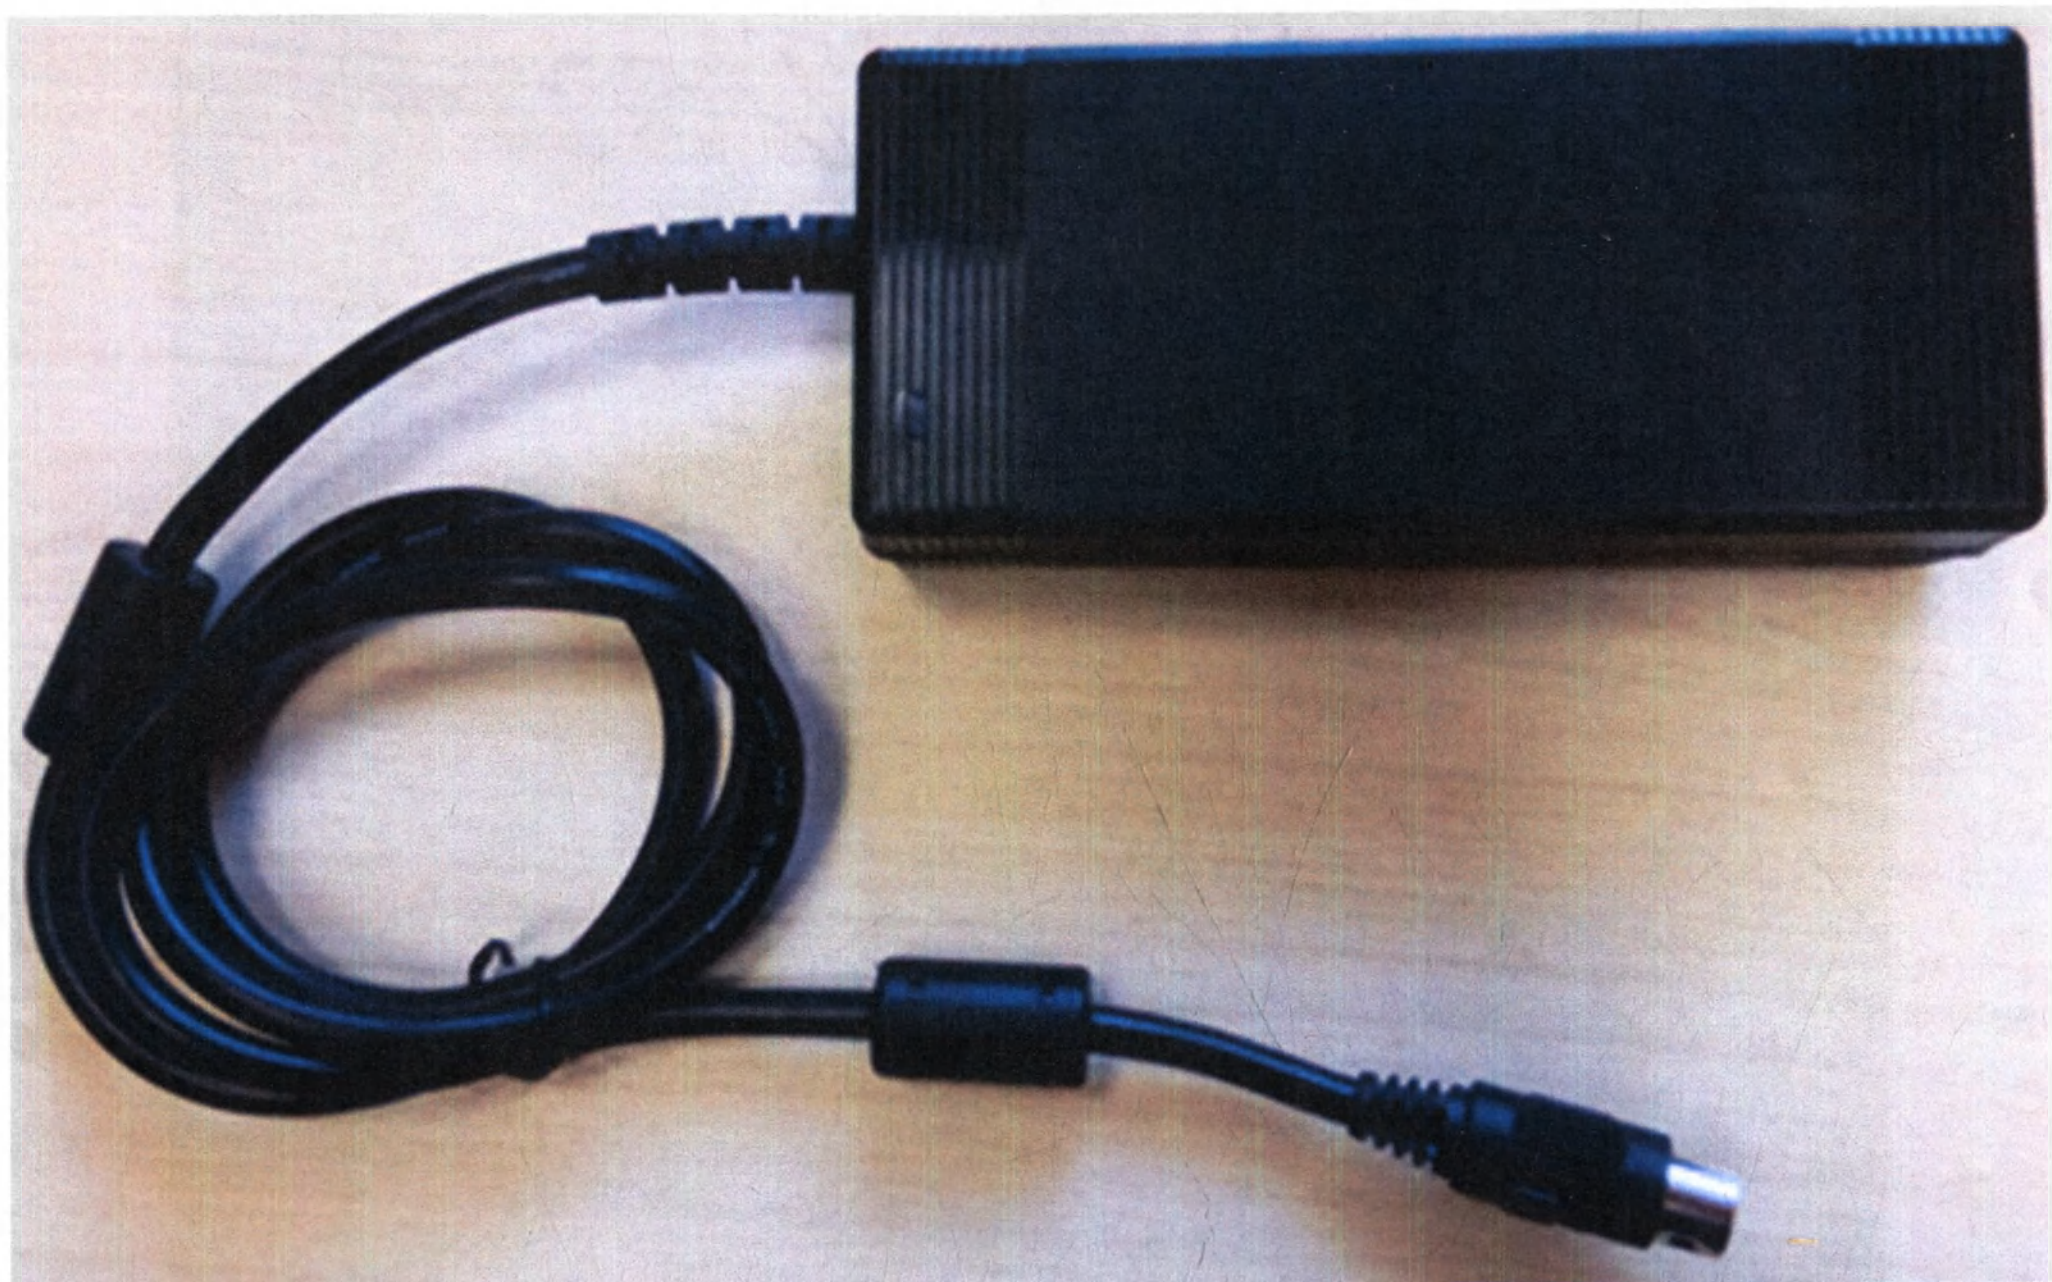

Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой цветной доплеровский V7 (Адаптер питания)



Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой цветной доплеровский V7 (Датчик конвексный матричный TC50)



Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой цветной доплеровский V7 (Датчик внутривидеостенной ТС10)




Аппарат ультразвуковой диагностики цифровой цветной доплеровский V7 (Датчик линейный матричный TL40)



Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой цветной доплеровский V7 (Патчик фазированный матричный TP16)




Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой цветной доплеровский V7 (Держатель датчиков)

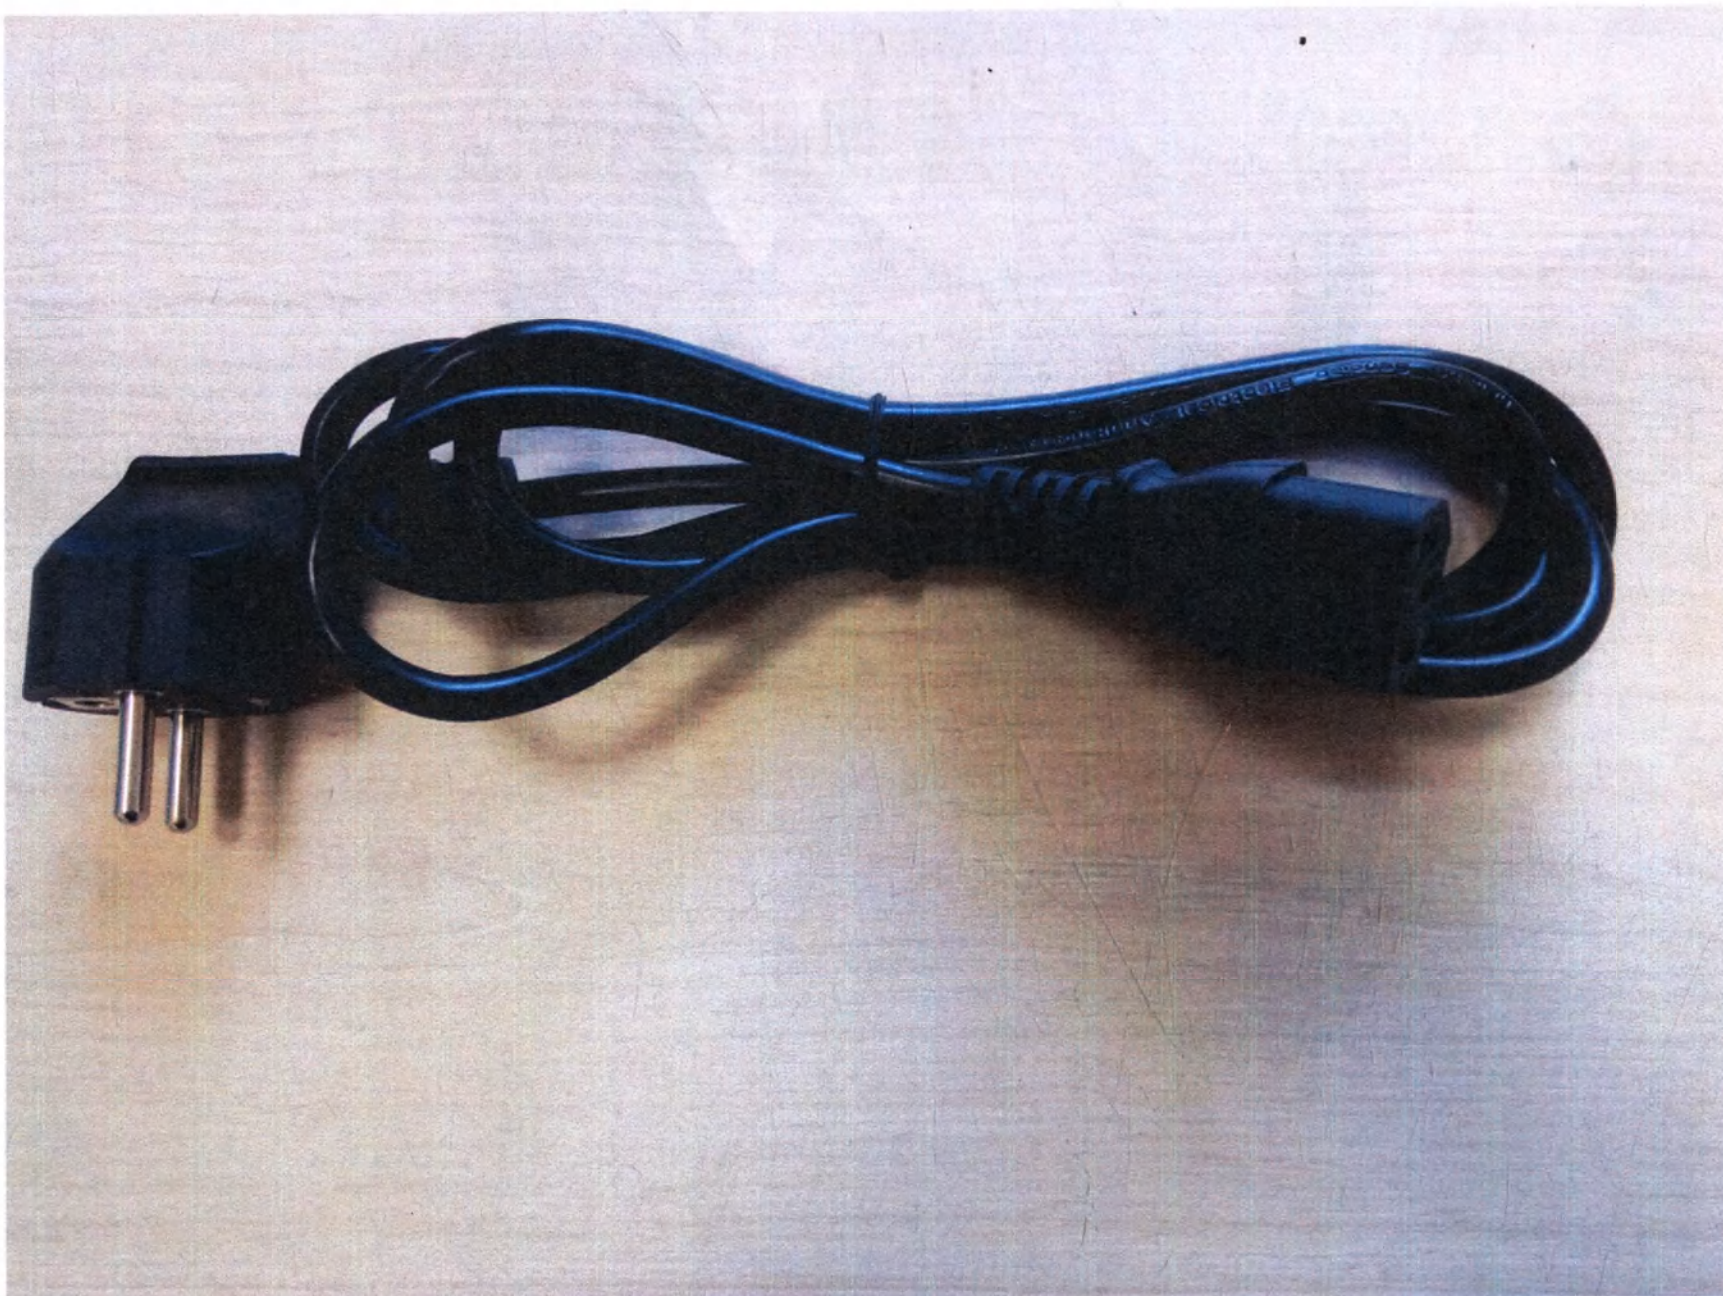

Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой цветной доплеровский V7 (Кабель питания)



H712190308N0001



2017-08-02

I класс электробезопасности

Питание : ~100 - 240 В , 50/60 Гц, 200 ВА

Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой цветной доплеровский V7



Well kang Limited,

The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Ireland



Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd. («Ухань Зонкее

Био-медикал Электроникс Ко., Лтд.»), Китай

#380, High-tech 2nd road, Eastlake high-tech district, Wuhan, Hubei,

P. R. China



Срок службы: 10 лет

Маркировка: Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой цветной доплеровский V7

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой цветной доплеровский V7, в составе:

- Адаптер питания – 1 шт.
- Блок основной – 1 шт.
- Датчик внутрисполостной TC10 (при необходимости) – 1 шт.
- Датчик конвексный матричный TC50 (при необходимости) – 1 шт.
- Датчик линейный матричный TL40 (при необходимости) – 1 шт.
- Датчик фазированный матричный TP16 (при необходимости) – 1 шт.
- Держатель датчиков – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью _____ листа (-ов)

Генеральный Директор _____ Носова Т.А.
М.П.

