




Фотографии медицинского изделия
Аппарат рентгеновский палатный передвижной
«МобиРен-4МТ-А»,
производства
АО «МТЛ», Россия

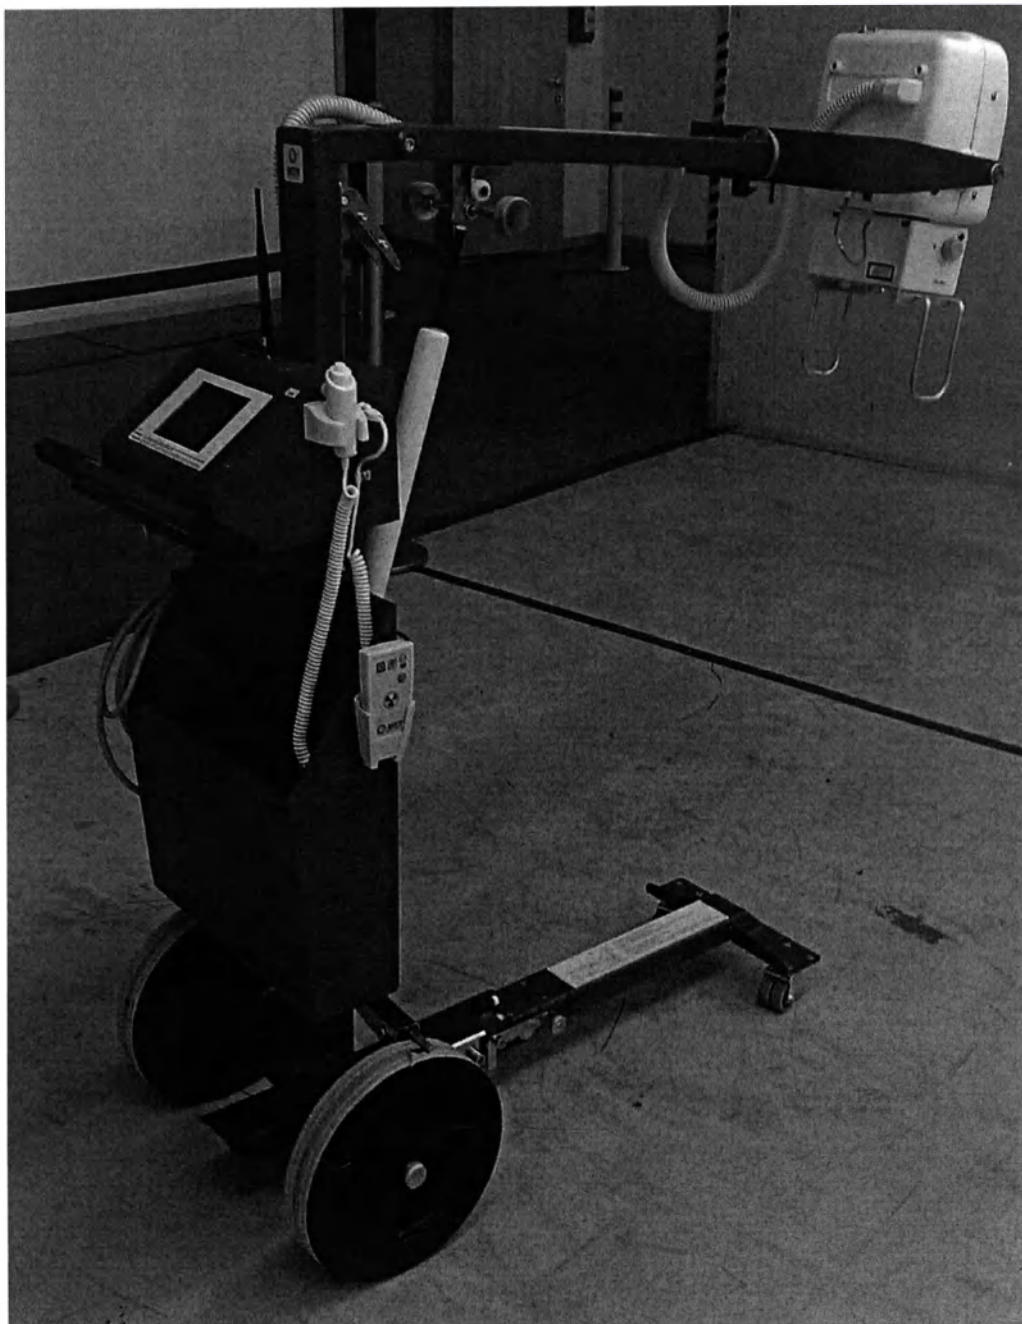


**Аппарат рентгеновский палатный передвижной
«МобиРен-4МТ-А»-1.1 производства АО «МТЛ», Россия**

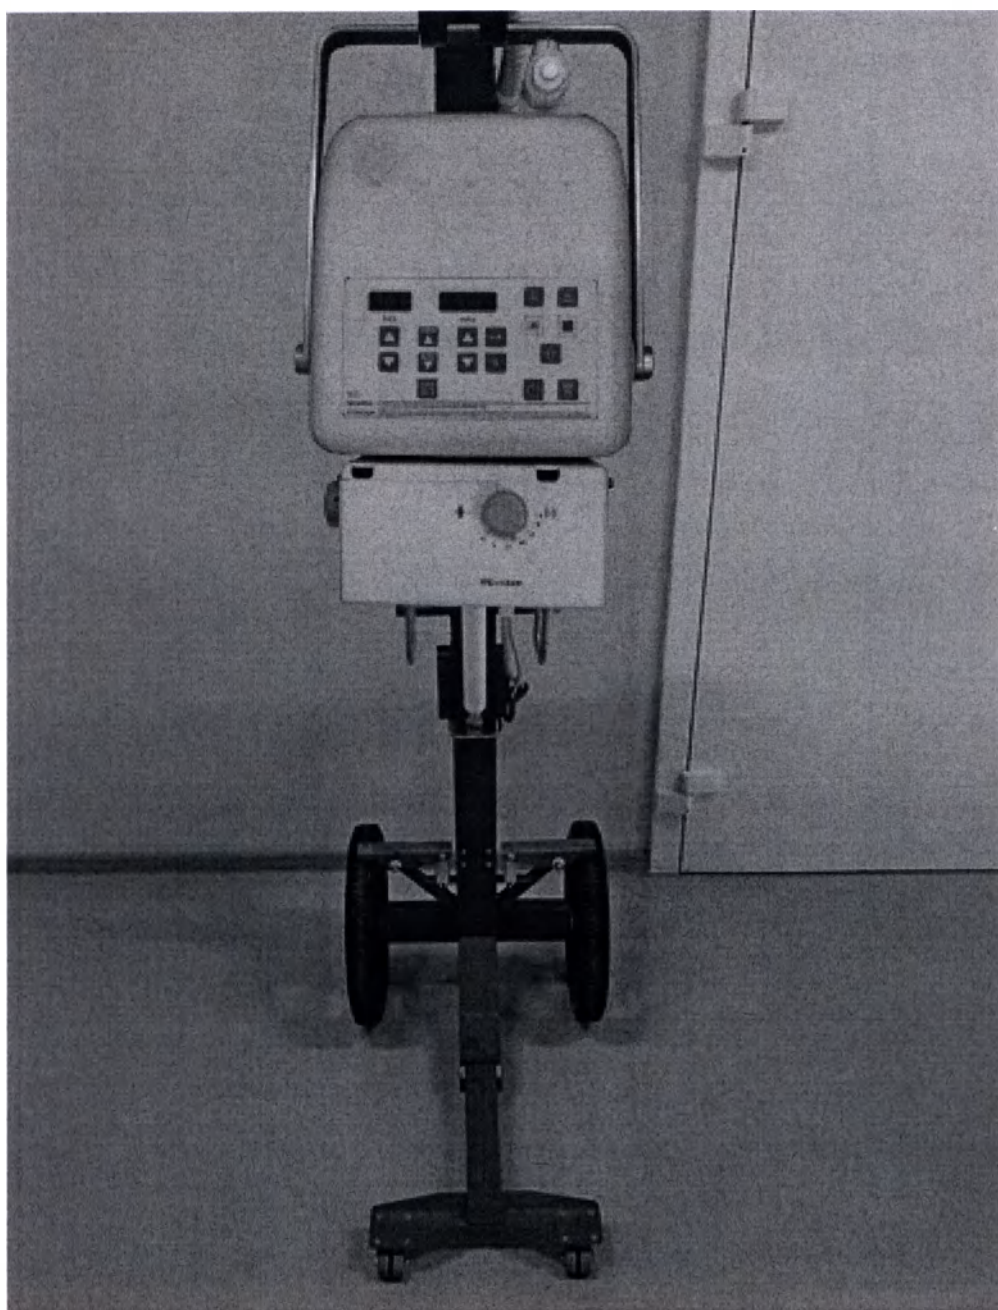


Аппарат рентгеновский палатный
передвижной «МобиРен-4МТ-А»-2.1
производства АО «МТЛ», Россия

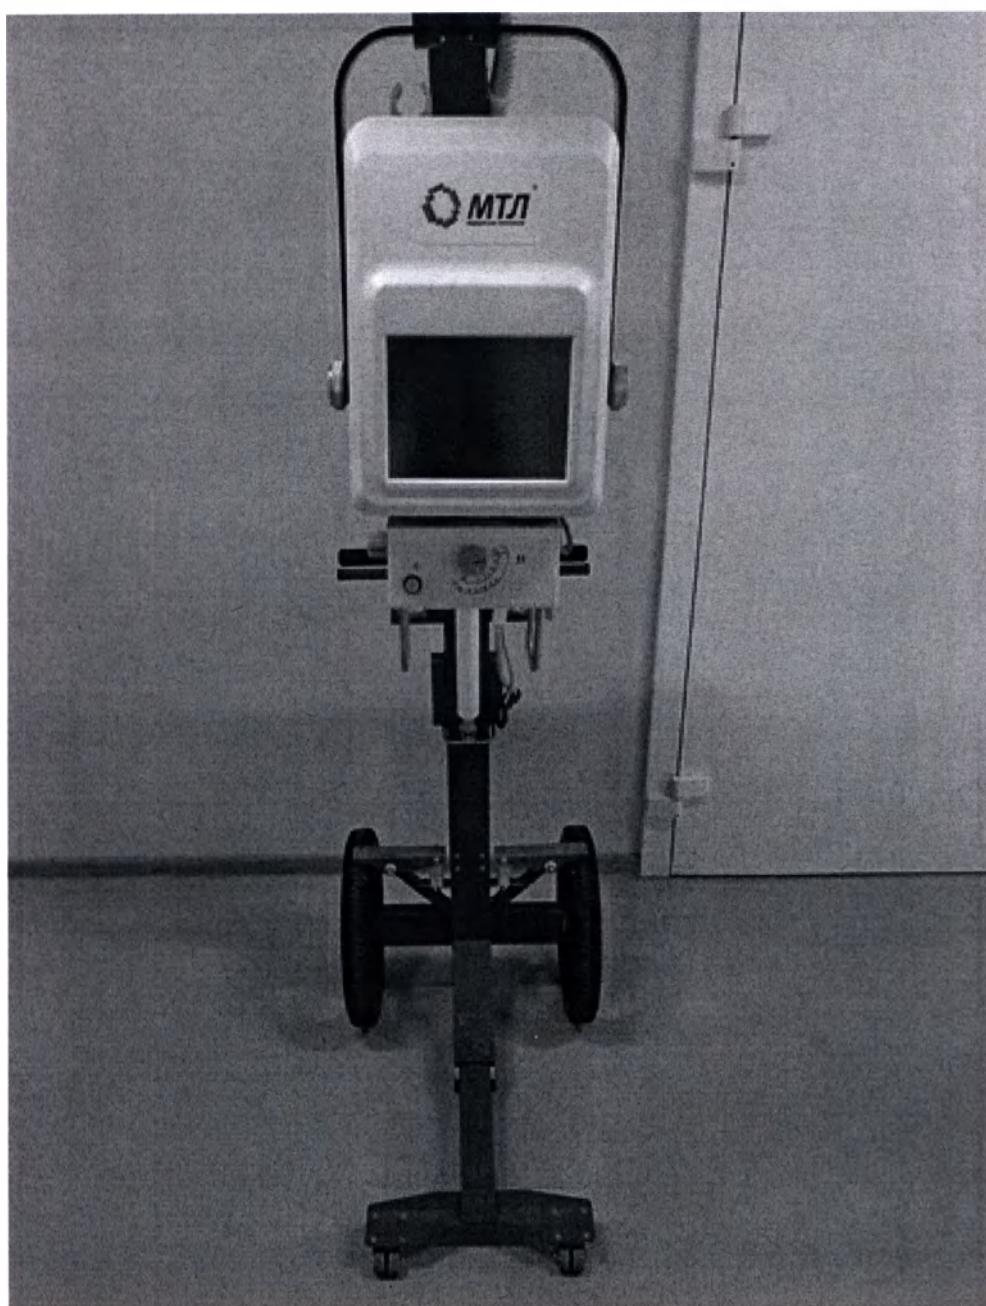


Аппарат рентгеновский палатный
передвижной «МобиРен-4МТ-А»-2.2
производства АО «МТЛ», Россия

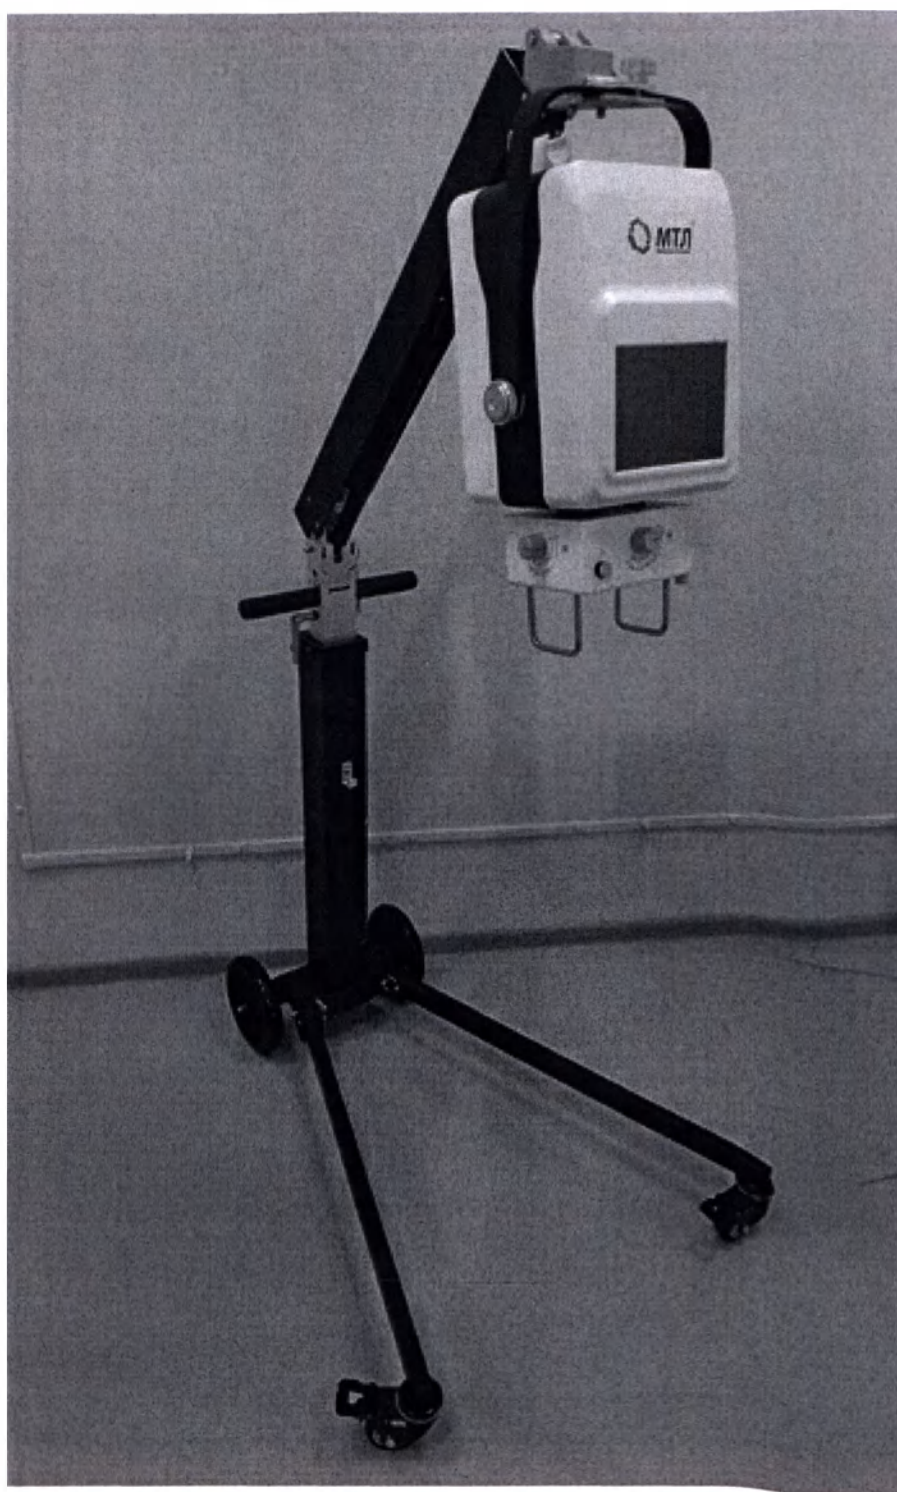

Аппарат рентгеновский палатный
передвижной «МобиРен-4МТ-А»-3.2
производства АО «МТЛ», Россия

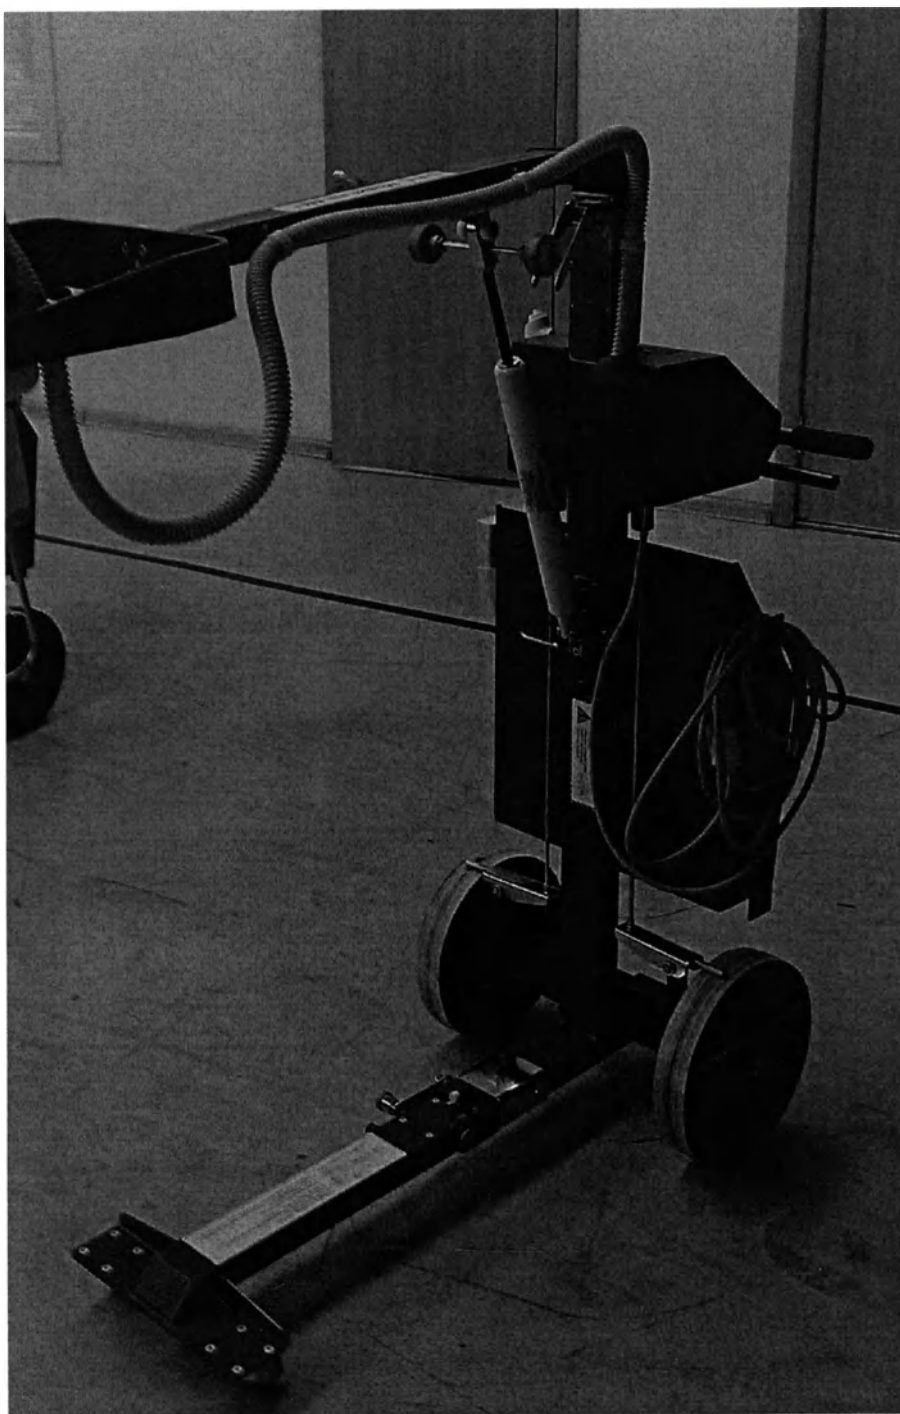

Штатив МТ-А-1
производства АО «МТЛ»,
Россия

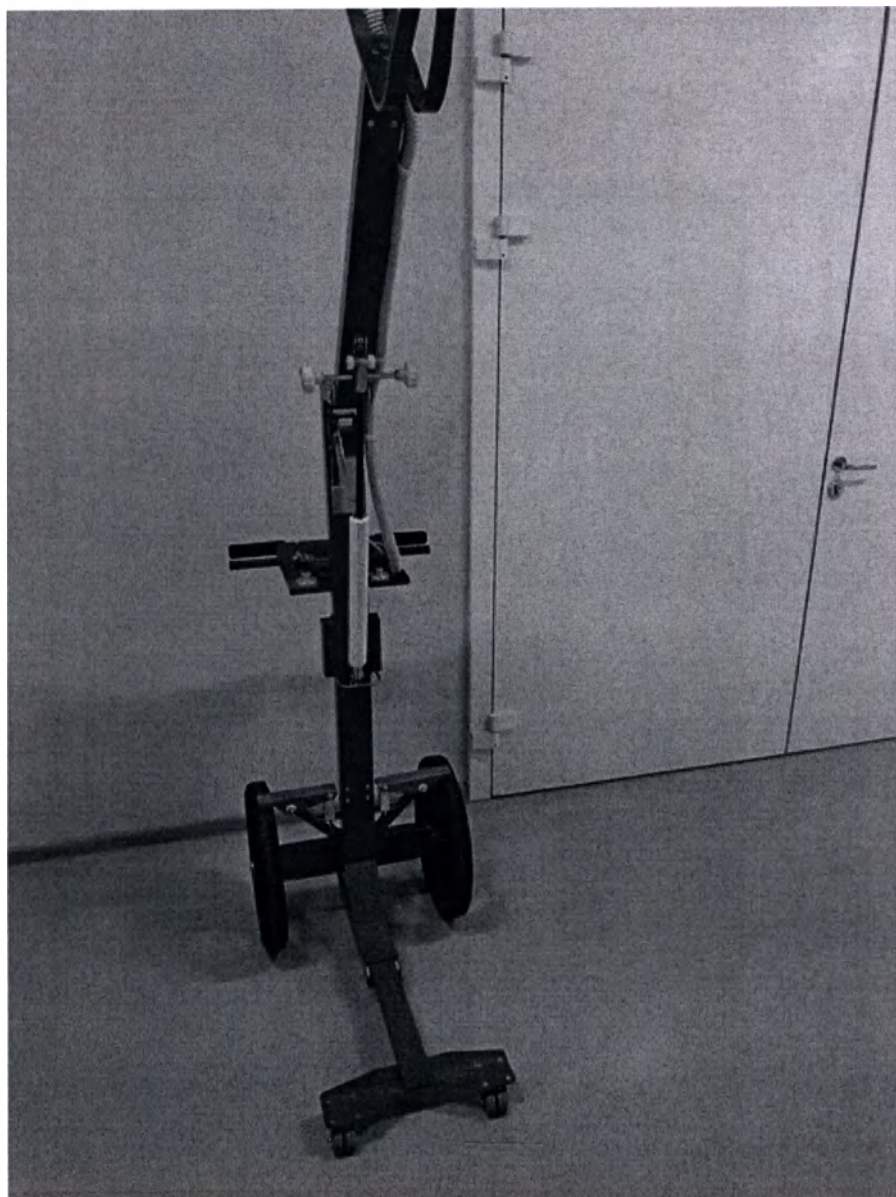


Штатив МТ-А-2
производства АО «МТЛ», Россия



Штатив МТ-А-3
производства АО «МТЛ», Россия



Моноблок с выносным пультом управления SPSL-HF-4.0-APR-MD или SPSL-HF-8.0-APR-MD
производства Sedecal S.A., Испания
на фото представлен моноблок SPSL-HF-4.0-APR-MD

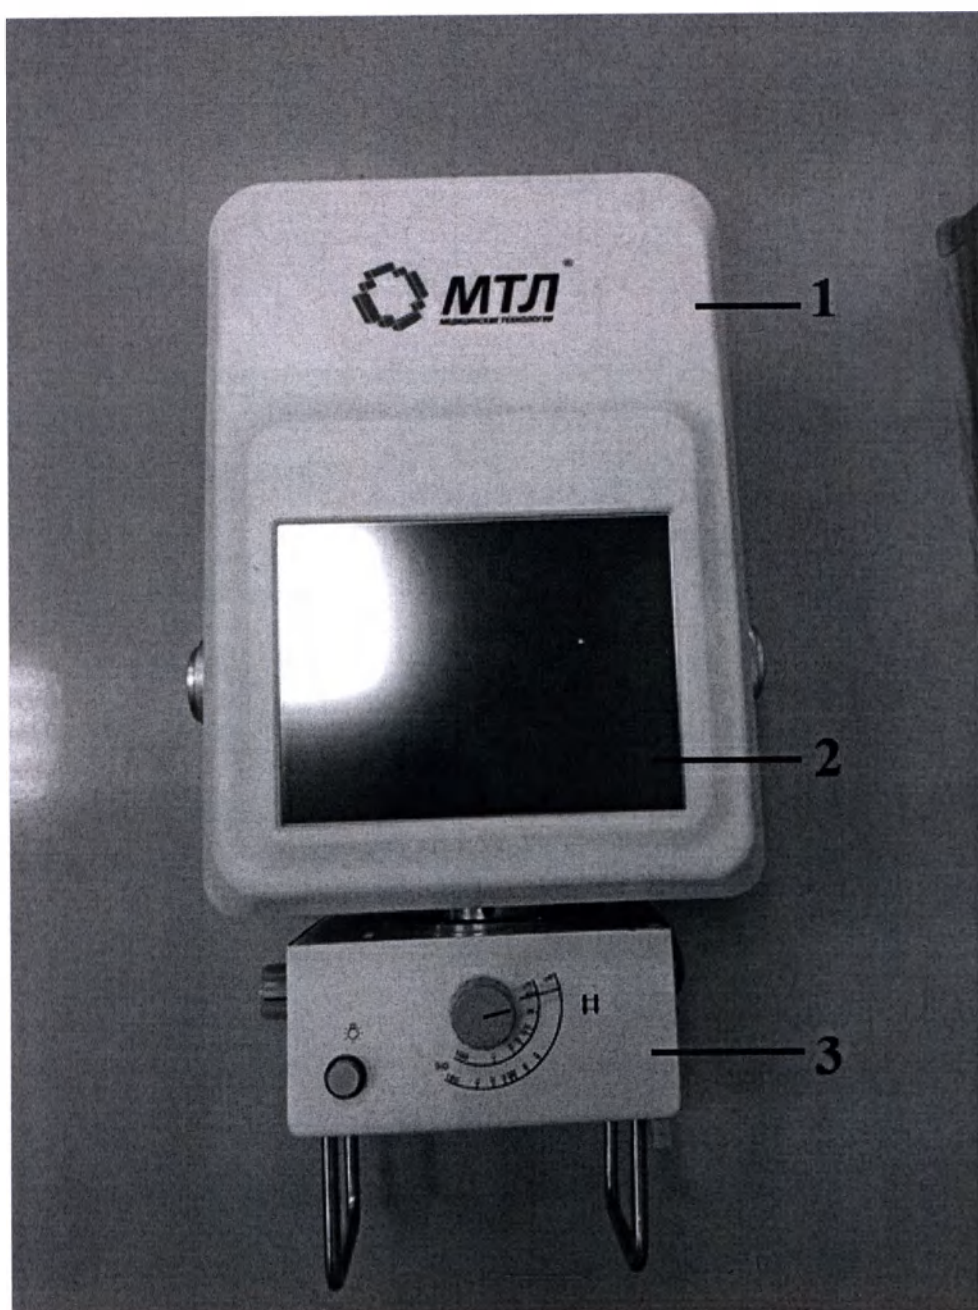


- 1 - Высоковольтный блок с модулем управления
- 2 - Блок интерфейса
- 3 - Коллиматор

Моноблок МТ-0.2 производства АО «МТЛ», Россия




Консоль управления МТ-0.2
производства АО «МТЛ», Россия

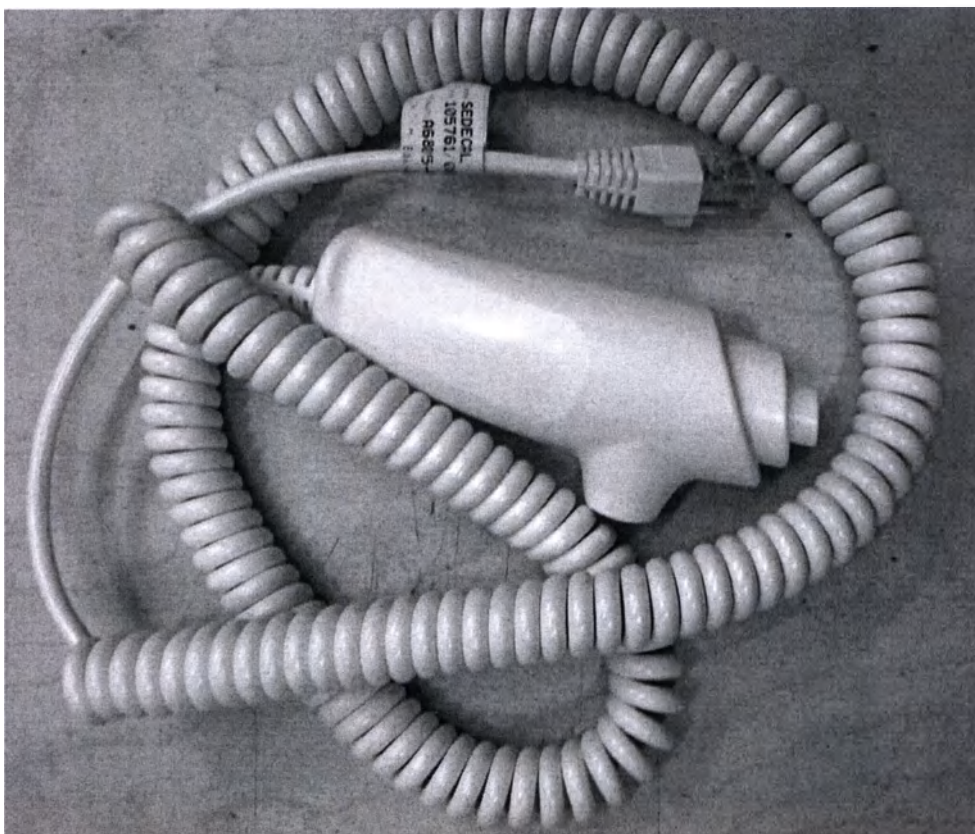


Устройство включения экспозиции А3399-01
производства Sedecal S.A., Испания




Устройство включения экспозиции А3399-01
производства Medical Scientific Ltd., США

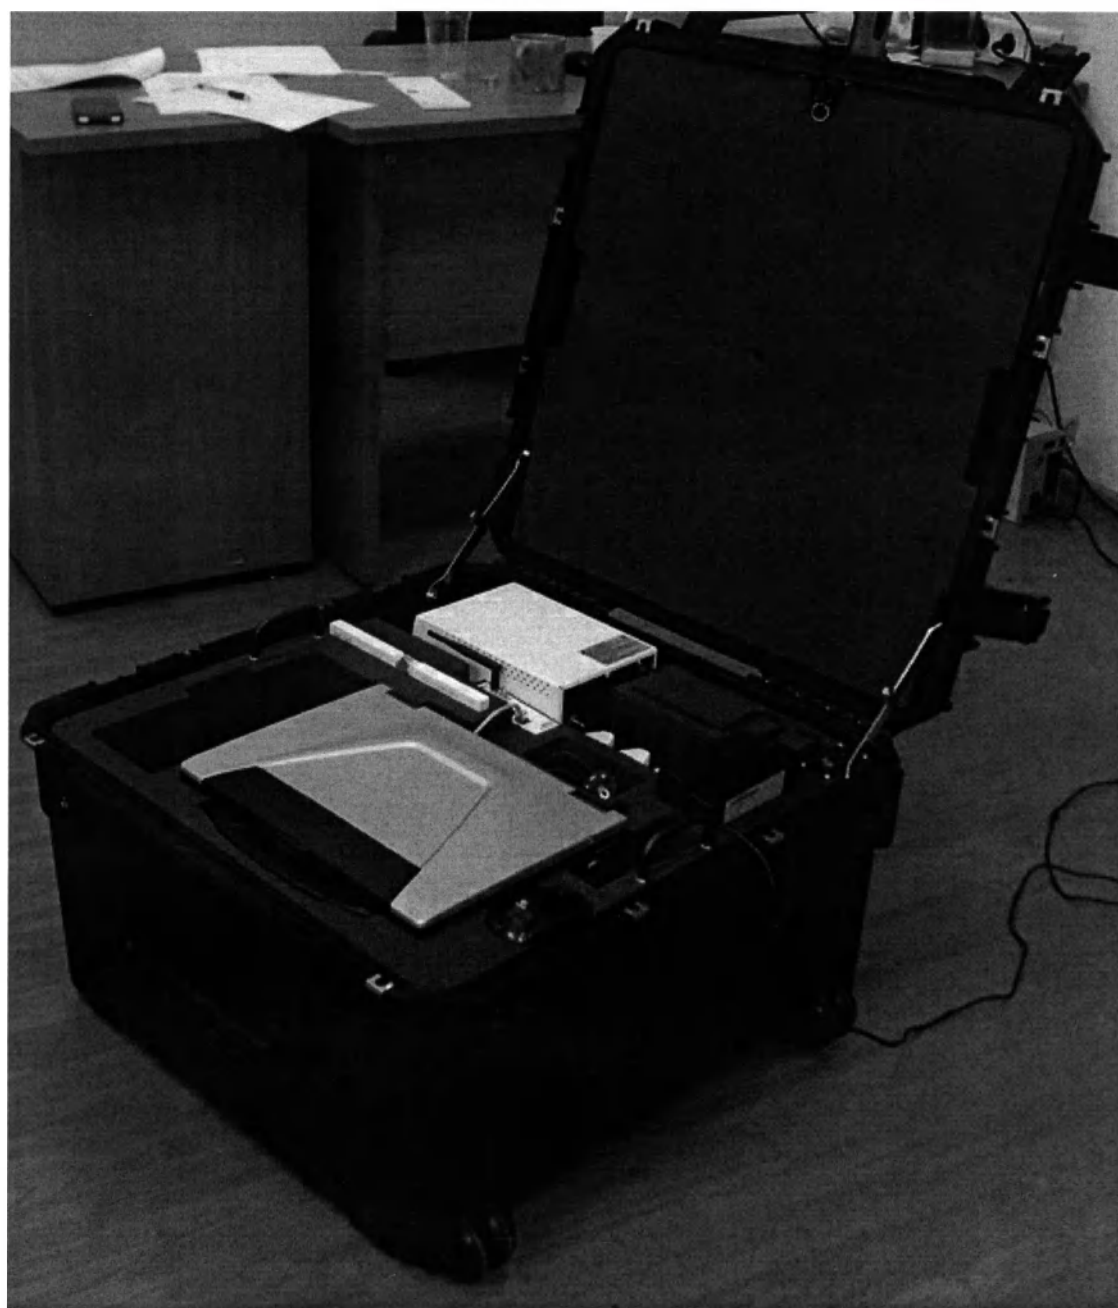


Система медицинская переносная для регистрации и работы с цифровыми медицинскими изображениями в лучевой диагностике «ДИАРМ-МТ-М»
исполнение «ДИАРМ-МТ-М»-1 или
исполнение «ДИАРМ-МТ-М»-2 в кейсе К-789-Е
производства АО «МТЛ», Россия

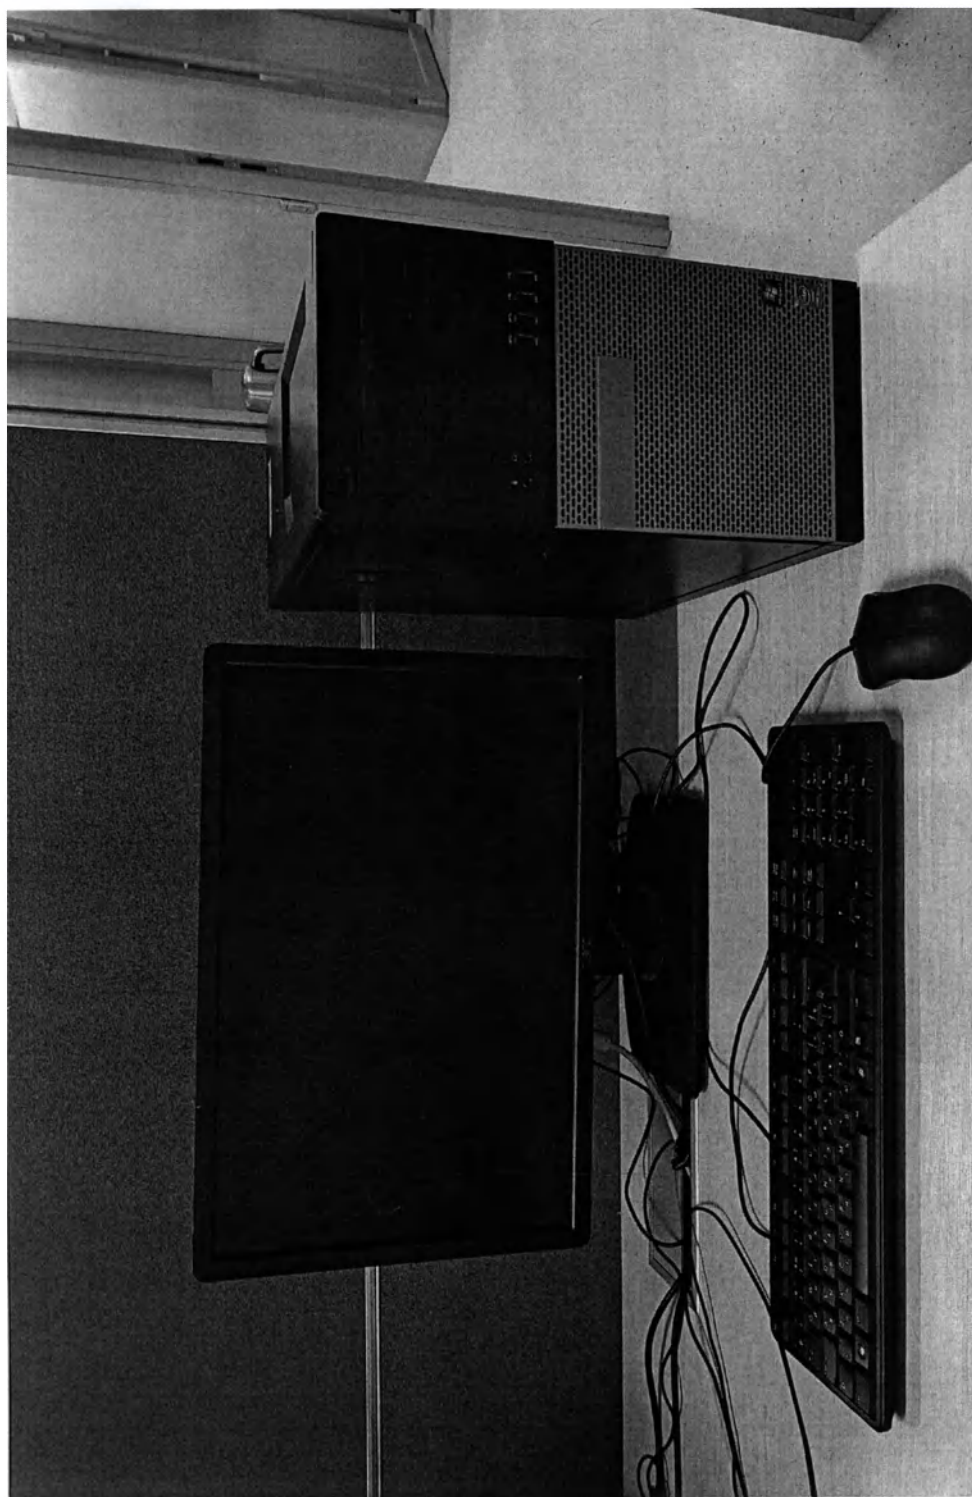

**Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога
«ДИАРМ-МТ-Плюс» производства АО «МТЛ», Россия**

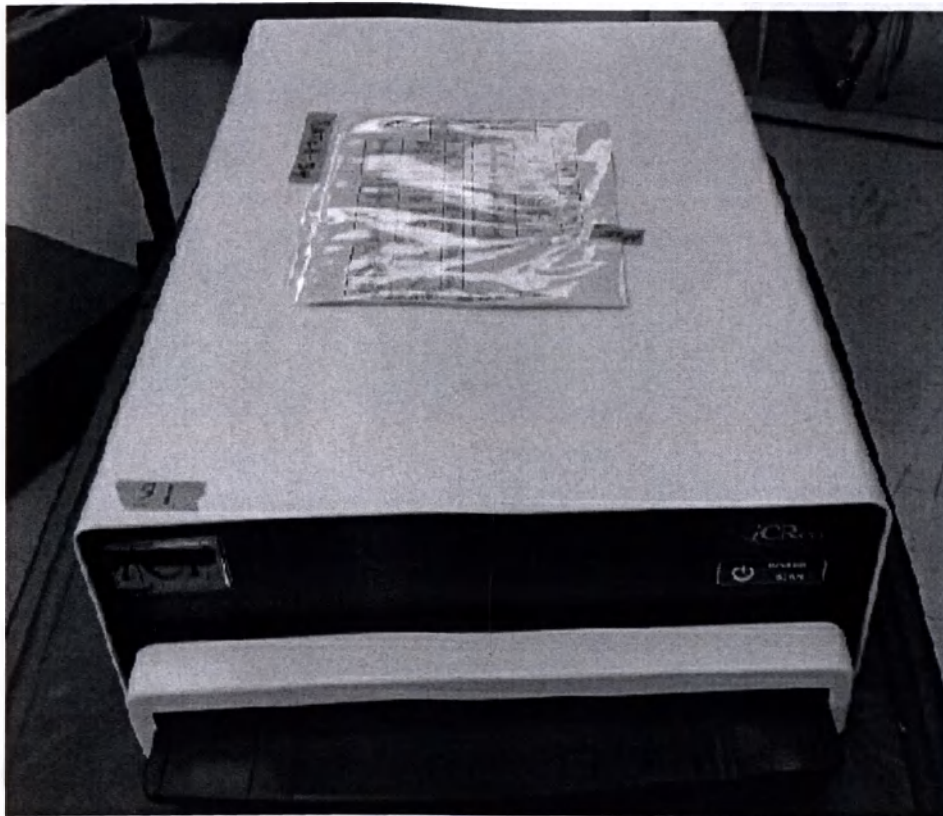

Устройство считывания и оцифровки Chrome
в комплекте с устройством регистрации цифровых
изображений медицинских рентгеновских аппаратов (кассета рентгенографическая с ФСЛ
экраном) размером: 35x43 см (14x17in), 35x35 см (14x14in), 24x30 см (10x12in), 18x24 см (8x10in)
производства iCRco., США

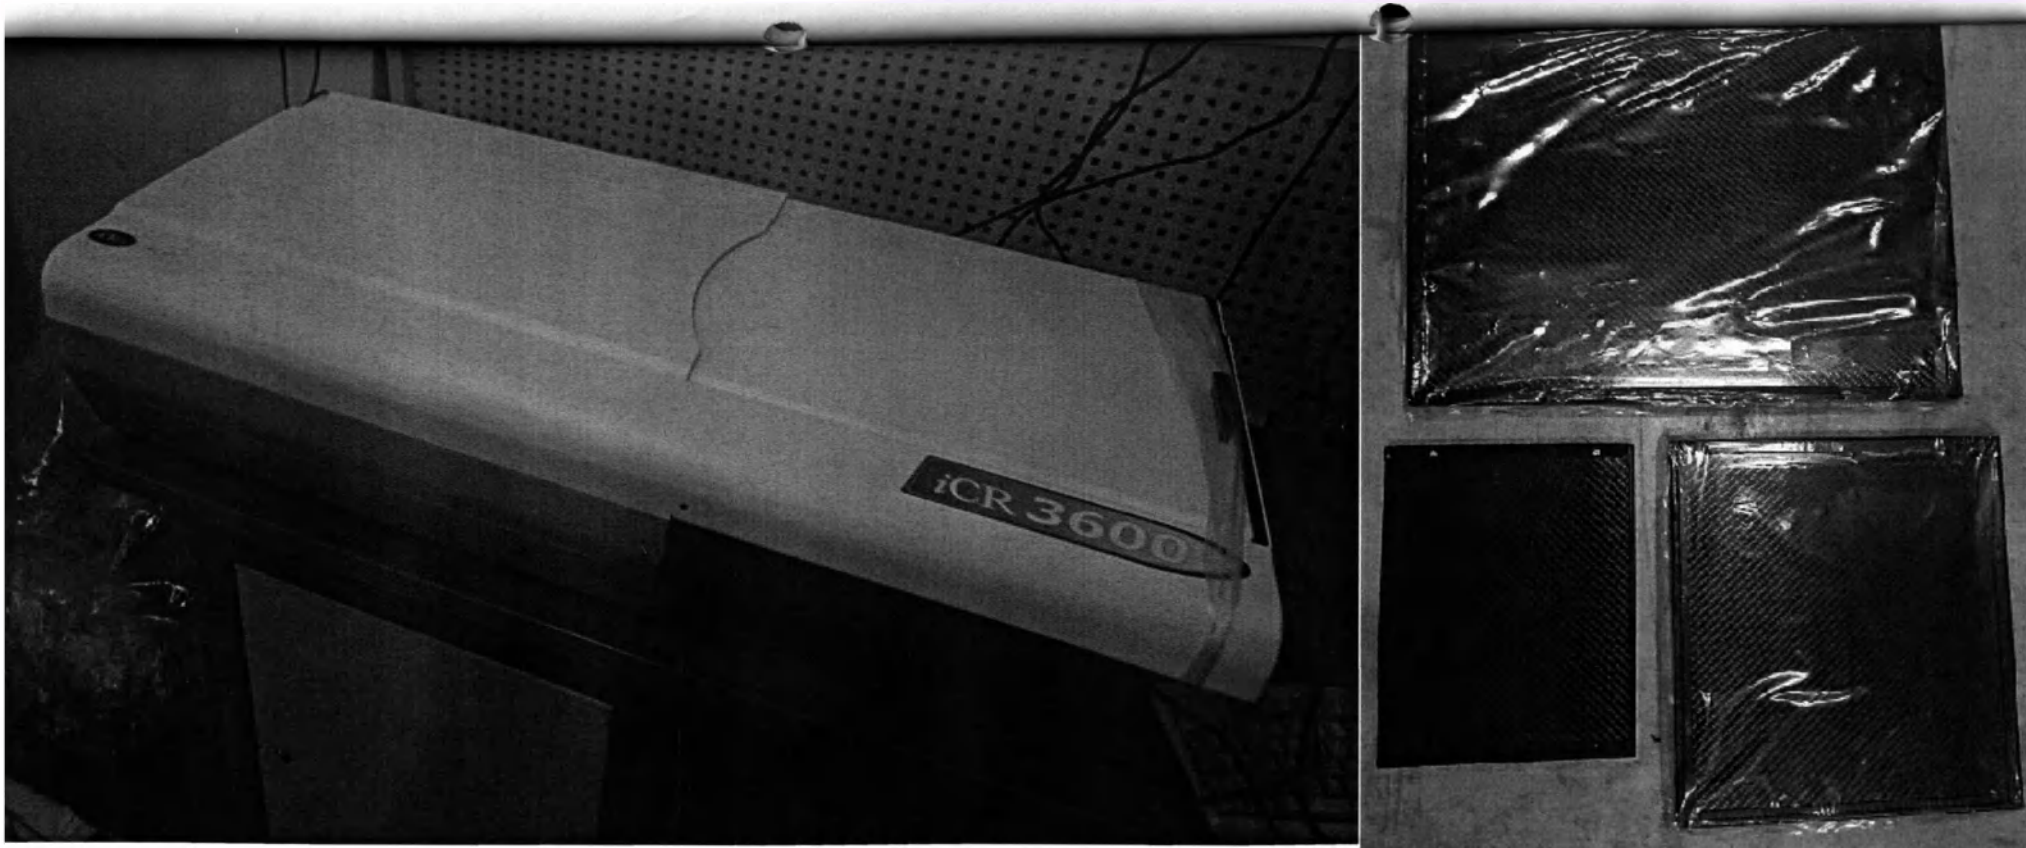

Устройство считывания и оцифровки в комплекте с устройством регистрации цифровых изображений медицинских рентгеновских аппаратов (кассета рентгенографическая с ФСЛ экраном) размером: 35x43 см (14x17in), 35x35 см (14x14in), 24x30 см (10x12in), 18x24 см (8x10in)

производства iCRco., США




Устройство для цифровой радиологии на основе фотостимулируемых
люминофоров, FCR CAPSULA XL2 (CR-IR 359)
производства FUJIFILM Corporation., Япония




Комплекс цифровой CR диагностический
для получения и архивирования
медицинских рентгеновских изображений
CR 30-Xm или CR 10-X
производства Agfa HealthCare N.V., Бельгия
на фото представлен комплекс CR 30-Xm



Система компьютерной рентгенографии CR
CR 12-X или CR 15-X
производства Agfa N.V., Бельгия
на фото представлена Система компьютерной
рентгенографии CR 15-X

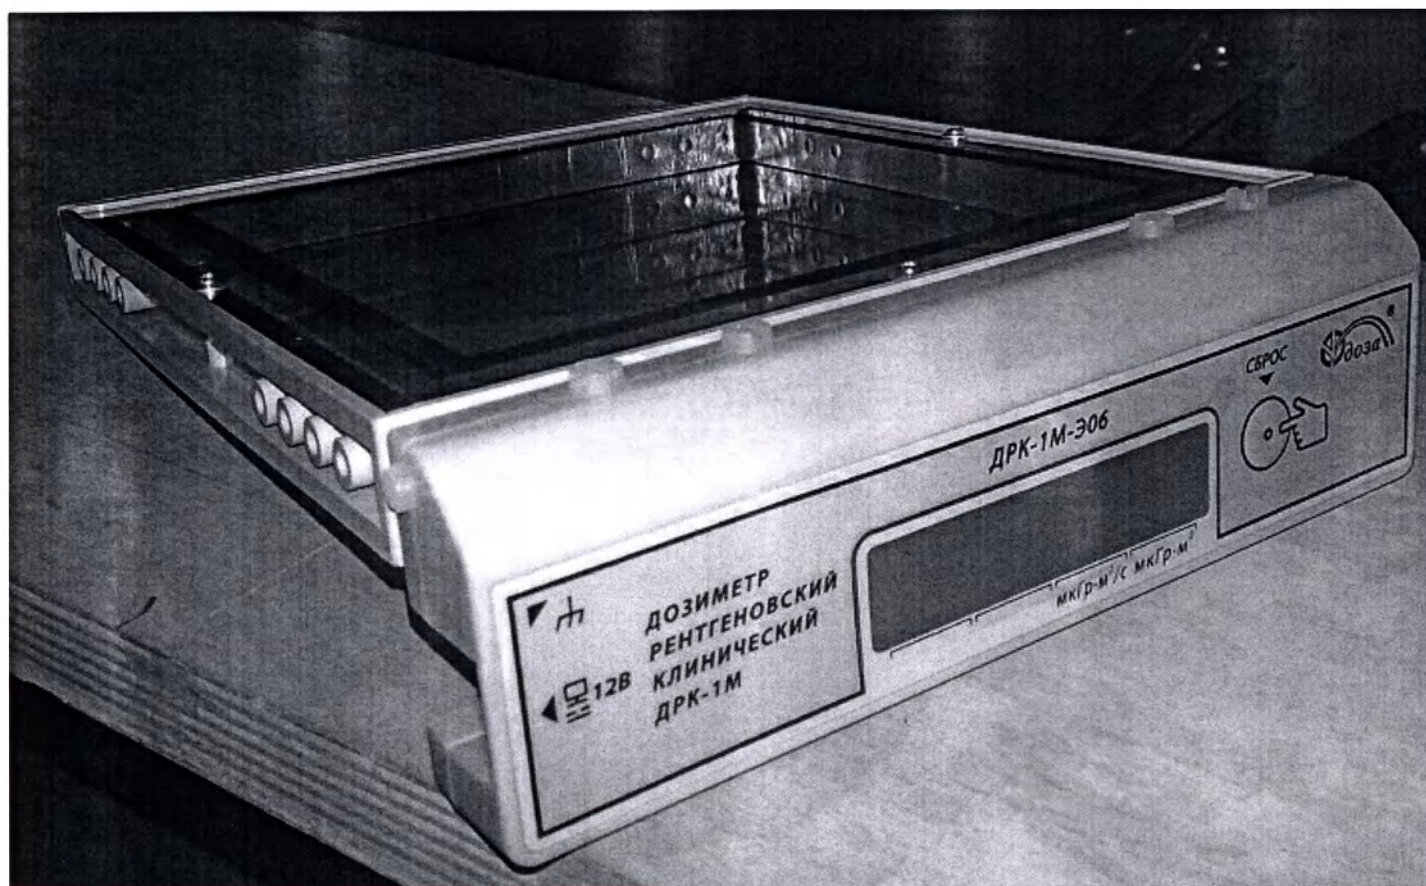

Дозиметр рентгеновского излучения
ДРК-1М
производства НПП «Доза», Россия

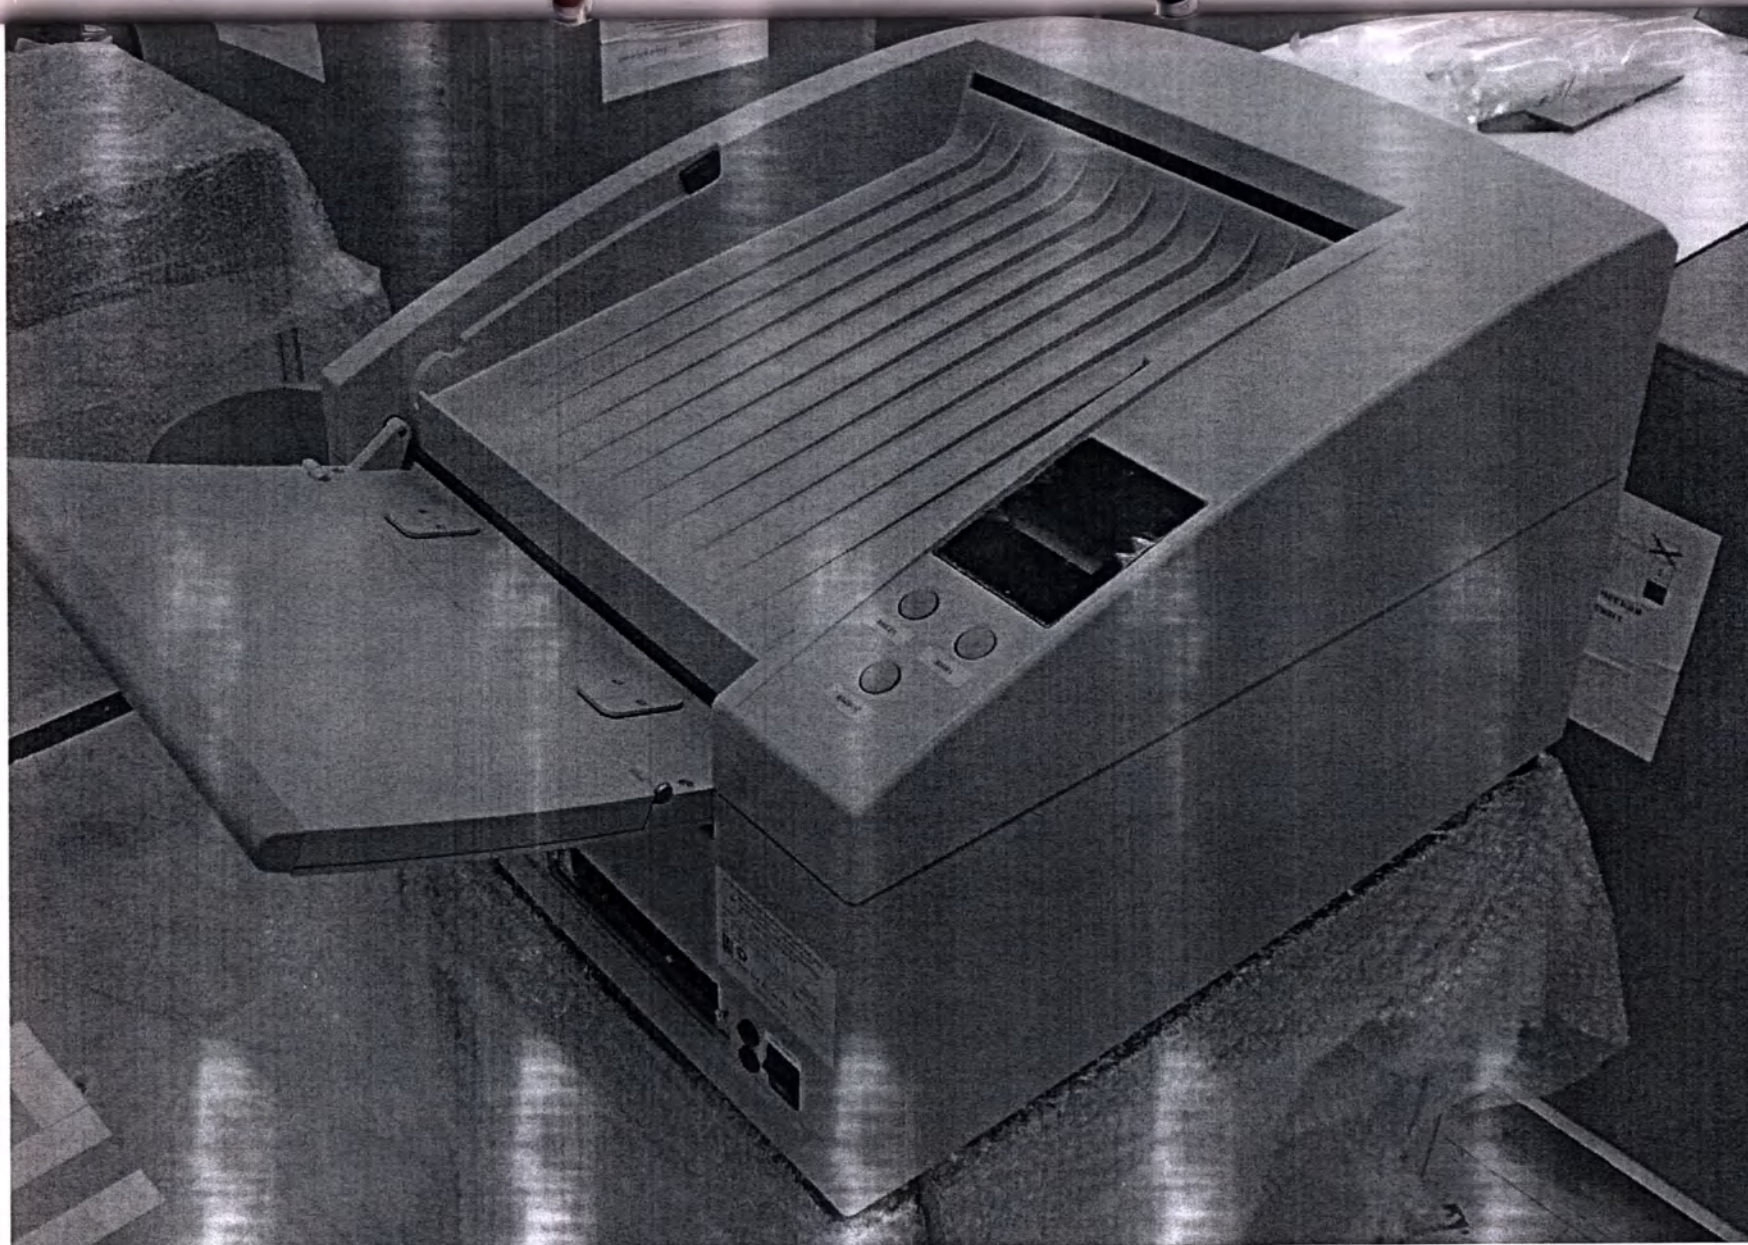

Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «МиниМед-4-МТ»

производитель АО «МТЛ», Россия




Устройство печати цифровых диагностических медицинских изображений «Horizon», производства фирмы Codonics, Inc., США




Камера лазерная мультиформатная DryView 5700 или DryView 5950
производства Carestream Health, Inc., США


на фото представлена камера лазерная мультиформатная DryView 5700

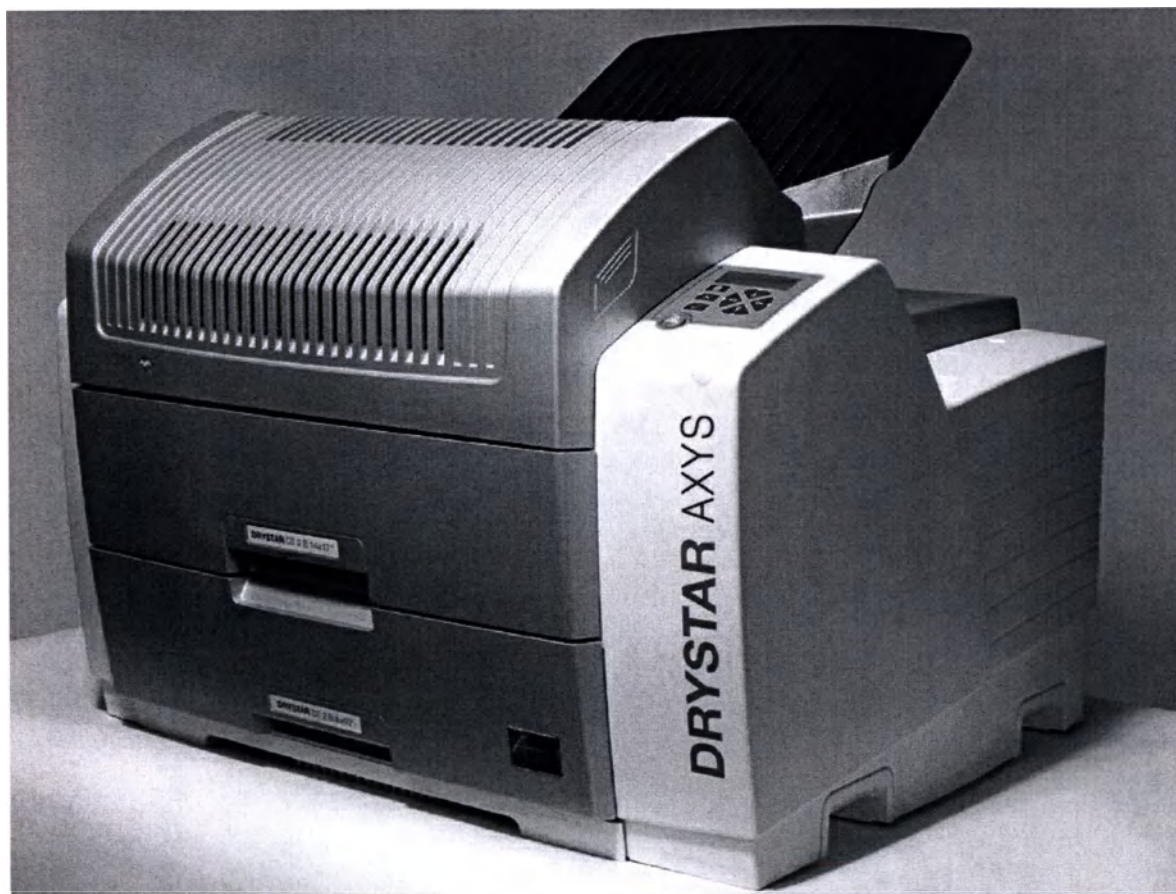

Камера мультиматная термографическая
Drystar AXYS
производства Agfa N.V., Бельгия

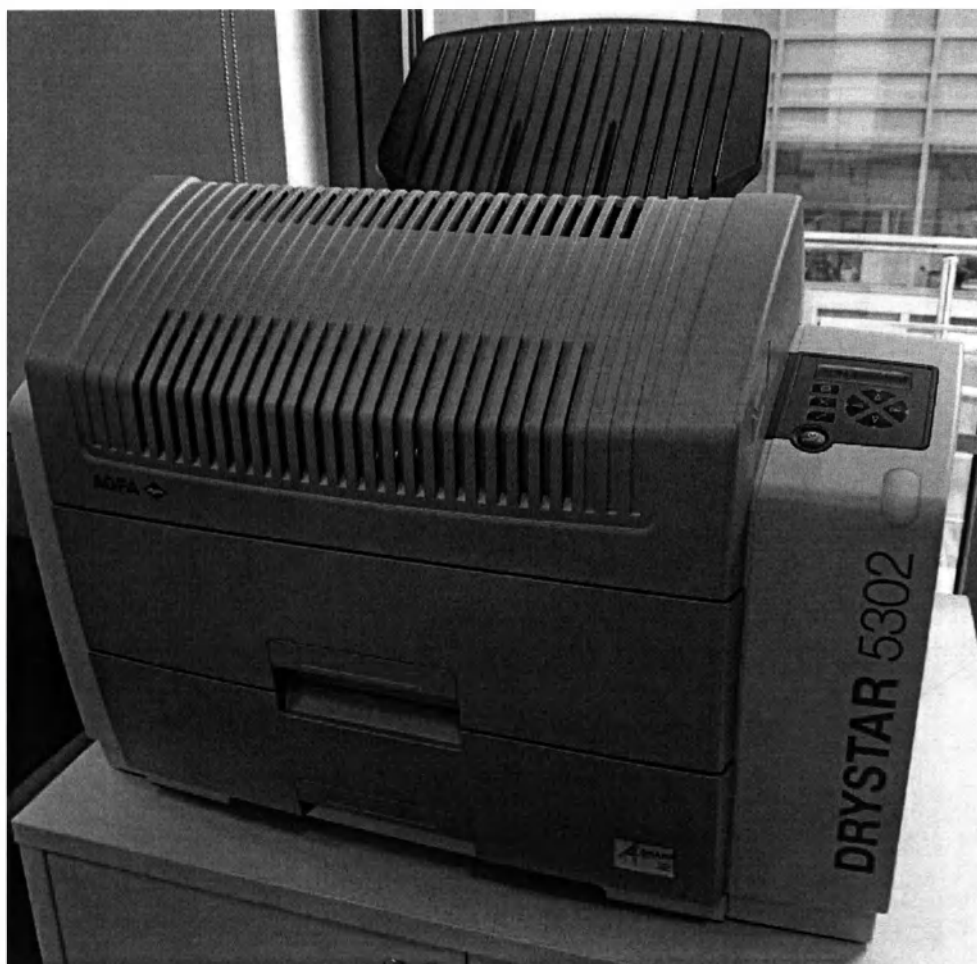


Камера мультиматная термографическая
Drystar 5302
производства Agfa N.V., Бельгия

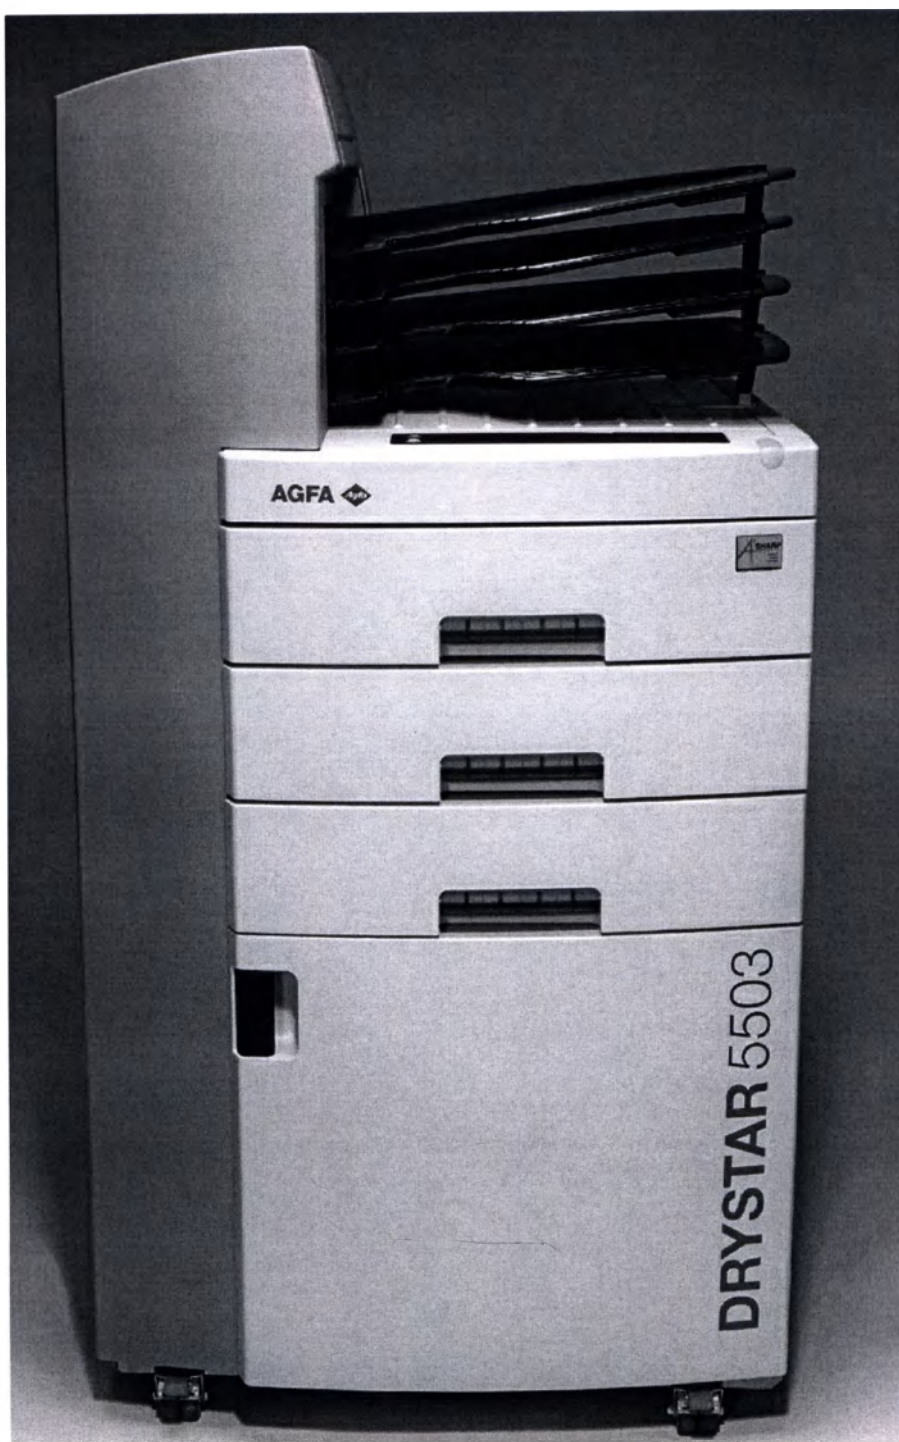


Камера мультиматная термографическая
Drystar 5503
производства Agfa N.V., Бельгия



Камера медицинская термографическая мультиформатная
DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite
производства FUJIFILM Corporation, Япония

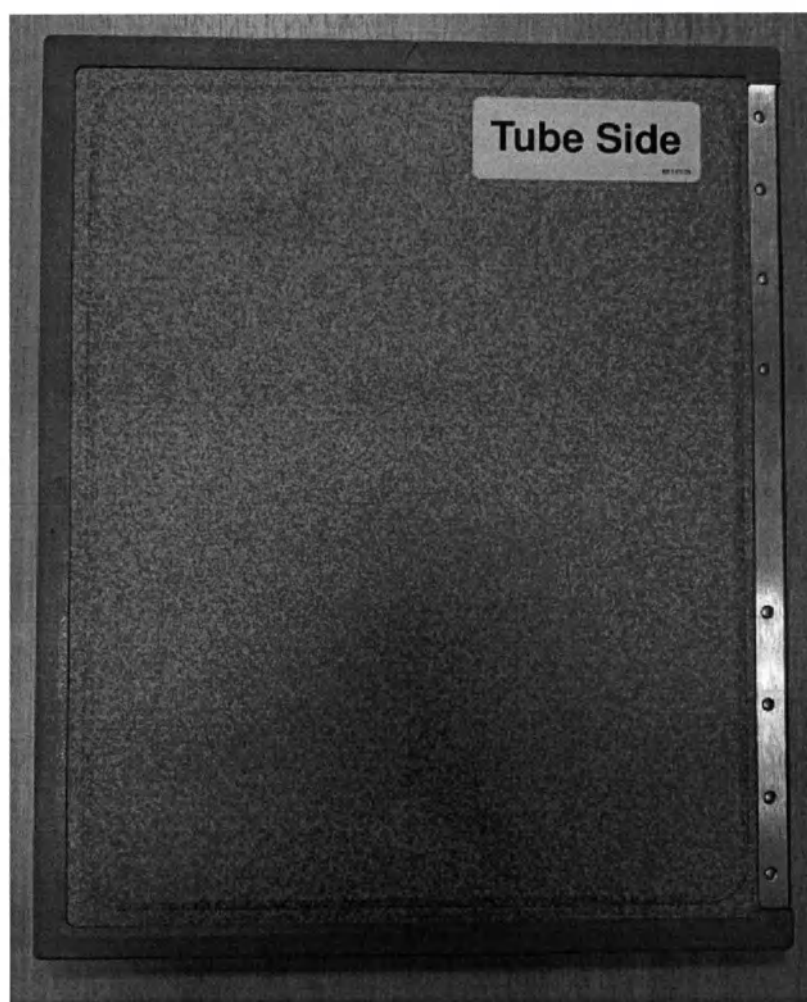

Комплект рентгеновских кассет
производства Carestream Health Inc.,
США

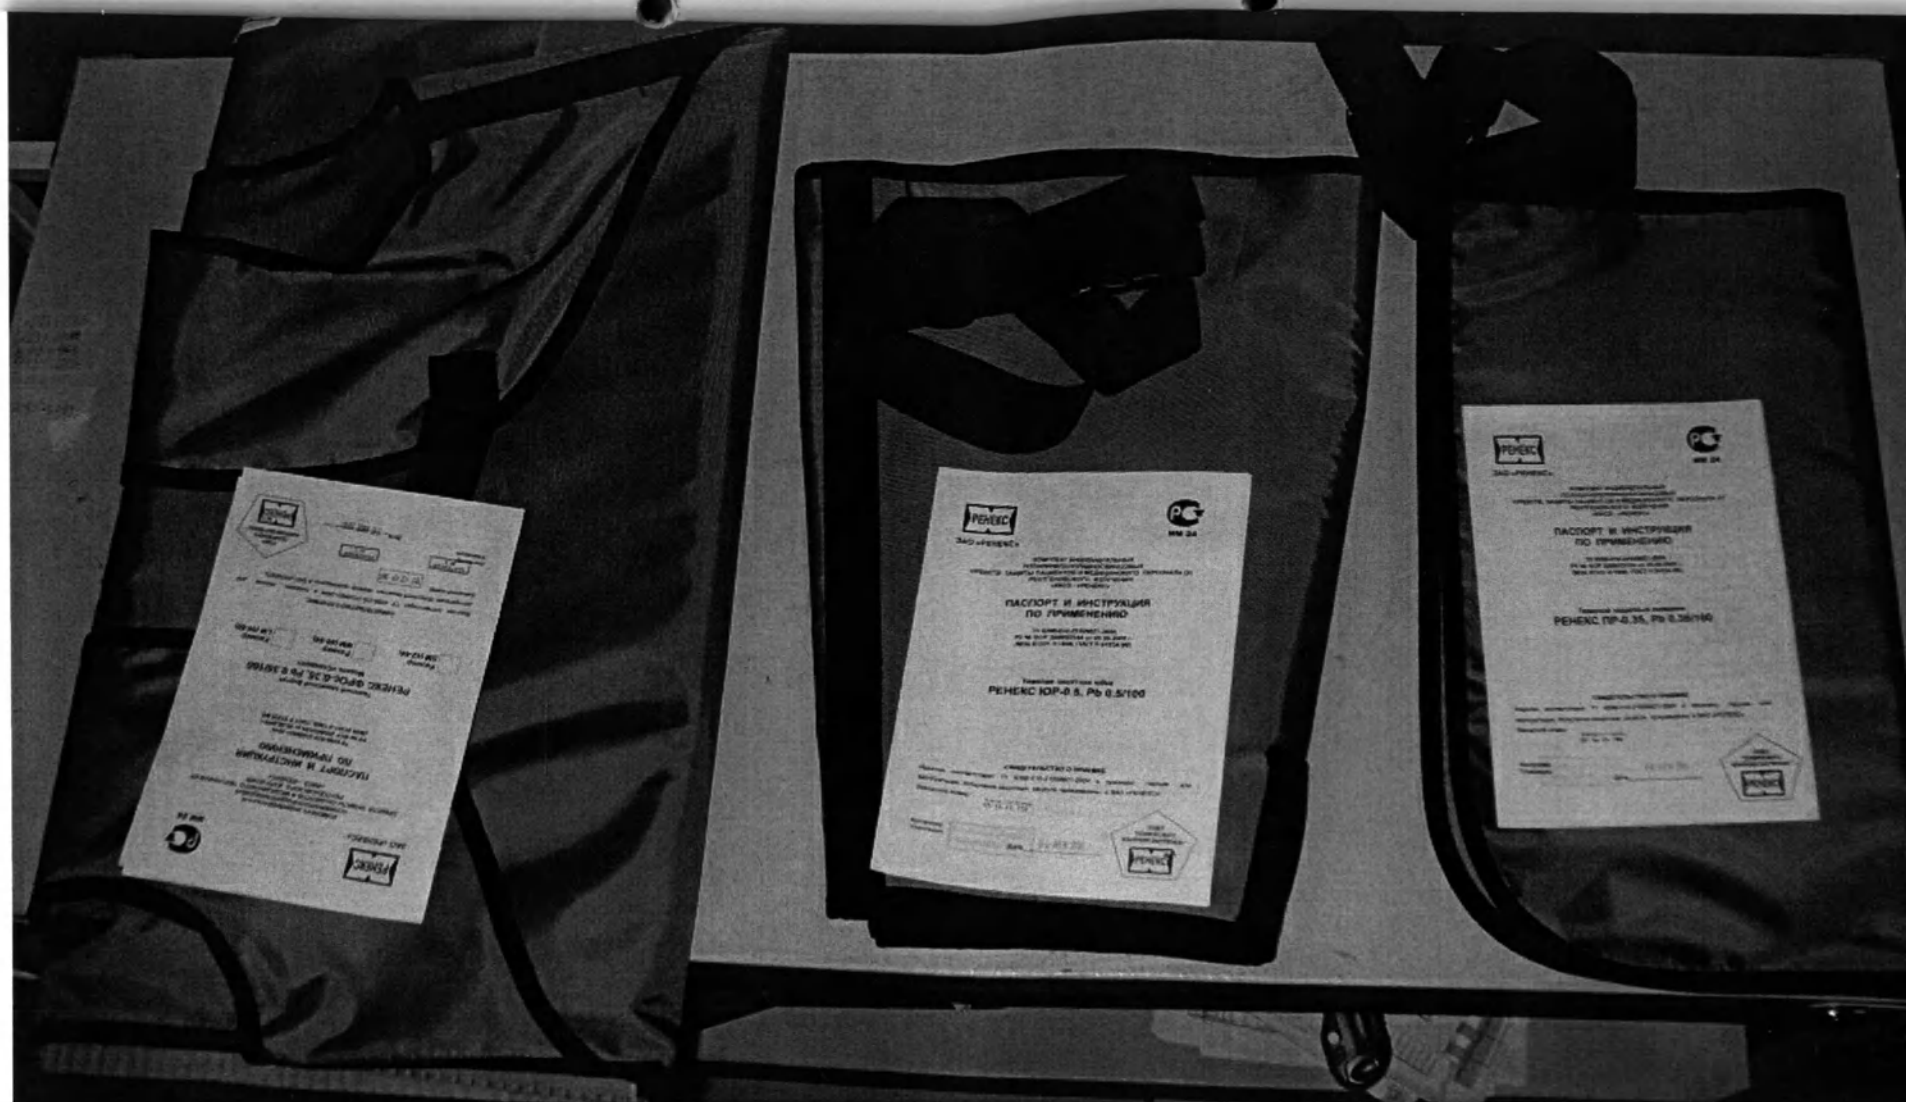


Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты
пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения
КИСЗ-«РЕНЕКС»


производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия



Носители пленочные для термической печати
диагностических медицинских изображений Direct
Vista, производства фирмы Codonics, Inc., США

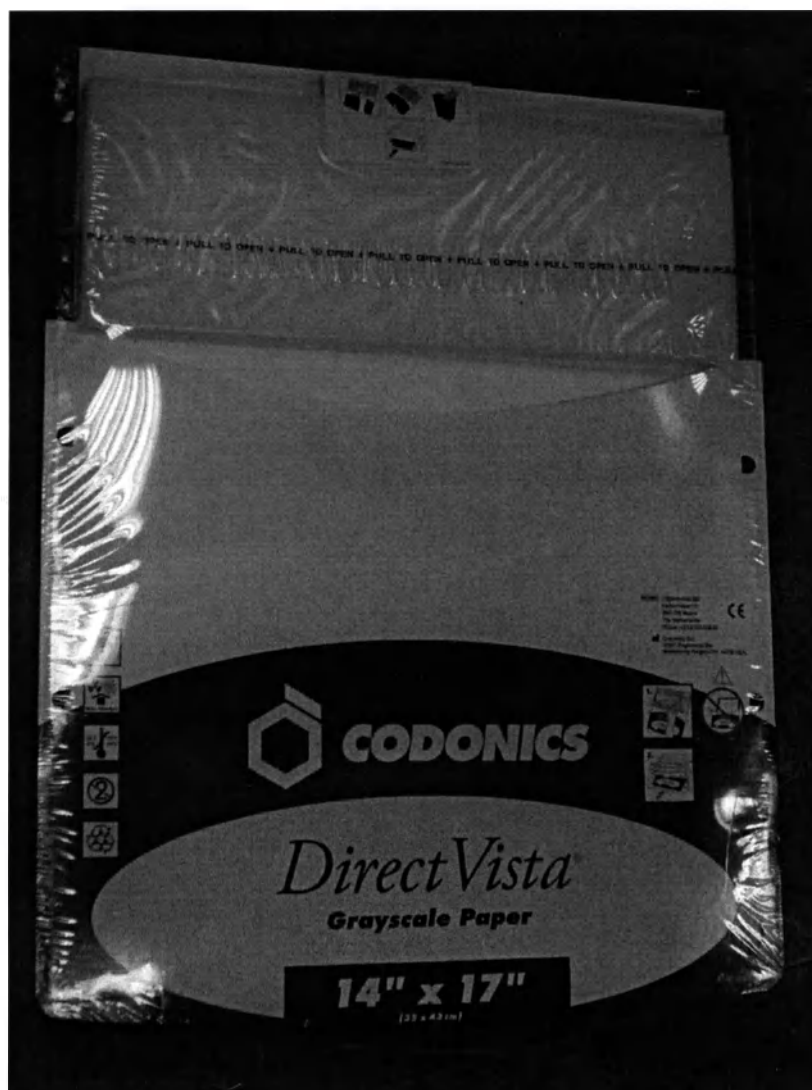

Носители бумажные для термической печати
диагностических медицинских изображений Direct
Vista (100 листов), производства фирмы Codonics, Inc.,
США

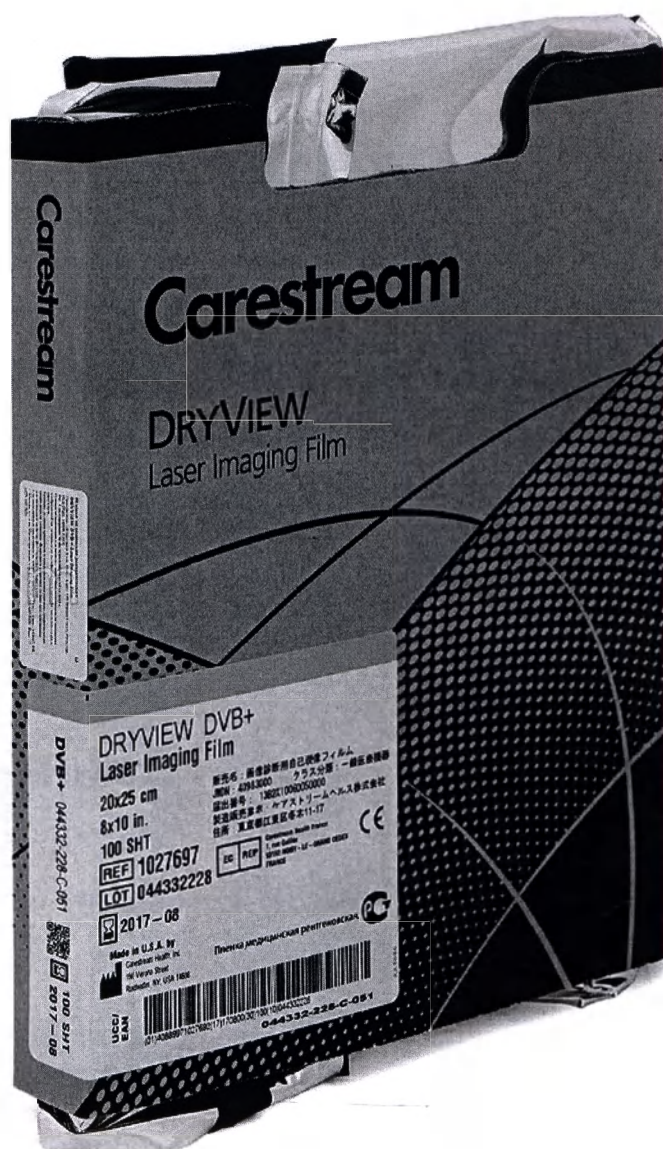

**Плёнка медицинская рентгеновская
 DRYVIEW DVB+ Laser Imaging Film
 производства Carestream Health, Inc., США**



упаковка термографическая медицинская Drystar DT 10 B (упаковка - 100 листов)

варианты исполнений:

формат 8x10 дюймов (20x25 см);

формат 10x12 дюймов (25x30 см);

формат 11x14 дюймов (28x35 см);

формат 14x14 дюймов (35x35 см);


формат 14x17 дюймов (35x43 см);

производитель Agfa N.V. Бельгия


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Пленка медицинская термографическая и лазерная DI-AT, или DI-HT, или DI-HL, или DI-HL2, или DI-AL, или DI-ML производства FUJIFILM Corporation, Япония

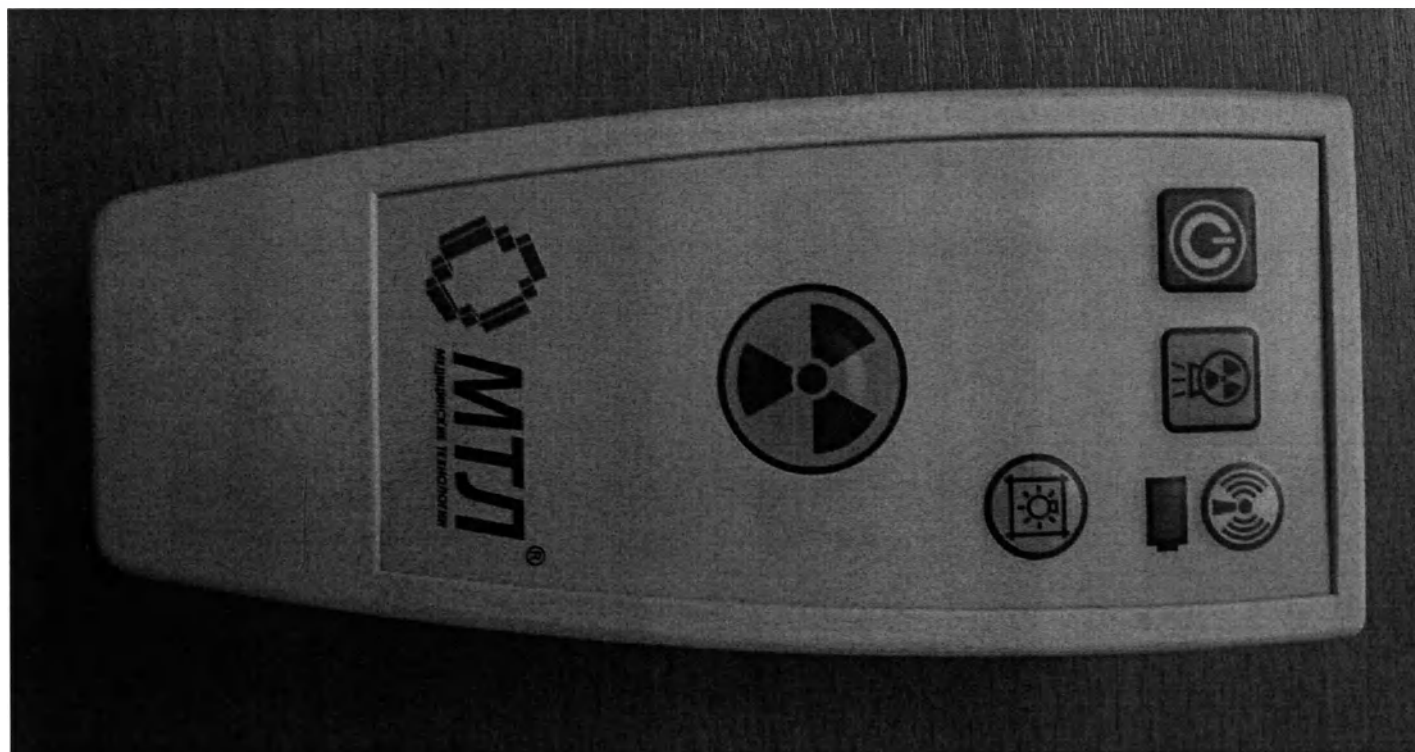


Беспроводная кнопка включения экспозиции
производства АО «МТЛ», Россия

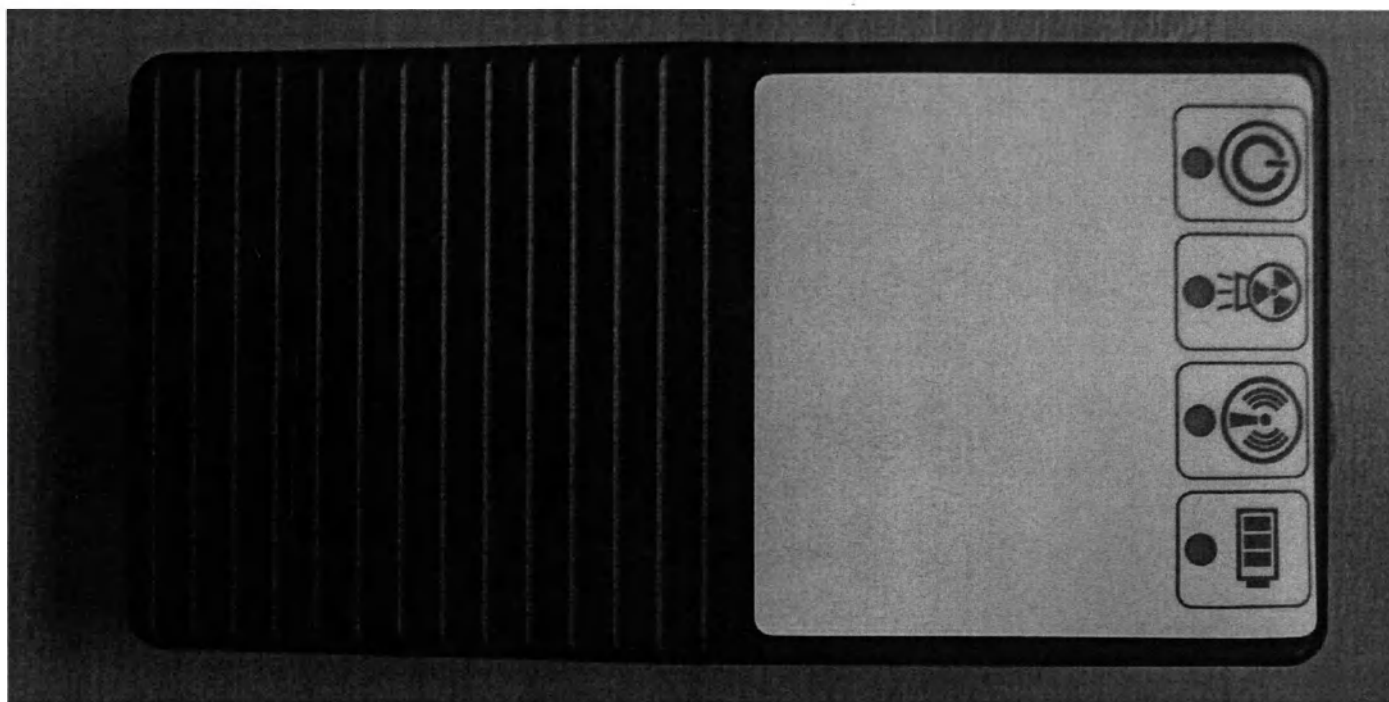

Беспроводная педаль включения экспозиции, производства
АО «МТЛ», Россия

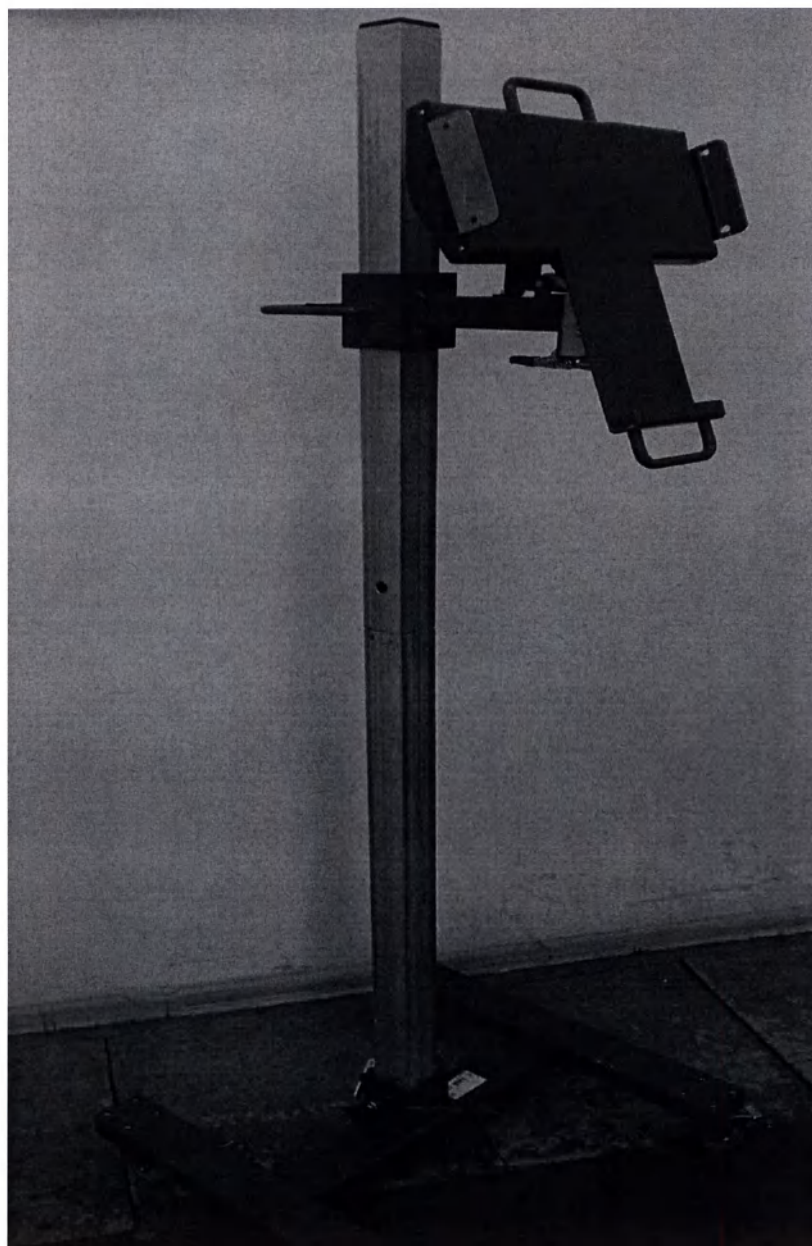


Мобильная стойка снимков
производства АО «МТЛ», Россия

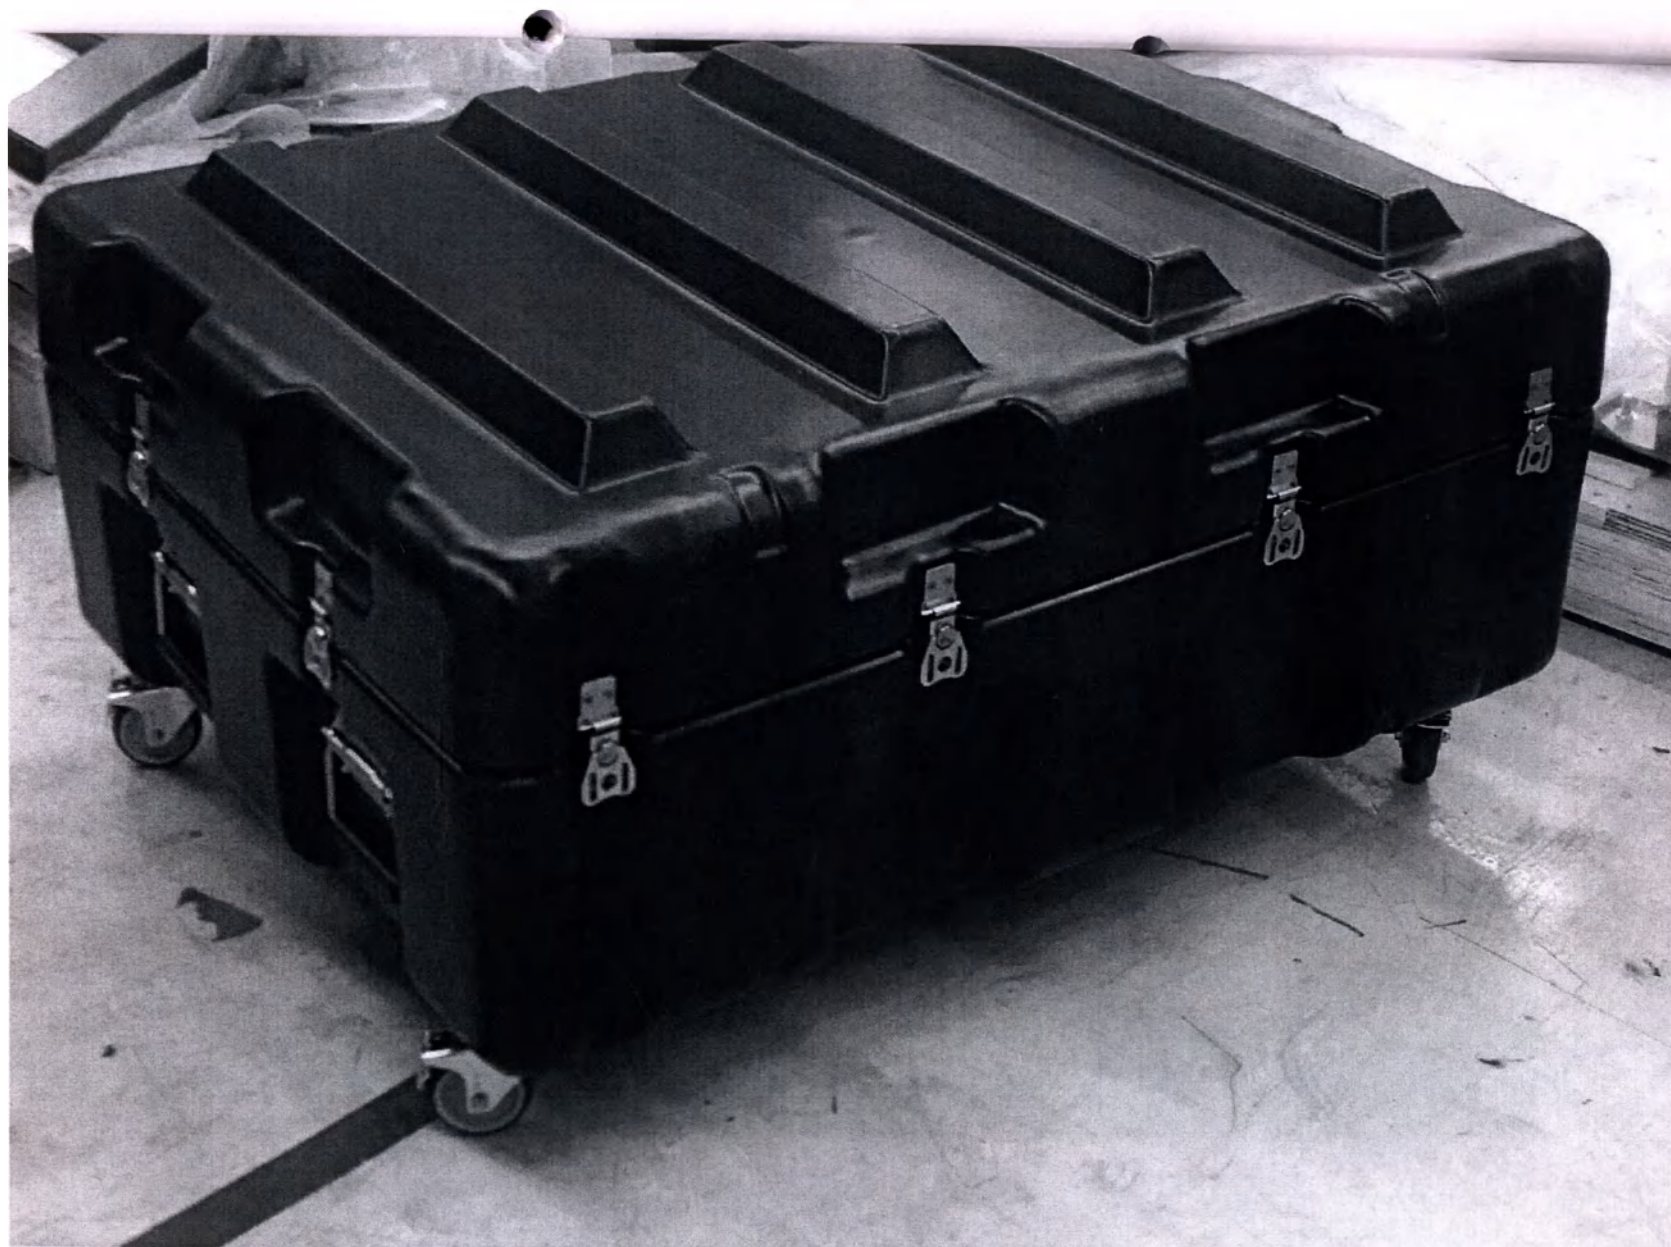

Кейс для мобильной стойки снимков

39 ООО Цирми INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ства АО «МТЛ», Россия

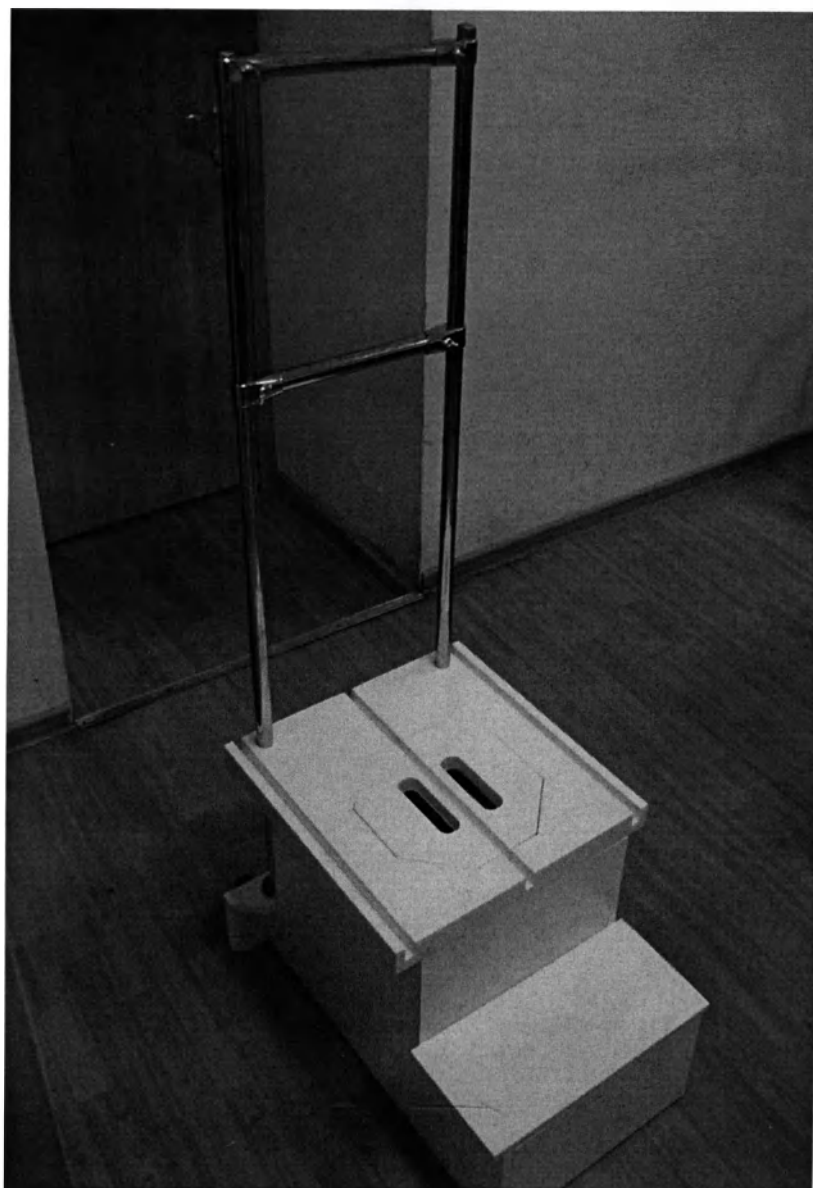

Многофункциональное устройство
фиксации МУФ-МТ
производства АО «МТЛ», Россия





**Макеты маркировки и упаковки
медицинского изделия
Аппарат рентгеновский цифровой палатный
передвижной «МобиРен-4МТ-Д»,
производства
АО «МТЛ», Россия**

Макет маркировки изделия

АО «МТЛ»	
Аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной «МобиРен-4МТ-Д»	
Исполнение	«МобиРен-4МТ-Д»-__
Зав. номер	МРМД-__-__
ТУ	9442-053-47245915-2016
Дата выпуска	
	Потребляемая мощность: ____ ВА Питание: 220 В 50 Гц Класс I 
Сделано в России	

Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения наносится методом стикерования.

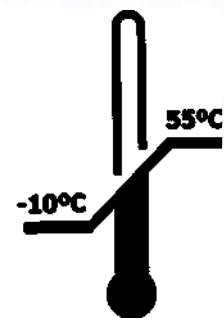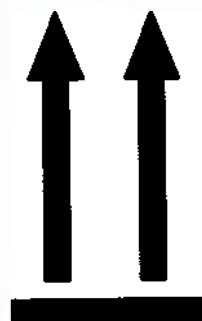


**Аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной
«МобиРен-4МТ-Д»**



Заводской номер:

Год и месяц упаковывания:

Макет транспортной маркировки МобиРен-4МТ-Д исполнений: 1.1.1, 2.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 3.2.1



МТЛ[®]
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

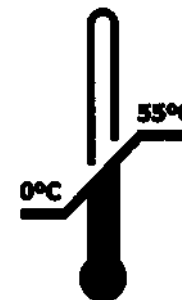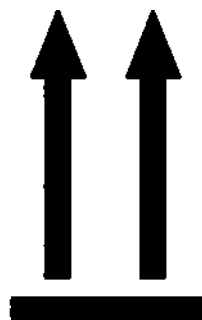

**Аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной
«МобиРен-4МТ-Д»**

Заводской номер:

Год и месяц упаковывания:

Макет транспортной маркировки МобиРен-4МТ-Д исполнений: 1.1.2, 2.1.2, 2.2.2, 3.1.2, 3.2.2

