



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИННОТЕК»


МП «» 2020г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Трикотаж медицинский компрессионный SMARTLEG®

производства компании «Лаборатории ИННОТЕРА»
(Laboratoires INNOTHERA), Франция

2020 г


КОЛГОТКИ КОМПРЕССИОННЫЕ МАТОВЫЕ SMARTLEG®

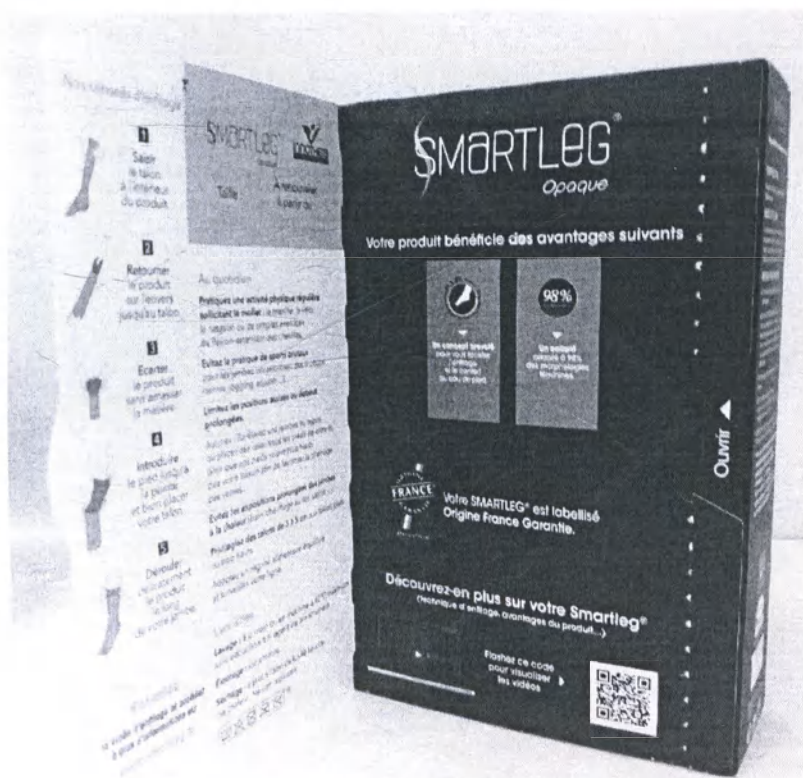

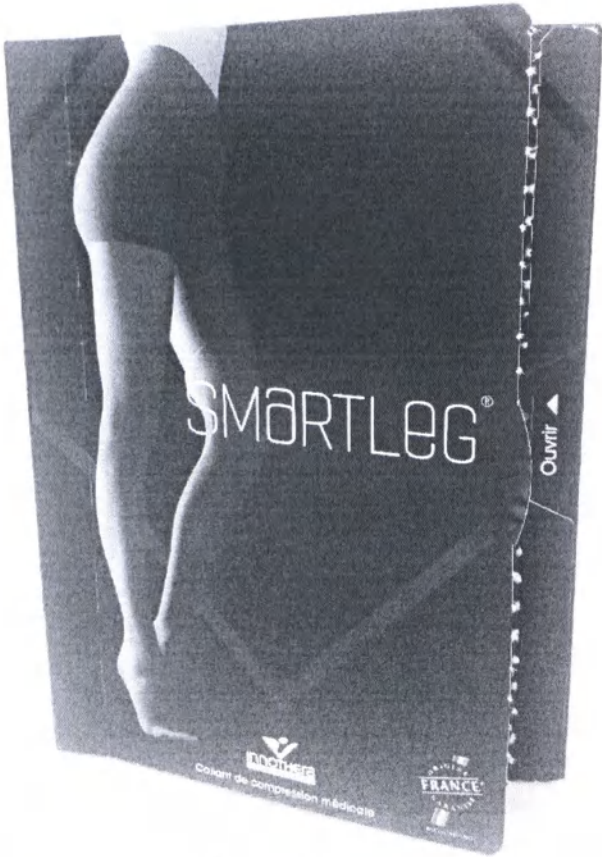




КОЛГОТКИ КОМПРЕССИОННЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ SMARTLEG®



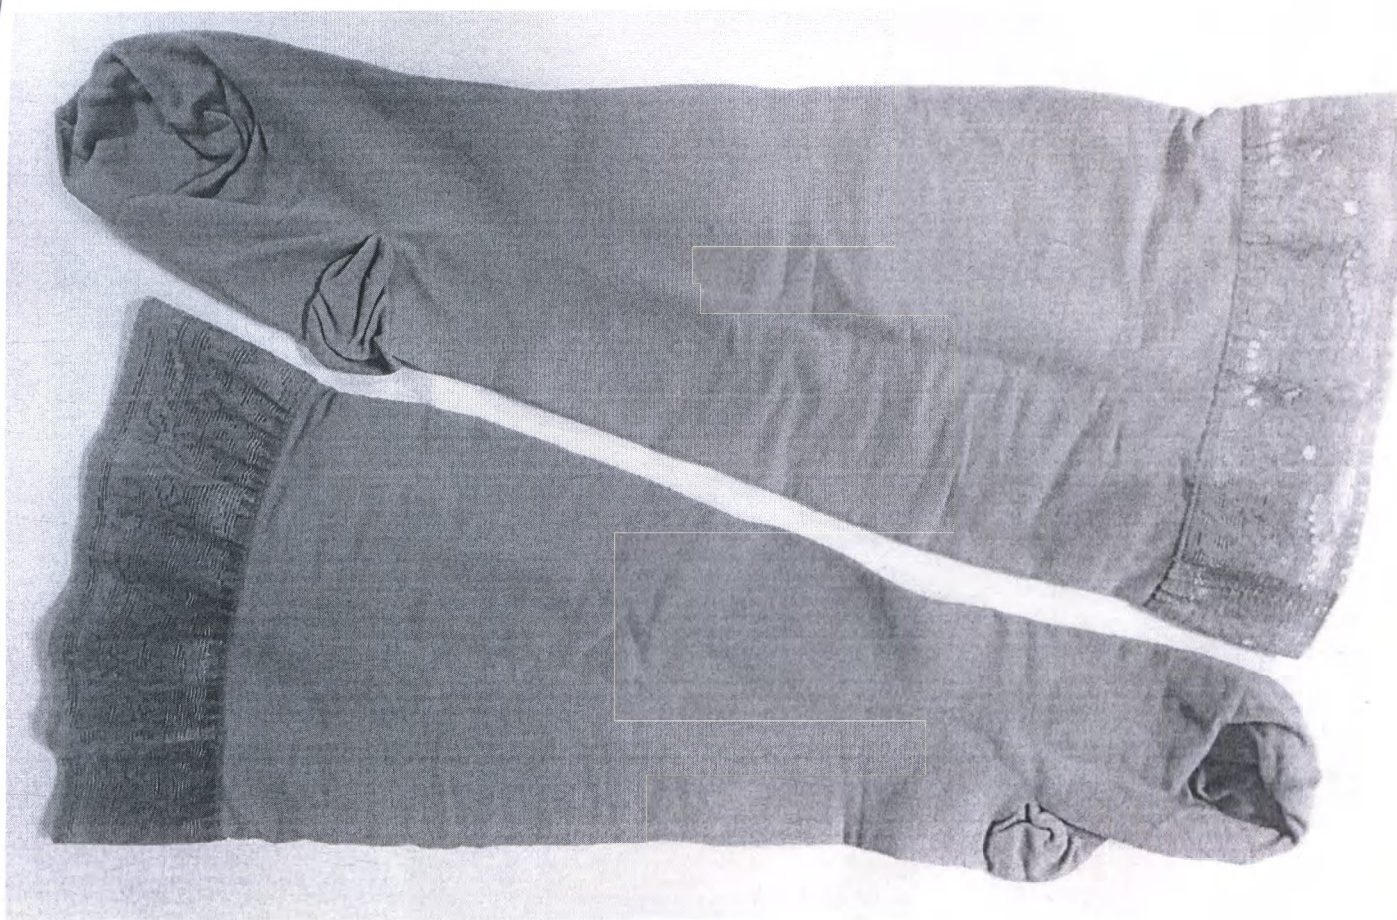


ЧУЛКИ КОМПРЕССИОННЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ SMARTLEG®

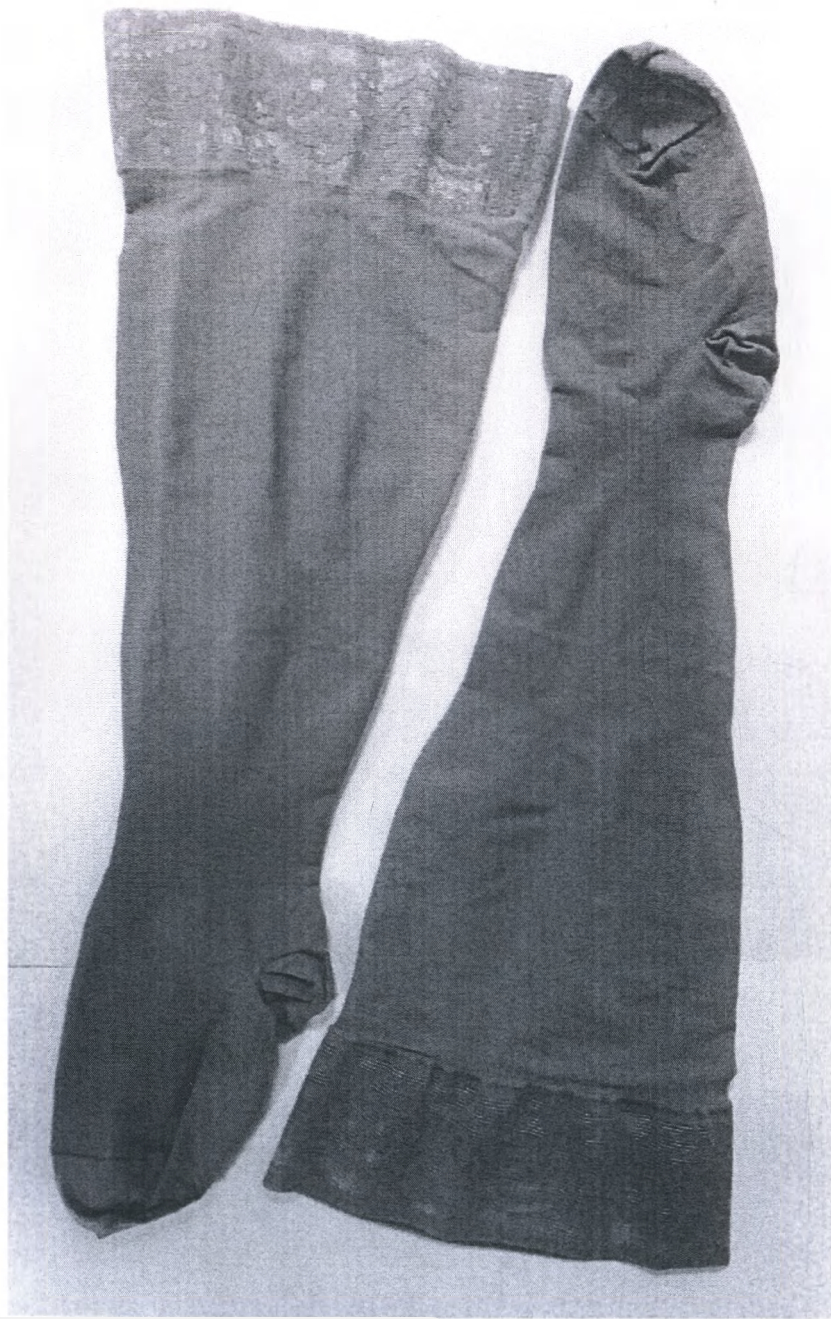

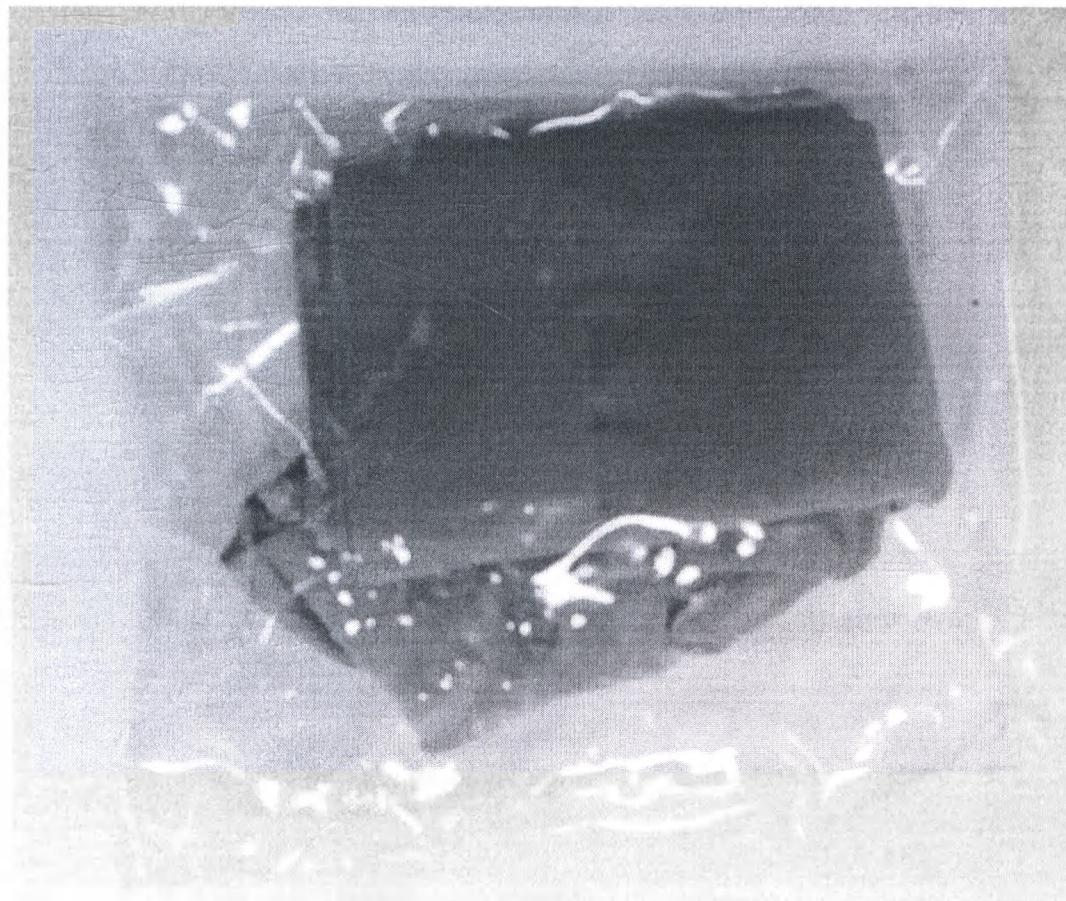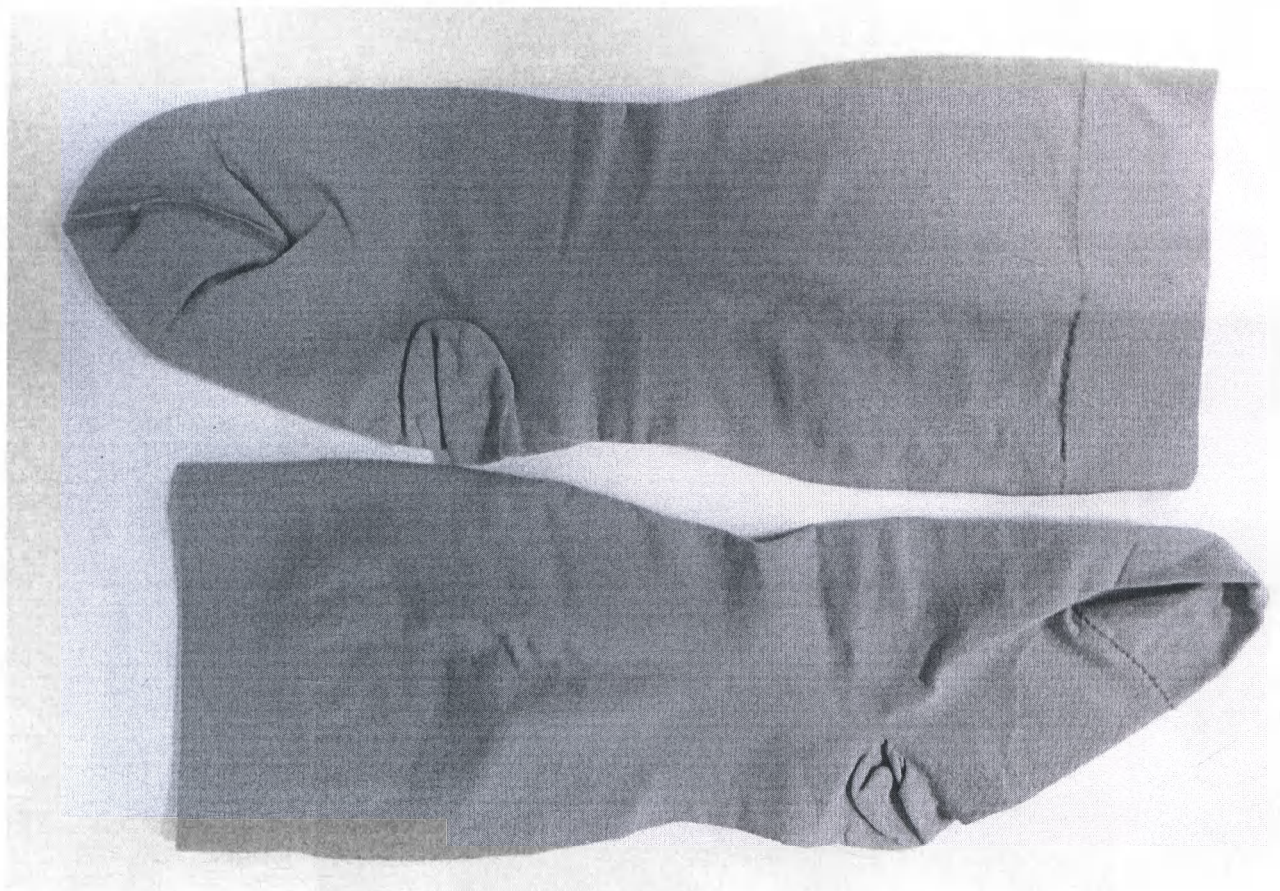



МАКЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ С МАРКИРОВКОЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

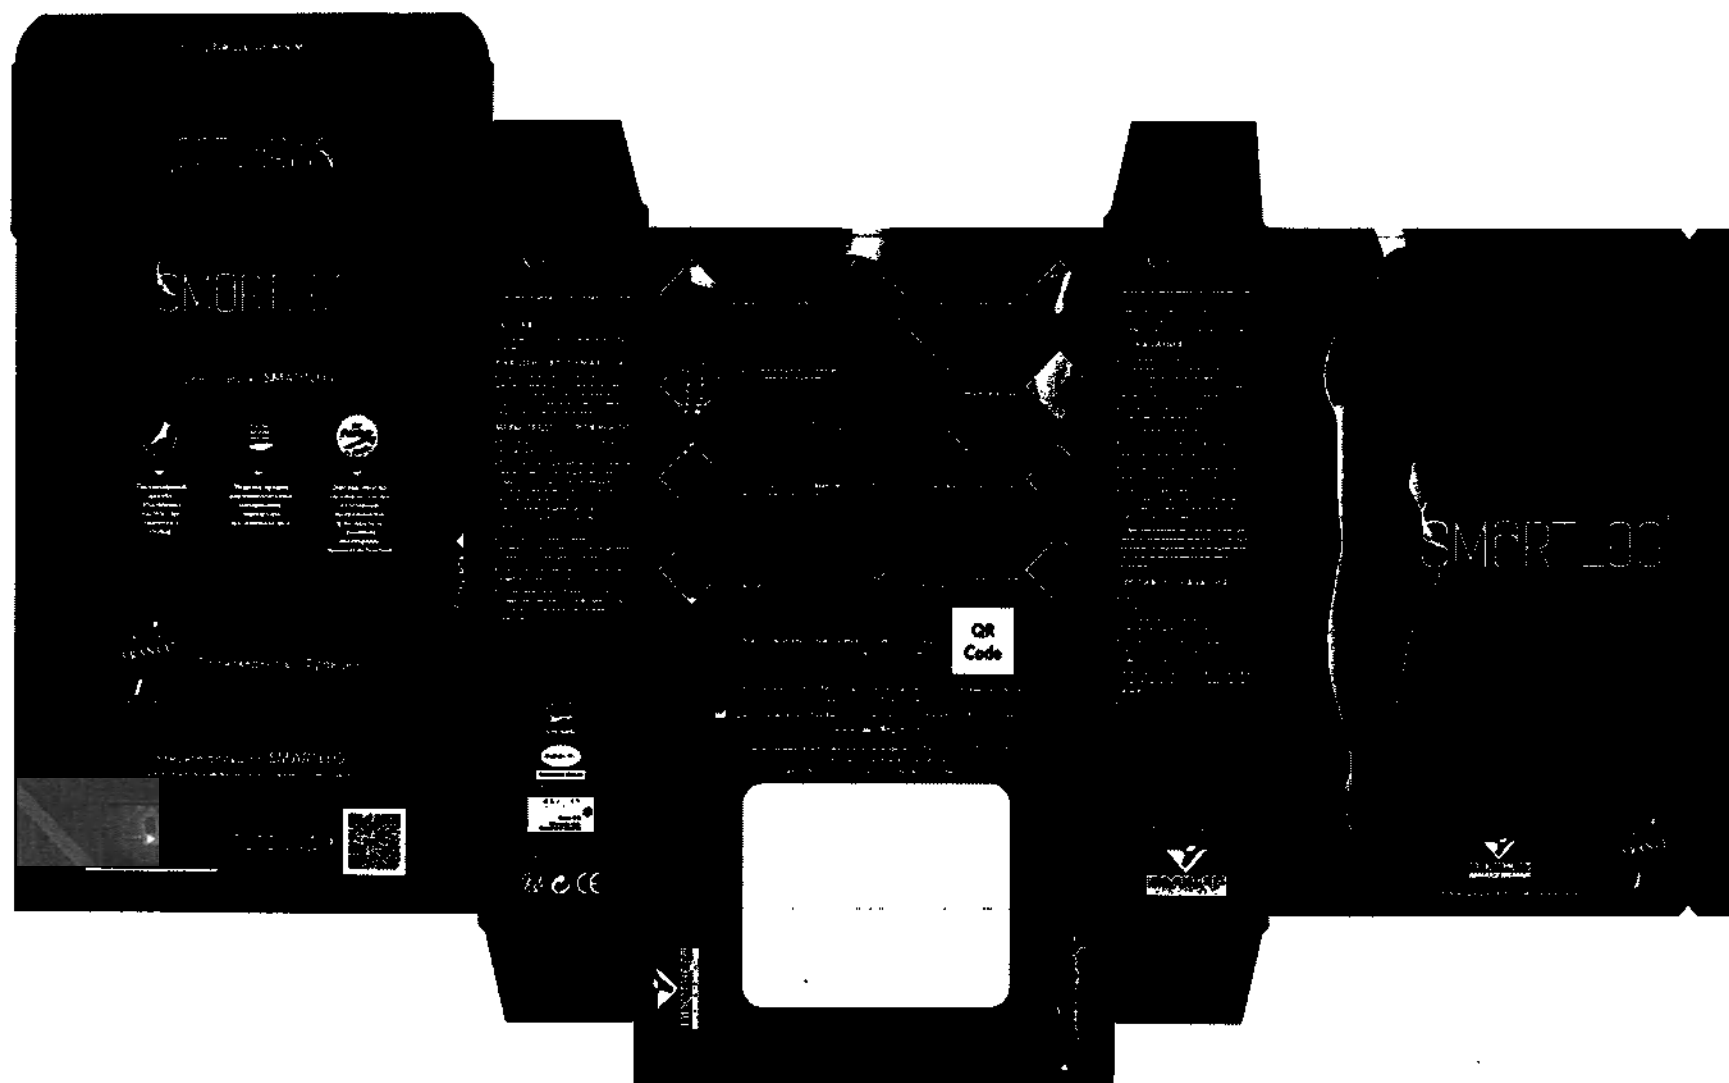

МАКЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ С МАРКИРОВКОЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

www.smartleg.ru

SMARTLEG

SMARTLEG

Преимущества SMARTLEG



Патентованный
двигок,
обеспечивает
удобство при
ходьбе и
комфорт



Изделие прошло
дерматологическое
тестирование,
подходит для
чувствительной кожи



Этот знак качества
гарантирует, что при
использовании
комплексного
прибора вы будете
ощущать
максимальный комфорт



Произведено во Франции

Узнайте больше о SMARTLEG

на сайте www.smartleg.ru или позвонив по телефону 8 800 100 10 10

Смарт-леги - это не просто
технология, это стиль жизни



МАКЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ С МАРКИРОВКОЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

SMARTLEG®

Трикотаж медицинский компрессионный

СОСТАВ

Полиамид, в том числе полиамид микрофибра, эластан.

КАК ДЕЙСТВУЕТ SMARTLEG®

Компрессионный трикотаж оказывает давление, убывающее от лодыжки к верхней части ноги, что способствует увеличению скорости оттока венозной крови, улучшению микроциркуляции и лимфодренажа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ Рекомендуется постирать изделие перед первым применением.
- ◆ При облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей с лодыжечно-плечевым индексом от 0.6 до 0.9, развивающейся периферической нейропатии, мокнущем дерматозе или экземе необходимо регулярное наблюдение врача для постоянной оценки соотношения пользы и риска.
- ◆ Не допускать соприкосновения компрессионного трикотажа непосредственно с раной или поврежденной кожей.
- ◆ При развитии кожных реакций следует снять изделие и обратиться к врачу.
- ◆ При инфекционных заболеваниях кожи следует сначала вылечить инфекцию и только потом использовать компрессионный трикотаж.

VOSGES
terre textile

ASQUAL
COMPRESSION MEDICAL
www.asqual.com

OEKO-TEX®
STANDARD 100
by Hohenstein
www.oeko-tex.com

ПРОИЗВЕДЕНО ВО ФРАНЦИИ



SMARTLEG®

Трикотаж медицинский компрессионный

СОСТАВ

Полиамид, в том числе полиамид микрофибра, эластан.

КАК ДЕЙСТВУЕТ SMARTLEG®

Компрессионный трикотаж оказывает давление, убывающее от лодыжки к верхней части ноги, что способствует увеличению скорости оттока венозной крови, улучшению микроциркуляции и лимфодренажа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ Рекомендуется постирать изделие перед первым применением.
- ◆ При облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей с лодыжечно-плечевым индексом от 0.6 до 0.9, развивающейся периферической нейропатии, мокнущем дерматозе или экземе необходимо регулярное наблюдение врача для постоянной оценки соотношения пользы и риска.
- ◆ Не допускать соприкосновения компрессионного трикотажа непосредственно с раной или поврежденной кожей.
- ◆ При развитии кожных реакций следует снять изделие и обратиться к врачу.
- ◆ При инфекционных заболеваниях кожи следует сначала вылечить инфекцию и только потом использовать компрессионный трикотаж.

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$



innothera
www.innothera.com



SMARTLEG[®]


- ♦ Тяжесть или боль в ноге, усталость, отеки ног после длительного нахождения в положении стоя или сиди (например, во время ректороманоскопии), а также чихлы при отсутствии внешних признаков поражения вен.

- ◆ Сосудистая закладка и иссечение (тепличка/экзостаз) на коже ног
- ◆ Возможное расширение вен.
- ◆ После склеротерапии или хирургического вмешательства на венах ног
- ◆ Во время беременности и 6 недель после родов (6 месяцев в случае массивной свертываемости)
- ◆ Также может применяться для профилактики тромбоза глубоких вен в комплексе с антикоагулянтной терапией либо независимо от неё.

- ◆ Непереносимость материала, аллергия на материал изделия

- ◆ Дерматологические заболевания, сопровождающиеся мокнутиями.
- ◆ Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей с периферическим индексом меньше 0,6
- ◆ Флебит нижних конечностей, сопровождающийся резкой болью, цианозом и отсутствием пульсации артерий.
- ◆ Септический тромбоз.

МАКЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ
С МАРКИРОВКОЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

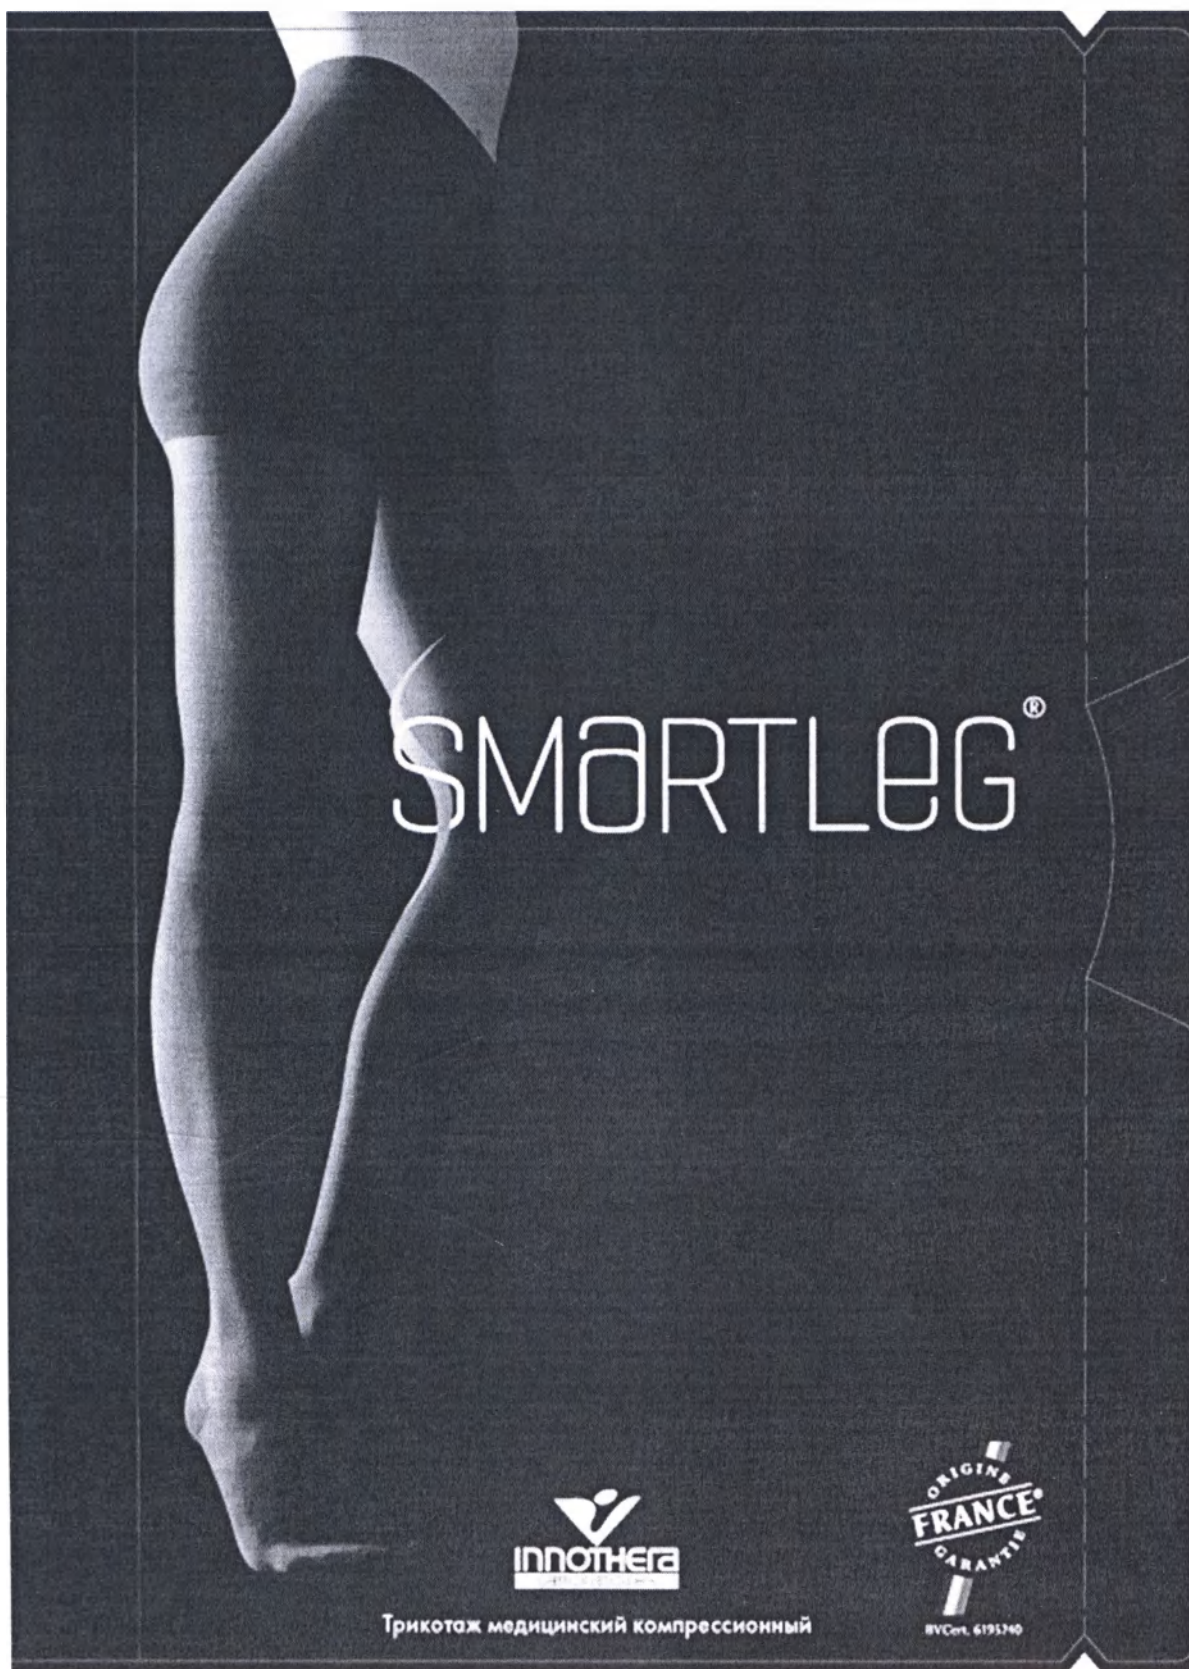

SMARTLEG®



Трикотаж медицинский компрессионный



МАКЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ С МАРКИРОВКОЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

SMARTLEG®



1

Возьмите за пятку
изнутри изделия.

2

Выверните изделие
наизнанку до пятки.

3

Расправьте
изделие, чтобы не
было складок.

4

Осторожно наденьте
изделие на ступню.
Убедитесь, что пятка и
мысок изделия
правильно расположены
на ноге

5

Осторожно
распределите изделие
по вашей ноге.

Кольца, браслеты, часы могут
повредить изделие.
Их рекомендуется снять перед тем, как
надевать, снимать и стирать изделия

Посмотрите
более подробную информацию,
инструкцию по надеванию и видео
на сайте

www.smartleg.fr/ru

Регулярно выполняйте физические упражнения
с нагрузкой на мышцы голени: ходьба, езда
на велосипеде, плавание или простые упражнения
для тренировки мышц голени.

Избегайте видов спорта с большой нагрузкой
на ноги (теннис, бег и др).

Старайтесь долго не оставаться в положении
сидя или стоя.

Для улучшения венозного оттока рекомендуется
лежать так, чтобы ноги находились выше таза.

Избегайте продолжительного перегрева ног
(горячие ванны, пол с подогревом, сауна).

Отдавайте предпочтение обуви с каблуками
высотой 3-5 см вместо высоких каблуков или
обуви без каблуков.

Старайтесь придерживаться сбалансированного
режима питания, следите за весом.

Стирка вручную или в стиральной машине
при 40°C без смягчителей или отбеливателей.

Не выкручивать при отжиме.


Сушка: положить на плоскую, поверхность вдали
от источников тепла. Не гладить.
Химическая чистка запрещена.



МАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВОЧНОЙ ЭТИКЕТКИ

КЛАСС компрессии 1		<i>Чулки компрессионные полупрозрачные SMARTLEG®</i>	
		РАЗМЕР T2+	Radieuse
		NORMAL	
	ДД.ММ.ГГГГ		
LOT	XXXXXX	 3 664540 004750	
REF	XXXXXX		

МАКЕТ ГРУППОВОЙ (ТРАНСПОРТНОЙ) УПАКОВКИ

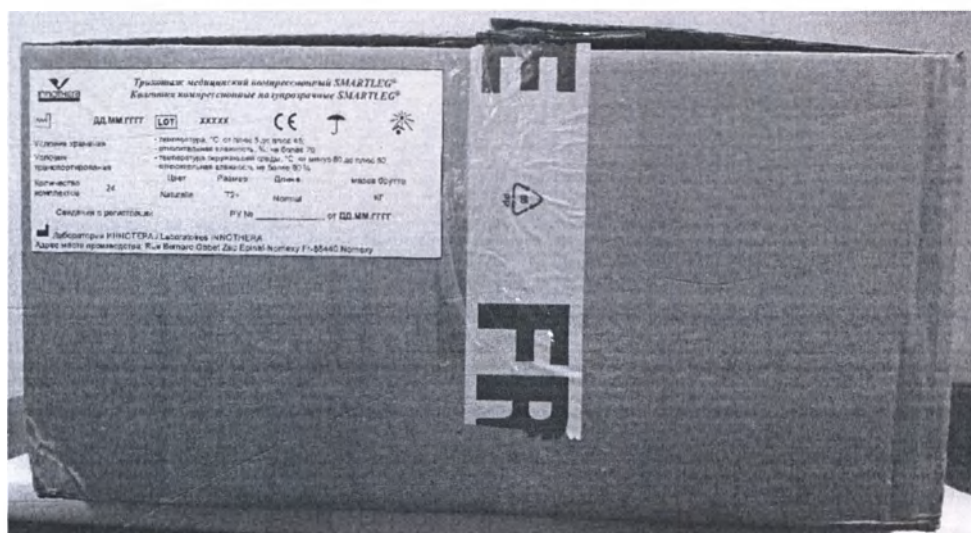

Макет маркировочной этикетки групповой (транспортной упаковки)



Трикотаж медицинский компрессионный SMARTLEG®
Колготки компрессионные полупрозрачные SMARTLEG®



ДД.ММ.ГГГГ

LOT

XXXXX



Условия хранения

- температура, °C: от плюс 5 до плюс 45;
- относительная влажность, %: не более 70

Условия транспортирования

- температура окружающей среды, °C: от минус 50 до плюс 50;
- относительная влажность не более 80 %

Количество
комплектов

24

Цвет
Naturelle

Размер
T2+

Длина
Normal

масса брутто
КГ

Сведения о регистрации

РУ № _____ от ДД.ММ.ГГГГ



Лаборатории ИННОТЕРА / Laboratoires INNOTHERA

Адрес места производства: Rue Bernard Gobet Zac Epinal-Nomexy Fr-88440 Nomexy

печатью: 17 сенсоров лист(а/ов)

Генеральный директор
ООО «ИННОТЕК»

В. Д. Уварс





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИННОТЕК»



/В.Д. Зверев/

«19» февраля 2020г.

Макет потребительской упаковки медицинского изделия

Трикотаж медицинский компрессионный SMARTLEG®

производства компании «Лаборатуар ИННОТЕРА» С.А.С.
(Laboratoires INNOTHERA S.A.S.), Франция

2020 г

www.smartleg.fr

SMARTLEG®

SMARTLEG®

Votre produit bénéficie des avantages suivants

Un confort
bénéfique pour
votre cheville
et le maintien
de votre pied plat

Un bon
maintien de l'arche
du pied, évitant
votre pied
d'adopter une posture
pathologique

Un effet qui protège
votre cheville
des chutes
et des blessures
liées aux
maladies
de la circulation
et des troubles
de la mobilité

Votre SMARTLEG® est labellisé
Origine France Garantie.

Découvrez-en plus sur votre Smartleg®

(technique d'embellie, avantages du produit...)

Flasquez ce code
pour visionner
les vidéos

SMARTLEG®

Dispositif de compression médicale

COMPOSITION :

Polyamide double fil, polyamide non tressé,
élasthanne.

MODE D'ACTION :

La compression verticale exercée assure
une pression descendante de la cheville
vers le haut de la jambe, elle permet
d'augmenter le retour veineux vers le cœur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

• Éviter le produit sur la peau
irritée.

• Si le cas d'usage avec PES + 50 et + 55,
de compression orthopédique destinée au
déclassement constant ou intermittent,
de compression médicale (type support
de maintien) doit être utilisé.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• En cas de réaction cutanée,
arrêter le produit et consulter un médecin.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

• Ne pas appliquer directement sur peau
froide.

Taille et PRISE DE MESURES (en cm) :

Tour de cheville • Tour de cuisse • Tour de hanche • hauteur (H)

Tour de taille hauteur (H)	88,5	91	93	100	102	104	106	108	110
Tour de hanche	80-120	79-119	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
Tour de cuisse	43-57	40-54	54-66	45-59	59-71	57-65	65-77	60-74	
Tour de cheville	16-19	17-22	22-25				25-28	28-31	

H = Hauteur Coûtant. Coûtant en cm 6-67 / Hauteur de 67 / 5-77 / Longueur 5-77

(Tour de taille au niveau du nombril)
 Tour de hanche au plus large du bassin
 Tour de cuisse 5 cm sous le pli fessier
 Tour de cheville sur la partie la plus fine

Labellisé Origine France Garantie
 22 avenue Aristide Briand - 94130 Arcueil - France
 Tél. : 01 46 15 18 00 - Fax : 01 46 15 28 32 - www.smartleg.fr

H

Sol

Entrebanc

Tour de taille

Tour de hanche

Tour de cuisse

Tour de cheville

Tour de taille

Tour de hanche

Tour de cuisse

Tour de cheville

Tour de taille

Tour de hanche

Tour de cuisse

Tour de cheville

Tour de taille

Tour de hanche

Tour de cuisse

Tour de cheville

Tour de taille

Tour de hanche

Tour de cuisse

Tour de che

www.smartleg.fr

SMARTLEG®

SMARTLEG®

Votre produit bénéficie des avantages suivants

 Un concept breveté pour vous soulager l'entaille et le confort du cou de pied.	 Tout développement en 3D vous indique comment vos pieds sont sensibles.	 Un logo qui garantit que votre produit bénéficie de l'expertise des dernières technologies et innovations brevetées.
---	--	---



Votre SMARTLEG® est labellisé
Origine France Garantie.


Découvrez-en plus sur votre Smartleg®
(technique d'entaille, avantages du produit...)



Floutez ce code
pour visualiser
les vidéos



Ouvrir



Dispositif de compression médicale

COMPOSITION :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne.

MODE D'ACTION :

La compression veineuse élastique exerce une pression décroissante de la cheville vers le haut de la jambe, elle permet d'améliorer le retour veineux vers le cœur.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Lever le produit avant la première utilisation.
- En cas d'AOMI avec IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfices/risques doit être effectuée.
- Ne pas appliquer directement sur peau lésée.
- En cas de réaction cutanée, retirez le produit et parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
- Infections cutanées : d'abord soigner l'infection avant de porter la compression.
- En cas de changement ou évolution morphologique (grossesse, prise/perte de poids, résorption d'œdème, ...), consultez votre médecin, pharmacien ou orthopédiste pour réajuster la taille ou le format de votre produit.



FABRIQUÉ EN FRANCE
REMBOURSÉ SÉCURITÉ SOCIALE




Dispositif de compression médicale

COMPOSITION :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne.

MODE D'ACTION :

La compression veineuse élastique exerce une pression décroissante de la cheville vers le haut de la jambe, elle permet d'améliorer le retour veineux vers le cœur.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- ♦ Laver le produit avant la première utilisation.
- ♦ En cas d'AOMI avec IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfices/risques doit être effectuée.
- ♦ Ne pas appliquer directement sur peau lésée.
- ♦ En cas de réaction cutanée, retirez le produit et parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
- ♦ Infections cutanées : d'abord soigner l'infection avant de porter la compression.
- * En cas de changement ou évolution morphologique (grossesse, prise/perte de poids, résorption d'œdème, ...), consultez votre médecin, pharmacien ou orthopédiste pour réajuster la taille ou le format de votre produit.

SMARTLEG®


Taillage et PRISE DE MESURES (en cm) :

Tour de cheville + Tour de cuisse + Tour de hanche + hauteur (H)

Tour de taille maximum conseillé	88,5	96	95	106	120	129		
TAILLES	T1+		T2+		T3+			
Tour de hanche	80-120	70-110	90-130	80-120	95-135	90-130	115-155	110-150
Tour de cuisse	43-57	40-54	54-66	45-59	59-71	51-65	65-77	60-74
Tour de cheville	16-19	19-22	22-25		25-28		28-31	


H Hauteur Collant Court Int. ou Égal à 69 / Normal de 69,1 à 77 / Long Sup. à 77

(Tour de taille au niveau du nombril)
 Tour de hanche au plus large du bassin
 Tour de cuisse 5 cm sous le pli fessier
 Tour de cheville sur la partie la plus fine

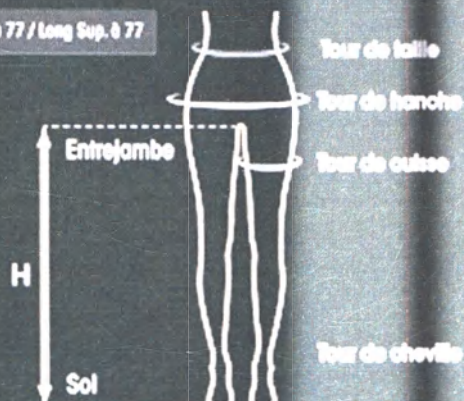

Laboratoires Innothéra 22 avenue Aristide Briand - 94110 Arcueil - France
 Tél. : 01 46 15 18 00 - Fax : 01 46 15 28 32 - www.smartleg.fr





Dispositif de compression médicale

INDICATIONS :

Classe II, 15,1 à 20 mmHg :

- ♦ Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée.
- ♦ Varicosités, varices.
- ♦ Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- ♦ Prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.
- ♦ Grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois si césarienne).
* Voir précautions d'emploi.
- ♦ En superposition selon l'avis de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

- ♦ Intolérance/Réaction/Allergie au produit.
- ♦ Affections dermatologiques suintantes de la jambe.
- ♦ Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- ♦ Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- ♦ Thrombose septique.



N1086-09-18



Dispositif de compression médicale

INDICATIONS :

Classe II, 15,1 à 20 mmHg :

- ♦ Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée.
- ♦ Varicosités, varices.
- ♦ Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- ♦ Prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.
- ♦ Grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois si césarienne).
* Voir précautions d'emploi.
- ♦ En superposition selon l'avis de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

- ♦ Intolérance/Réaction/Allergie au produit.
- ♦ Affections dermatologiques suintantes de la jambe.
- ♦ Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- ♦ Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- ♦ Thrombose septique.



SMARTLEG®



Collant de compression médicale



Nos conseils d'enfilage



1

Saisir
le talon
à l'intérieur
du produit.



2

Retourner
le produit
sur l'envers
jusqu'au talon.



3

Ecarter
le produit
sans amasser
la matière.



4

Introduire
le pied jusqu'à
la pointe
et bien placer
votre talon.



5

Dérouler
délicatement
le produit
le long
de votre jambe.

Visionnez

la vidéo d'enfilage et accédez
à plus d'informations sur

www.smartleg.fr

SMARTLEG®



Taille :

À renouveler
à partir du :

Au quotidien

Pratiquez une activité physique régulière sollicitant le mollet : la marche, le vélo, la natation ou de simples exercices de flexion-extension des chevilles.

Evitez la pratique de sports brutaux pour les jambes occasionnant des à-coups (tennis, jogging, squash...).

Limitez les positions assises ou debout prolongées.

Astuces : Surélevez vos jambes au repos ou placez des cales sous les pieds de votre lit, pour que vos pieds soient plus hauts que votre bassin afin de favoriser le drainage des veines.

Evitez les expositions prolongées des jambes à la chaleur (bain, chauffage au sol, sauna...).

Privilégiez des talons de 3 à 5 cm aux talons plats ou trop hauts.

Adoptez un régime alimentaire équilibré et surveillez votre ligne.

L'entretien

Lavage : à la main ou en machine à 40°C sans adoucissant ni agent de blanchiment.

Essorage : sans tordre.

Séchage : à plat à l'abri de toute source de chaleur. Ne pas repasser.



МАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАРКИРОВОЧНОГО СТИКЕРА И МАРКИРОВОЧНОЙ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ С МАРКИРОВКОЙ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ



Трикотаж медицинский компрессионный SMARTLEG®
Чулки компрессионные полупрозрачные SMARTLEG®



Лаборатуар ИННОТЕРА, С.А.С / Laboratoires INNOTHERA, S.A.S
Адрес места производства: Rue Bernard Gobet Zac Epinal-Nomexy Fr-88440 Nomexy

Уполномоченный представитель
производителя
в Российской Федерации
Сведения о регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «ИННОТЕК»
115035, Москва, Садовническая набережная, дом 71
Тел. 8-800-250-1738 E-mail: innotech@innotech.ru
РУ № _____ от ДД.ММ.ГГГГ

Посмотрите более подробную информацию, инструкцию по надеванию и видео на сайте
[www.smartleg.fr / ru](http://www.smartleg.fr/ru)

**КЛАСС
компрессии
1**



**РАЗМЕР
T2+**

Radieuse

NORMAL



ДД.ММ.ГГГГ



LOT

XXXXXX

REF

XXXXXX



МАКЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ С МАРКИРОВКОЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



МАКЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ С МАРКИРОВКОЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

SMARTLEG®

Трикотаж медицинский компрессионный

СОСТАВ

Полиамид, в том числе полиамид микрофибра, эластан.

КАК ДЕЙСТВУЕТ SMARTLEG®

Компрессионный трикотаж оказывает давление, убывающее от лодыжки к верхней части ноги, что способствует увеличению скорости оттока венозной крови, улучшению микроциркуляции и лимфодренажа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ♦ Рекомендуется постирать изделие перед первым применением.
- ♦ При облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей с лодыжечно-плечевым индексом от 0.6 до 0.9, развивающейся периферической нейропатии, мокнущем дерматозе или экземе необходимо регулярное наблюдение врача для постоянной оценки соотношения пользы и риска.
- ♦ Не допускать соприкосновения компрессионного трикотажа непосредственно с раной или поврежденной кожей.
- ♦ При развитии кожных реакций следует снять изделие и обратиться к врачу.
- ♦ При инфекционных заболеваниях кожи следует вначале вылечить инфекцию и только потом использовать компрессионный трикотаж.



ПРОИЗВЕДЕНО ВО ФРАНЦИИ



SMARTLEG®

Трикотаж медицинский компрессионный

СОСТАВ

Полиамид, в том числе полиамид микрофибра, эластан.


КАК ДЕЙСТВУЕТ SMARTLEG®

Компрессионный трикотаж оказывает давление, убывающее от лодыжки к верхней части ноги, что способствует увеличению скорости оттока венозной крови, улучшению микроциркуляции и лимфодренажа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ♦ Рекомендуется постирать изделие перед первым применением.
- ♦ При облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей с лодыжечно-плечевым индексом от 0.6 до 0.9, развивающейся периферической нейропатии, мокнущем дерматозе или экземе необходимо регулярное наблюдение врача для постоянной оценки соотношения пользы и риска.
- ♦ Не допускать соприкосновения компрессионного трикотажа непосредственно с раной или поврежденной кожей.
- ♦ При развитии кожных реакций следует снять изделие и обратиться к врачу.
- ♦ При инфекционных заболеваниях кожи следует вначале вылечить инфекцию и только потом использовать компрессионный трикотаж.

МАКЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ С МАРКИРОВКОЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

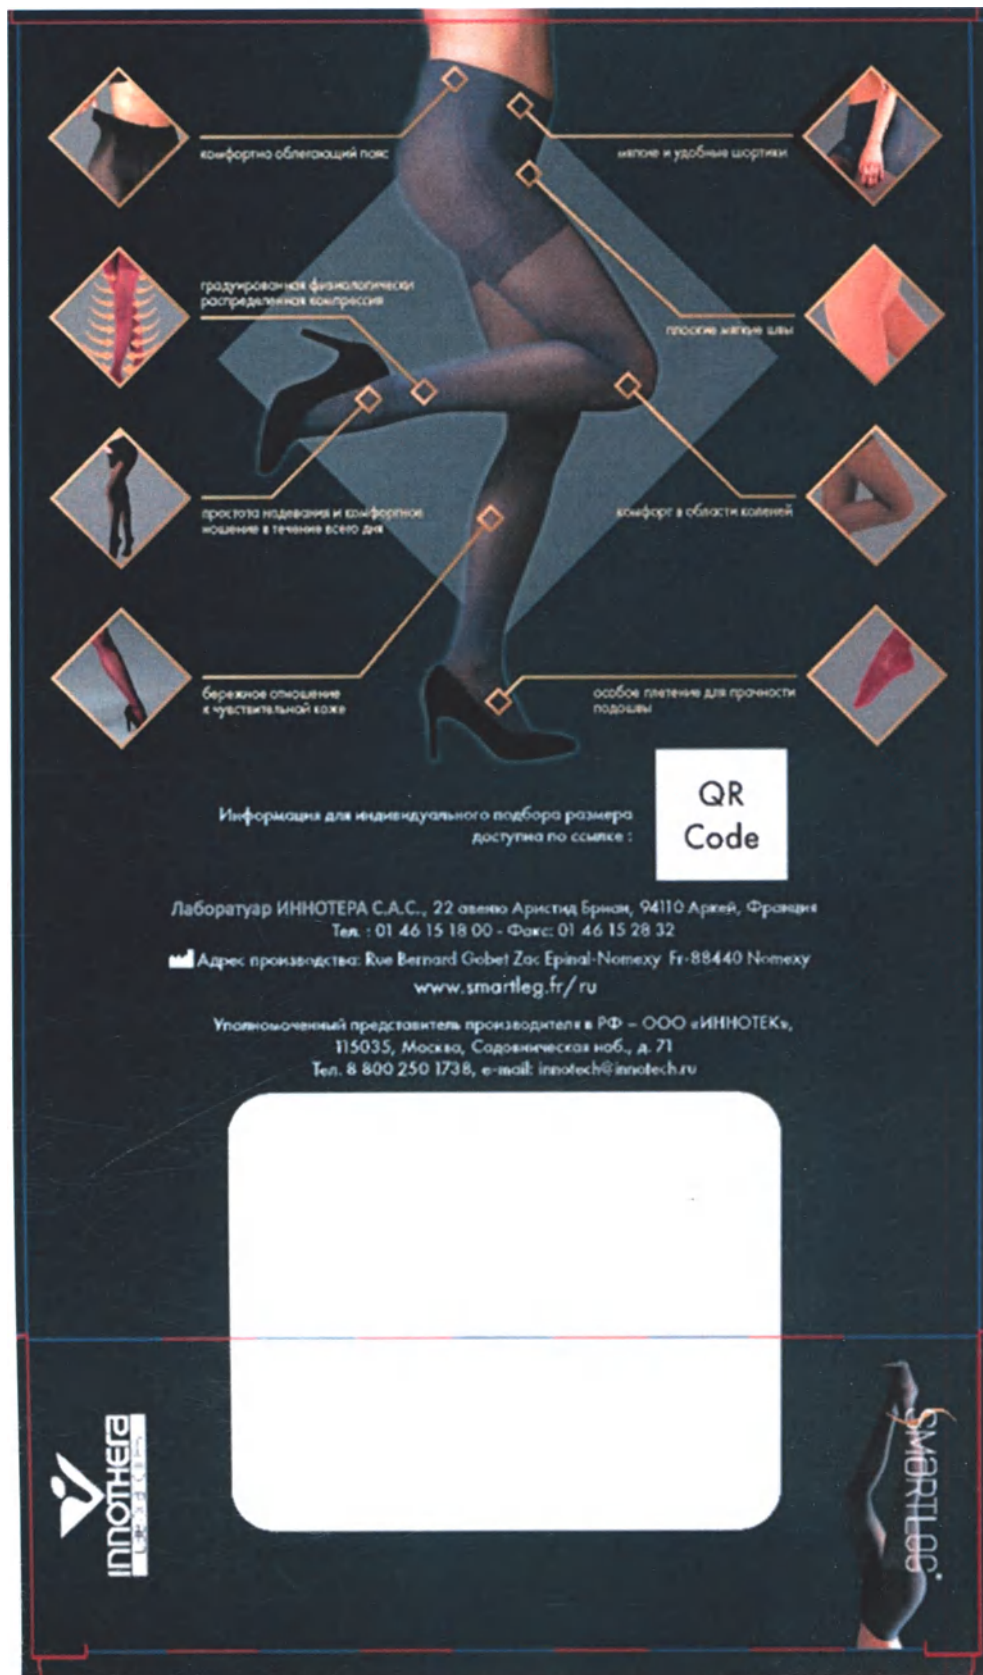

конфортно облегающий пояс

мягкие и удобные шортики

градуированная физиологическая распределенная компрессия

гладкое мягкое швы

прокатка подвздошья и комфортное ношение в течение всего дня

комфорт в области коленей

бережное отношение к чувствительной коже

особое плетение для прочности подошвы

Информация для индивидуального подбора размера доступна по ссылке :

QR Code

Лаборатуар ИННОТЕРА С.А.С., 22 avenue Aristide Briand, 94110 Arles, France
Тел. : 01 46 15 18 00 - Факс: 01 46 15 28 32

Адрес производства: Rue Bernard Gobel Zac Epinal-Nomexy Fr-88440 Nomexy
www.smartleg.fr/ru

Уполномоченный представитель производителя в РФ – ООО «ИННОТЕХ»,
115035, Москва, Садовническая наб., д. 71
Тел. 8 800 250 1738, e-mail: innotech@innotech.ru

innotera
L'ART DE LA COMPRESSION

SMARTLEG

МАКЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ С МАРКИРОВКОЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

SMARTLEG⁺

Трикотаж медицинский компрессионный

Давление на уровне лодыжки
от 15,1 до 20 мм рт. ст.
Соответствует классу II стандарта ASQUAL.

ПОКАЗАНИЯ

- ♦ Тяжесть или боль в ногах, усталость, отёки ног после длительного нахождения в положении стоя или сидя (например, во время авиалёта), в том числе при отсутствии внешних признаков поражения вен.
- ♦ Сосудистые звёздочки и сеточки (телеангиэктазии) на коже ног.
- ♦ Варикозное расширение вен.
- ♦ После склеротерапии или хирургического вмешательства на венах ног.
- ♦ Во время беременности и 6 недель после родов (6 месяцев в случае кесарева сечения).
- ♦ Также может применяться для профилактики тромбоза глубоких вен в комплексе с антикоагулянтной терапией либо независимо от неё.

* При беременности, наборе и потере веса, исчезновении отёка и т.п. следует проконсультироваться со специалистом для уточнения размера или типа изделия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ♦ Непереносимость материала, аллергия на материал изделия.
- ♦ Дерматологические заболевания, сопровождающиеся мокнутием.
- ♦ Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей с подожечно-плечевым индексом меньше 0,6.
- ♦ Флебит нижних конечностей, сопровождающийся резкой болью, цианозом и отсутствием пульсации артерий.
- ♦ Септический тромбоз.

РУ № _____ от ДД.ММ.ГГГГ


INNOTHERA
LABORATORIES

N1086-03-18

SMARTLEG⁺

Трикотаж медицинский компрессионный

Давление на уровне лодыжки
от 15,1 до 20 мм рт. ст.
Соответствует классу II стандарта ASQUAL.

ПОКАЗАНИЯ


- ♦ Тяжесть или боль в ногах, усталость, отёки ног после длительного нахождения в положении стоя или сидя (например, во время авиалёта), в том числе при отсутствии внешних признаков поражения вен.
- ♦ Сосудистые звёздочки и сеточки (телеангиэктазии) на коже ног.
- ♦ Варикозное расширение вен.
- ♦ После склеротерапии или хирургического вмешательства на венах ног.
- ♦ Во время беременности и 6 недель после родов (6 месяцев в случае кесарева сечения).
- ♦ Также может применяться для профилактики тромбоза глубоких вен в комплексе с антикоагулянтной терапией либо независимо от неё.

* При беременности, наборе и потере веса, исчезновении отёка и т.п. следует проконсультироваться со специалистом для уточнения размера или типа изделия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ♦ Непереносимость материала, аллергия на материал изделия.
- ♦ Дерматологические заболевания, сопровождающиеся мокнутием.
- ♦ Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей с подожечно-плечевым индексом меньше 0,6.
- ♦ Флебит нижних конечностей, сопровождающийся резкой болью, цианозом и отсутствием пульсации артерий.
- ♦ Септический тромбоз.

МАКЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ
С МАРКИРОВКОЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

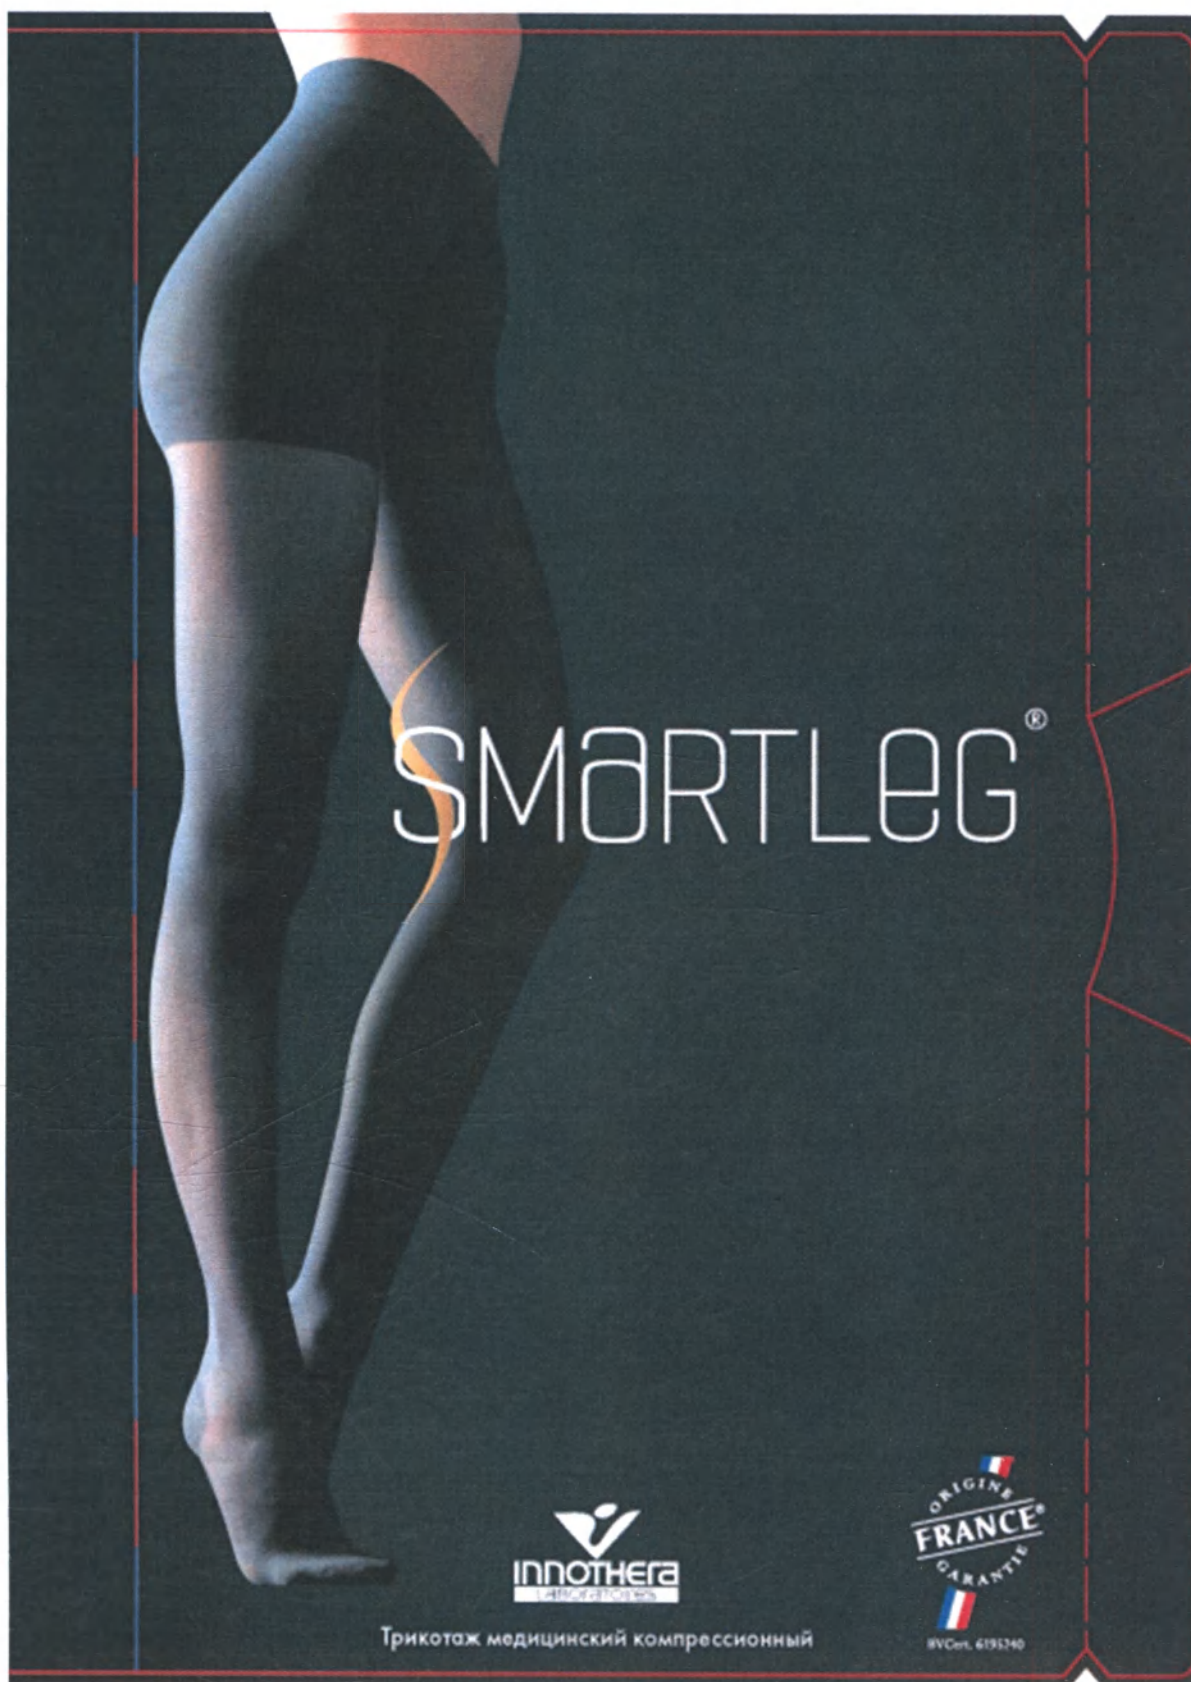

МАКЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ С МАРКИРОВКОЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Советы по надеванию

1

Возьмите за пятку
изнутри изделия.

2

Выверните изделие
наизнанку до пятки.

3

Расправьте
изделие, чтобы не
было складок.

4

Осторожно наденьте
изделие на ступню.
Убедитесь, что пятка и
мысок изделия
правильно расположены
на ноге

5

Осторожно
распределите изделие
по вашей ноге.

Кольца, браслеты, часы могут
повредить изделие.
Их рекомендуется снять перед тем, как
надевать, снимать и стирать изделия

Посмотрите

более подробную информацию,
инструкцию по надеванию и видео
на сайте

www.smartleg.fr/ru

SMARTLEG®



Каждый день

Регулярно выполняйте физические упражнения
с нагрузкой на мышцы голени: ходьба, езда
на велосипеде, плавание или простые упражнения
для тренировки мышц голени.

Избегайте видов спорта с большой нагрузкой
на ноги (теннис, бег и др.).

Старайтесь долго не оставаться в положении
сидя или стоя.

Полезные советы

Для улучшения венозного оттока рекомендуется
лежать так, чтобы ноги находились выше таза.

Избегайте продолжительного перегрева ног
(горячие ванны, пол с подогревом, сауна).

Отдавайте предпочтение обуви с каблучками
высотой 3-5 см вместо высоких каблучков или
обуви без каблучков.

Старайтесь придерживаться сбалансированного
режима питания, следите за весом.

Уход

Стирка вручную или в стиральной машине
при 40°C без смягчителей или отбеливателей.

Не выкручивать при отжиме.

Сушка: положить на плоскую, поверхность вдали
от источников тепла. Не гладить.

Химическая чистка запрещена.



МАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВОЧНОЙ ЭТИКЕТКИ

КЛАСС компрессии 1		<i>Чулки компрессионные полупрозрачные SMARTLEG®</i>	
		РАЗМЕР T2+	Radieuse
		NORMAL	
	ДД.ММ.ГГГГ		
LOT	XXXXXX		
REF	XXXXXX	3 664540 004750	

МАКЕТ МАРКИРОВОЧНОЙ ЭТИКЕТКИ ГРУППОВОЙ (ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ)

		<i>Трикотаж медицинский компрессионный SMARTLEG®</i> <i>Колготки компрессионные полупрозрачные SMARTLEG®</i>			
	ДД.ММ.ГГГГ	LOT	XXXXX		
Условия хранения	- температура, °C: от плюс 5 до плюс 45; - относительная влажность, %: не более 70				
Условия транспортирования	- температура окружающей среды, °C: от минус 50 до плюс 50; - относительная влажность не более 80 %				
Количество комплектов	24	Цвет	Размер	Длина	масса брутто
		Naturelle	T2+	Normal	КГ
Сведения о регистрации			РУ № _____ от ДД.ММ.ГГГГ		
Лаборатуар ИННОТЕРА, С.А.С / Laboratoires INNOTHERA, S.A.S. Адрес места производства: Rue Bernard Gobet Zac Epinal-Nomexy Fr-88440 Nomexy					



