

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ООО «КГБ» -

индивидуальный предприниматель



Богатов Е.А.

2020 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Комплекс роботизированный 3D NEWTON
для гравитационной терапии**


**Комплекс роботизированный 3D NEWTON
для гравитационной терапии, в составе:**

1. Рама на станине с вертикальной стойкой в сборе
2. Блок управления
3. Компакт-диск с программным обеспечением «3D NEWTON»
4. Сетевой кабель

1. Рама на станине с вертикальной стойкой в сборе

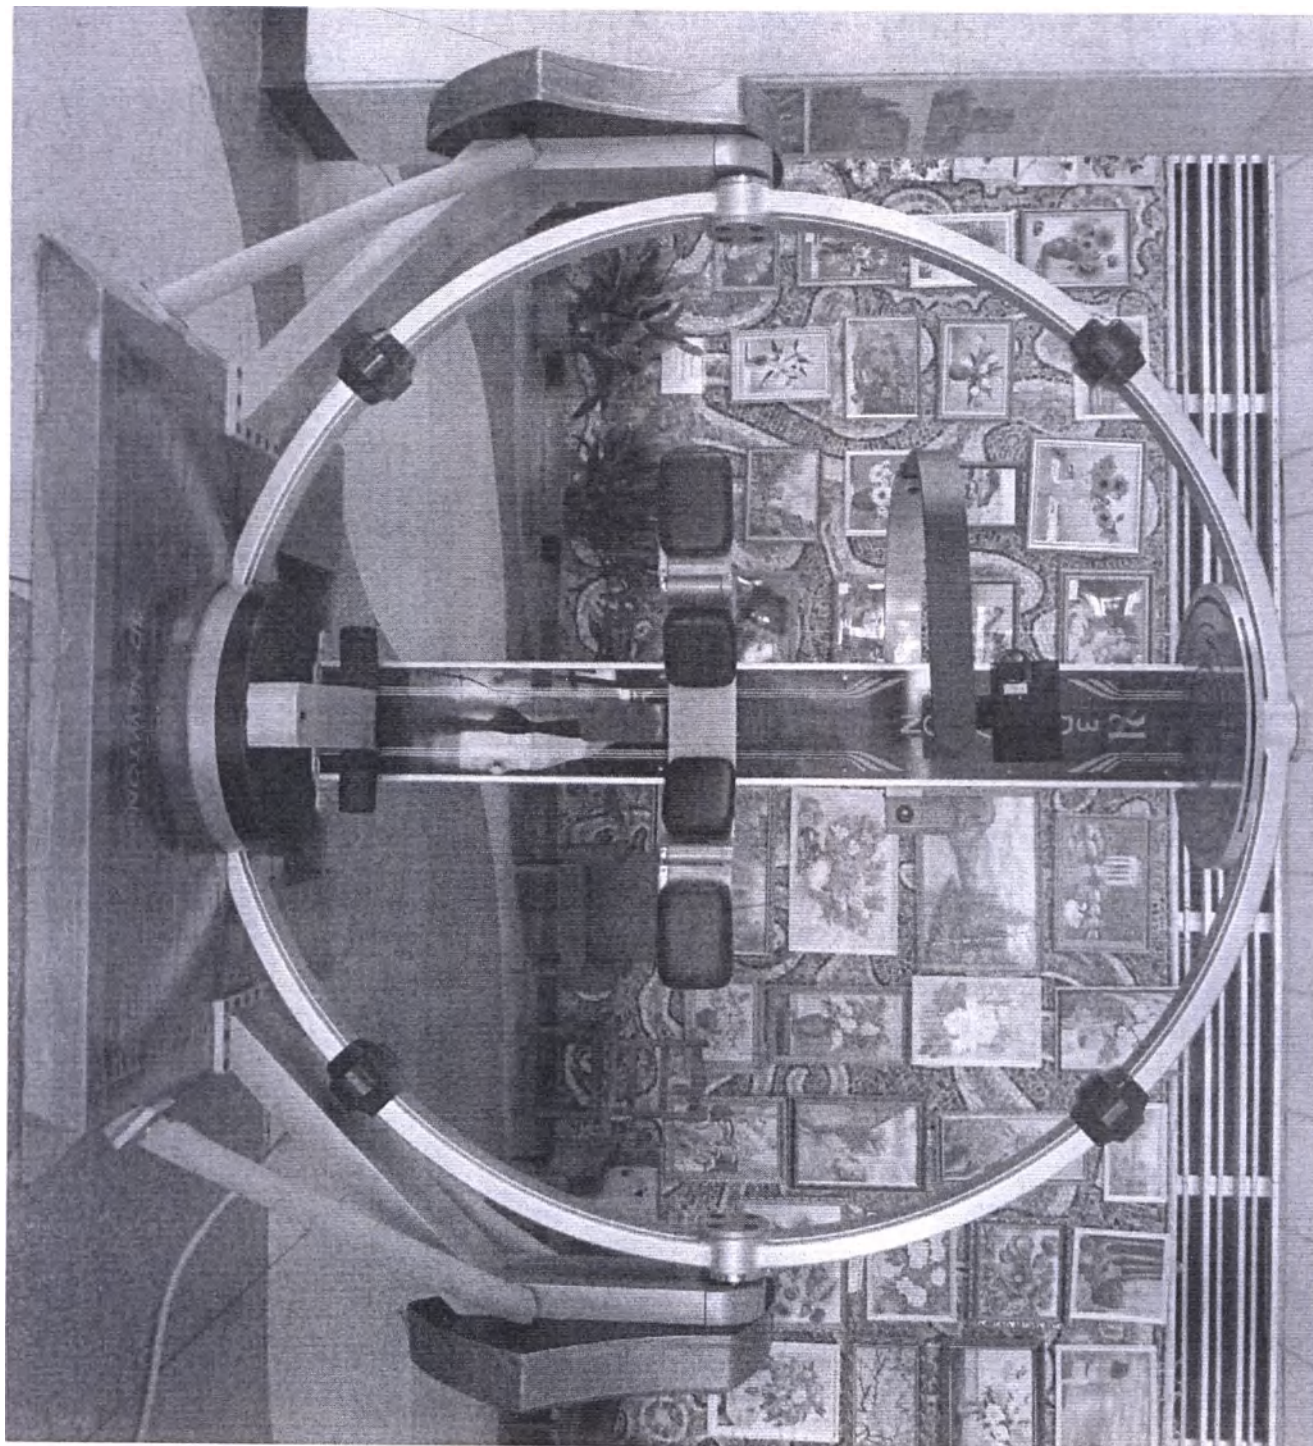


1.1. Фундаментная рама

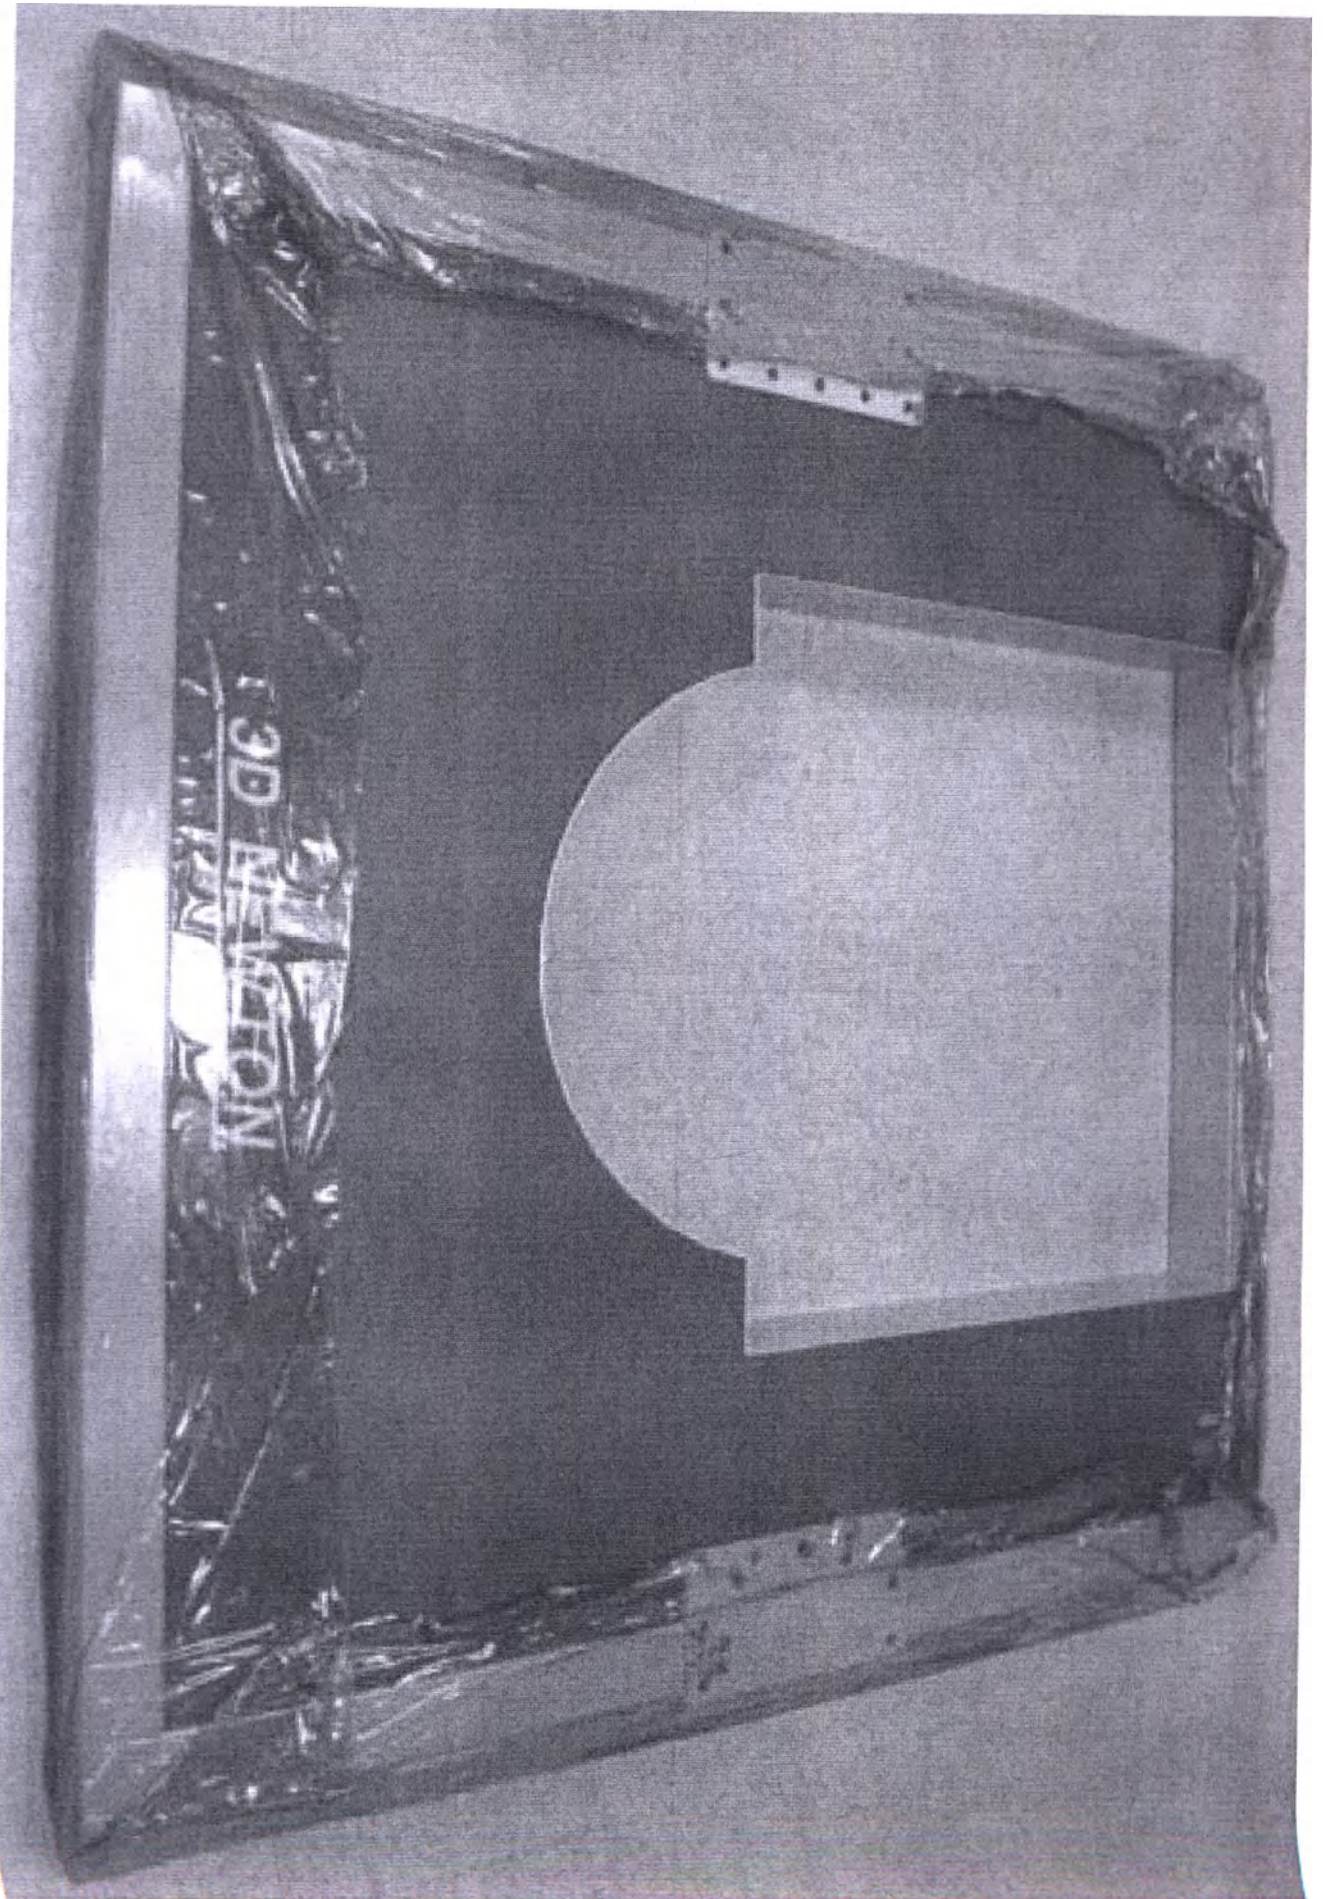





1.3. Крышка мотора

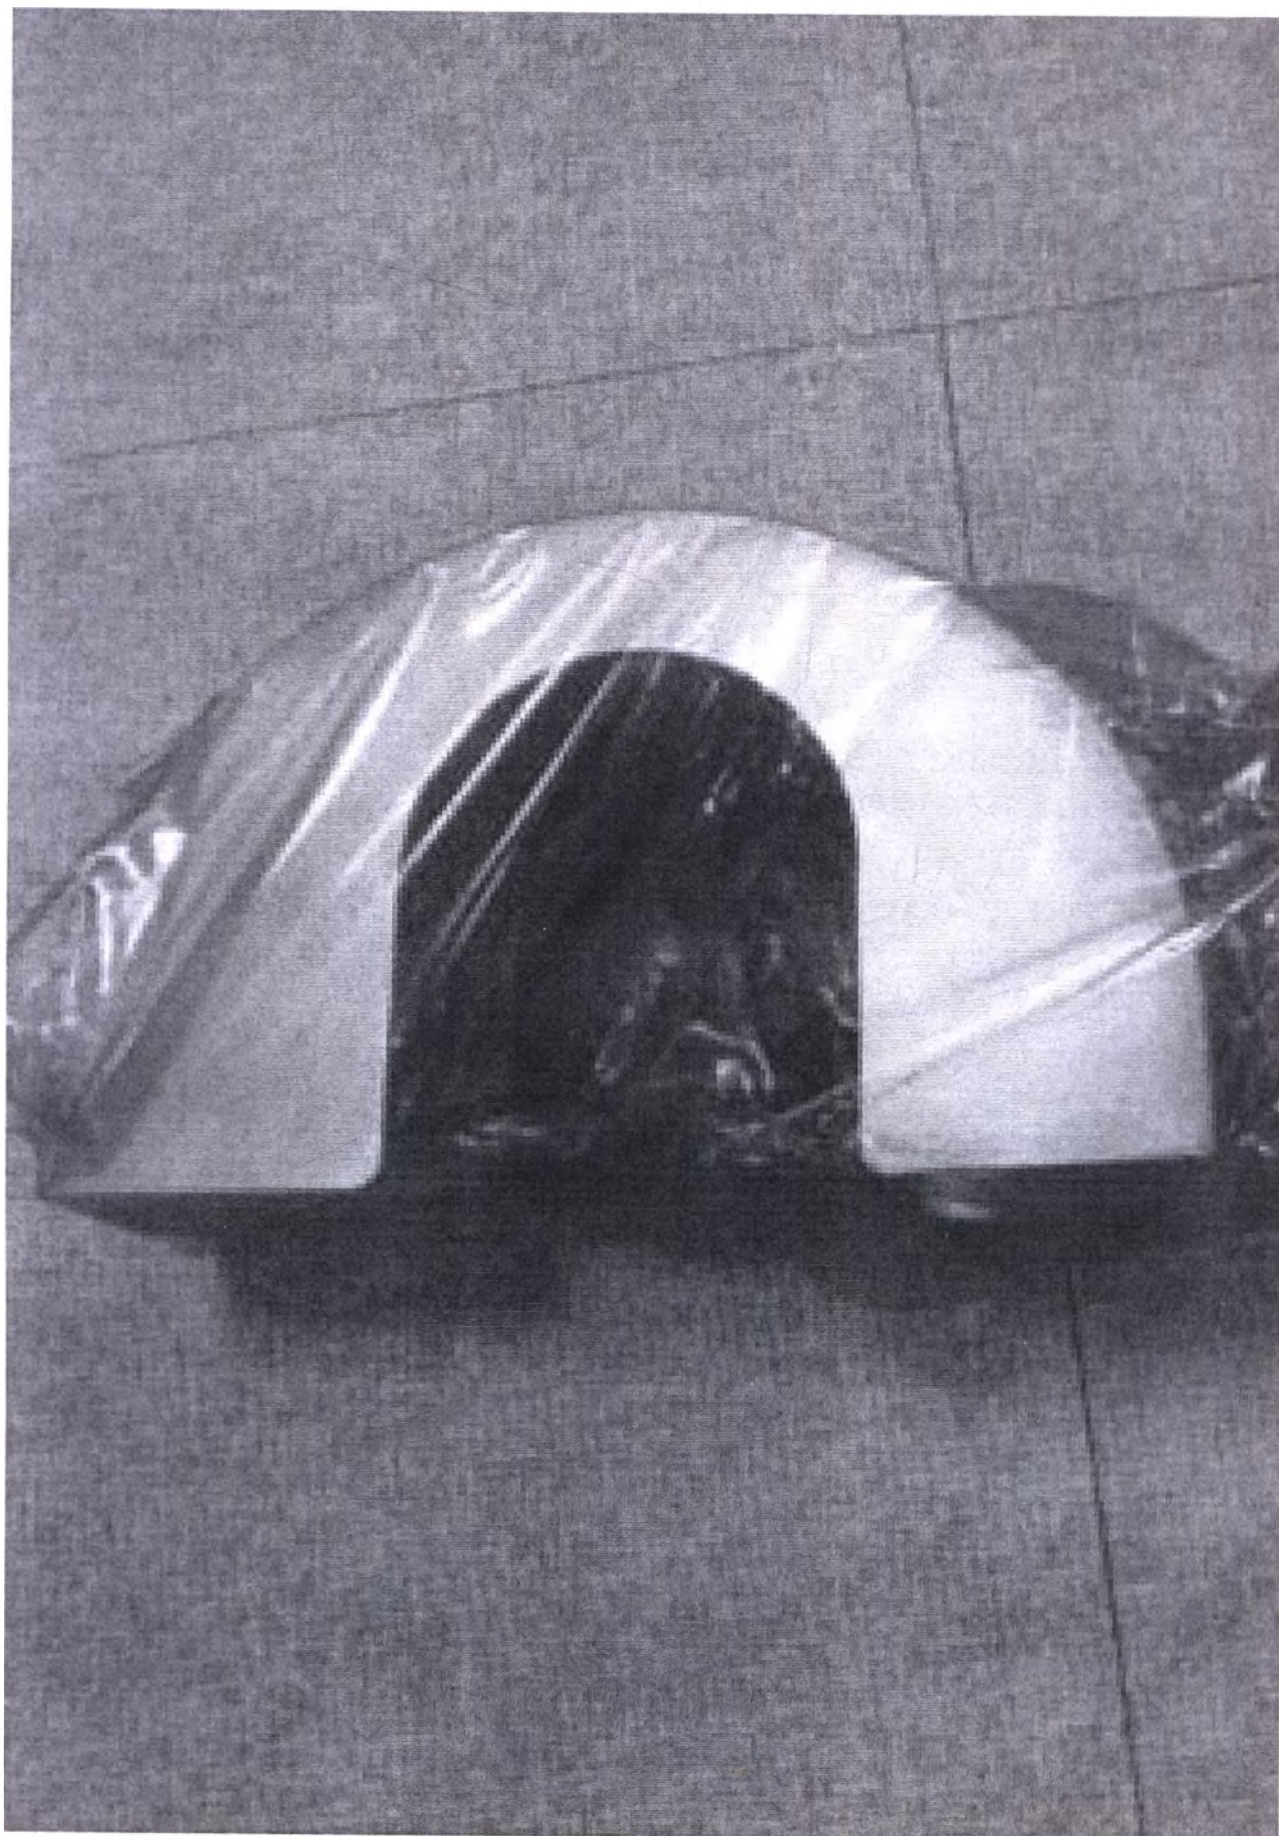


1.4. Основная круговая рама

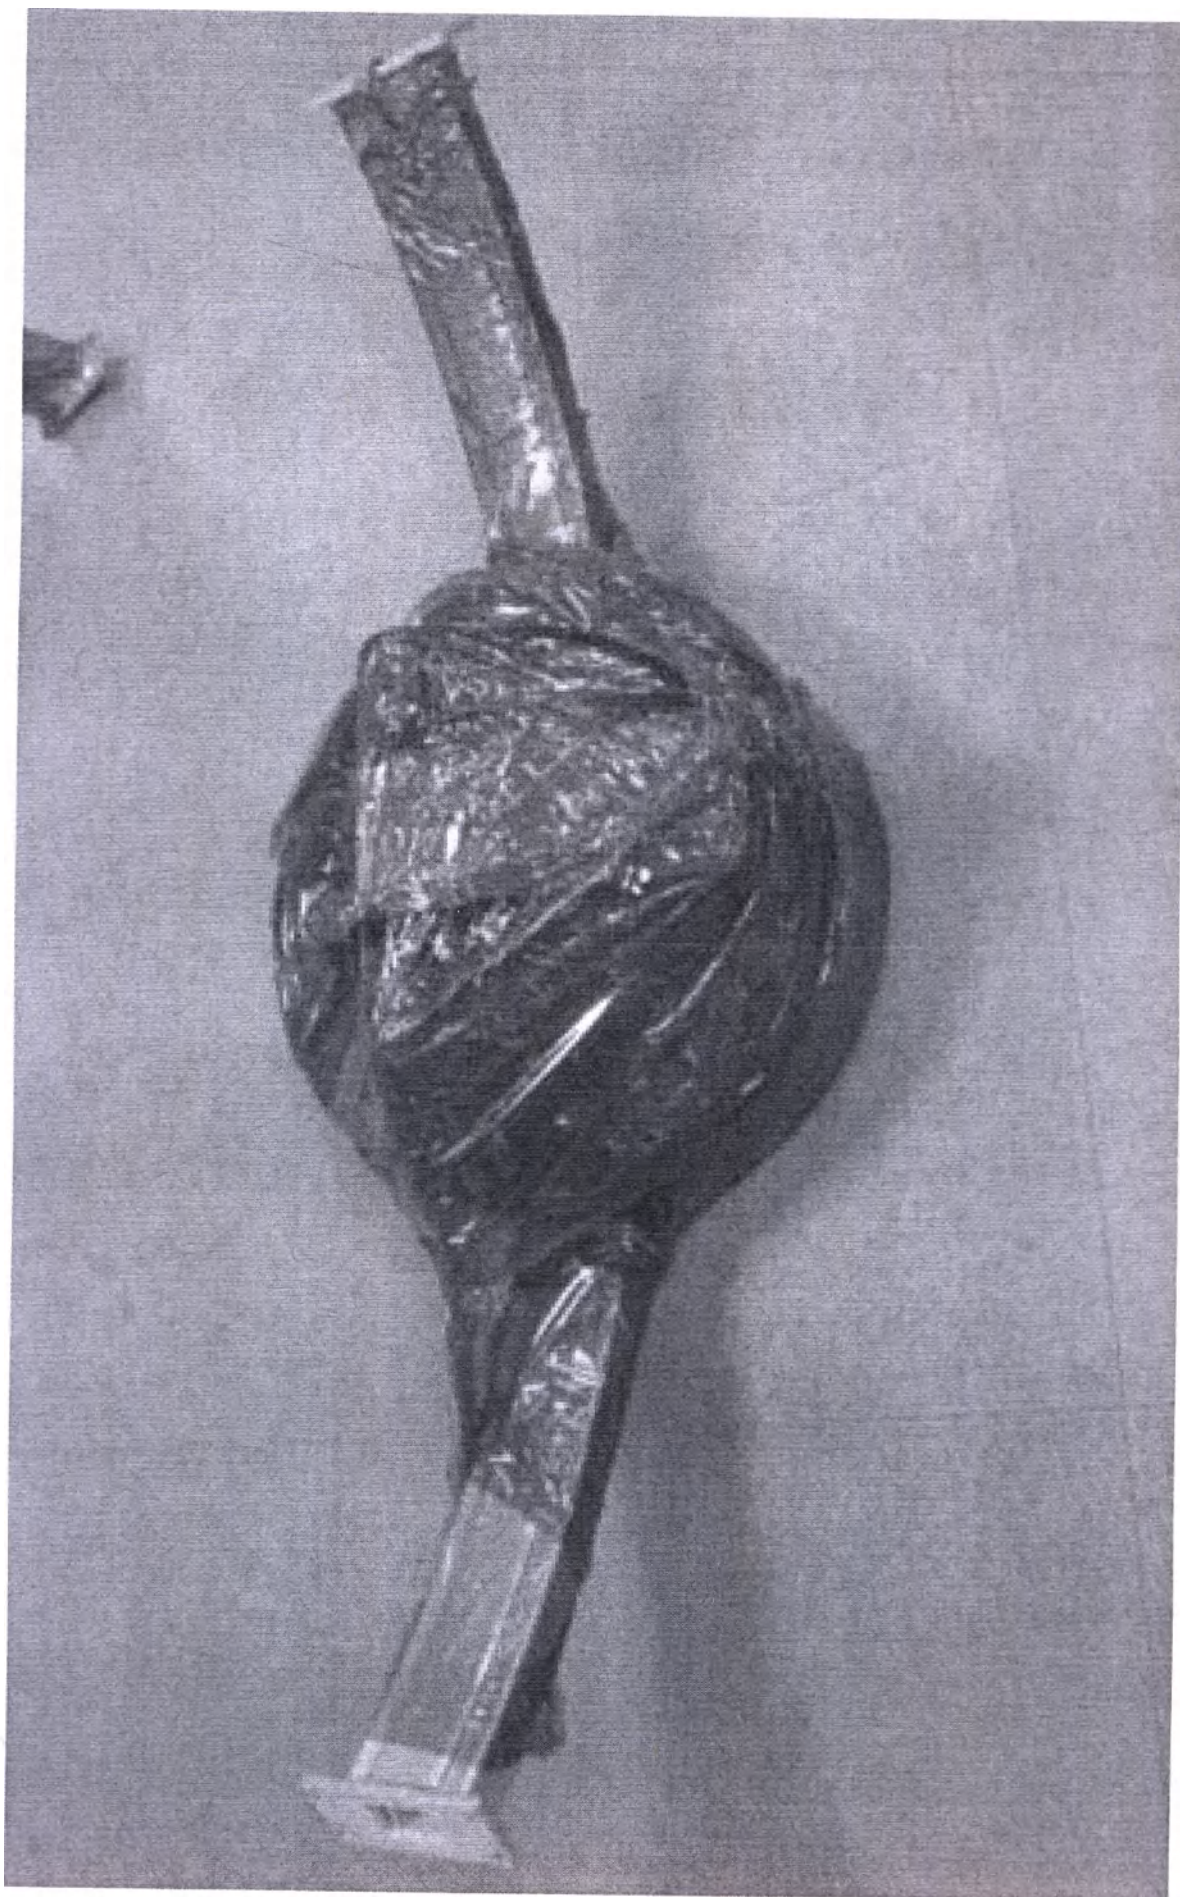


1.5. Круговая рама 1

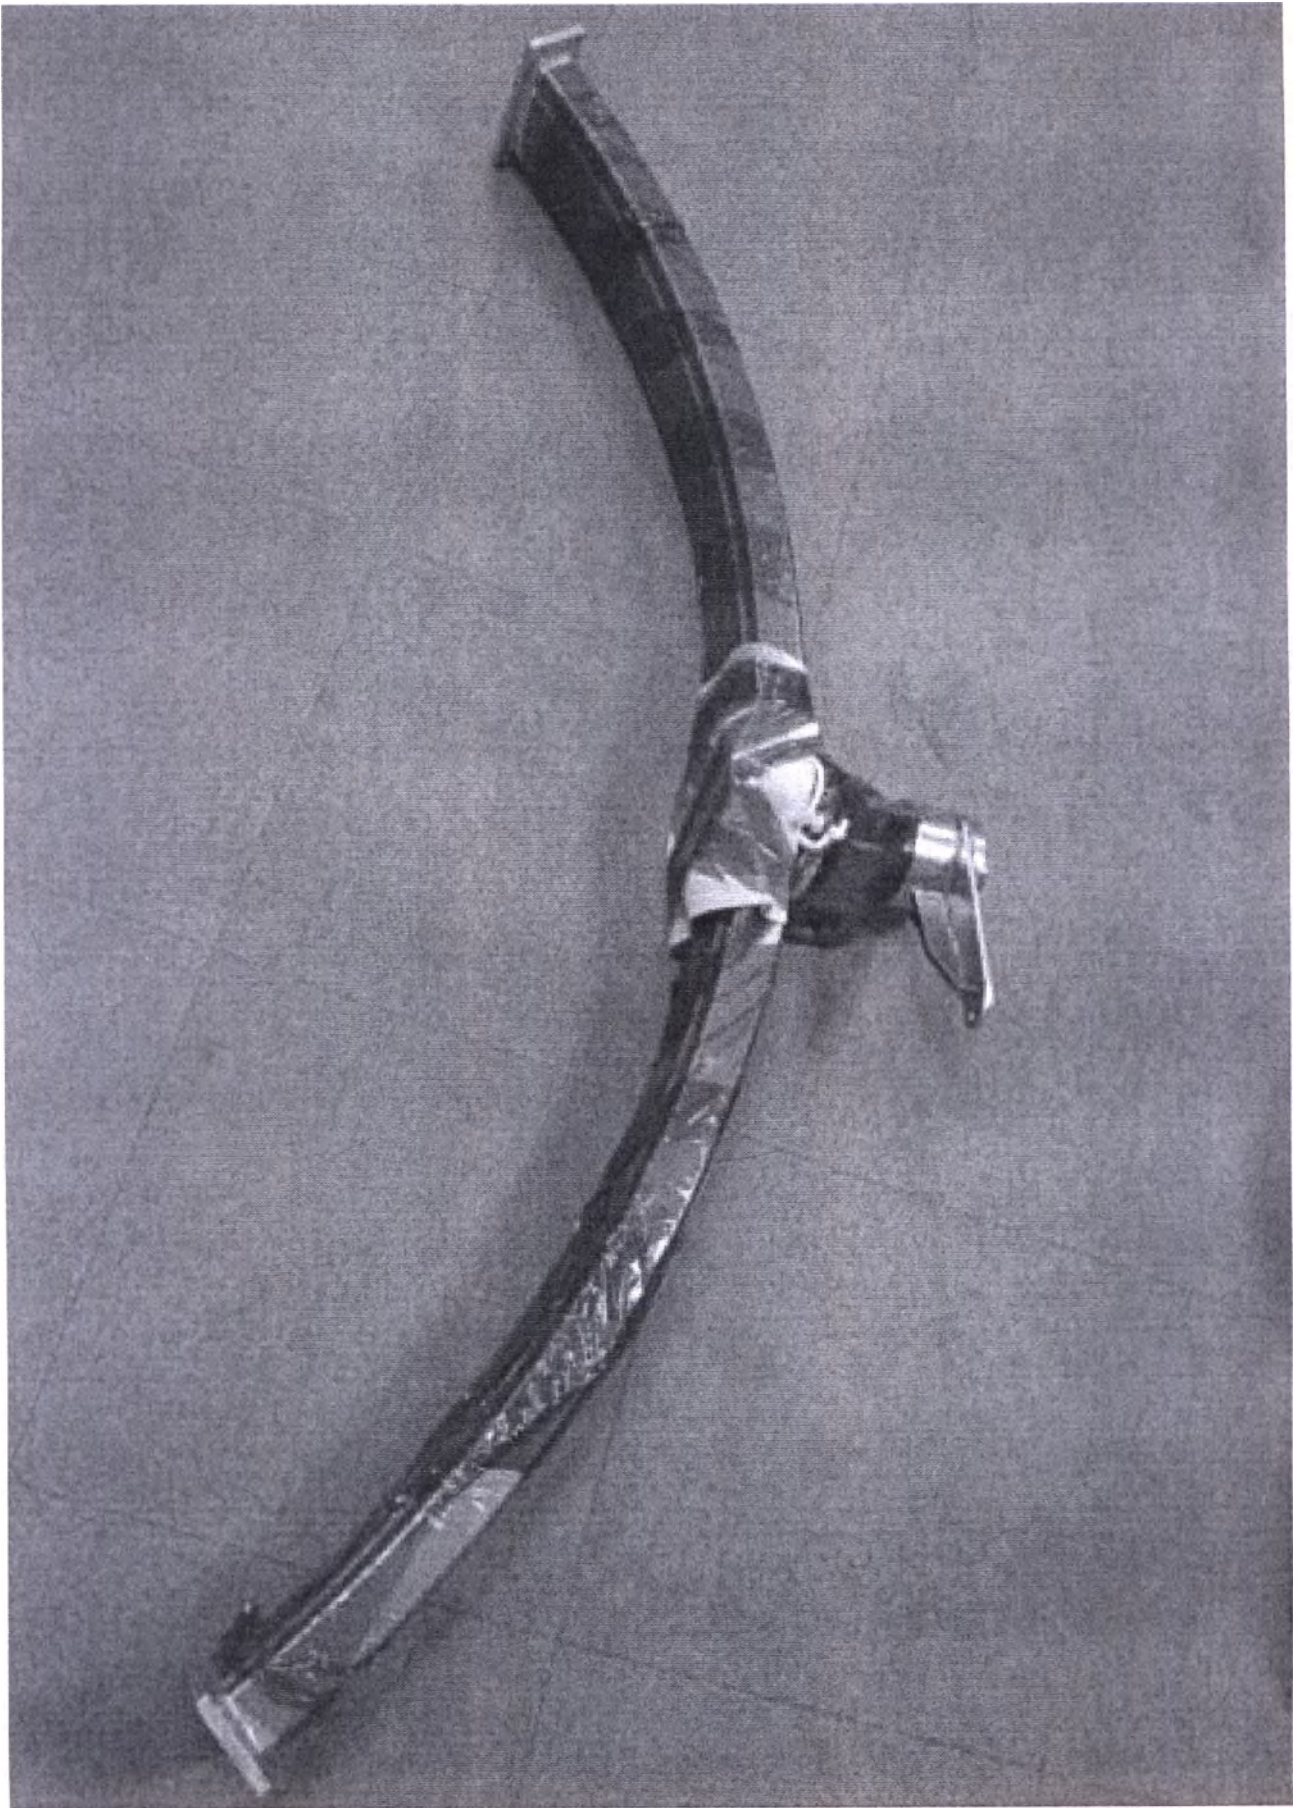

1.6. Круговая рама 2

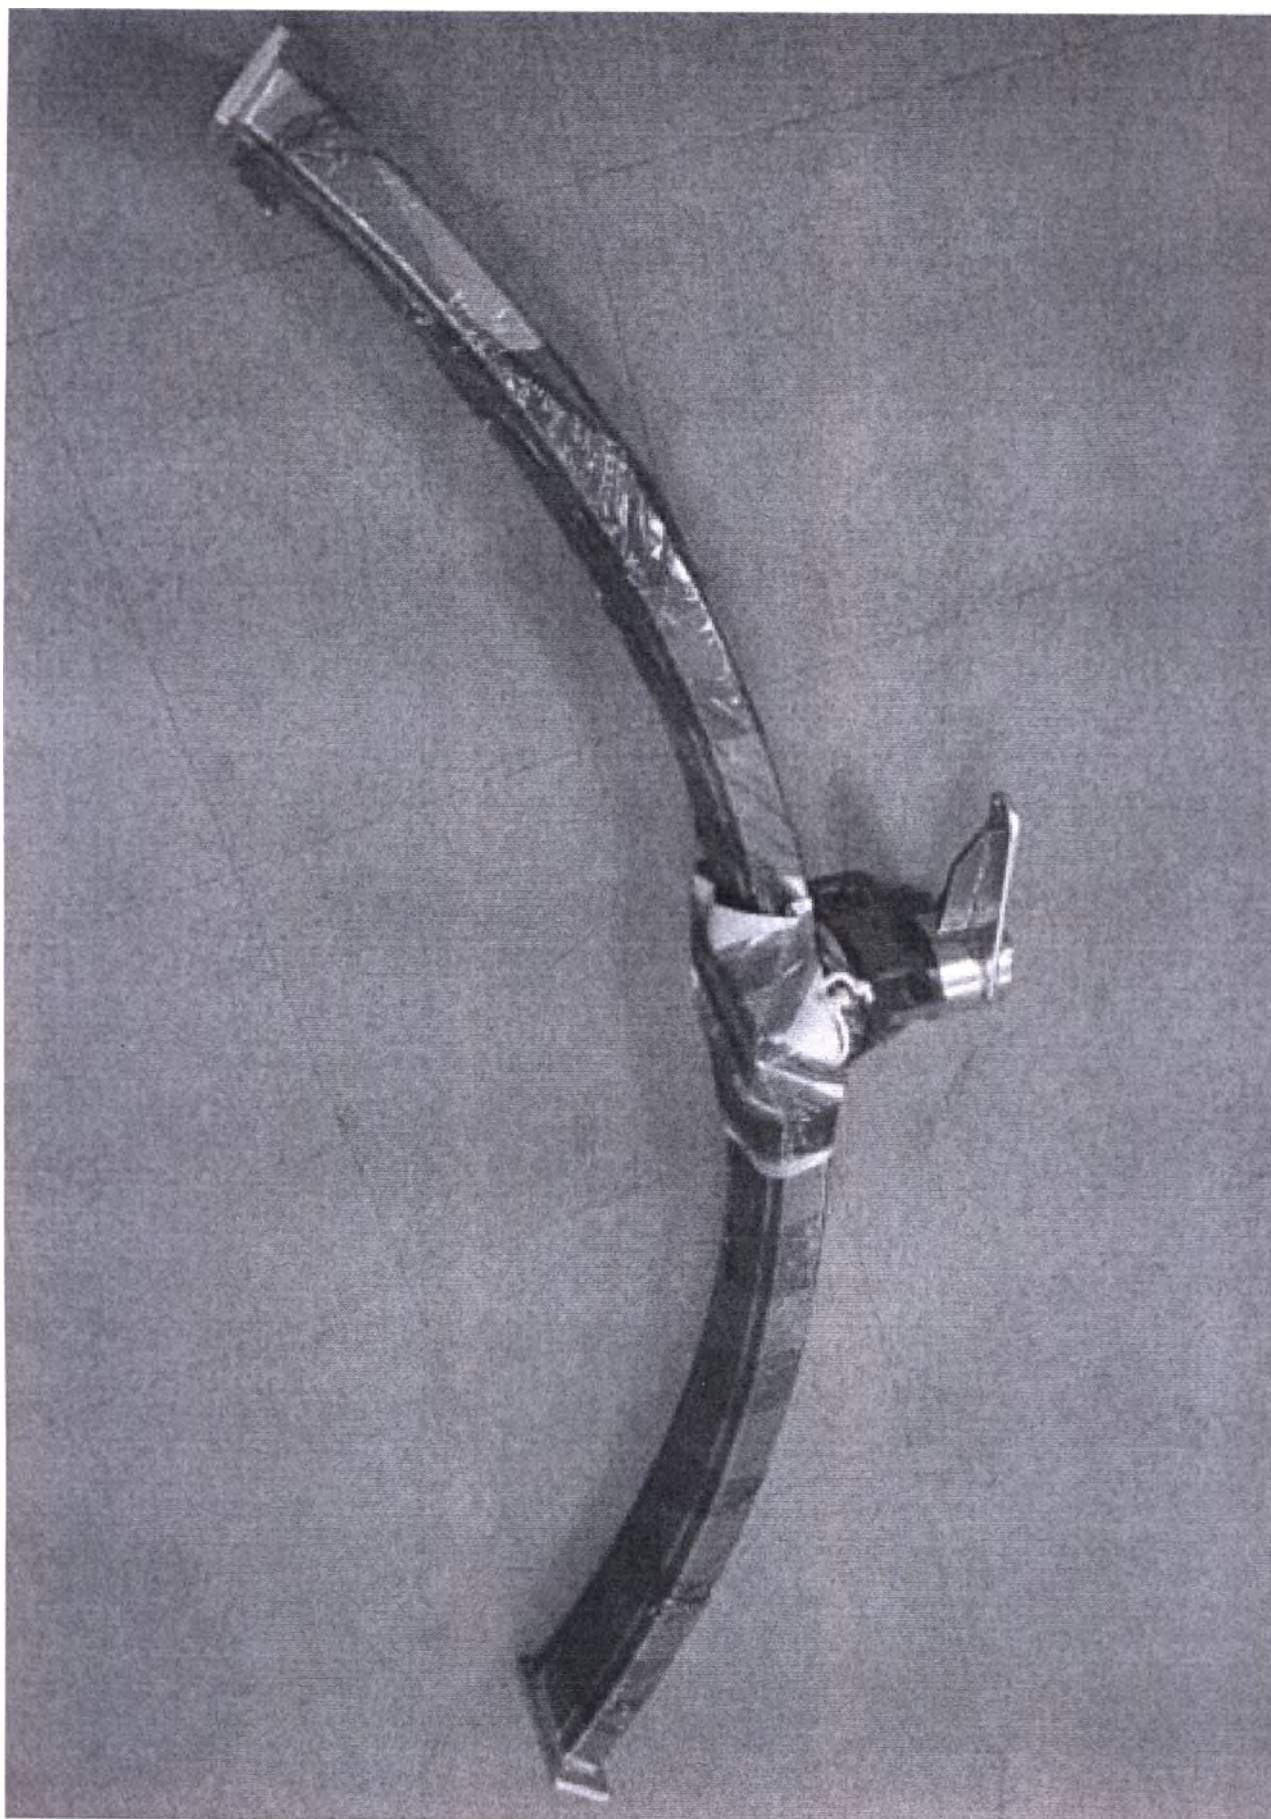



1.7. Круговая рама 3

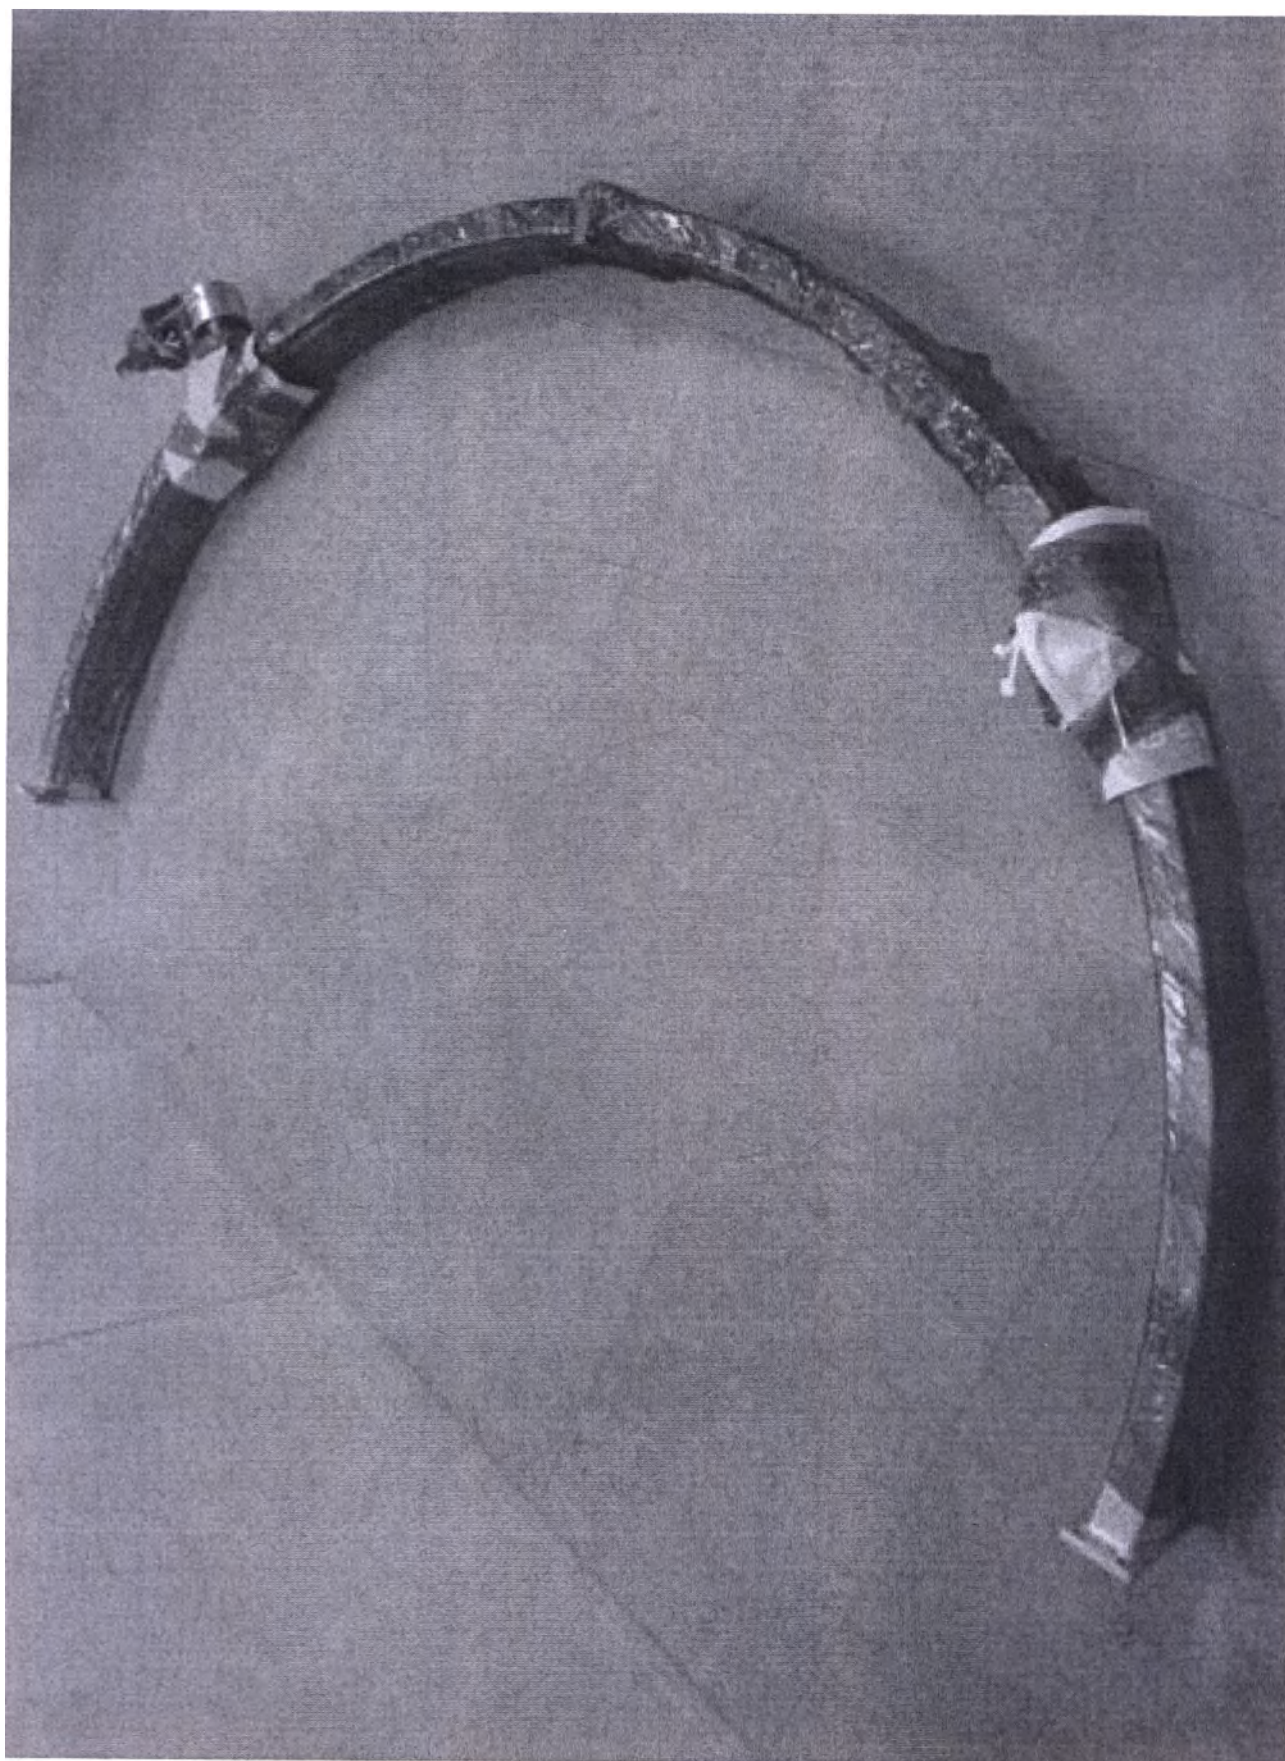


1.8. Боковая рама 1 (слева)


1.9. Боковая рама 2 (справа)

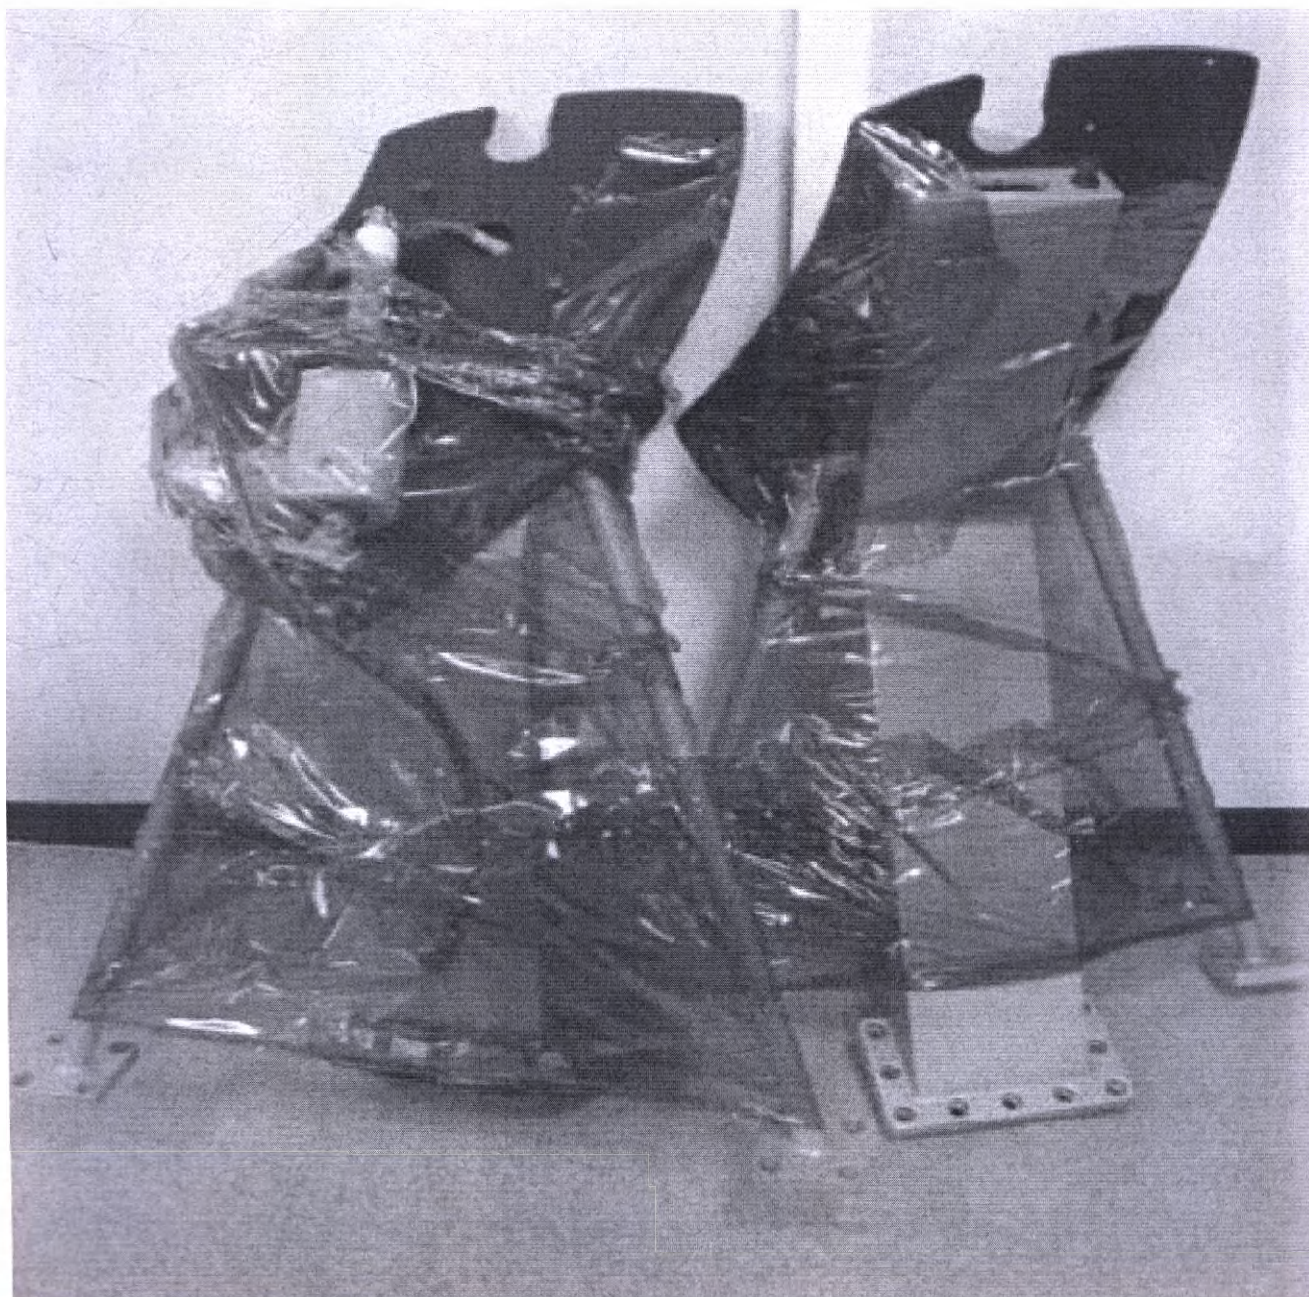


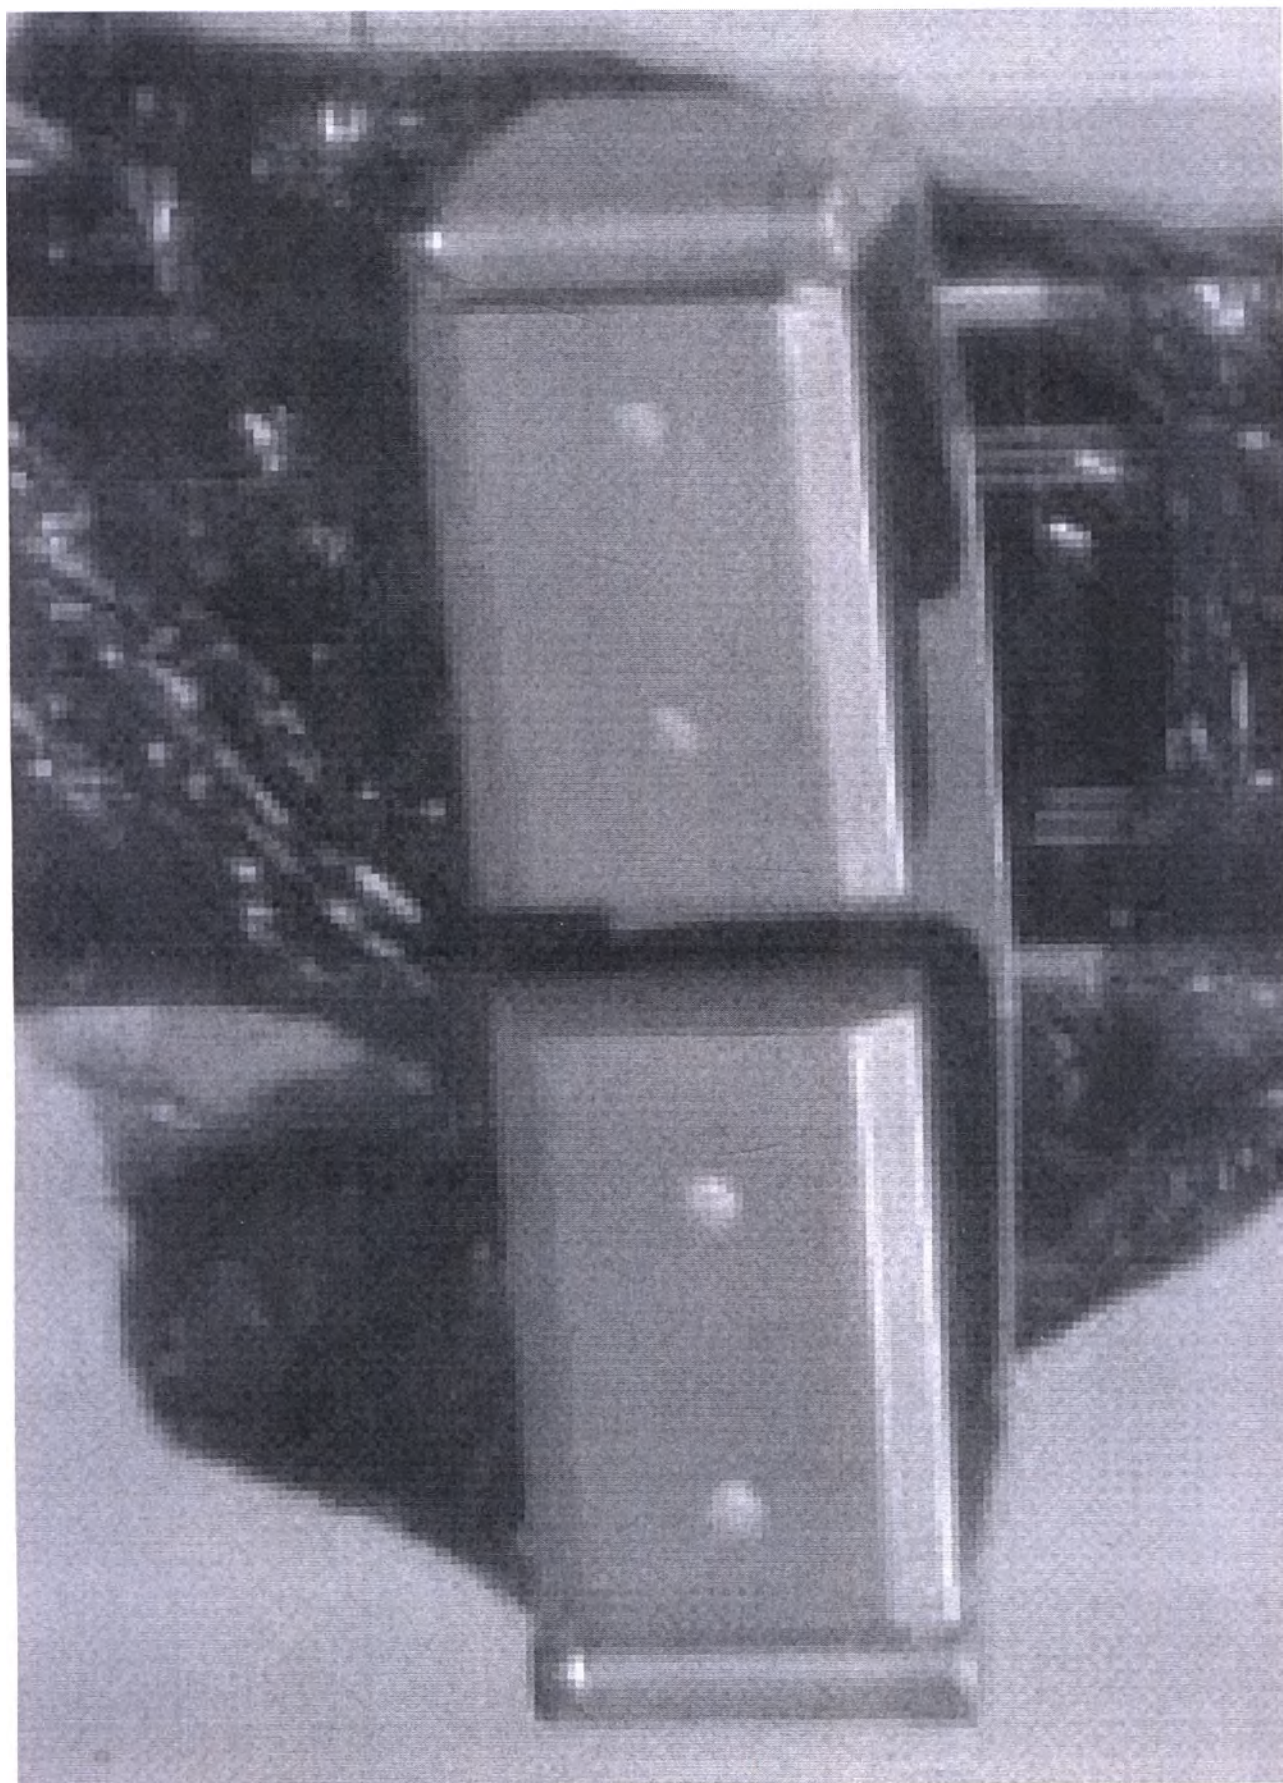


1.11. Датчик рукоятки

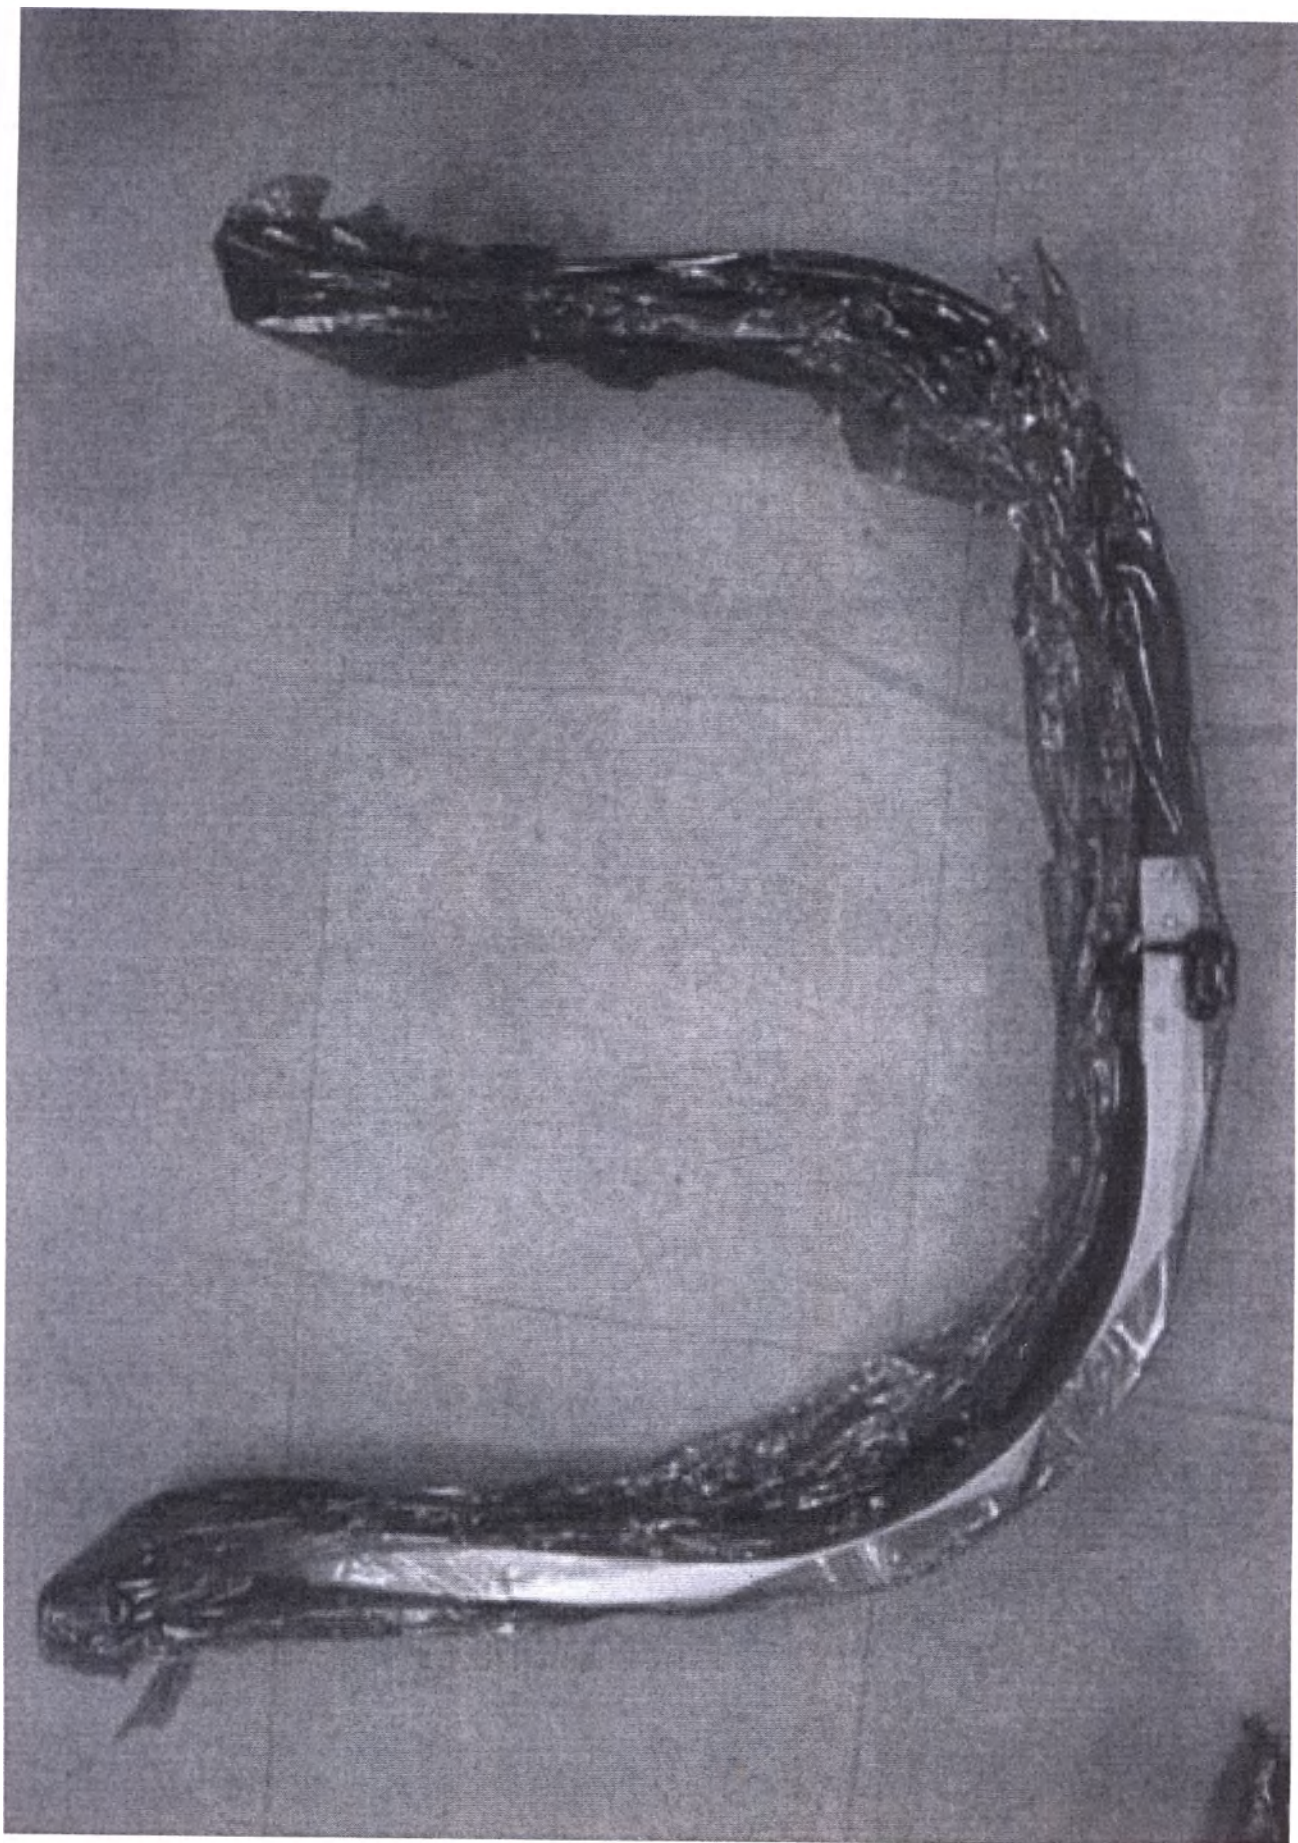


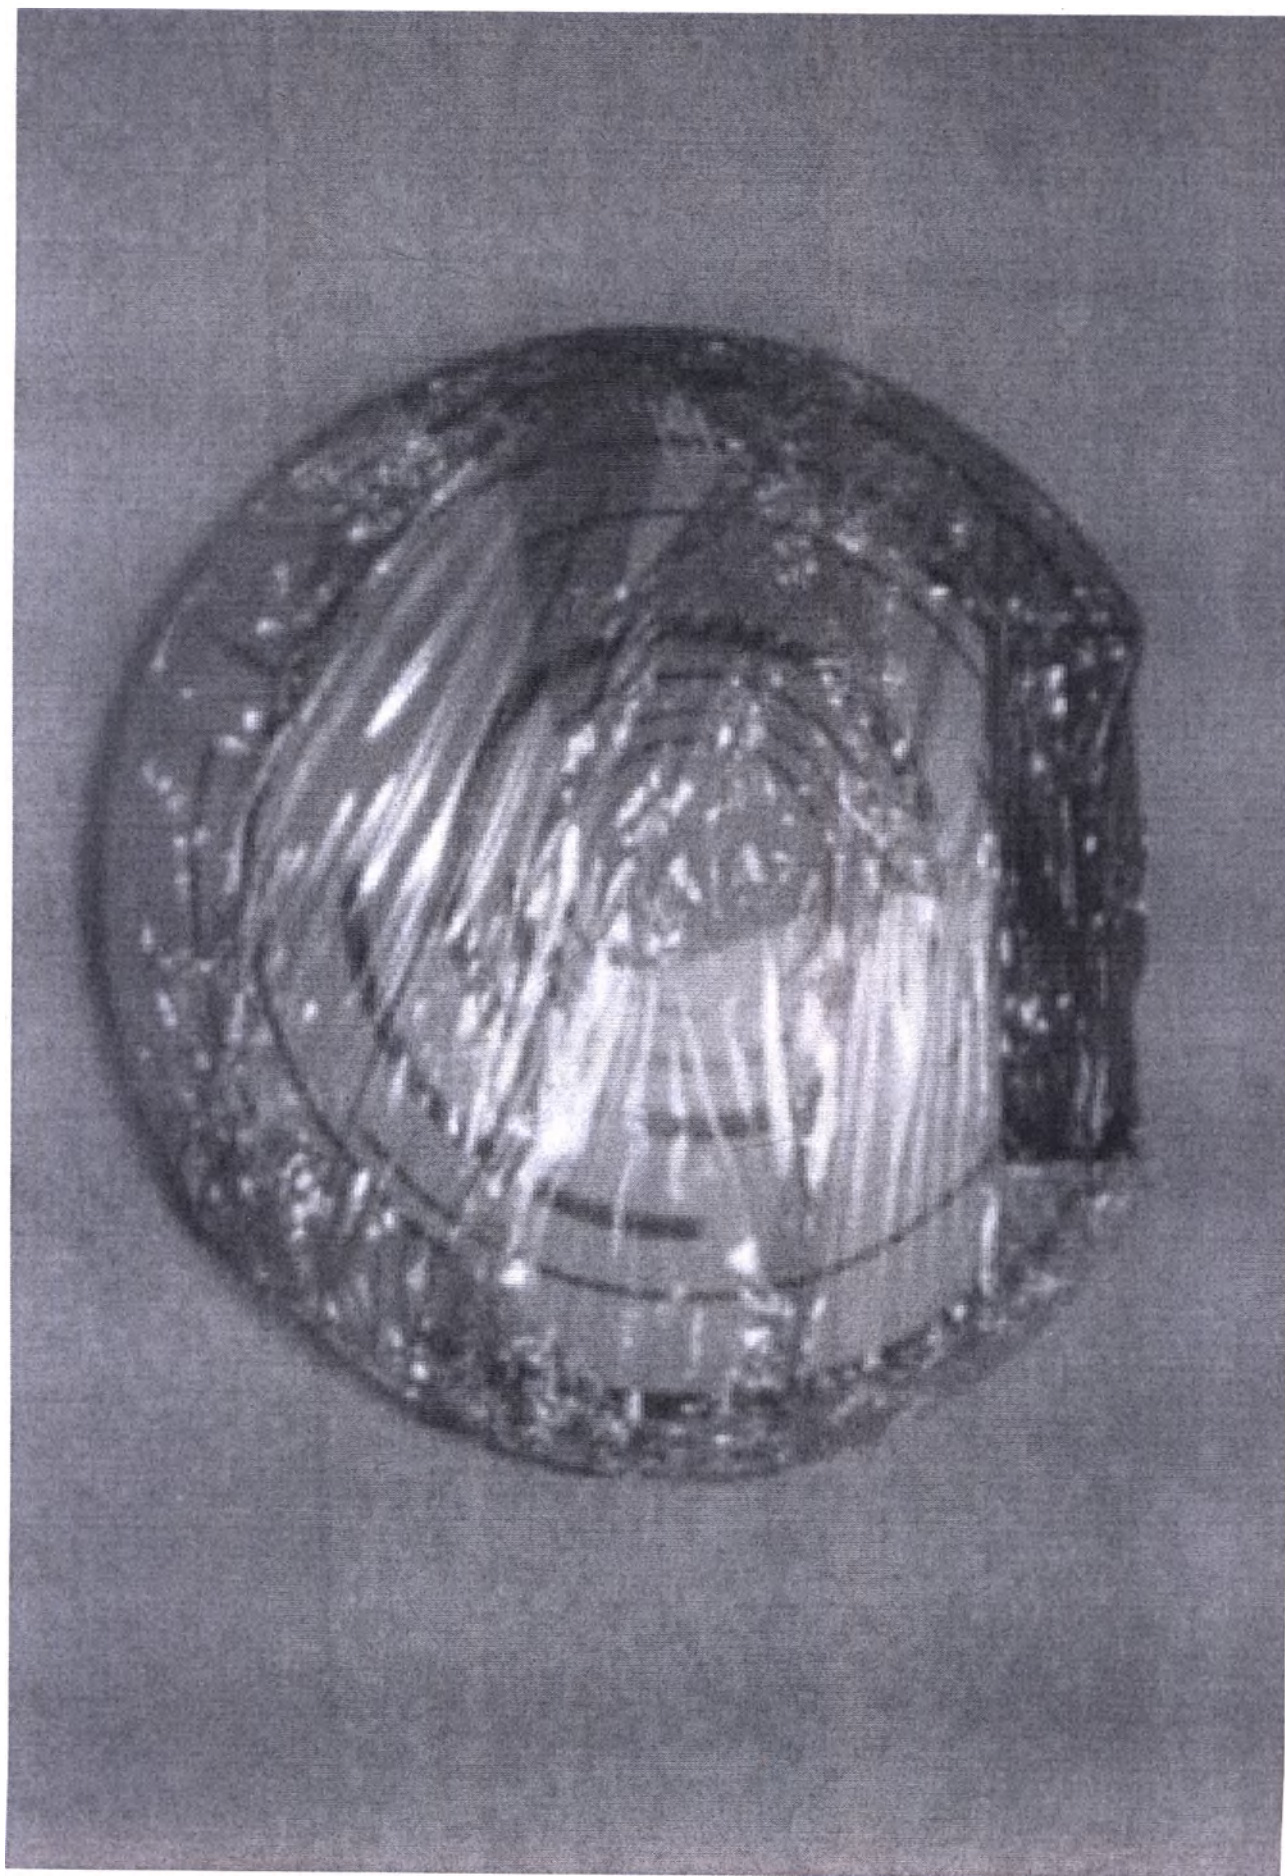


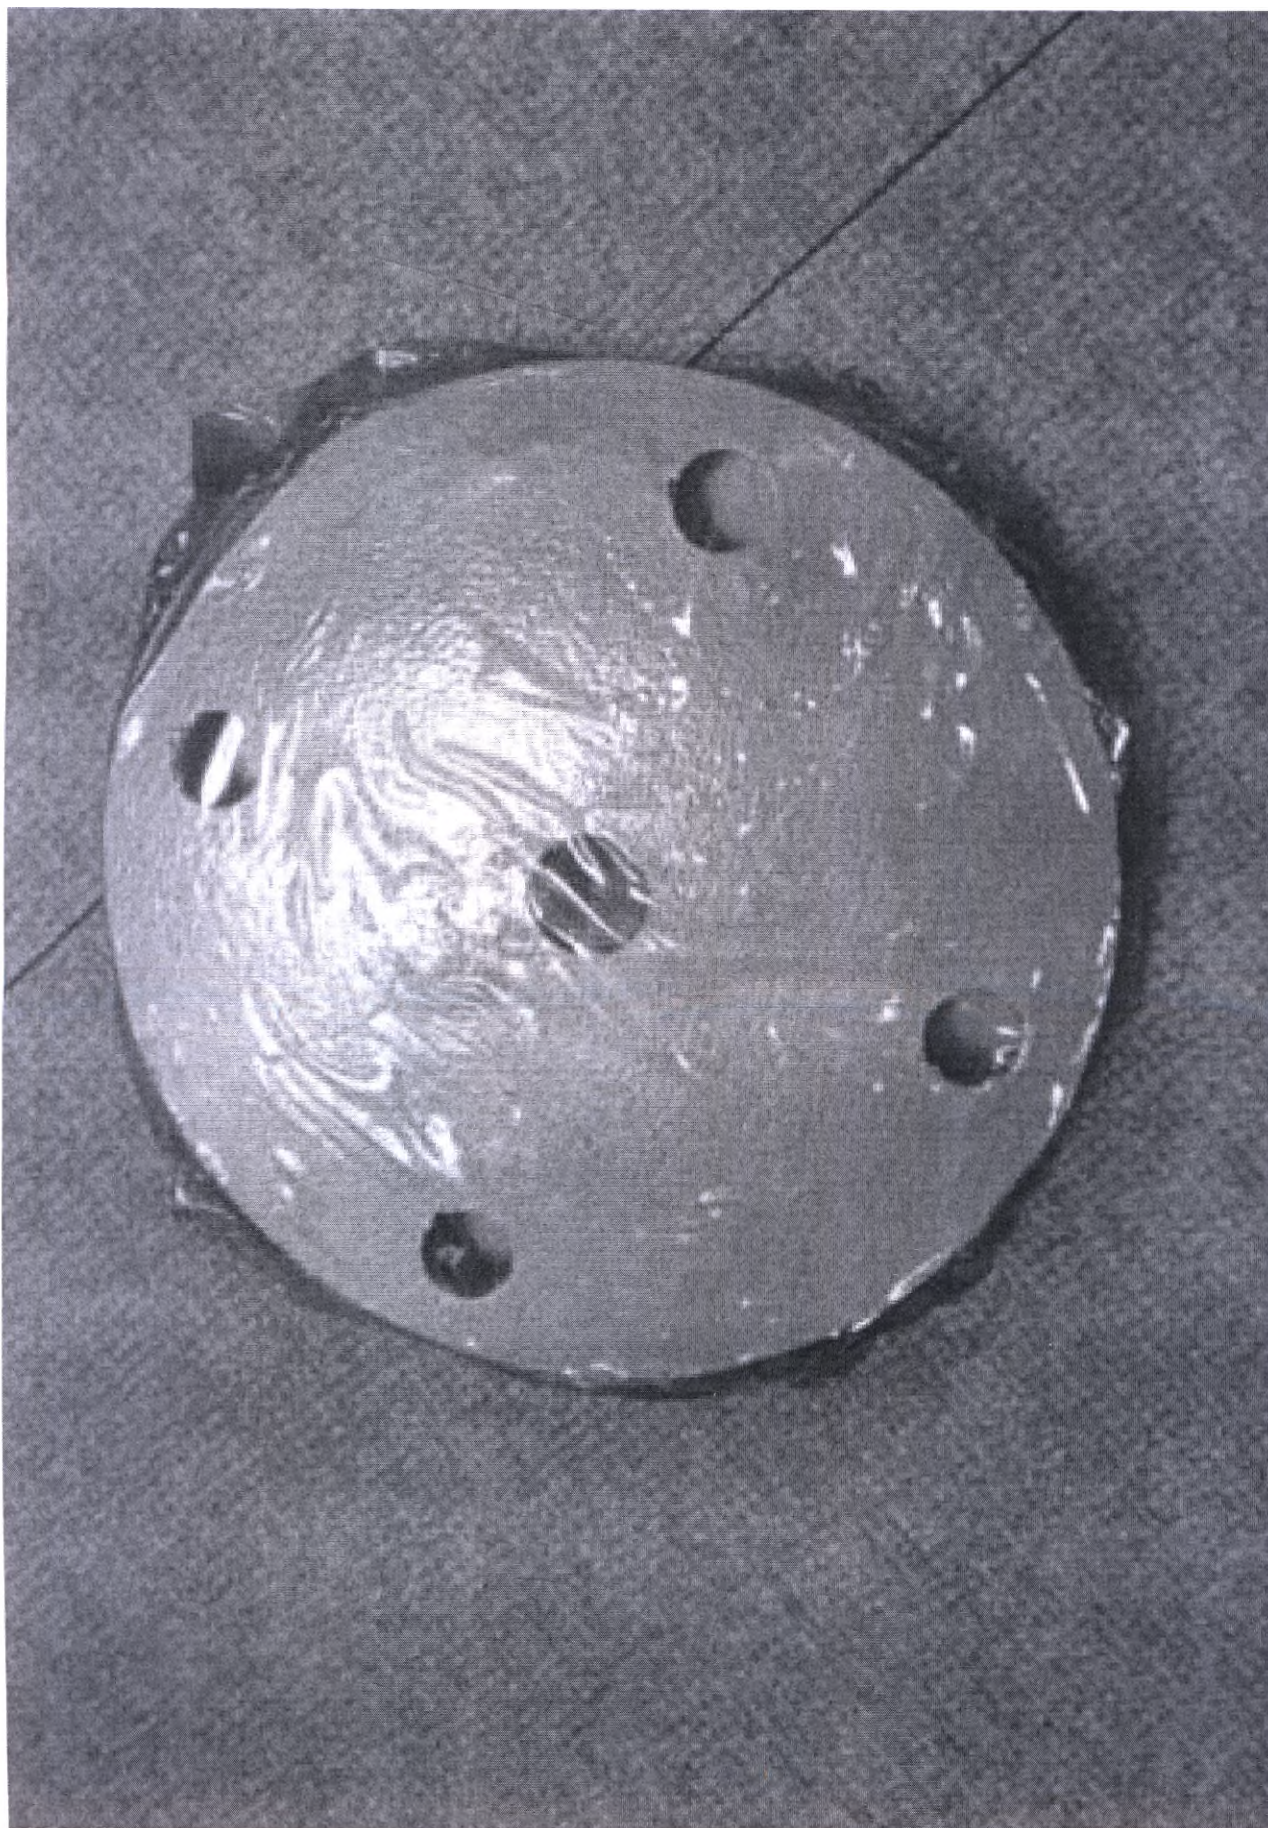

1.14. Соединительный колпак

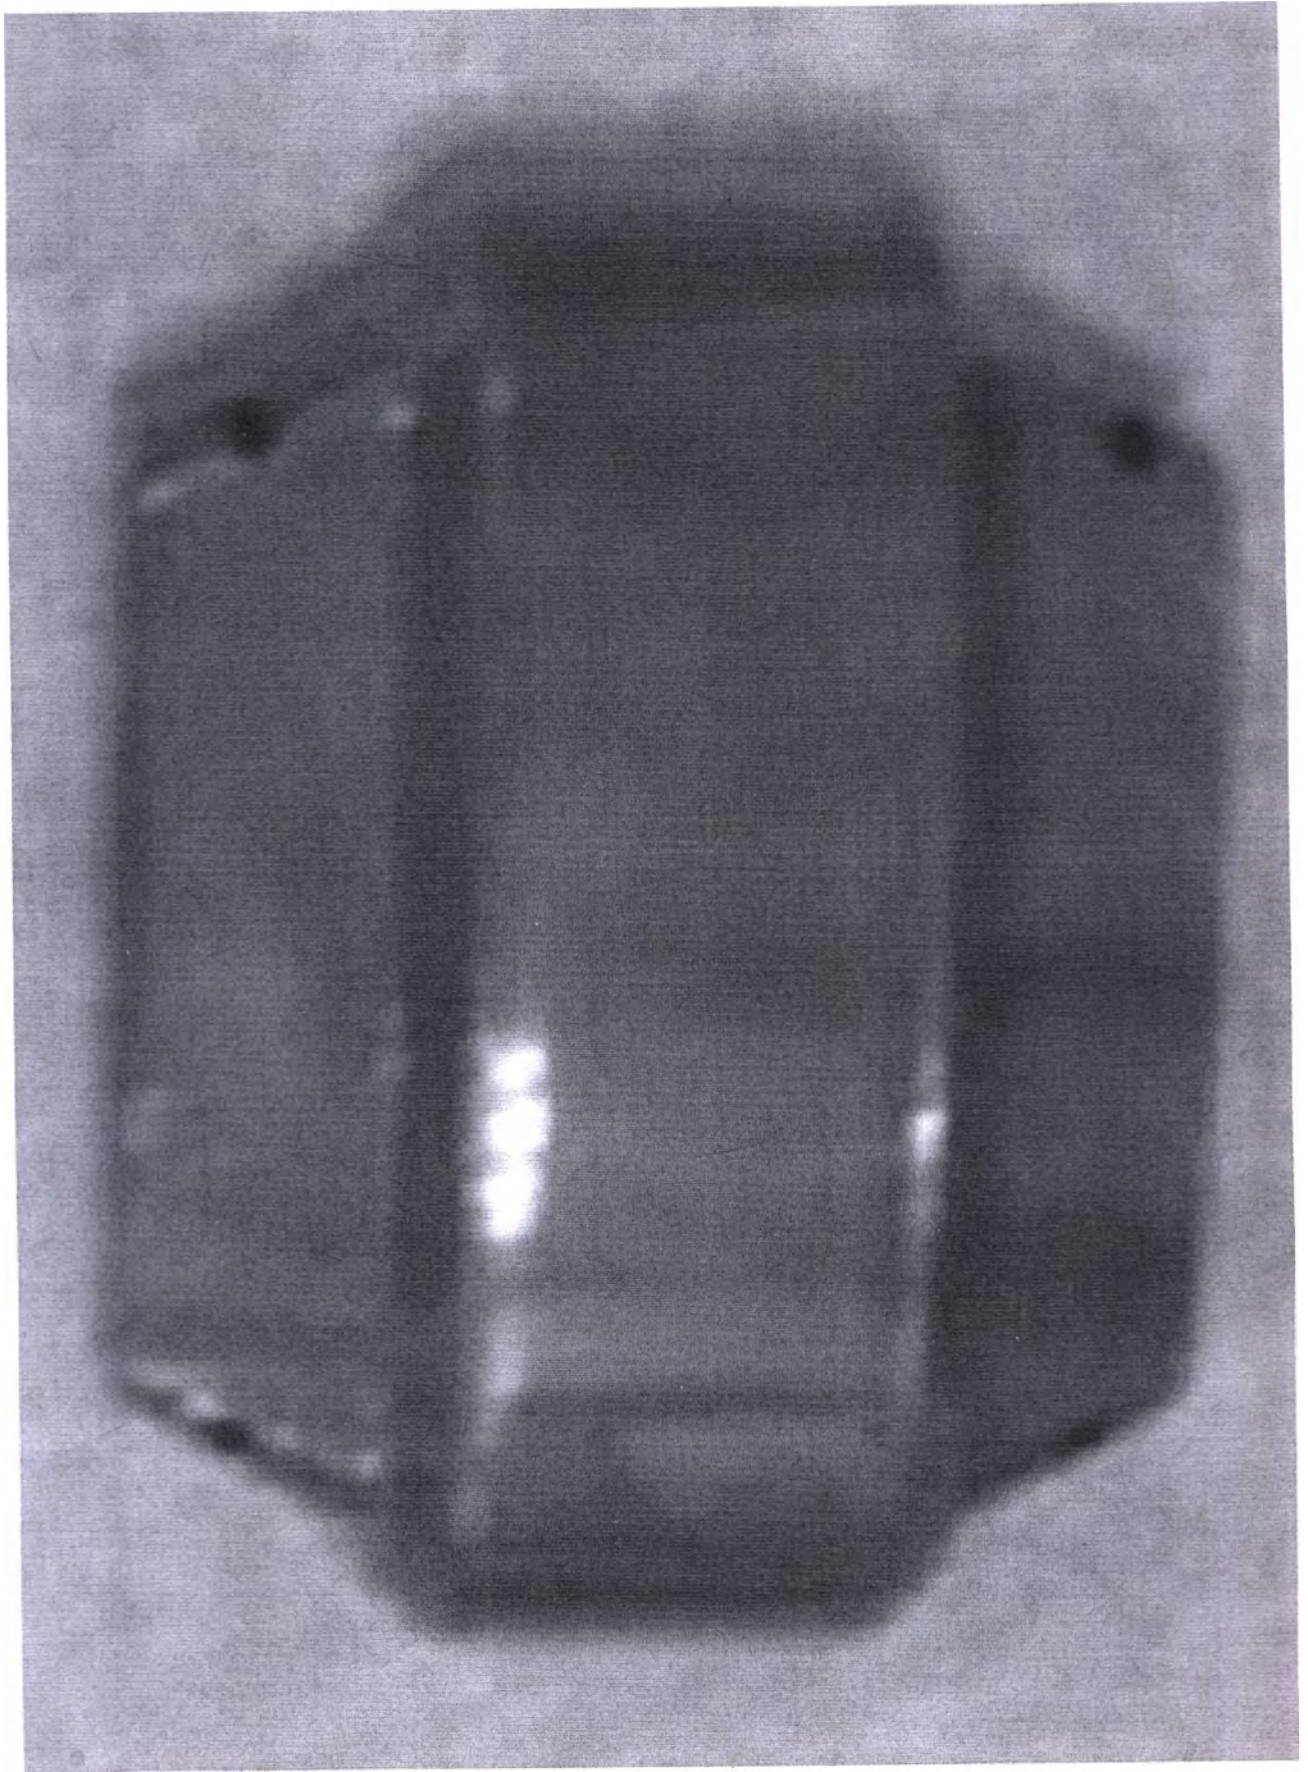


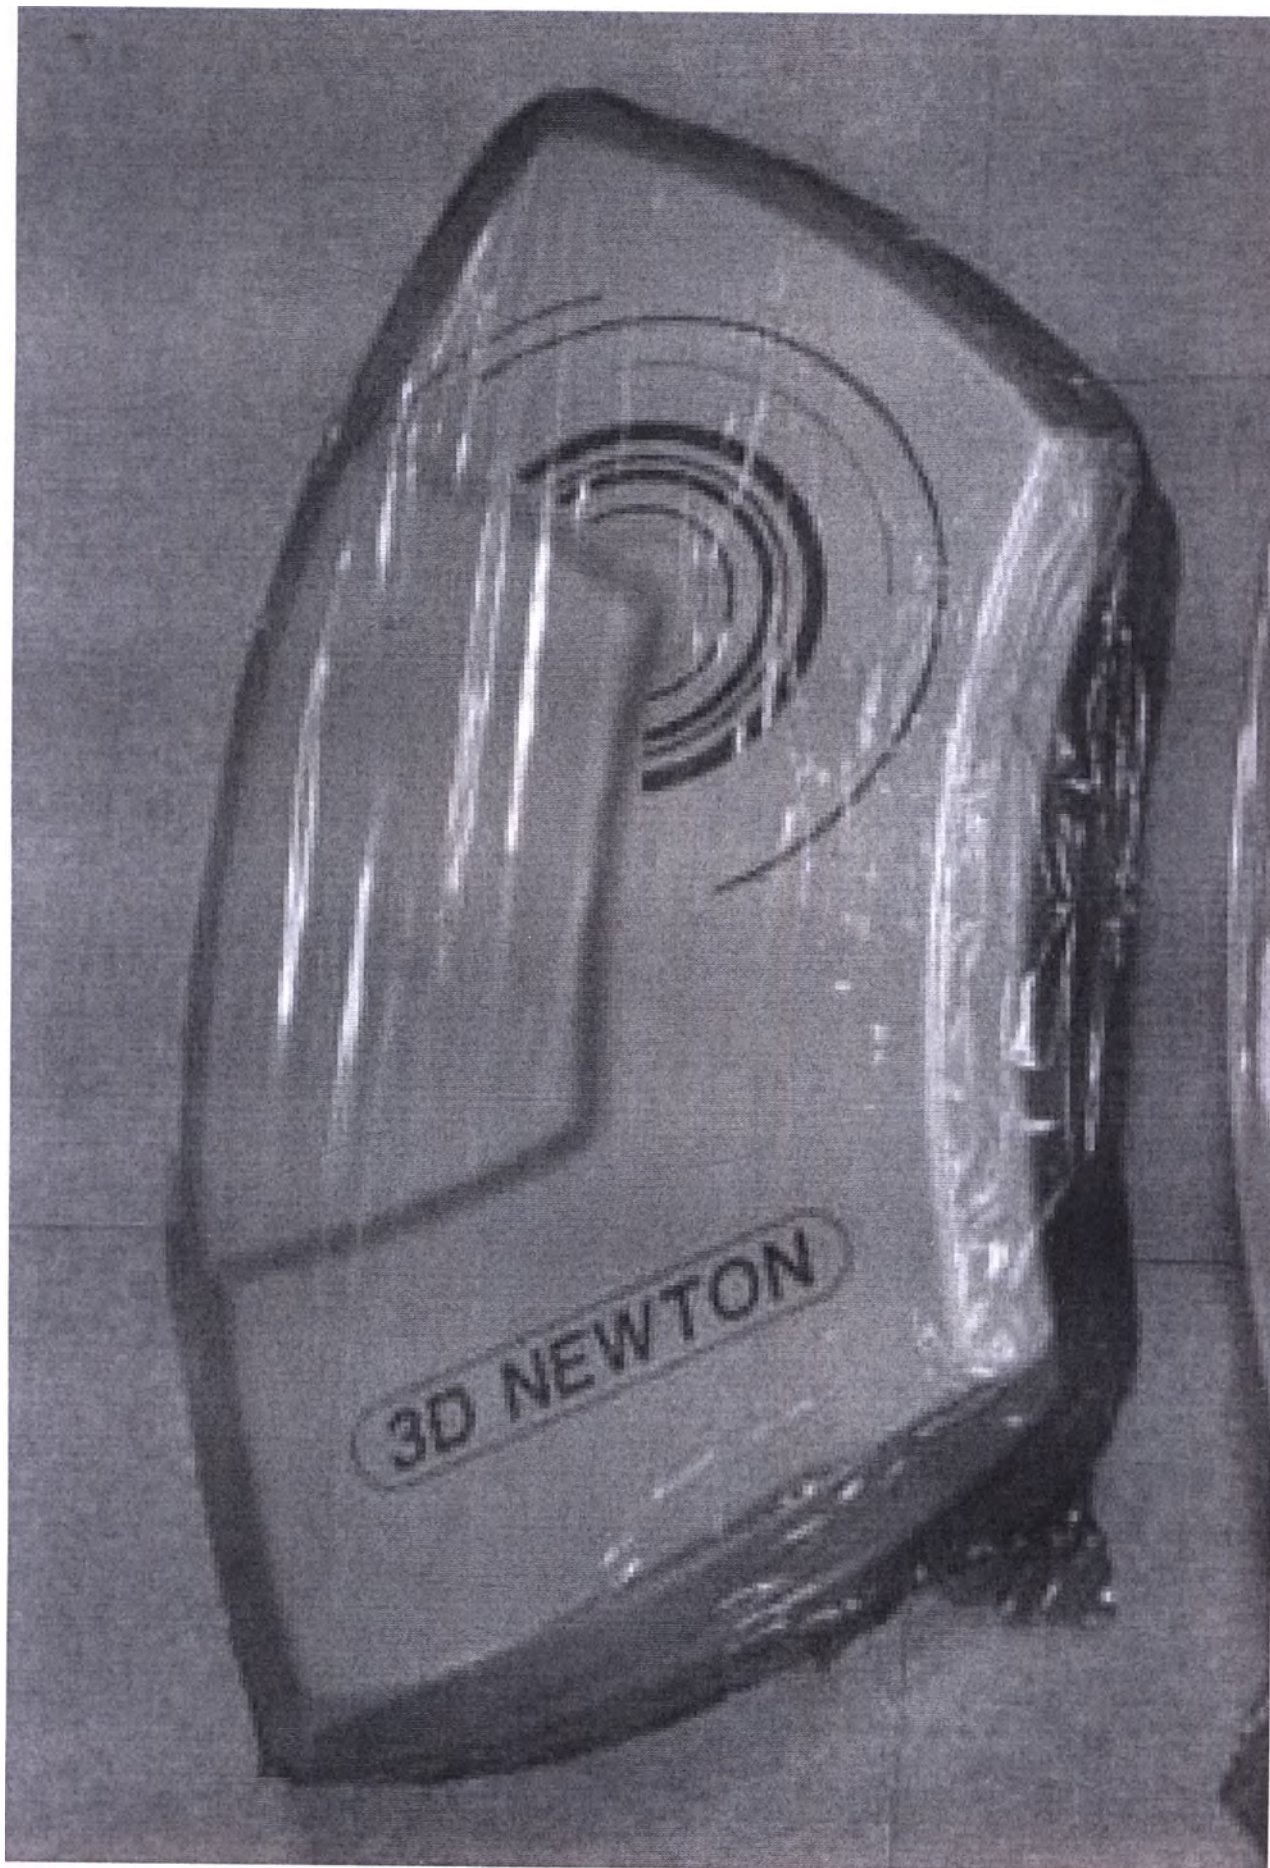

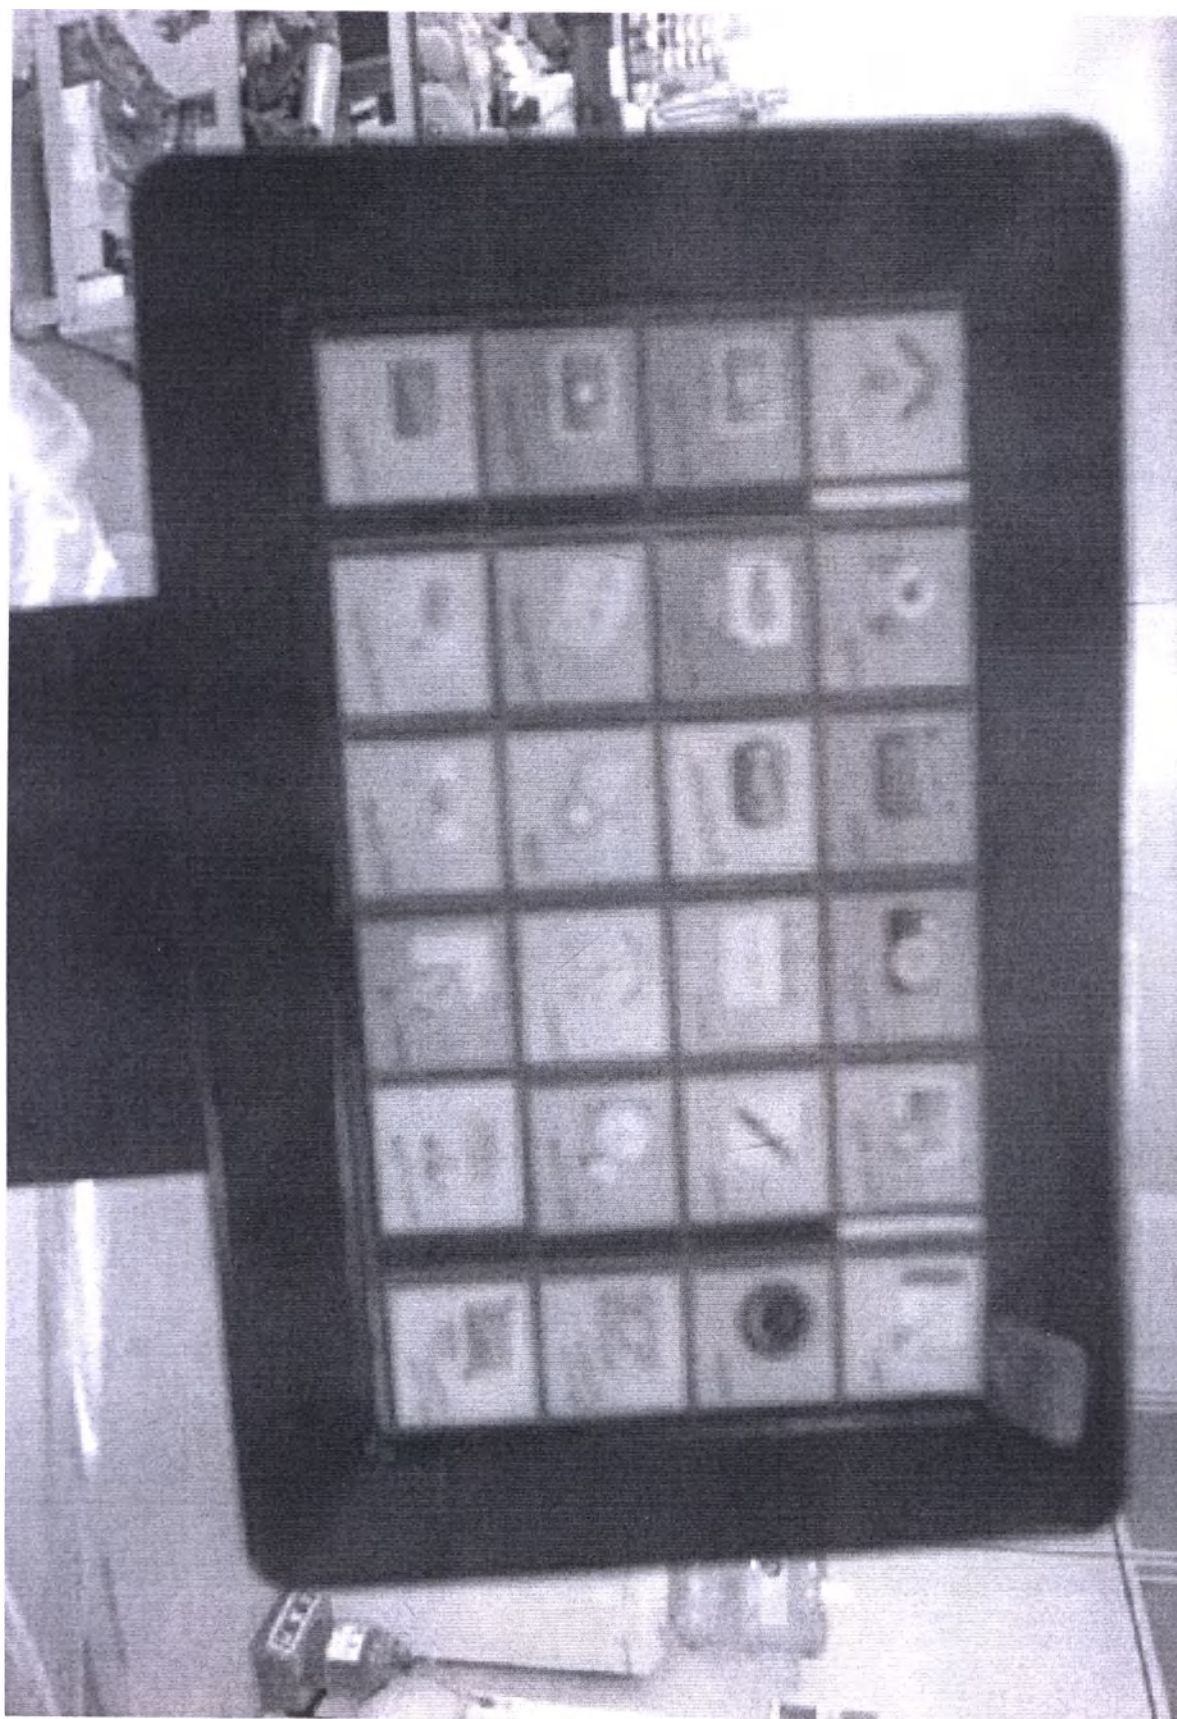


1.17. Круговая крышка



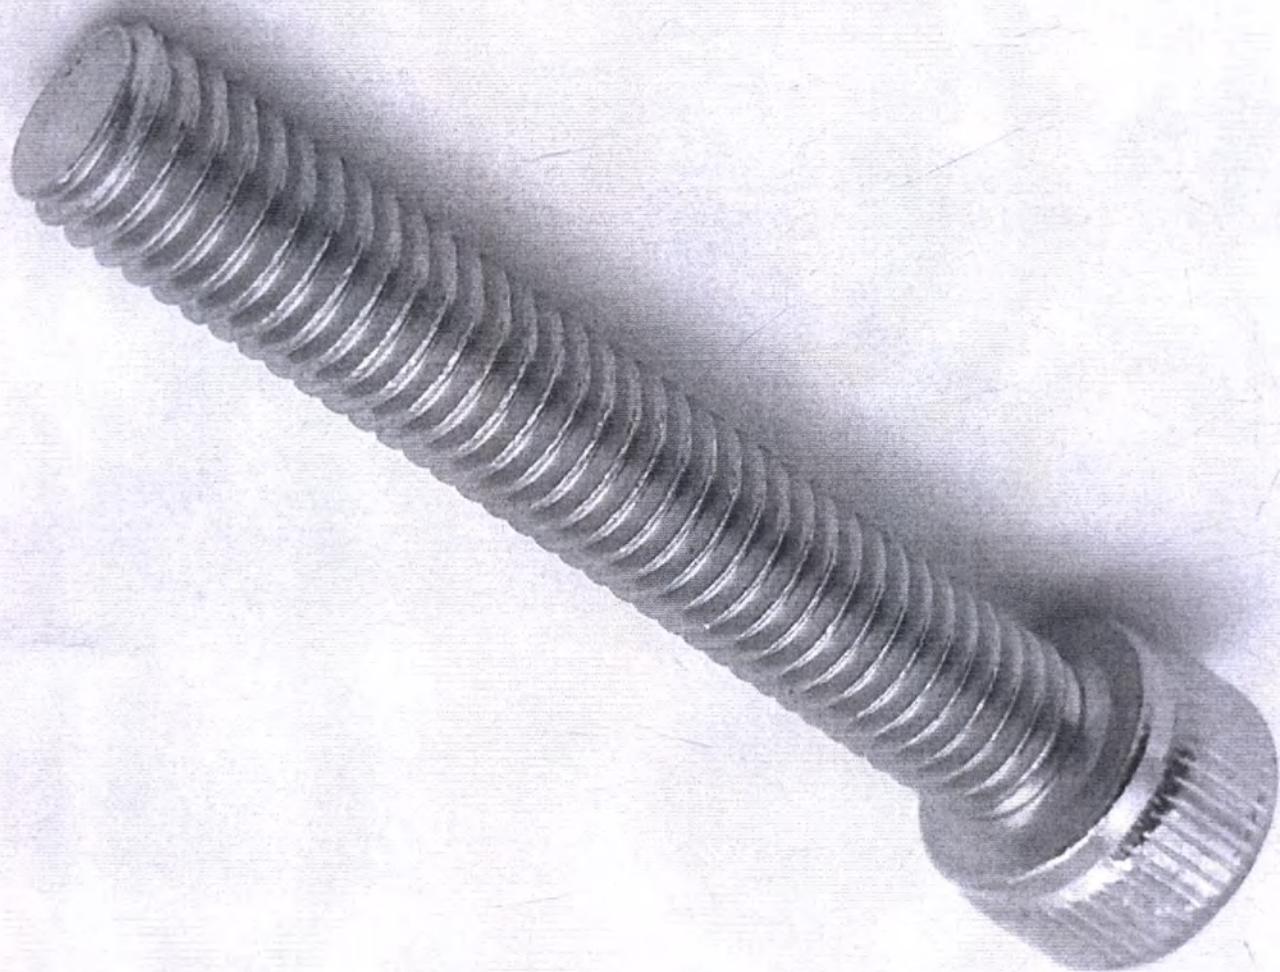





1.20. Пластина для рукоятки

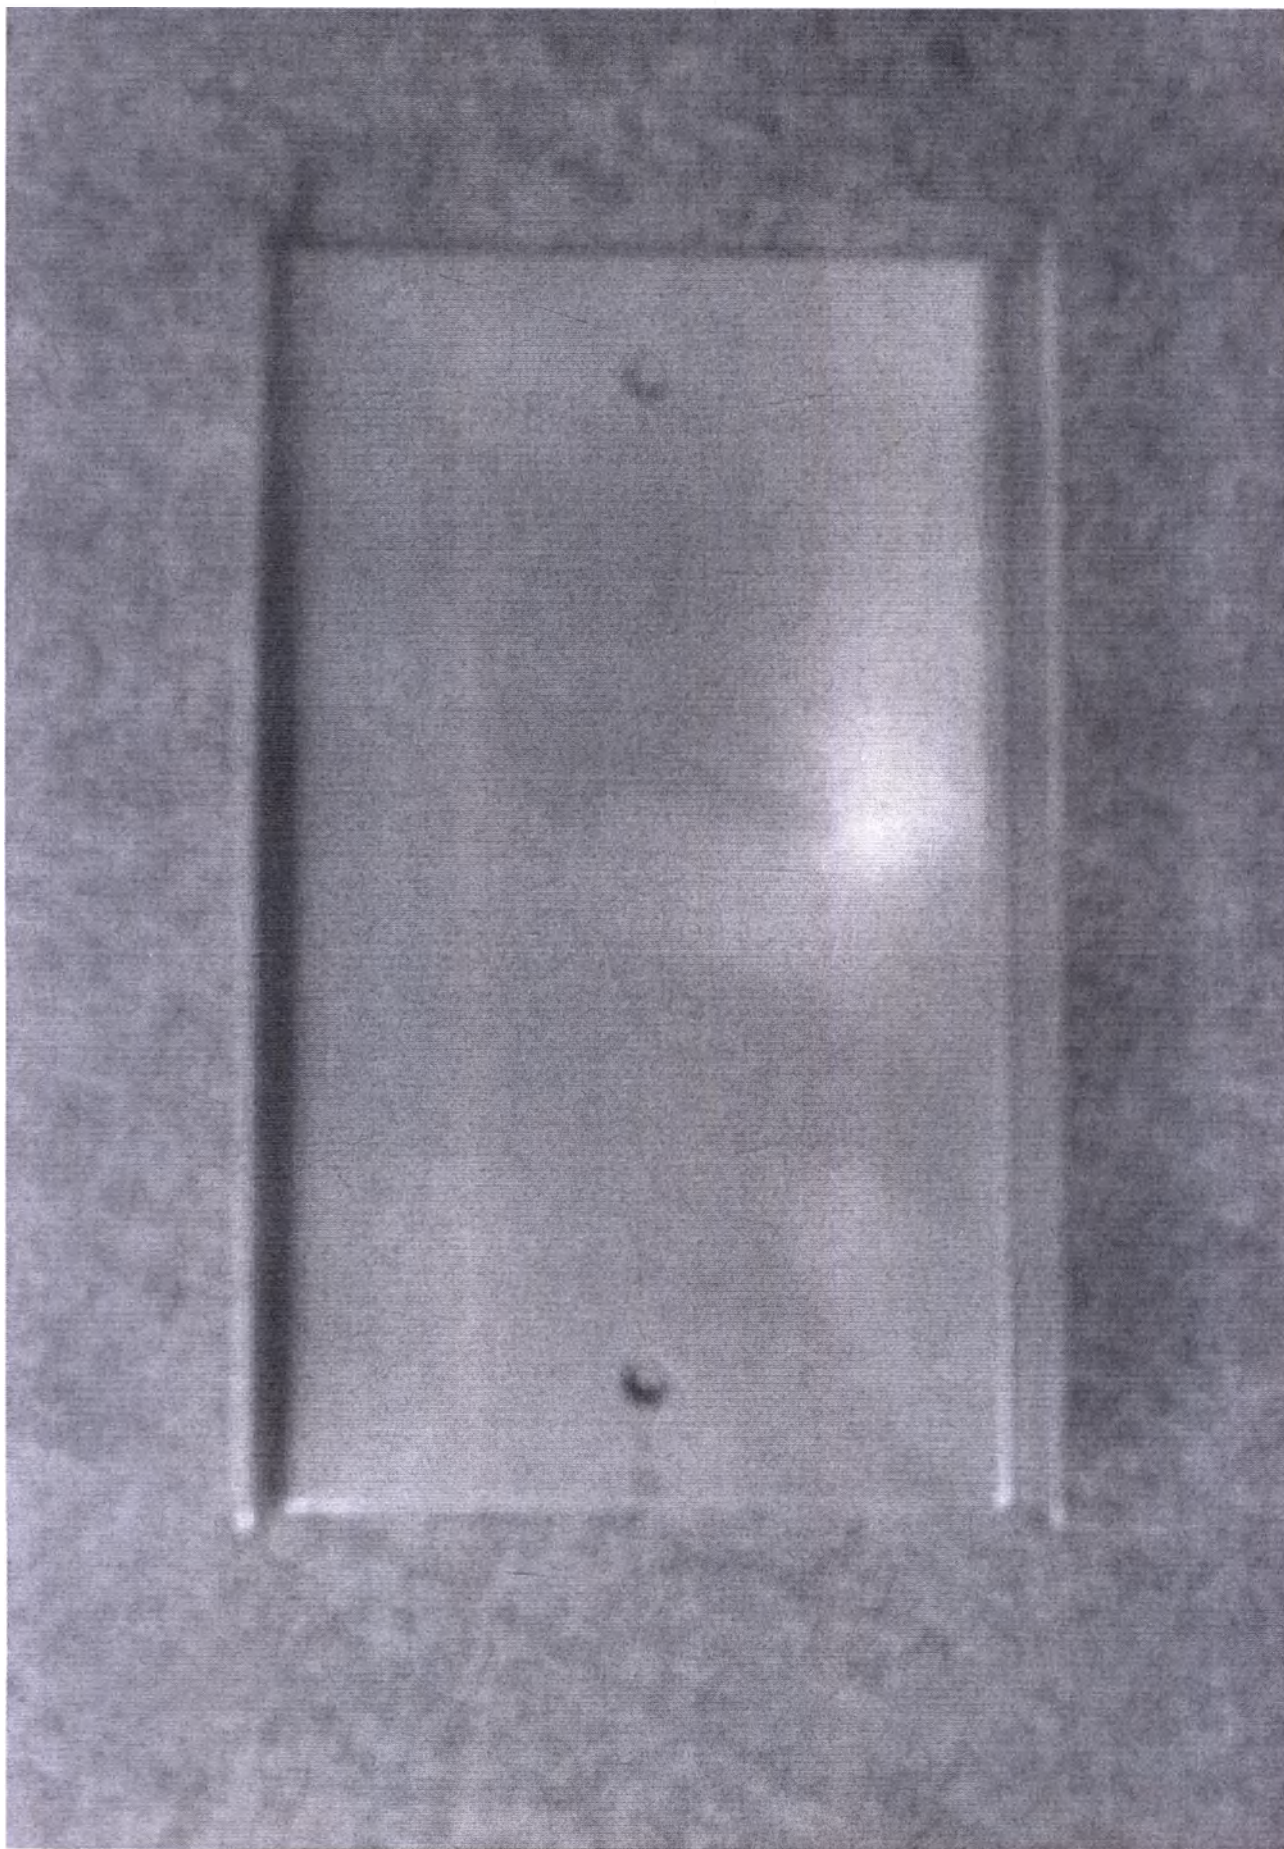

2. Блок управления

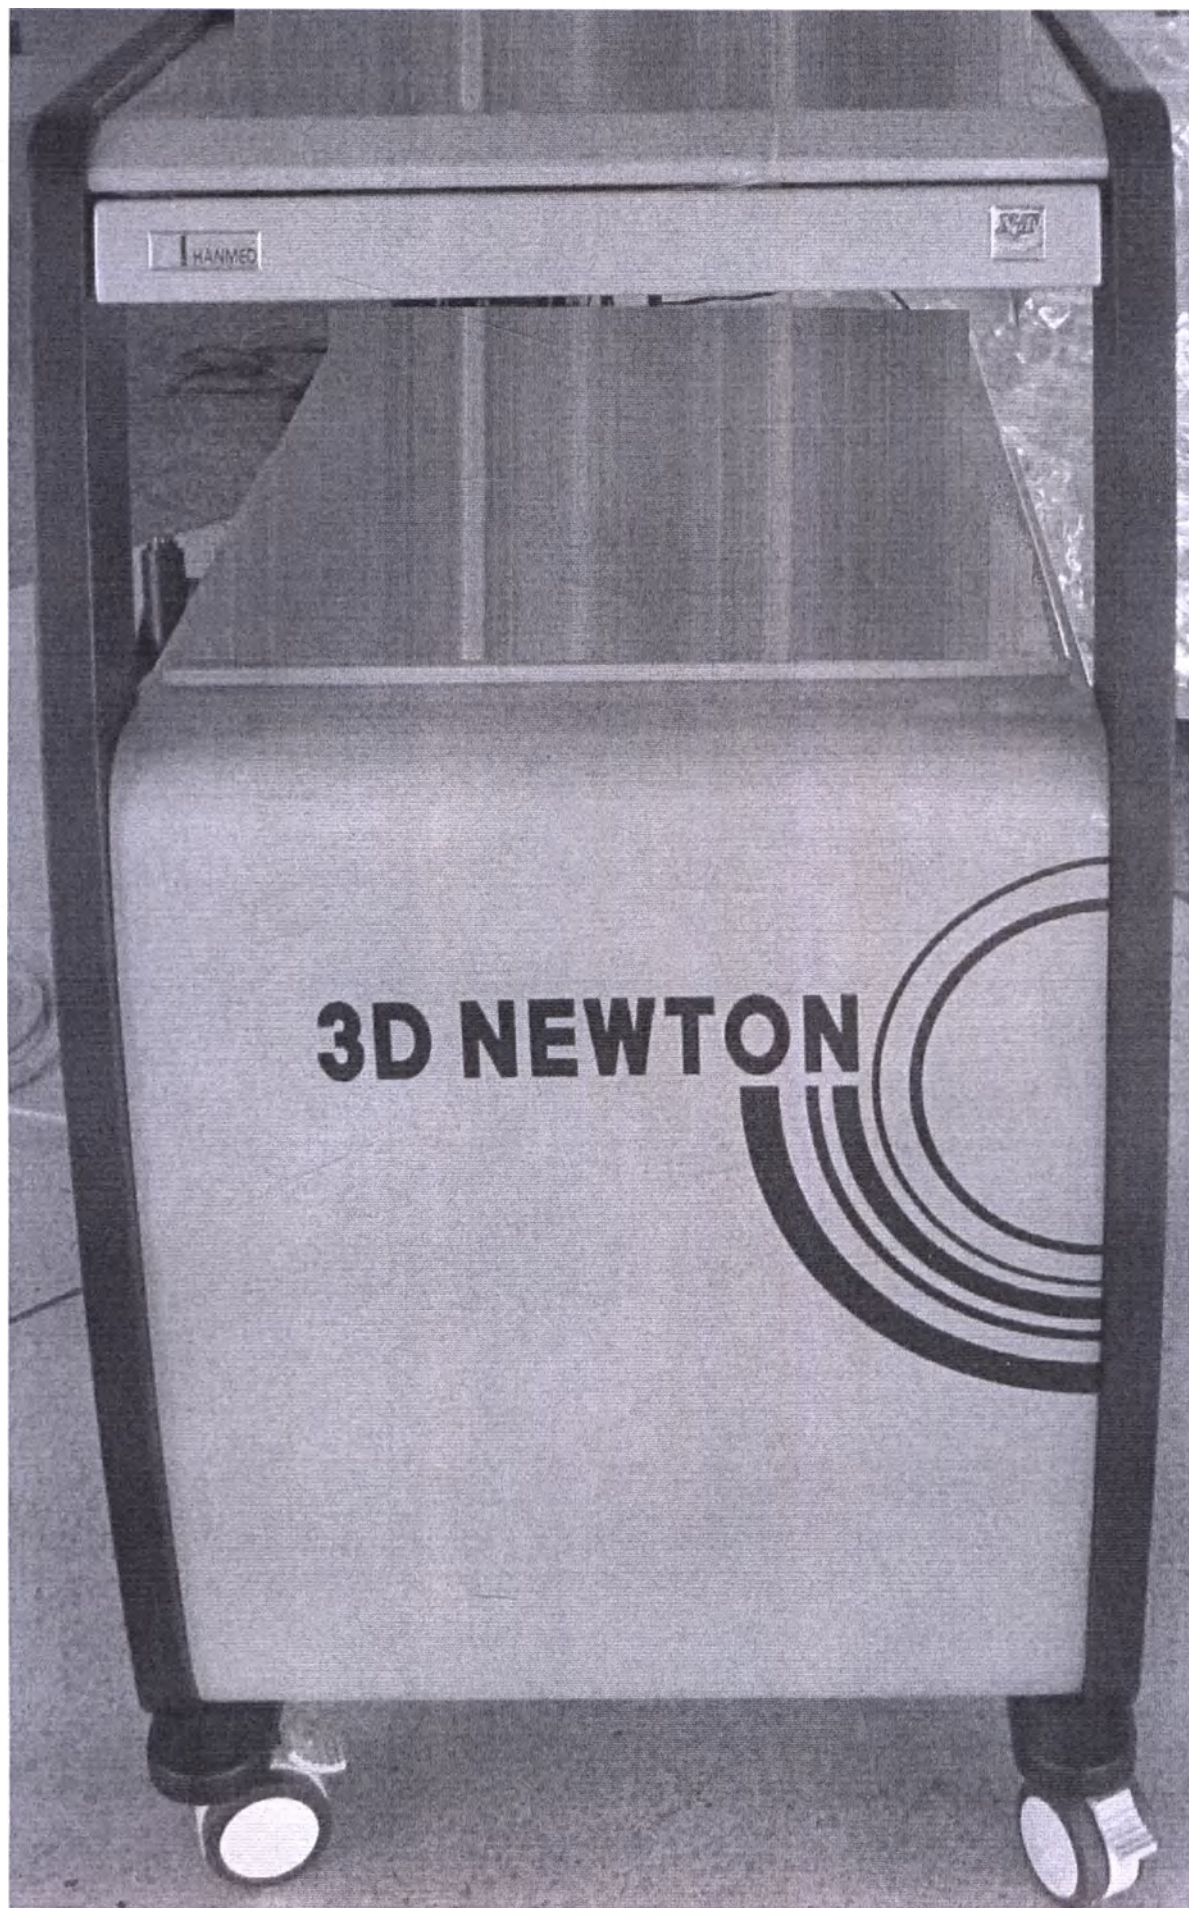

3. Компакт-диск с программным обеспечением «3D NEWTON»

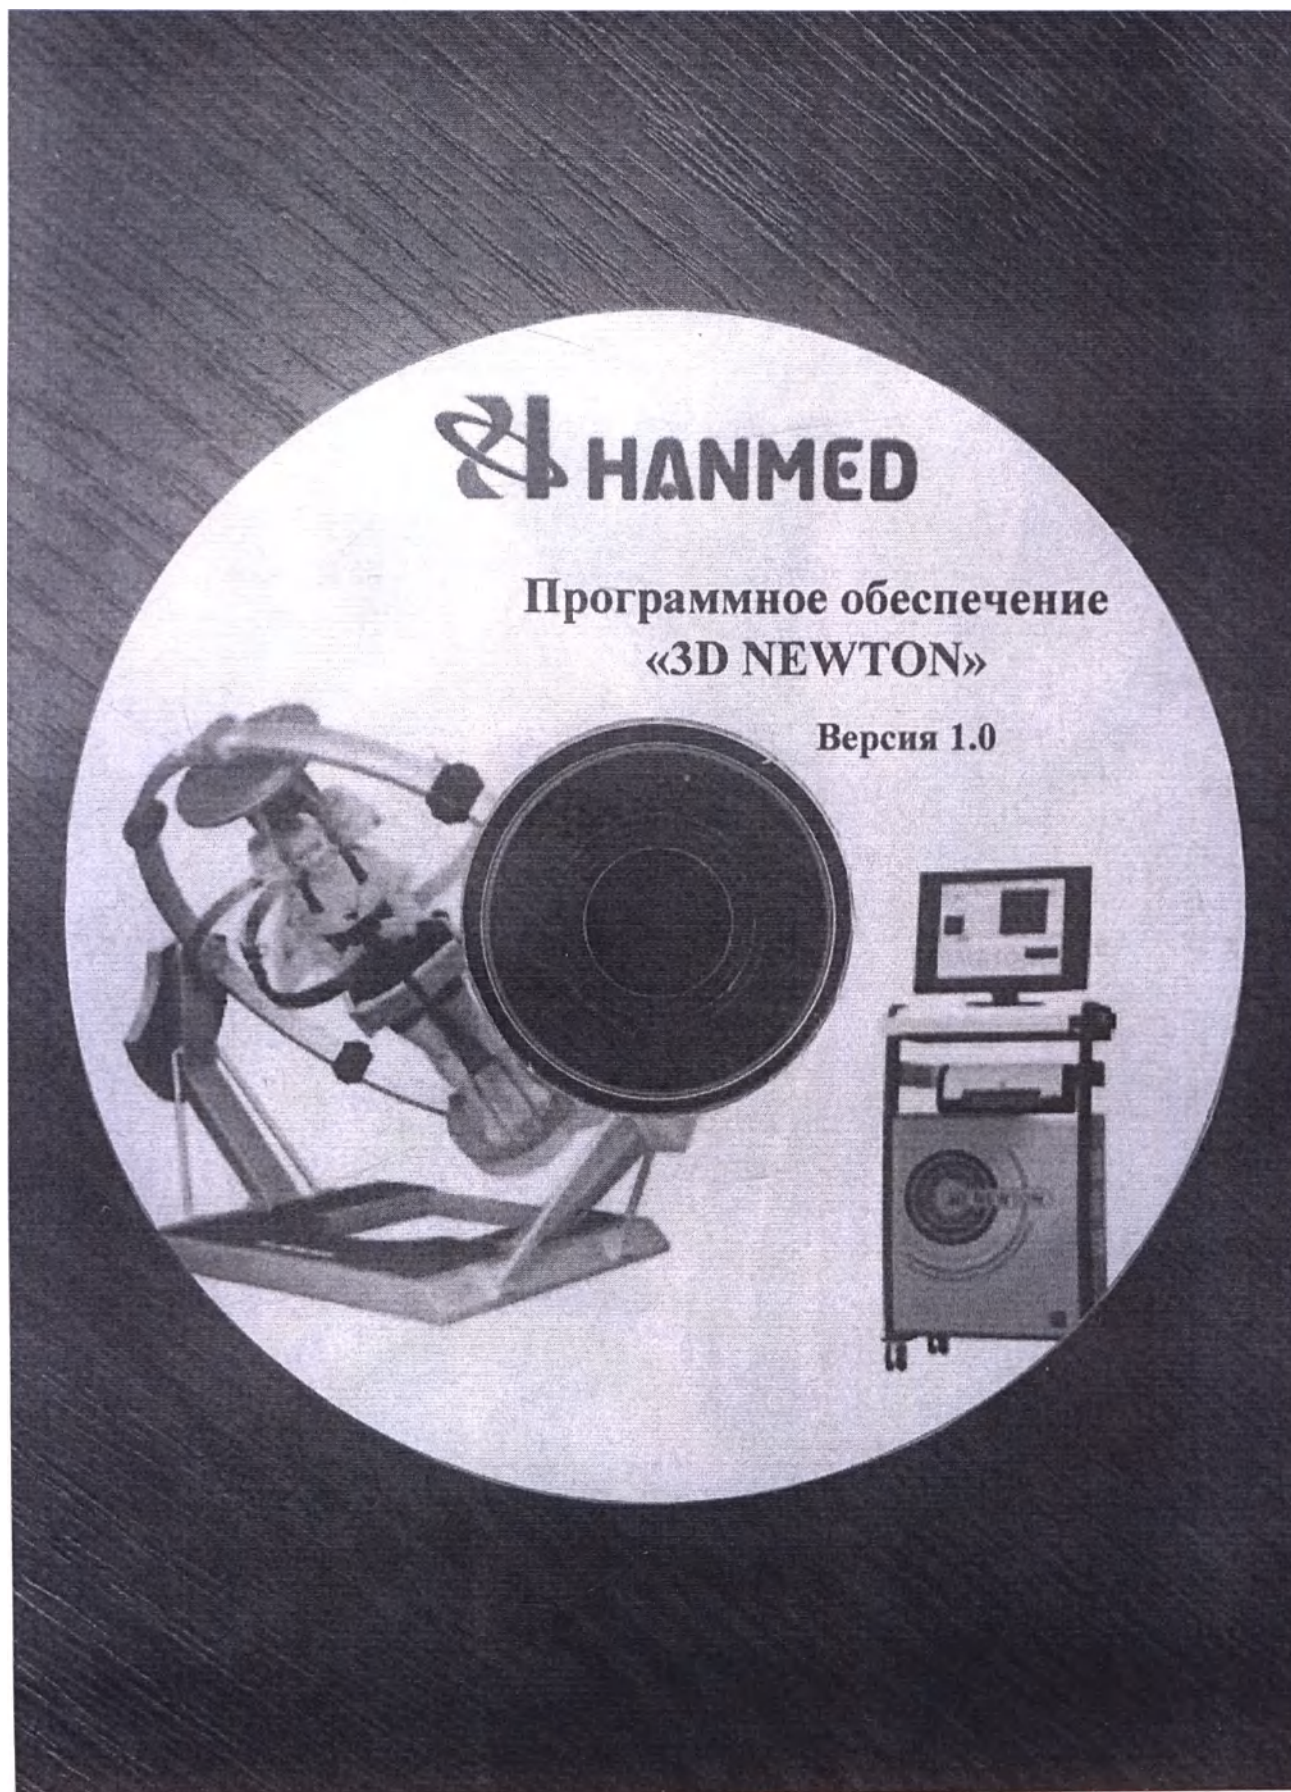

4. Сетевой кабель





Комплекс роботизированный 3D NEWTON для гравитационной терапии



HANMED Co., Ltd.

(ХАНМЕД Ко., Лтд.)

B-101, HANMED, 80-121, Golden root-ro, Juchon-myeon,
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea

Питание: 220 В, $\sim$ 50Гц

IP 20



Потребляемая мощность, не более: 400 Вт

Максимальный рабочий цикл: 60 мин – работа, 20 мин - пауза



NT-17101501



10.2017 г.



прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 25 лист(ов)

Управляющий ООО «КГБ»
индивидуальный предприниматель

Богатов Е.А. Богатов
«15» сентября 20 20

