



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система для лечения недержания мочи у женщин STEEMA Retropubic


(Promedon S.A. (Промедон С.А.), Аргентина)

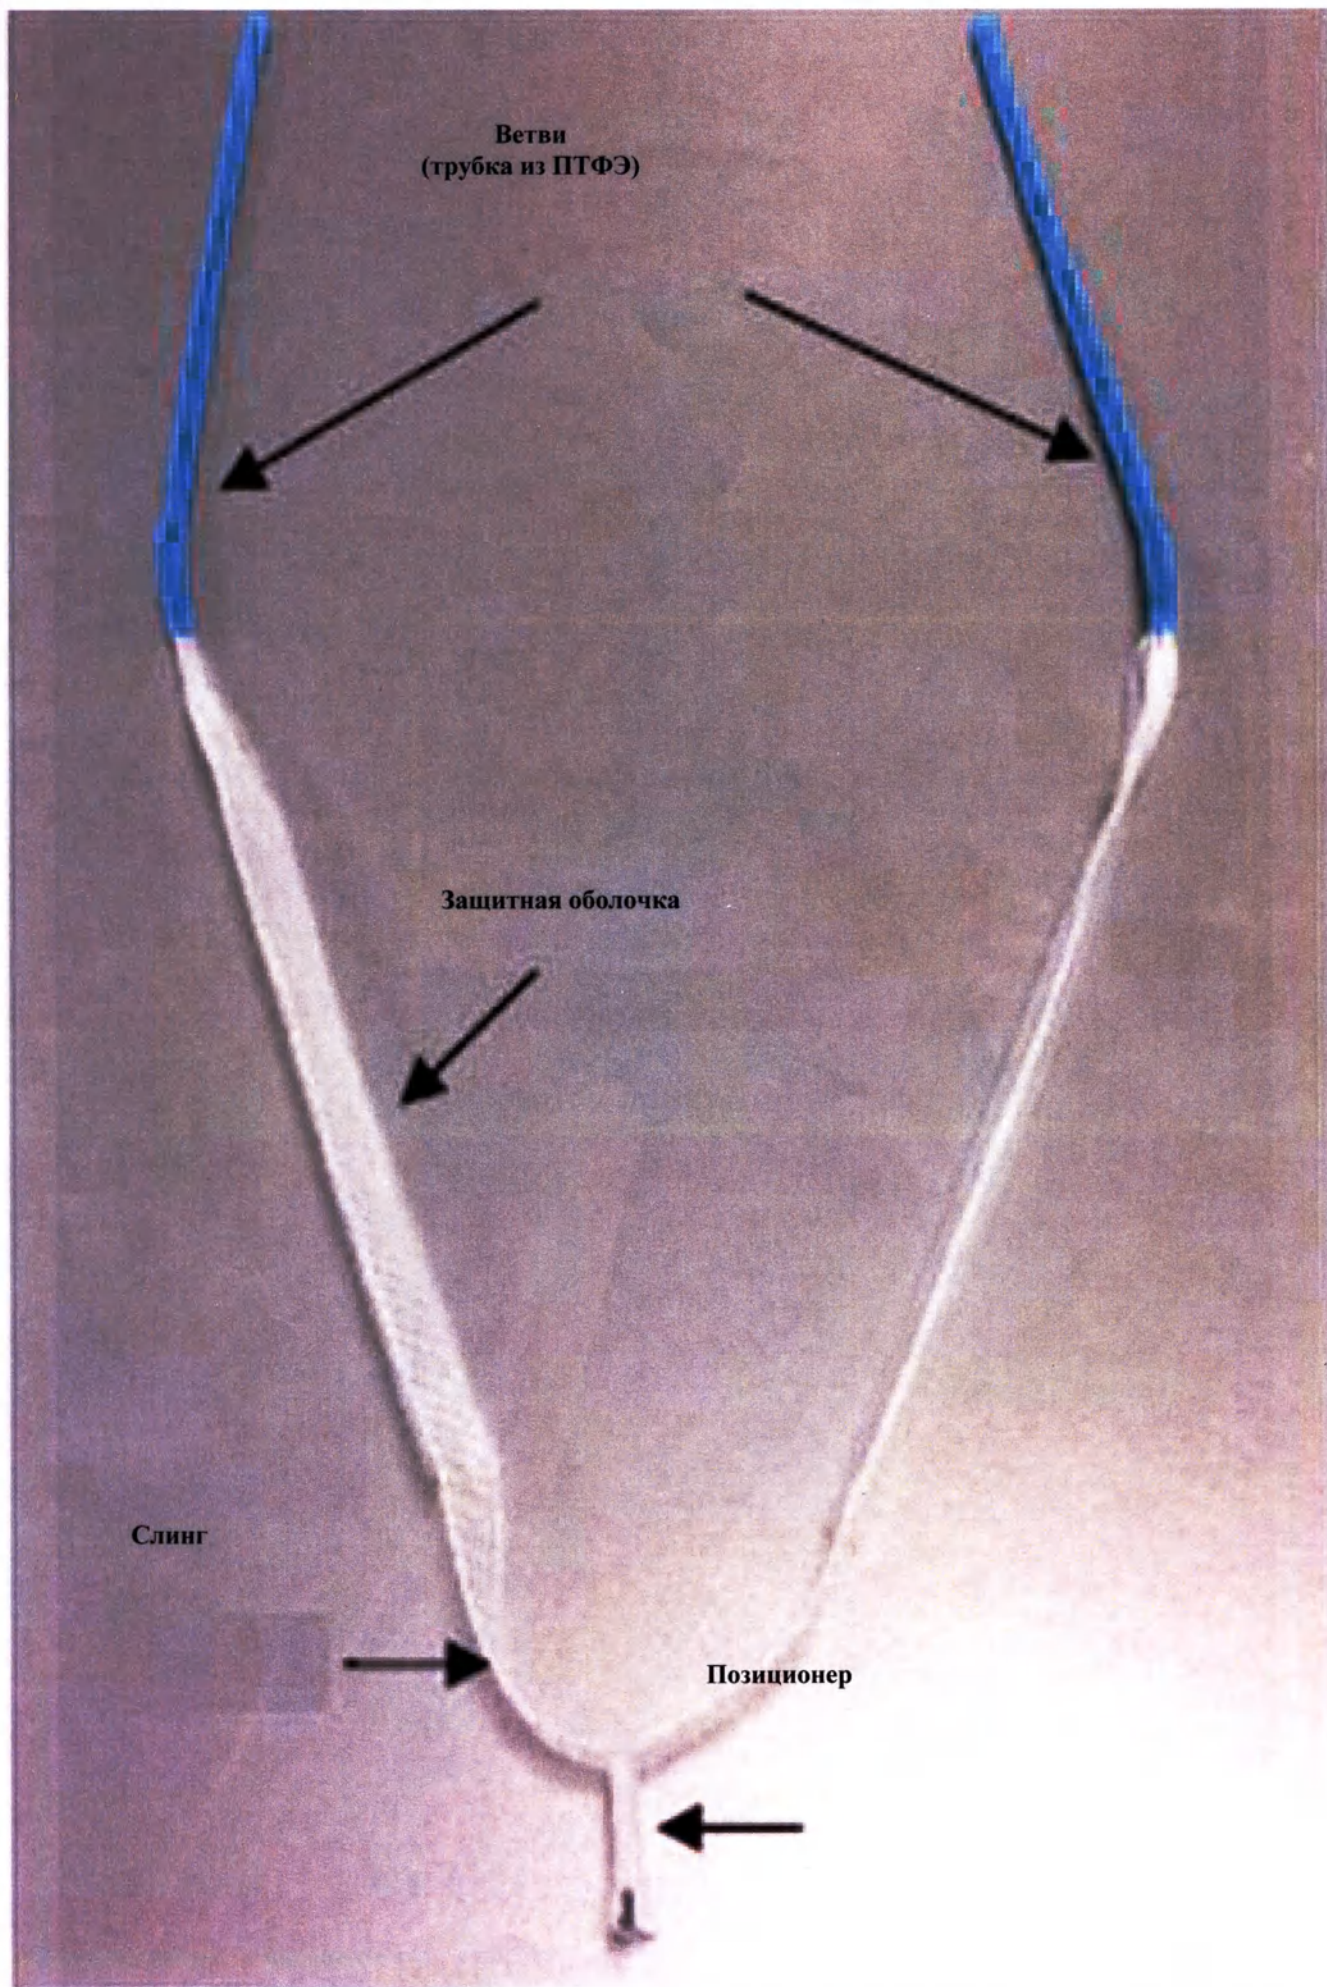


Фотографическое изображение 1: Внешний вид МИ: Слинг Steeta Retropubic с указанием компонентов

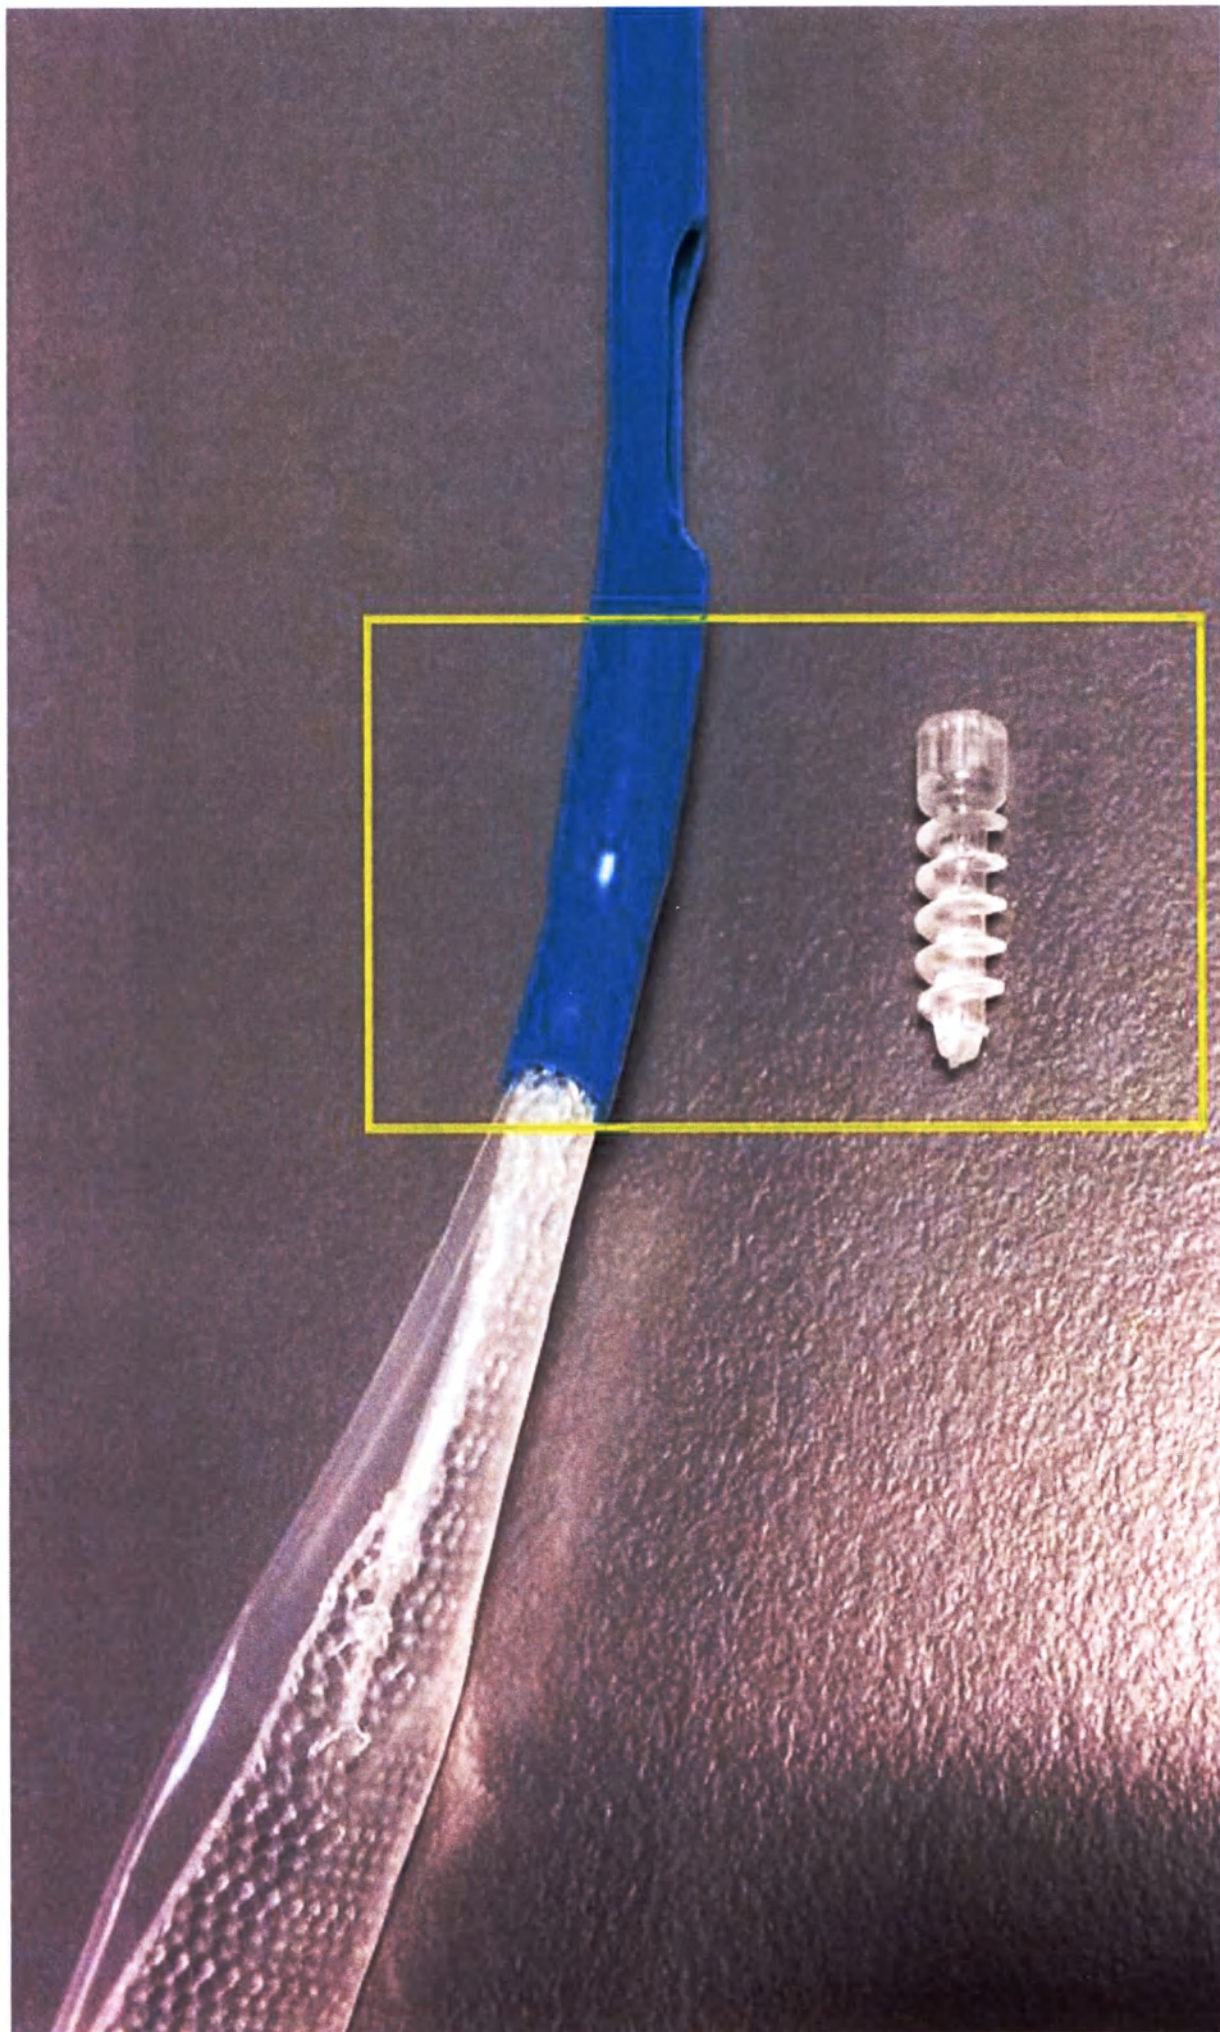


Фотографическое изображение 2.1. Внешний вид – Фиксирующие винты

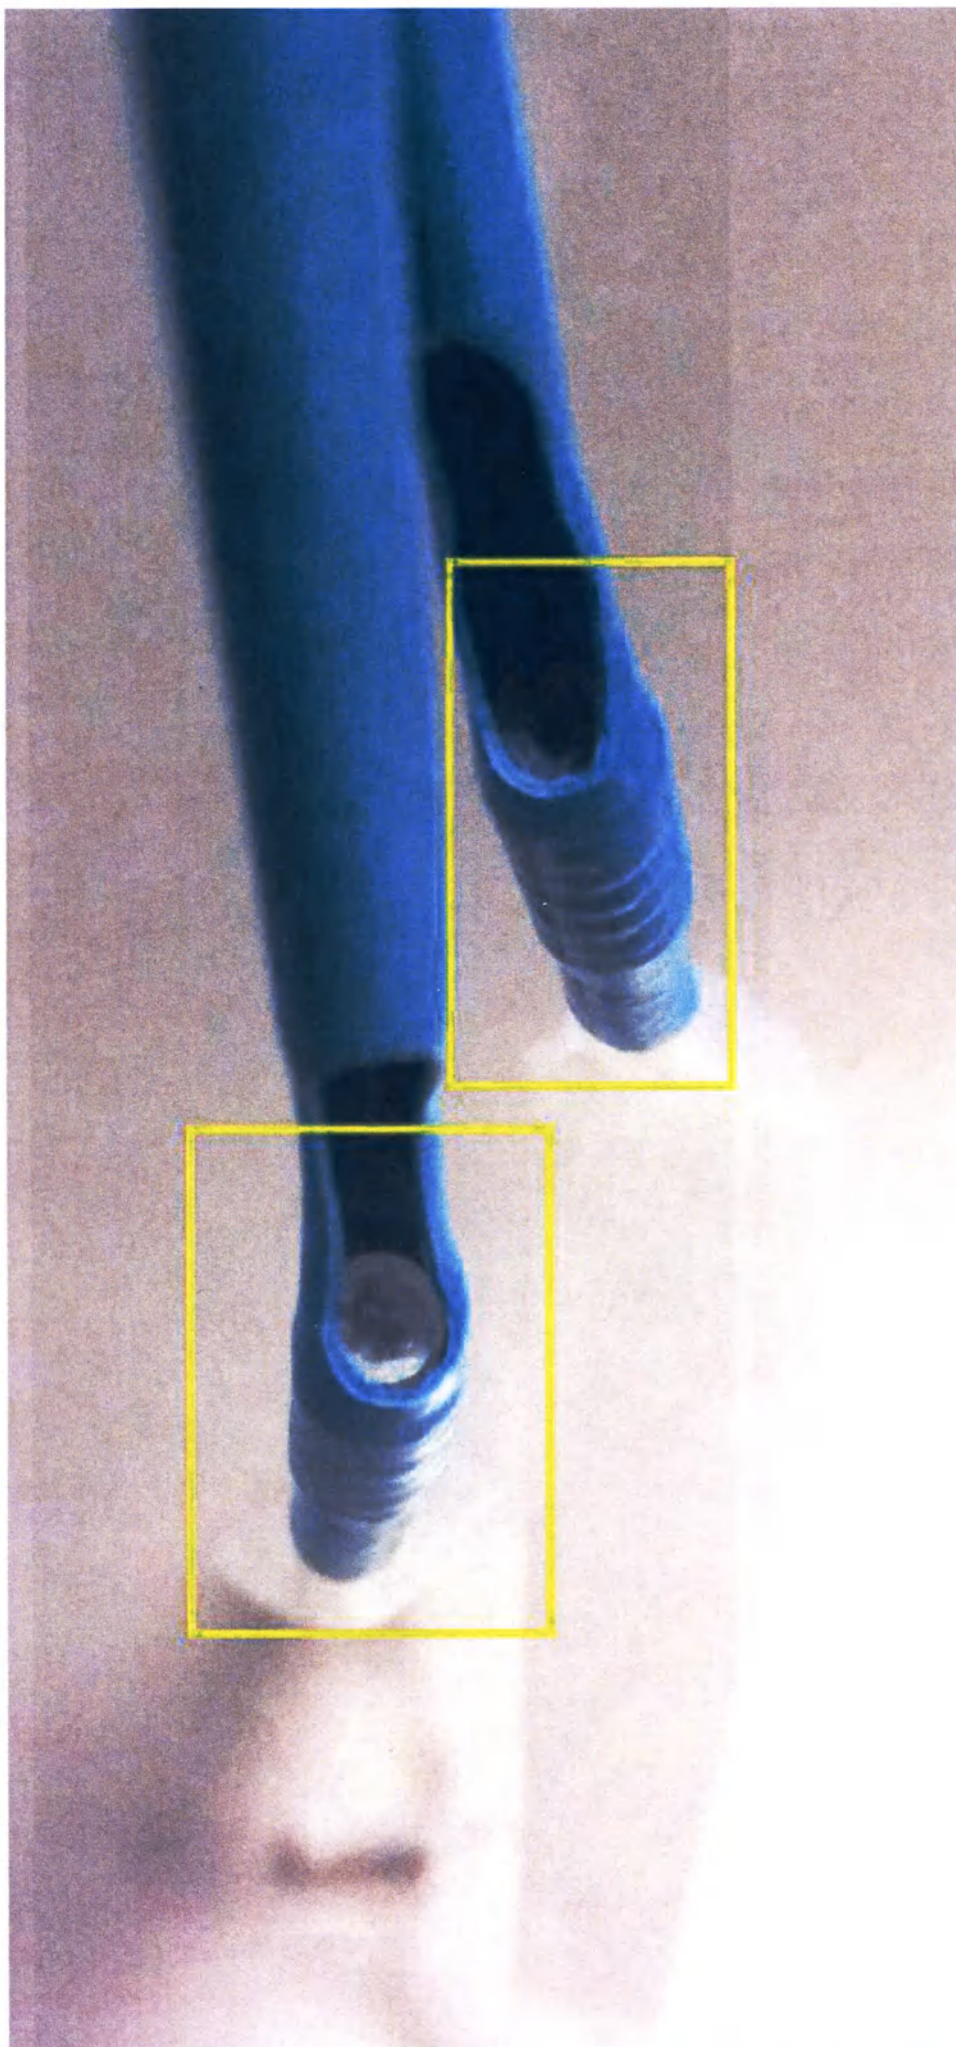

Фотографическое изображение 2.2. Внешний вид – Фиксирующие винты

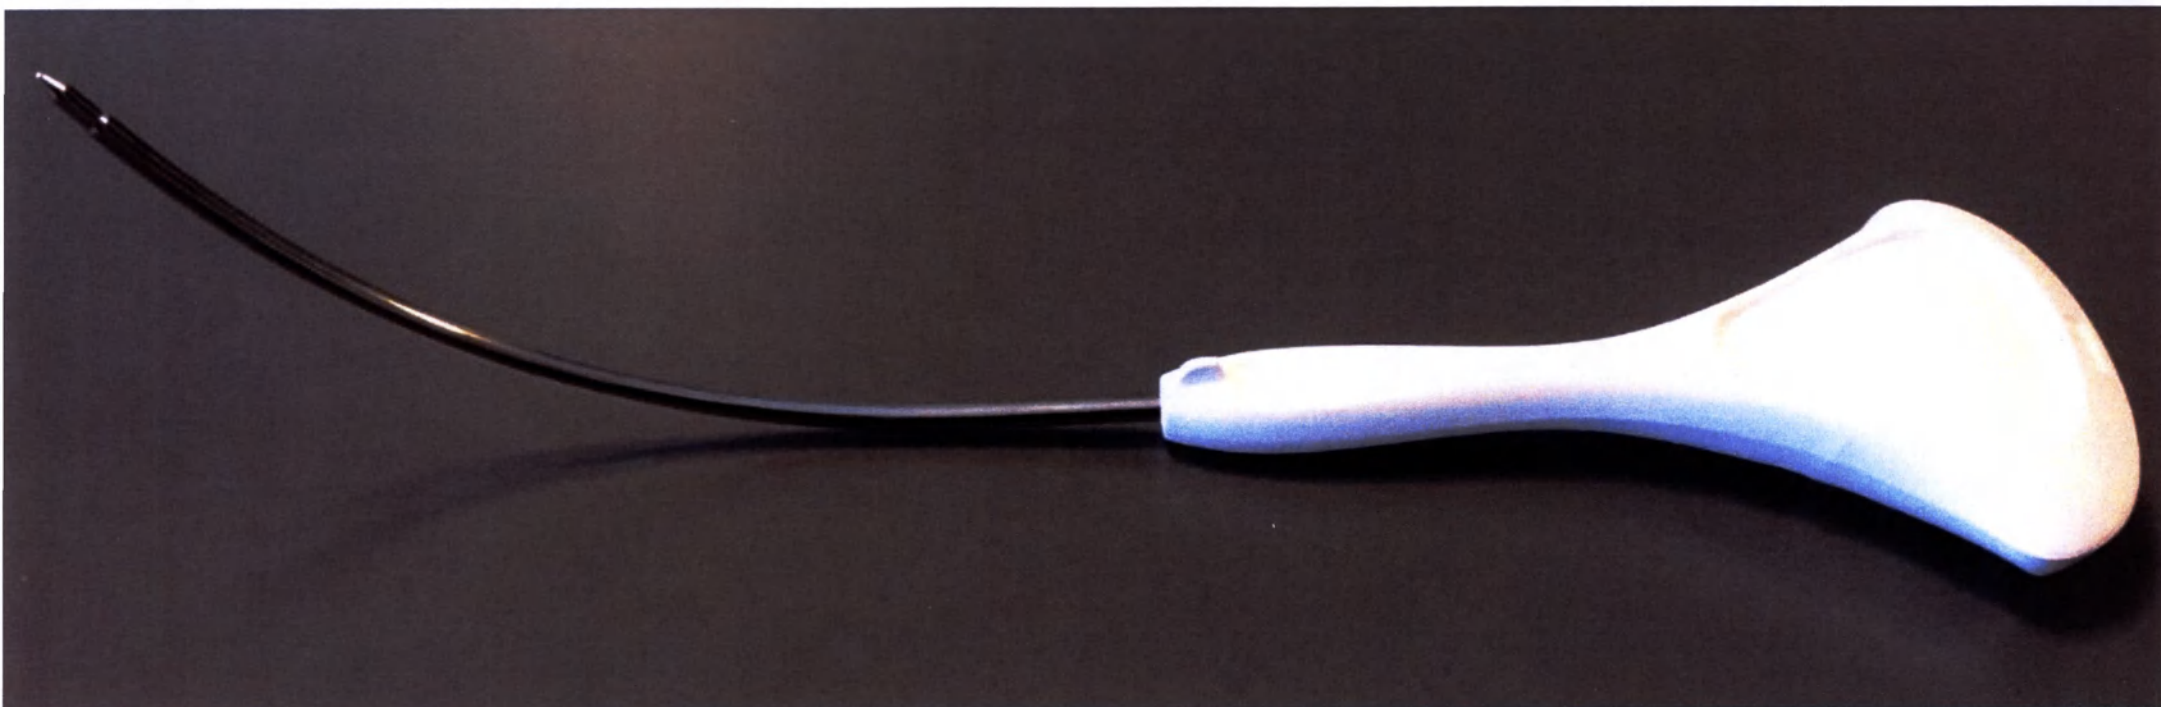

Фотографическое изображение 3: Внешний вид – Игла VS

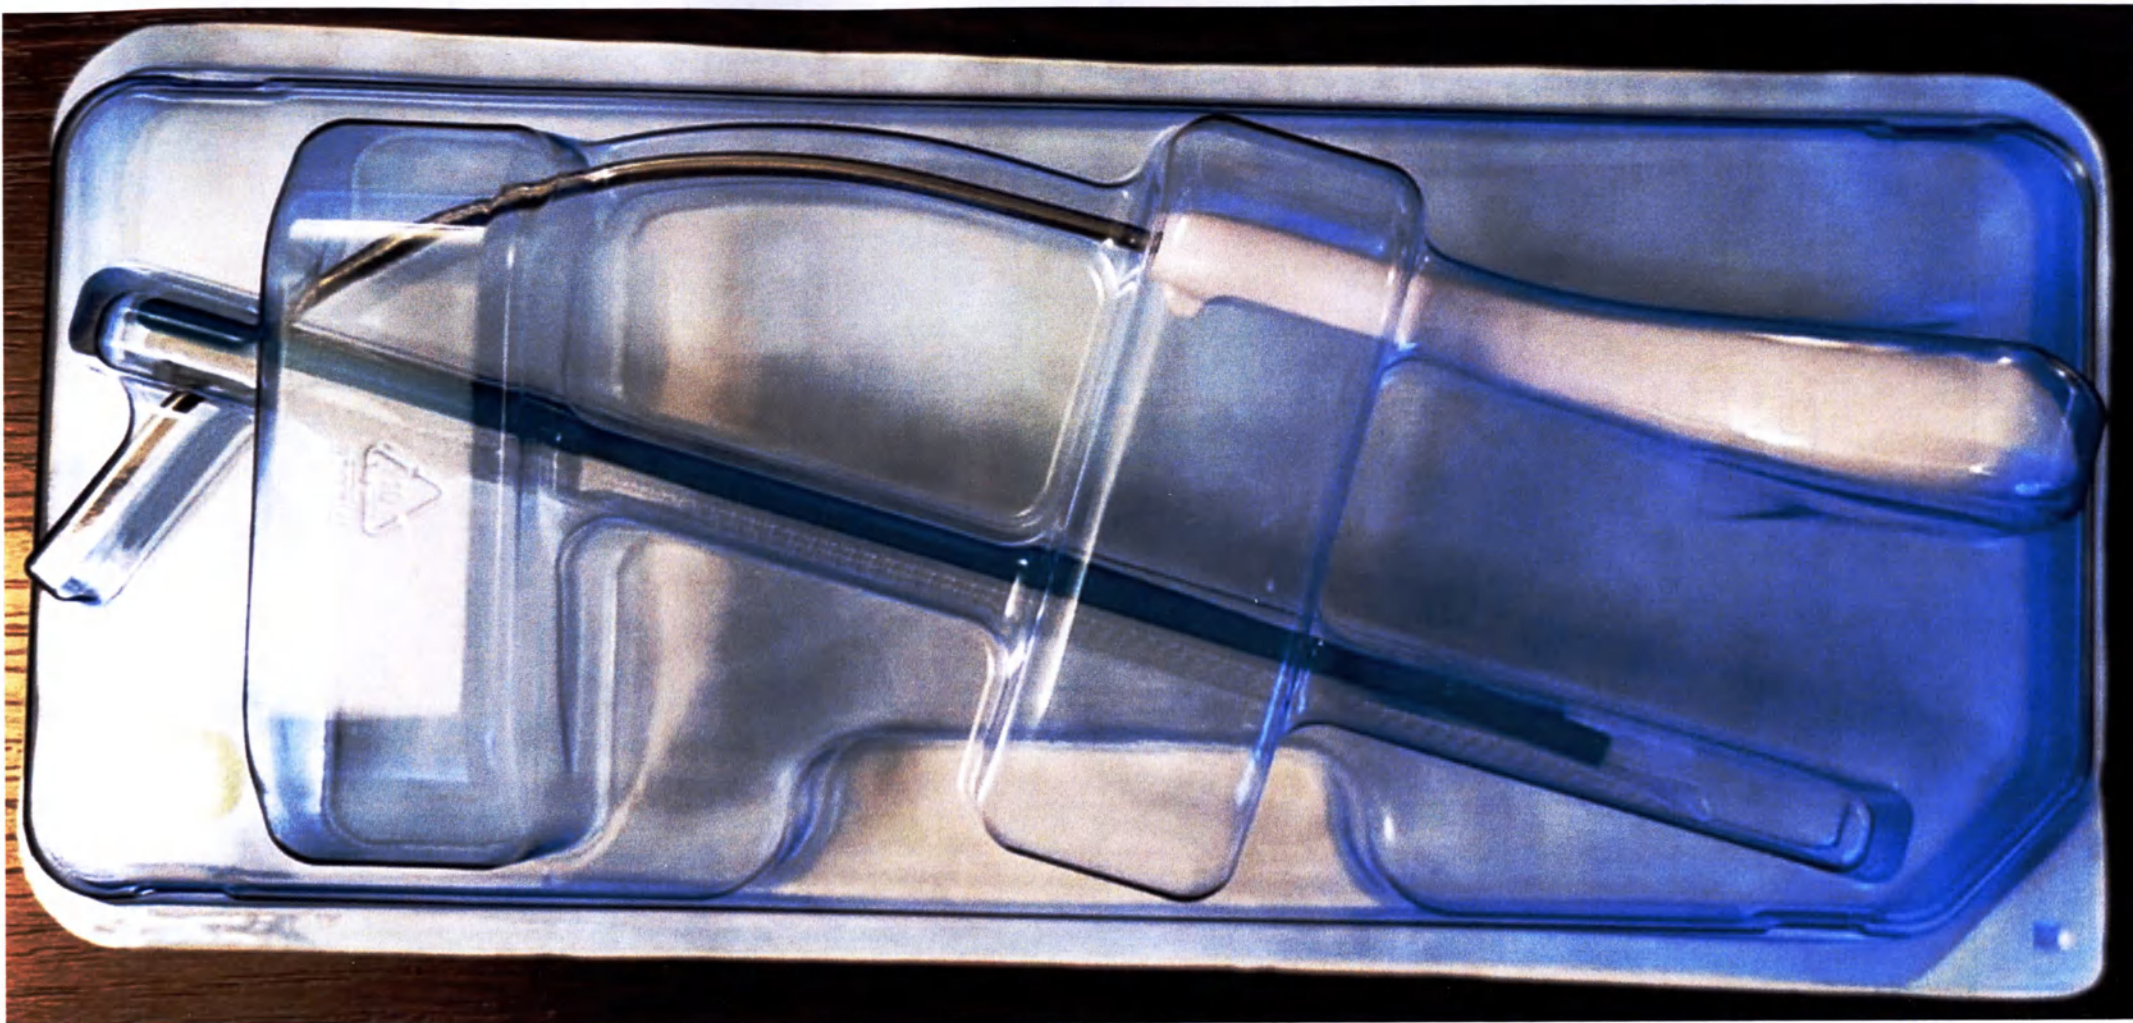

Фотографическое изображение 4: Внешний вид блистерной упаковки

REF

KIT-STEEMA-
VS

LOT

39767

SN

0060

2019-02

2022-02

STERIL ISO

PY №


**НЕ
ТОКСИЧНО****Система для лечения недержания мочи у женщин
STEEMA Retropubic**

Комплект поставки изделия:

Слинг Steema Retropubic (SL-100SR) 1 шт

Игла VS (DPN-SVS) 1 шт

Инструкция по применению 1 шт

**Promedon S.A.**
Av. Gral. Manuel
Savio s/n Lote 3,
Manzana 3 Parque
Industrial Ferreyra
X5925XAD
Córdoba Argentina

30343380839767803C

Фотографическое изображение 5: Маркировка блистерной упаковки

STEEMA
RETROPUBIC SLING SYSTEM

**STEE
VS**

LOT

39767

SN

39767024

REF

KIT-STEEMA-VS



2019-03




2022-02



01107798121802681/11106/03/19/17126/02/22(10139767(21139767024(2401300033799

Фотографическое изображение 5: Маркировка коробки МИ Система для лечения недержания мочи у женщин STEEMA Retropubic

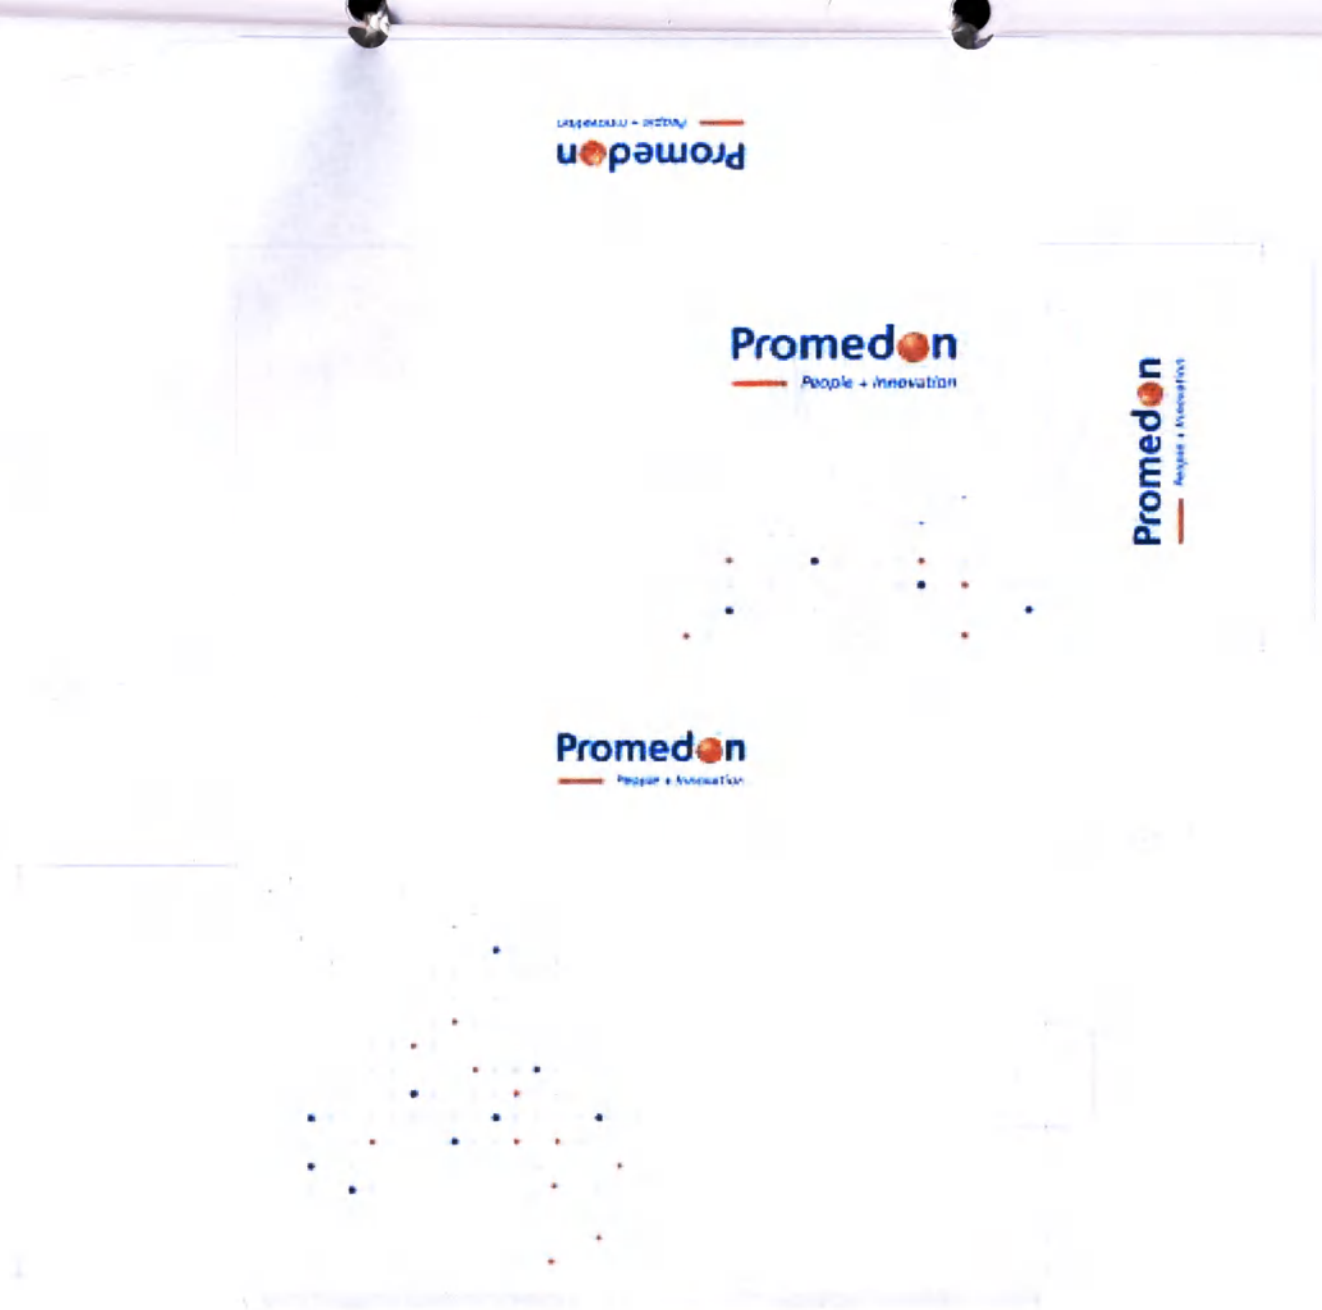

Фотографическое изображение 6: Макет коробки МИ Система для лечения недержания мочи у женщин STEEMA Retropubic

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 (42) листов
цифрами прописью

Должность _____

Подпись _____

« _____ 20 20 г. МП

