

Фотографии медицинского изделия

**Набор реагентов с принадлежностями для количественного
иммуноферментного определения свободного Т4 в сыворотке крови
человека «ТиройдИФА-свободный Т4» по ТУ 21.20.23-221-98539446-2016,
производства ООО «Компания Алкор Био»**


- фотография «ТиройдИФА-свободный Т4», комплектация №1, общий вид – лист 2;
- фотография «ТиройдИФА-свободный Т4», комплектация №2, общий вид – лист 3;
- фотография «ТиройдИФА-свободный Т4», укрупнено флаконы КП и КС – лист 4;
- фотография «ТиройдИФА-свободный Т4», укрупнено принадлежности (ванночки и наконечники) – лист 5;
- фотография «ТиройдИФА-свободный Т4», укрупнено принадлежности ванночки, наконечники и Буфер Р) – лист 6.

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.





Комплекты 1

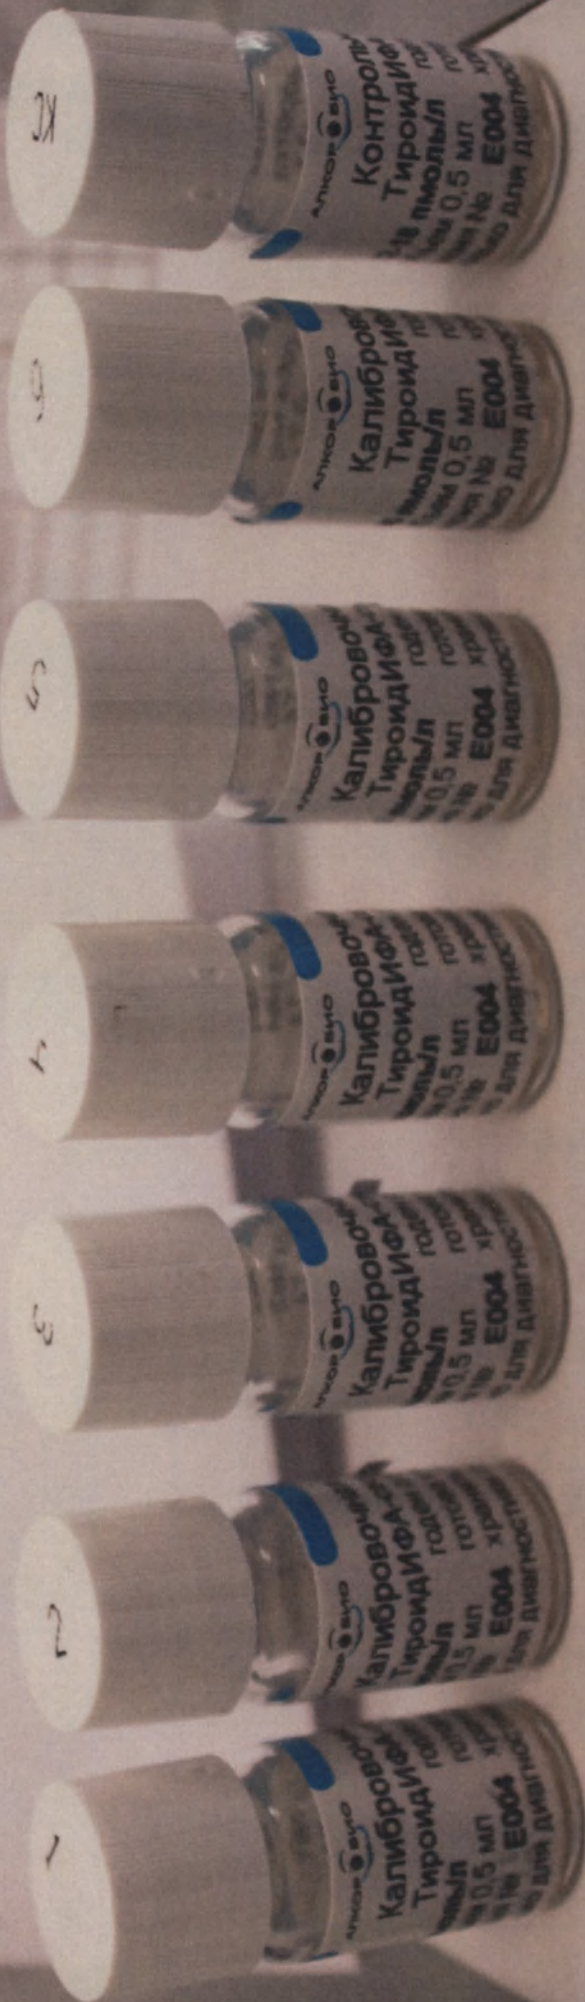


Стоп-реагент
 Объем 1,4 мл
 Срок годности 2018-07-29
 Температура хранения +2...+8°C
 Место хранения в холодильнике
 Только для диагностики

ТУ 20.59.52-221-98539446-2016
 РУ № ФСР 2011/11311 от 22.12.2016
 7. Стоп-реагент
Принадлежности
 1. Пакет закрывающийся полиэтиленовый 1 шт.

Ферр Р (20X)
 Объем 1,4 мл
 Срок годности 2018-07-29
 Температура хранения +2...+8°C
 Место хранения в холодильнике
 Только для диагностики

Ферр Р (20X)
 Объем 1,4 мл
 Срок годности 2018-07-29
 Температура хранения +2...+8°C
 Место хранения в холодильнике
 Только для диагностики



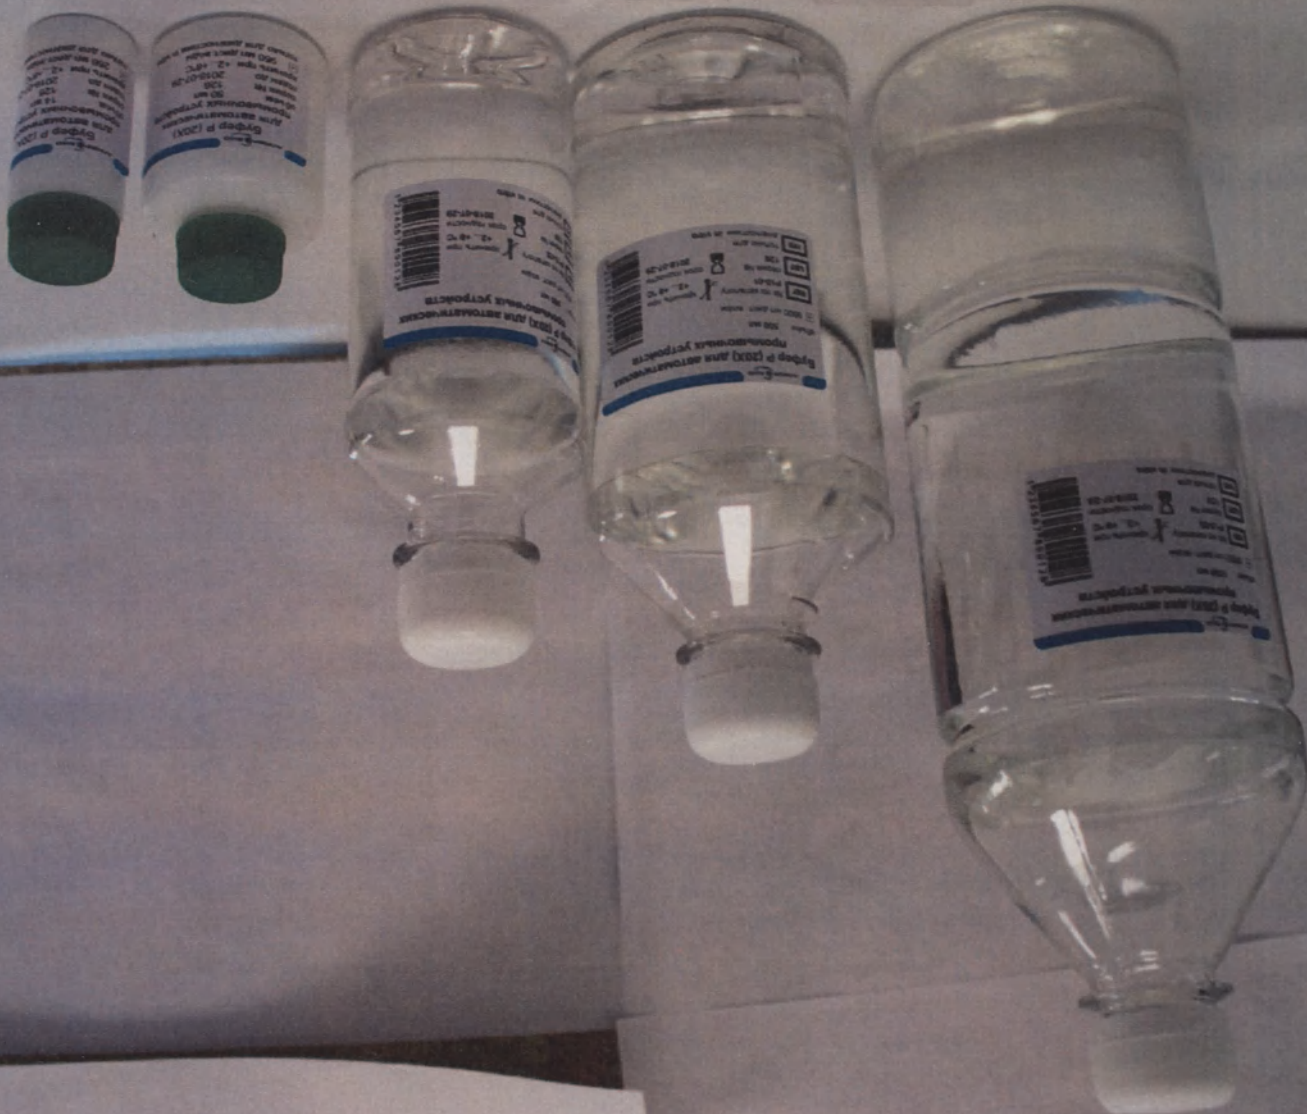

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 6 (шесть) _____) лист

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полинцев



Макеты этикеток на медицинское изделие

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения свободного Т4 в сыворотке крови человека «ТироидИФА-свободный Т4» по ТУ 21.20.23-221-98539446-2016, производства ООО «Компания Алкор Био»

- внешняя (головная) этикетка на «ТироидИФА-свободный Т4», комплектация №1– лист 2;
- внутренние этикетки на «ТироидИФА-свободный Т4», комплектация №1– лист 3;
- внешняя (головная) этикетка на «ТироидИФА-свободный Т4», комплектация №2– лист 4;
- внутренние этикетки на «ТироидИФА-свободный Т4», комплектация №2– лист 5.

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г..



Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения свободного Т4 в сыворотке крови человека «ТироидИФА-свободный Т4» по ТУ 21.20.23-221-98539446-2016

Макет головной этикетки

ГРУППА КОМПАНИЙ

АЛКОР БИО

Комплектация №1, кат.№ 100-09


ГРУППА КОМПАНИЙ

АЛКОР БИО

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7 (812) 677 8779; 677 2162,
info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

ТироидИФА-свободный Т4

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека

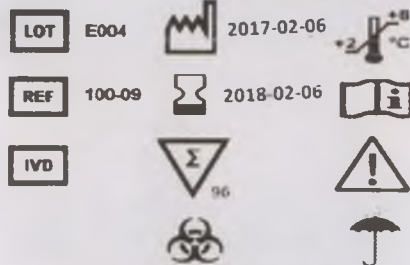

ТУ-21.20.23-221-98539446-2016
РУ № ФСР 2011/11311 ОТ 22.12.2016



Основной состав набора

- | | |
|--|---------|
| 1. Стрипы с моноклональными антителами к тироксину | 1 упак. |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл. |
| 4. Конъюгат Е | 1 фл. |
| 5. Буфер Р | 2 фл. |
| 6. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 7. Стоп-реагент | 1 фл. |

Принадлежности

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 1 шт. |
|---------------------------------------|-------|

ТироидИФА-свободный Т4



LOT E004

2018-02-06
MediMark Europe
11 rue E Zola 38100 Grenoble France

EC REP

Для профессионального применения

F1

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО
www.alkorbio.ru

ТироидИФА-свободный Т4

LOT

E004




2018-02-06

EC REP

MediMark Europe
11 rue E Zola 38100 Grenoble France

Для профессионального применения

F1



АЛКОР БИО www.alkorbio.ru

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения свободного Т4 в сыворотке крови человека «ТироидИФА-свободный Т4» по ТУ 21.20.23-221-98539446-2016

Макет внутренних этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Комплектация №1, кат. № 100-09

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №1
ТироидИФА-свободный Т4
0 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E004** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №4
ТироидИФА-свободный Т4
9,2 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E004** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
ТироидИФА-свободный Т4
объем 18 мл
серия № **E004**
годен до 2018-02-06
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Стрипы с моноклональными антителами к тироксину
ТироидИФА - свободный Т4
серия № **E004**
годен до 2018-02-06
хранить при +2...+8°C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №2
ТироидИФА-свободный Т4
2,3 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E004** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №5
ТироидИФА-свободный Т4
19,8 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E004** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Раствор ТМБ
объем 14 мл
серия № 054
годен до 2018-02-26
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №3
ТироидИФА-свободный Т4
4,7 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E004** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №6
ТироидИФА-свободный Т4
96 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E004** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Контрольная сыворотка
ТироидИФА-свободный Т4
12-18 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № **E004** хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Буфер Р (20X)
объем 14 мл
серия № 126
годен до 2018-07-29
хранить при +2...+8°C
+ 266 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Стоп-реагент
объем 14 мл
серия № 431
годен до 2019-07-06
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Буфер Р (20X)
объем 14 мл
серия № 126
годен до 2018-07-29
хранить при +2...+8°C
+ 266 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения свободного Т4 в сыворотке крови человека «ТиродиИФА-свободный Т4» по ТУ 21.20.23-221-98539446-2016

Макет внутренних этикеток



Комплектация №2, кат. № 100-09А

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №1
ТиродиИФА-свободный Т4
0 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E104 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Контрольная сыворотка
ТиродиИФА-свободный Т4
12-18 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E104 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Контрольная сыворотка
ТиродиИФА-свободный Т4
12-18 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E104 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Стрипы с моноклональными
антителами к тироксину
ТиродиИФА - свободный Т4
серия № E104
годен до 2018-02-06
хранить при +2...+8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №2
ТиродиИФА-свободный Т4
2,3 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E104 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №3
ТиродиИФА-свободный Т4
4,7 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E104 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №4
ТиродиИФА-свободный Т4
9,2 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E104 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №3
ТиродиИФА-свободный Т4
4,7 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E104 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Раствор ТМБ
объем 14 мл
серия № 054
годен до 2018-02-26
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Буфер Р (20X)
объем 50 мл
серия № 126
годен до 2018-07-29
хранить при +2...+8°C
+ 950 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №4
ТиродиИФА-свободный Т4
9,2 пмоль/л годен до 2018-01-16
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E104 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
ТиродиИФА-свободный Т4
объем 18 мл
серия № E104
годен до 2018-02-06
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Стоп-реагент
объем 19 мл
серия № 431
годен до 2019-07-06
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №5
ТиродиИФА-свободный Т4
19,8 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E104 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Калибровочная проба №6
ТиродиИФА-свободный Т4
39,6 пмоль/л годен до 2018-02-06
объем 0,5 мл готова к использованию
серия № E104 хранить при +2...+8°C
только для диагностики in vitro

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 5 (12.11.16) лист 16

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Польбинцев

