


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Набор реагентов для количественного определения аутоантител
класса IgG к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-ТПО Реагенты (Alinity i Anti-TPO Reagent Kit)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



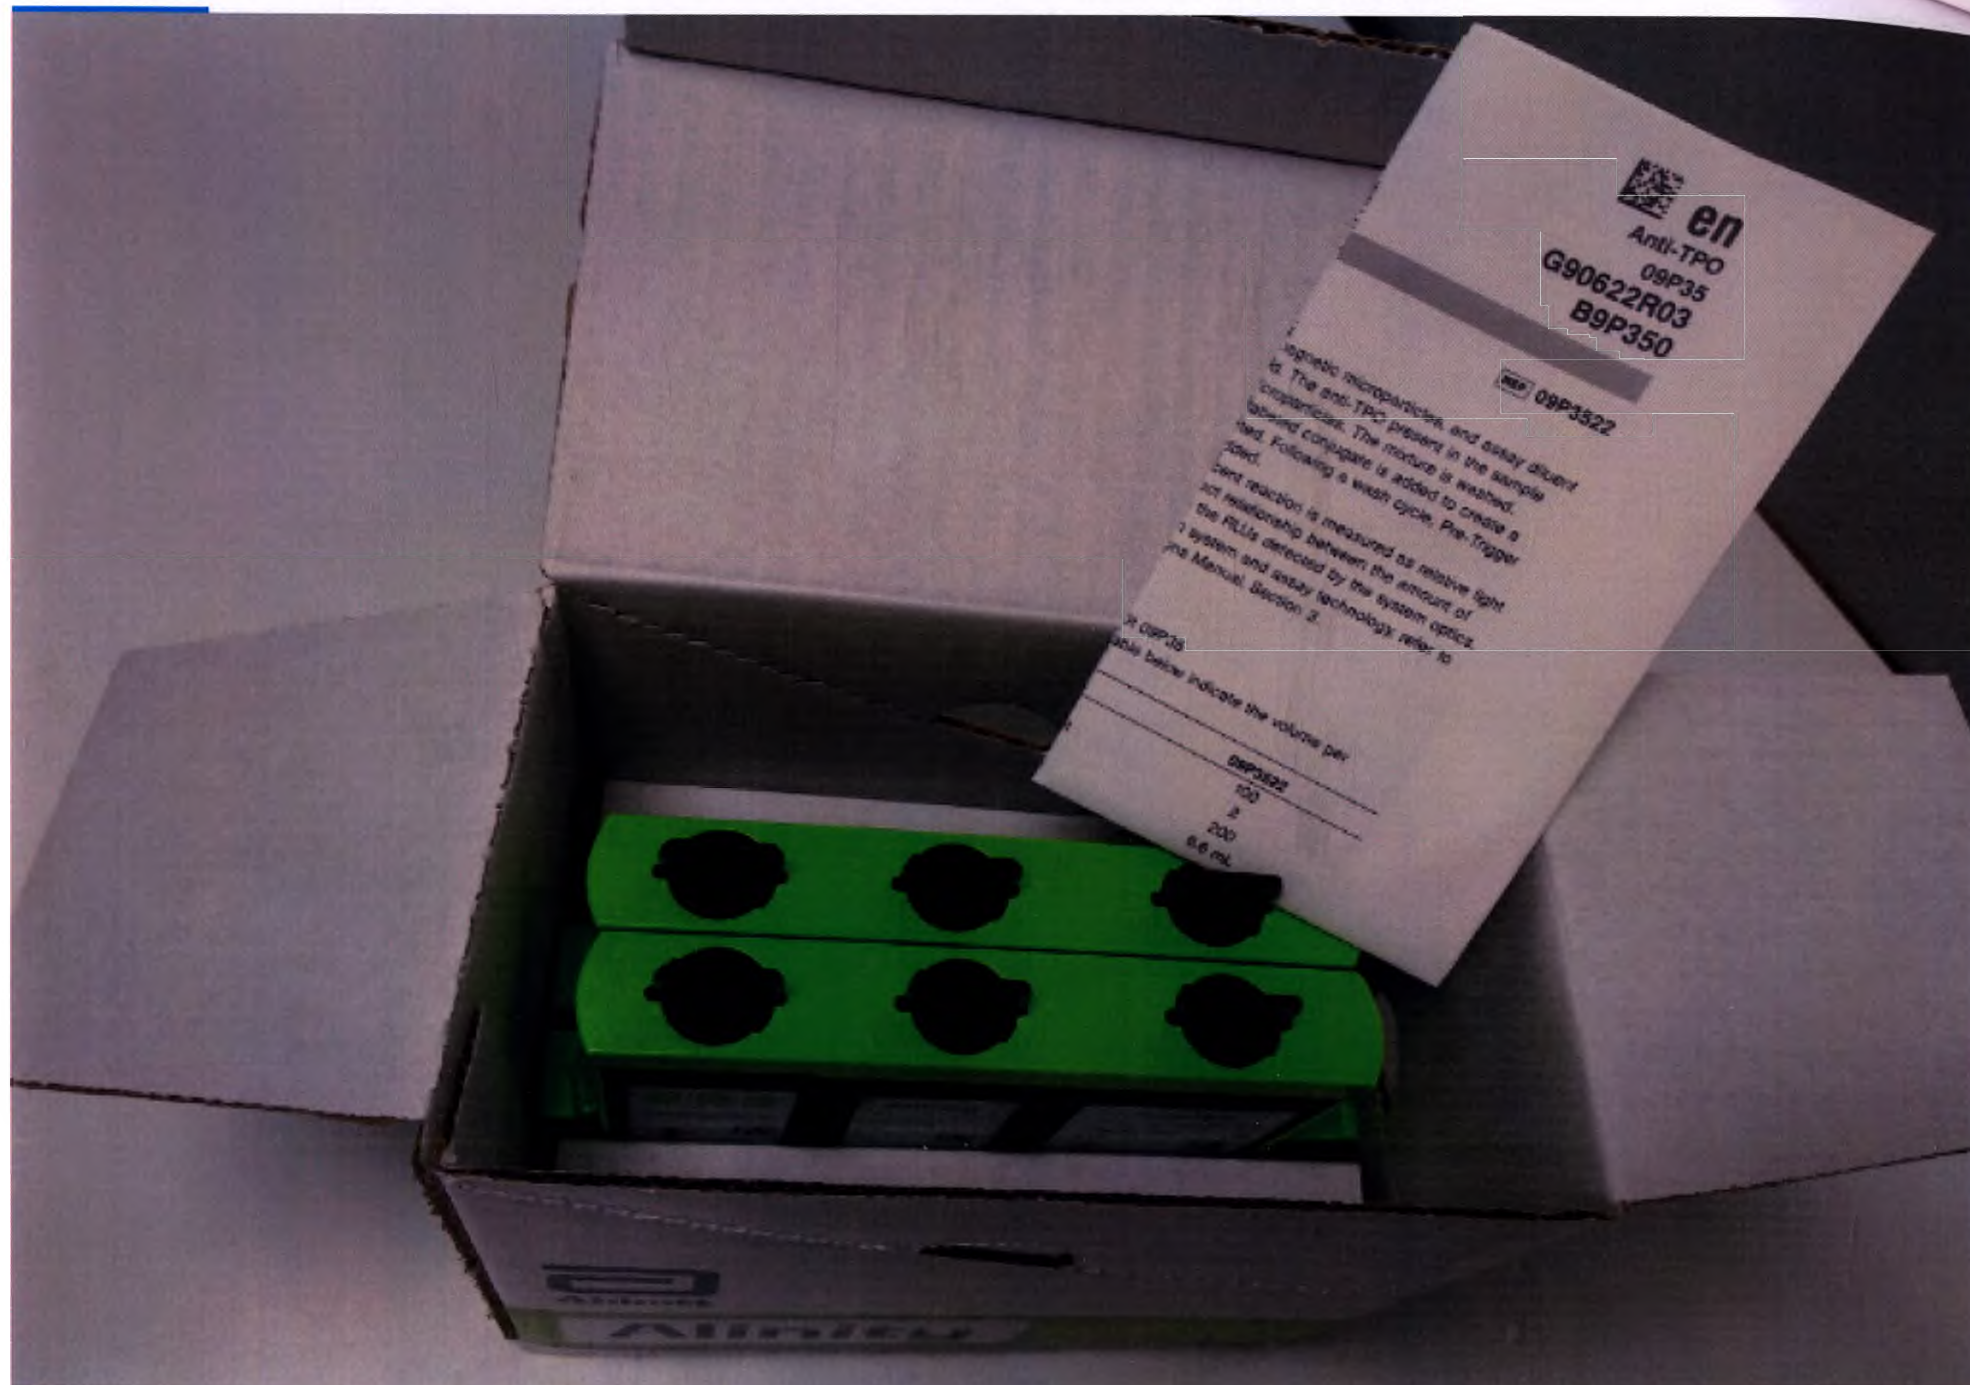





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 листов



Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения аутоантител
класса IgG к тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-ТПО Реагенты (Alinity i Anti-TPO Reagent Kit)»**

**Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации,
2 картриджа по 100 тестов**



09P3522



**Набор реагентов для количественного определения аутоантител класса IgG к
тиреопероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i**

«Анти-ТПО Реагенты (Alinity i Anti-TPO Reagent Kit)»


2 картриджа по 100 тестов в составе: Микрочастицы (Alinity i Anti-TPO Microparticles) – 2 x 6,6 мл;
Конъюгат (Alinity i Anti-TPO Conjugate) – 2 x 6,1 мл; Дилуент теста (Alinity i Anti-TPO Assay Diluent) –
2 x 10,4 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin
Business Park Sligo, Ireland (Ирландия) / РУ № _____ / _____ от _____. / Инструкция по
применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия
хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции
Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия Анти-ТПО Реагенты (Alinity i Anti-TPO Reagent Kit),

2 картриджа по 100 тестов



Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия, картридж на 100 тестов

 MICROPARTICLES 6.6 mL  GG0624R01  2°C 8°C ABBOTT A.100 Silgo, Ireland	 CONJUGATE 6.1 mL GG0625R01 SN	Anti-TPO ASSAY DELUENT 10.4 mL 09P35 IVD  GG0626R01 Exp. LOT Abbott
--	--	--

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов



Подпись