

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека «ТирондИФА-ТТГ» по ТУ 9398-213-98539446-2016

Фотографическое изображение набора



1. Фотографическое изображение набора Общий вид-лист 2;
2. Фотографическое изображение набора Общий вид (укрупнено)- лист 3;
3. Фотографическое изображение Флакончики : раствор ТМБ ,Конъюгат Е, Буфер Р и Стоп-реагент- лист 4;
4. Фотографическое изображение Калибровочные пробы КП1-КП5, Контрольная сыворотка и Буфер Д (вид флакончиков сбоку)- лист 5;
5. Фотографическое изображение Калибровочные пробы КП1-КП5, Контрольная сыворотка и Буфер Д (вид флакончиков прямо)- лист 6;
6. Фотографическое изображение Пакет полиэтиленовый с замком -лист 7.
7. Фотографическое изображение Комплект стрипов рядом с упаковкой-лист 8.

Генеральный директор



М.В. Швырев

ООО «Компания Алкор Био»
Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87 79
ПАСПОРТ № 310R
(с 16.08.2016) Исходный документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008, ISO 13485:2003

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека «ТироидИФА-ТТГ»

Кат. № 100-11 Серия № 310R10 Количество шт

Наименование реагента	Внешний вид и форма выпуска	Аппроксим. масса (мг/мл)	Концентрация	Срок годности	Соответствие контрольному параметру
Основной состав набора					
Калибровочная проба №1	калибровочная проба, в контрольной сыворотке	0	1 фл (0,5 мл)	04.08.10	соответствует
Калибровочная проба №2	калибровочная проба, в контрольной сыворотке	0,24	1 фл (0,5 мл)	04.08.10	соответствует
Калибровочная проба №3	калибровочная проба, в контрольной сыворотке	0,71	1 фл (0,5 мл)	04.08.10	соответствует
Калибровочная проба №4	калибровочная проба, в контрольной сыворотке	2,4	1 фл (0,5 мл)	04.08.10	соответствует
Калибровочная проба №5	калибровочная проба, в контрольной сыворотке	7,1	1 фл (0,5 мл)	04.08.10	соответствует
Калибровочная проба №6	калибровочная проба, в контрольной сыворотке	14,3	1 фл (0,5 мл)	04.08.10	соответствует
Контрольная сыворотка	контрольная сыворотка, в контрольной сыворотке	2,2-3,4	1 фл (0,5 мл)	04.08.10	соответствует
Конъюгат Е (1:1000)	конъюгат Е, в контрольной сыворотке	1 конгл	1 конгл	01.08.10	соответствует
Буфер Д	буфер Д, в контрольной сыворотке	1 конгл	1 конгл	01.08.10	соответствует
Раствор ТМБ	раствор ТМБ, в контрольной сыворотке	1 конгл	1 конгл	01.08.10	соответствует
Буфер Р	буфер Р, в контрольной сыворотке	1 конгл	1 конгл	01.08.10	соответствует

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА («ТироидИФА-ТТГ»)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «ТироидИФА-ТТГ» предназначен для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Набор реагентов «ТироидИФА-ТТГ» — это набор реагентов для определения тиреотропного гормона с молекулярной массой 28 000.

Условия хранения: +2...+8 °С. Срок годности: 12 месяцев. Условия использования: в лаборатории. Условия транспортировки: в холодильнике. Условия хранения: в холодильнике. Условия использования: в лаборатории. Условия транспортировки: в холодильнике.

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7 (812) 677 8779, 677 2162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru


ТироидИФА-ТТГ

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека

Состав набора

1. Стрилы с моноклональными антителами к ТТГ
2. Калибровочные пробы
3. Контрольная сыворотка
4. Конъюгат Е
5. Буфер Д
6. Буфер Р
7. Раствор ТМБ
8. Стоп-реагент
9. Прозрачный пластиковый пакет с замком

Номер серии: 310R
Дата изготовления: 2016-08-27
№ по каталогу: 100-11
Срок годности: 2017-08-27
Только для in vitro диагностики
Хранить при +2...+8 °С
MediMark Europe
11 rue E. Zola 38100 Grenoble France
TY 9398-213-98539446-2016
PU № ФСР 2011/11309 от 12.07.2011



ГРУППА КОМПАНИЙ

АЛКОР БИО



ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7 (812) 677 8779; 677 2162.
info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

ТироидИФА-ТТГ

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
тиреотропного гормона в сыворотке крови человека



Номер
серии
310R



№ по
каталогу
100-11



Только для
in vitro
диагностики



MediMark Europe
11 rue E. Zola 38100 Grenoble France

TU 9398-213-98539446-2016

PY № ФСР 2011/11309 от 12 07 2011



Дата
изготовления
2016-08-27



Срок
годности
2017-08-27









Хранить при
+2...+8

Состав набора

- | | |
|--|---------|
| 1. Стрипы с моноклональными антителами к ТТГ | 1 упак. |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл. |
| 4. Конъюгат Е | 1 фл. |
| 5. Буфер Д | 1 фл. |
| 6. Буфер Р | 2 фл. |
| 7. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 8. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 9. Прозрачный пластиковый пакет с замком | 1 шт. |



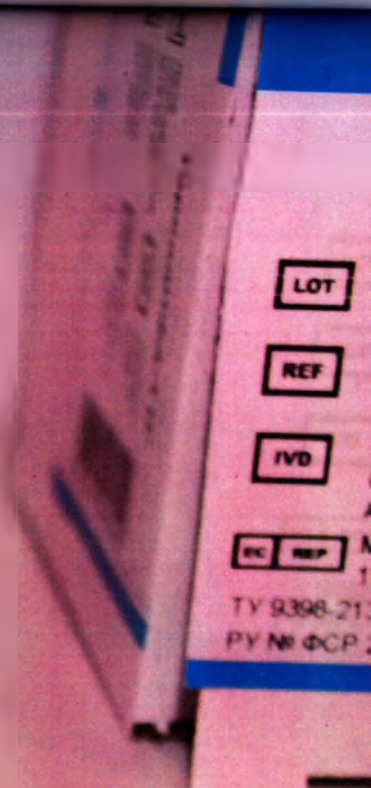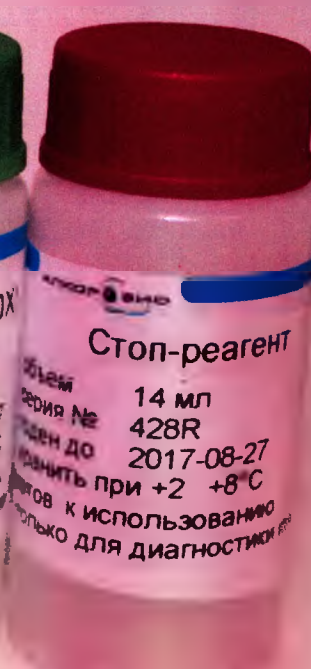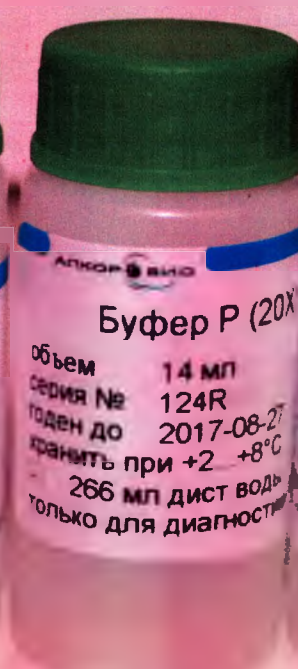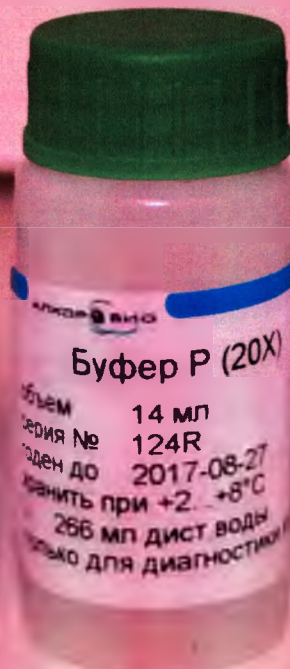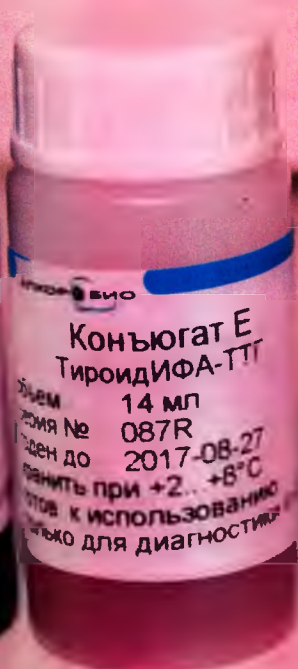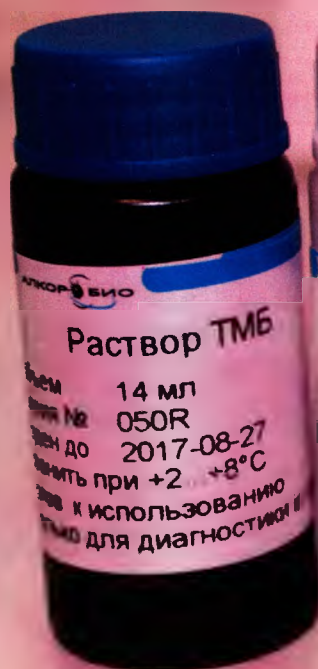

проба №1
ИФА-ТТТ
использовать
при +2...+8 °C
использовать
для диагностики in vitro

проба №2
ИФА-ТТТ
использовать
при +2...+8 °C
использовать
для диагностики in vitro

проба №3
ИФА-ТТТ
использовать
при +2...+8 °C
использовать
для диагностики in vitro

проба №4
ИФА-ТТТ
использовать
при +2...+8 °C
использовать
для диагностики in vitro

проба №5
ИФА-ТТТ
использовать
при +2...+8 °C
использовать
для диагностики in vitro

Тиреотропная
гормональная
проба (ТТГ)
0,5 мл
хранить при
+2...+8 °C
использовать
для диагностики in vitro

Тиреотропная
гормональная
проба (ТТГ)
0,5 мл
хранить при
+2...+8 °C
использовать
для диагностики in vitro

Буфер Д
ИФА-ТТТ
использовать
при +2...+8 °C
использовать
для диагностики in vitro

АЛКОР БИО

ООО «Цирми»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург
Жанселиуфская ул., д. 40, лит. А



АЛКОР БИО

ТироидИФА-ТТГ

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека



LOT

Номер серии 310R



Дата изготовления 2016-08-27

REF

каталогу 100-11



Срок годности 2017-08-27

IVD

Только для in vitro диагностики



Хранить при +2...+8

MediMark Europe

11 rue E. Zola 38100 Grenoble France

TU 9398-213-98539446-2018

PY № ФСР 2011/11309 от 12.07.2011

Состав набора

1. Стрипы с моноклональными антителами к ТТГ 1 упак.
2. Калибровочные пробы 6 фл.
3. Контрольная сыворотка 1 фл.
4. Конъюгат Е 1 фл.
5. Буфер Д 1 фл.
6. Буфер Р 2 фл.
7. Раствор ТМБ 1 фл.
8. Стоп-реагент 1 фл.
9. Прозрачный пластиковый пакет с замком 1 шт.

Стоп-реагент

14 мл
050R10
2017-08-27
Хранить при +2...+8°C
Использовать для диагностики

Буфер Р (20X)

14 мл
124R10
2017-08-27
Хранить при +2...+8°C
Использовать для диагностики

Раствор ТМБ

14 мл
050R10
2017-08-27
Хранить при +2...+8°C
Использовать для диагностики

Конъюгат Е

ТироидИФА-ТТГ
14 мл
087R10
2017-08-27
Хранить при +2...+8°C
Использовать для диагностики

Буфер Р (20X)

14 мл
124R10
2017-08-27
Хранить при +2...+8°C
Использовать для диагностики



Стрипы с моноклональными
антителами к ТТГ
ГироидиФА - ТТГ
серия № **310R**
годен до 2017-08-27
хранить при +2 +8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 (всего) лист 6

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
М.В. Швырев

