

Фотографии медицинского изделия

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека» («ГонадотропинИФА-ФСГ») по ТУ 21.20.23-212-98539446-2017, производства ООО «Компания Алкор Био»

- фотография «ГонадотропинИФА-ФСГ» по ТУ 21.20.23-212-98539446-2017, комплектация №1– лист 2;
- фотография «ГонадотропинИФА-ФСГ» по ТУ 21.20.23-212-98539446-2017, комплектация №1, КП и КС укрупнено– лист 3;
- фотография «ГонадотропинИФА-ФСГ» по ТУ 21.20.23-212-98539446-2017, комплектация №1, буфер Р, Стоп-реагент, конъюгат Е, ТМБ укрупнено – лист 4;
- фотография «ГонадотропинИФА-ФСГ» по ТУ 21.20.23-212-98539446-2017, комплектация №2– лист 5;
- фотография «ГонадотропинИФА-ФСГ» по ТУ 21.20.23-212-98539446-2017, комплектация №2, КП и КС укрупнено– лист 6;
- фотография «ГонадотропинИФА-ФСГ» по ТУ 21.20.23-212-98539446-2017, комплектация №2, буфер Р, Стоп-реагент, конъюгат Е, ТМБ укрупнено – лист 7;
- фотография ванночек и наконечников -лист 8;
- фотография принадлежностей при полной комплектации набора, принадлежности представлены в максимально возможном количестве. (состав поставляемых с набором принадлежностей определяется заказчиком) - лист 9.

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.





АТРИКОМ® ЕВРО

Гомеопатическая форма № ЕВРО

Содержит 10 доз

Срок годности: 3 года

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °C

Состав: Гомеопатическая форма № ЕВРО

Содержит 10 доз

Срок годности: 3 года

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °C

Справка с лабораторными результатами

Гомеопатическая форма № ЕВРО

Содержит 10 доз

Срок годности: 3 года

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °C

Состав: Гомеопатическая форма № ЕВРО

Содержит 10 доз

Срок годности: 3 года

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °C





Стрипы с моноклональными антителами к ФСГ
ГонадотропинИФА - ФСГ
Лот № E004
Валид до 2018-10-21
Хранить при +2...+8 °C
Использовать для диагностики in vitro

Буфер Р (20X)
14 мл
140
2019-04-21
Хранить при +2...+8 °C
200 мл дист. воды
для диагностики in vitro

Буфер Р (20X)
14 мл
140
2019-04-21
Хранить при +2...+8 °C
200 мл дист. воды
для диагностики in vitro

Стоп-реагент
19 мл
447
2020-04-12
Хранить при +2...+8 °C
для диагностики in vitro

Конъюгат Е
ГонадотропинИФА-ФСГ
14 мл
E004
2017-09-05
Хранить при +2...+8 °C
для диагностики in vitro

Раствор ТМБ
14 мл
086
2018-10-21
Хранить при +2...+8 °C
для диагностики in vitro

Система лабораторной диагностики «Алкор-Био»
Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека «ГонадотропинИФА-ФСГ»
Кат. № 100-06 Серия № E004 Версия № 1 Кол-во тестов 100

Наименование реагента	Вместимость и форма выпуска	Артикул	Срок годности	Срок хранения	Срок годности
Основной состав набора					
Конъюгат Е	14 мл	447	2017-09-05	2017-09-05	2017-09-05
Стоп-реагент	19 мл	447	2020-04-12	2020-04-12	2020-04-12
Буфер Р (20X)	14 мл	140	2019-04-21	2019-04-21	2019-04-21
Раствор ТМБ	14 мл	086	2018-10-21	2018-10-21	2018-10-21

Инструкция по применению
Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека «ГонадотропинИФА-ФСГ»
1. Подготовка образцов и реагентов
2. Подготовка образцов
3. Подготовка реагентов
4. Проведение анализа
5. Интерпретация результатов

АЛКОР БИО

ГонадотропинИФА-ФСГ

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека

Основной состав:

1. Стрипы с моноклональными антителами к ФСГ

1 упак.






ГонадотропинИФА-ФСГ

15-01-8-10-2


100-06-06

100-06-06

100-06-06

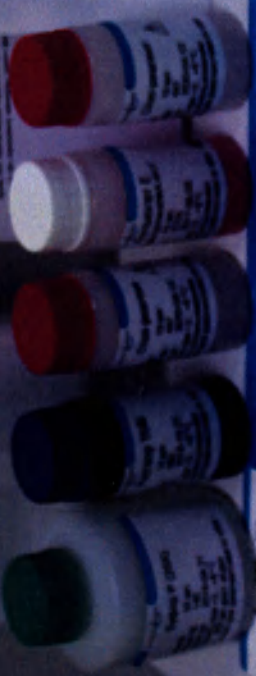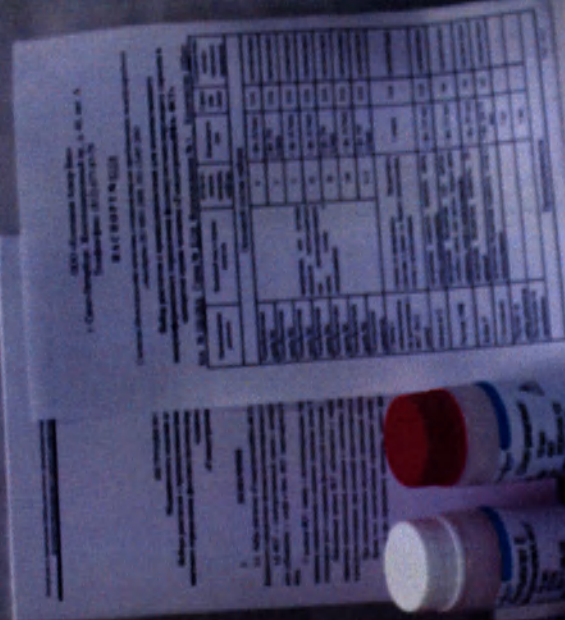

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

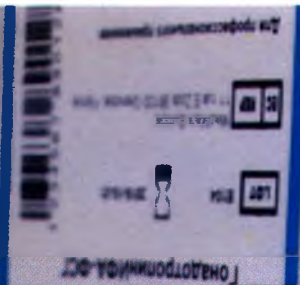

Стрипы с моноклональными антителами к ФСГ
ГонадотропинИФА - ФСГ
серия № E104
годен до 2018-10-21
хранить при +2...+8 °С
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

ИНСТРУКЦИЯ ПО
Медицинского изделия для
Набора реагентов с принадлежностями
иммуноферментного определения фолликулостимулирующего
гормона человека
«ГонадотропинИФА-ФСГ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов «ГонадотропинИФА-ФСГ» ферментного определения фолликулостимулирующего гормона человека.

1.2. ФСГ — гликопротеиновый гормон с молекулярной массой 22,5 кДа, состоящий из двух субъединиц — альфа и бета. ФСГ секретируется гипофизом.

У мужчин ФСГ, наряду с лютеинизирующим гормоном, стимулирует рост и созревание фолликулов в яичниках. Повышенные уровни ФСГ наблюдаются у пациентов (первичная недостаточность яичников и семенников, после кастрации, при почечной недостаточности и др.). При злокачественных опухолях семенников обычно наблюдается повышенное содержание ФСГ.

Кроме того, количественное определение уровня ФСГ имеет значение при определении менопаузы, точного времени наступления беременности.

Система менеджмента качества соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, ISO 13483:2003

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека «ГонадотропинИФА-ФСГ»

Кат. № 100-06А Серия № E104 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Наименование реагента	Внешний вид и форма выпуска	Активное значение, мМЕ/мл	Комплектирование	Срок годности	Соответствие контролируемого параметра
Основной состав набора					
Калибровочная проба №1	прозрачные или мутные жидкости светло-желтого или светло-коричневого цвета, готовые к использованию	0	1 фла. (0,5 мл)	E104	соответствует
Калибровочная проба №2		2	2 фла. (по 0,5 мл)	E104	соответствует
Калибровочная проба №3		5	1 фла. (0,5 мл)	E104	соответствует
Калибровочная проба №4		25	1 фла. (0,5 мл)	E104	соответствует
Калибровочная проба №5		50	2 фла. (по 0,5 мл)	E104	соответствует
Калибровочная проба №6		100	1 фла. (0,5 мл)	E104	соответствует
Контрольная сыворотка		8-12	2 фла. (по 0,5 мл)	E104	соответствует
Стрипы с моноклональными антителами к ФСГ (8х12 лунок)	стрипы из прозрачного пластика в рамке из белого полистилена, готовы к использованию		1 компл.	E104	соответствует
Конъюгат Е	прозрачная жидкость красного цвета, готов к использованию		1 фла. (14 мл)	E104	соответствует
Раствор ТМБ	прозрачная бесцветная или светло-голубого цвета, или светло-бурого цвета жидкость, готов к использованию		1 фла. (14 мл)	066	соответствует
Буфер Р	прозрачная бесцветная жидкость, 20-кратный		1 фла. (50 мл)	140	соответствует
Стоп-реагент	прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию		2 фла. (по 19 мл)	447	соответствует
Паспорт на набор реагентов			1 шт.	-	-
Инструкция по применению			1 шт.	-	-

Принадлежности

Стр. 1 из 2



АЛКОР БИО

ГонадотропинИФА-ФСГ

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека

Основной состав:

1. Стрипы с моноклональными антителами к ФСГ
2. Калибровочные пробы
3. Контрольная сыворотка
4. Конъюгат Е
5. Буфер Р
6. Раствор ТМБ
7. Стоп-реагент

Принадлежности

1. Пакет закрывающийся полиэтиленовый

1 упак

8 фла.

2 фла.

1 фла.

1 фла.

1 фла.

2 фла.

1 шт.

1 234567 890128

2018-10-21

E104

100-06А

2017-04-21

2018-10-21

96

ТУ 21.20.23-212-98539446-2017


ПУ № ФСР 2011/11313 от 30.12.2016

АЛКОР БИО

www.alcorbio.ru

Для профессионального применения



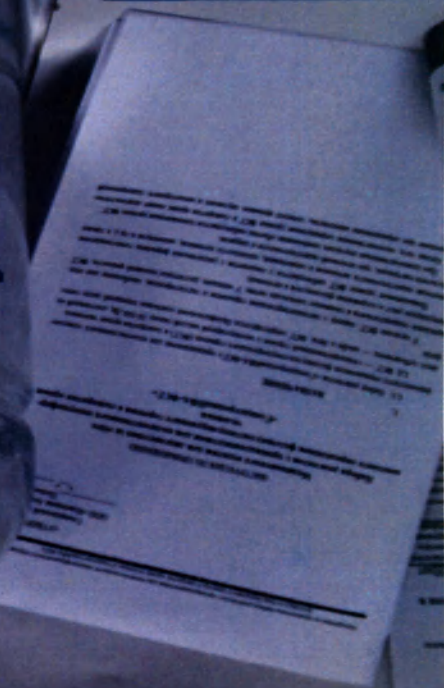

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 (Левин)
лист 26

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полинцев

