

Фотографии медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* методом ПЦР в режиме реального времени «Интифика *Chlamydia trachomatis*»

- набор «Интифика *Chlamydia trachomatis*», форма S– лист 2;
- набор «Интифика *Chlamydia trachomatis*», форма T– лист 3;

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Интифика Chlamydia trachomatis

В-1.2018-08

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *In vitro*
Набора реагентов для выявления ДНК
Chlamydia trachomatis
методом ПЦР в режиме реального времени
«Интифика *Chlamydia trachomatis*»

Интифика
Chlamydia trachomatis Форма S кат. № 441-01
Интифика
Chlamydia trachomatis Форма Т кат. № 441-02

Intifica

ПЦР-смесь-Si
Интифика
Chlamydia trachomatis

Форма S
14 стрипов по 8 пробирок
серия № 009
годен до 2018-05-11
хранить при +2...+8 °С
готов к использованию
ООО «Кристаллический Алмаз Восток»


Интифика *Chlamydia trachomatis*
Набор реагентов для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis*
методом ПЦР в режиме реального времени

Форма S

LOT: 090805
REF: 441-01
PVI: 112
2017-05-29
2018-05-11
112

Состав набора

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. ПЦР-смесь-Si | 14 стрипов по 8 пр. |
| 2. Таq | 1 пр. |
| 3. ПКО | 1 пр. |
| 4. ВКО | 2 пр. |
| 5. ОКО | 1 пр. |

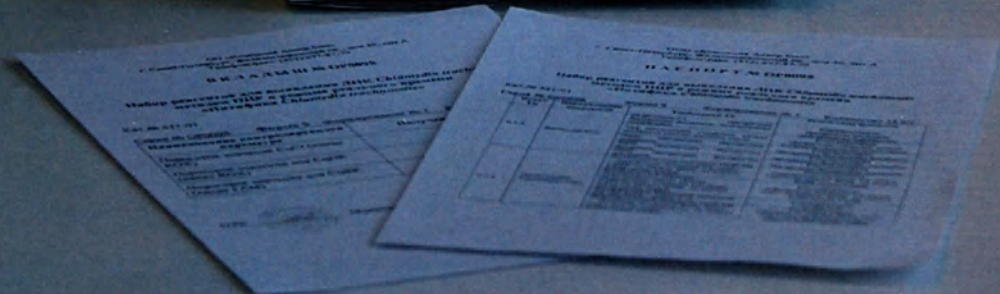

Интифика Chlamydia trachomatis

9-1 2018-08

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набора реагентов для выявления ДНК
Chlamydia trachomatis
методом ПЦР в режиме реального времени
«Интифика Chlamydia trachomatis»

Интифика
Chlamydia trachomatis Форма S кат. № 441-01
Интифика
Chlamydia trachomatis Форма Т кат. № 441-02

Intifica
ПЦР-смесь-Ct
Интифика
Chlamydia trachomatis
Форма Т
112 пробирок
Серия № 009
годен до 2018-05-11
хранить при +2...+8 °С
готов к использованию
ООО "Космеликс Альянс Бийск"


Интифика Chlamydia trachomatis
Набор реагентов для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis*
методом ПЦР в режиме реального времени

LOT 441-02
ОГРНИП 112
ИПВ 112
Годен до 2018-05-11
Срок годности 112
Срок годности 112

Форма Т


Состав набора

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. ПЦР-смесь-Ct | 112 пр. |
| 2. Таq | 1 пр. |
| 3. ПКО | 1 пр. |
| 4. ВКО | 2 пр. |
| 5. ОКО | 1 пр. |

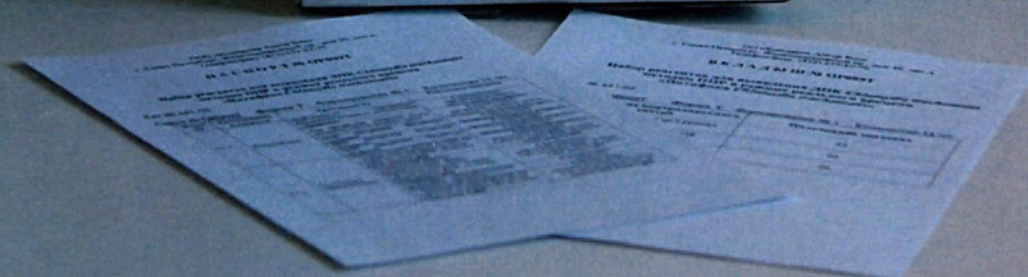

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 (74) лист 9

Генеральный директор
ООО «Компания Аякор Био»
Д.Г. Полынцев



Макеты этикеток на медицинское изделие

Набор реагентов для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* методом ПЦР в режиме реального времени «Интифика *Chlamydia trachomatis*»

- внешняя этикетка на набор «Интифика *Chlamydia trachomatis*», форма S – лист 2;
- внутренние этикетки на набор «Интифика *Chlamydia trachomatis*», форма S – лист 3;
- внешняя этикетка на набор «Интифика *Chlamydia trachomatis*», форма T – лист 4;
- внутренние этикетки на набор «Интифика *Chlamydia trachomatis*», форма T – лист 5.

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Интифика Chlamydia trachomatis

Внешняя этикетка

группа компаний

АЛКОР БИО



Кат. №441-01

Форма S



ТУ 21 20 23-253-98539446-2016
РУ

Интифика
Chlamydia trachomatis


Интифика Chlamydia trachomatis

Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis
методом ПЦР в режиме реального времени


Форма S

Состав набора

1. ПЦР-смесь-Ct	14 стрипов по 8 пр
2. Taq	1 пр.
3. ПКО	1 пр.
4. ВКО	2 пр.
5. ОКО	1 пр.

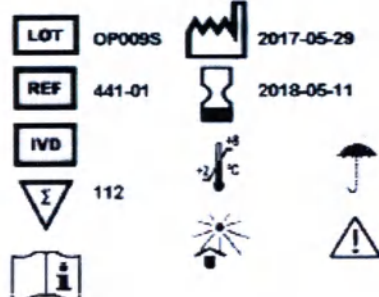

Интифика
Chlamydia trachomatis

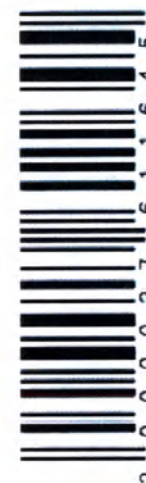

F1



Интифика *Chlamydia trachomatis*

Внутренние этикетки

Кат.№ 441-01

Форма S



ПЦР-смесь-St
Интифика
Chlamydia trachomatis
Форма S   
14 стрипов по 8 пробирок
серия № 009
годен до 2018-05-11
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

 **ВКО**
Интифика
Chlamydia trachomatis
Форма S
объем 1120 мкл 
серия № 009
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

 **ОКО**
Интифика
Chlamydia trachomatis
Форма S
объем 1500 мкл 
серия № 009
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

 **Taq**
Интифика
Chlamydia trachomatis
Форма S
объем 1120 мкл 
серия № 009
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

 **ВКО**
Интифика
Chlamydia trachomatis
Форма S
объем 1120 мкл 
серия № 009
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

 **ПКО**
Интифика
Chlamydia trachomatis
Форма S
объем 250 мкл 
серия № 009
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Интифика Chlamydia trachomatis

Внешняя этикетка

ГРУППА КОМПАНИЙ

АЛКОР БИО



Кат. №441-02

Форма Т



ТУ 21.20.23-253-98539446-2016
РУ

Интифика
Chlamydia trachomatis


Интифика Chlamydia trachomatis

Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis
методом ПЦР в режиме реального времени

Форма Т

Состав набора

1. ПЦР-смесь-Ct	112 пр
2. Taq	1 пр
3. ПКО	1 пр
4. ВКО	2 пр
5. ОКО	1 пр

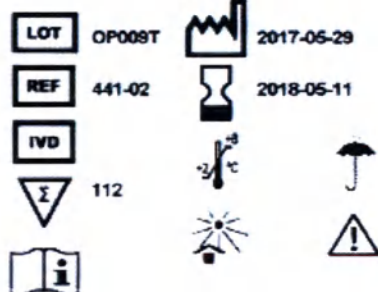

Интифика
Chlamydia trachomatis



F1



Интифика *Chlamydia trachomatis*

Внутренние этикетки

Кат.№ 441-02

Форма Т

Intifica

ПЦР-смесь-Ст

Интифика

Chlamydia trachomatis

Форма Т



IVD

112 пробирок

серия № 009

годен до 2018-05-11

хранить при +2...+8 °С

готов к использованию

ООО "Компания Алкор Био"

Intifica
ПКО
Интифика
Chlamydia trachomatis
Форма Т
объем 250 мкл
серия № 009
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica
ОКО
Интифика
Chlamydia trachomatis
Форма Т
объем 1500 мкл
серия № 009
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica
ВКО
Интифика
Chlamydia trachomatis
Форма Т
объем 1120 мкл
серия № 009
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica
ВКО
Интифика
Chlamydia trachomatis
Форма Т
объем 1120 мкл
серия № 009
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Intifica
Тaq
Интифика
Chlamydia trachomatis
Форма Т
объем 1120 мкл
серия № 009
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 56 не мб) лист 56

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полынцев

