




Фотографии медицинского изделия

**Набор реагентов с принадлежностями для количественного
иммуноферментного определения лютеинизирующего гормона в
сыворотке крови человека» («ГонадотропинИФА-ЛГ») по ТУ
21.20.23-216-98539446-2017,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

- фотография «ГонадотропинИФА-ЛГ» по ТУ 21.20.23-216-98539446-2017, комплектация №1– лист 2;
- фотография «ГонадотропинИФА-ЛГ» по ТУ 21.20.23-216-98539446-2017, комплектация №1, КП и КС укрупнено– лист 3;
- фотография «ГонадотропинИФА-ЛГ» по ТУ 21.20.23-216-98539446-2017, комплектация №1, буфер Р, Стоп-реагент, конъюгат Е, ТМБ укрупнено – лист 4;
- фотография принадлежностей при полной комплектации набора, принадлежности представлены в максимально возможном количестве. (состав поставляемых с набором принадлежностей определяется заказчиком) - лист 5;
- фотография «ГонадотропинИФА-ЛГ» по ТУ 21.20.23-216-98539446-2017, комплектация №2– лист 6;
- фотография «ГонадотропинИФА-ЛГ» по ТУ 21.20.23-216-98539446-2017, комплектация №2, КП и КС укрупнено– лист 7;
- фотография «ГонадотропинИФА-ЛГ» по ТУ 21.20.23-216-98539446-2017, комплектация №2, буфер Р, Стоп-реагент, конъюгат Е, ТМБ укрупнено – лист 8;
- фотография принадлежностей при полной комплектации набора, принадлежности представлены в максимально возможном количестве. (состав поставляемых с набором принадлежностей определяется заказчиком) - лист 9.

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.





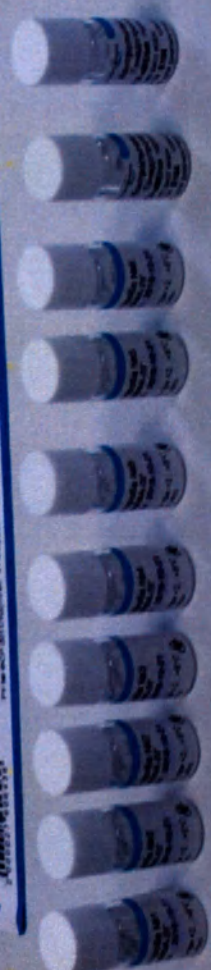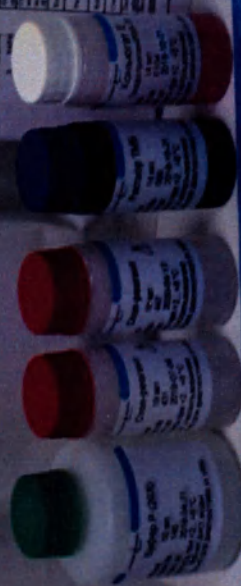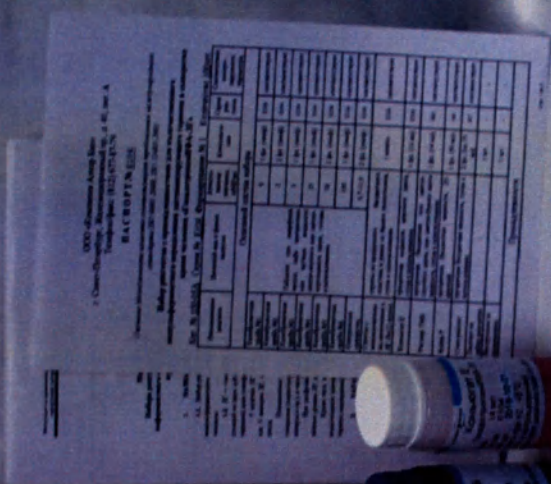



СЗЗ - Государственный завод по производству лекарственных средств
Адрес: 105080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1
Тел: 8 (495) 787 78 123

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Дата
1	Анализ №1	шт.	1	2018-10-21
2	Анализ №2	шт.	1	2018-10-21
3	Анализ №3	шт.	1	2018-10-21
4	Анализ №4	шт.	1	2018-10-21
5	Анализ №5	шт.	1	2018-10-21
6	Анализ №6	шт.	1	2018-10-21
7	Анализ №7	шт.	1	2018-10-21
8	Анализ №8	шт.	1	2018-10-21
9	Анализ №9	шт.	1	2018-10-21
10	Анализ №10	шт.	1	2018-10-21
11	Анализ №11	шт.	1	2018-10-21
12	Анализ №12	шт.	1	2018-10-21
13	Анализ №13	шт.	1	2018-10-21
14	Анализ №14	шт.	1	2018-10-21
15	Анализ №15	шт.	1	2018-10-21
16	Анализ №16	шт.	1	2018-10-21
17	Анализ №17	шт.	1	2018-10-21
18	Анализ №18	шт.	1	2018-10-21
19	Анализ №19	шт.	1	2018-10-21
20	Анализ №20	шт.	1	2018-10-21

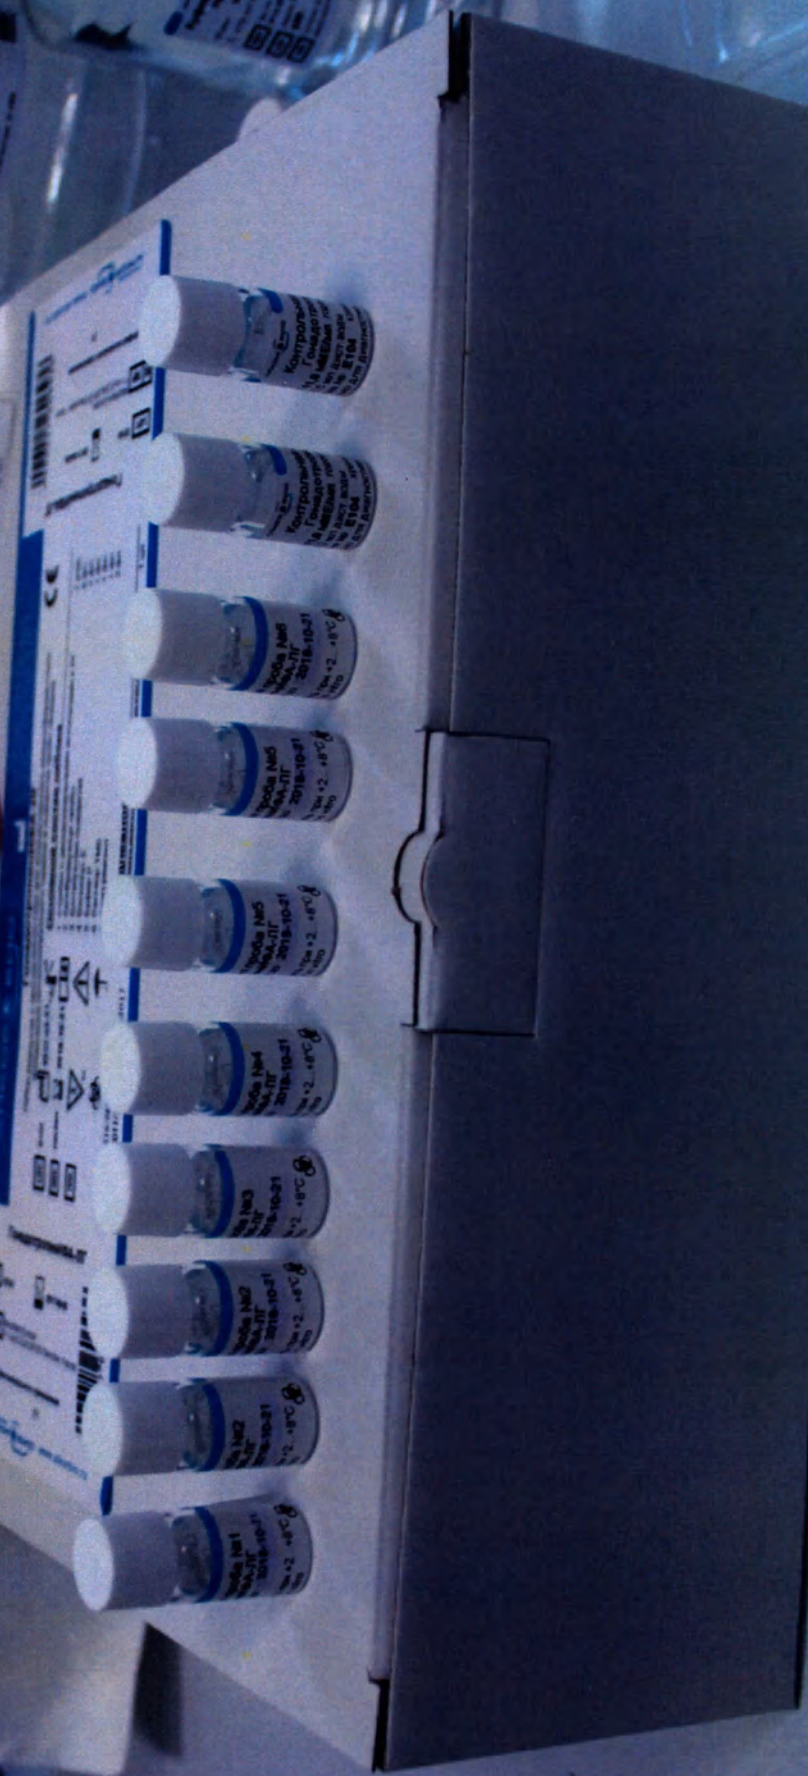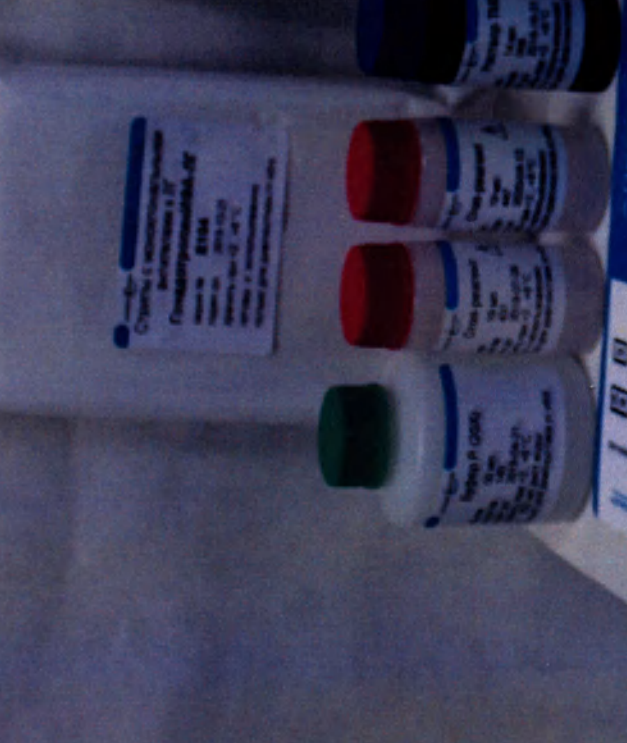

Buffer P (20X)
 50 мл
 160
 2019-04-21
 при +2...+8°C
 для использования в ИУВ
 для диагностики ИУВ

Стоп-регент
 19 мл
 431
 2019-07-06
 при +2...+8°C
 для использования
 для диагностики ИУВ

Стоп-регент
 10 мл
 447
 2020-04-12
 при +2...+8°C
 для использования
 для диагностики ИУВ

Раствор ТМБ
 14 мл
 005
 2018-10-21
 при +2...+8°C
 для использования
 для диагностики ИУВ

Конъюгат Е
 14 мл
 5104
 2018-10-21
 при +2...+8°C
 для использования
 для диагностики ИУВ

ООО «Компания Алкор Бьюс»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E104

Система Менеджмента качества соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, ISO 13485:2003



Выбор реагентов с признаками качества для количественного и качественного определения антигенных и антител в сыворотке крови человека «Биодирект ИФА-ЛГ»

Серия № E104. Формирование М.А.

Кат. № 100-05А

Наименование
Вид

[illegible]

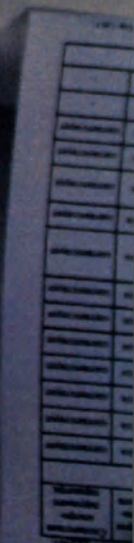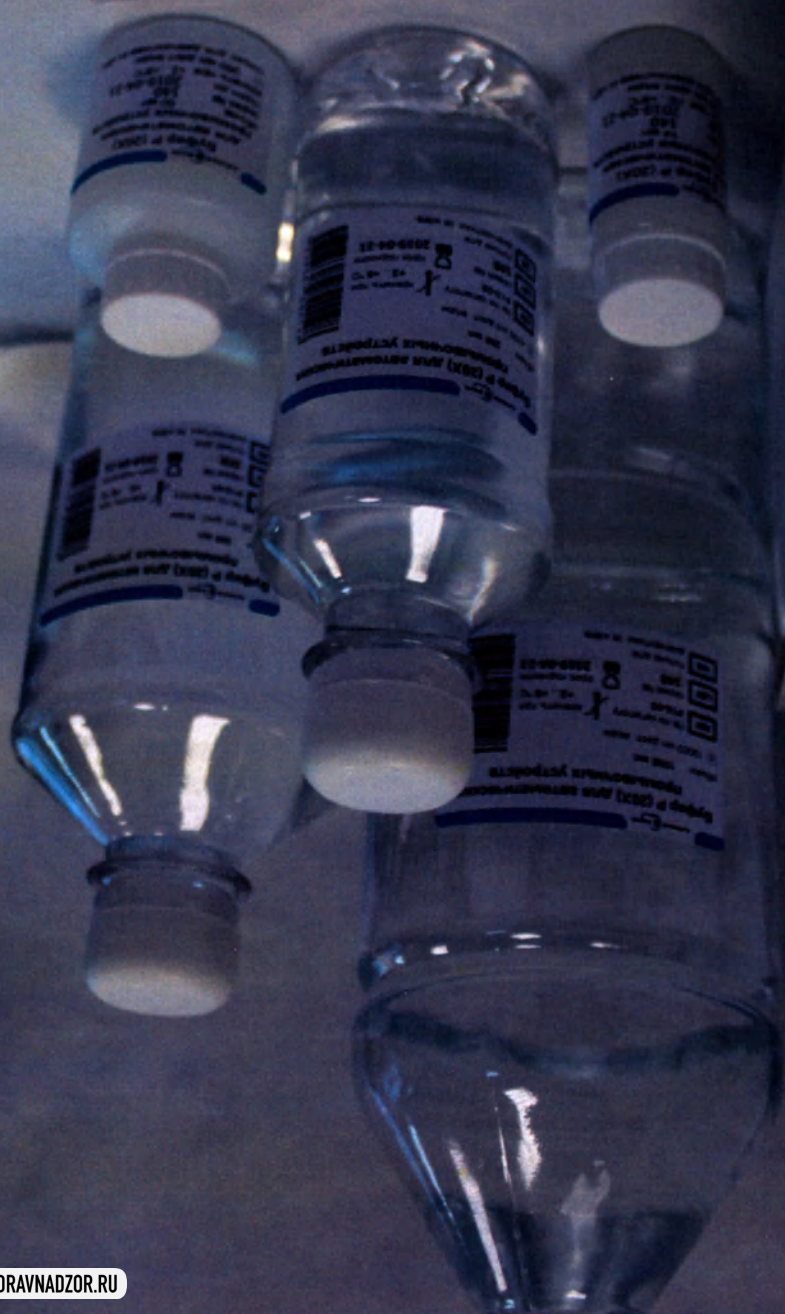



Исключение из архива документов и предоставление для использования информации
персональным и служебным лицам и сотрудникам органов государственной власти РФ - № 10

«УТВЕРЖД

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор»
Полномочный
а. « 201

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Машинного извлечения для диагностики *in vitro*
Набора реагентов с принадлежностями для количественного имму-
ноферментного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке
крови человека «Гонадотропин(ФА-П)»

1. НАМНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реактивов «Исодитрол» ФЭЛ-П предназначен для количественного многофакторного определения летучих органических горючих (ЛОГ) в сыроватке крови животных.

1.2. П — глицериловый термик с молекулярной массой около 30 000 Да, состоящий из двух субстанций — альфа и бета. П стабилизирует биологические материалы в течение двух недель.

У мужчин П стимулирует синтез тестостерона в лейдиновых клетках гипогонадизма. У животных П, вводимый в дозах, превышающих 10 мг/кг, вызывает гиперплазию простаты.

Полосинки крови П не вызывают гемолиза, поэтому могут использоваться для гематологических исследований.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

[illegible]

... в изложенном образе (Рисунок 1).

[illegible][illegible][illegible]

101

[illegible]





Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 (деветь) лист



Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полинцев