


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Стерилизаторы плазменные Stericool с использованием перекиси водорода, модели
A160SF, A160DF, A110SF, A110DF


Генеральный директор
ООО "Маке"
(Должность)



А.М. Медникова
(И.О. Фамилия)

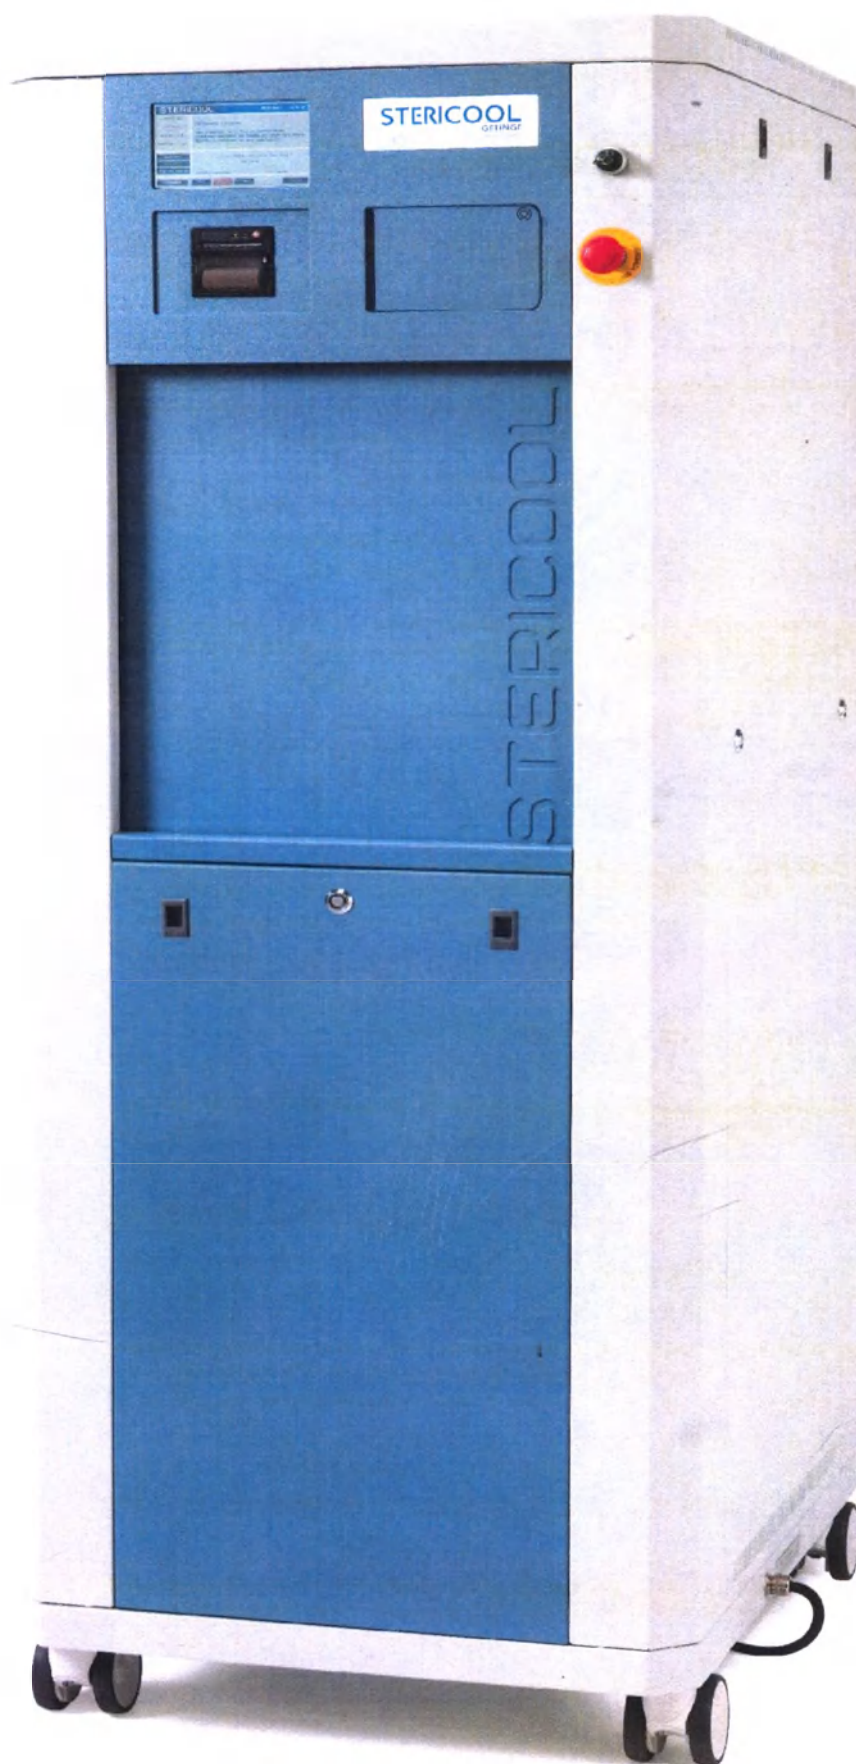

Общий вид: Стерилизатор плазменный *Stericool A160SF* с использованием перекиси водорода

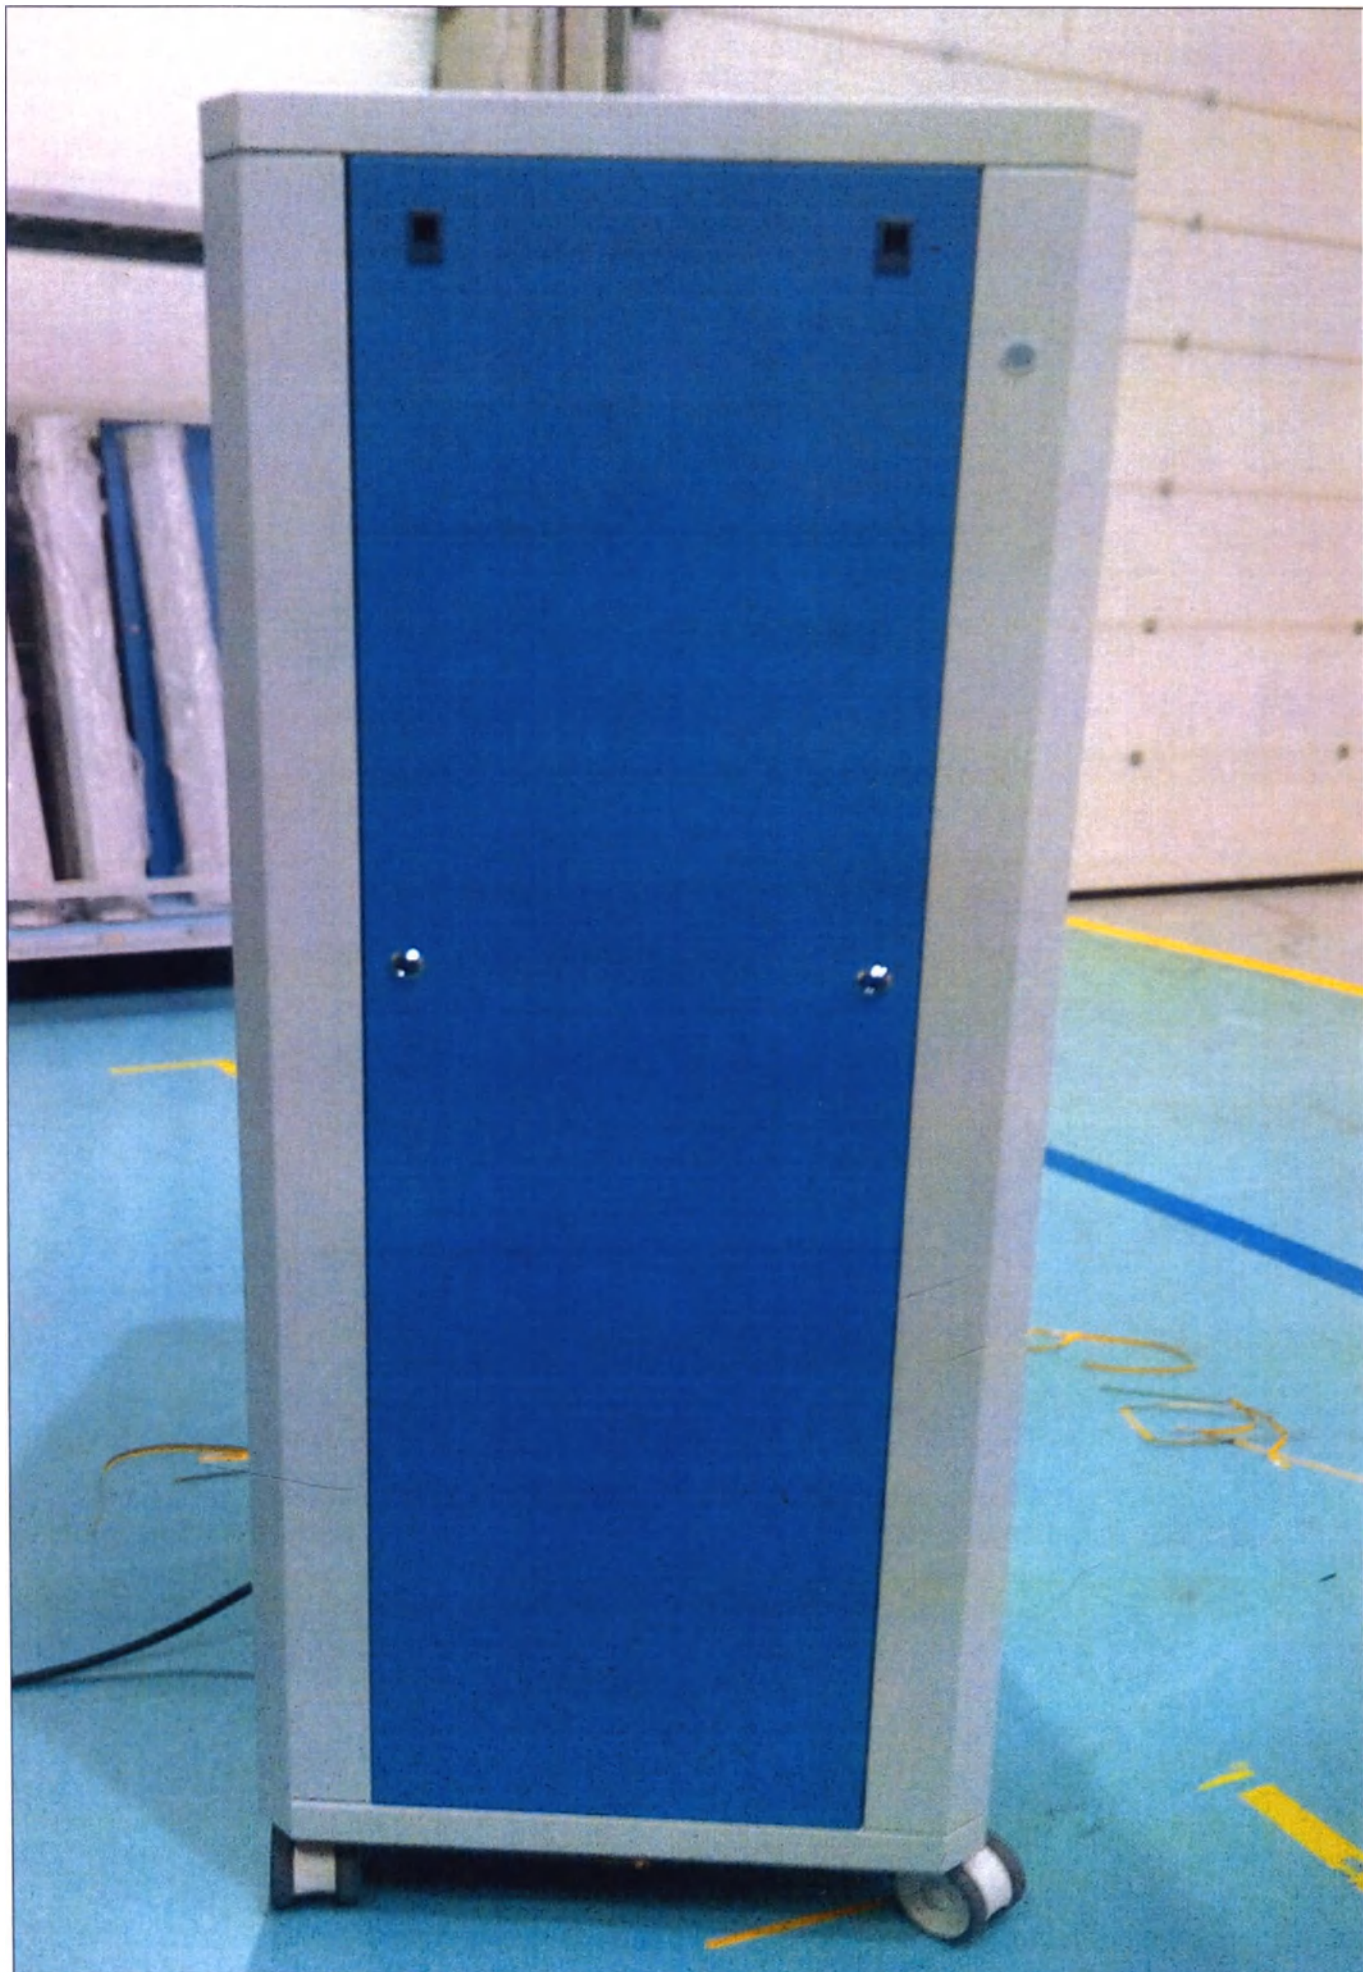


Общий вид: Стерилизатор плазменный *Stericool A160SF* с использованием перекиси водорода (обратная сторона)




Общий вид: : Стерилизатор плазменный *Stericool A160DF* с использованием перекиси водорода




Общий вид: : Стерилизатор плазменный *Stericool A160DF* с использованием перекиси водорода (обратная сторона)

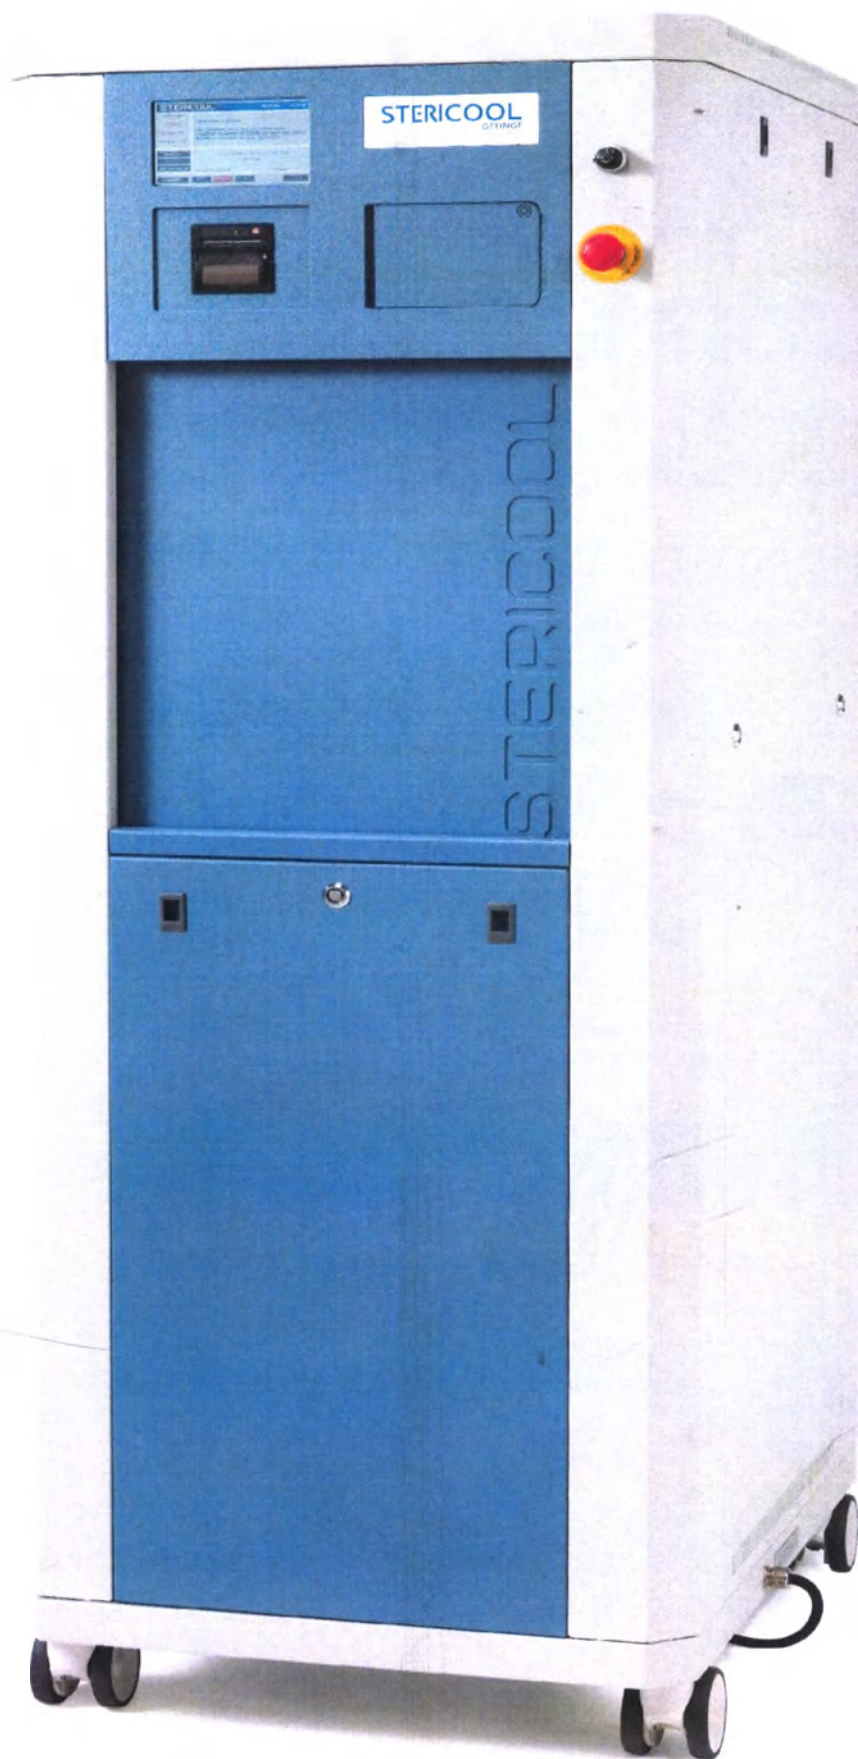

Общий вид: : Стерилизатор плазменный водорода *Stericool A110SF* с использованием перекиси

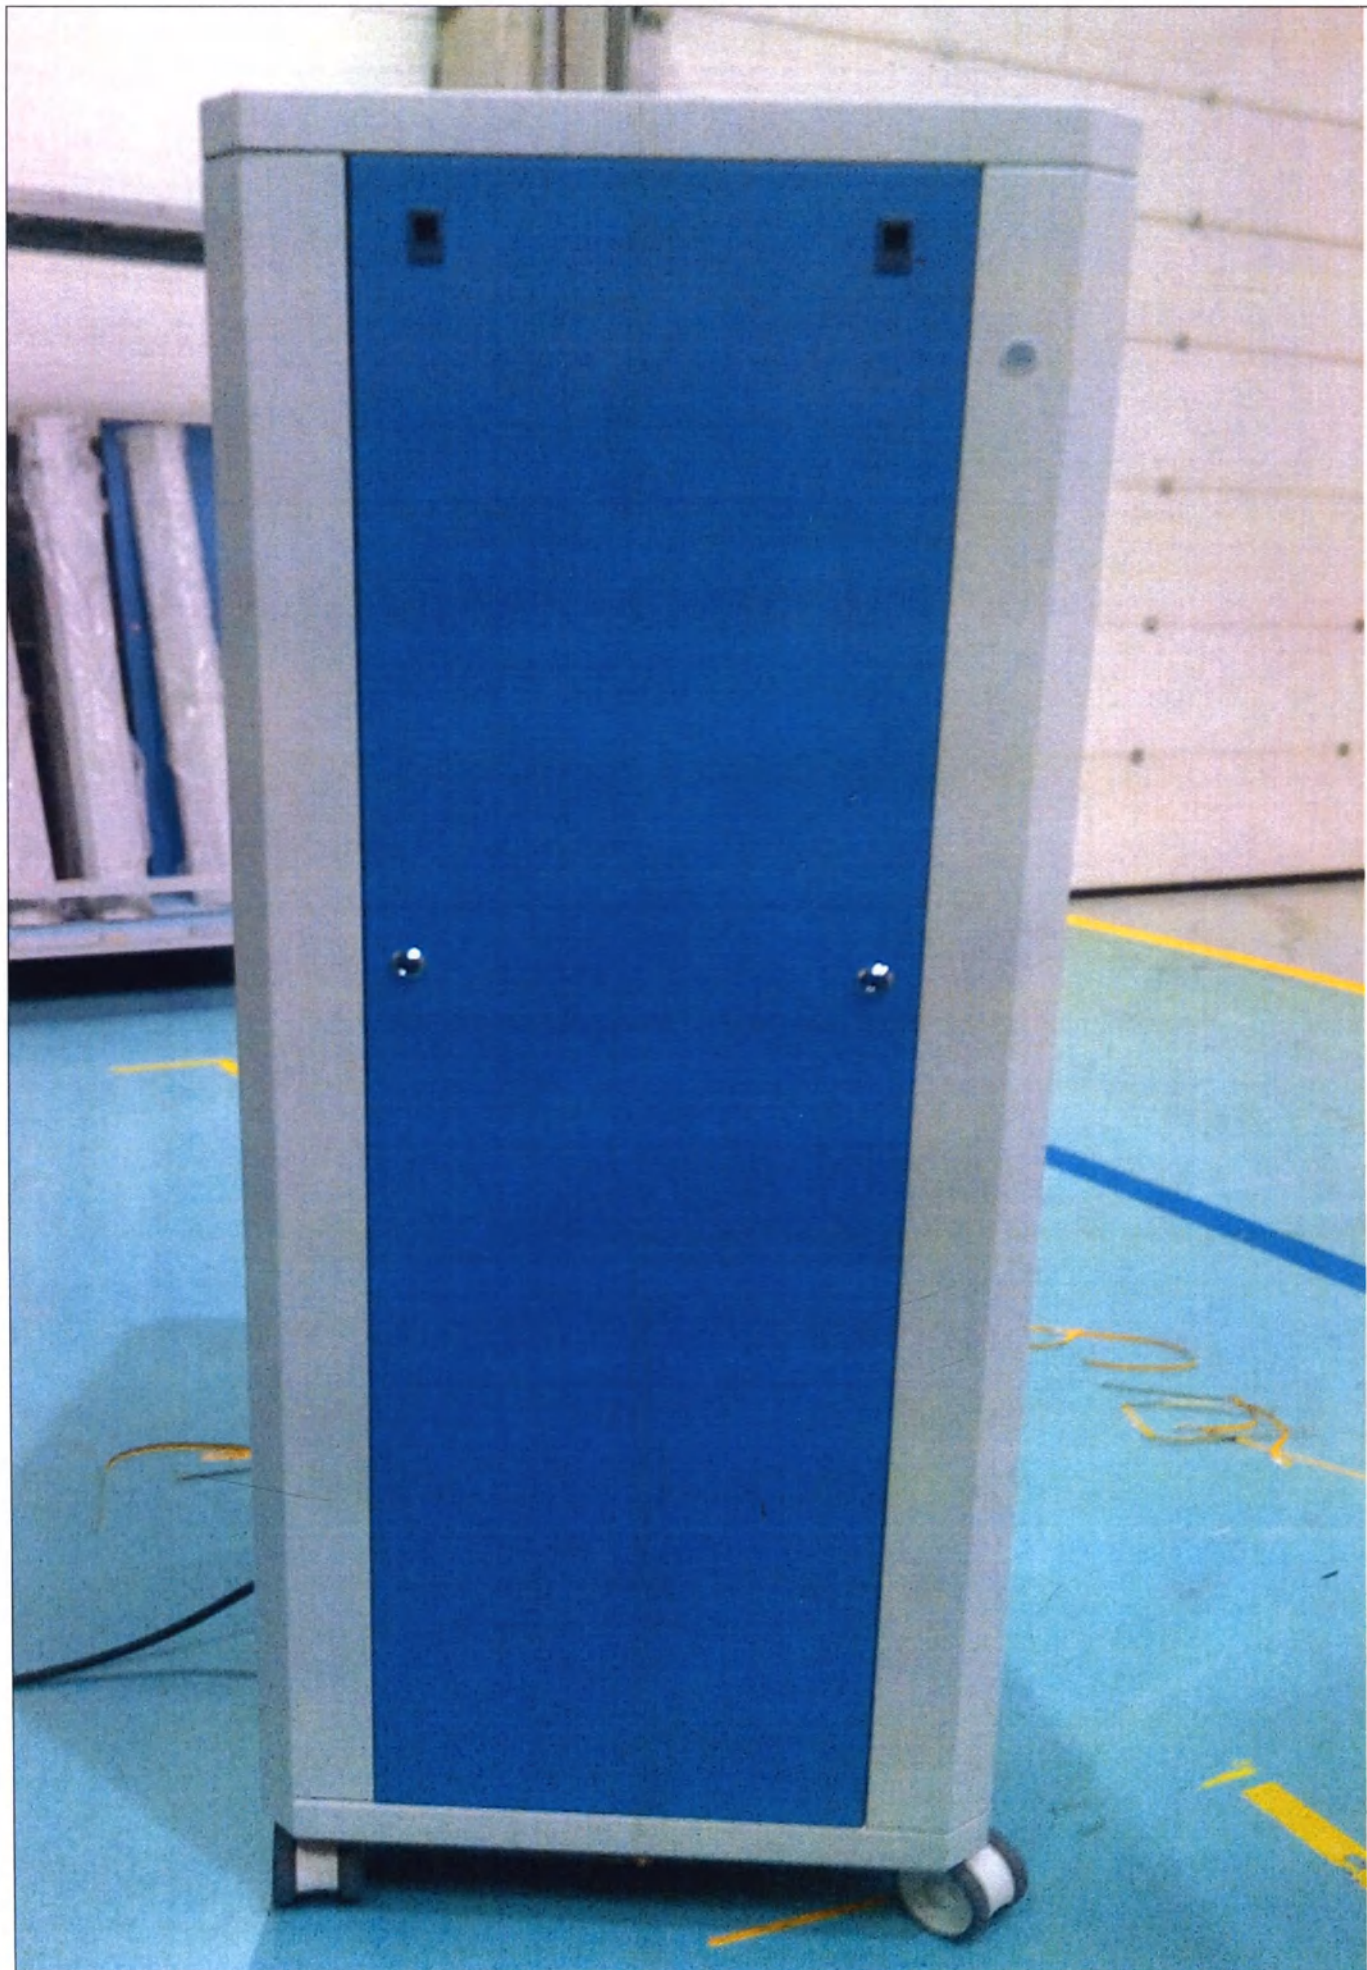


Общий вид: : Стерилизатор плазменный водорода *Stericool A110SF* с использованием перекиси (обратная сторона)

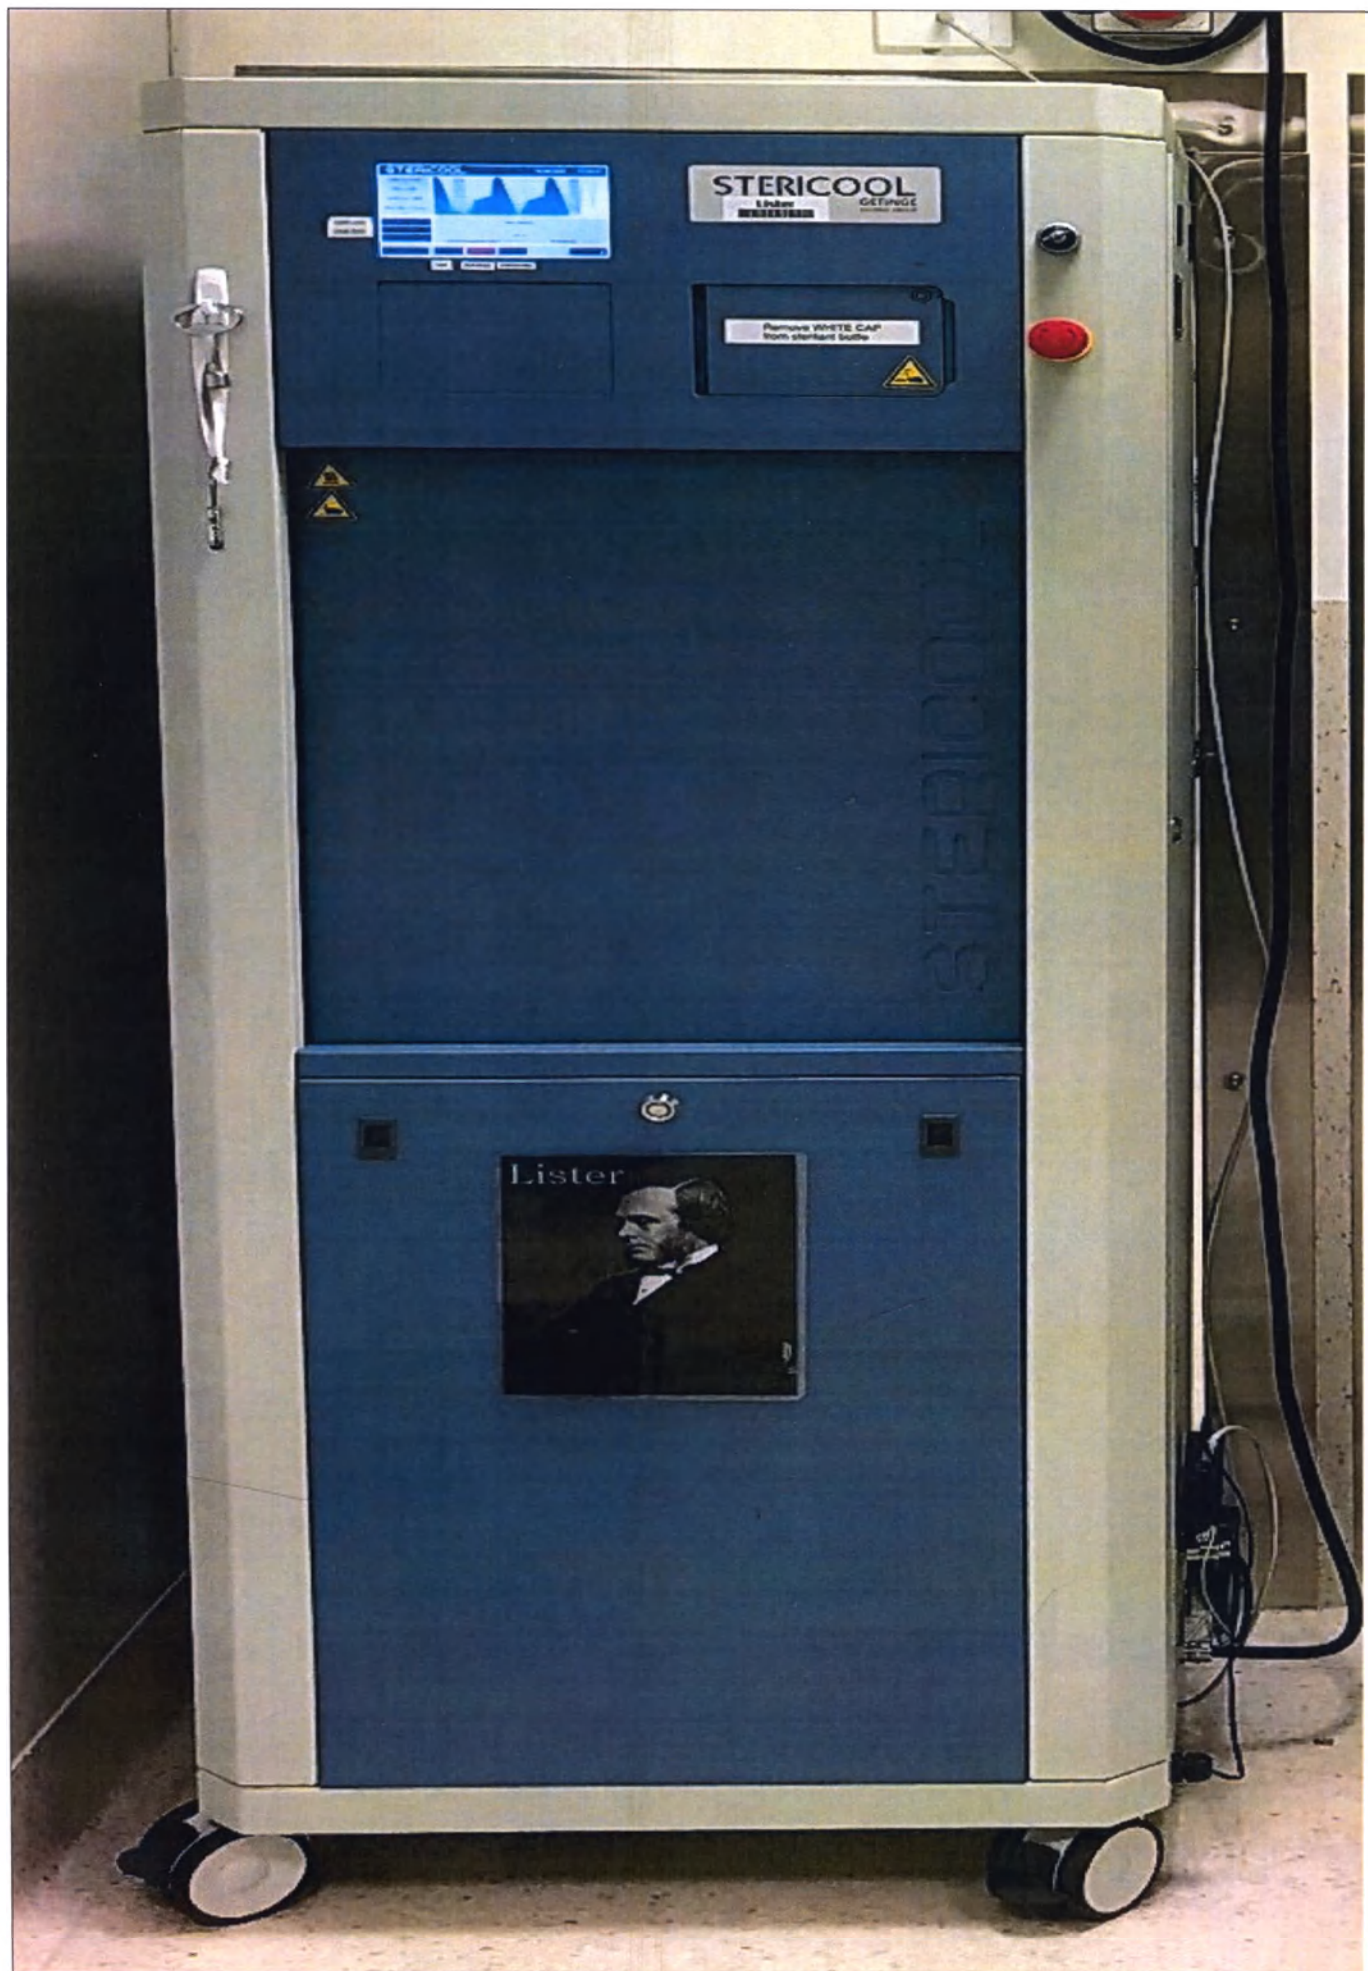

Общий вид: : Стерилизатор плазменный *Stericool A110DF* с использованием перекиси водорода



Общий вид: : Стерилизатор плазменный *Stericool A110DF* с использованием перекиси водорода (обратная сторона)



1. Камера



2. Инжектор-концентратор

STERICOOOL

00.00.0000

00:00:00

TEMPERATURE

52 °C

PRESSURE

760 m Torr

ELAPSED TIME

00:00 Sec.

MACHINE CYCLES

0



Opening the Door.

STOP

Open Door

Close Door

Open Cartridge Bay

Door is OPENING Please Wait.

H2O2 Expiration Date:

Remaining:

Diagnostics

FAST

STANDARD

ADVANCE

Proceed






5. Датчик давления







7. Каталитический преобразователь



8 Вакуумный насос








11. Воздушный фильтр



12. Уплотнительное кольцо

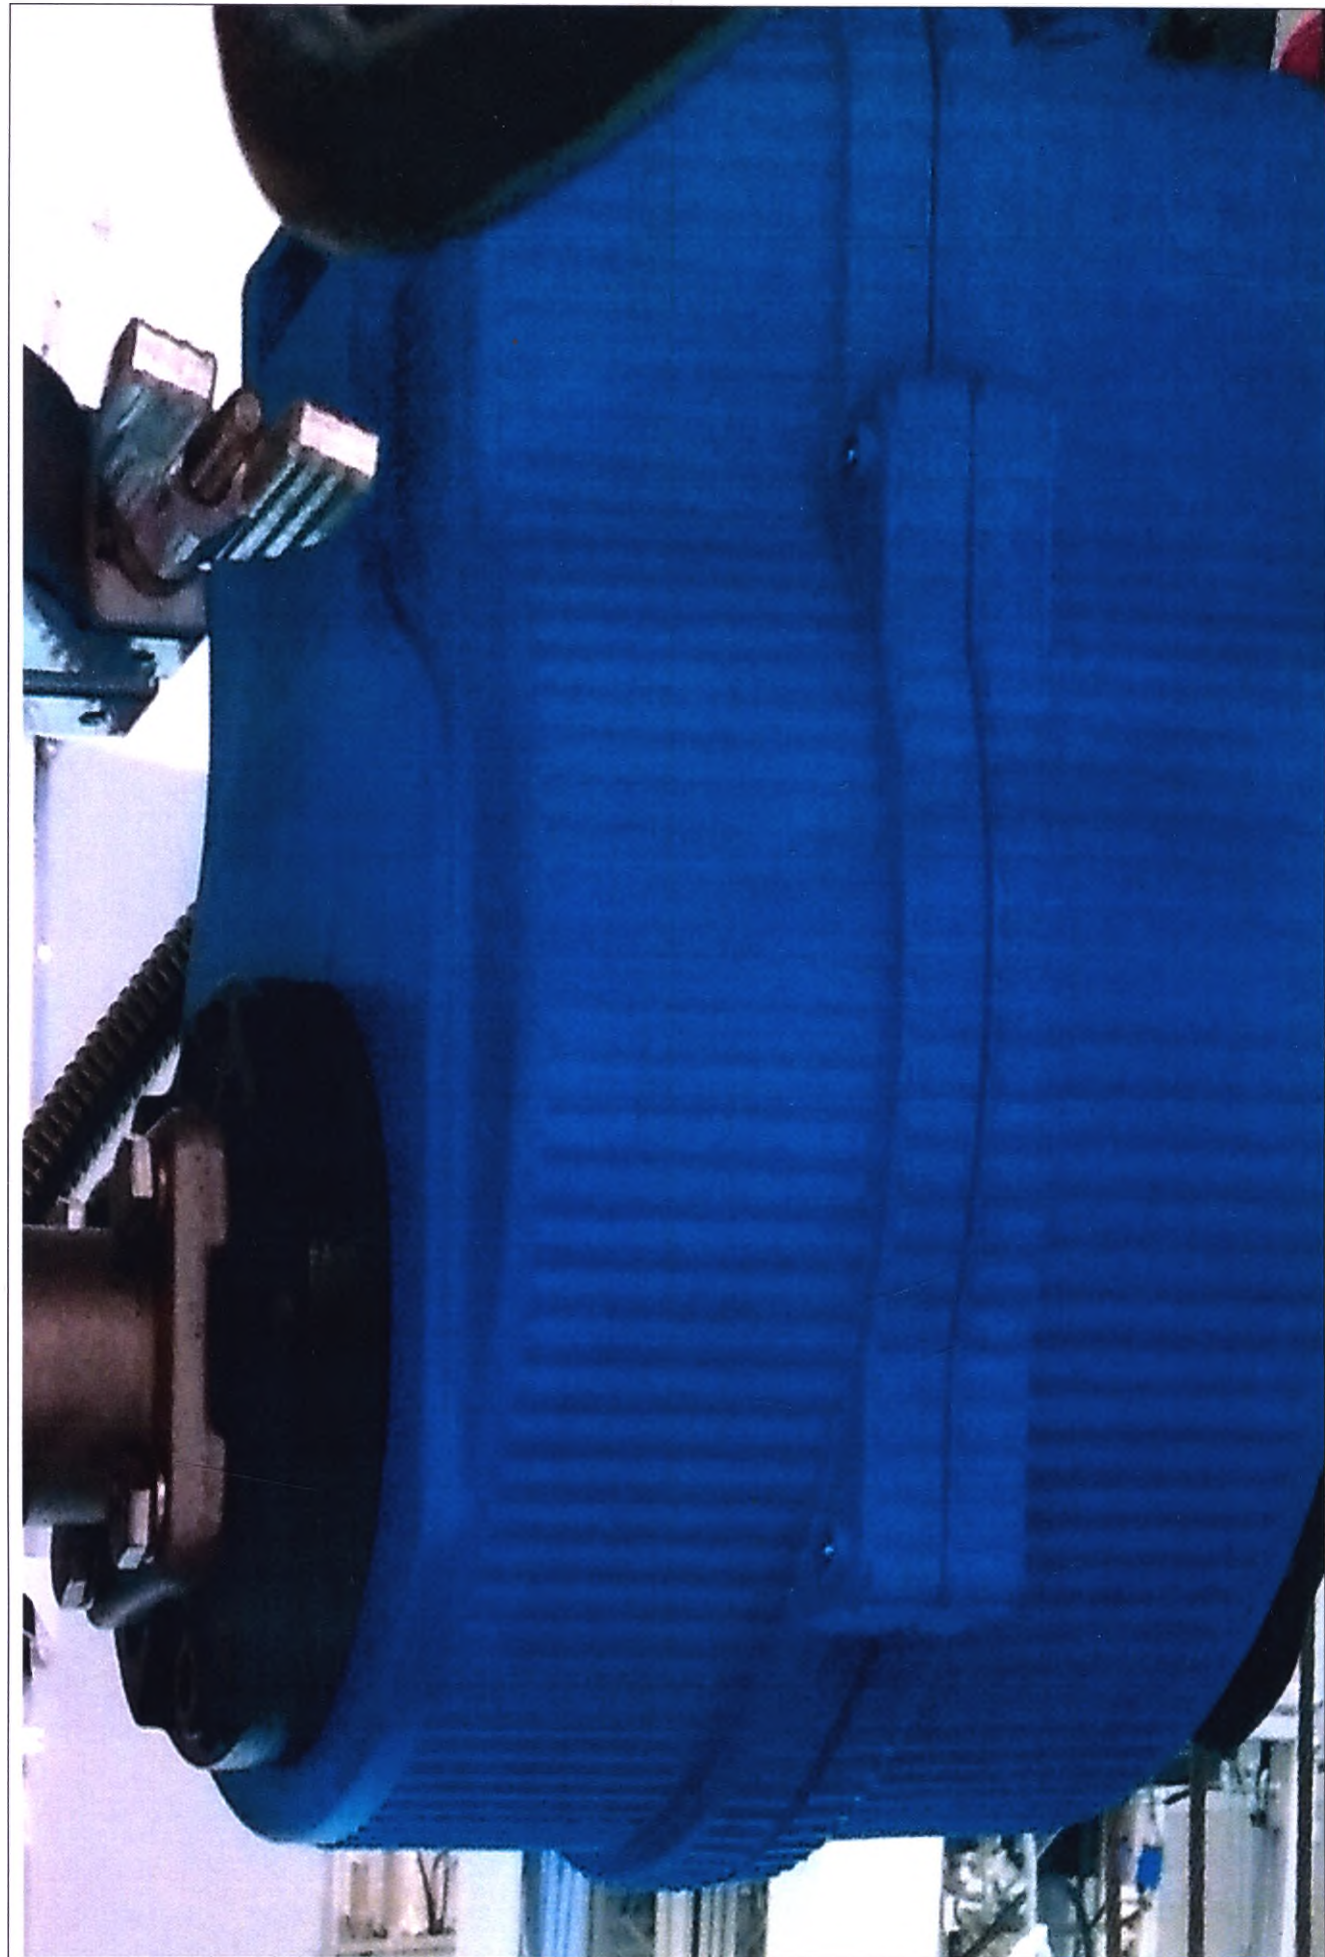

13. Электромагнитный клапан



14. Картриджи со стерилизующим агентом, варианты исполнения: ST 240

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

линейки плазменных стерилизаторов STERICOOOL с использованием перекиси водорода

A160SF, A160DF, A110SF, A110DF



Низкотемпературная стерильная
повторная обработка
высочайшего стандарта

ИДЕНТИФИКАТОР ДОКУМЕНТА: UM.01-STD201-RU — Руководство пользователя стерилизатора
Stericool плазменных стерилизаторов с использованием перекиси водорода
Редакция 4.404 [соответствует программному обеспечению версии 4], издана 03.09.2018

