

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Петр Телегин»

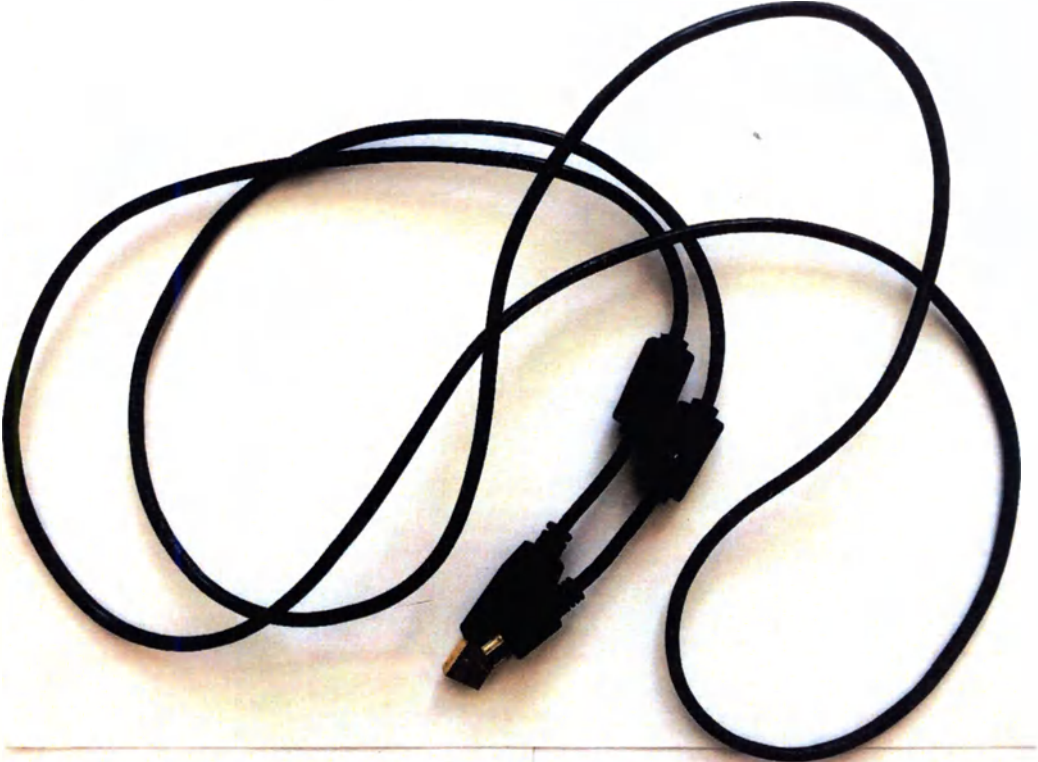
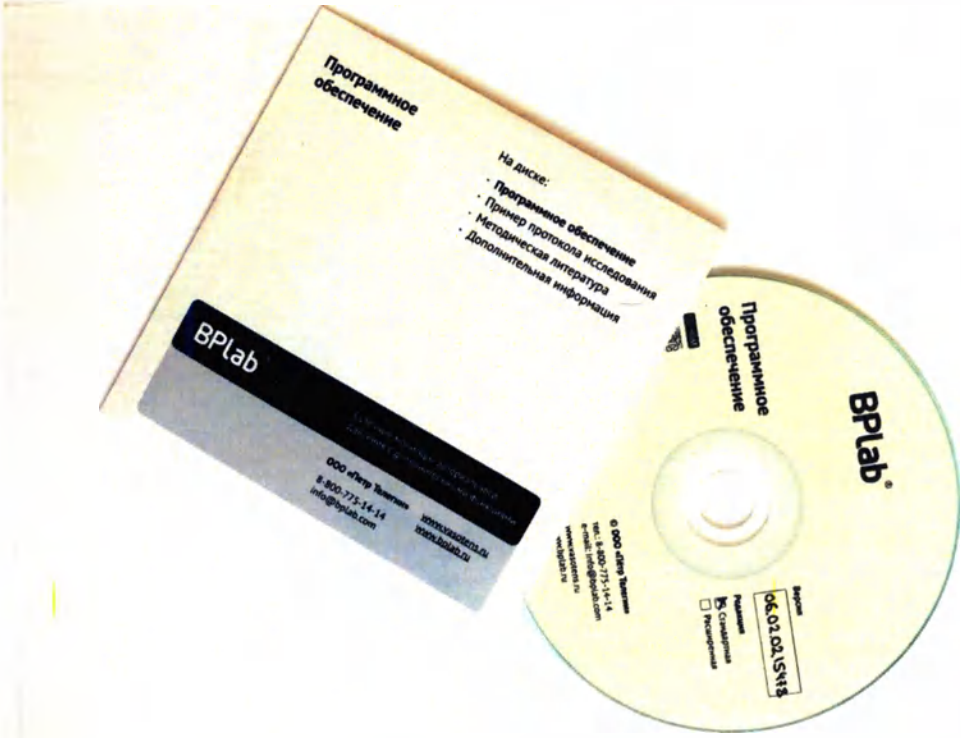


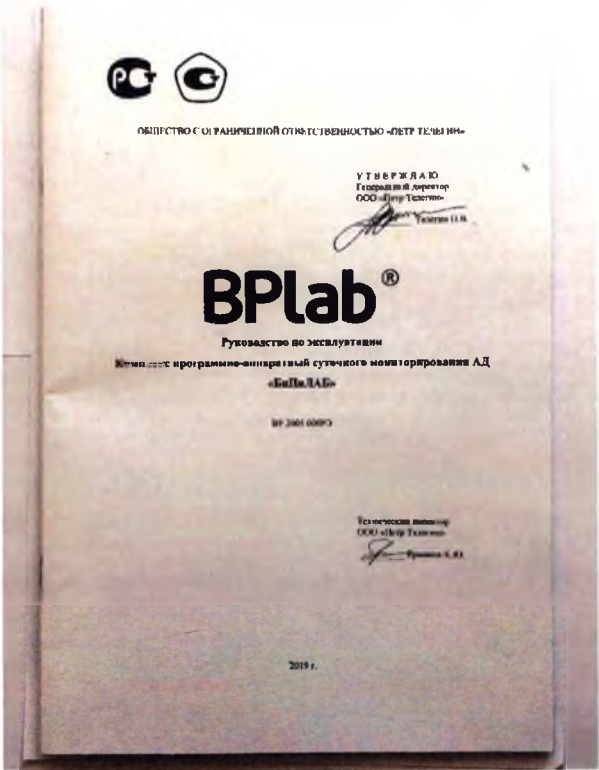
Телегин П.В.

10» марта 2020 г.

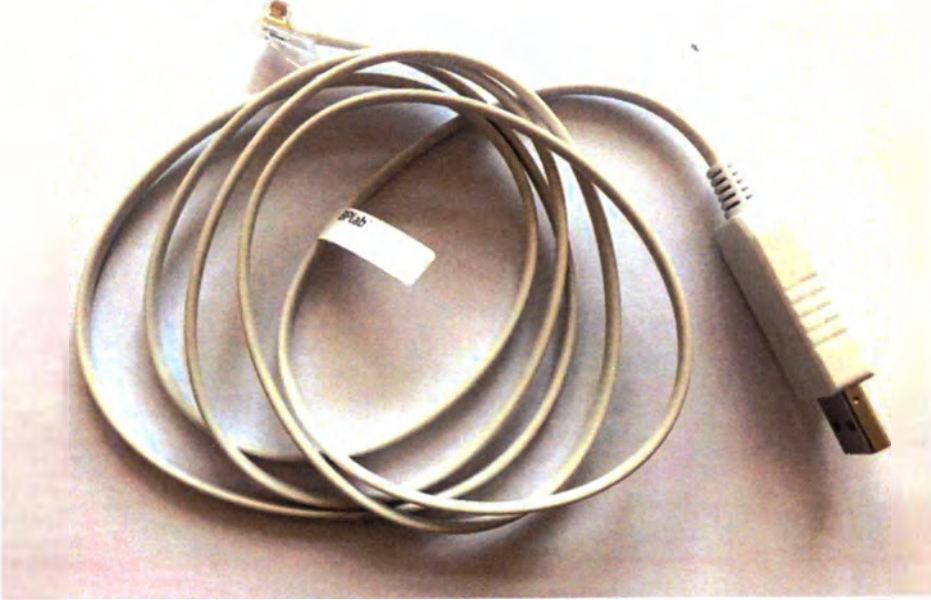
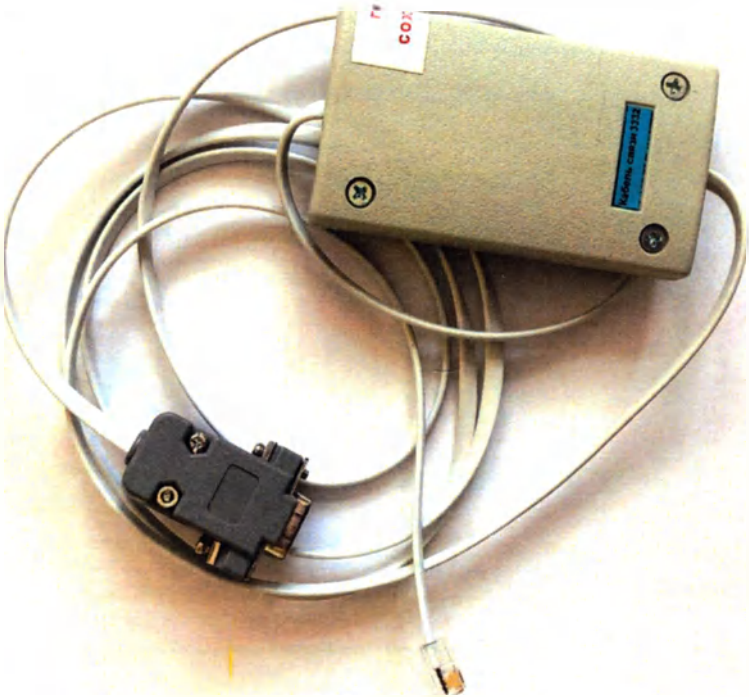
ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

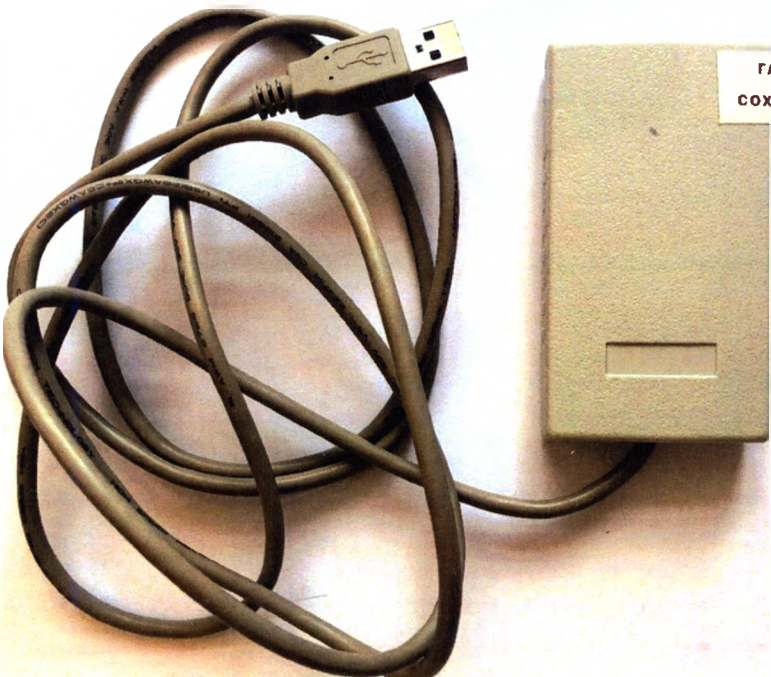
**«Комплекс программно-аппаратный суточного мониторингирования АД
«БиПиЛАБ»**

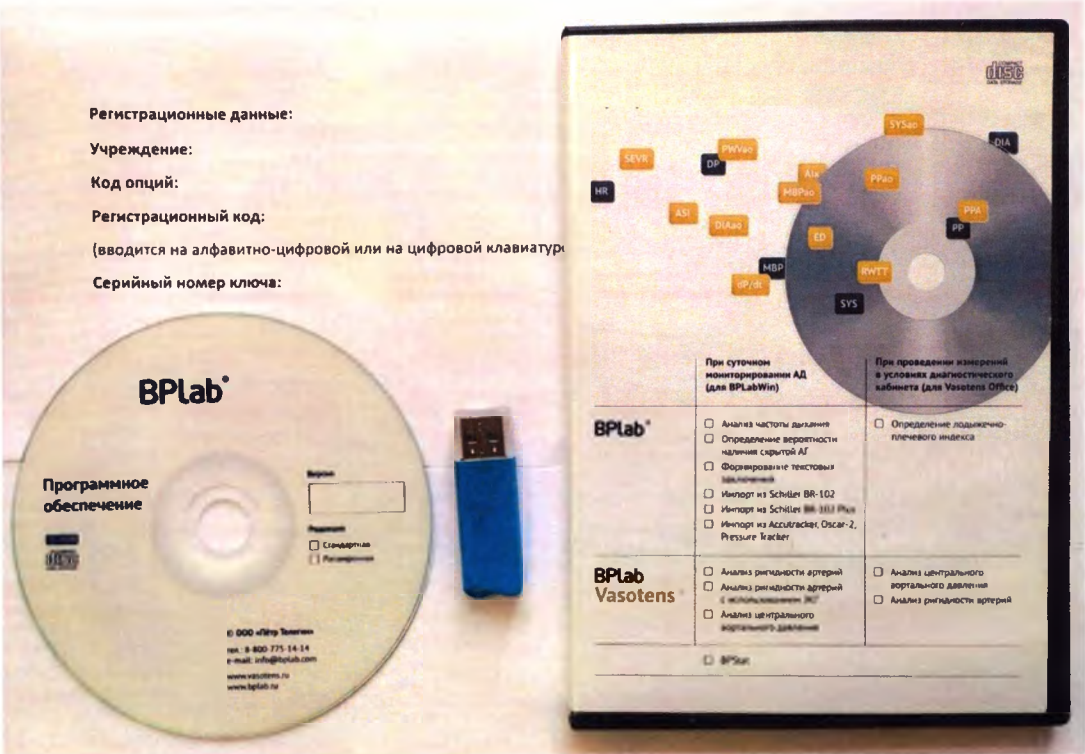
№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
1.	Кабель связи монитора с компьютером для USB-порта	
2.	Программное обеспечение для анализа данных суточного мониторинга АД BPLab (стандартная или расширенная редакция), руководство пользователя и методическое руководство на компакт диске CD	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
3.	Руководство по эксплуатации	
4.	Паспорт на комплекс	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
5.	Паспорт монитора носимого	
6.	Тара потребительская	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
7.	Рабочая станция обработки данных (на базе ПК)	По заявке заказчика может быть представлена в виде ноутбука, моноблока или персонального компьютера с монитором с необходимыми для работы комплектующими и принтером.
8.	Переходник кабеля связи монитора с компьютером	
9.	Кабель связи монитора с компьютером для СОМ-порта	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
10.	Адаптер беспроводного ИК интерфейса для компьютера	
11.	Адаптер беспроводного ИК интерфейса для монитора	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
12.	Адаптер Bluetooth Acorp WBD2-A2 (2.0) ¹	
13.	Программный модуль «Анализ ригидности артерий при суточном мониторировании»	 Регистрационные данные: Учреждение: Код опций: Регистрационный код: (вводится на алфавитно-цифровой или на цифровой клавиатуре) Серийный номер ключа: BPLab® Программное обеспечение Версия: [] Пакет: [] Стандартный [] Расширенный © 2000 «Витро Технологии» тел.: 8 800 775 14 14 e-mail: info@bplab.ru www.vasotens.ru www.bplab.ru BPLab Vasotens® При суточном мониторинге АД (для BPLabWin) ☐ Анализ частоты дыхания ☐ Определение вероятности наличия скрытой АГ ☐ Формирование текстовых записей ☐ Импорт из Schiller BR-102 ☐ Импорт из Schiller BR-103 Plus ☐ Импорт из Accutracker Oscar-2, Pressure Tracker При проведении измерений в условиях диагностического кабинета (для Vasotens Office) ☐ Определение лодыжечно-плечевого индекса ☐ Анализ центрального вортального давления ☐ Анализ ригидности артерий ☐ BPLab
14.	Программный модуль «Анализ ригидности артерий при суточном мониторировании с использованием ЭКГ»	
15.	Программный модуль «Анализ частоты дыхания при суточном мониторировании»	
16.	Программный модуль «Анализ центрального аортального давления при суточном мониторировании»	
17.	Программный модуль «Определение вероятности наличия скрытой АГ по результатам суточного мониторирования АД»	

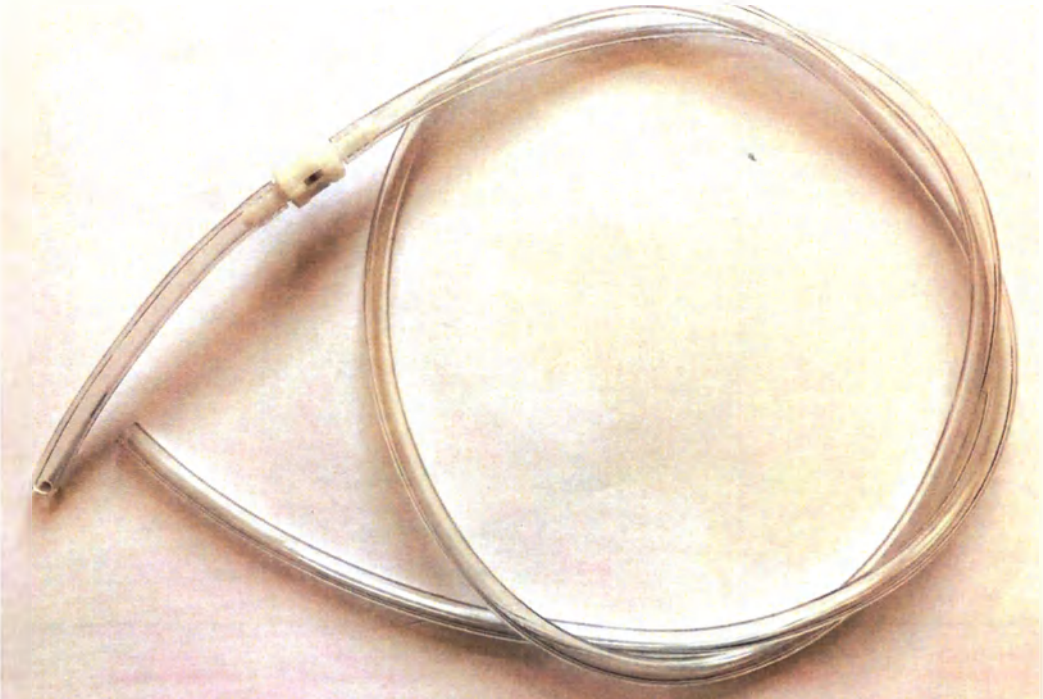
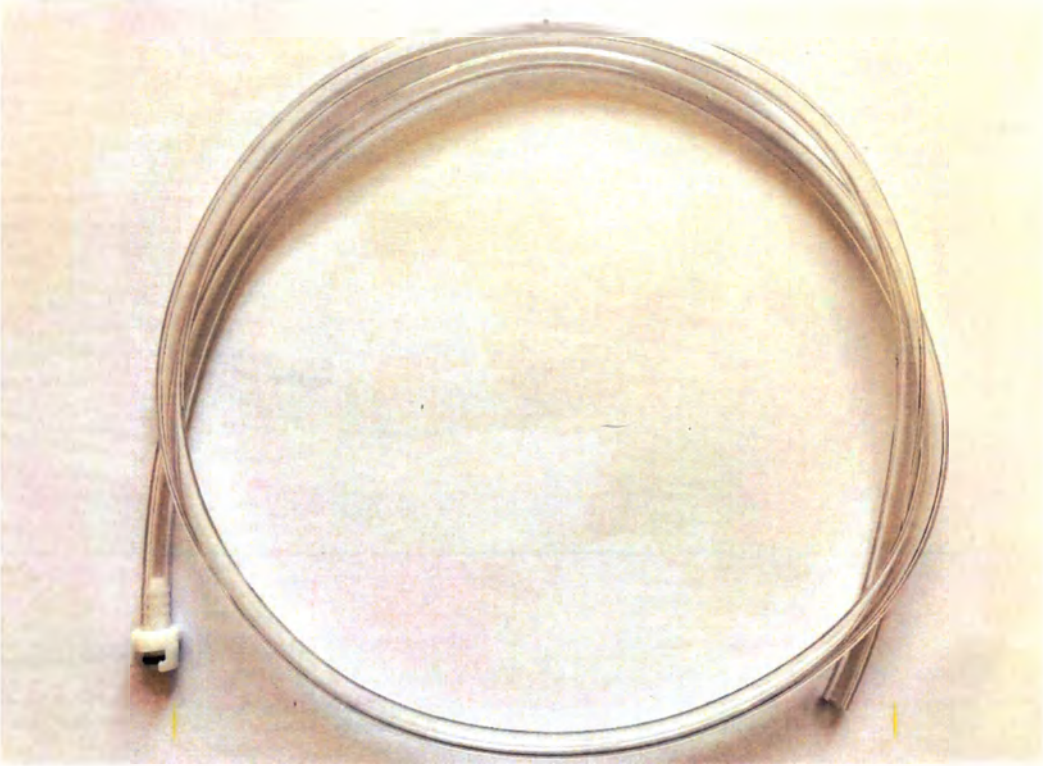
№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
18.	Программный модуль «Формирование текстовых заключений по результатам суточного мониторингов АД»	
19.	Программный модуль «Импорт из Schiller BR-102»	
20.	Программный модуль «Импорт из Schiller BR-102 Plus»	
21.	Программный модуль «Импорт из SpaceLabs»	
22.	Программный модуль «Импорт из Accutrack, Oscar-2, Pressure Tracker»	
23.	Программный модуль «Определение лодыжечно-плечевого индекса в условиях диагностического кабинета»	
24.	Программный модуль «Анализ центрального аортального давления в условиях диагностического кабинета»	
25.	Программный модуль «Анализ ригидности артерий в условиях диагностического кабинета»	
26.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ" в варианте комплектации "Н"	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
27.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ" в варианте комплектации "К"	
28.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ" в варианте комплектации "А"	
29.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ" в варианте комплектации "В"	
30.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ" в варианте комплектации "АВ"	
31.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ" в варианте комплектации "АК"	
32.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ" в варианте комплектации "АКВ"	
33.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "Н"	
34.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "К"	
35.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "А"	
36.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "В"	
37.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "АВ"	

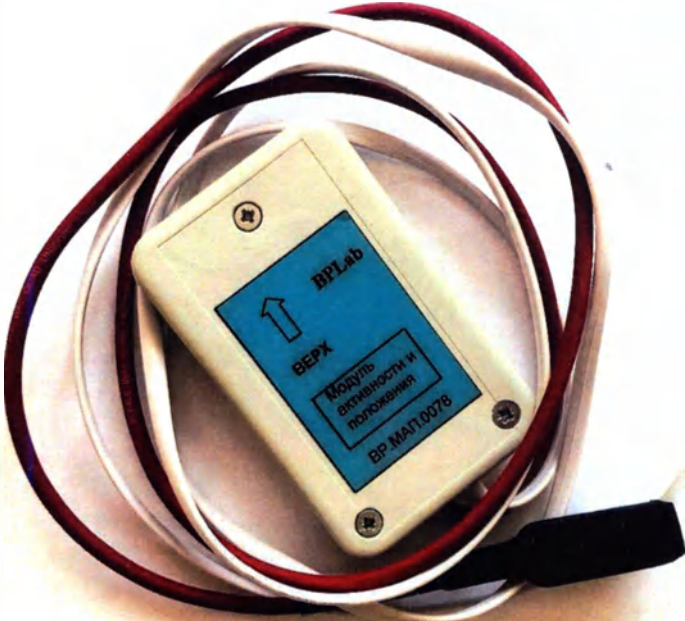
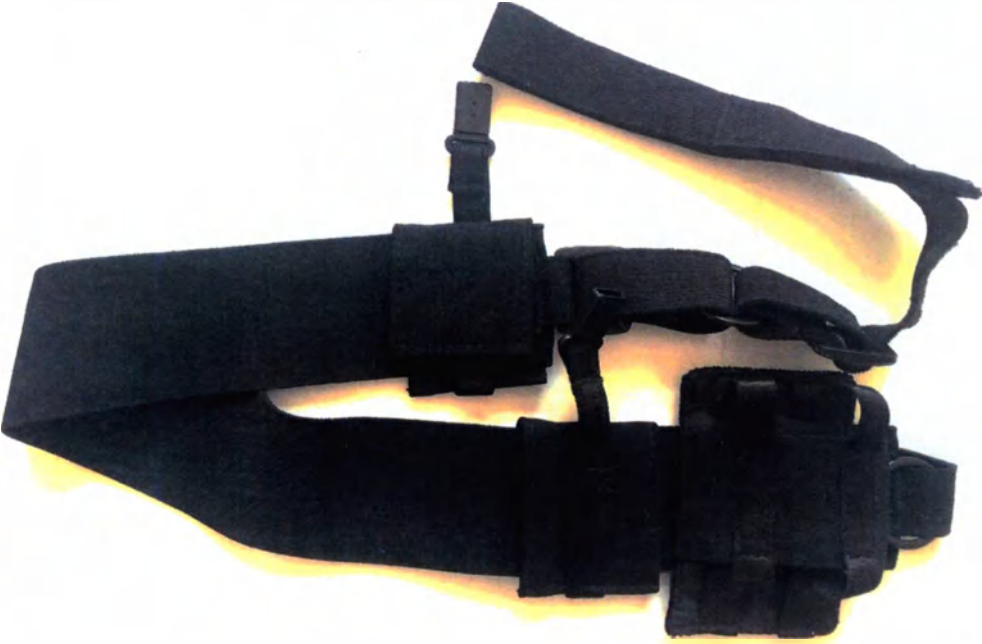
№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
38.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М " в варианте комплектации "АК"	
39.	Монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "АКВ"	
40.	Чехол с поясным и плечевым ремнем ВР.005.002	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
41.	Чехол с поясным и плечевым ремнем ВР.М000.002	
42.	Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой для взрослых, 24-32 см ²	Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00592
43.	Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой для взрослых, 28-40 см ²	
44.	Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой большая для взрослых, 32-42 см ²	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
45.	Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой радиусная для взрослых, 38-50 см ²	Манжеты компрессионные пневматические с текстильной застежкой для детей и взрослых 
46.	Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой бедренная для взрослых, 45-60 см ²	
47.	Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой малая для детей, 12-16 см ²	
48.	Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой средняя для детей, 16-24 см ²	
49.	Прищепка для манжеты	

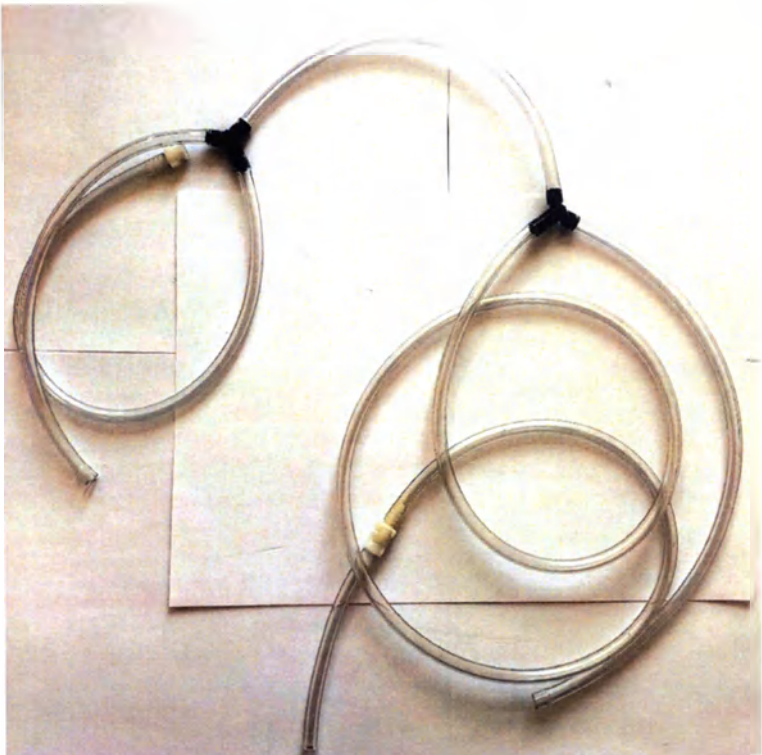
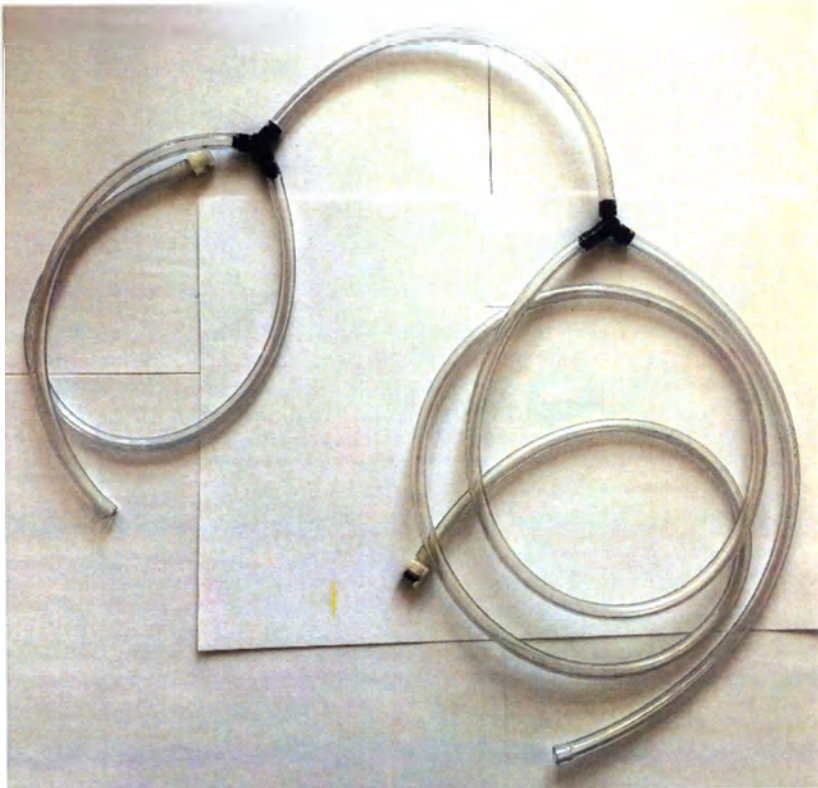
№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
50.	Шланг удлинительный ВР.005.007	
51.	Шланг удлинительный ВР.М000.003	

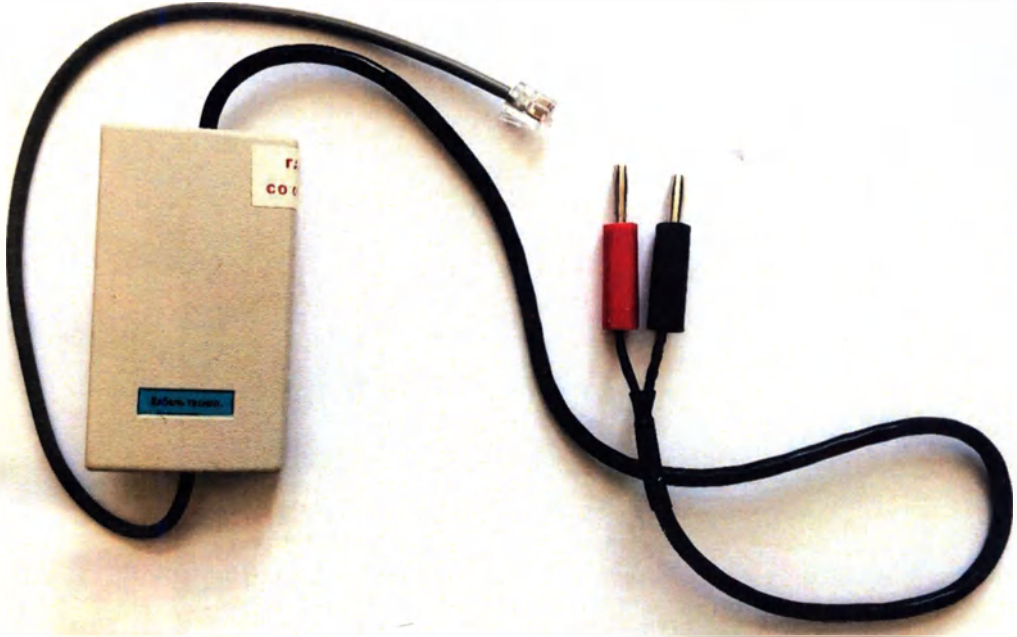
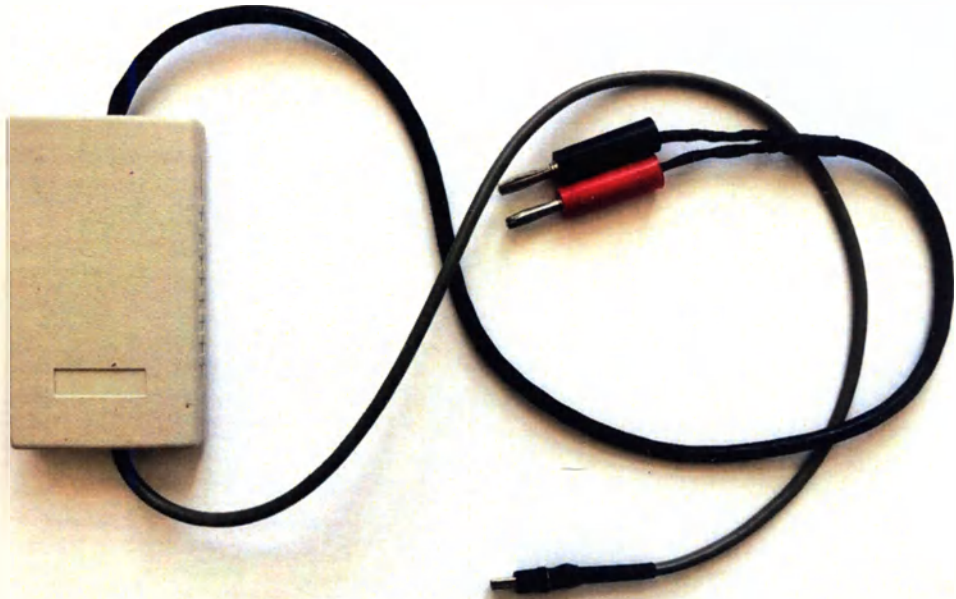
№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
52.	Датчик ТОНОВ Короткова ВР2005-14-001	
53.	Датчик ТОНОВ Короткова ВР.М000.006	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
54.	Модуль активности и положения "МАП"	
55.	Комплект креплений МАП поясной	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
56.	Комплект креплений МАП нагрудный	
57.	Комплект крепления датчика положения бедренного	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
58.	Аккумулятор "Ansmann Max-E" ¹ типоразмера AA с номинальным напряжением 1,2 В и номинальной емкостью не менее 2100 мА * ч	
59.	Зарядное устройство "Ansmann Max-E" ¹	
60.	Устройство для чтения карт памяти MicroSD Transcend ¹	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
61.	Программное обеспечение TEST005	Тип носителя согласовывается с Заказчиком
62.	Пневмопровод технологический ВР.005.005	
63.	Пневмопровод технологический ВР.М000.007	

№ пп	Наименование	Фотографическое изображение
64.	Кабель технологический ВР.005.011	
65.	Кабель технологический ВР.М000.008	

Сшито и заверено
печатью 19
(девятнадцать) лист а

