

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Кровать медицинская функциональная Enterprise
с принадлежностями***

Производства

АрджоХантли АБ

(ArjoHuntleigh AB)

Hans Michelsensgatan 10, 211 20, Malmö, Sweden.

Тел.: +46 (0) 413 645 00

Факс: +46 (0) 413 138 76

E-mail: sales.admin@arjohuntleigh.com

I. Кровать медицинская функциональная Enterprise, варианты исполнения: Enterprise 5000X (E5X)



I. Кровать медицинская функциональная Enterprise, варианты исполнения: Enterprise 5000X (E5X) (макет маркировки)

Кровать медицинская функциональная Enterprise 5000X (E5X)

Производитель: ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, 211 20, Malmö, Sweden


760.412



2017-10-06

Произведено в Польше

Рабочий цикл
10% (2 мин. вкл., / 18 мин. выкл.)



P0457982



IPX4



Входная мощность
230В~1,25 А 50/60 Гц



E5X2HD103BAAAA




250kg



Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02642

I. Кровать медицинская функциональная Enterprise, варианты исполнения: Enterprise 8000X (E8X)

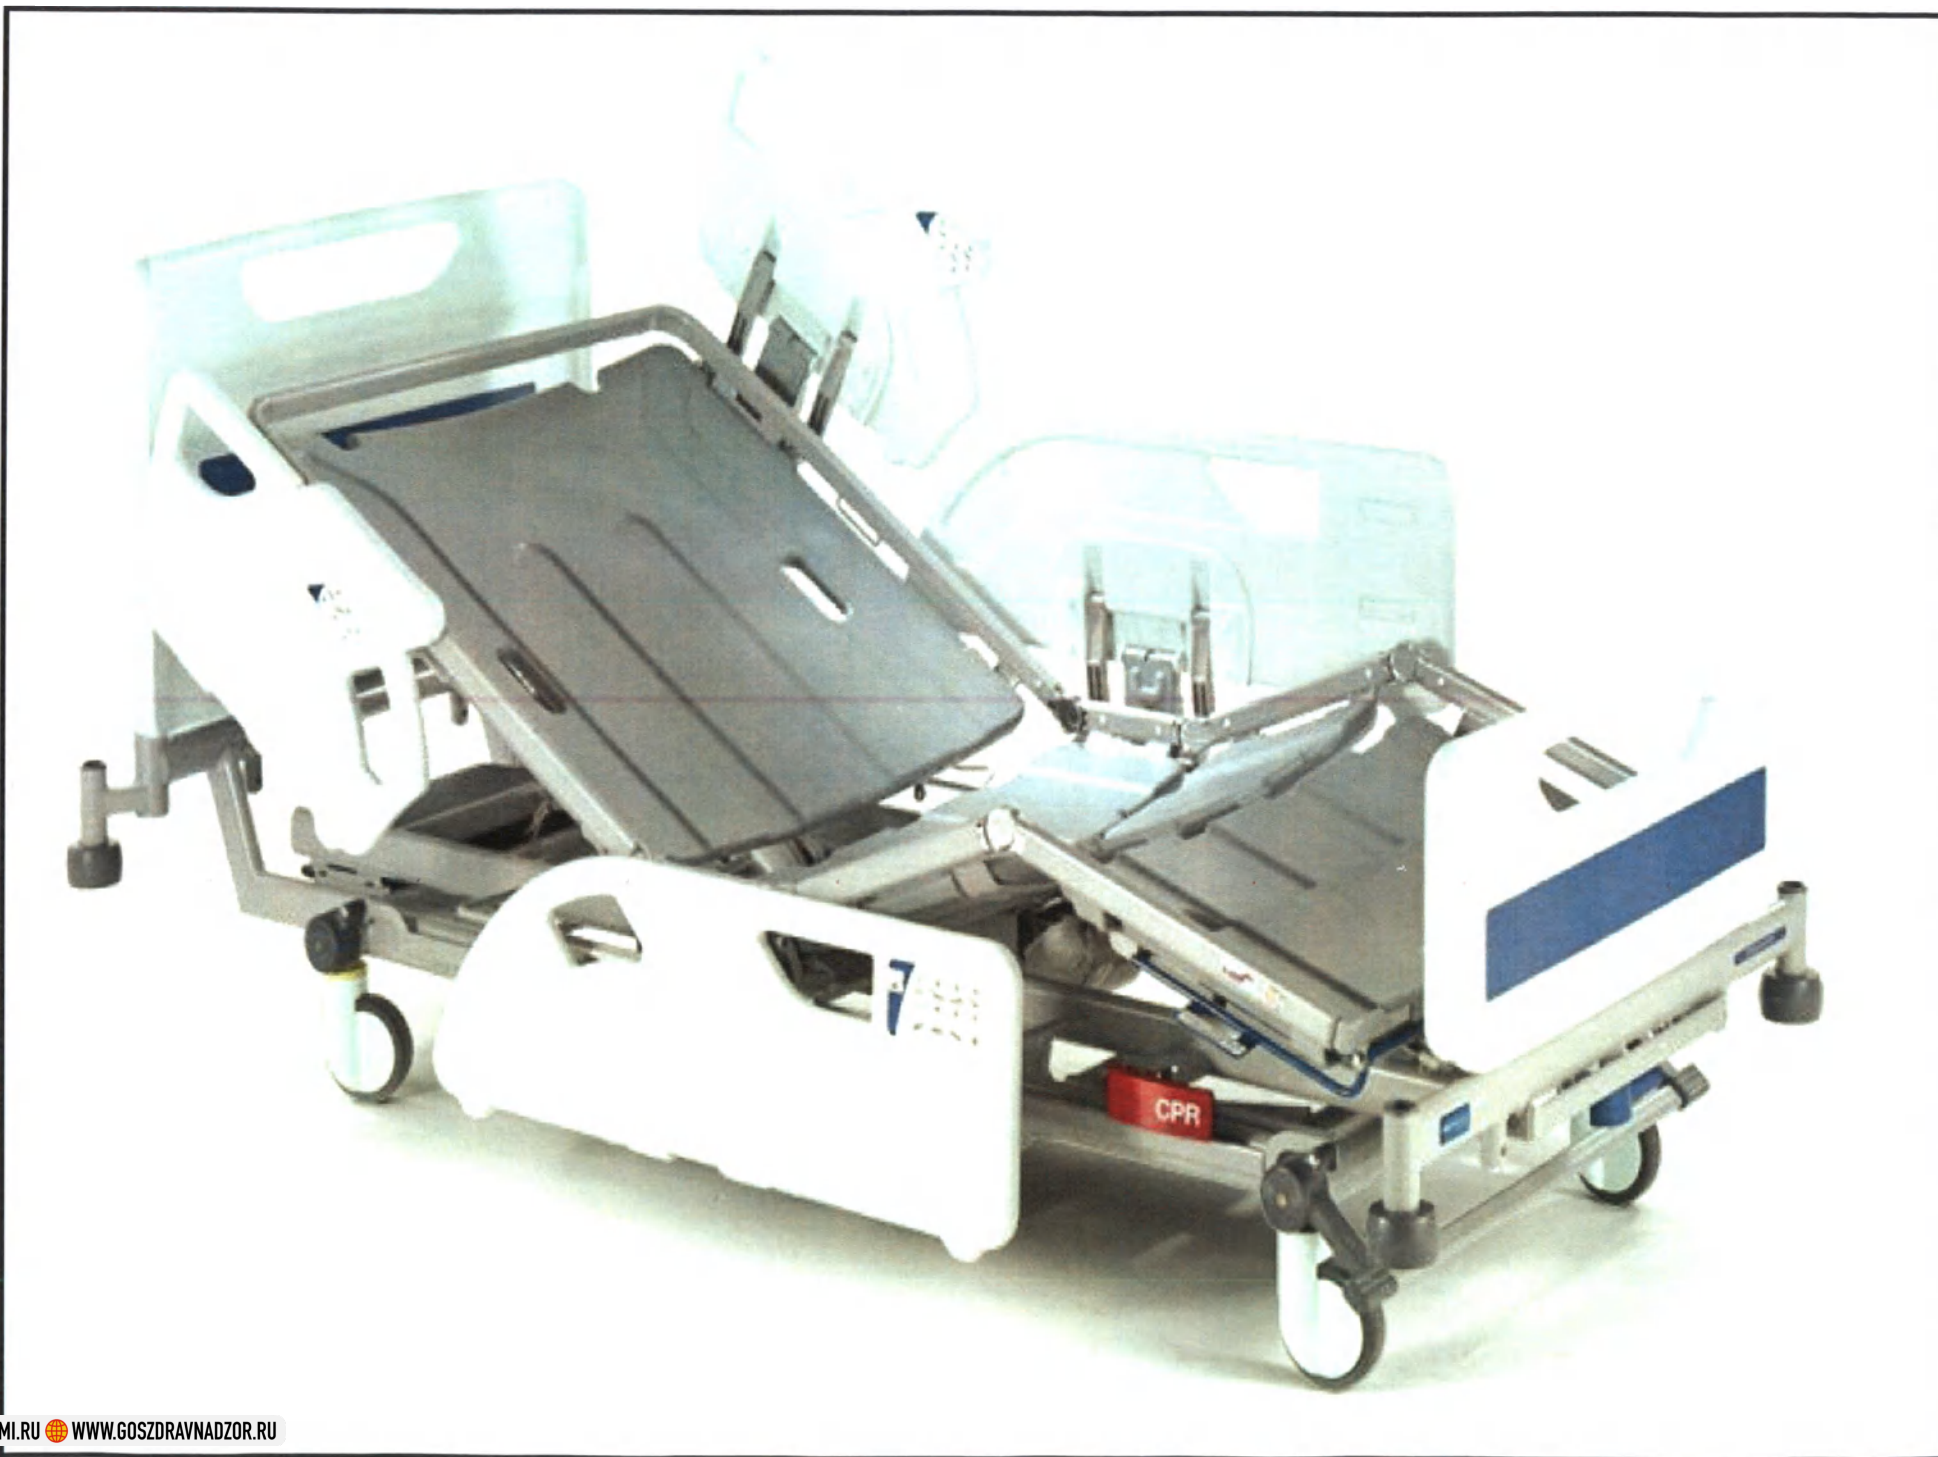

Кровать медицинская функциональная Enterprise 8000X (E8X)

Производитель: ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, 211 20, Malmö, Sweden


760.414



2017-04-13

Произведено в Польше

Рабочий цикл
10% (2 мин. вкл., / 18 мин. выкл.)



P0432664



IPX4



Входная мощность
230В~1,25 А 50/60 Гц



8X230A003BBAAA



250kg



Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02642

I. Кровать медицинская функциональная Enterprise, варианты исполнения: Enterprise 9000X (E9X)



I. Кровать медицинская функциональная Enterprise, варианты исполнения: Enterprise 9000X (E9X) (макет маркировки)

Кровать медицинская функциональная Enterprise 9000X (E9X)

Производитель: ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, 211 20, Malmö, Sweden

760.416



2015/03

Произведено в Польше

Рабочий цикл
10% (2 мин. вкл., / 18 мин. **выкл.**)



P0318050



IPX4



Входная мощность
230В~1,25 А 50/60 Гц



9X22BR11CON3377




250kg



15 0126

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02642


1. Основание (рама) кровати.

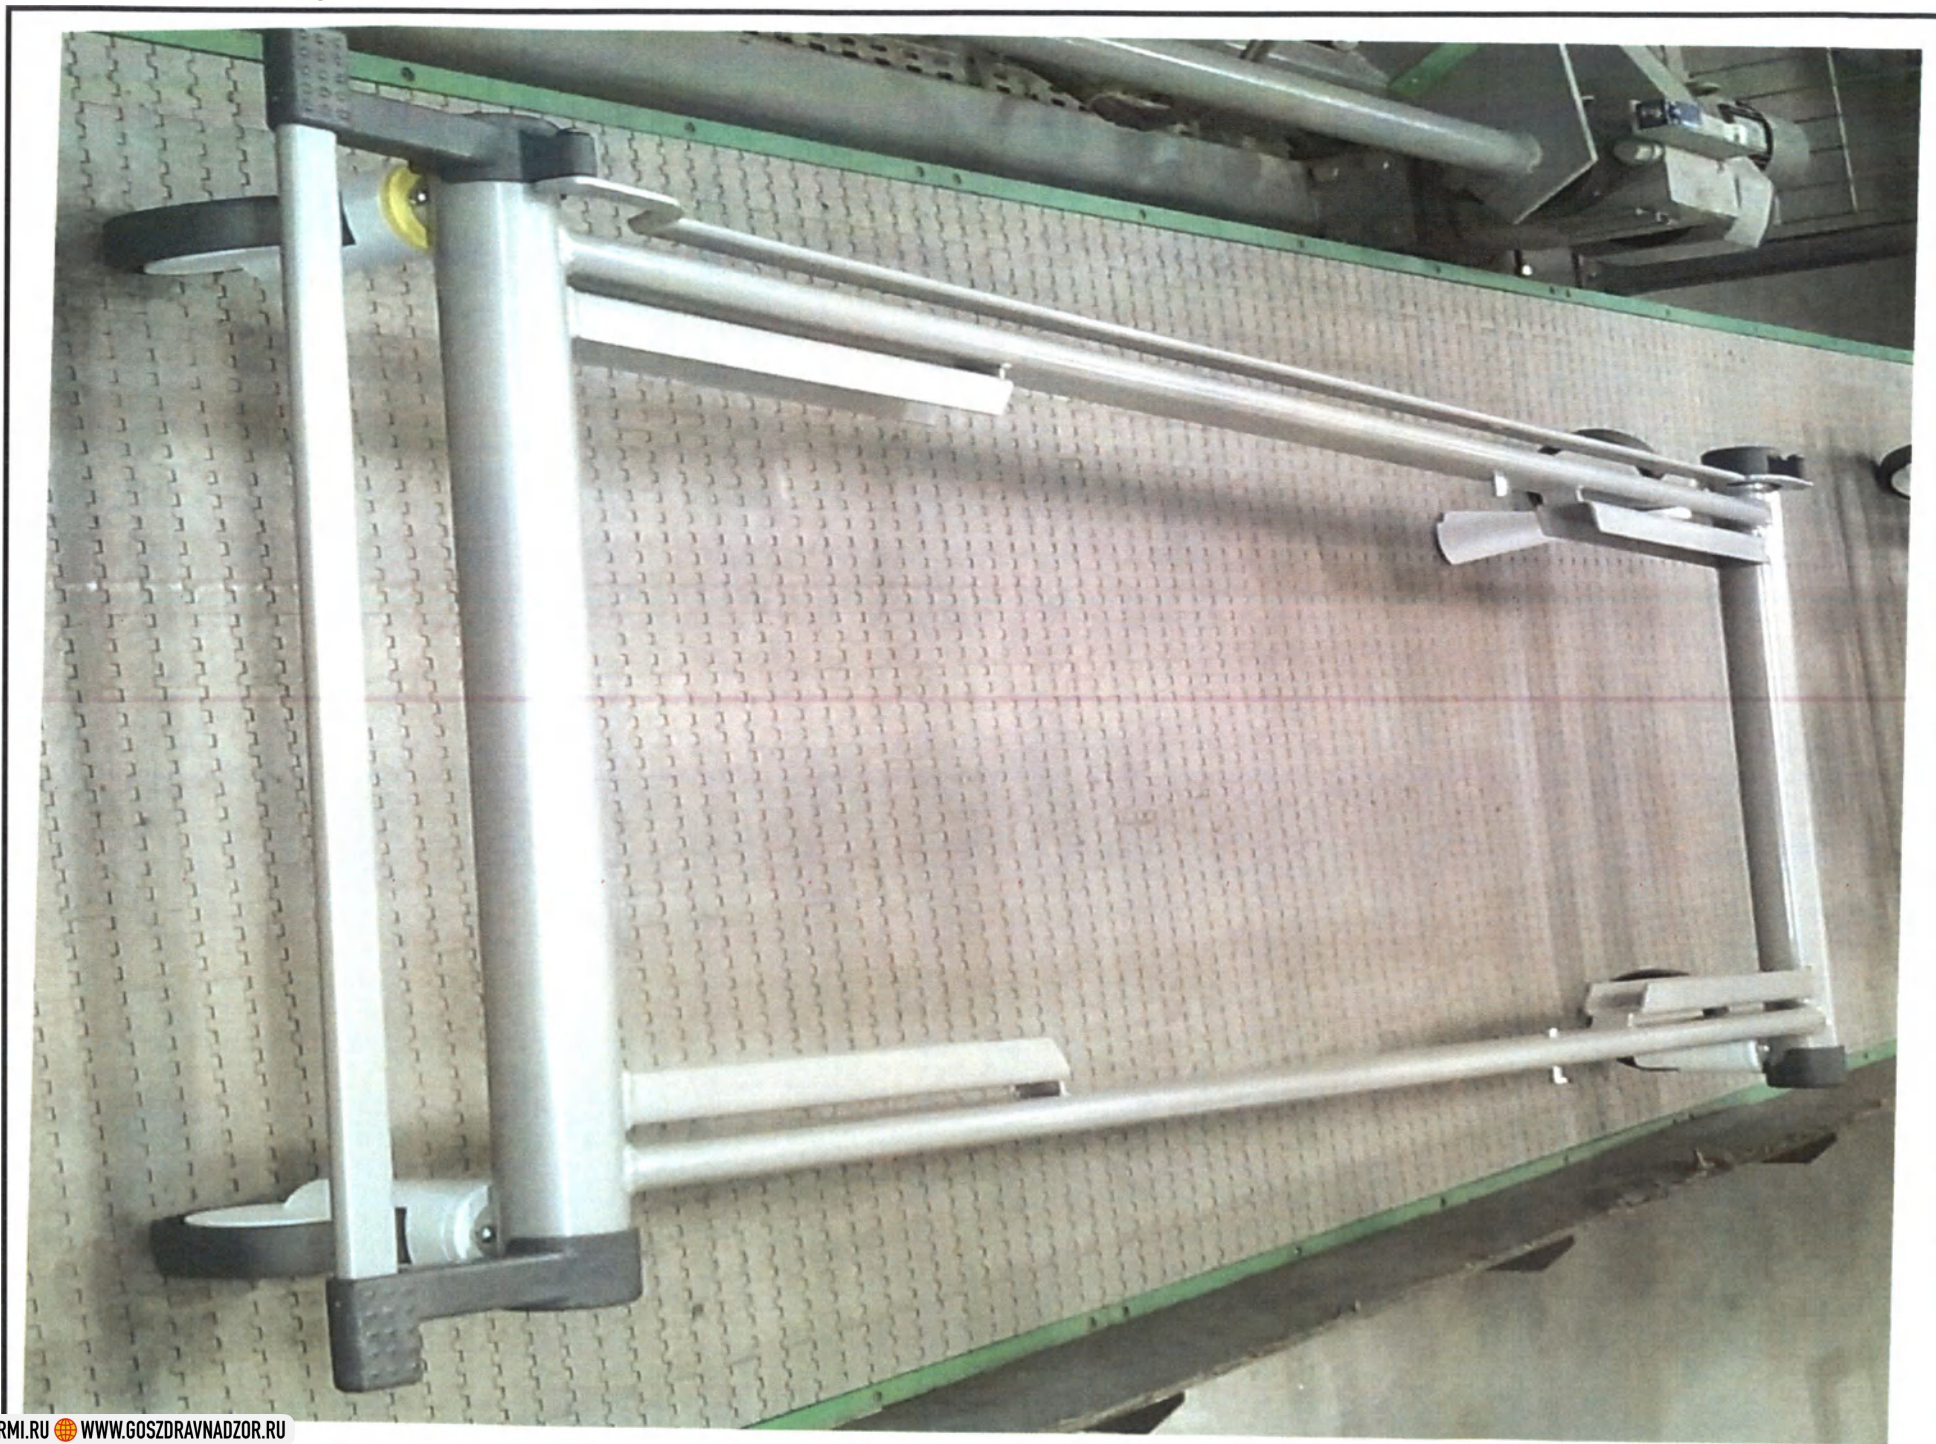

2. Матрасная платформа.



3. Колесо — 4 шт.

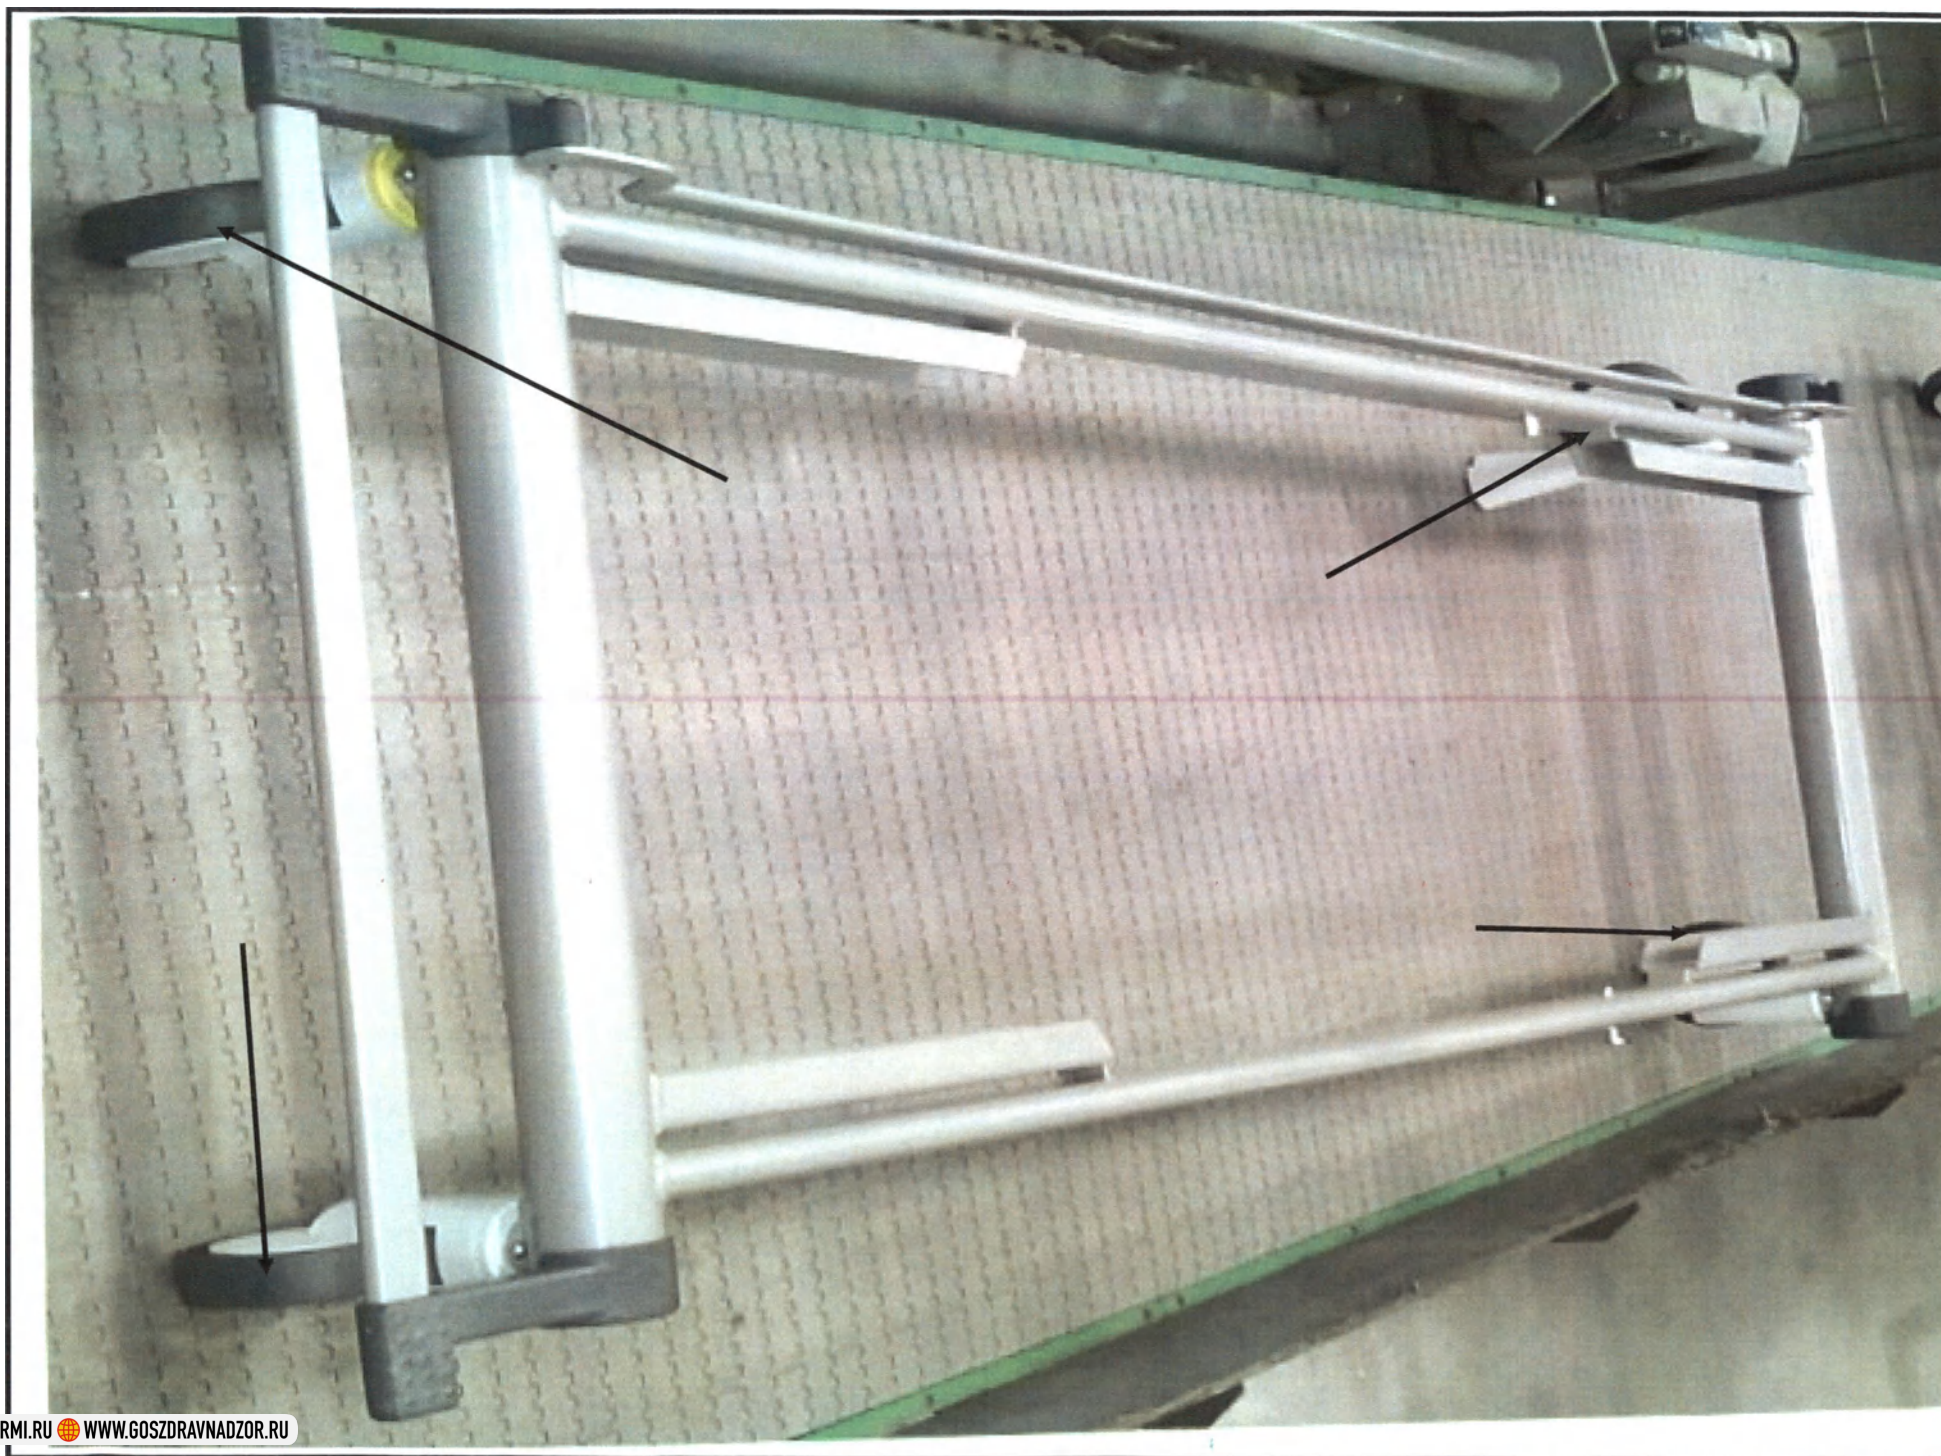

4. Кабель сетевой.



Enterprise 5000X (E5X)
Инструкция по эксплуатации

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP



746-577-RU_07 • 05/2016

...with people in mind

ENTERPRISE E8000X (E8X)

Инструкция по эксплуатации

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP



746-585-RU_04 • 05/2016

...with people in mind

ENTERPRISE 9000X (E9X)


Инструкция по эксплуатации

ARJOHUNTLEIGH


GETINGE GROUP



6. Матрас, варианты исполнения: **AtmosAir 9000**, Pentaflex, Simuflex, ConformX (при необходимости).

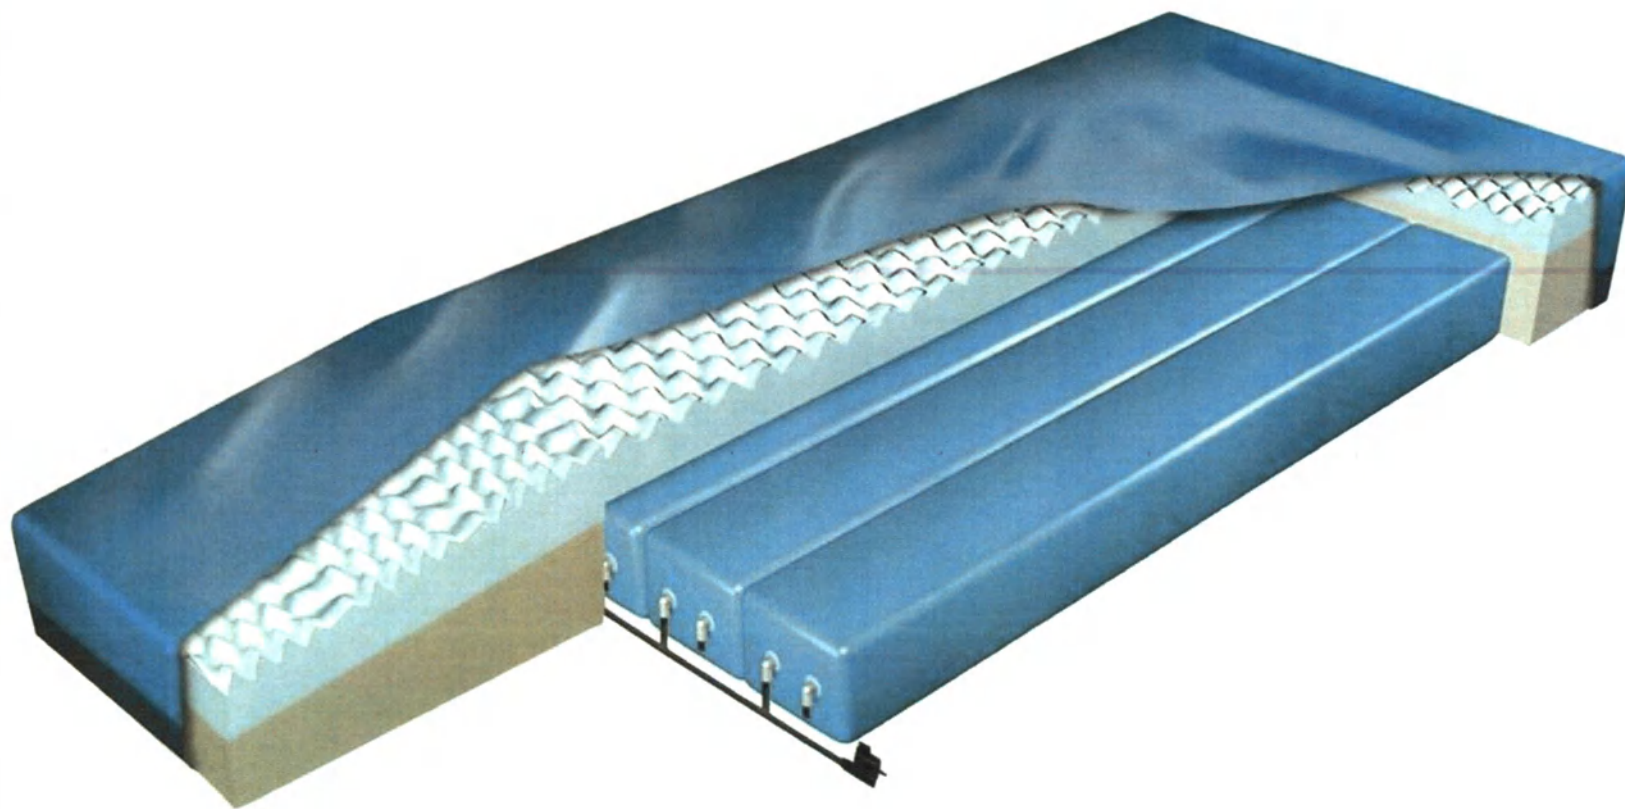

6. Матрас, варианты исполнения: AtmosAir 9000, **Pentaflex**, Simuflex, ConformX (при необходимости).

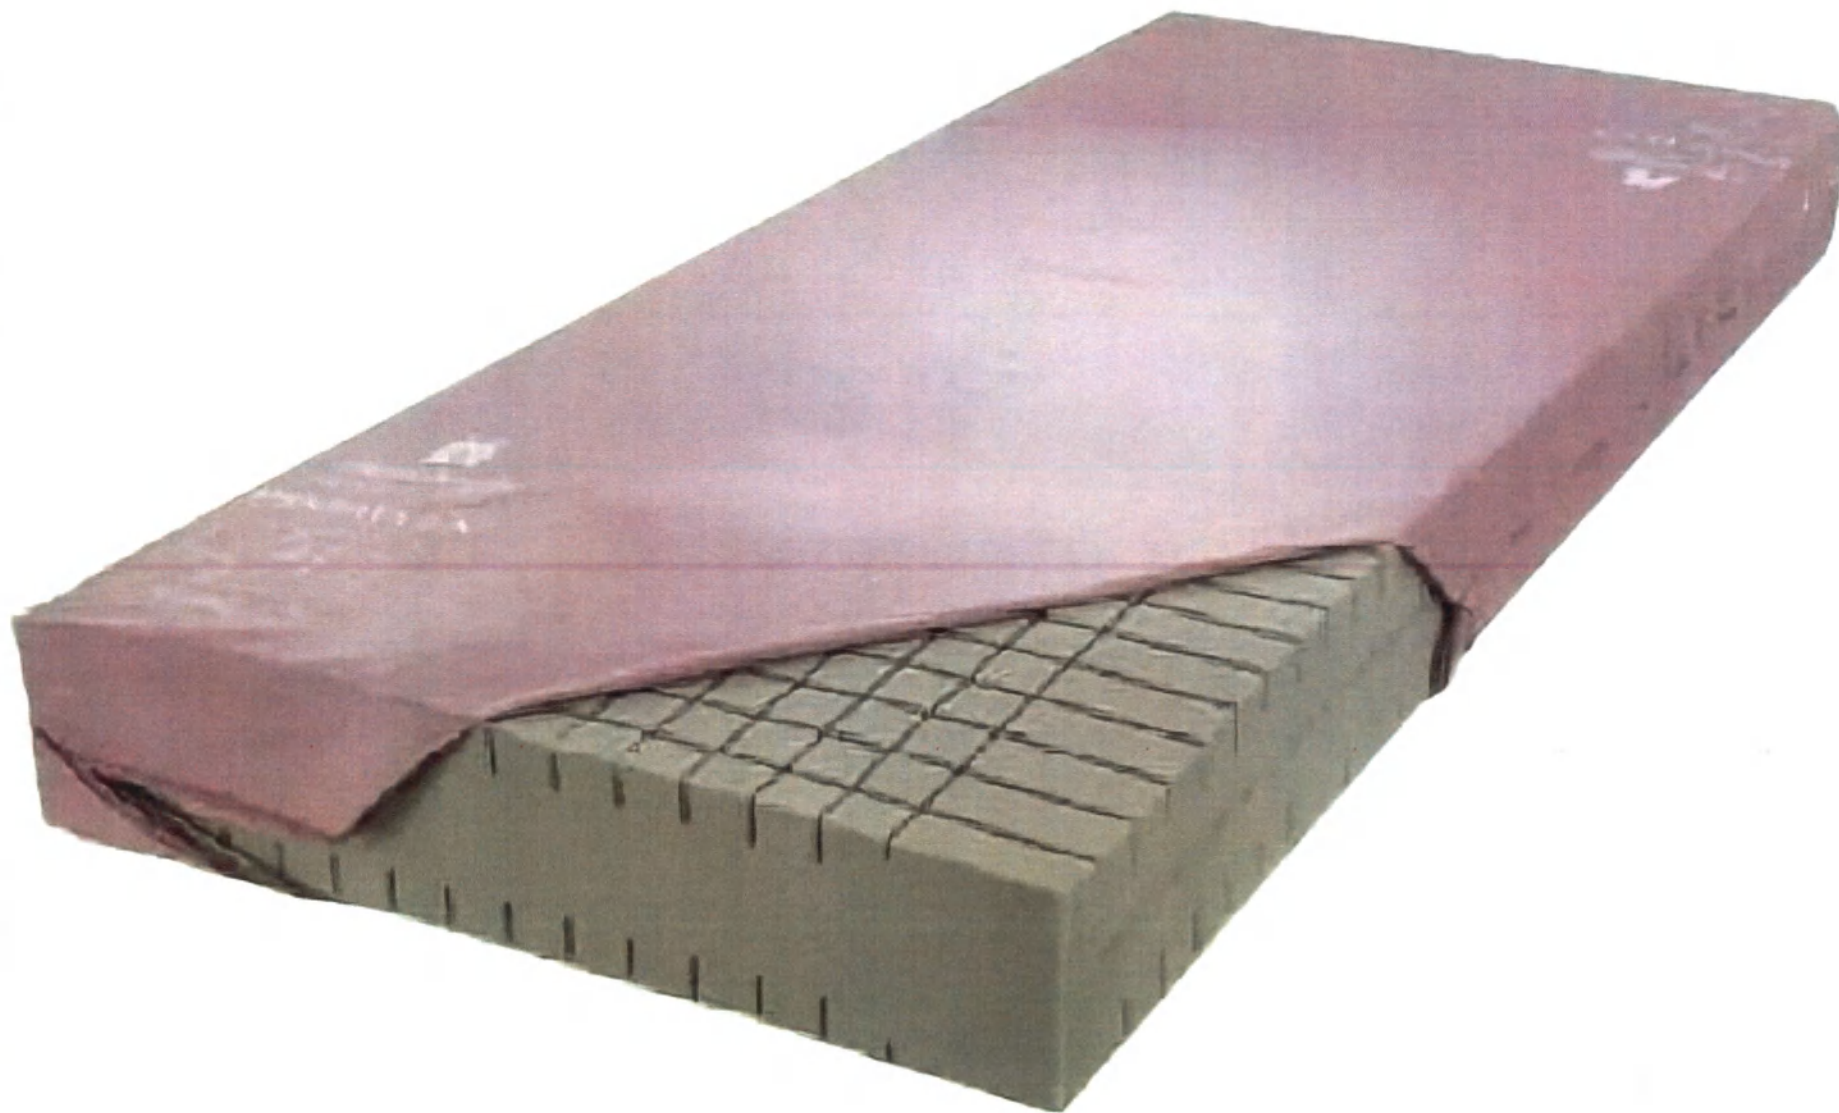

6. Матрас, варианты исполнения: AtmosAir 9000, Pentaflex, **Simuflex**, ConformX (при необходимости).



6. Матрас, варианты исполнения: AtmosAir 9000, Pentaflex, Simuflex, **ConformX** (при необходимости).



7. Матрасная вставка для удлинения матраса (при необходимости).



8. наматрасник с системой контроля микроклимата: SKIN IQ (4 шт./упак.), SKIN IQ 365 (не более 10 упак.), SKIN IQ 1000 (не более 10/20 упак.) (при необходимости).



8. Наматрасник с системой контроля микроклимата: **SKIN IQ** (4 шт./упак.), **SKIN IQ 365** (не более 10 упак.), **SKIN IQ 1000** (не более 10 21 упак.) (при необходимости).



в. панаграсник с системой контроля микроклимата: SKIN IQ (4 шт./упак.), SKIN IQ 303 (не более 10 упак.), SKIN IQ 1000 (не более 10 22 упак.) (при необходимости).




- матрас;



- помпа для матраса;



- кабель питания сетевой;

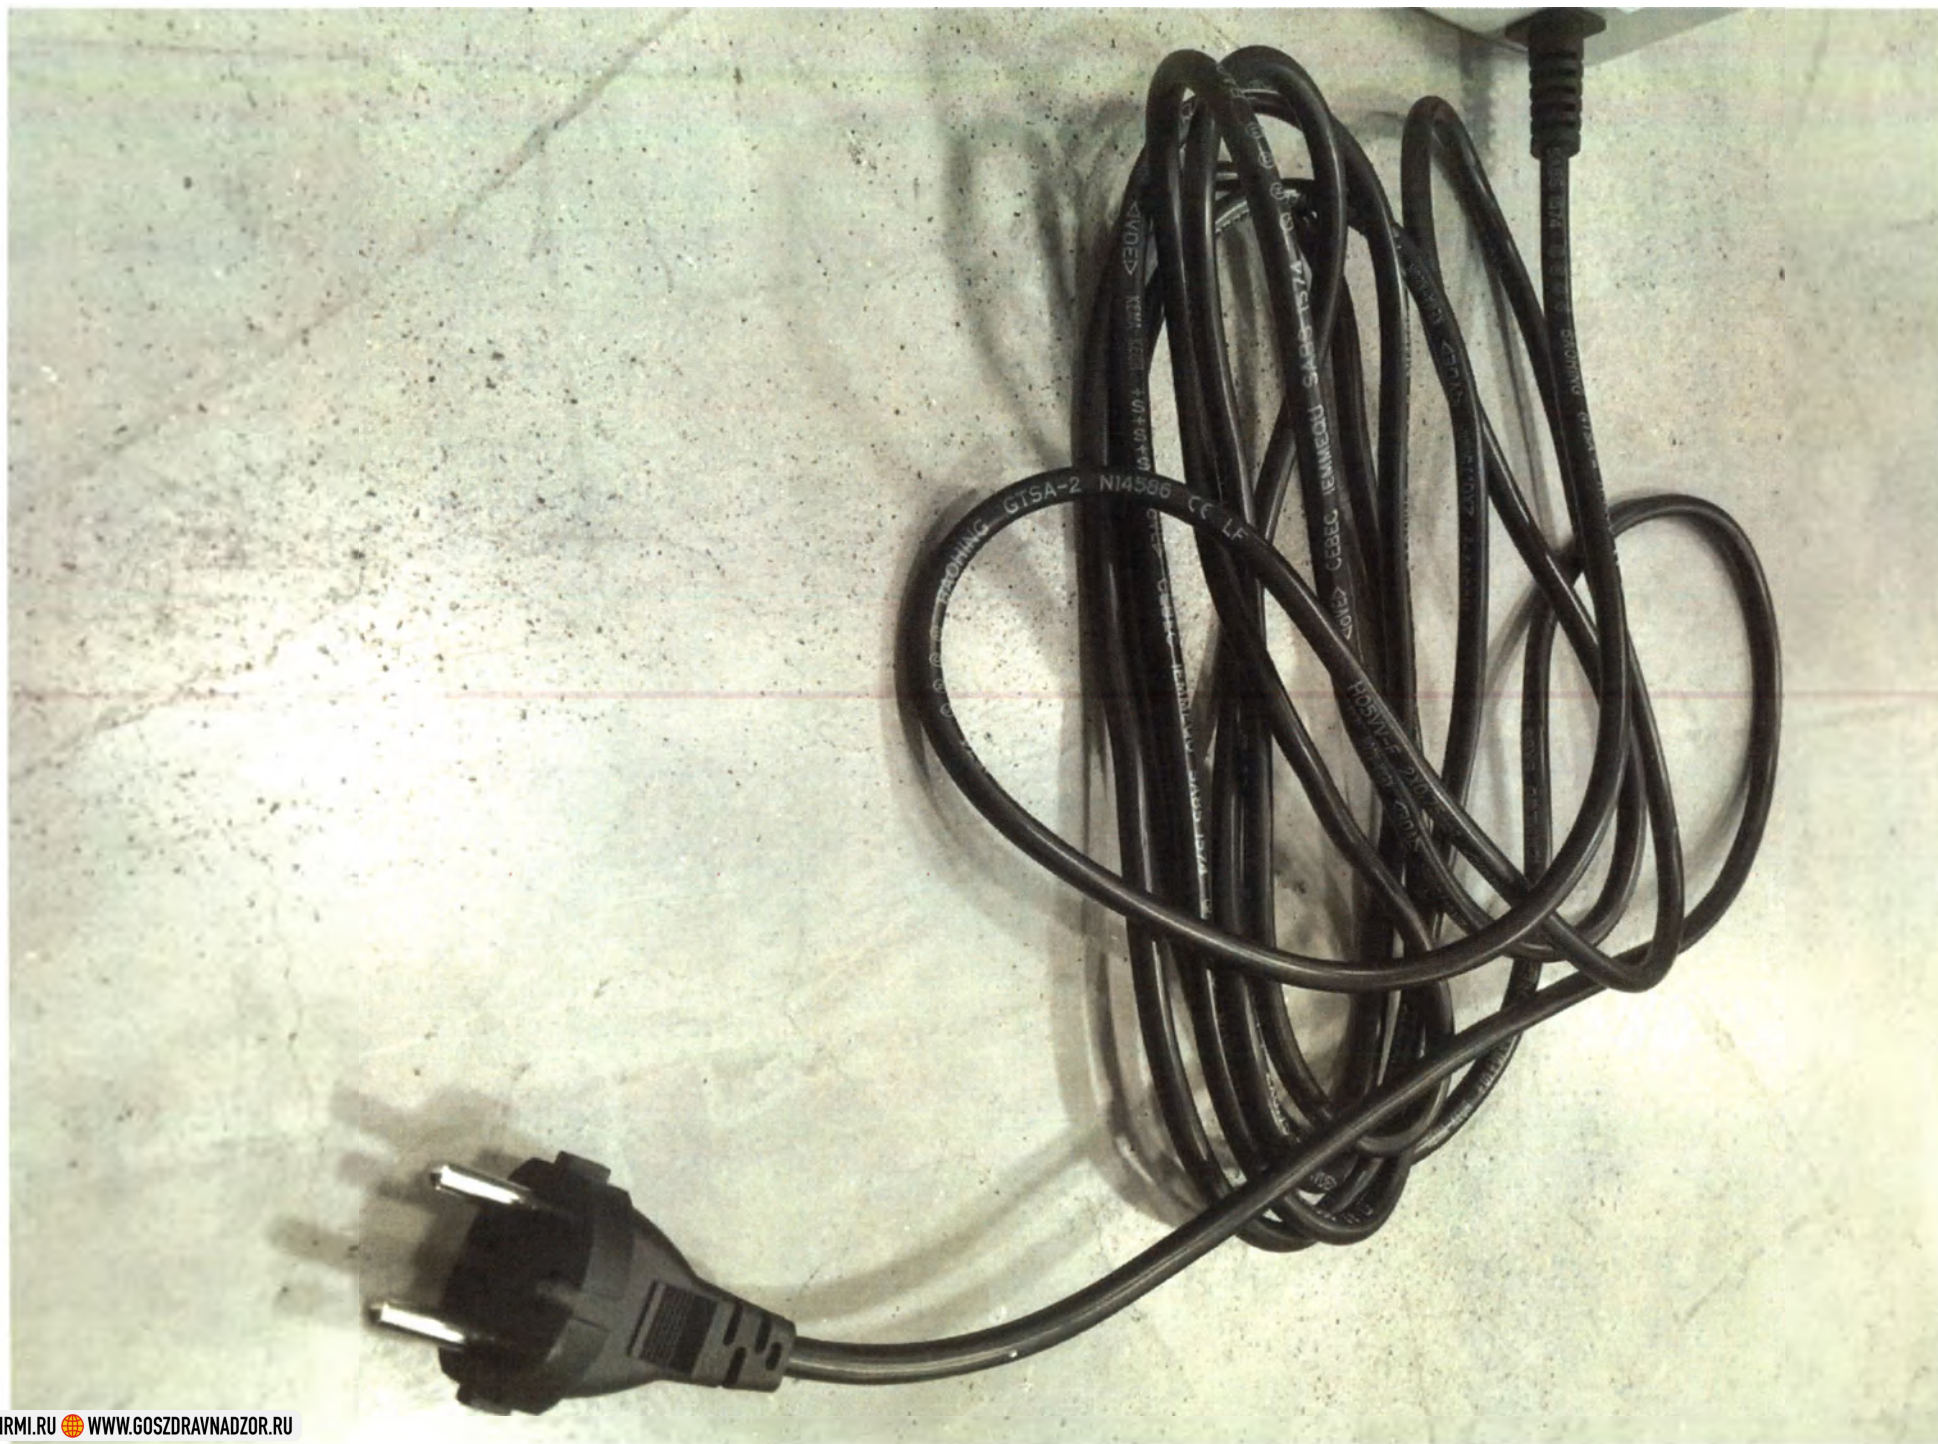

- система трубок для подсоединения к насосу;



- чехол;



9. Система противоопролежневая активного типа: Auto Logic 110, в составе:
- сумка для хранения матраса.




- матрас;



- помпа для матраса;



- кабель питания сетевой;

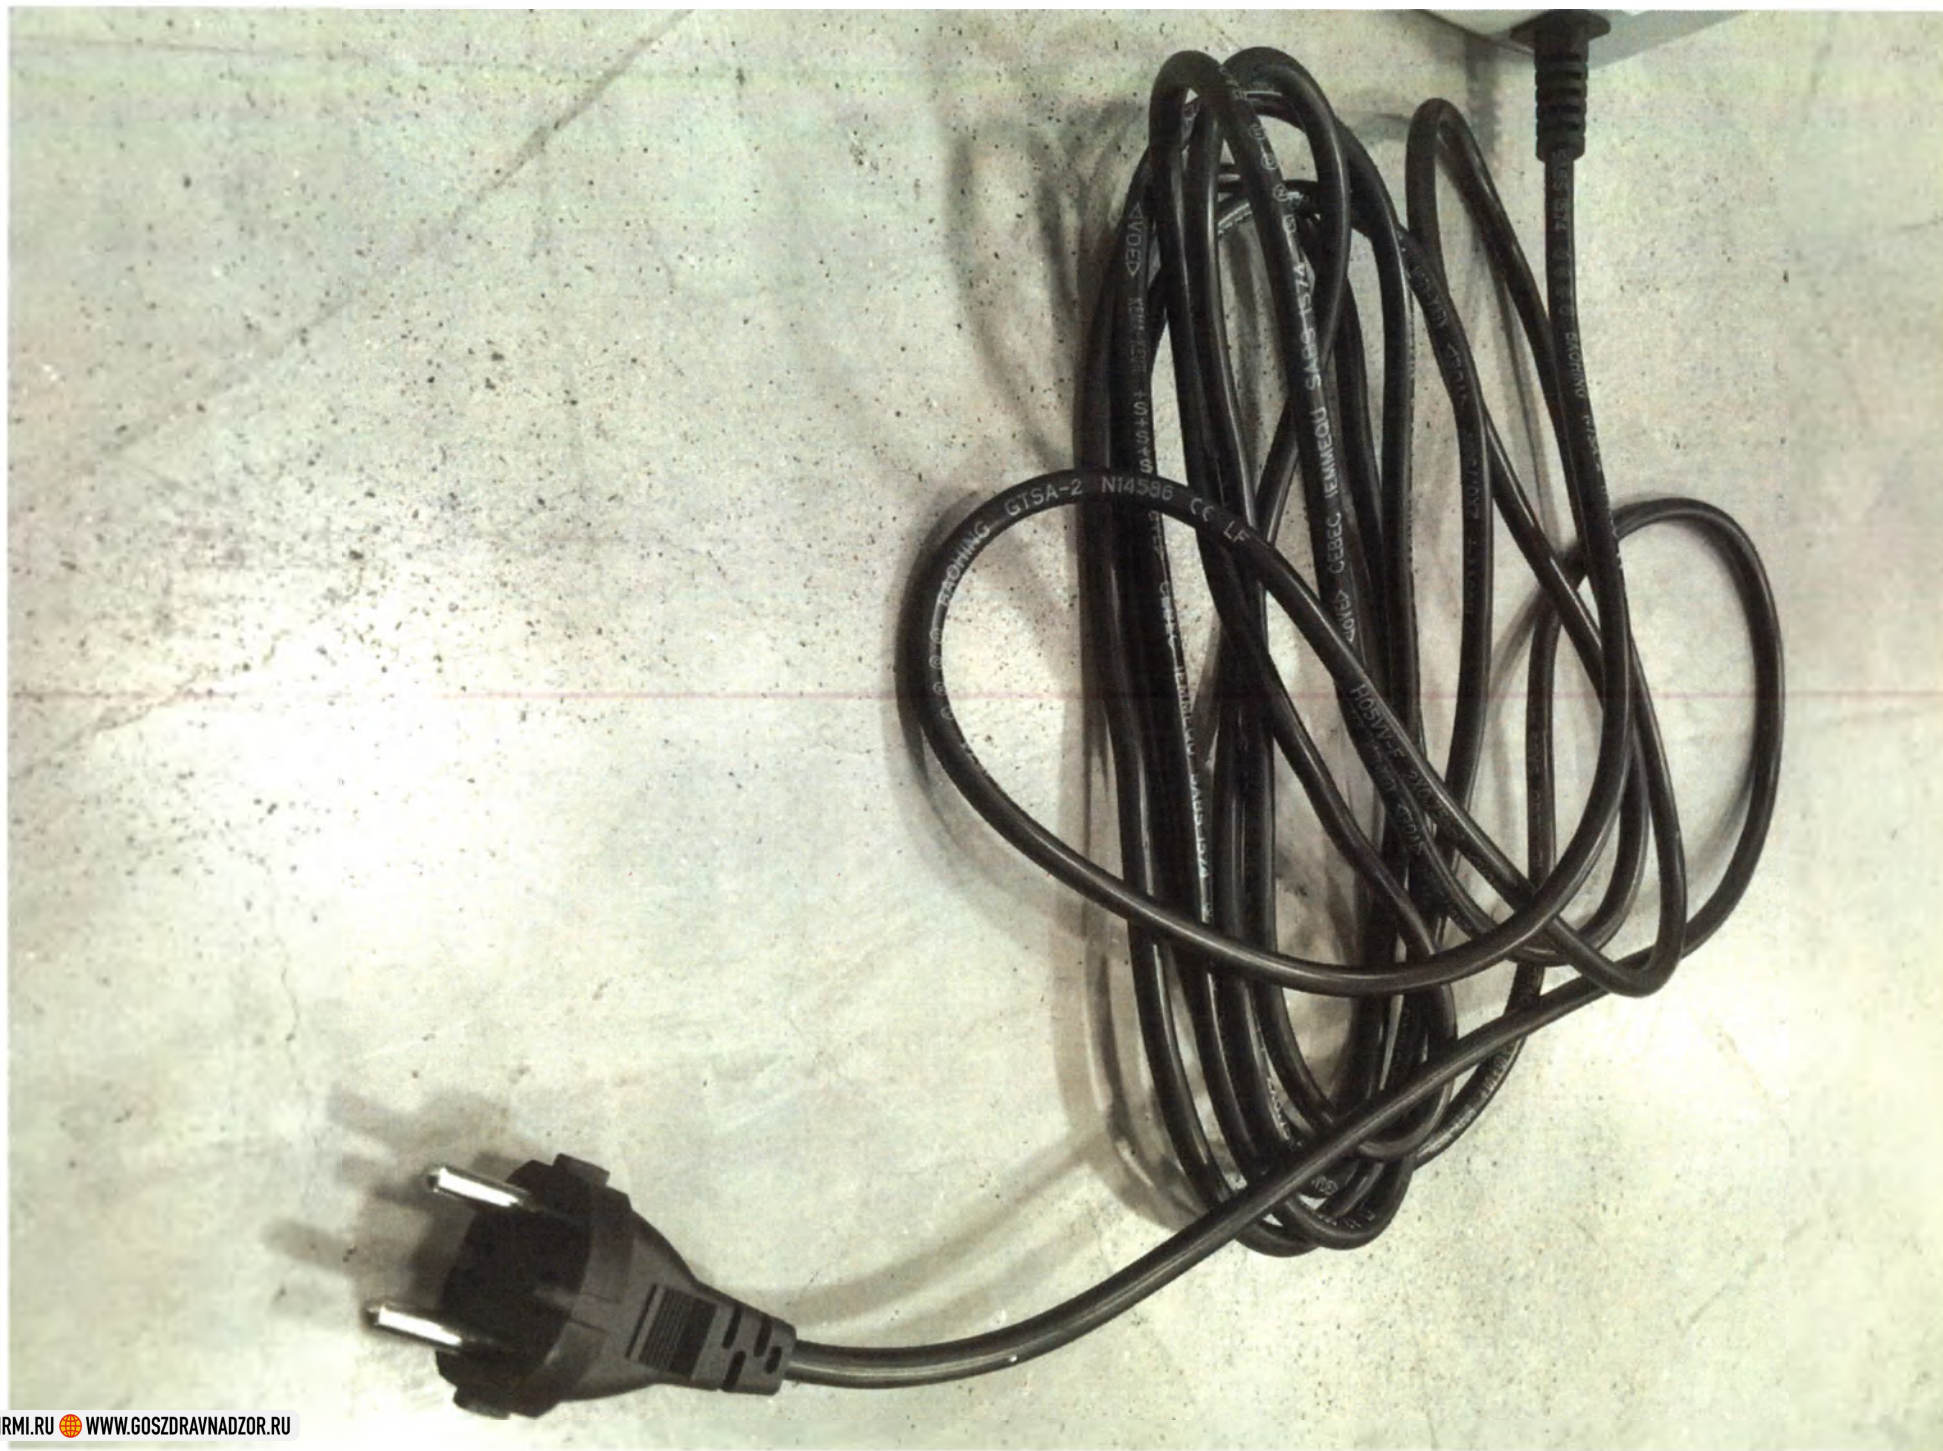

9. Система противополежная активного типа: Auto Logic 175, в составе:
- система трубок для подключения к насосу;



- чехол;



- сумка для хранения матраса.




- матрас;



- помпа для матраса;



- кабель питания сетевой;

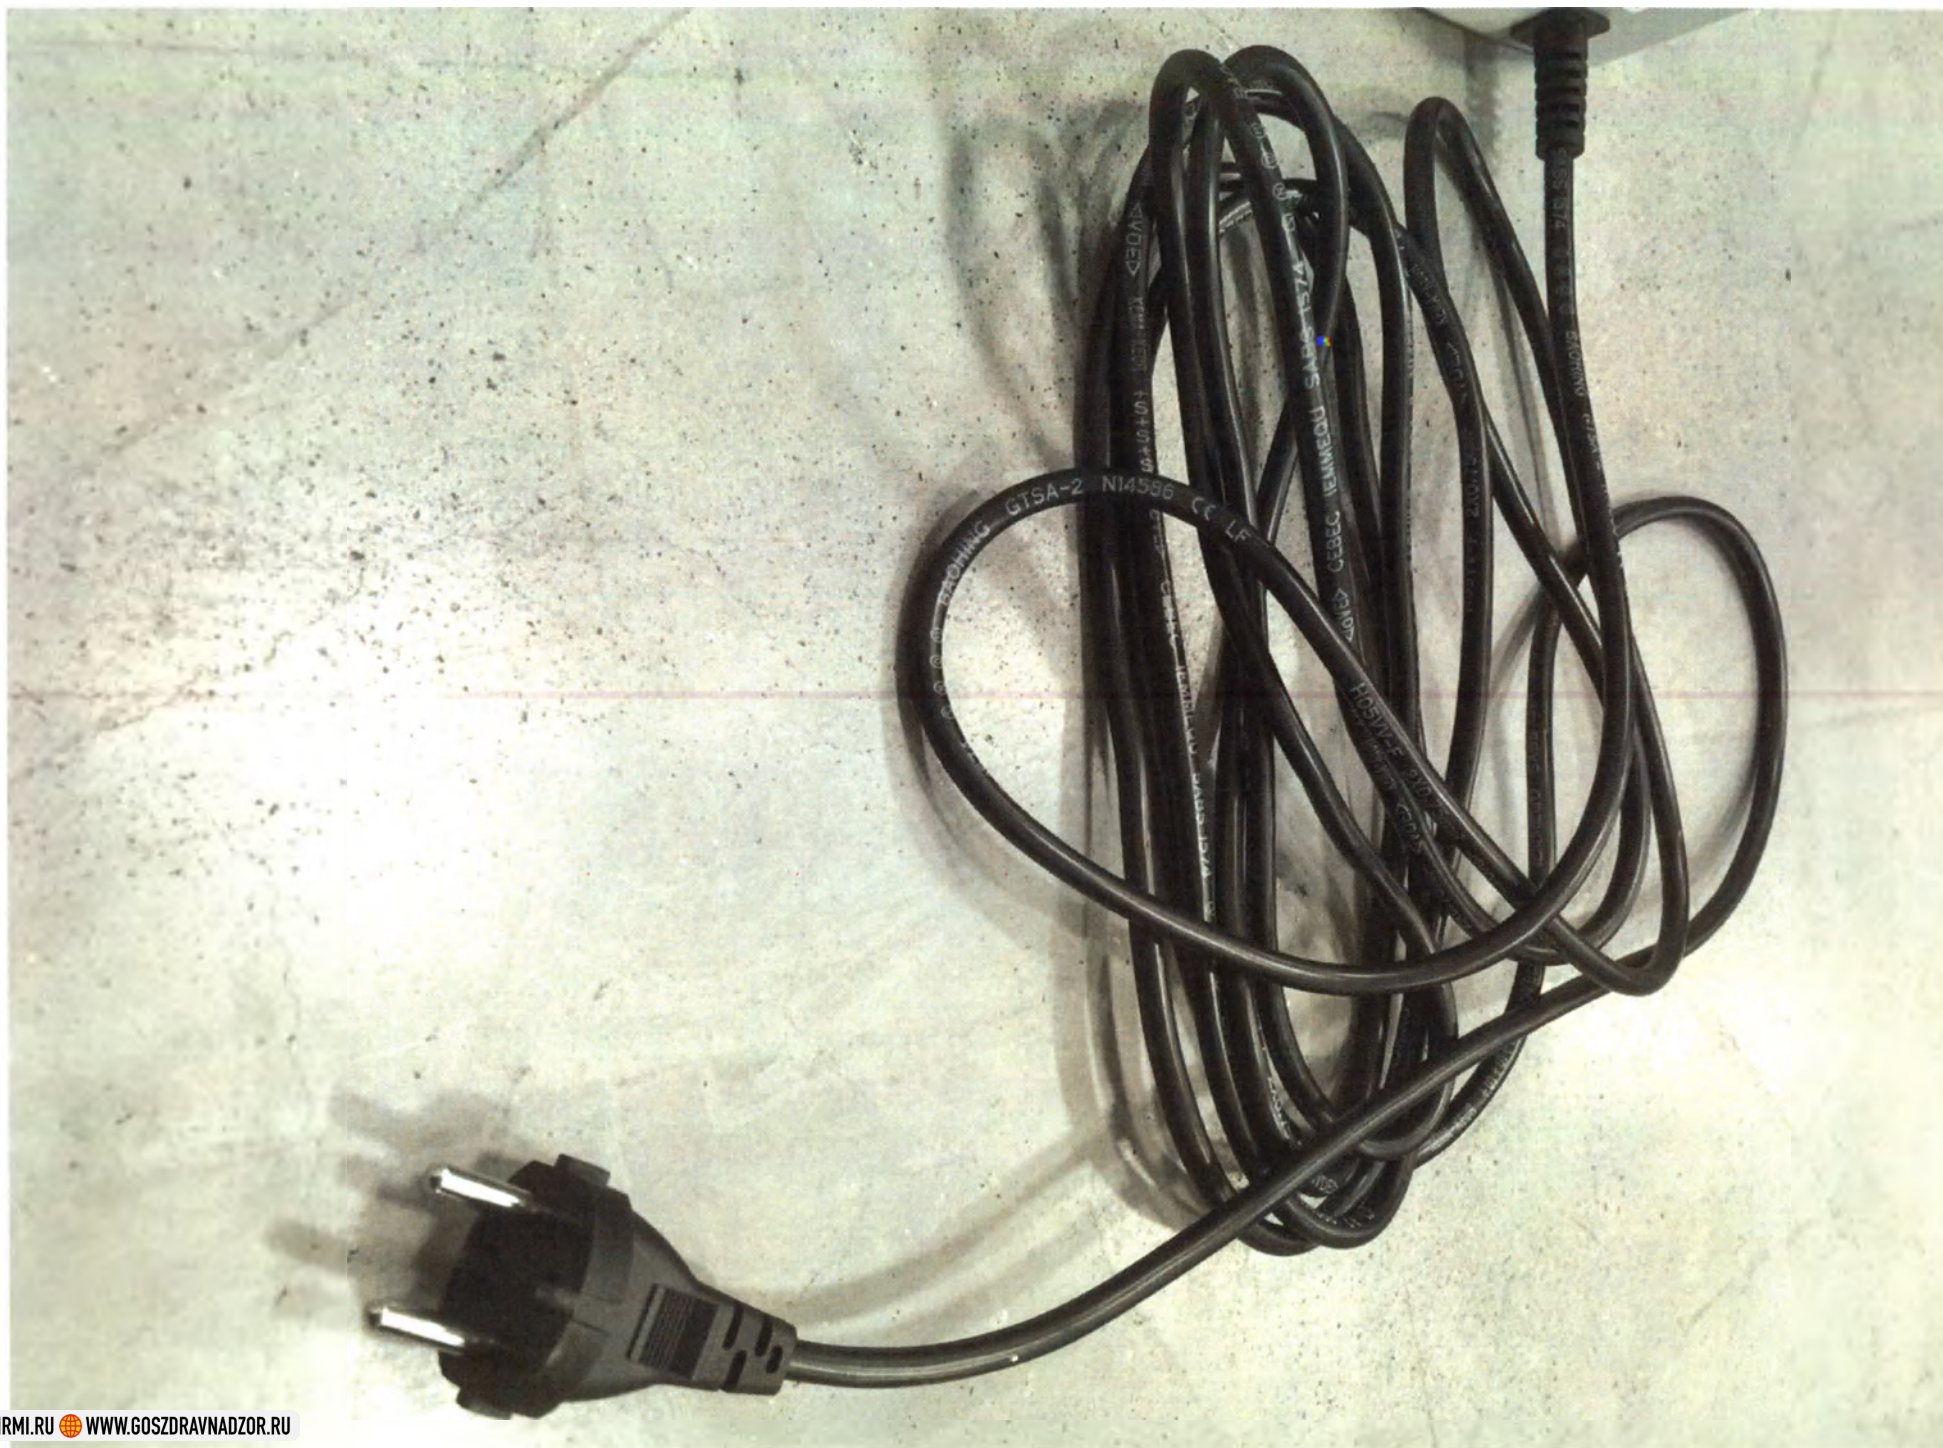

- система трубок для подсоединения к насосу;



- чехол



- сумка для хранения матраса



9. Система противопротеежная активного типа: Аирпа Active 4 , в составе:
- матрас;




- помпа для матраса;



9. Система противополежная активного типа: Airpa Active 4, в составе:

- кабель питания сетевой;

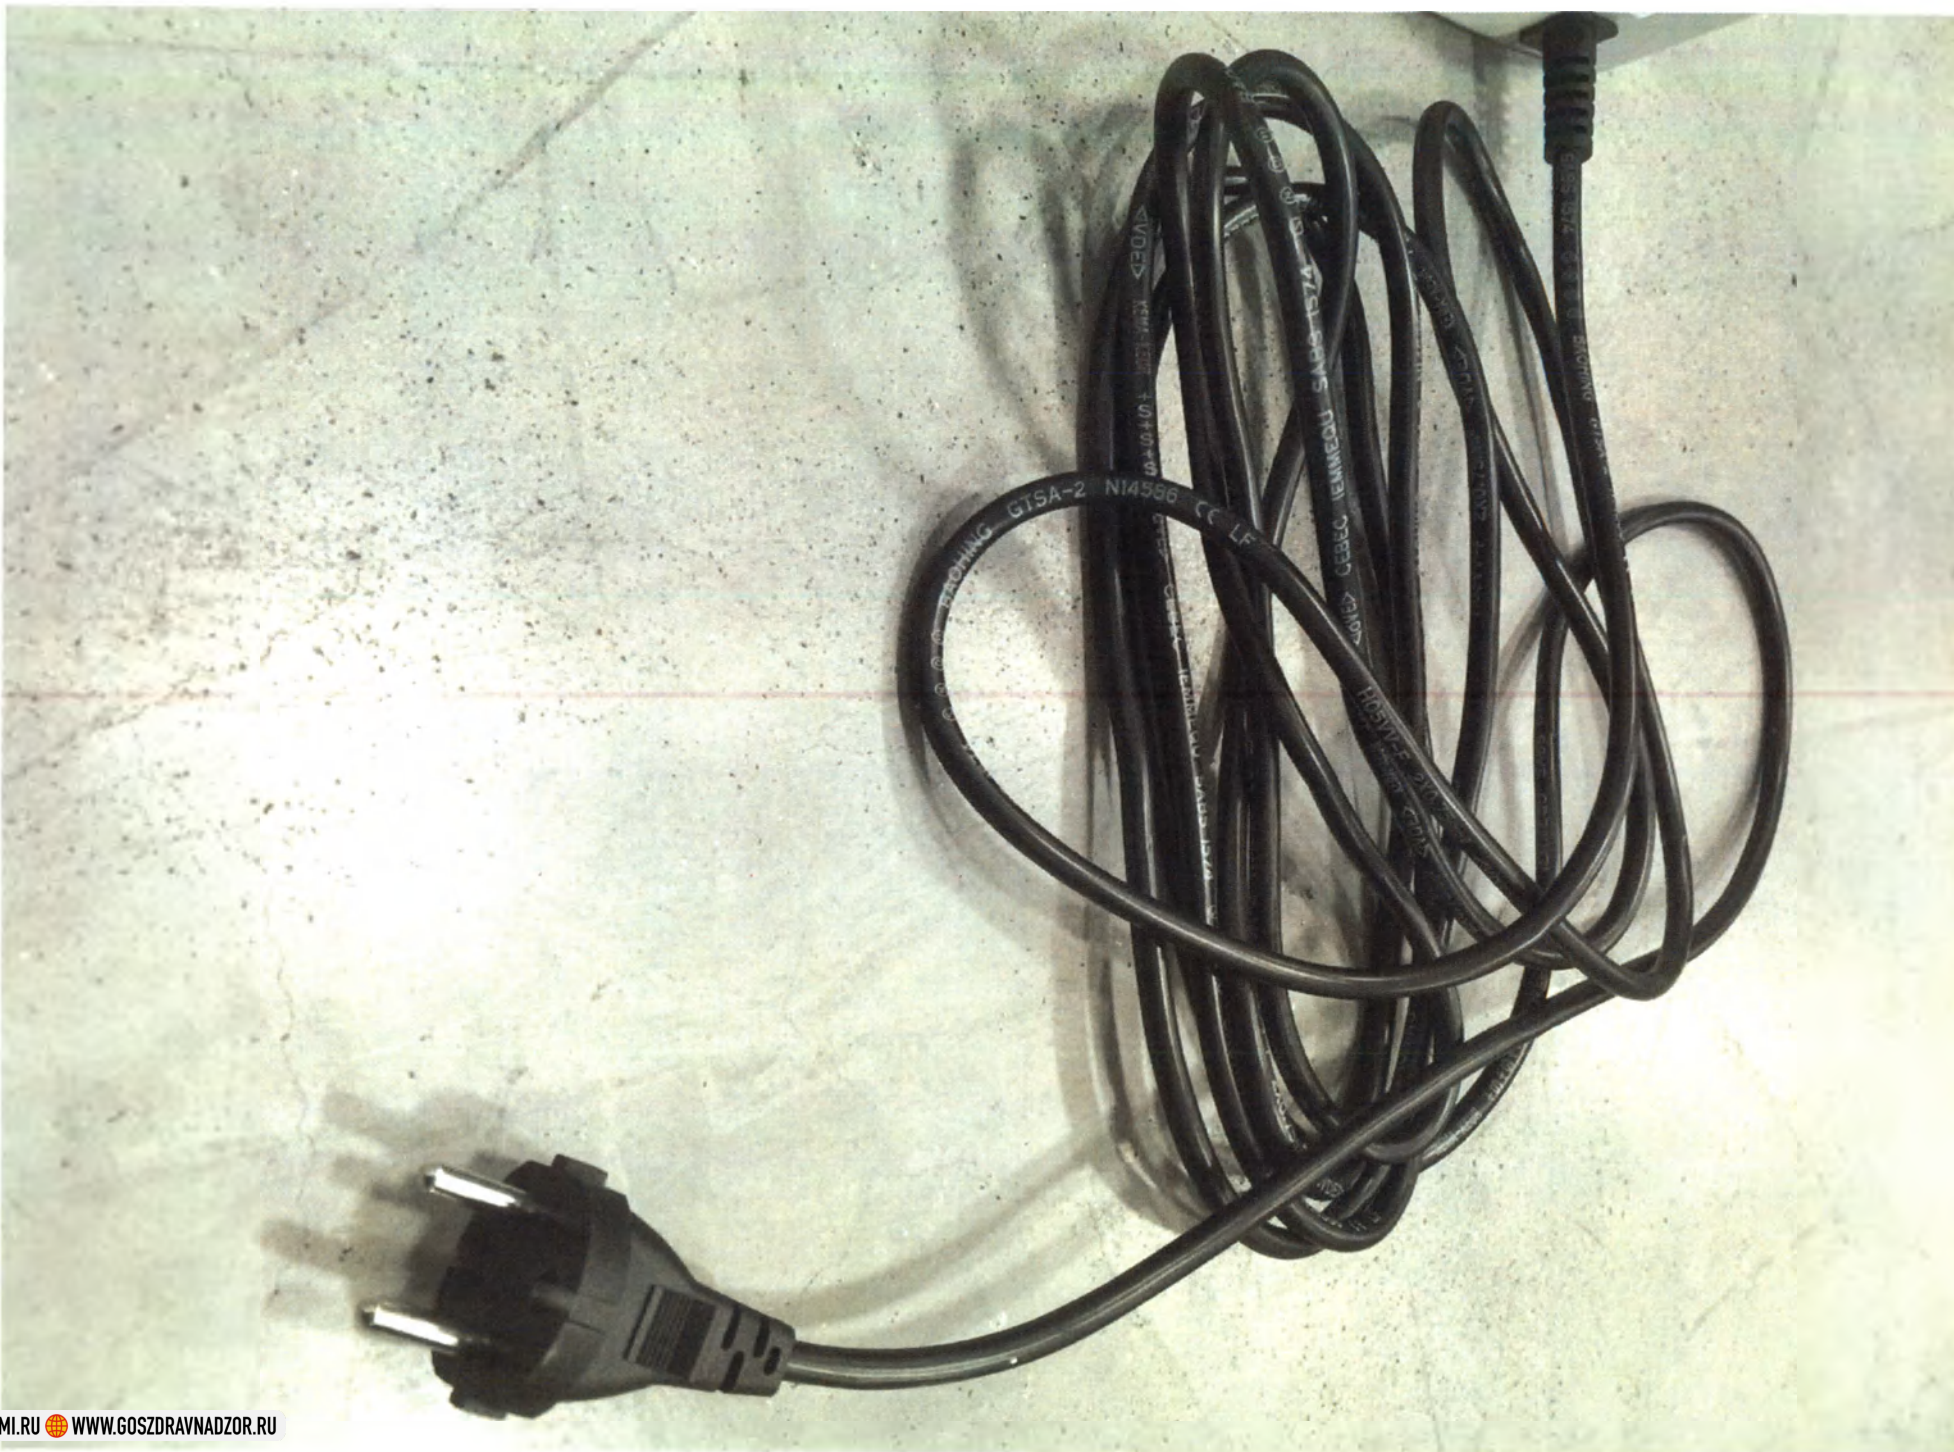

9. Система противополежная активная типа: Airpa Active 4, в составе:
- система трубок для подсоединения к насосу;



9. Система противопролежневая активного типа: Alpha Active 4 , в составе:
- чехол;



9. Система противопротезная активного типа: Airpa Active 4 , в составе:
- сумка для хранения матраса.



9. Система противопролежневая активного типа: Airpa Transen Deluxe, в составе:
- матрас;

47




9. Система противоопролежневая активного типа: Alpha Trancell Deluxe, в составе:
- помпа для матраса;



9. Система противополежная активного типа: Airpa Галсен Делухе, в составе:

- кабель питания сетевой;

49

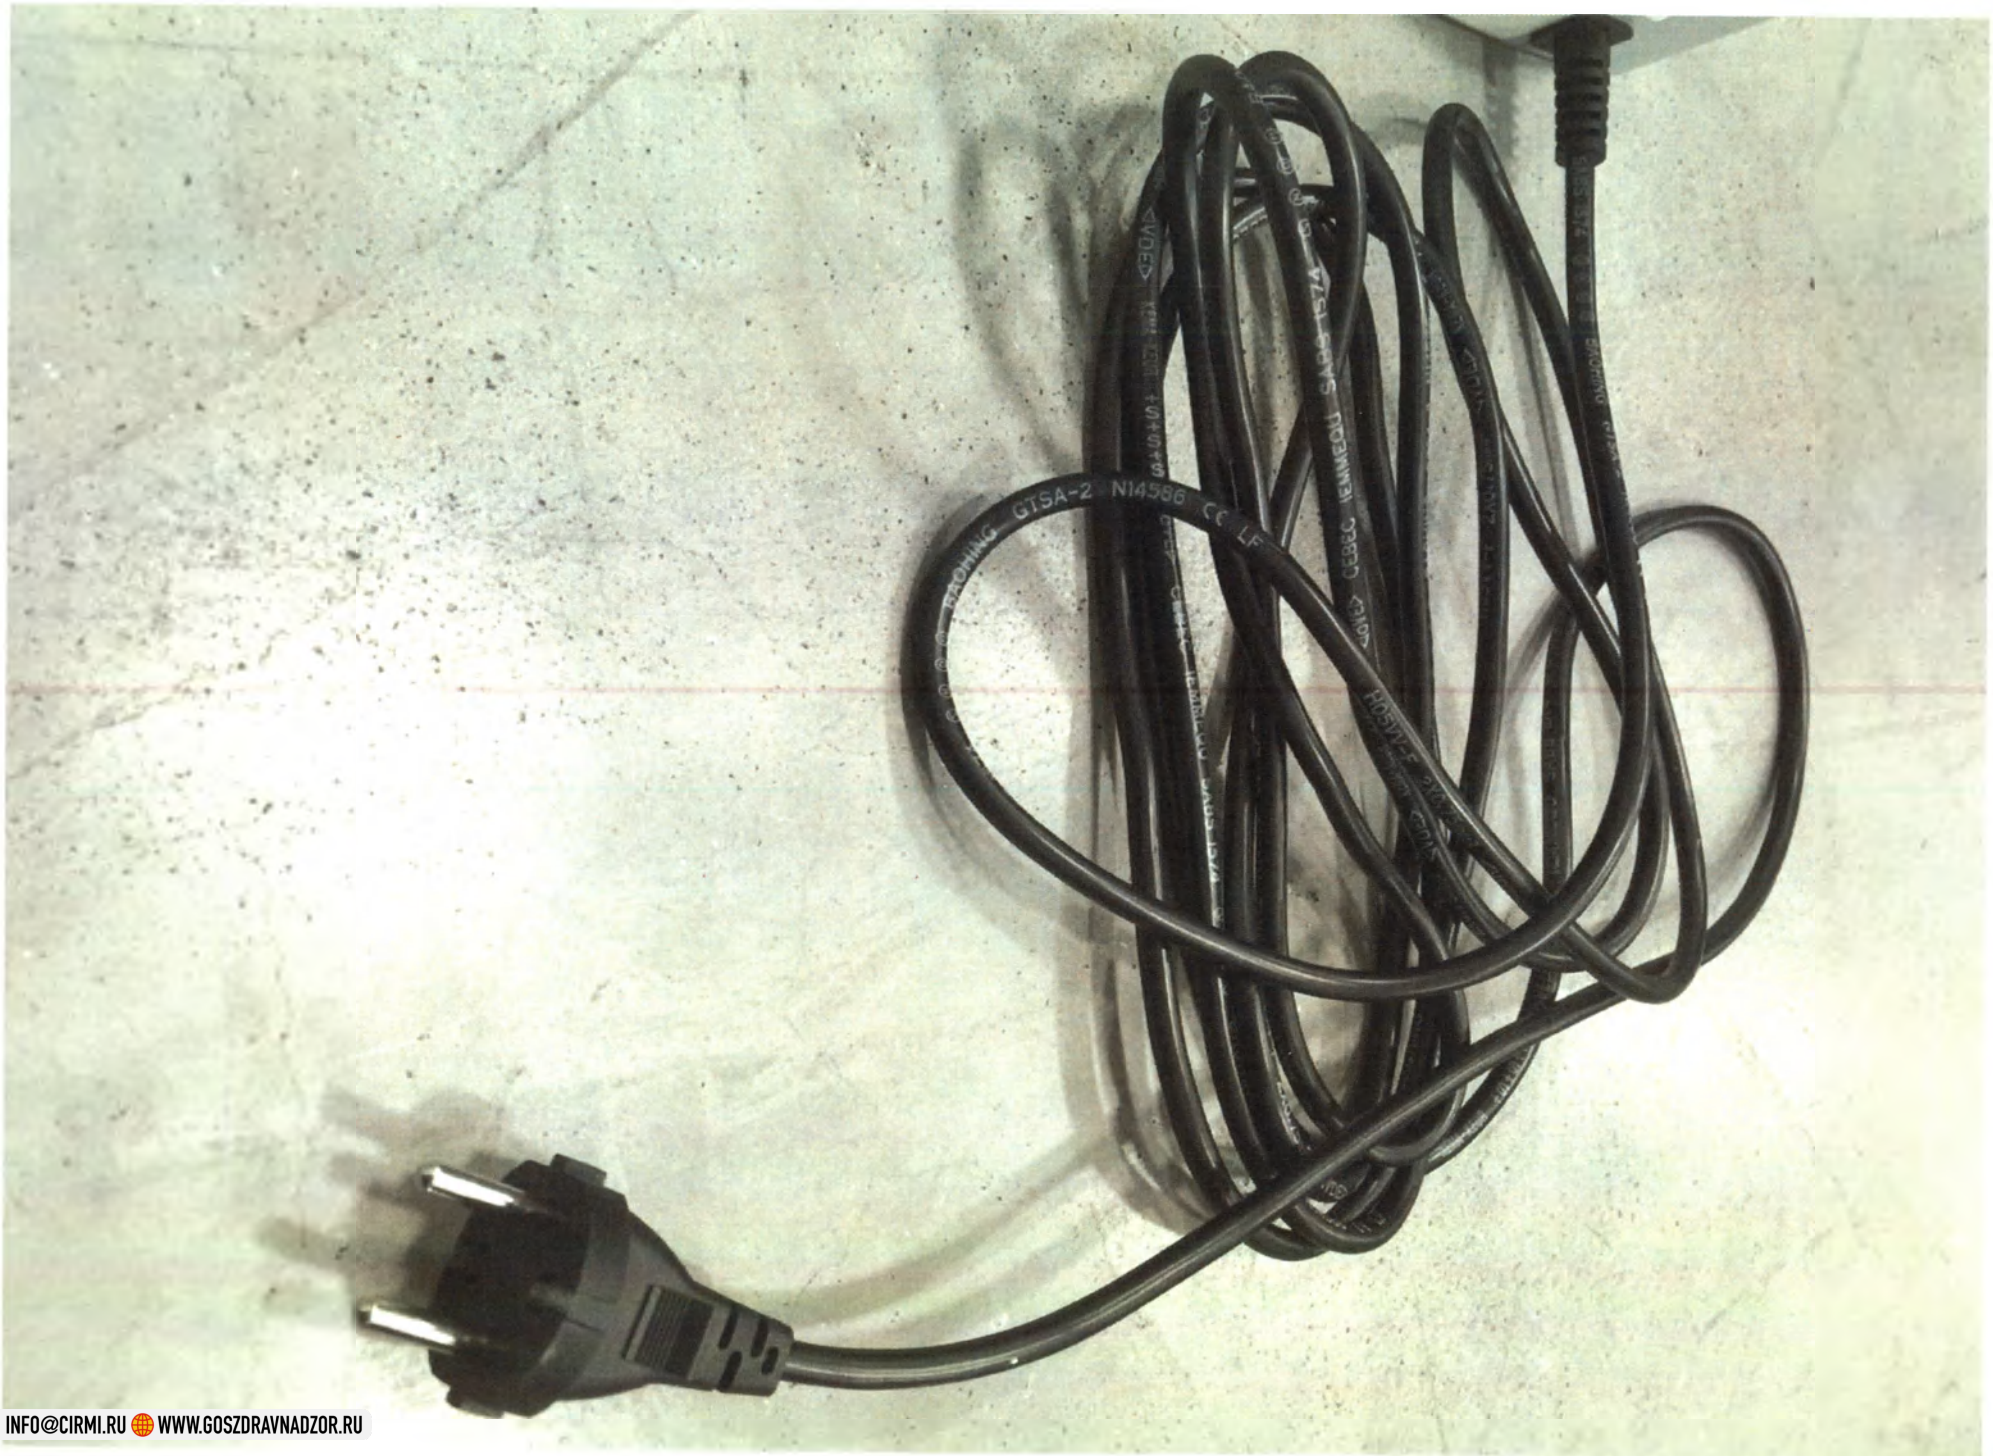

9. Система противопрележная активного типа: Airna Transen Deluxe, в составе:
- система трубок для подсоединения к насосу;

50





9. Система противопролежневая активного типа: Airna 1 гансен Deluxe, в составе:
- сумка для хранения матраса.






9. Система противопролежневая активного типа: nimbus 4, в составе:
- помпа для матраса;



9. Система противополежная активного типа: Nitrous 4, в составе:
- кабель питания сетевой;

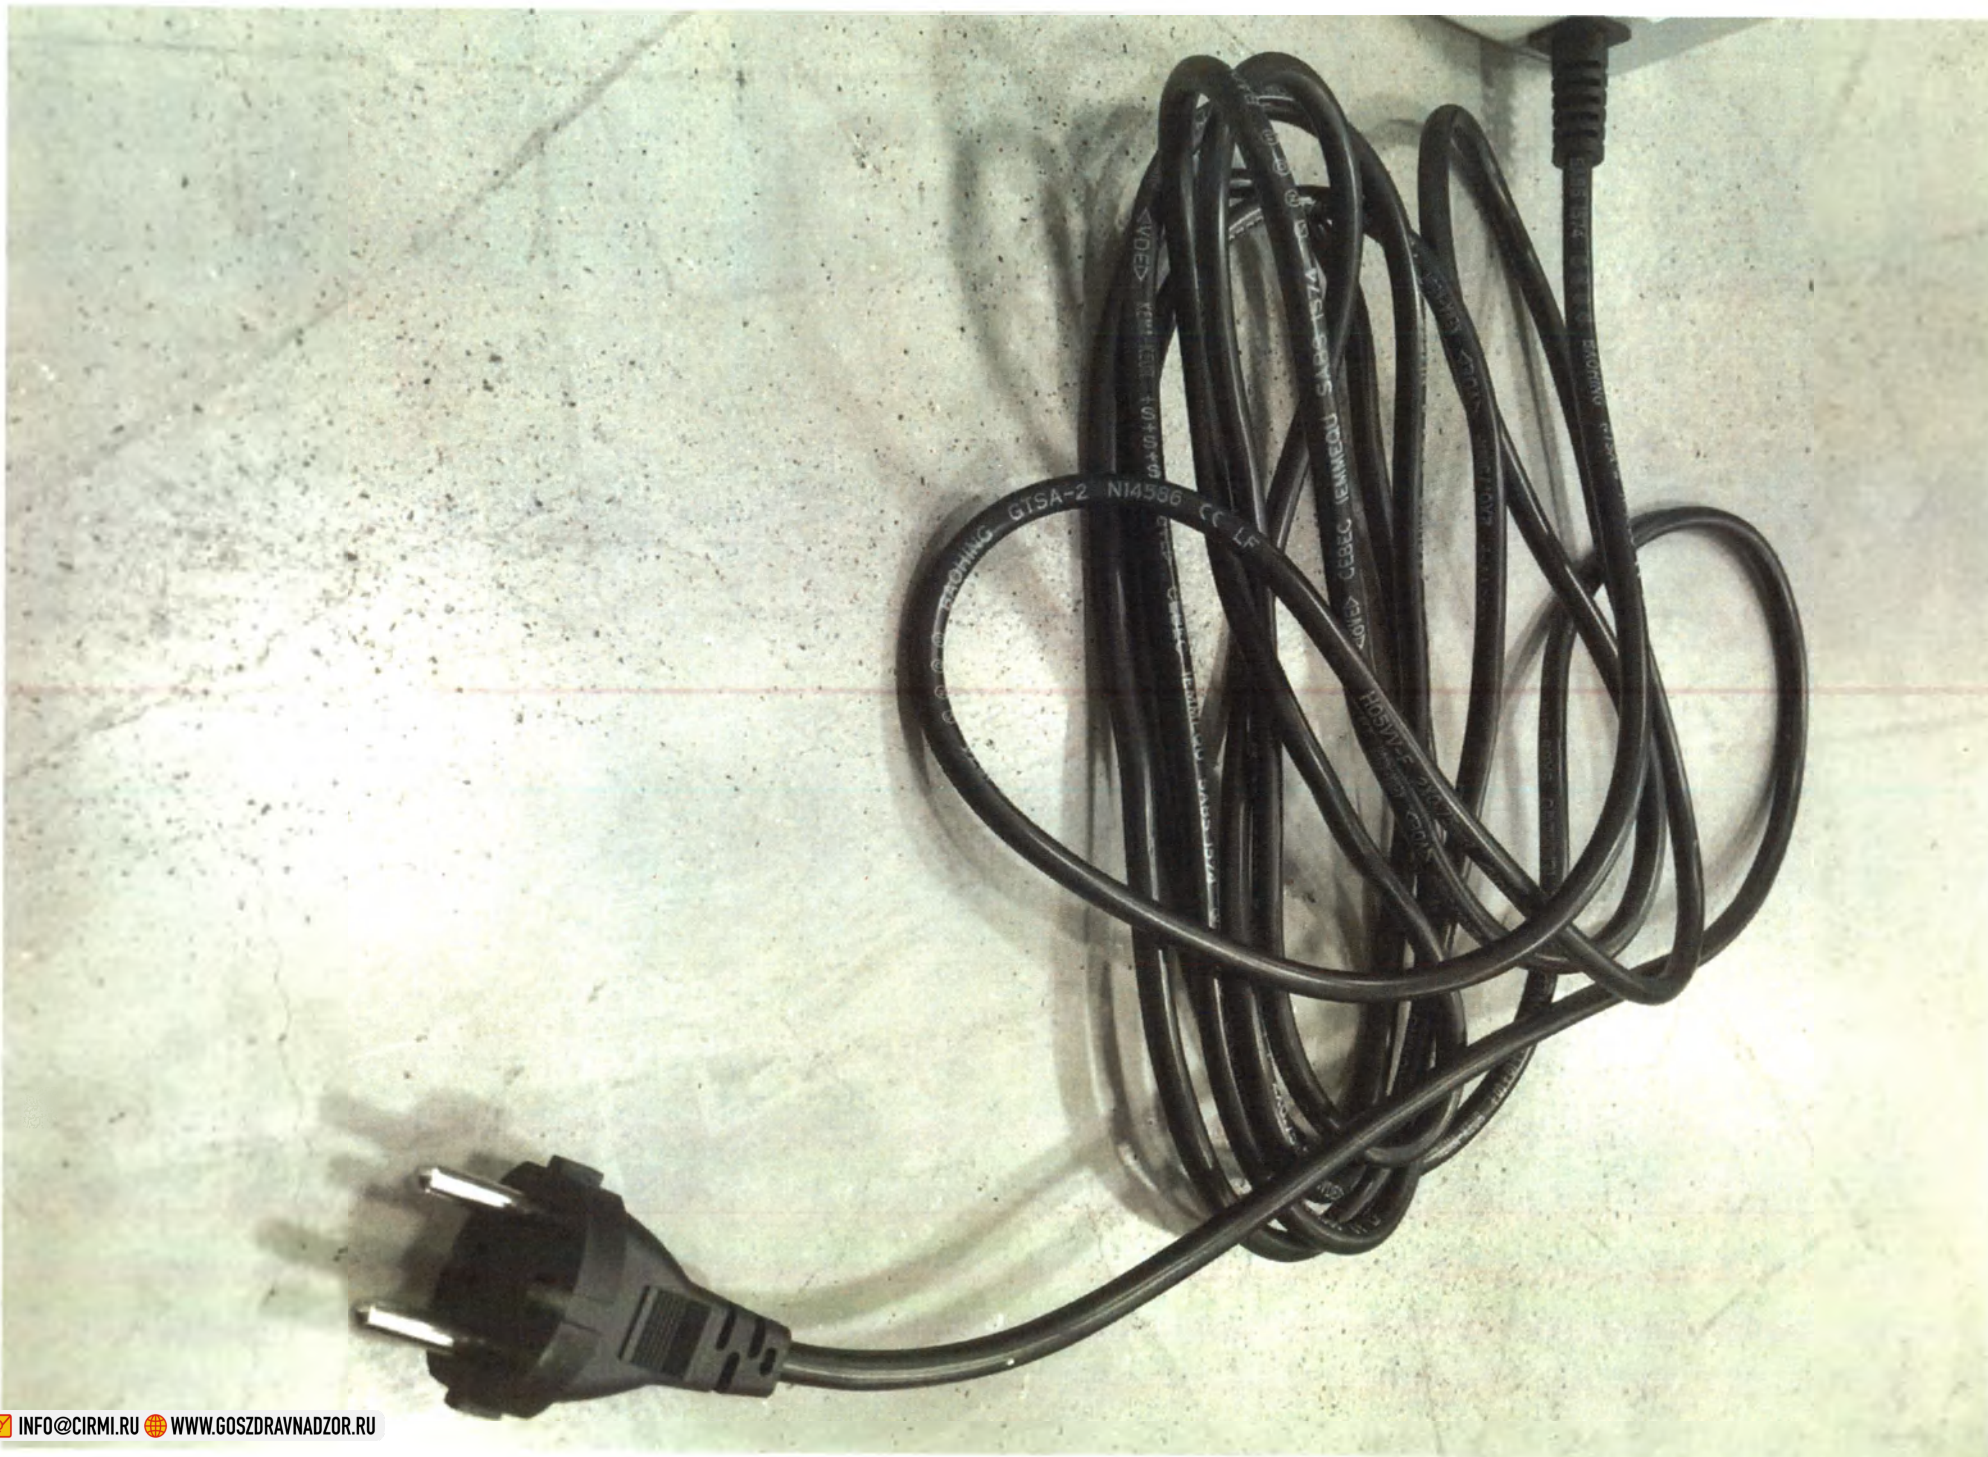

9. Система противопрележная активного типа: Nimbus 4, в составе:
- система трубок для подсоединения к насосу;





9. Система противопролежневая активного типа: Nitrobus 4, в составе:
- сумка для хранения матраса.




9. Система противоопролежневая активного типа: Nimbus Professional, в составе:
- матрас;

59



9. Система противопролежневая активного типа: Cimbus Professional, в составе:
- помпа для матраса;



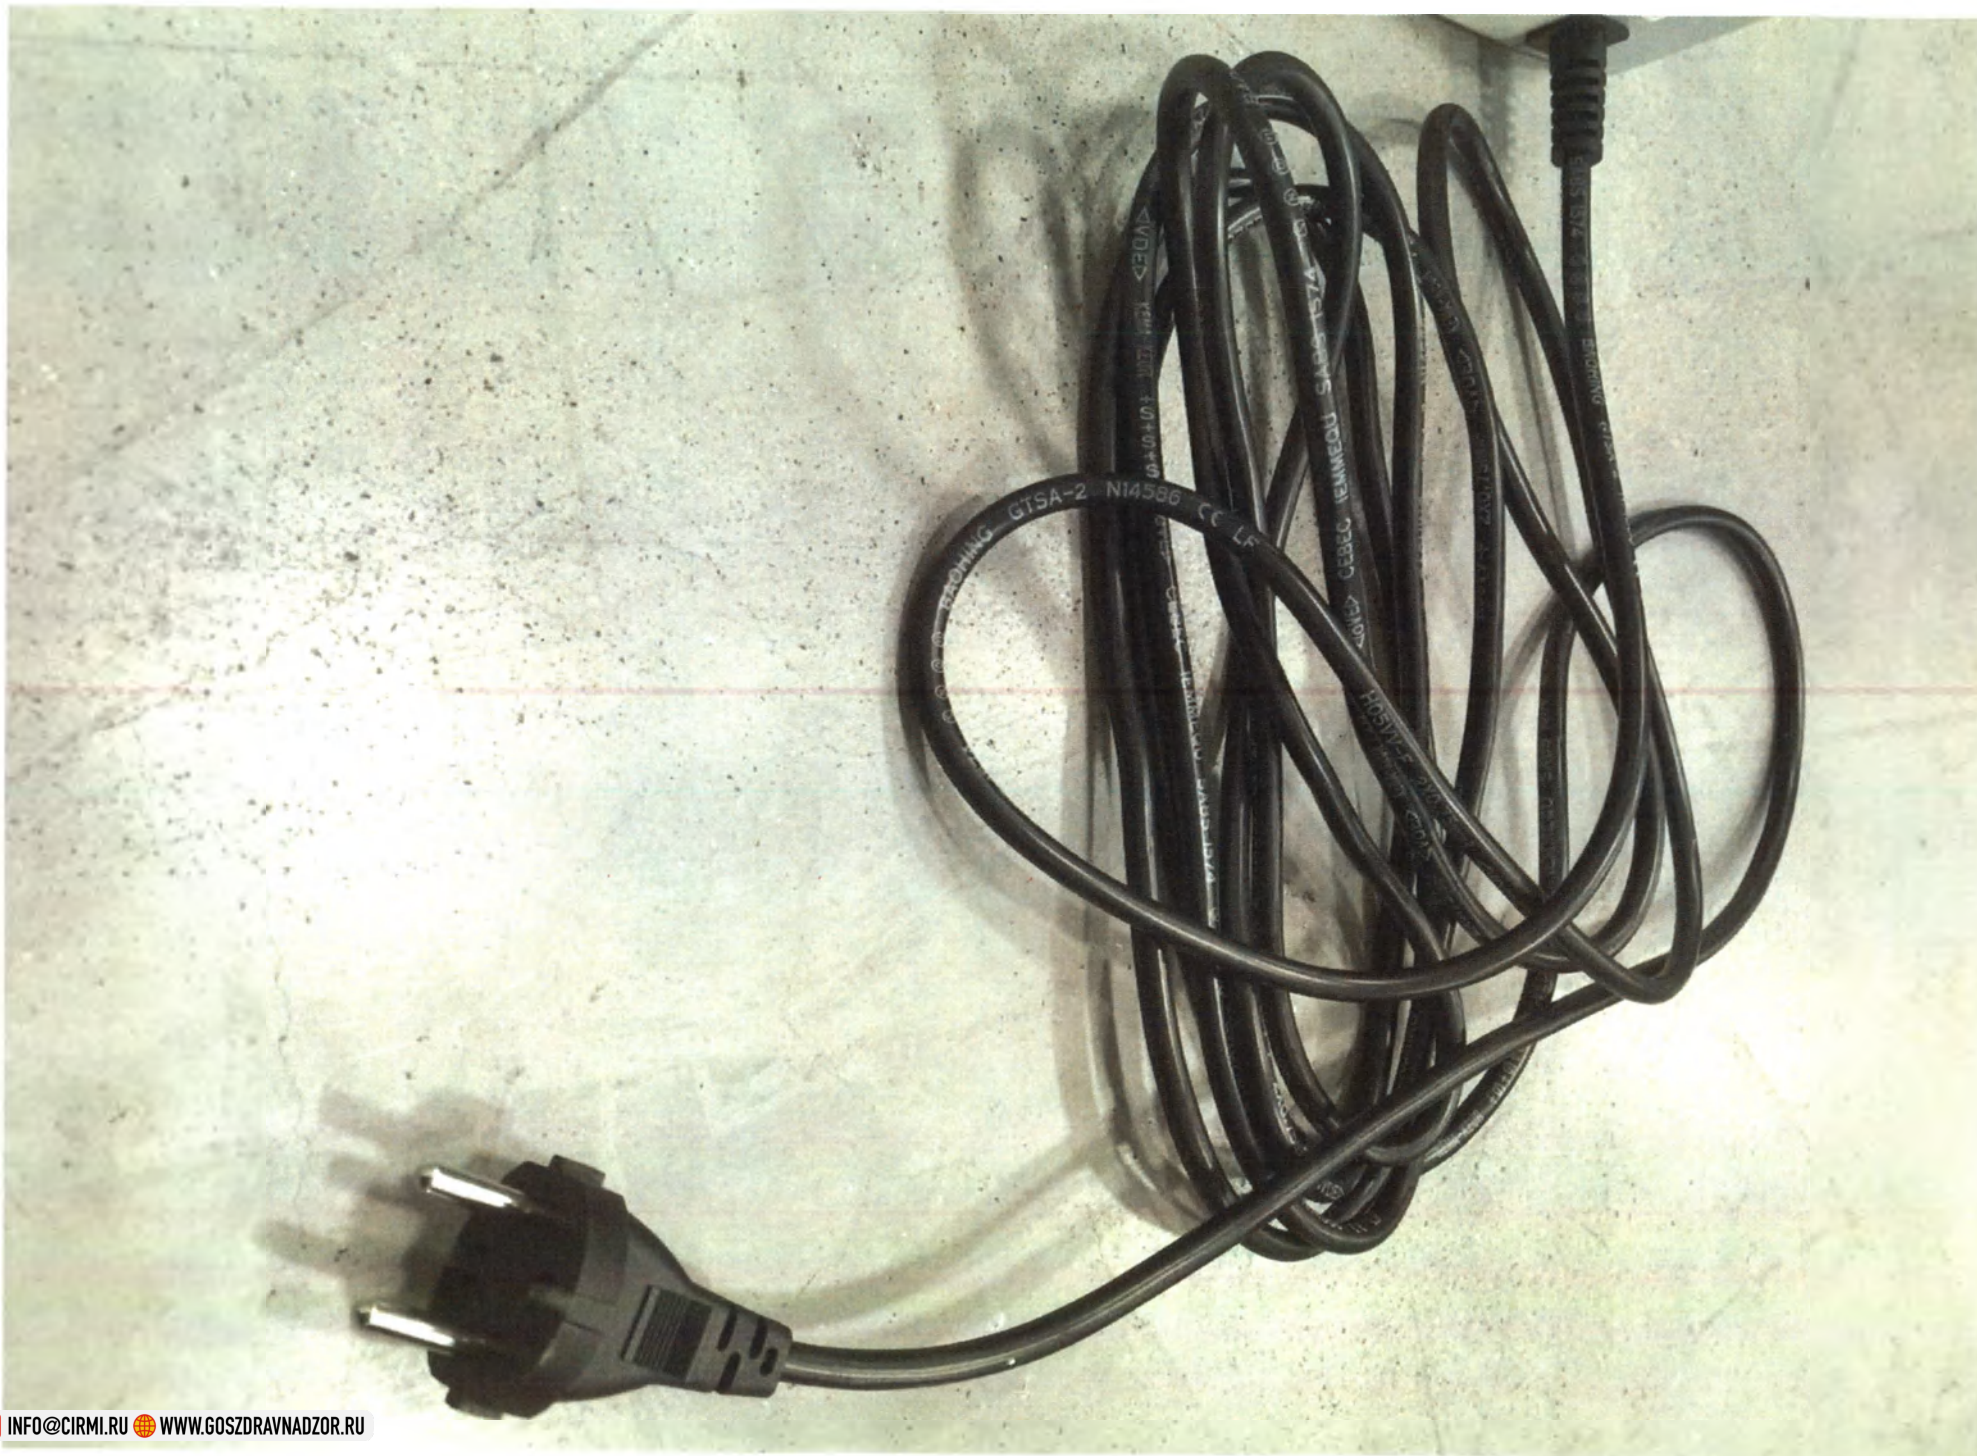

9. Система противооплежневая активного типа: Nimbus Professional, в составе:
- система трубок для подключения к насосу;





9. Система противопротезная активного типа: Nimbus Professional, в составе:
- сумка для хранения матраса.

64



Enterprise 5000X (E5X) Инструкция по эксплуатации

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP



746-577-RU_07 • 05/2016

...with people in mind

ENTERPRISE E8000X (E8X)

Инструкция по эксплуатации

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP



746-585-RU_04 • 05/2016

...with people in mind

ENTERPRISE 9000X (E9X)

Инструкция по эксплуатации

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP



746-591-RU_04 • 05/2016

...with people in mind

10. Эксплуатационная документация:


- на CD-диске (не более 10 шт.).



1. Боковые ограждения складные:- металлические на 3/4 длины (не более 2 шт.);



1. Боковые ограждения складные:- пластиковые 2-х секционные (не более 2 шт.).

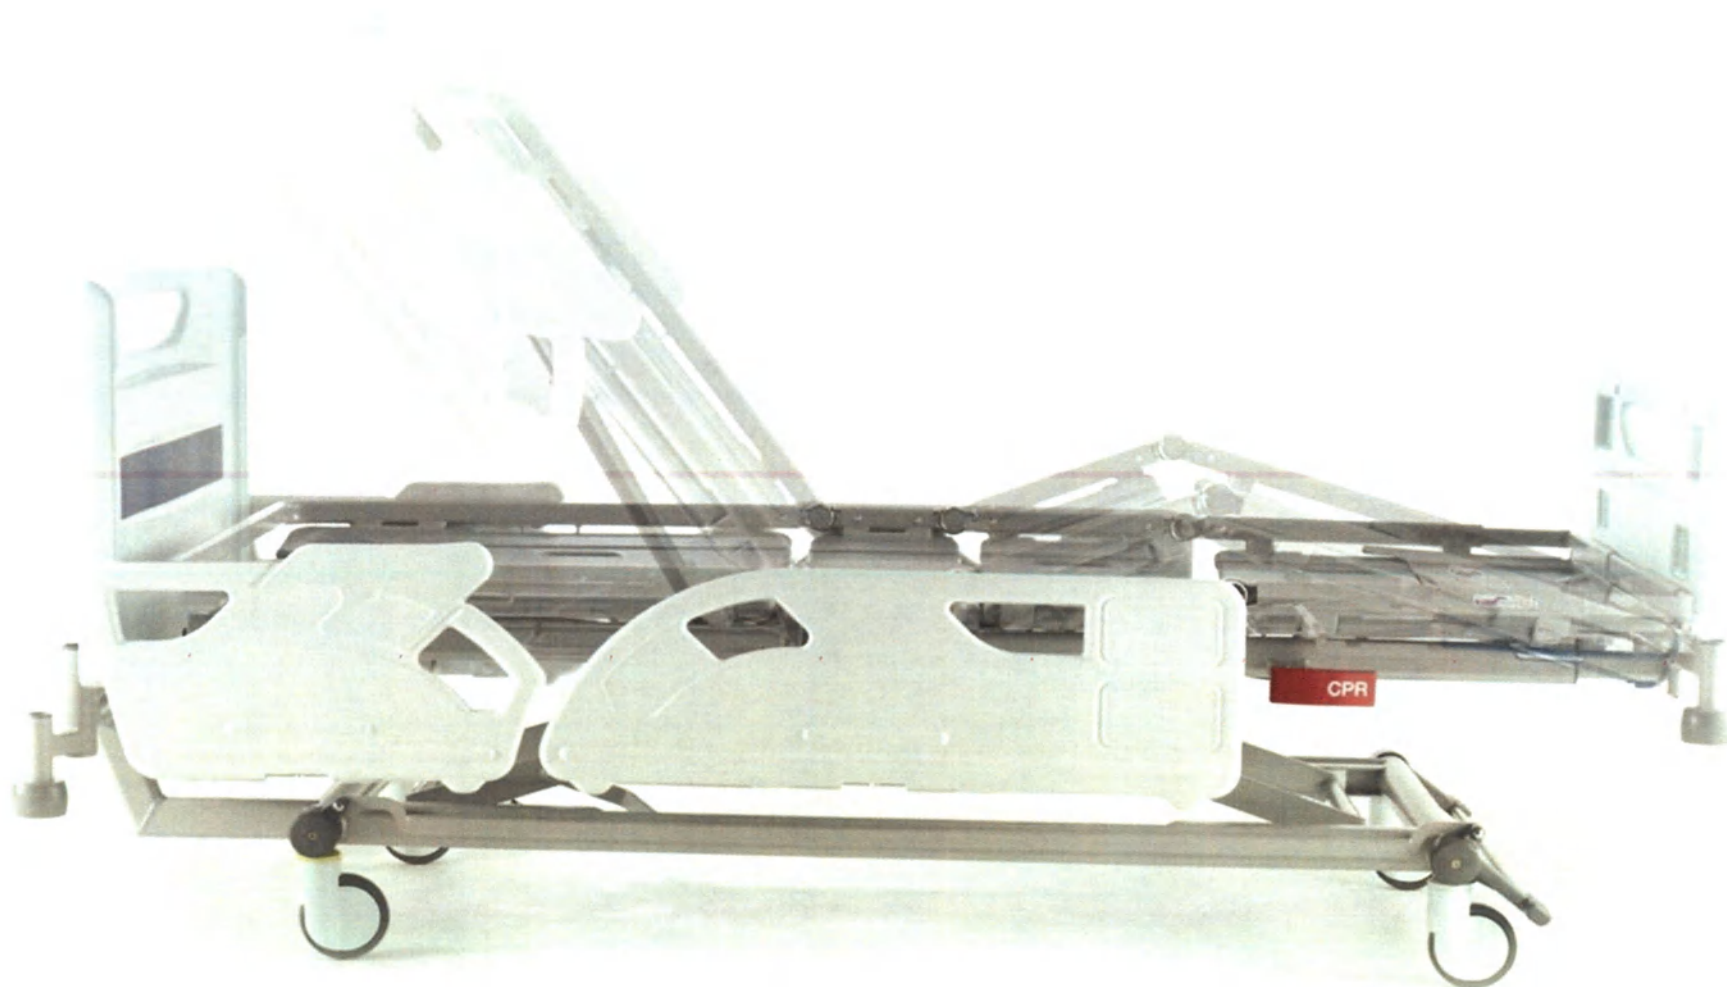

2. Увеличитель высоты металлических боковых ограждений (не более 2 шт.).



3. Накладки боковых ограждений.


- на металлические боковые ограждения на 3/4 длины складные (не более 2 шт.);






7. Стойка инфузионная (не более 6 шт.).


- стандартная (стальной крюк);

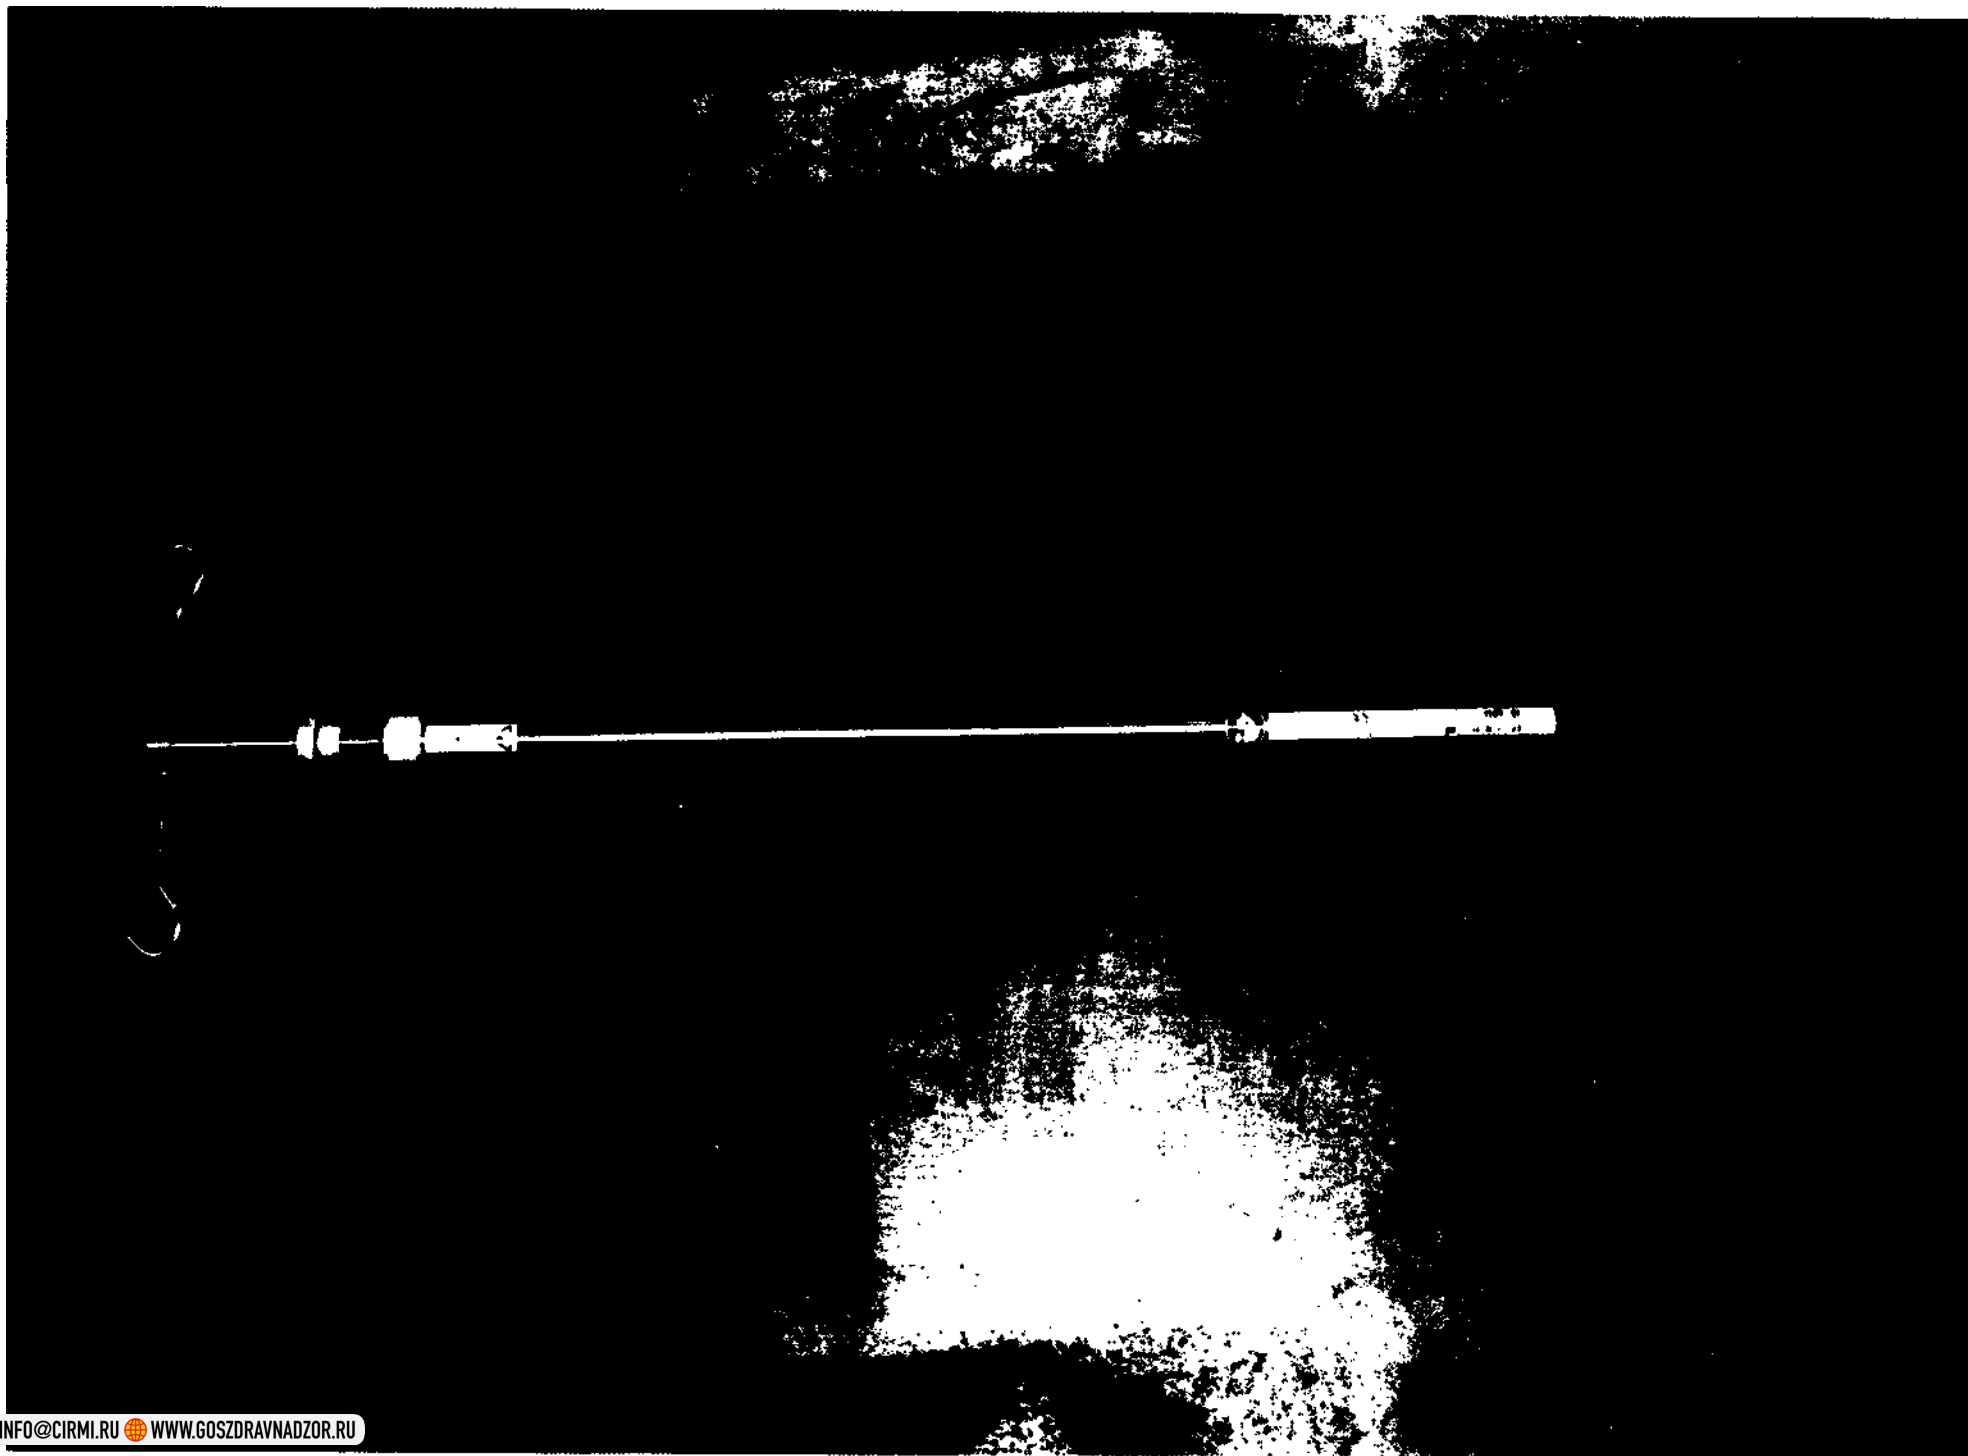

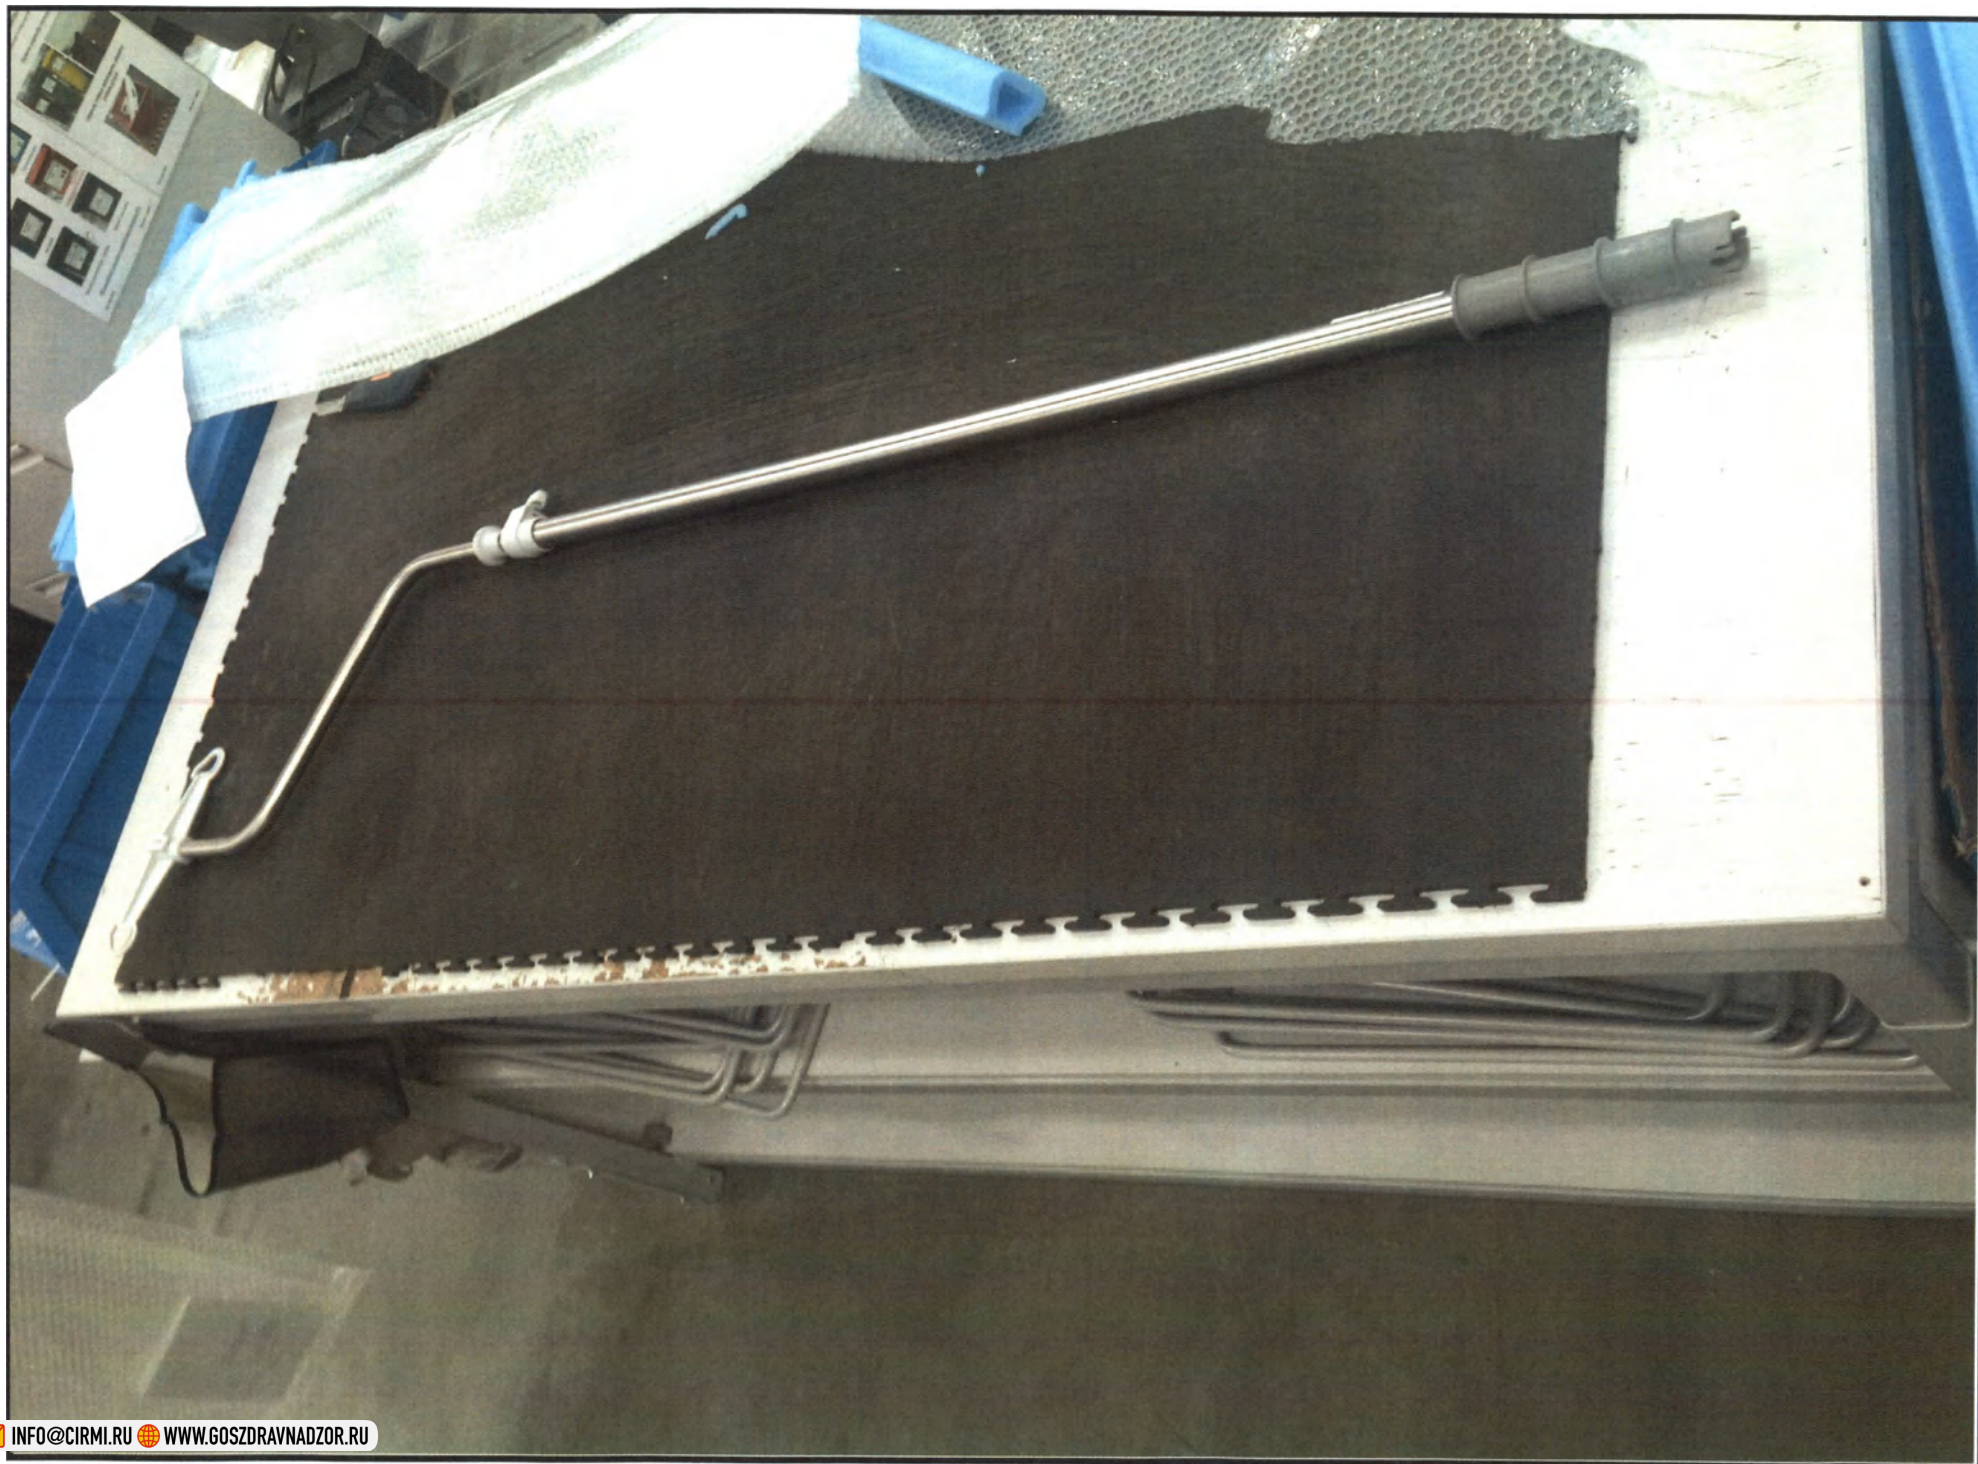

- усиленная;



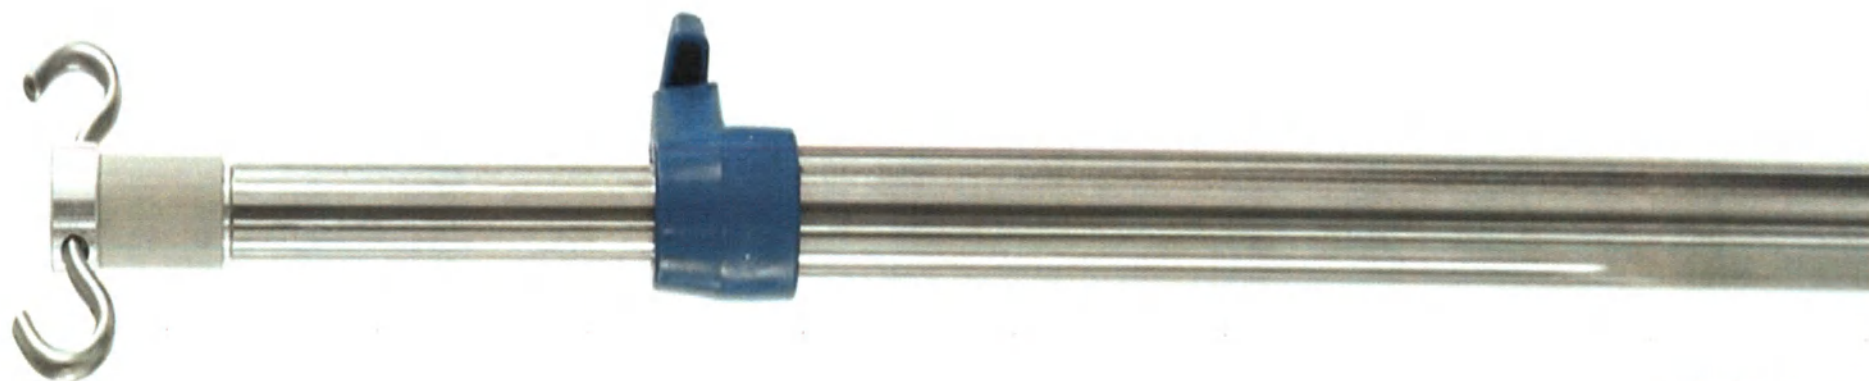

2. Стойка напольная подвешивая с ремнем и рукояткой (по бокам 2 шт.);
- фиксированная;




2. Столик пациента подвешивается к ремню и рукояткой (по одной в шт.),
- поворотная.





в. держатели для медицинских емкостей (не более 10 шт.).

- держатель дренажного сосуда;

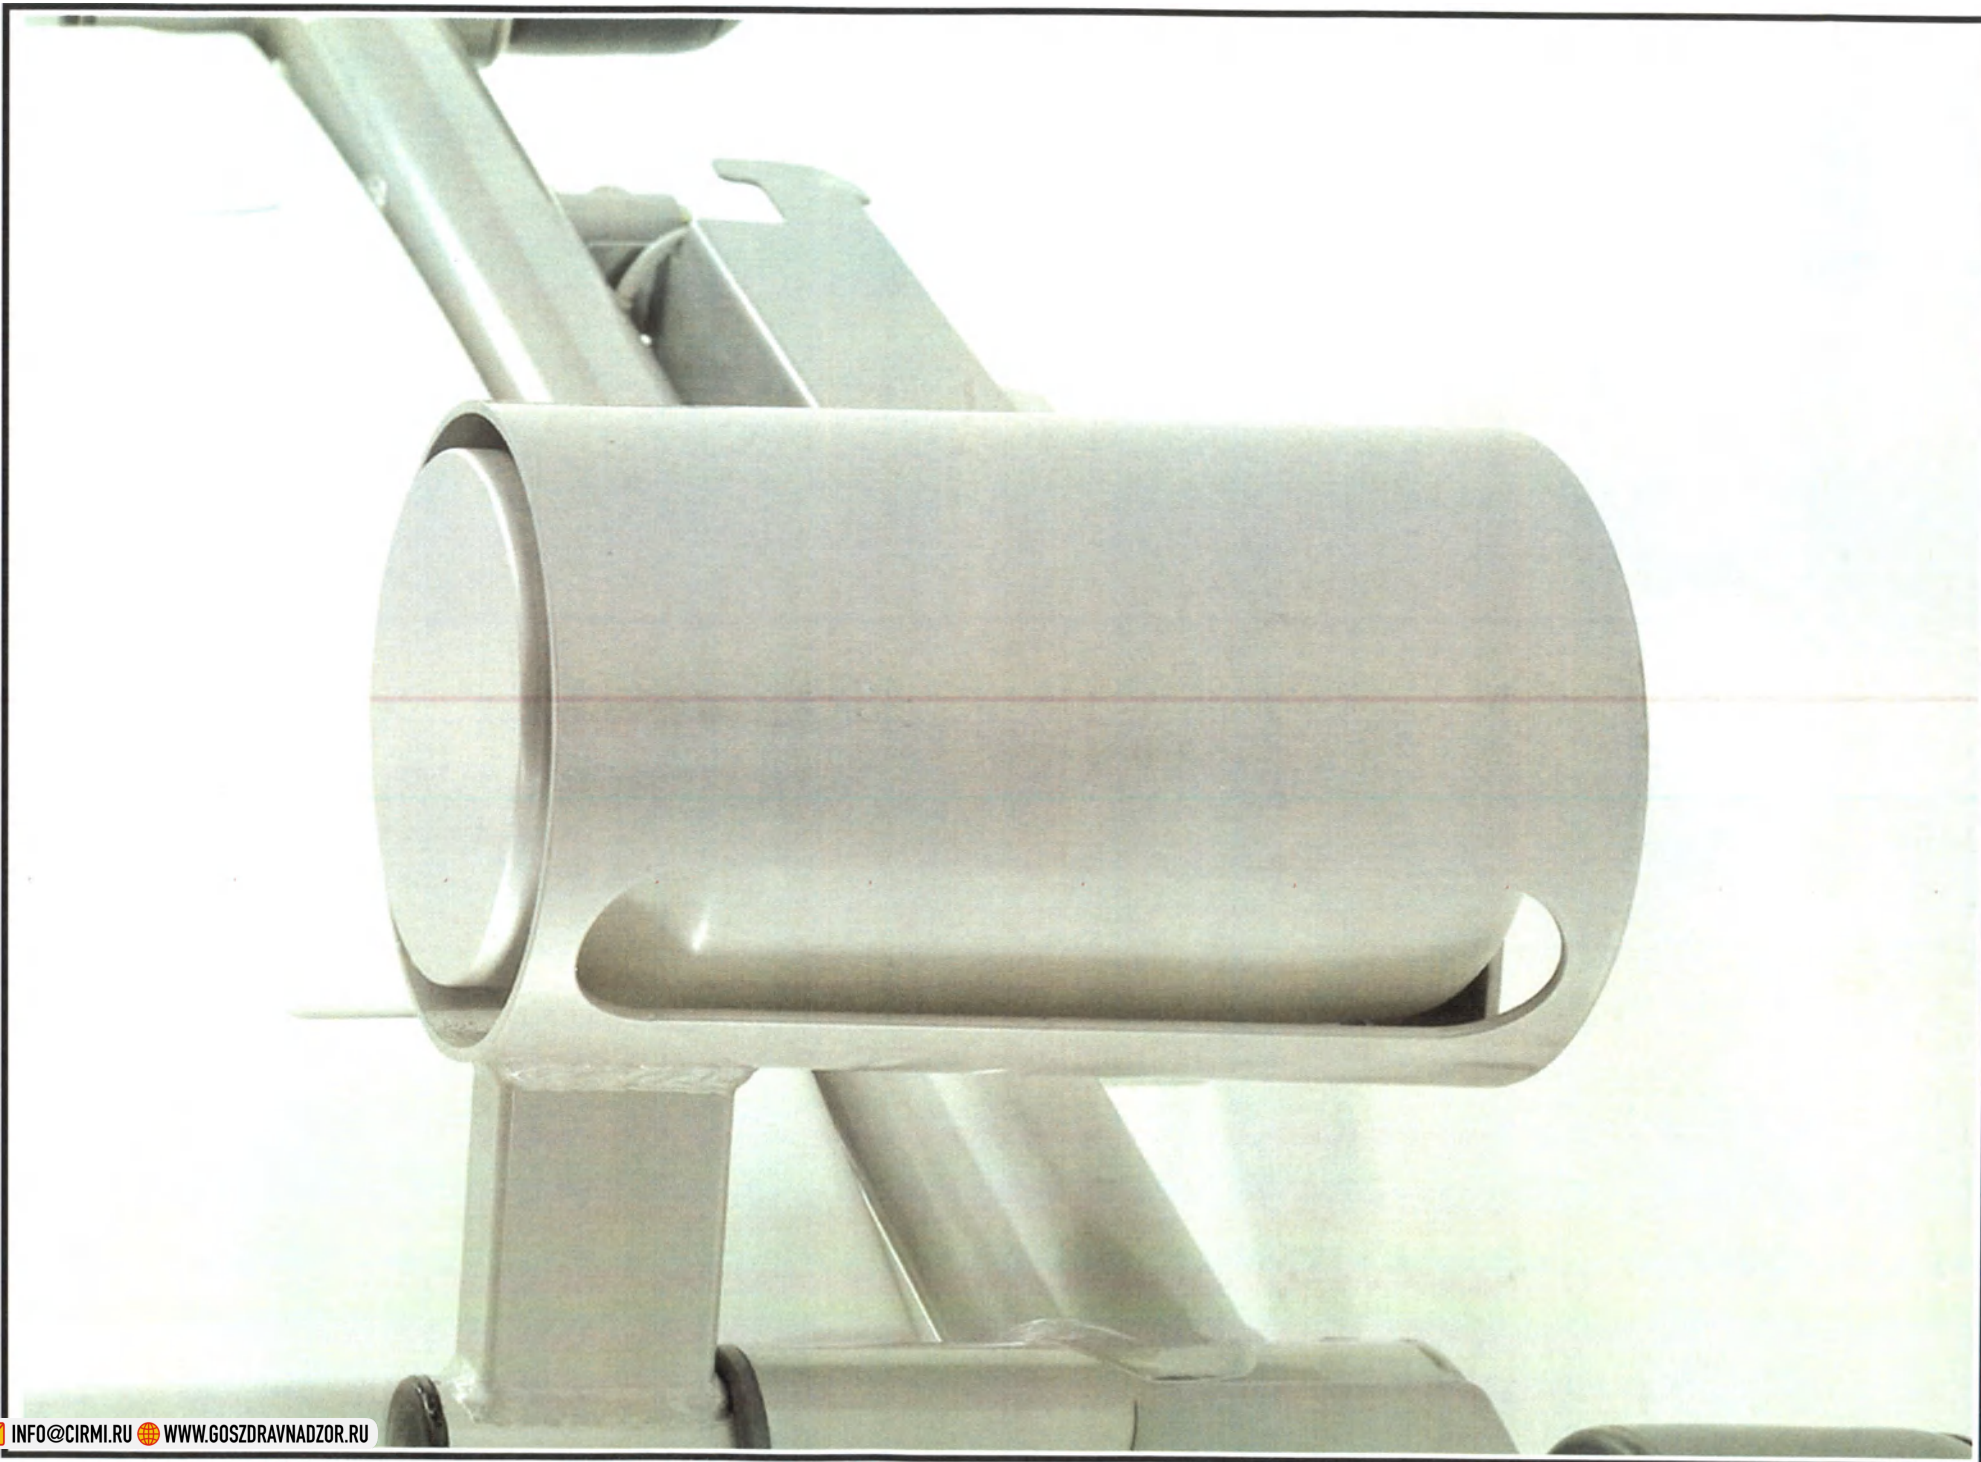


в. держатели для медицинских емкостей (по более 10 шт.);
- держатель судна, монтируемый к задней панели кровати;

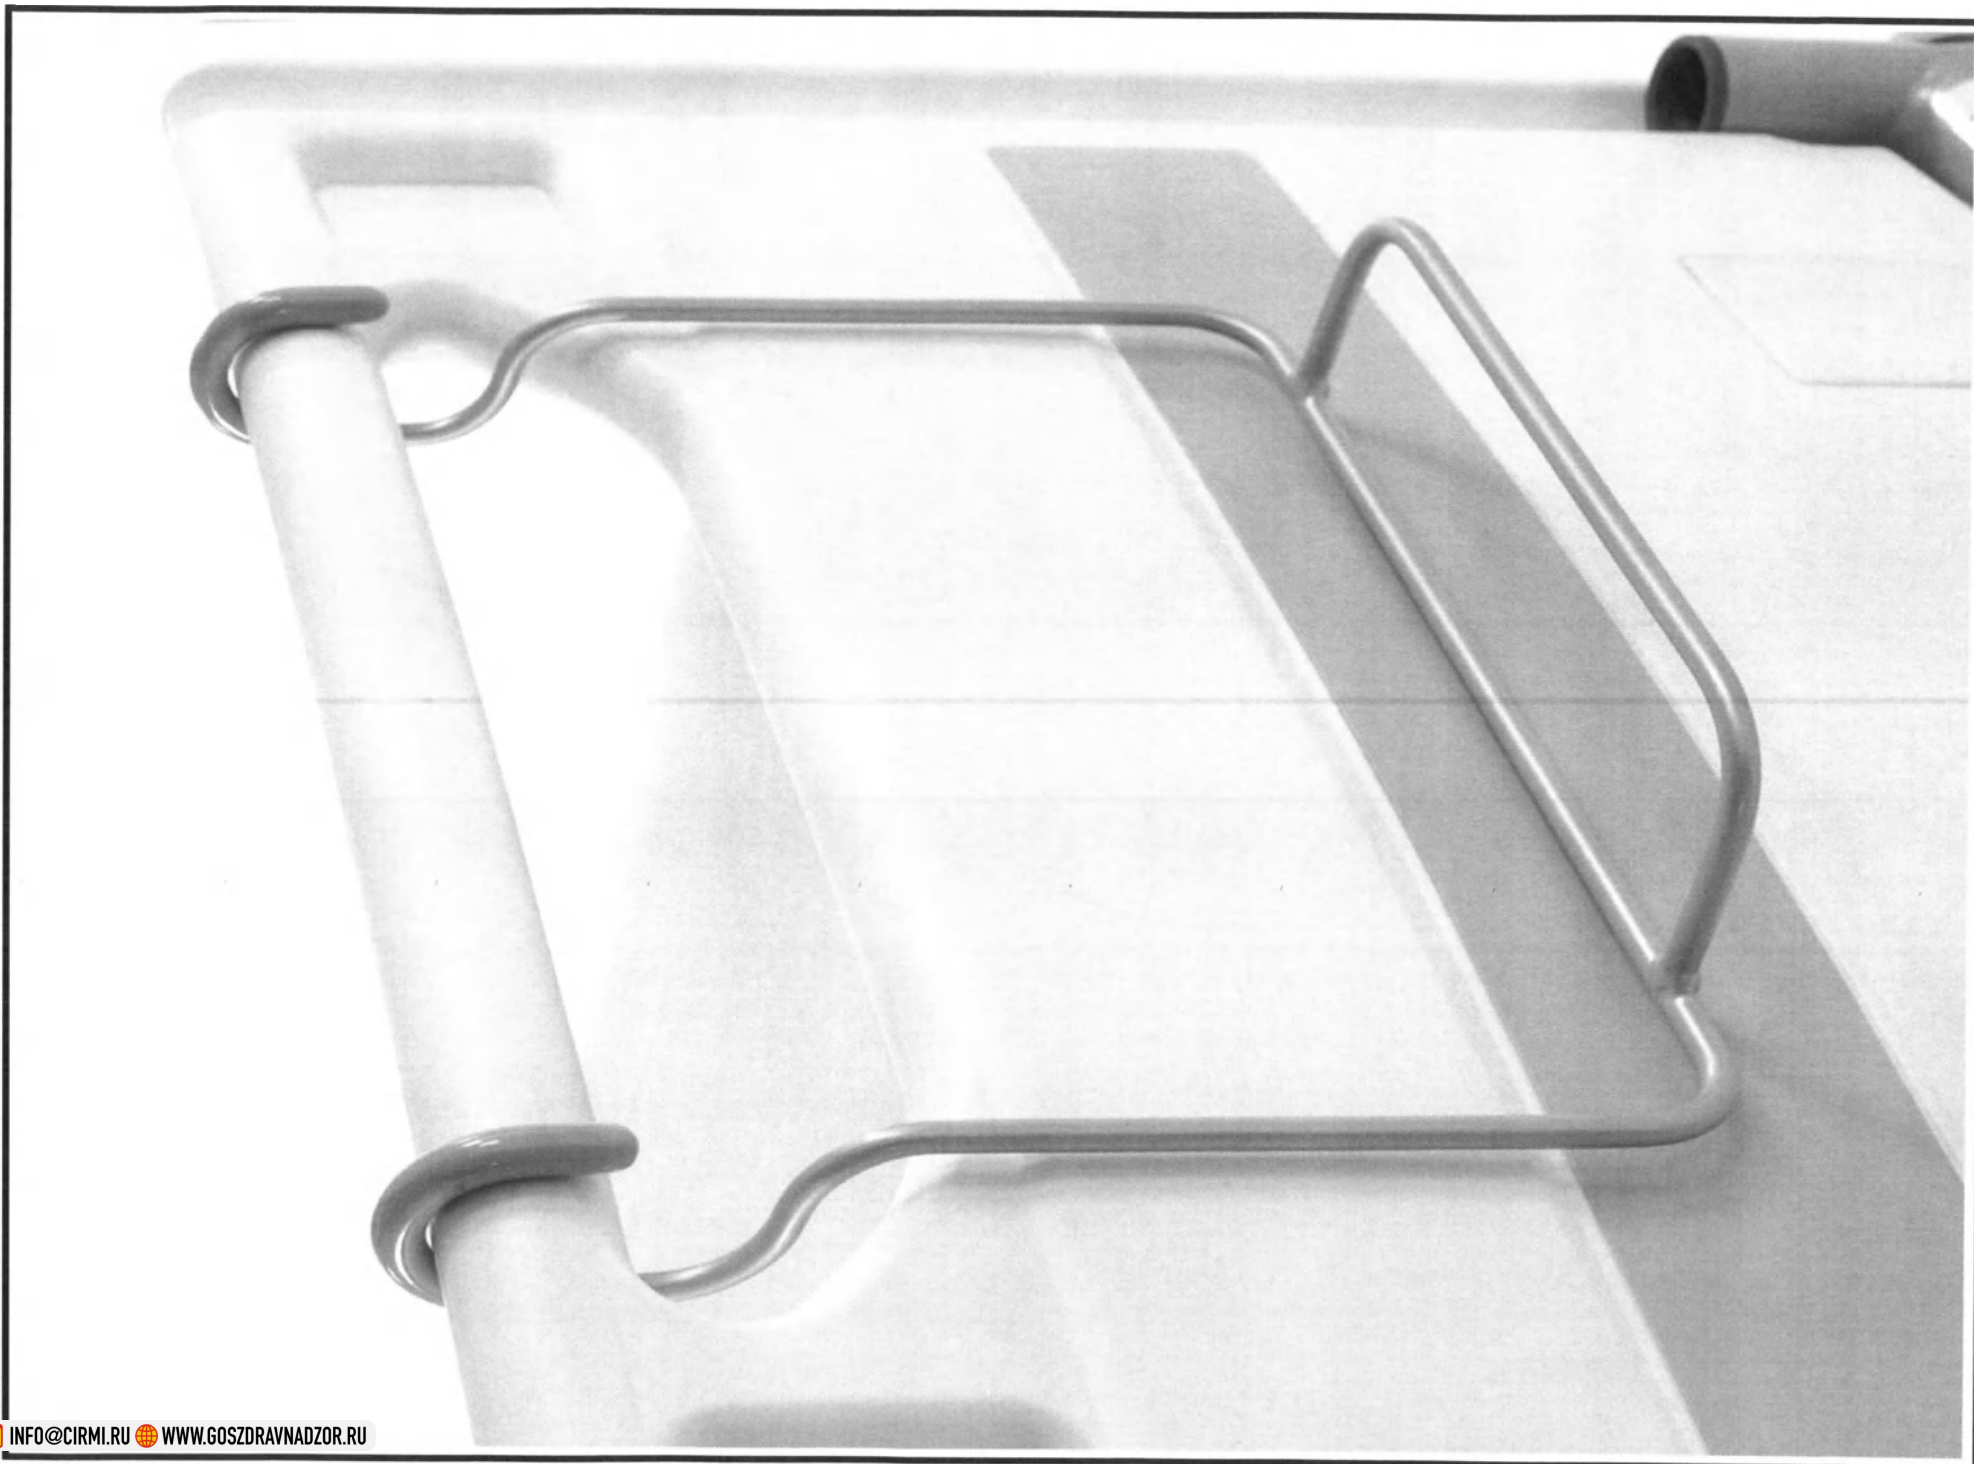

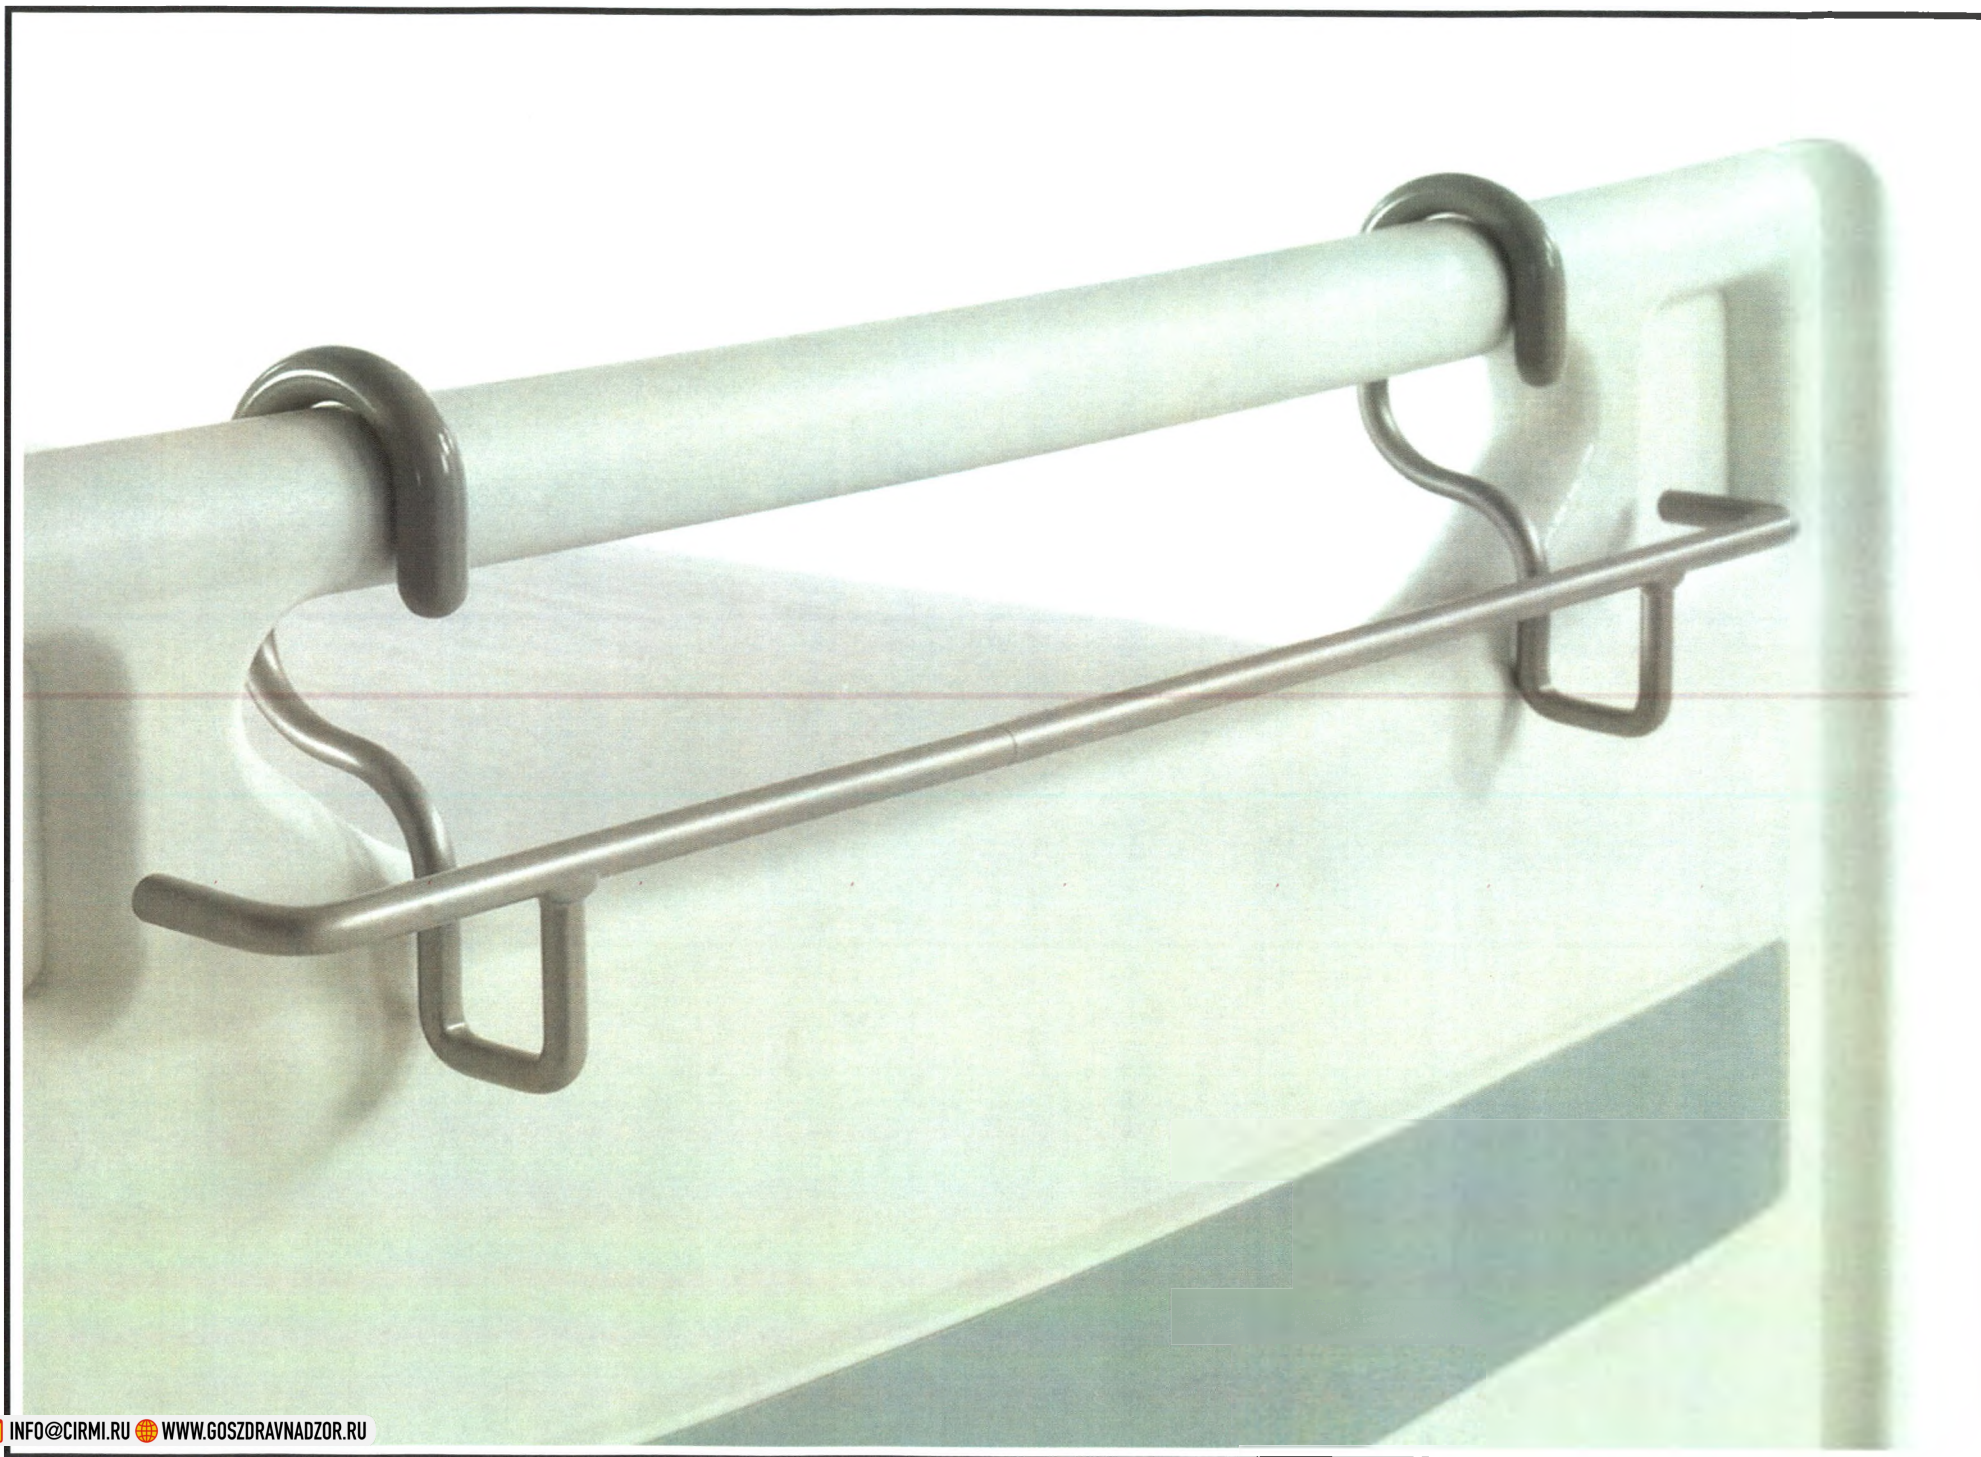

в. держатели для медицинских емкостей (не более 10 шт.);
- держатель для бутылок двухместный;

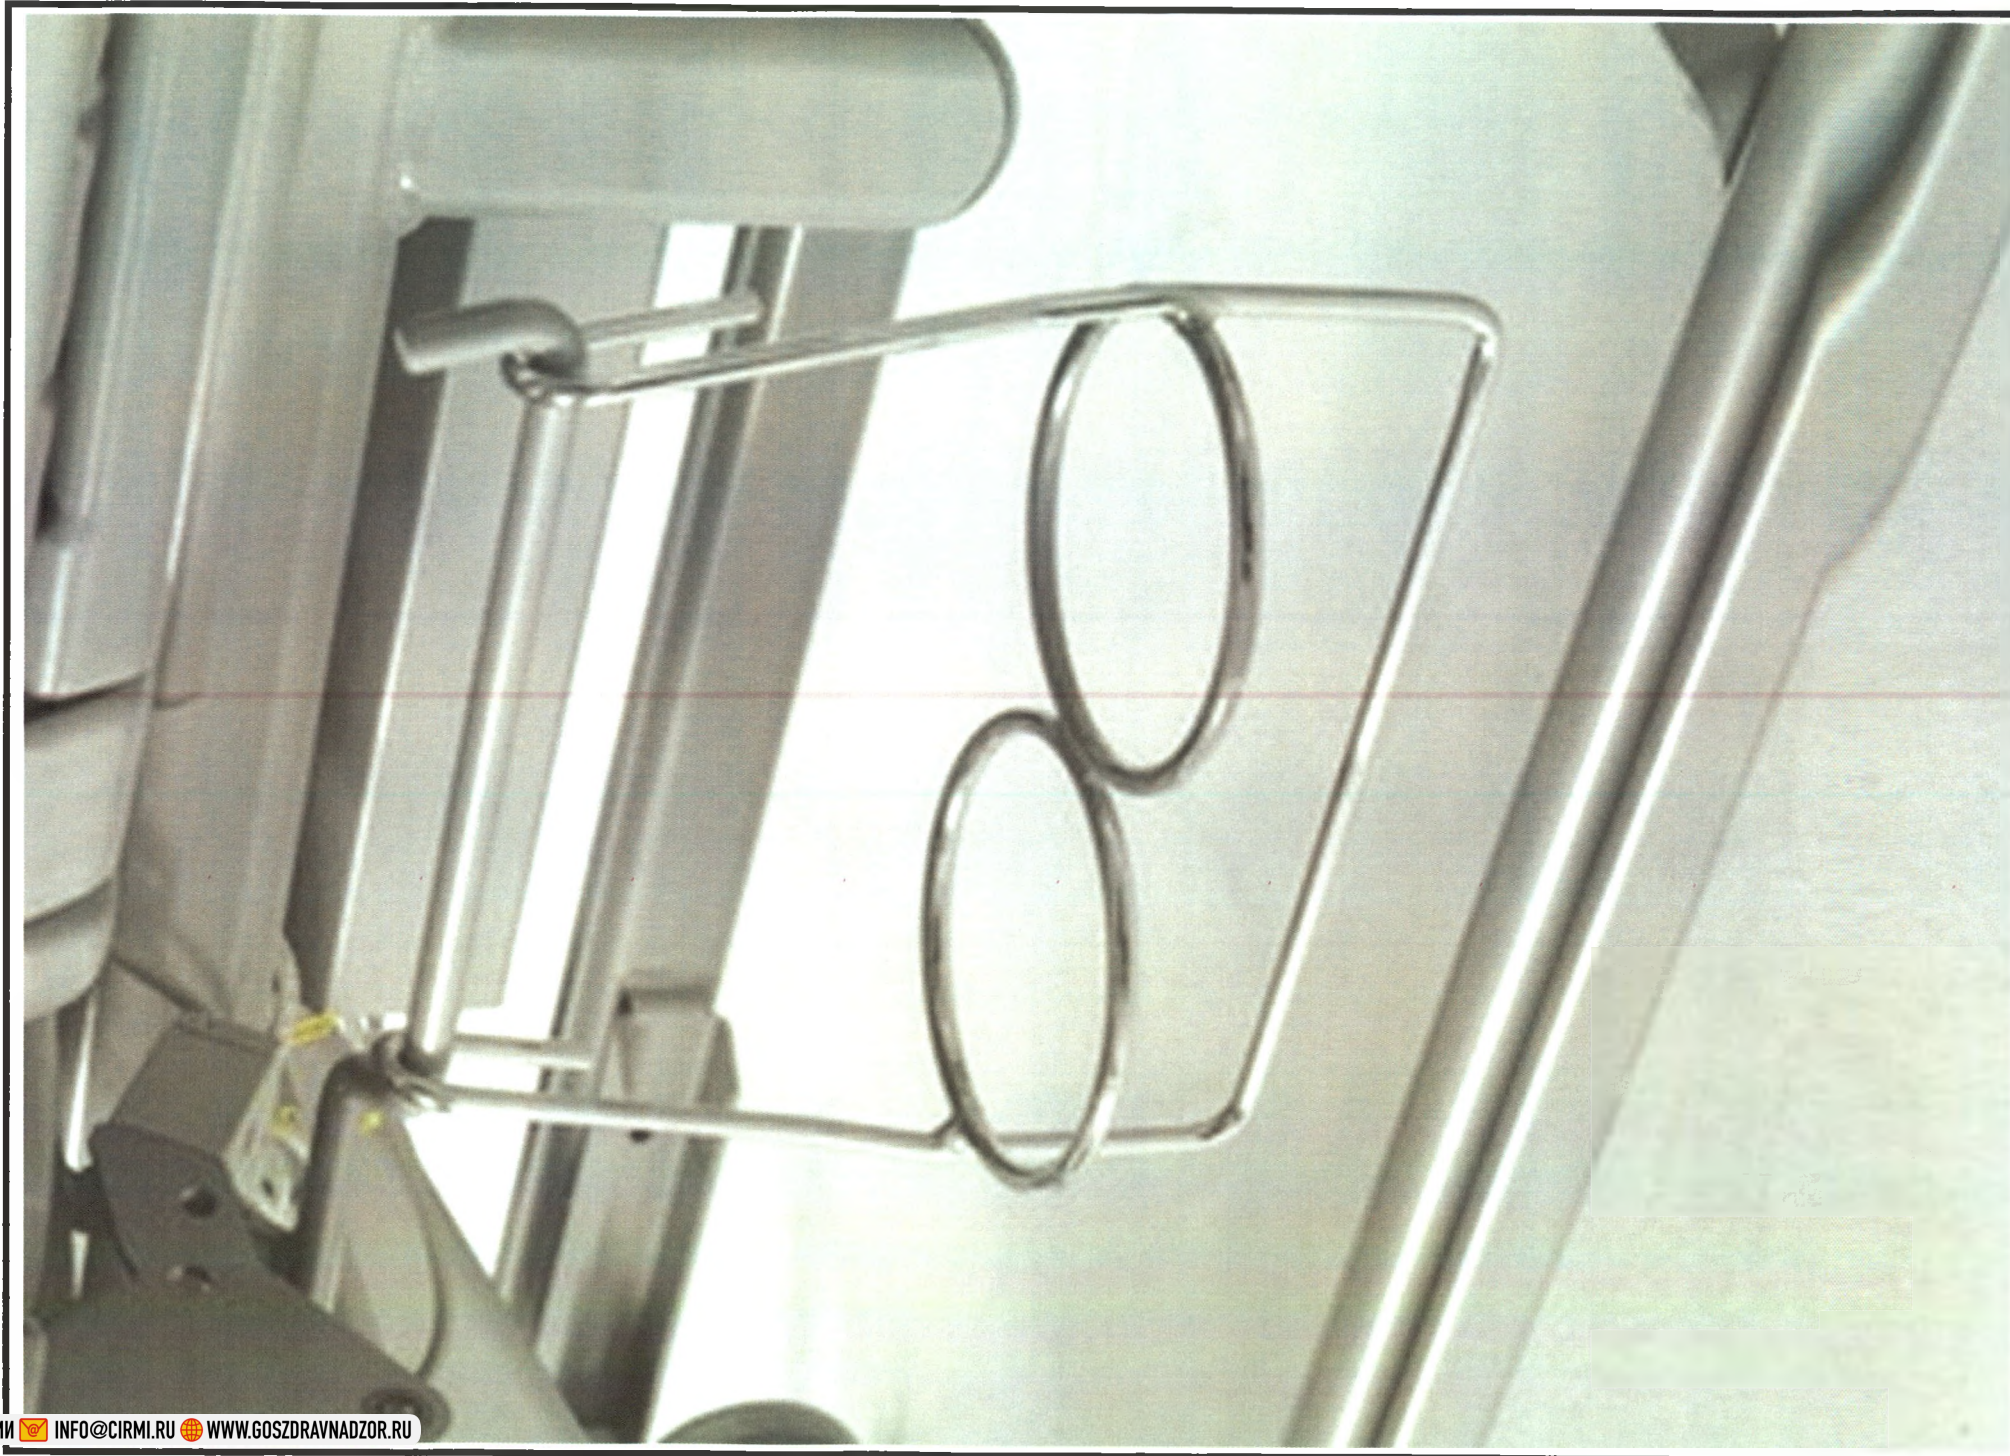

в. держатели для медицинских емкостей (по 5000 шт.).

- держатель мочеприёмника;



в. держатели для медицинских емкостей (не более 10 шт.).

- держатель шприцевого насоса;



в. держатели для медицинских емкостей (не более 10 шт.).


- держатель инфузионного мешка, монтируемый на стойке для подъема пациента.



7. Держатель кислородного баллона (для баллонов CD, D, E, PD, B5) (не более 3 шт.)



8. Заполняющая панель для ножного конца кровати (не более 2 шт.).

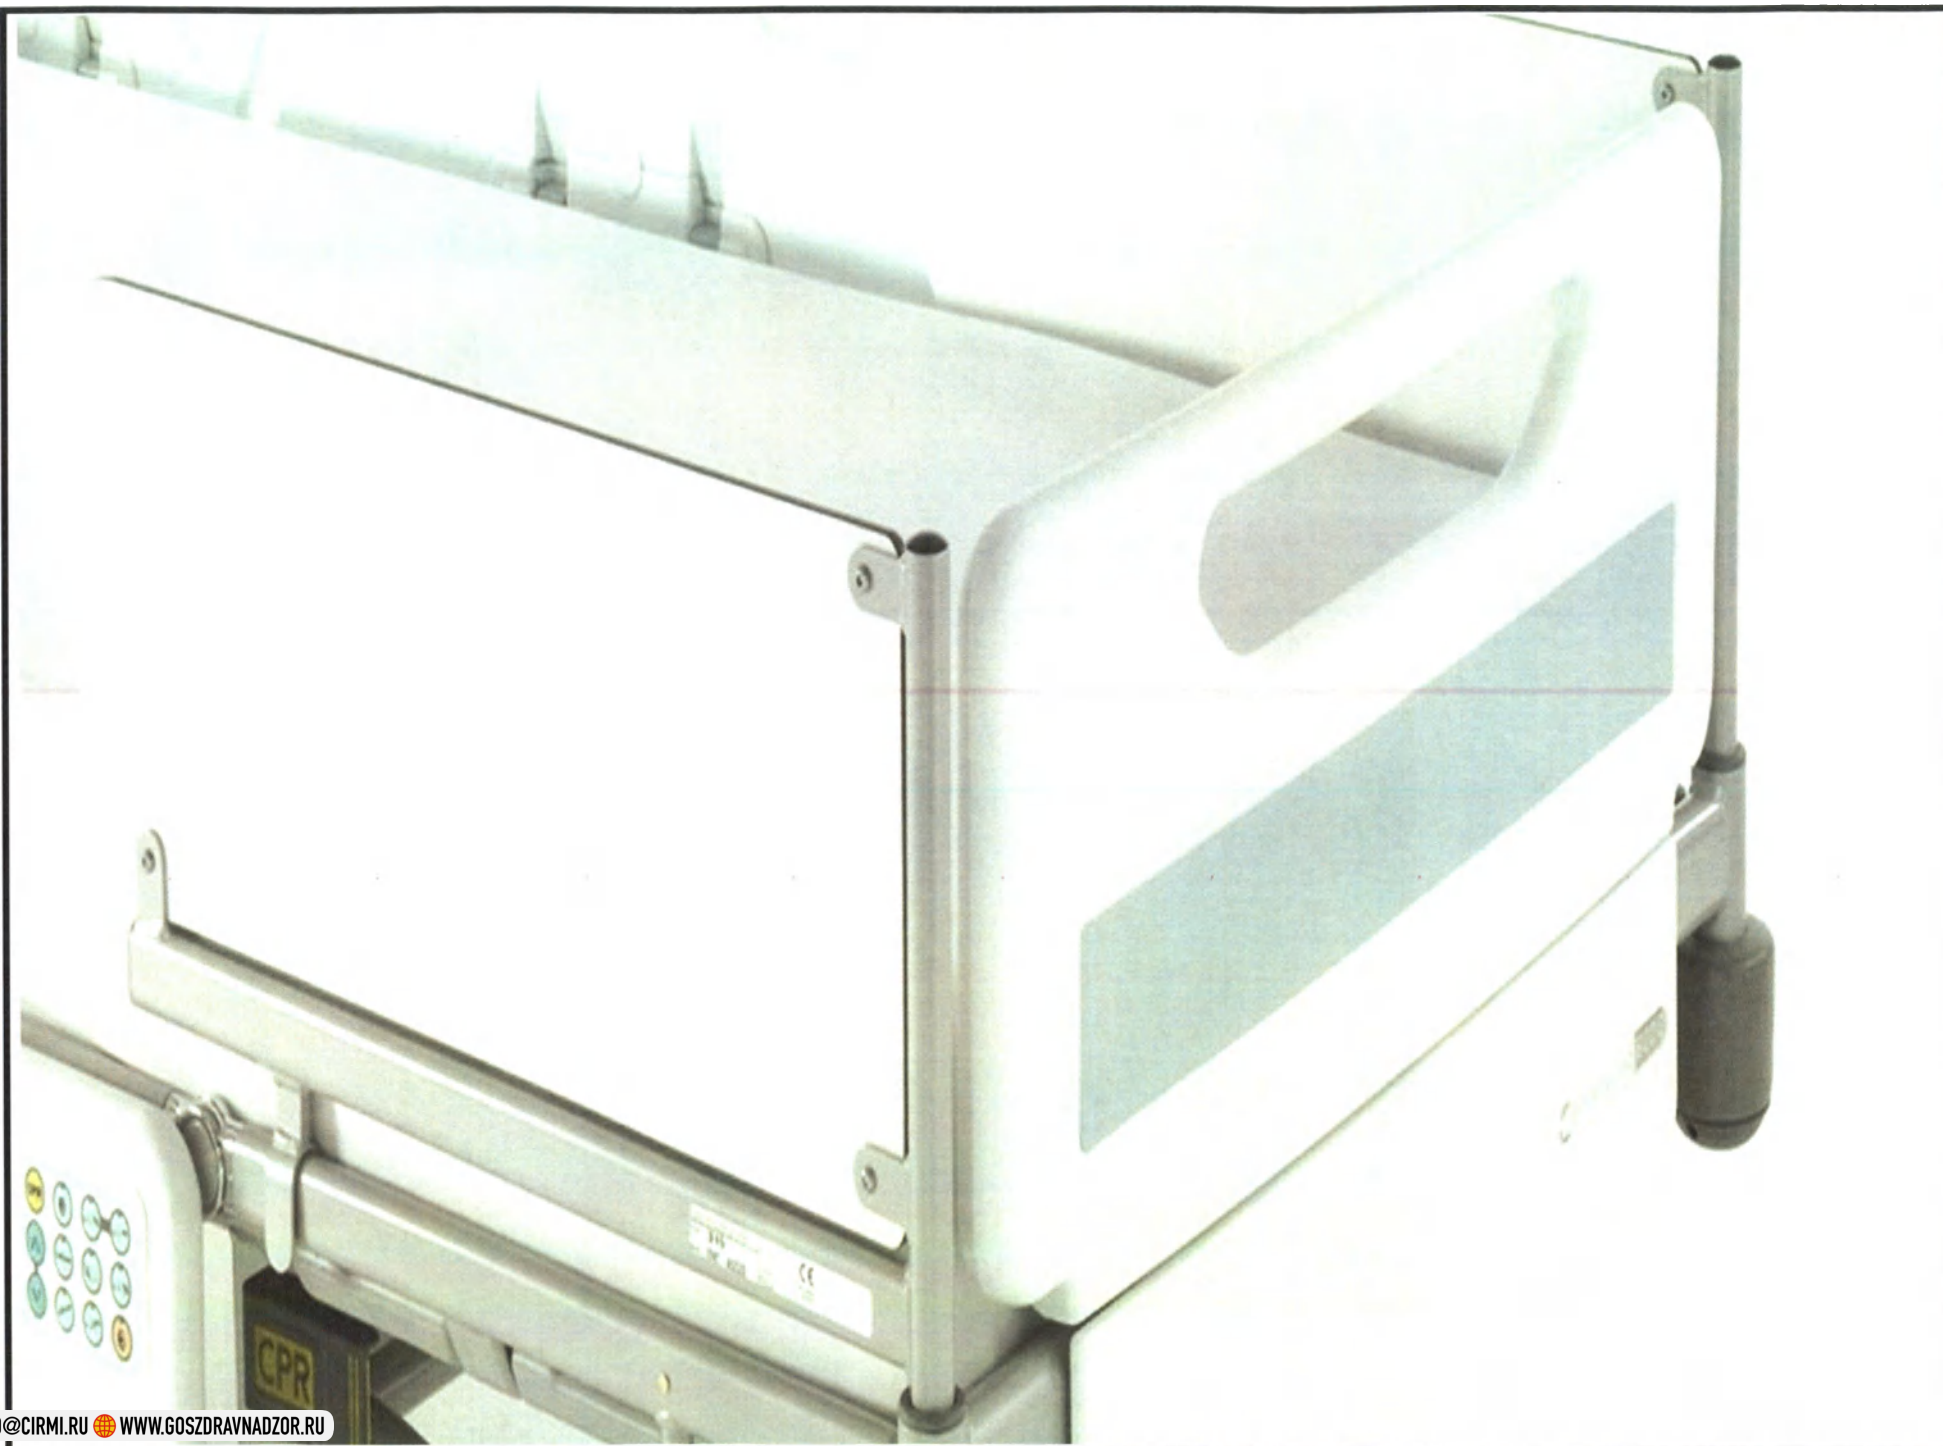

9. Панель для удлинения матрасной платформы.



10. Пульс управления кроватью.
- на гибком проводе для пациента;




- на гибком проводе для пациента дополнительный (не более 2 шт.);



- на гибком проводе для медицинского персонала (не более 2 шт.);



- интегрированный в боковые ограждения (не более 8 шт.);

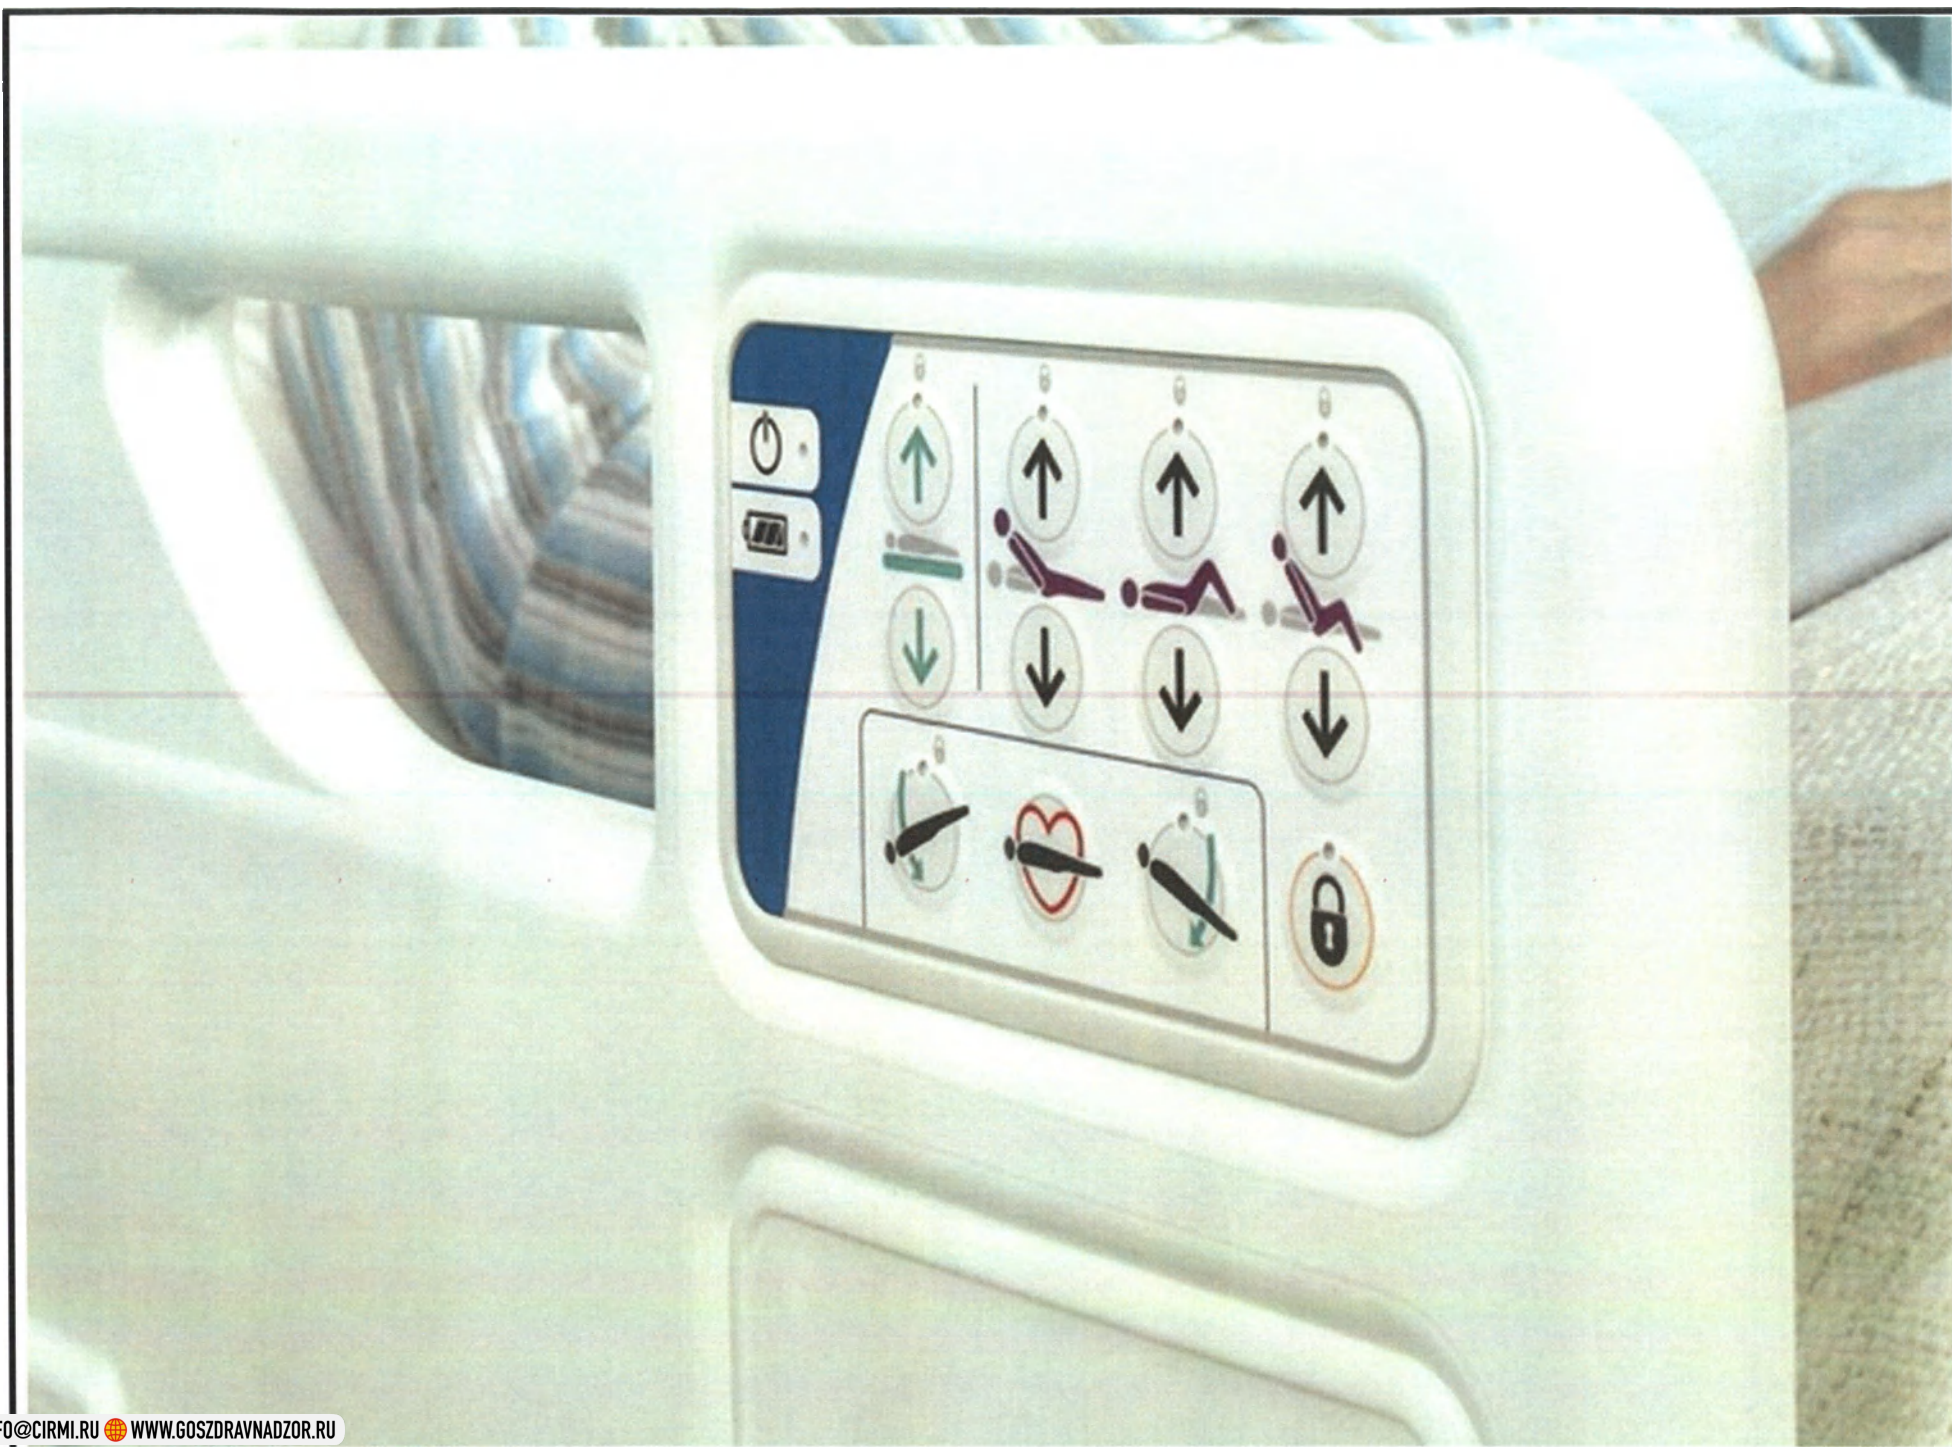

- ножная педаль для регулировки высоты кровати (не более 2 шт.).




11. Полка для монитора и/или диагностического оборудования складная.




- опора одиночная регулируемая – 1 шт.;




- опора раздвижная – 1 шт.;

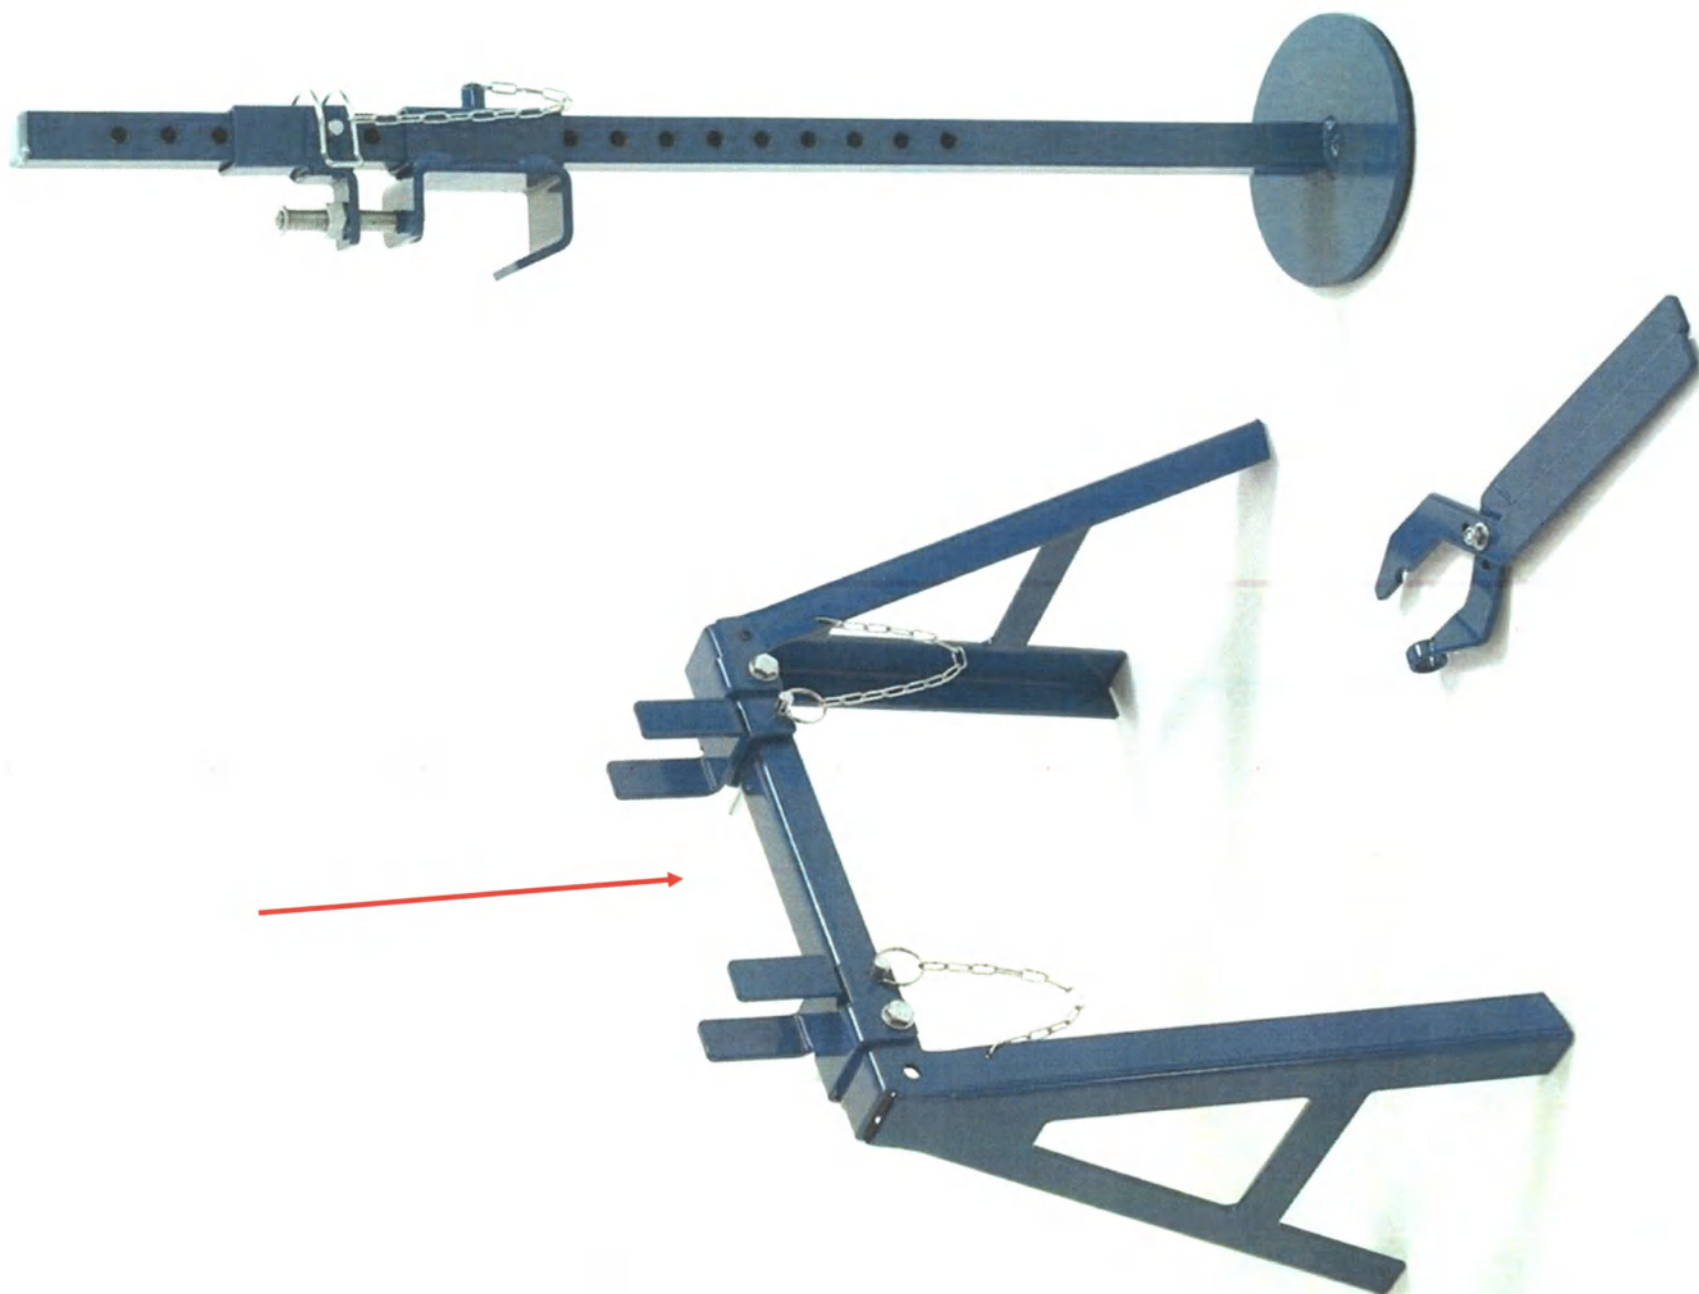

- приспособление-съёмник типа «клещи» - 1 шт.;

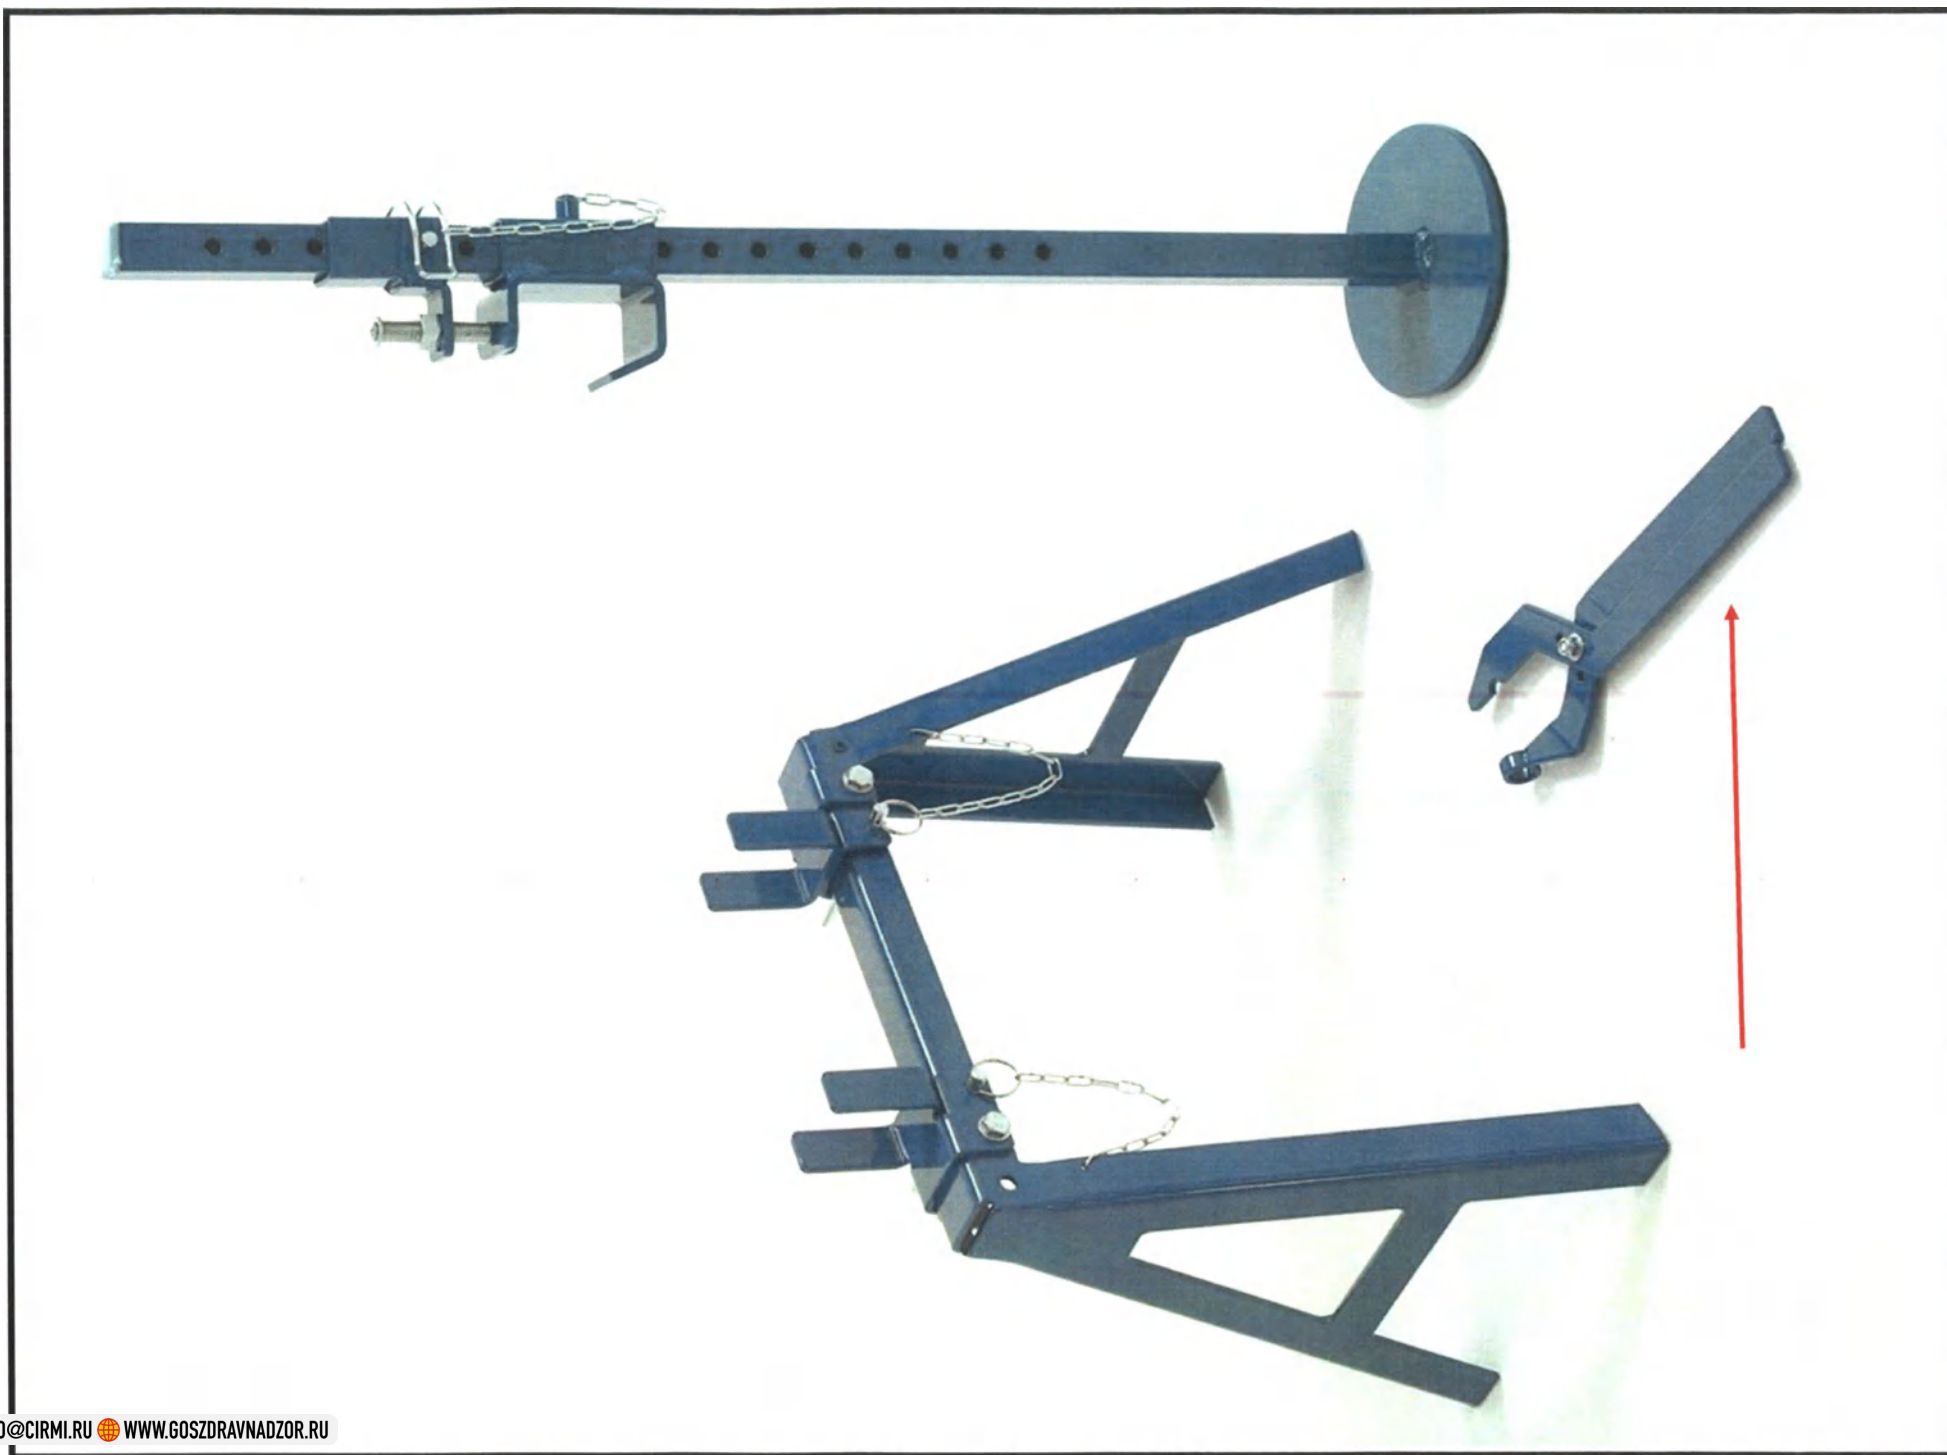

- комплект для сервисного обслуживания (не более 2 компл.), в составе:
- ключ трубчатый – 1 шт.

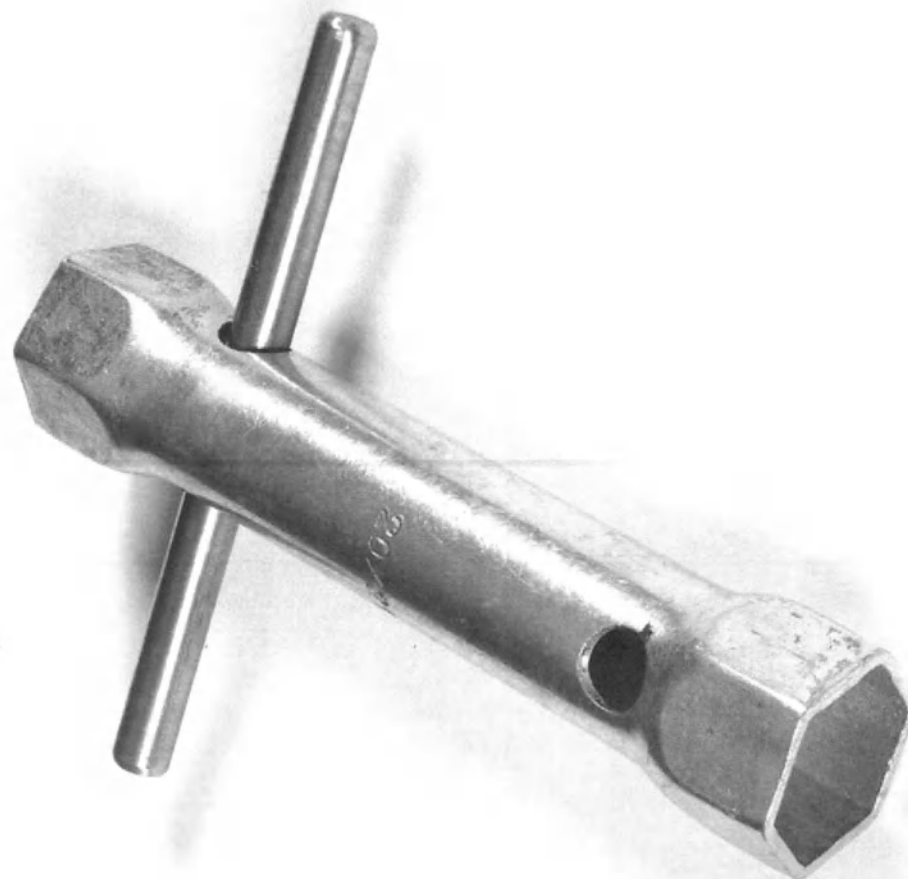


13. Держатель кассеты для рентгеновских исследований (не более 2 шт.).




14. Рукоятка для позиционирования кассеты для рентгеновских исследований.




15. Крючки для инфузионных стоек дополнительные (не более 10 шт.).

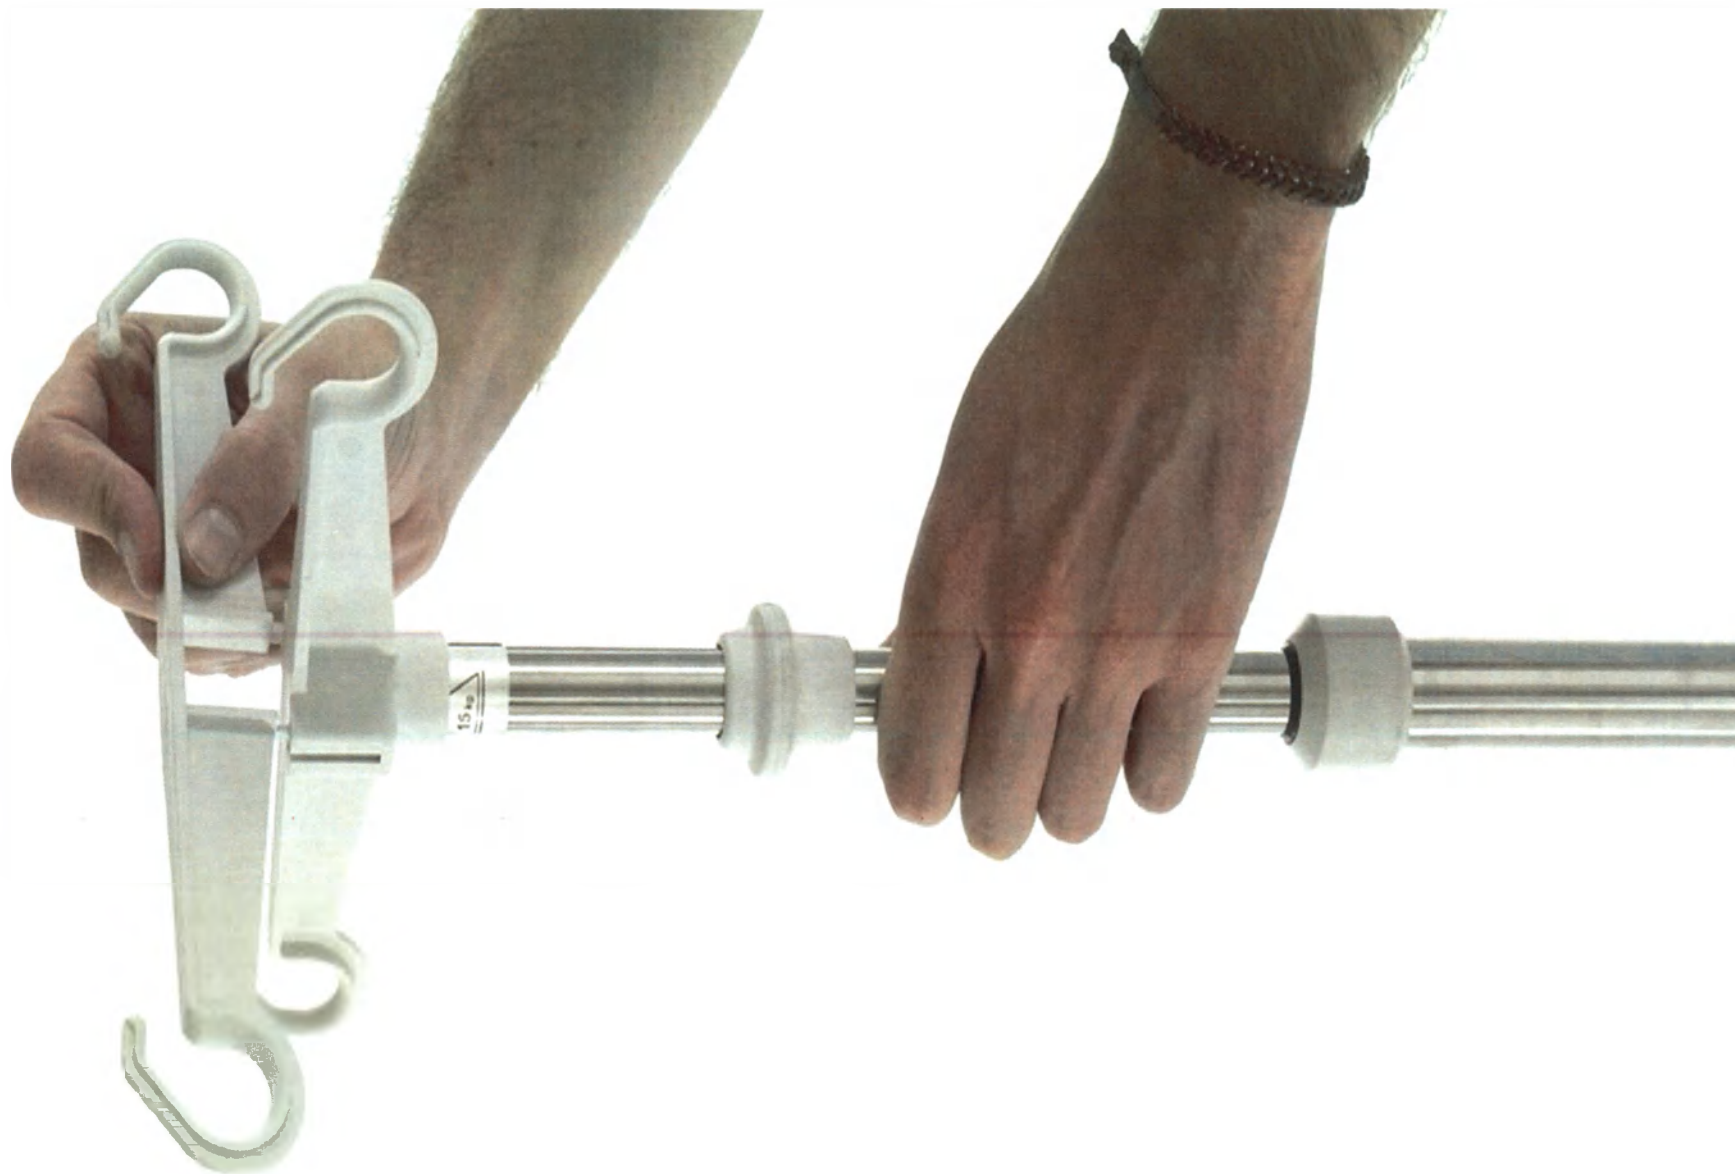

16. Стойка для датчика (не более 4 шт.).

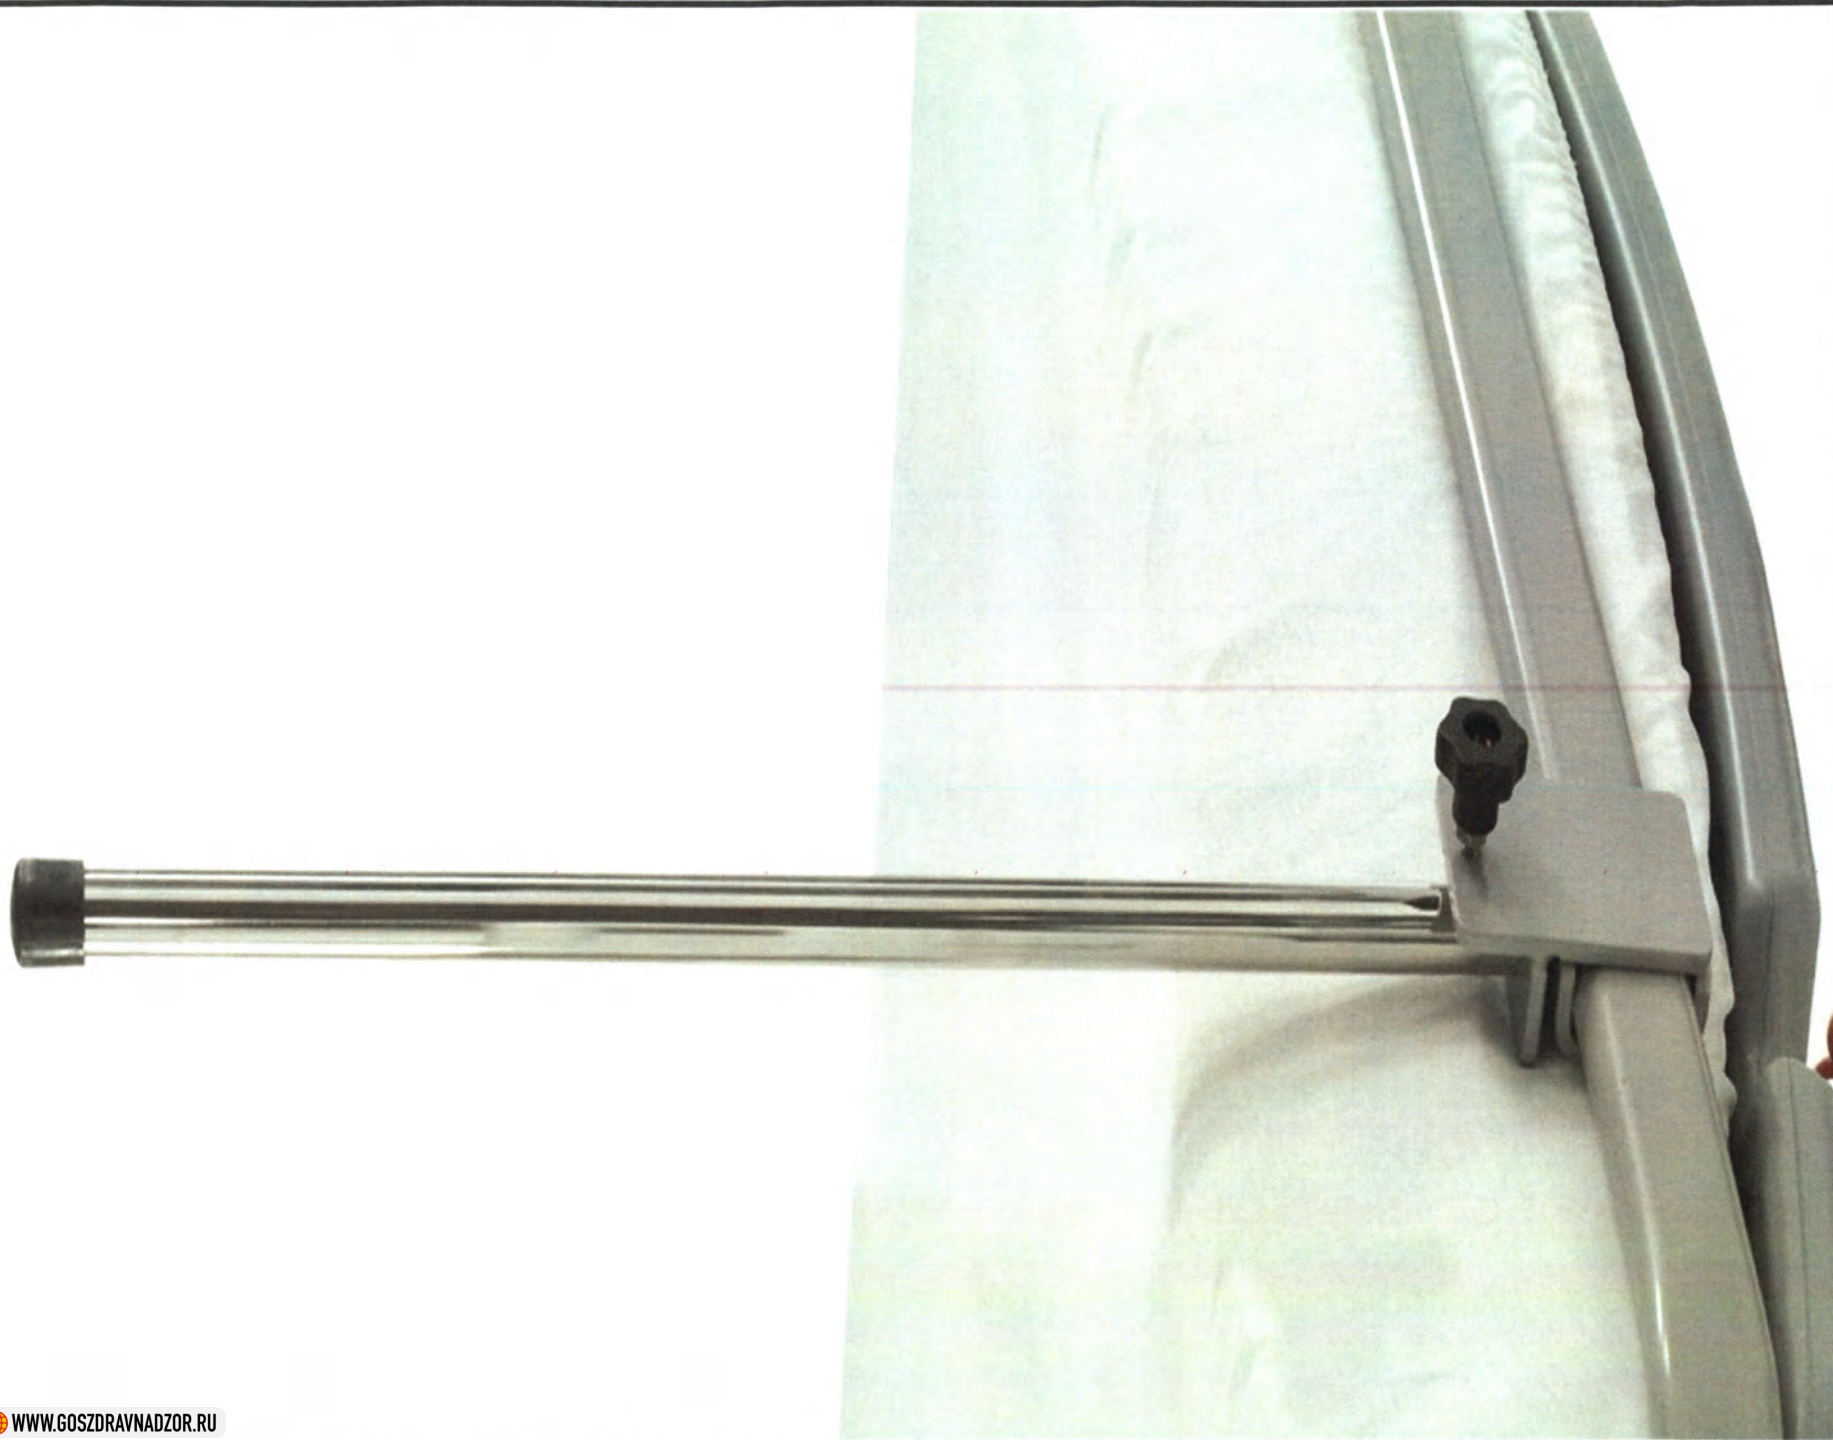


17. Рельсы для дренажного мешка (не более 2 шт.).

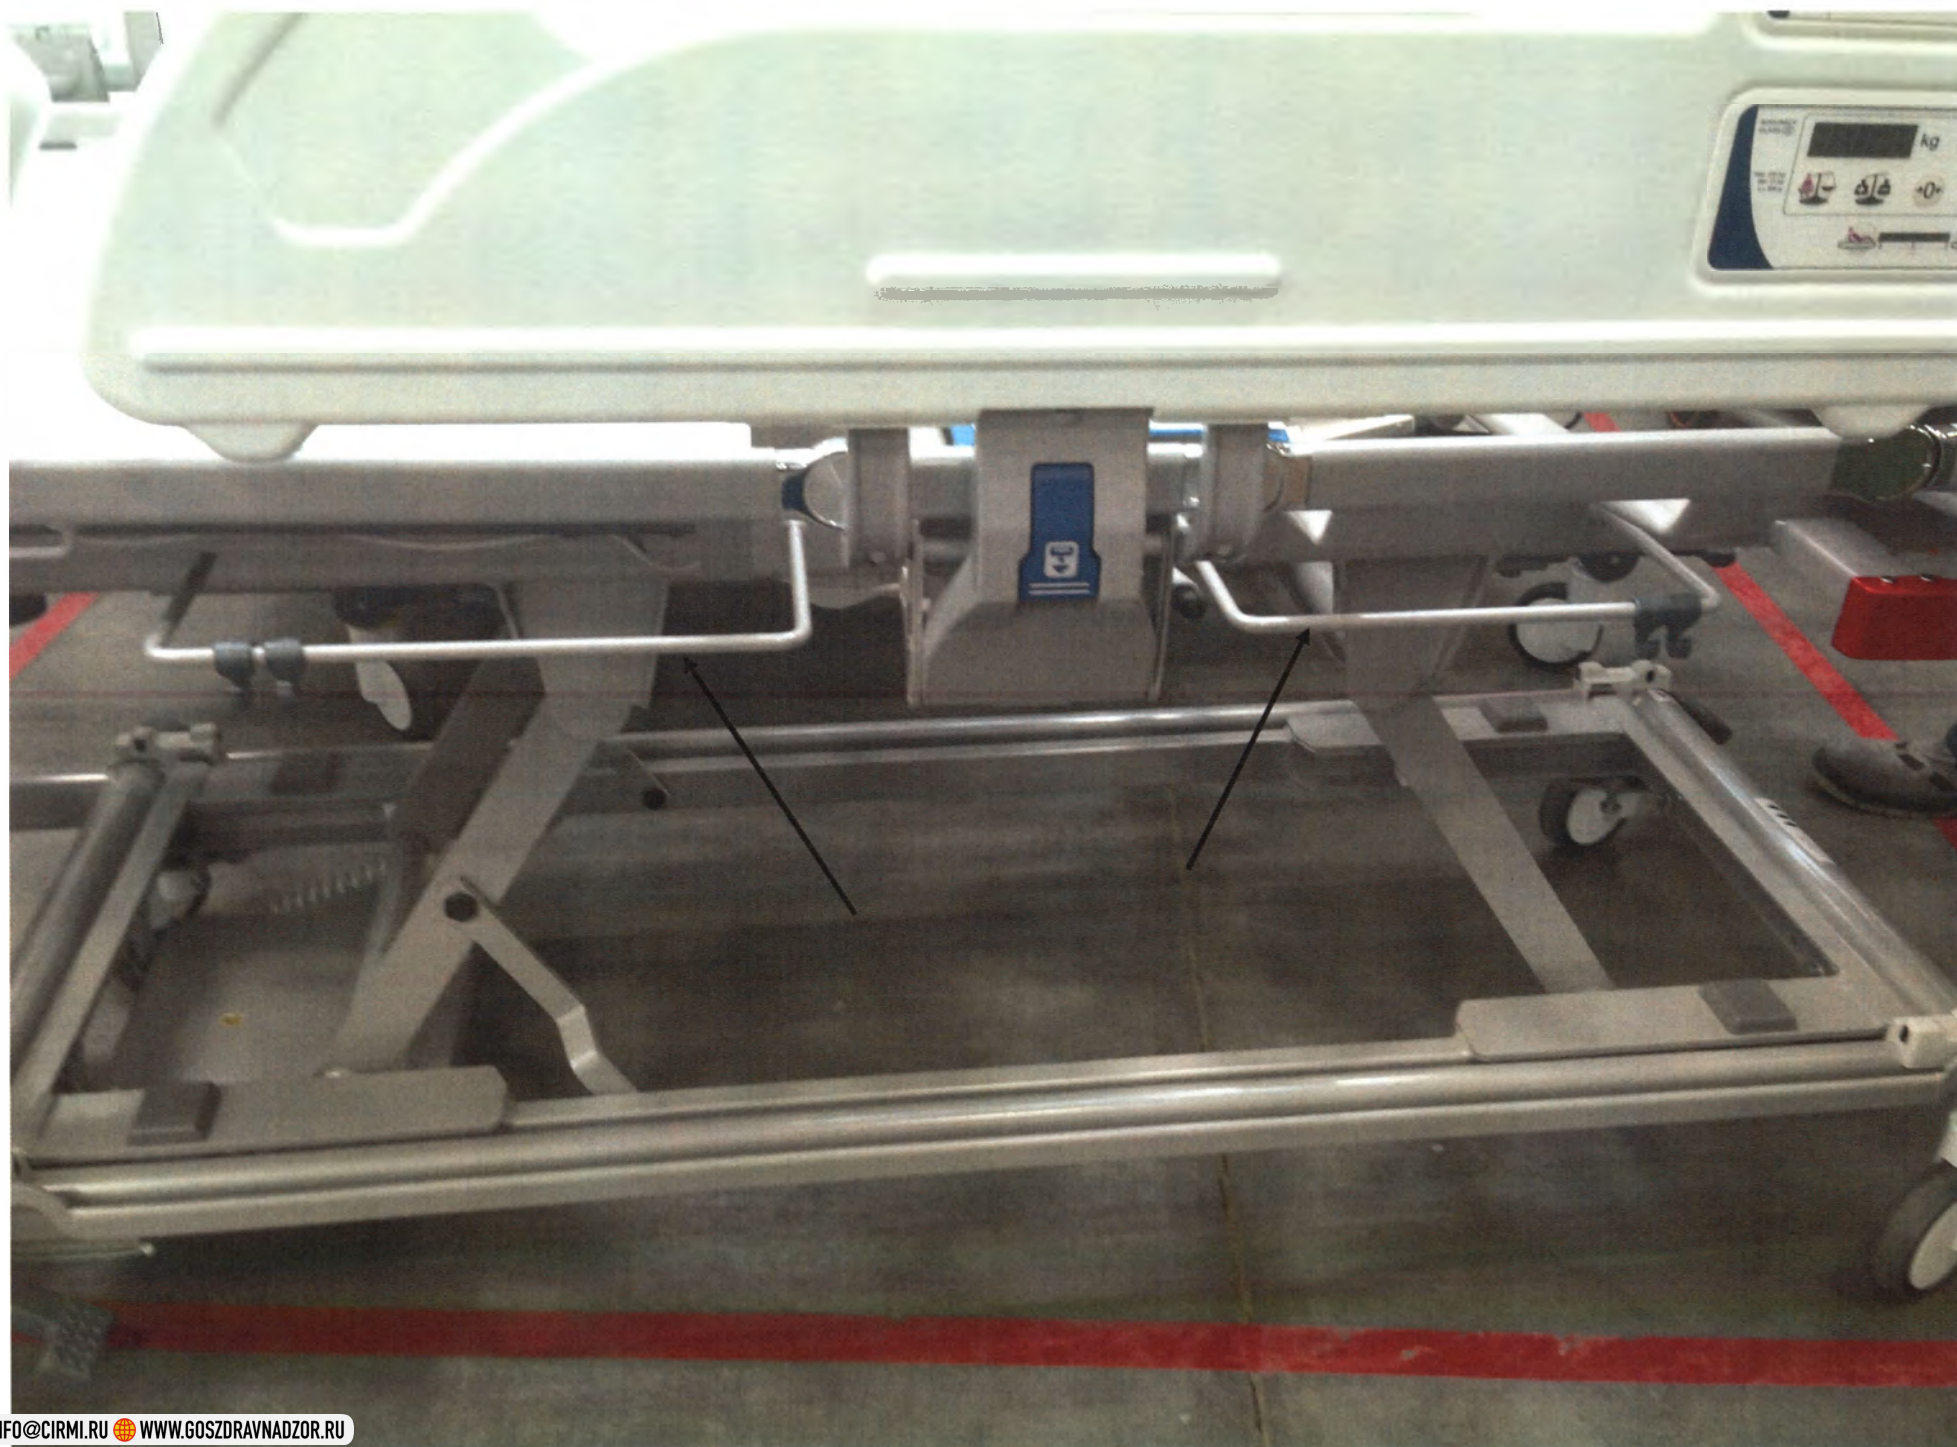

18. Рейка DIN для аксессуаров (не более 2 шт.).




19. Держатель пульта управления (не более 2 шт.).

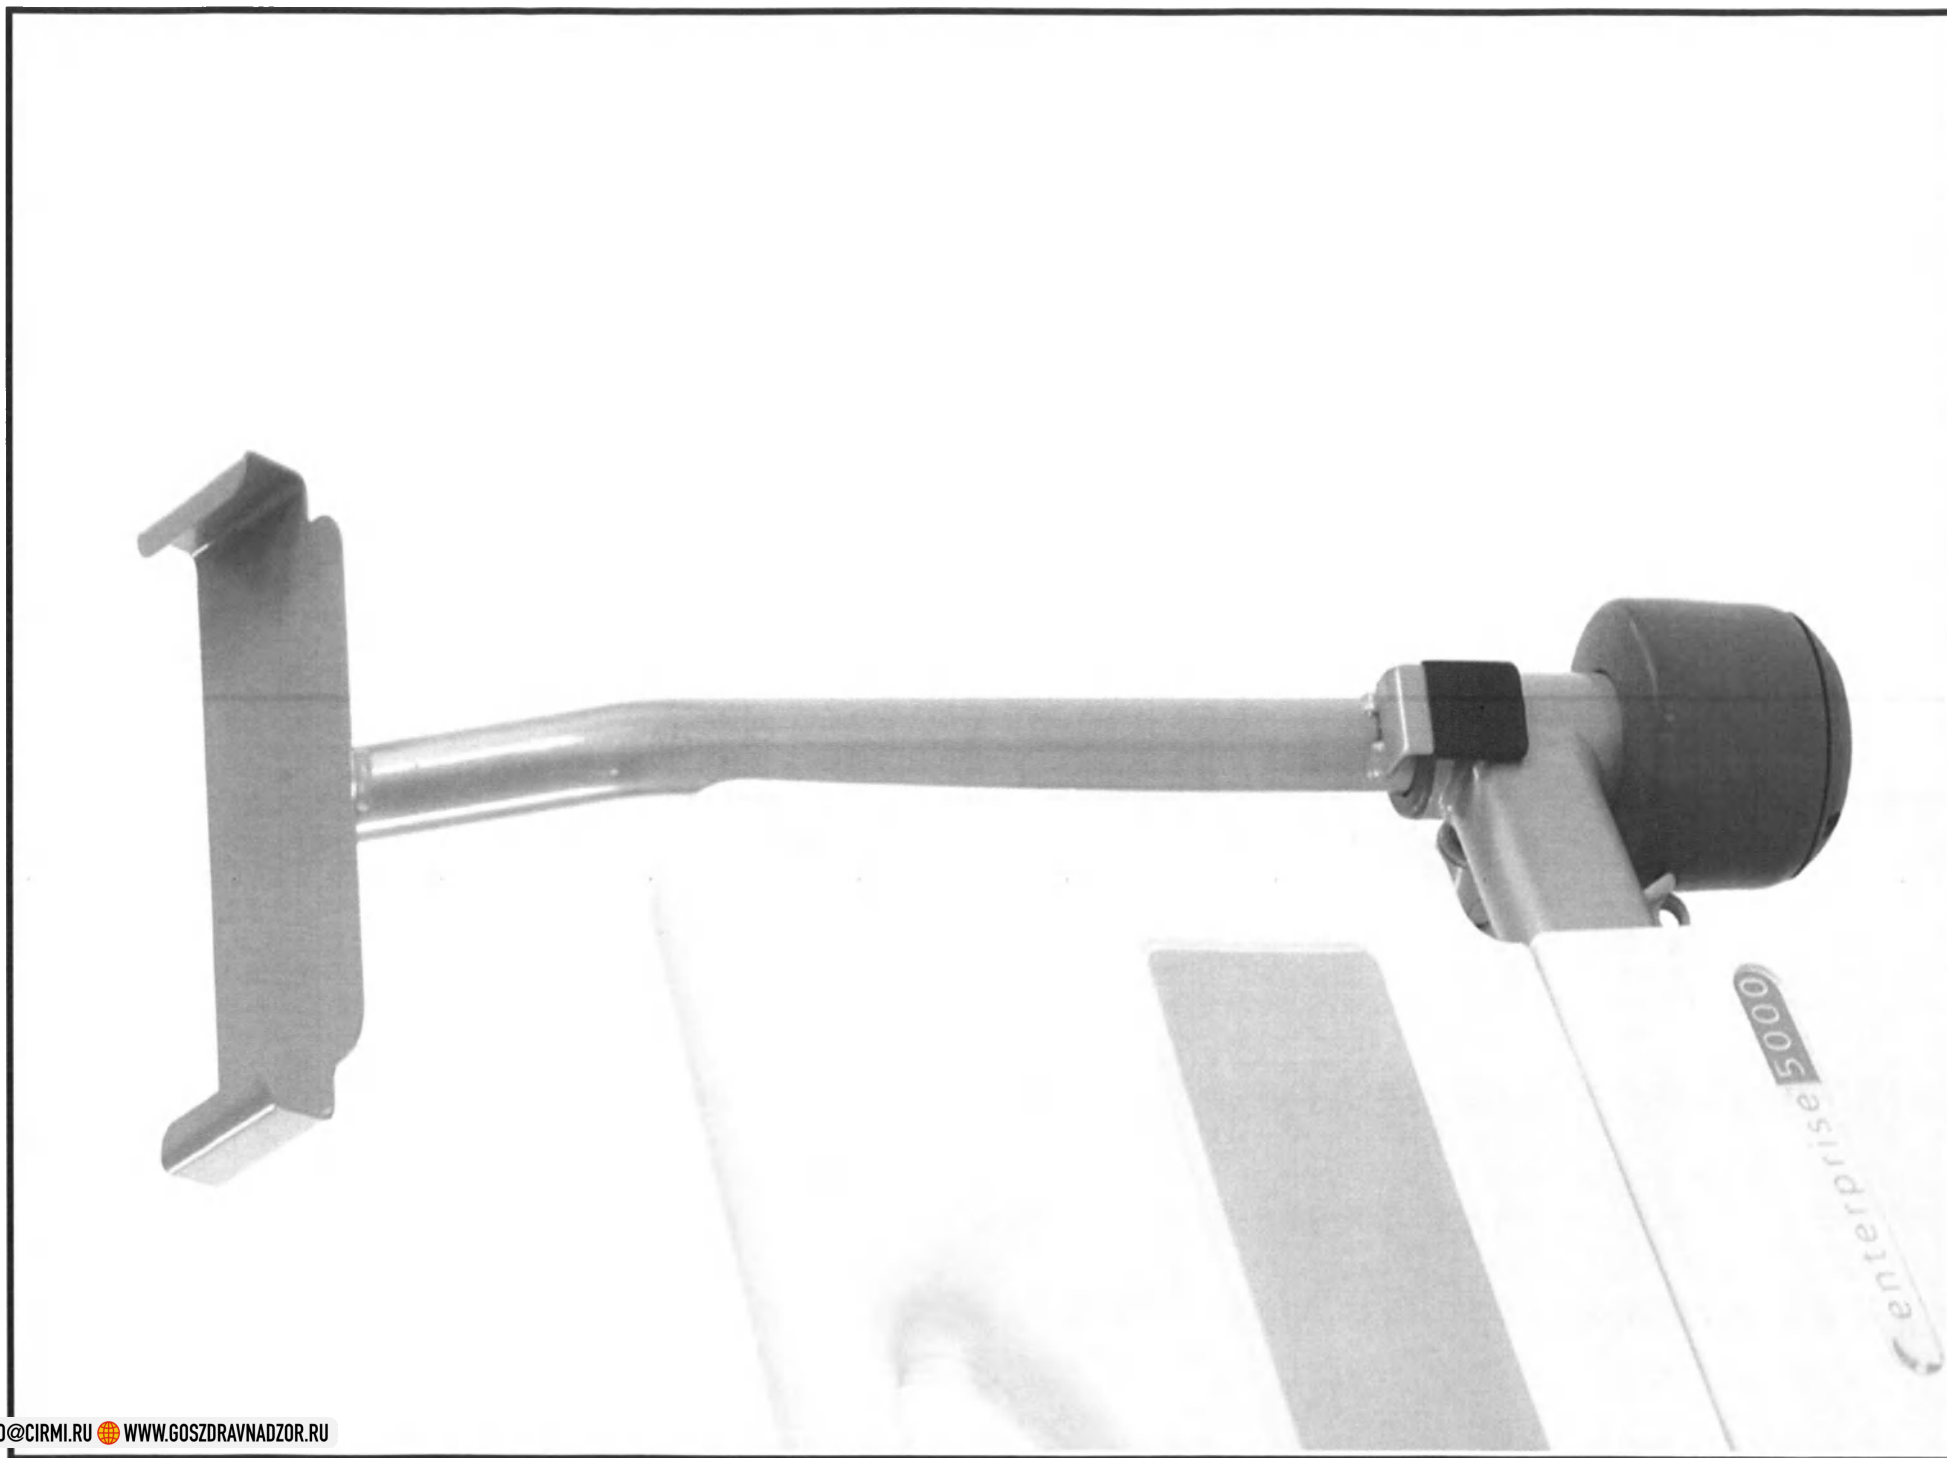


20. Кабель сетевой.



21. Крючок для кабеля сетевого (не более 2 шт.).

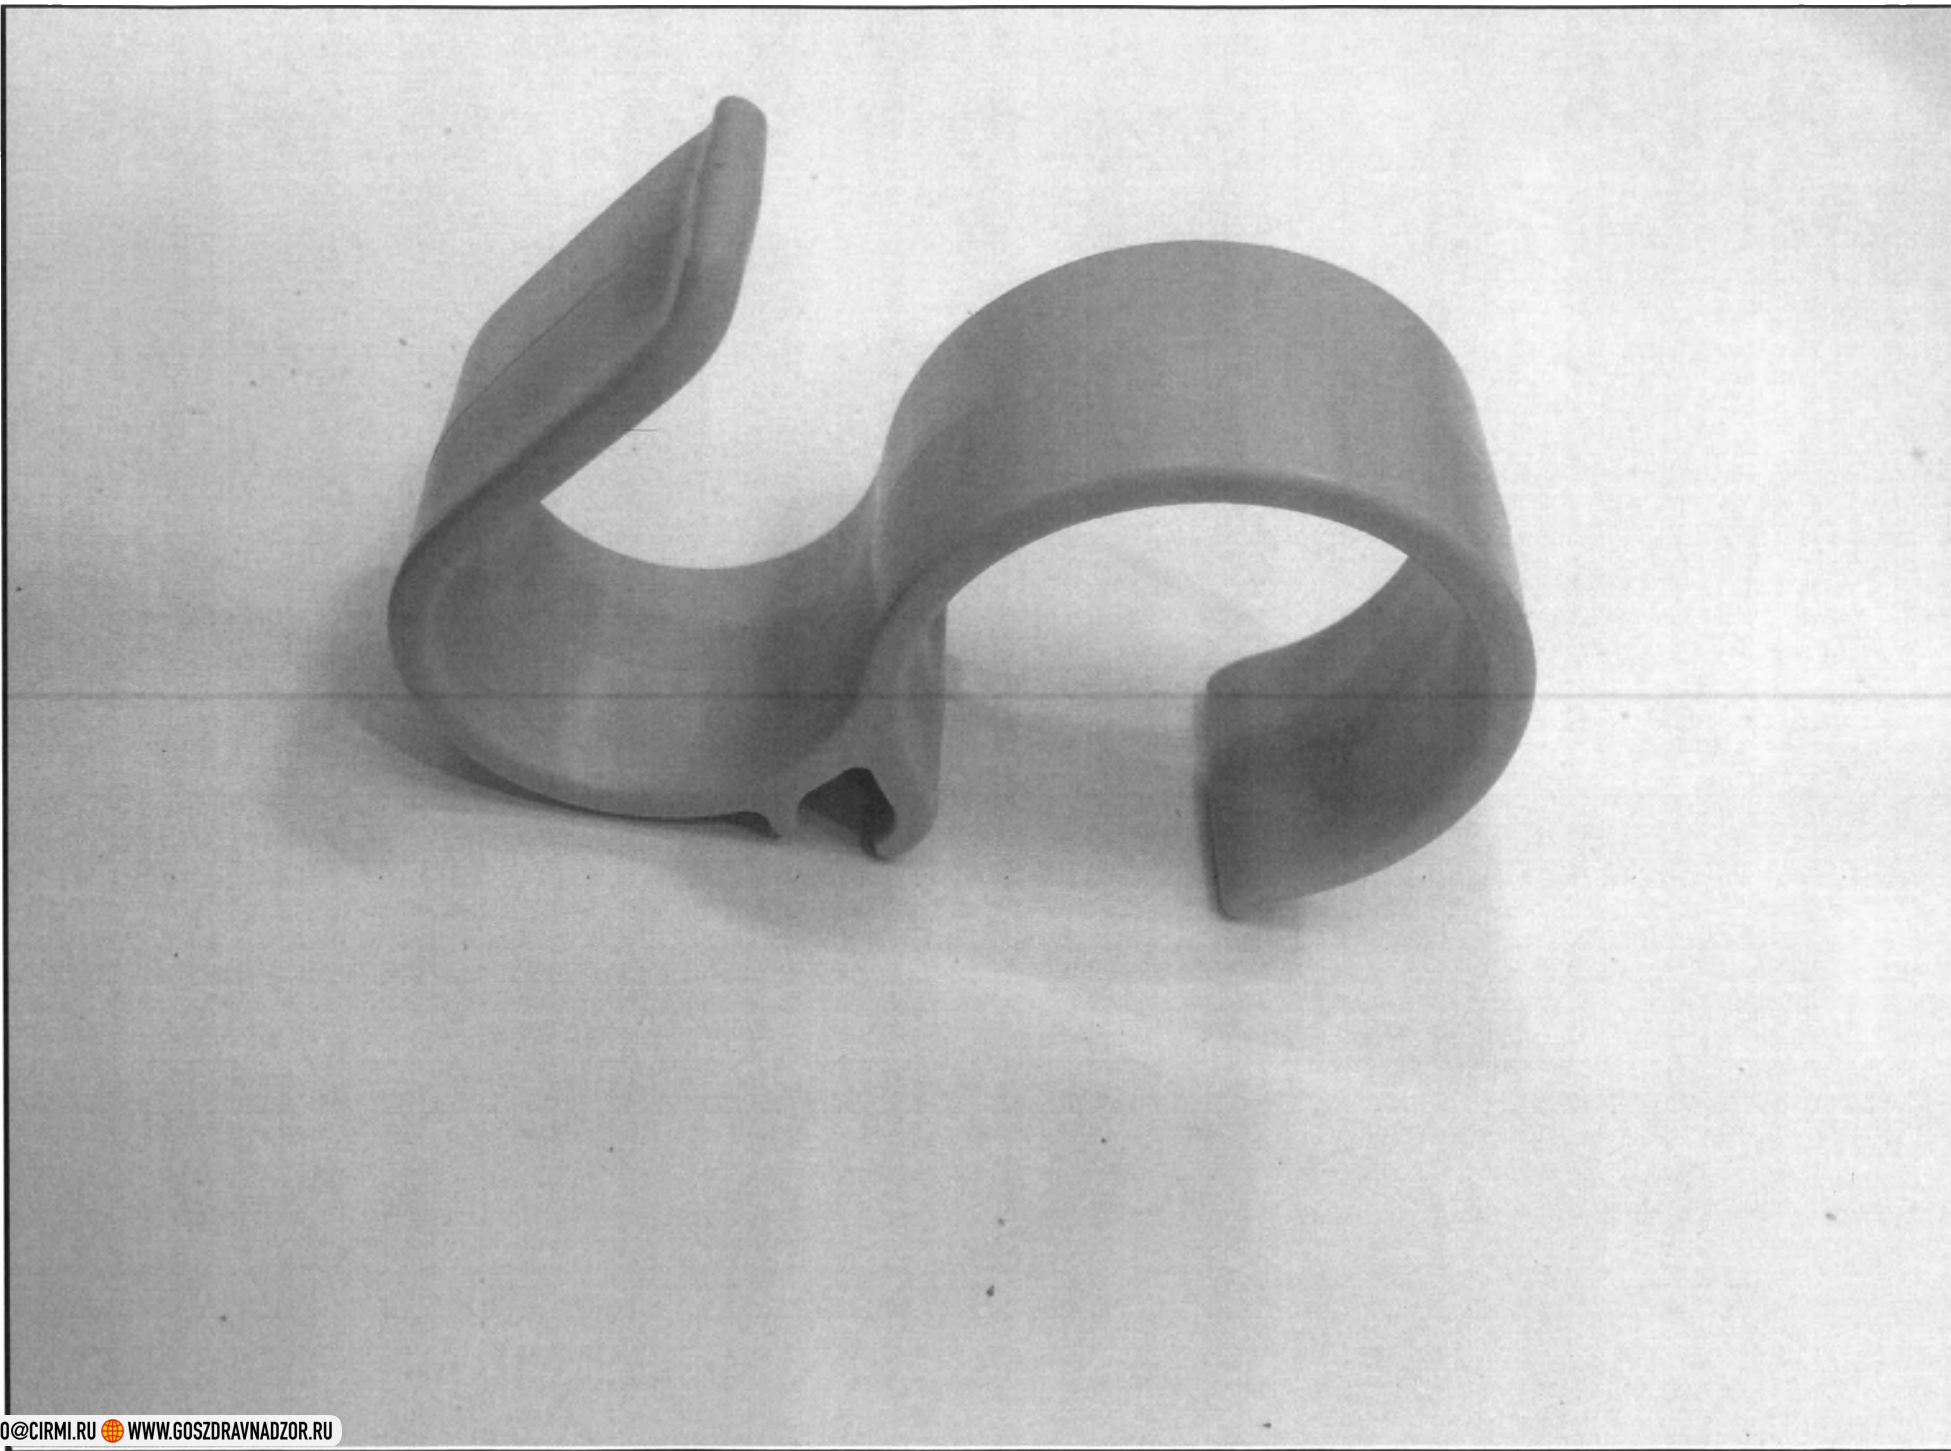


22. Кожух для розетки.

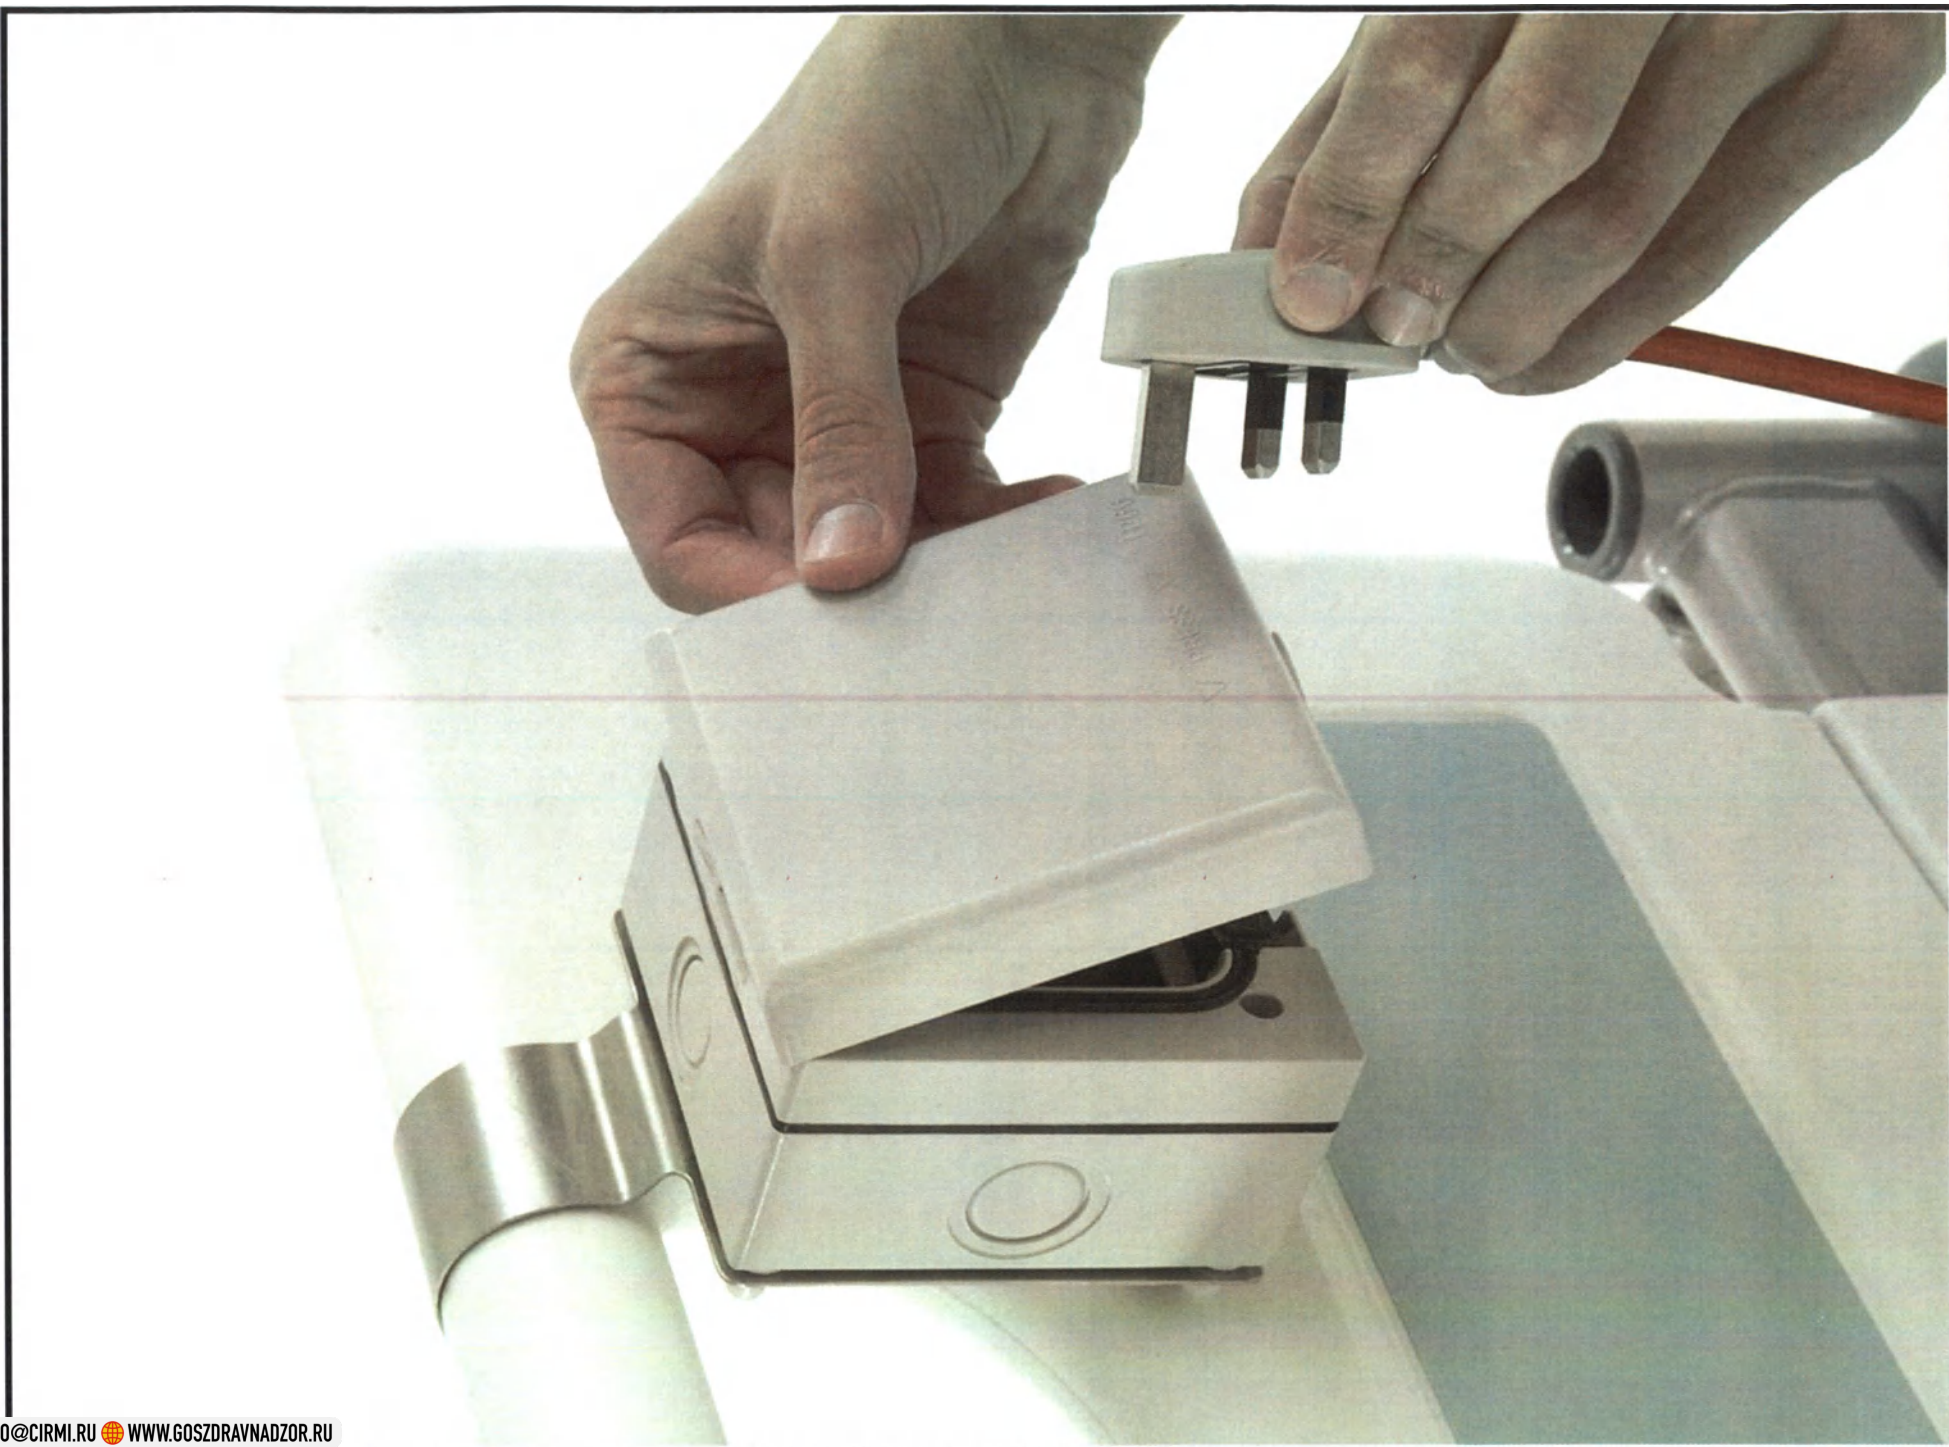


23. Спинка кровати открытая (рукоятки) для отделения реанимации и интенсивной терапии (не более 2 шт.).



24. Рукоятка для перемещения кровати (не более 2 шт.).

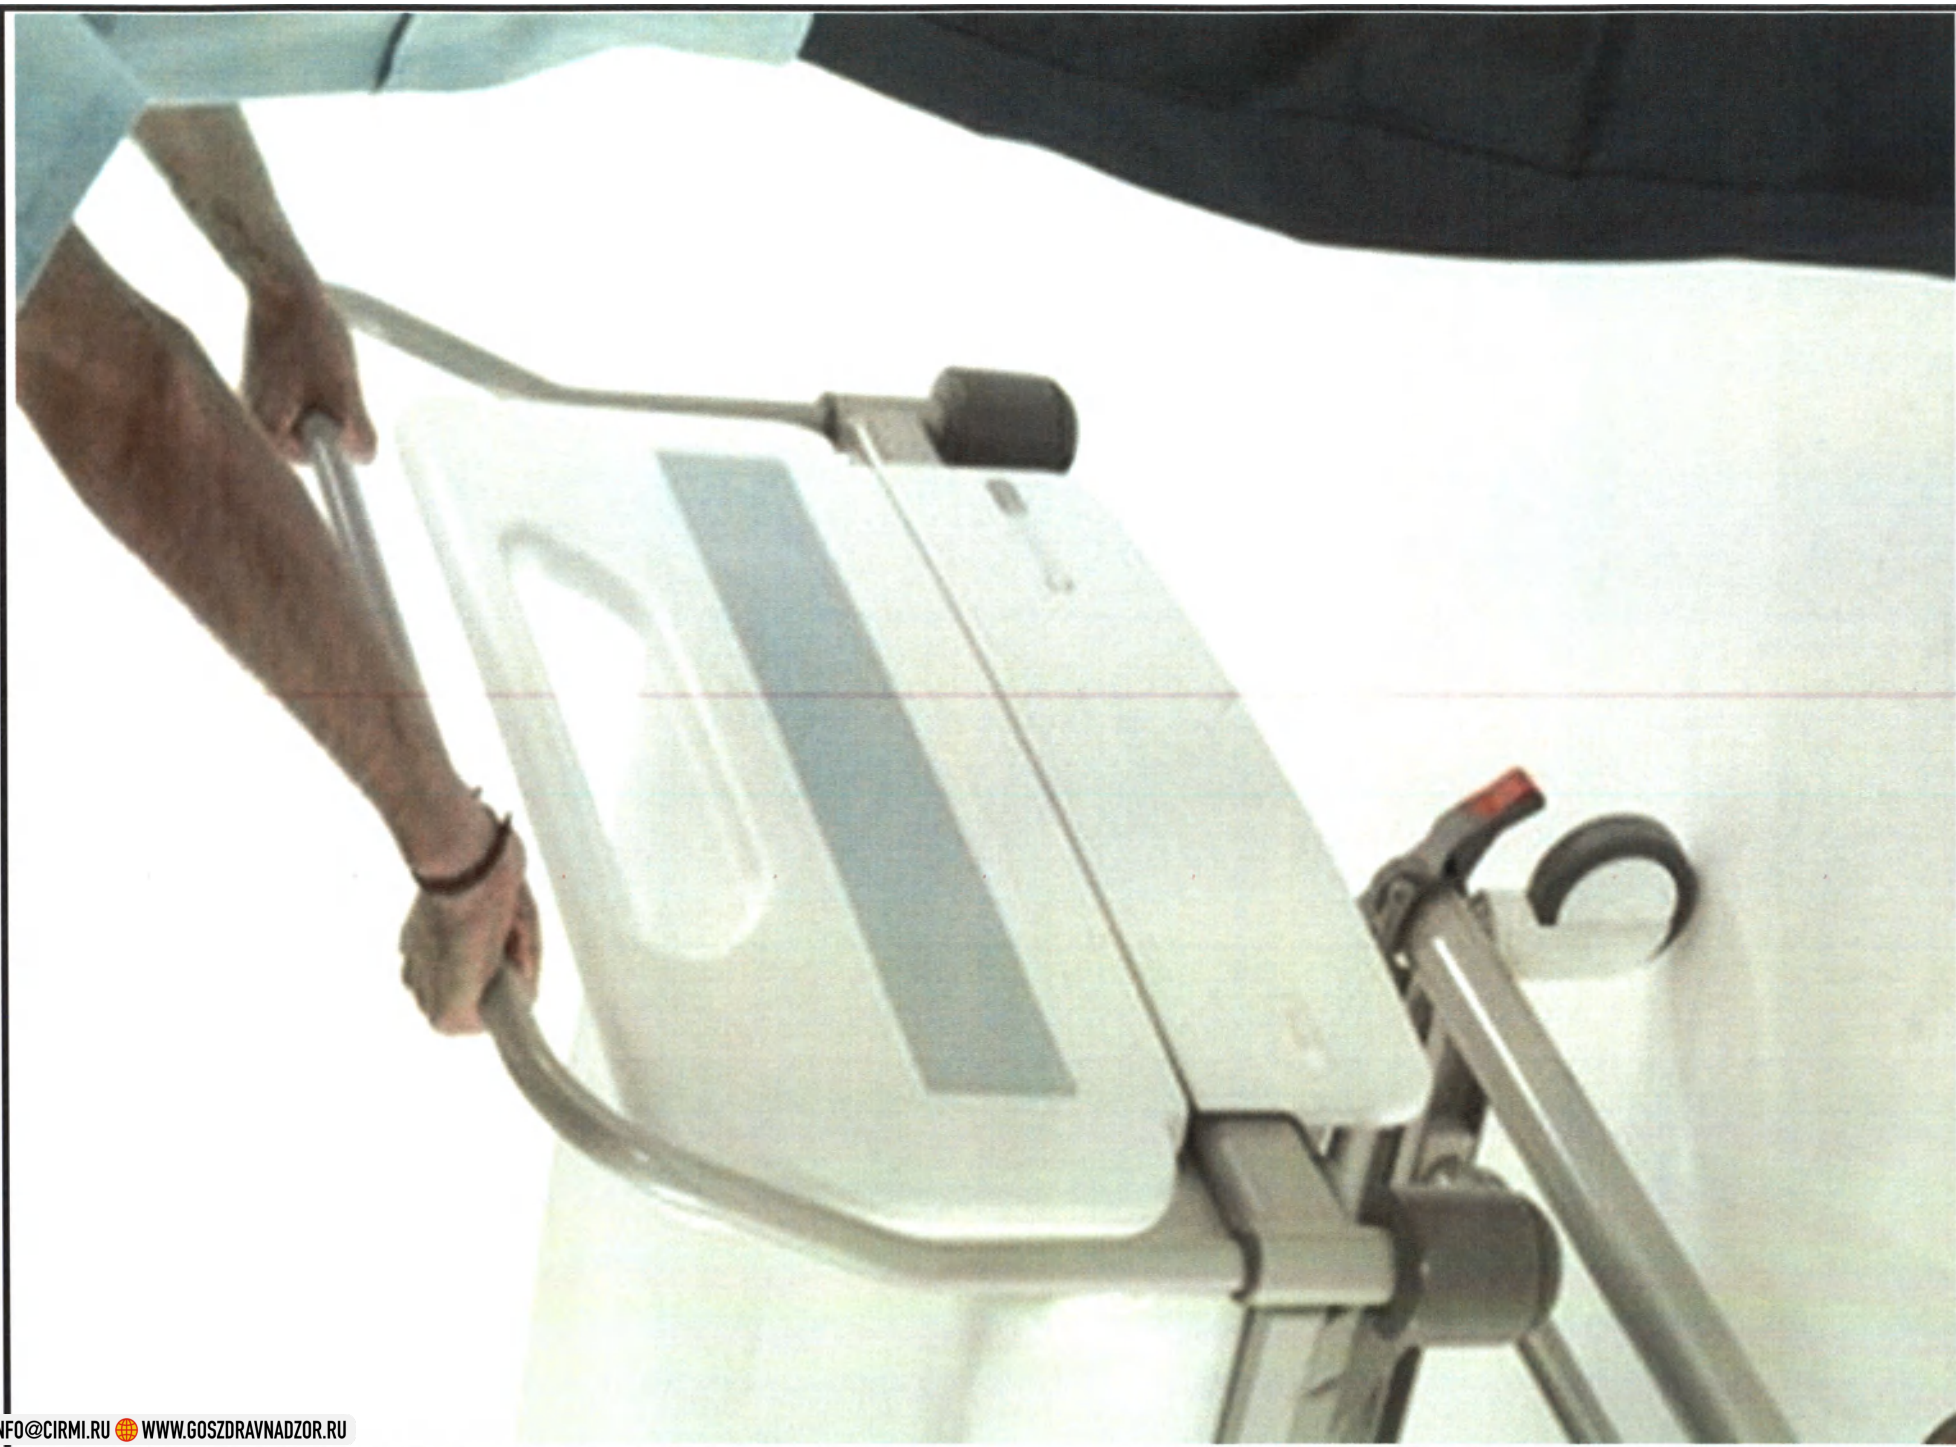


25. Полка для белья.

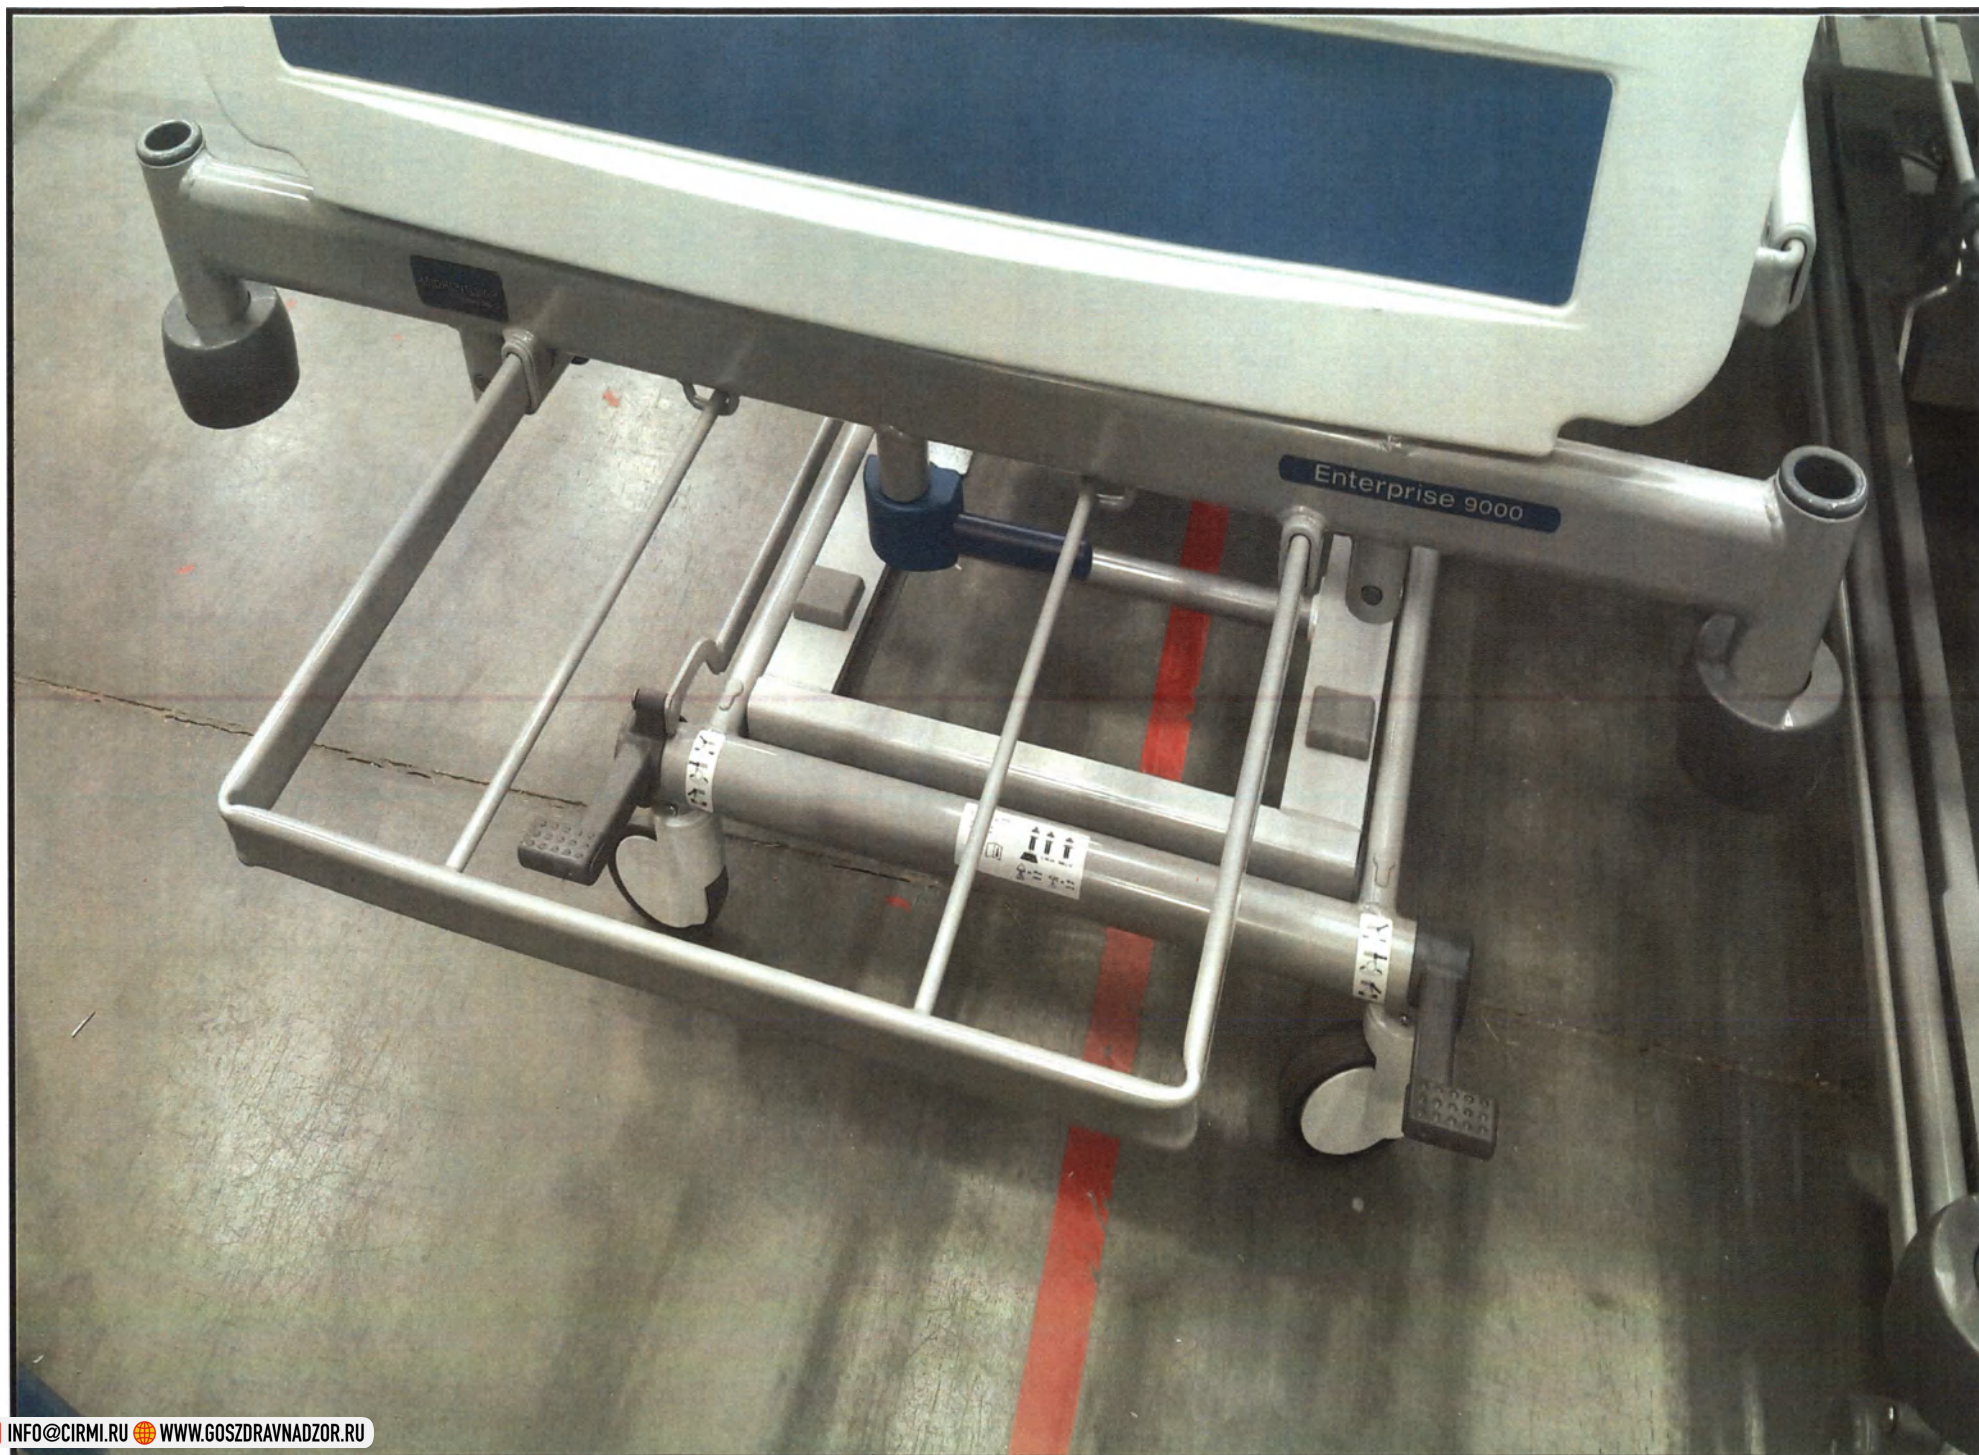

- 125 мм;





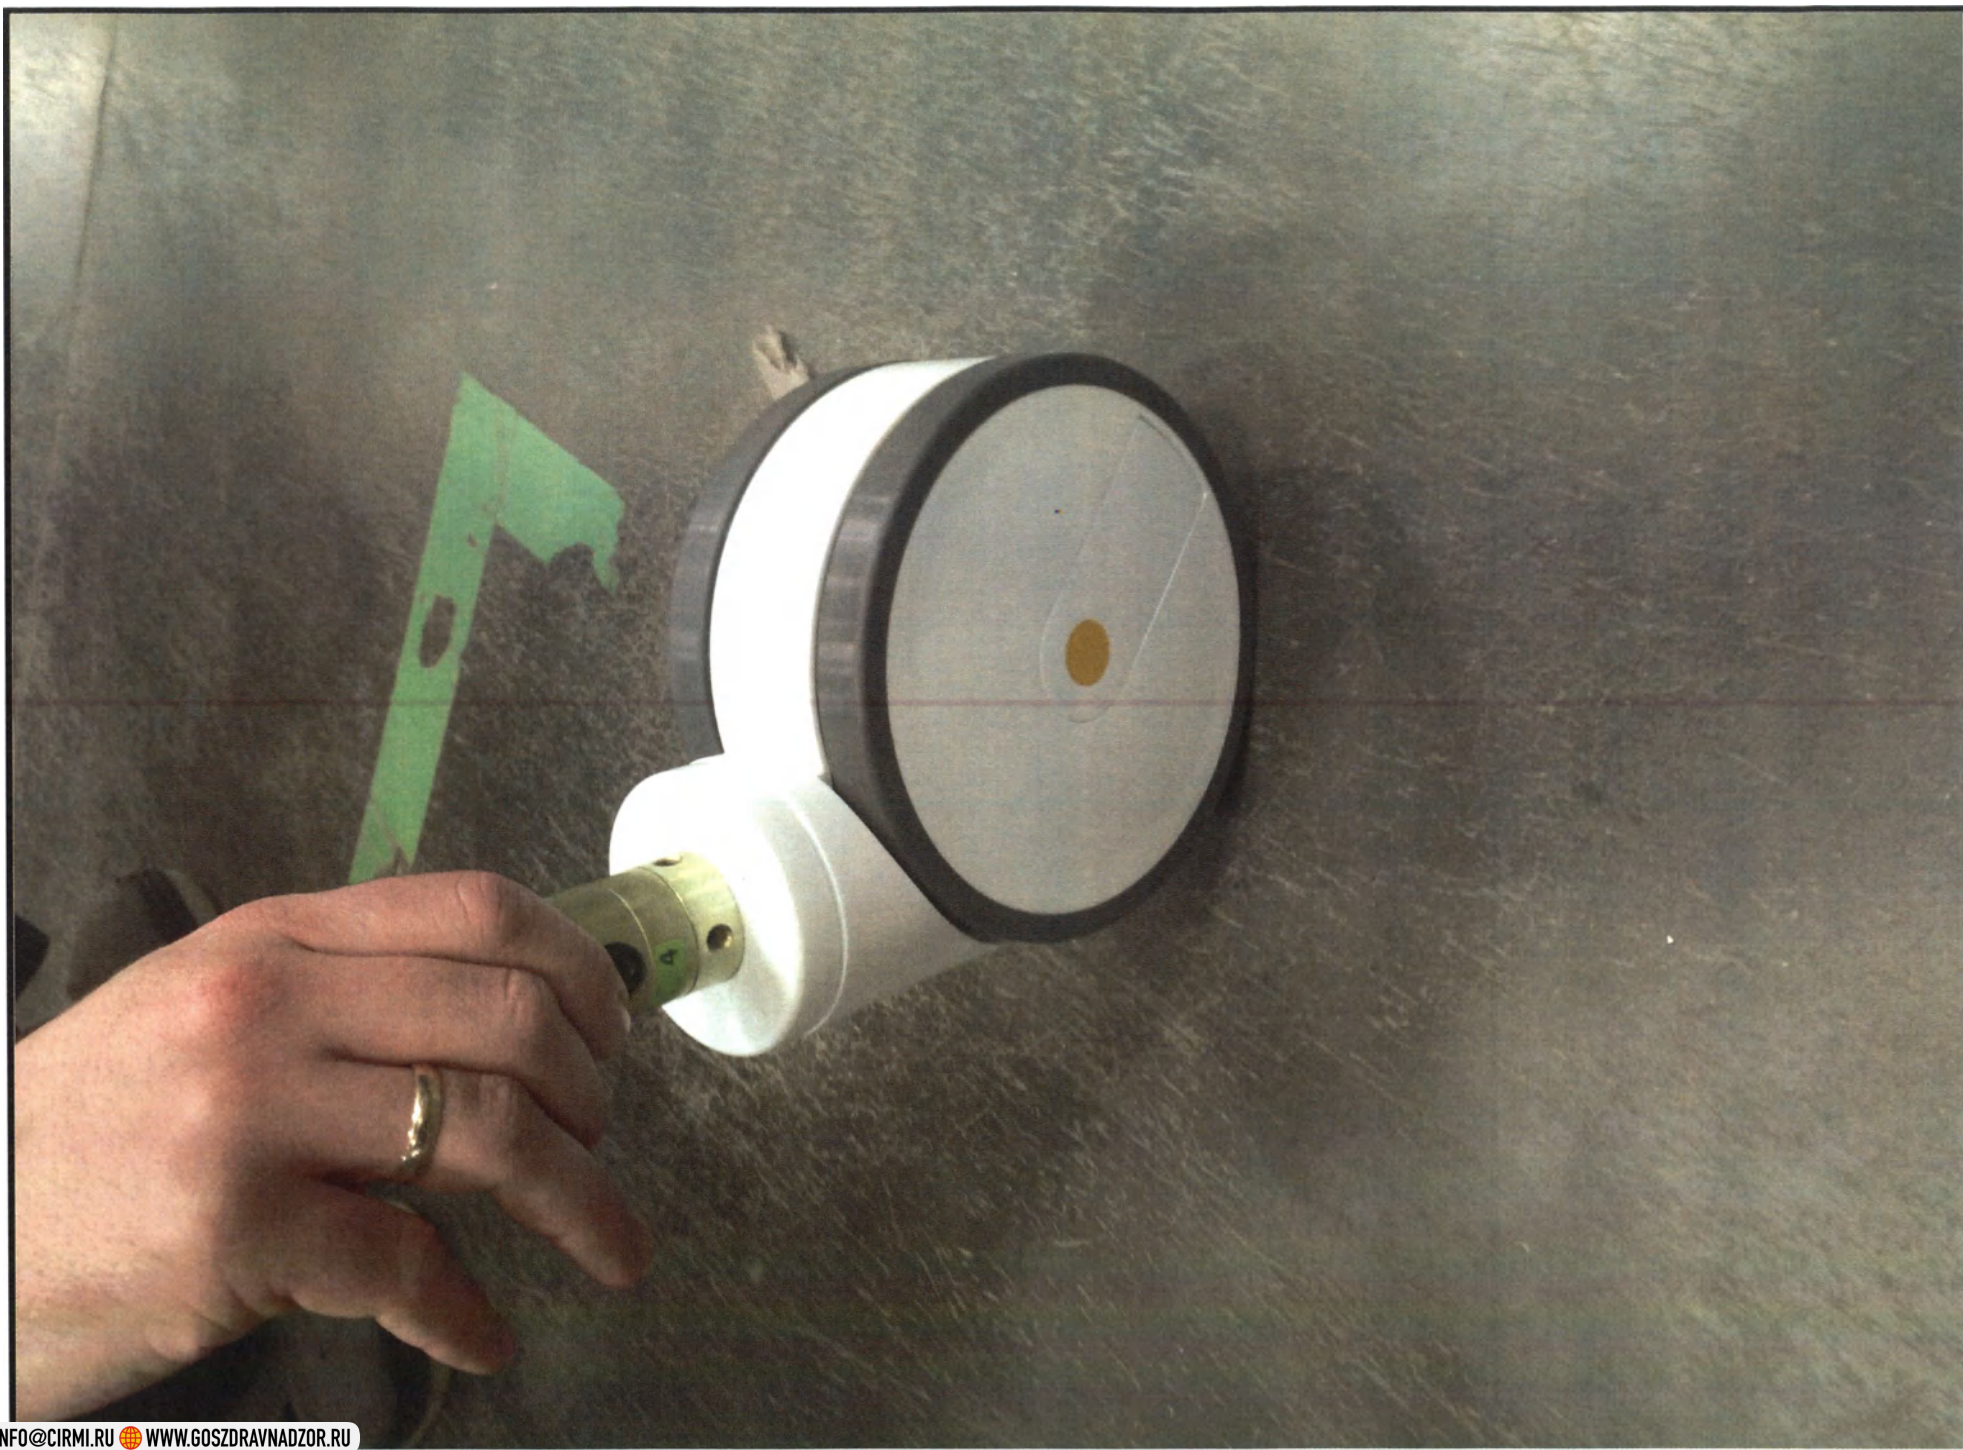

27. Штанга тормозная на полную ширину.



28. Педаль тормозная для ножной секции (не более 2 шт.).




28. Педаль тормозная для ножной секции (не более 2 шт.).




29. Педаль тормозная для головной секции дополнительная (не более 2 шт.).



30. Лампа для подкроватной подсветки специальная (не более 4 шт.).

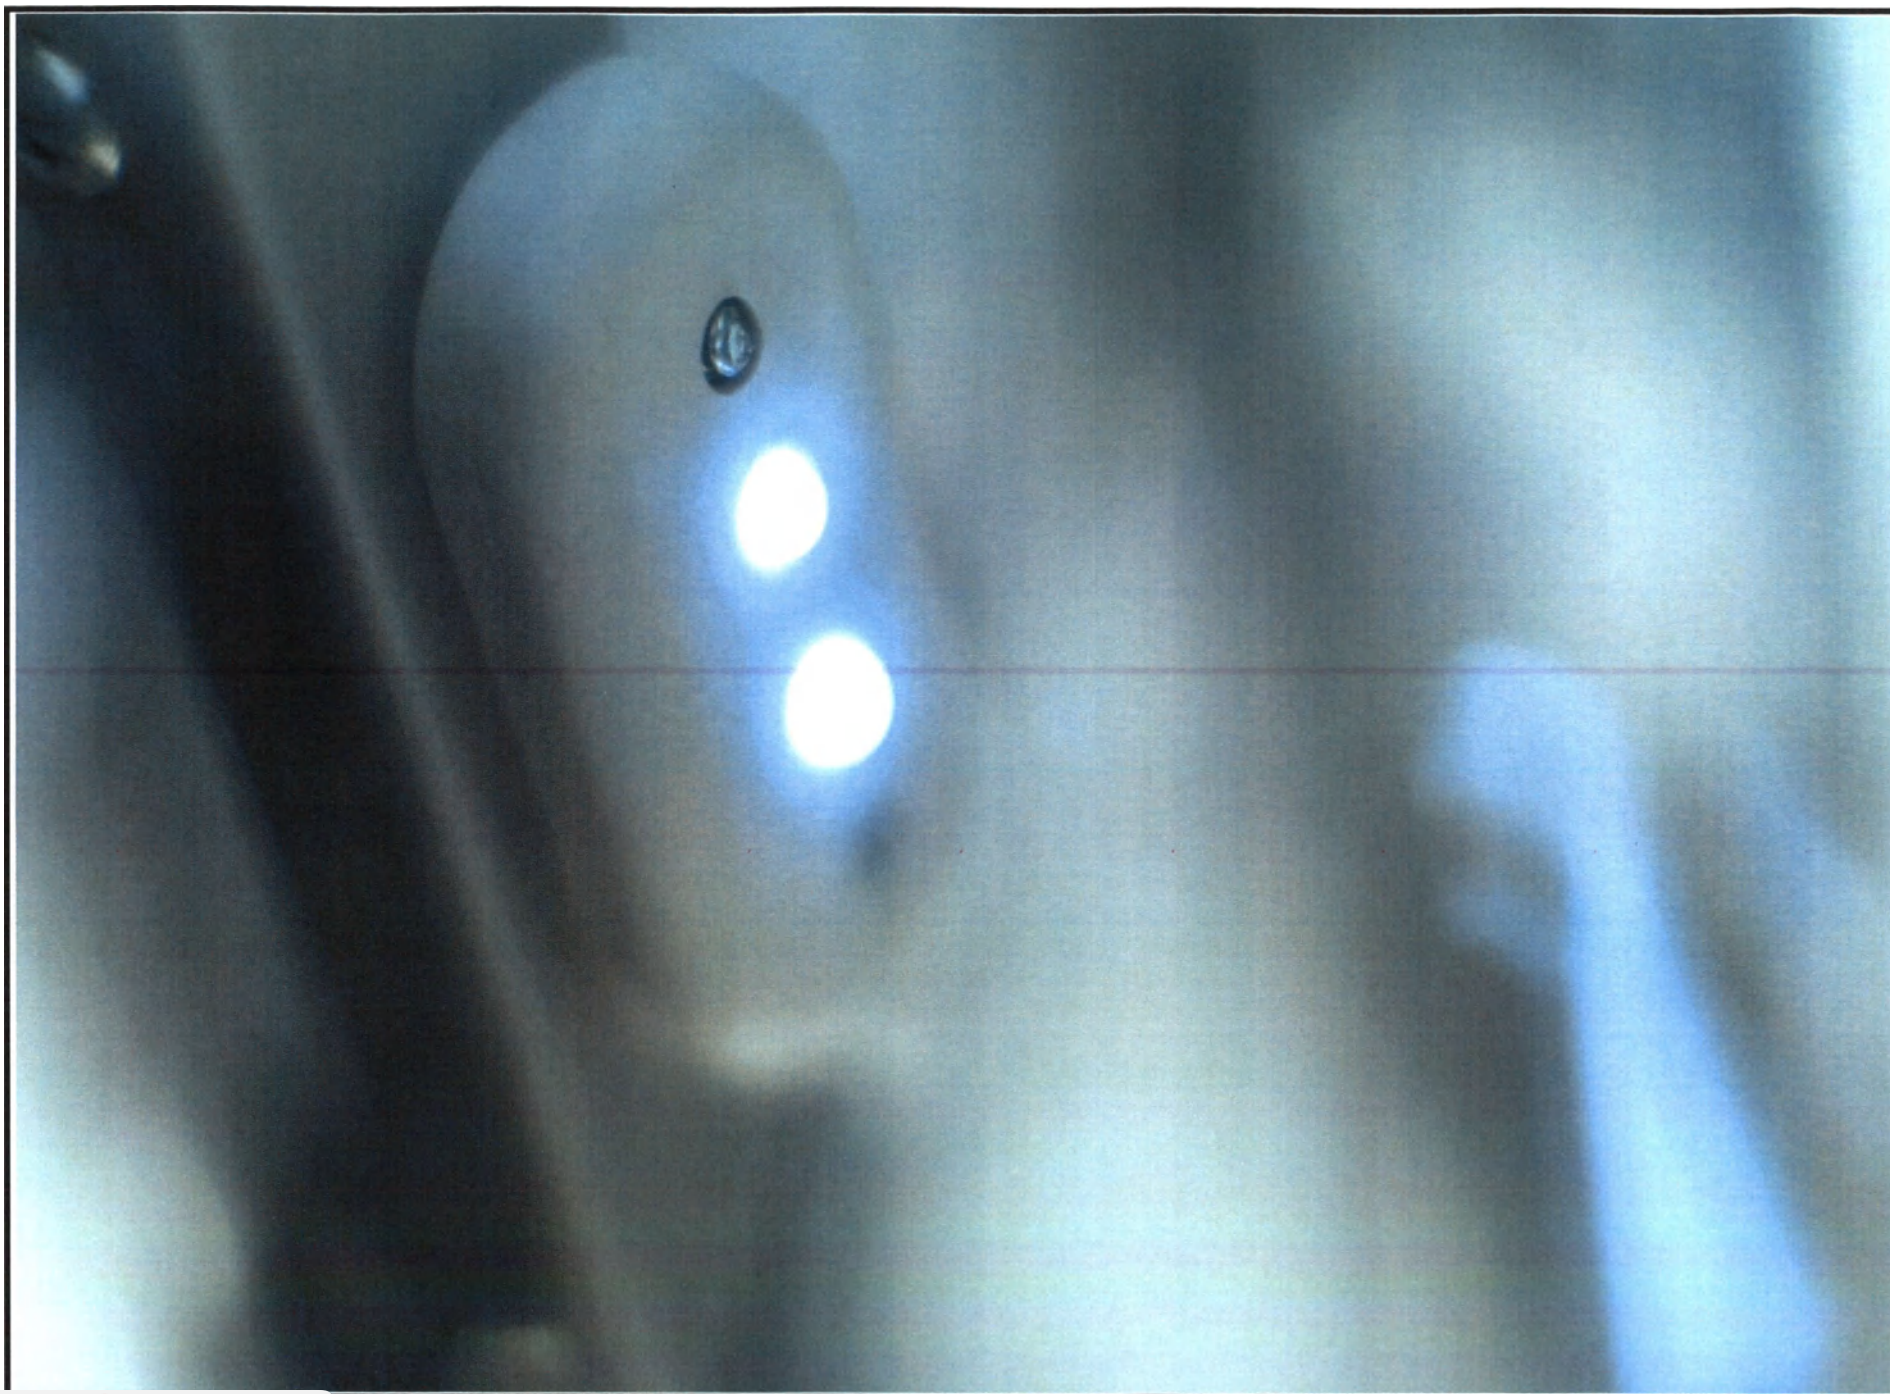


31. Батарея аккумуляторная (не более 2 шт.).

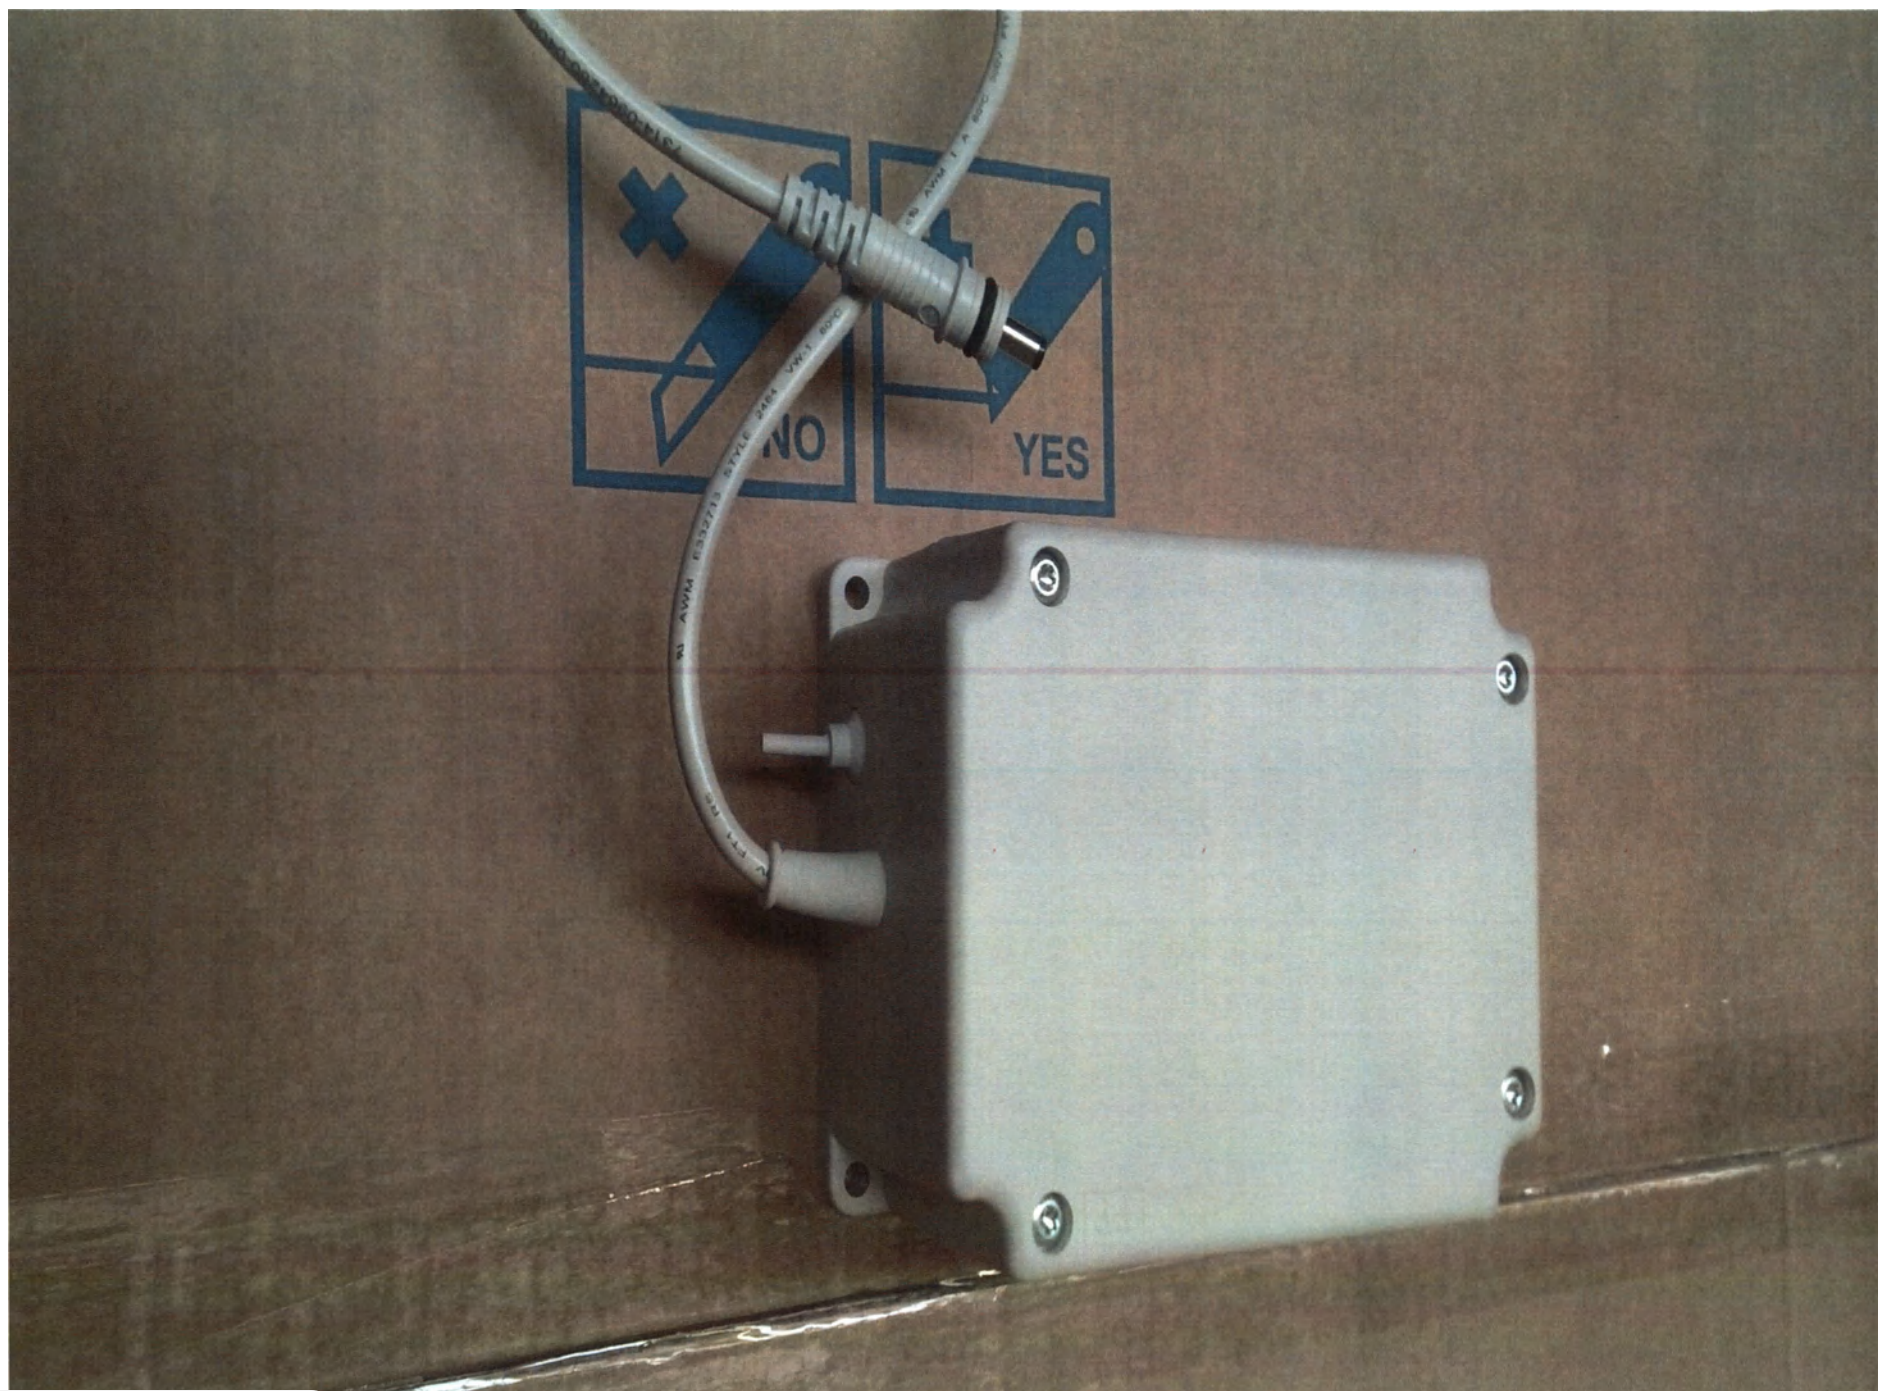

32. Интегрированная система взвешивания пациента.



33. Датчики для интегрированной системы «антизахвата».

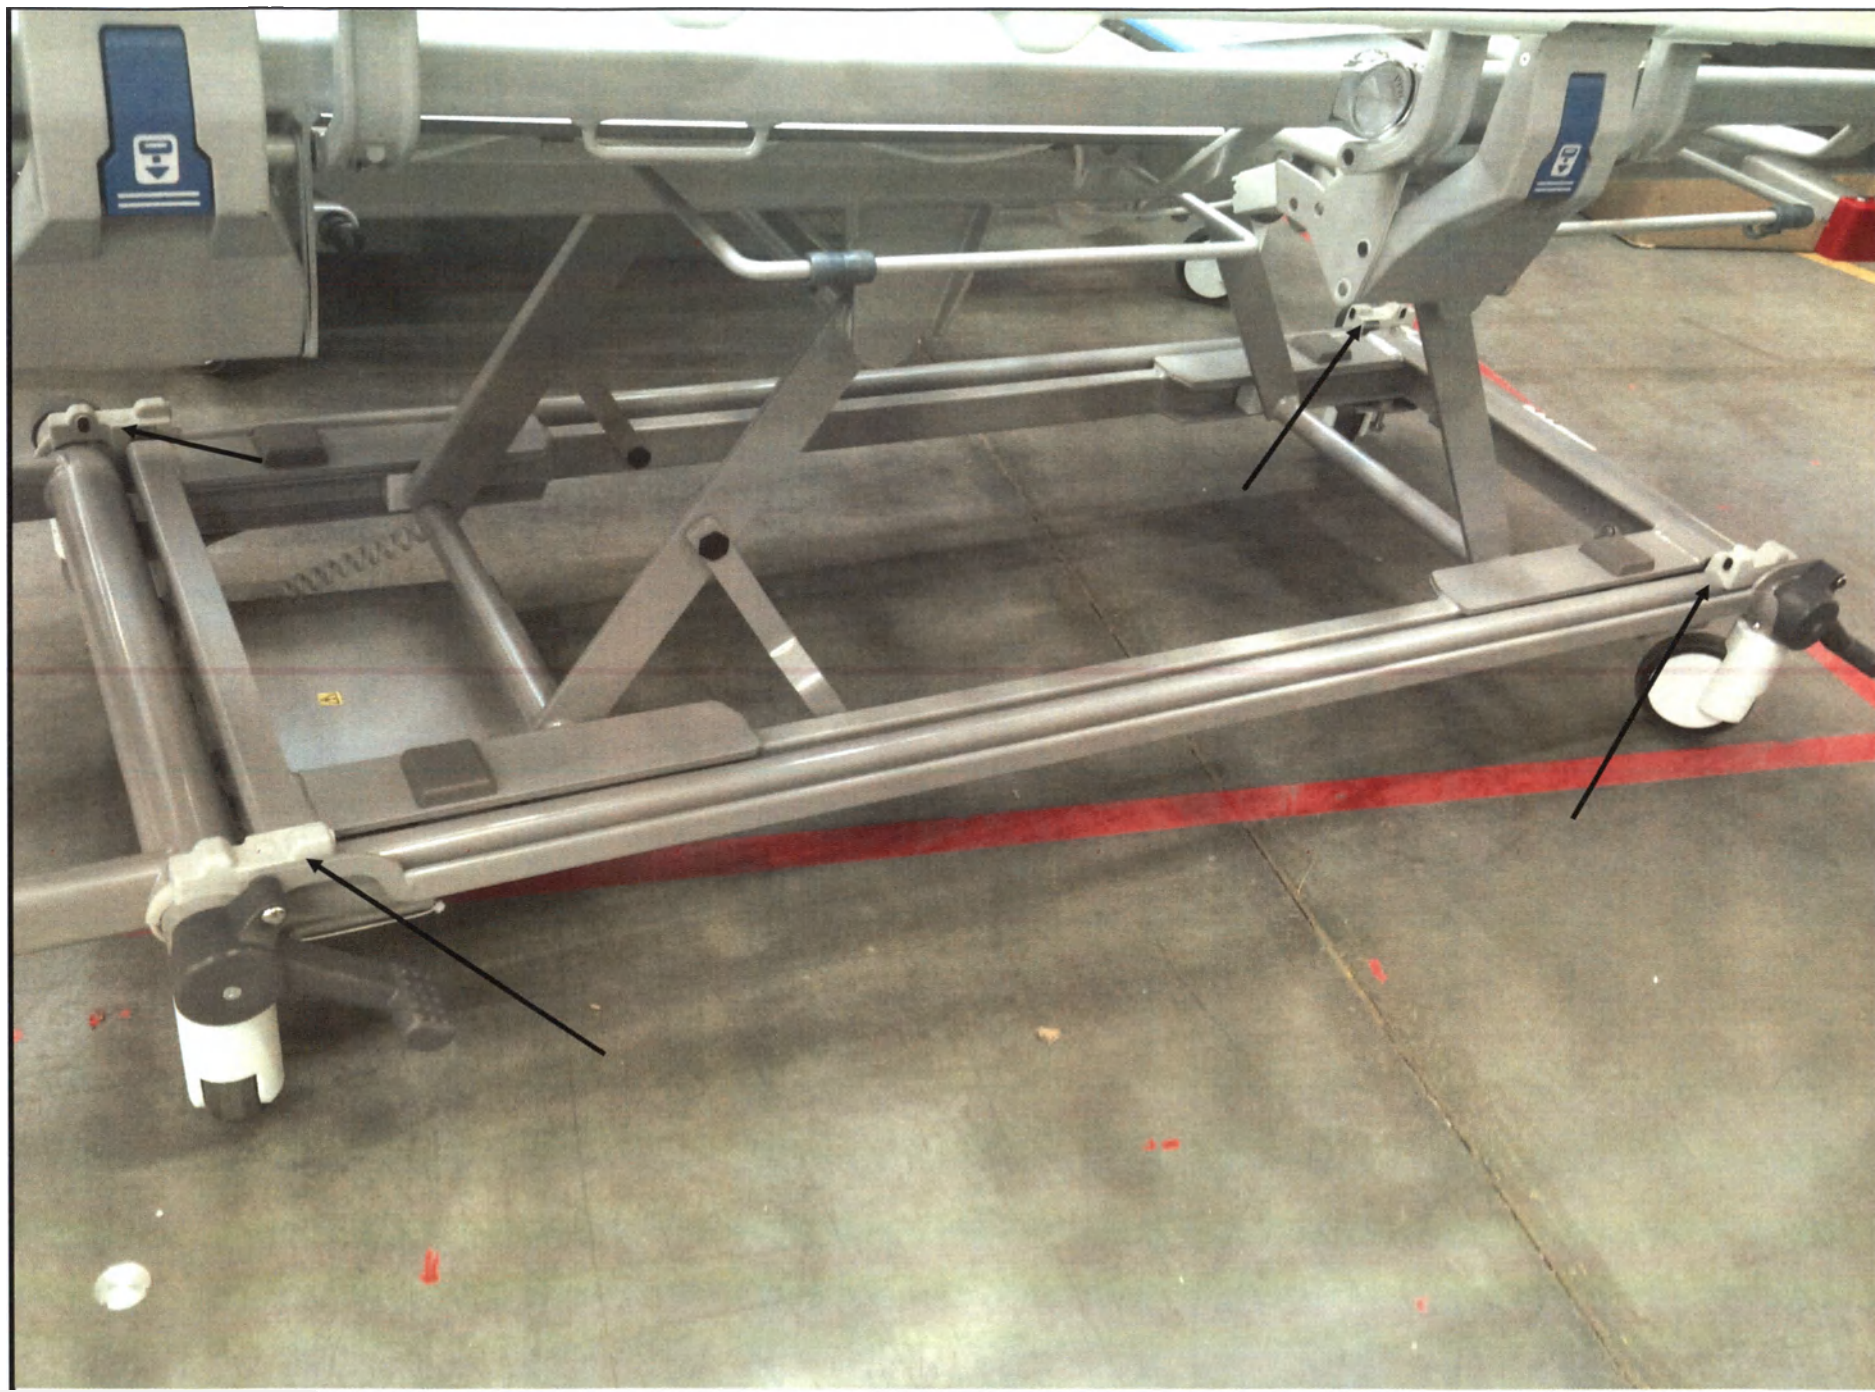

33. Датчики для интегрированной системы «антизахвата».



—

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 124 листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Маке»

Ульянова К.Н.

