

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Алькор Медикал»



И.С. Федоренко

«27» января 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА И УПАКОВКИ С МАРКИРОВКОЙ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT

NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS
NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS
NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS
NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS
NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS
NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS
NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS
NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS
NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS
NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS	NELIS


Производство:

«NELIS Co., Ltd.», Korea,


(«НЕЛИС Ко., Лтд.»), Корея

2020 г.

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 220

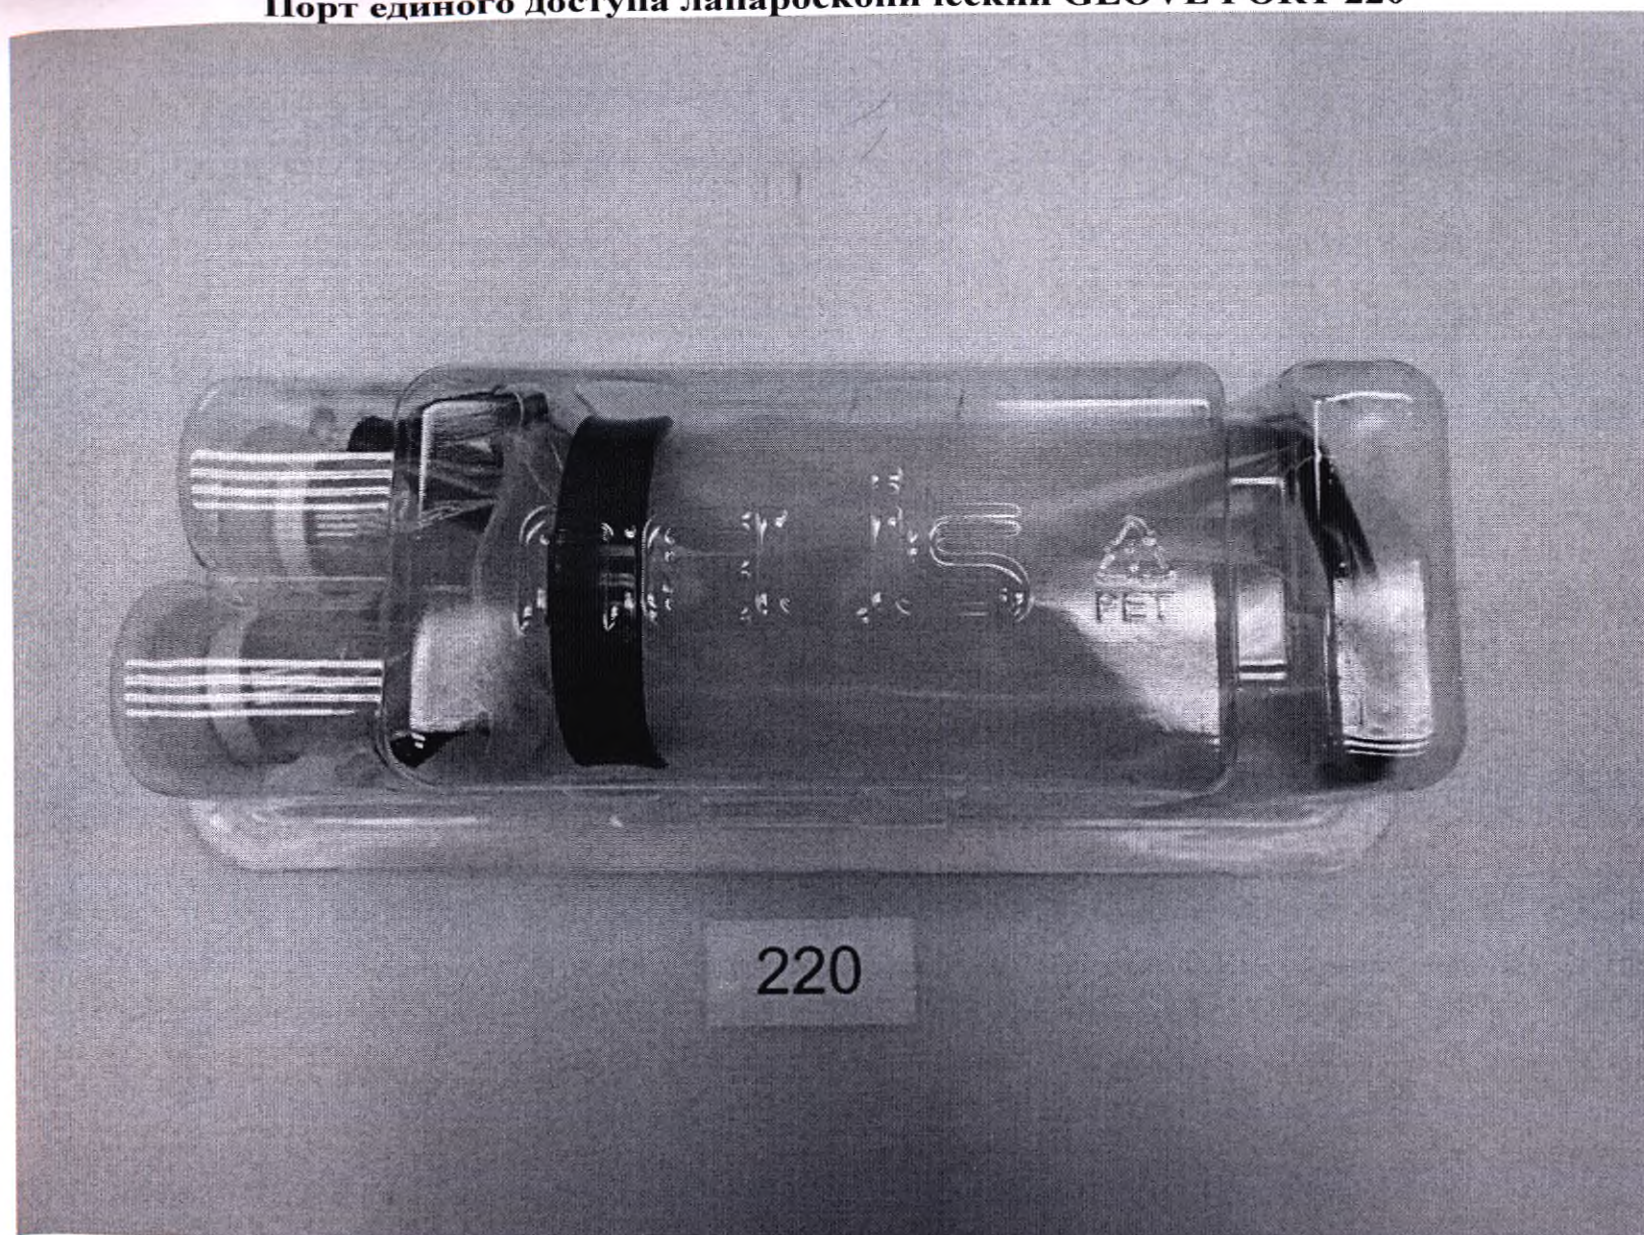

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 321

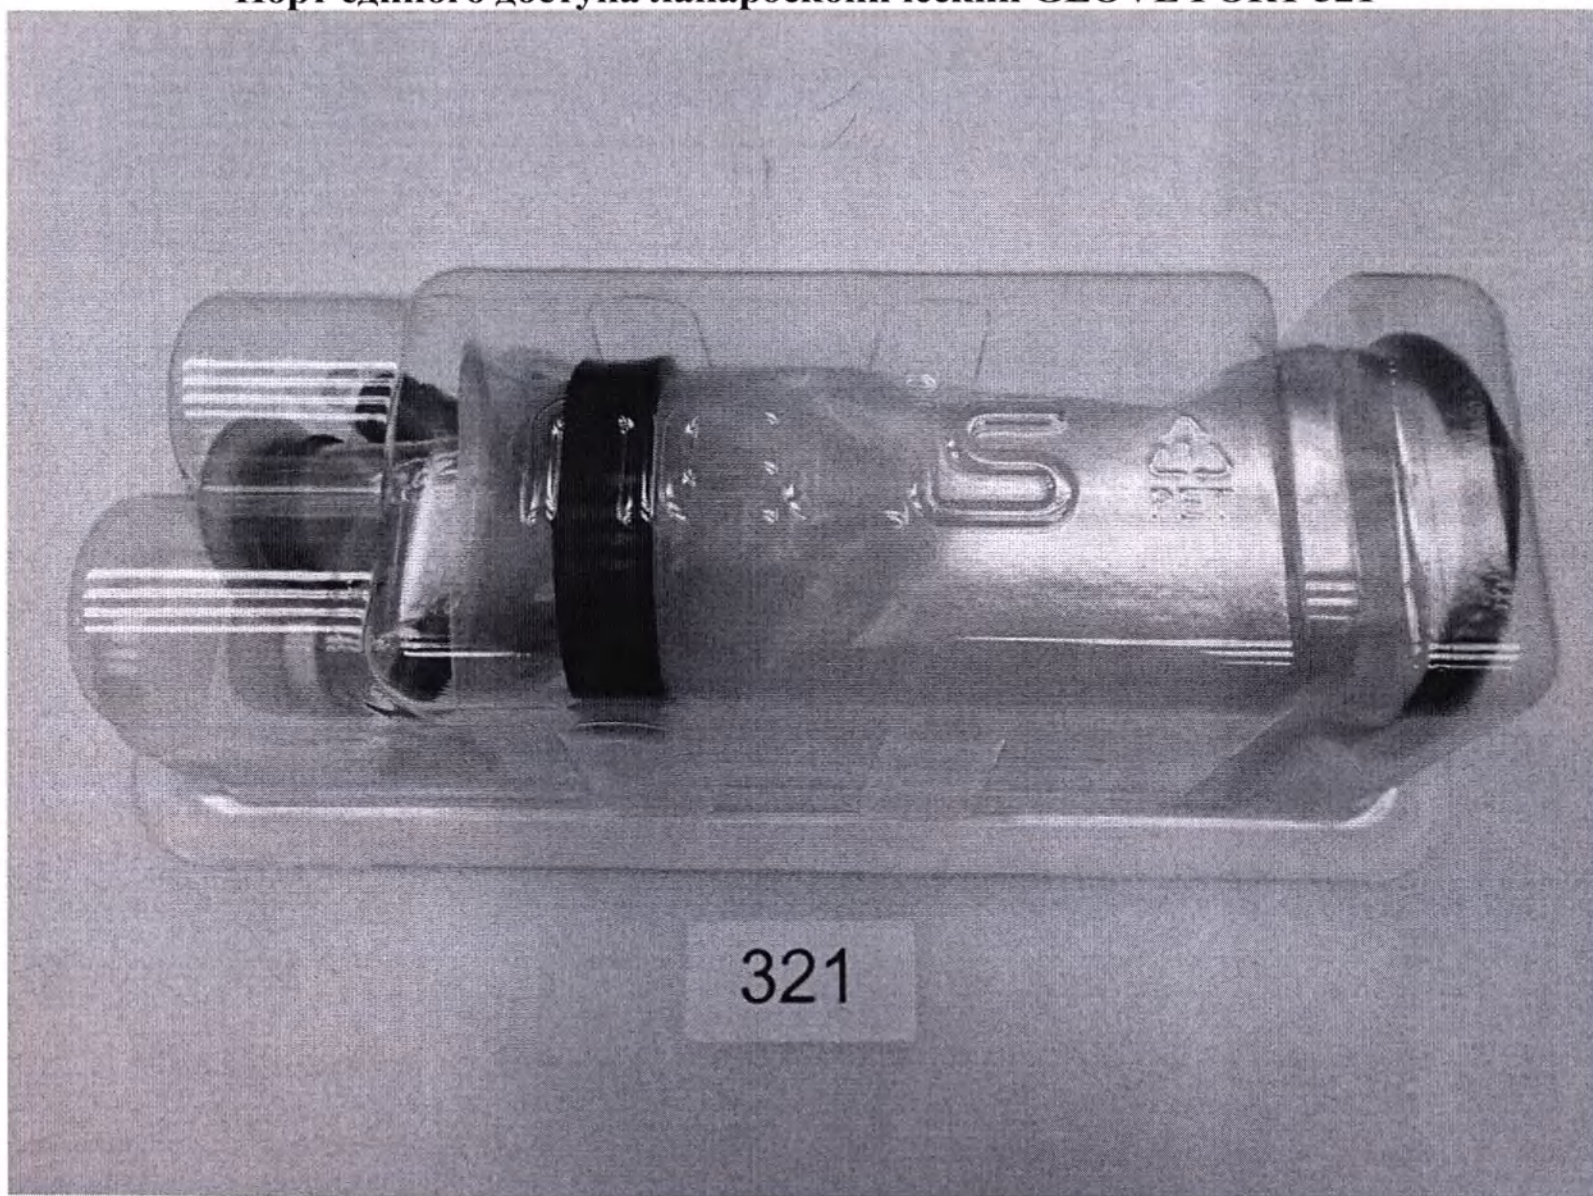

GLOVE PORT

- Наименование изделия: Порт артериального доступа лапароскопический.
- Модель: порт лапароскопический.
- Регистрационный номер № (GUSENCON № 10-137)
- Назначение: расширение области воздействия при помощи кроющих, режущих, опиливающих и расширяющих инструментов.
- Инструкция по эксплуатации.
- Выполните разрез 2,5 см в брюшной области.
- Сожмите пальцами внутреннее кольцо.
- Введите скальпел в отверстие кольца в разрез в брюшной стенке.
- Закрутите внешнее кольцо порта в толщу брюшной стенки и закрепите на поверхности брюшной стенки.
- Соедините конектор клапана с введенным клапаном газа.
- Отверните конектор клапана так, чтобы «жесткий» тор достался до разреза.
- Используйте различные инструменты, вводя их через инструментальный клапан расширителя.
- Сожмите нижнюю часть чека регулятора после операции и удалите клапанную часть.
- Дотяните внутреннее кольцо для закрытия порта.
- ВНИМАНИЕ:

1. Не используйте бракованное или поврежденное изделие. Не нарушайте целостность стерильной упаковки и датума.
2. Не используйте изделие по истечению срока годности.
3. Будьте осторожны при работе с острыми инструментами.
4. Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву.
5. Не используйте повторно.
6. Утилизируйте изделие в соответствии с установленными требованиями.
- 8) Издание является заводским.
- 9) Товароведатель: 1005, 201 Dong Vuchien Techno Park, Samrong 3 Cha, Samrong dong, Ongang 91, Buecheon si, Oueonji do, Korea (Korea).
- 10) Дата производства соответствует дате стерилизации.
- 11) Дата стерилизации.





Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Модель: порт лапароскопический.

Рег. №: GUSC 1005137 от 10.10.13



Инструкция по применению




Вушкое и вушкое отверстие для газа раздвинуты для легкого отведения газа и дыма.

Вушное внутреннее кольцо, как показано на рисунке.

1005, 201 Dong Vuchien Techno Park Samrong 3 Cha, Samrong dong, Ongang 91, Buecheon si, Oueonji do, Korea (Korea)
nelis
 Korea Rep. Port

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 321-AS

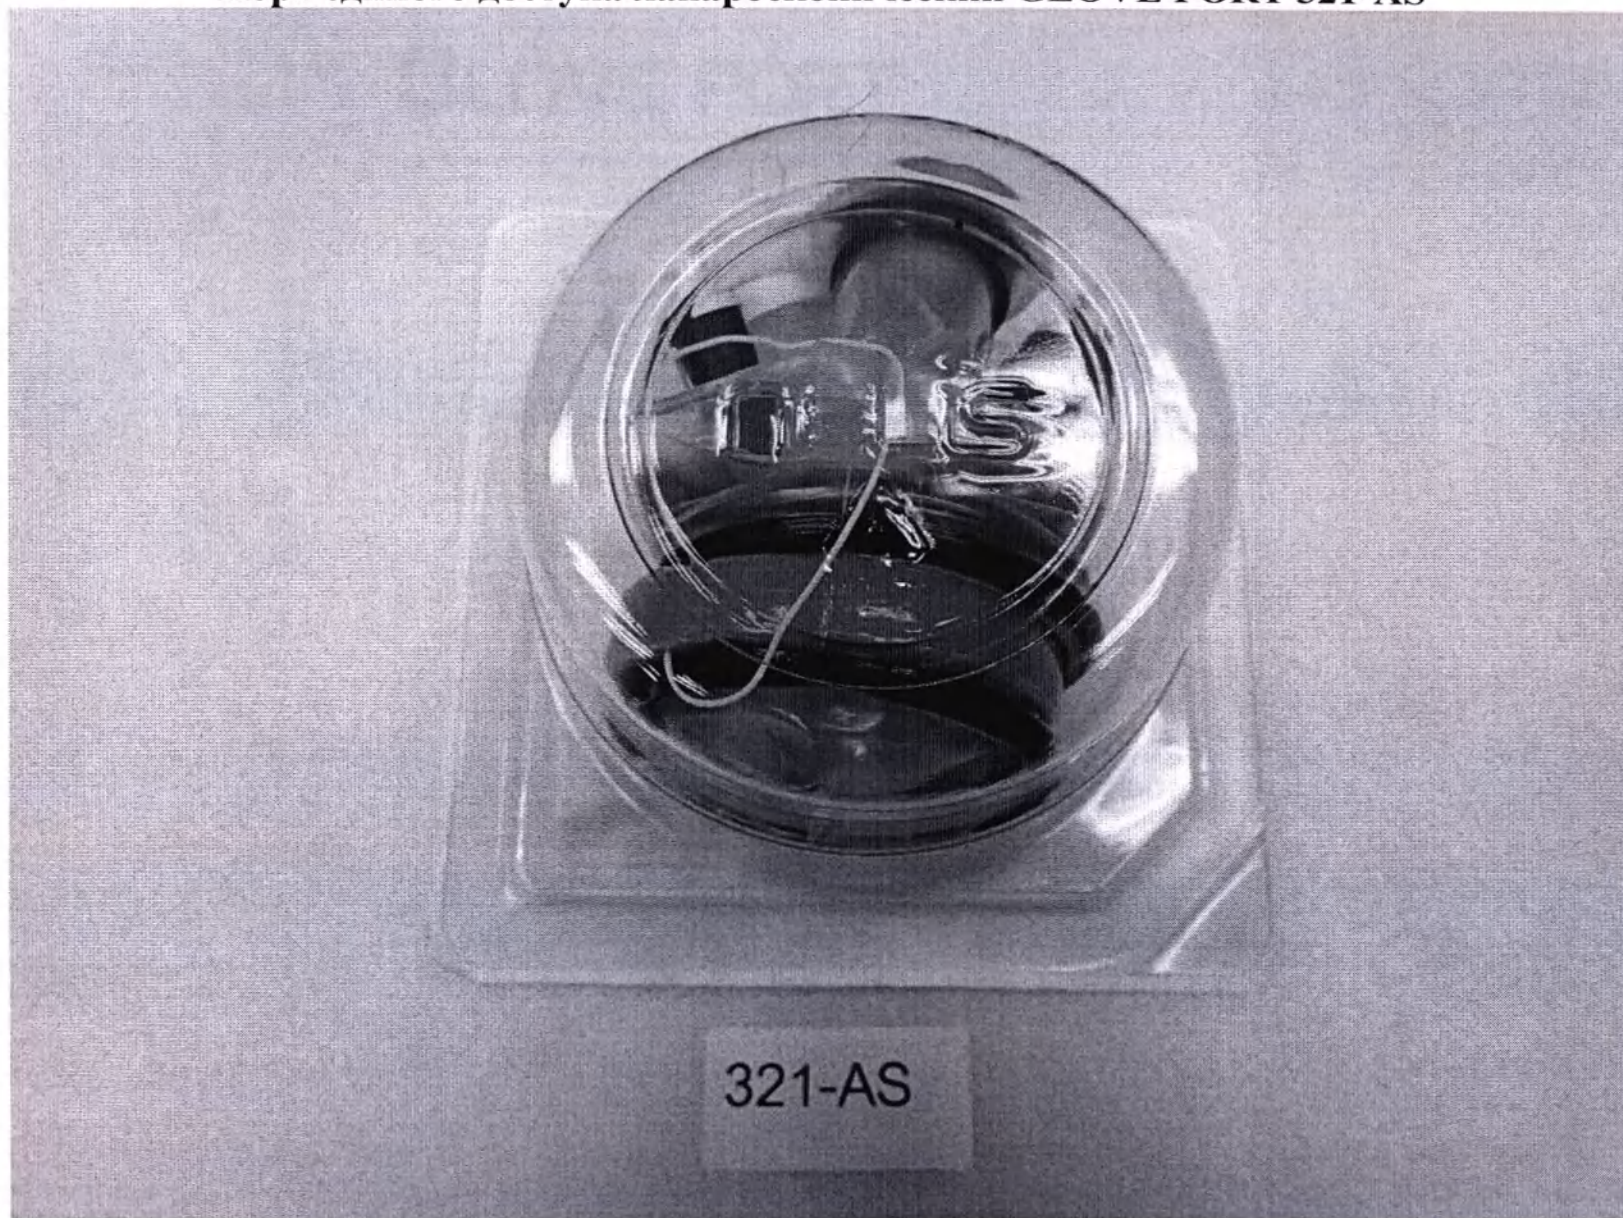


GLOVE PORT

- 1) Наименование изделия: Порт единого доступа лапароскопический.
- 2) Модель: порт лапароскопический.
- 3) Регистрационный номер № (GYEONGIN No.10-137)
- 4) Назначение: расширение области воздействия при помощи крючков, ретракторов, сепараторов и ретейнеров.
- 5) Упаковка: 1 шт.
- 6) Инструкция по эксплуатации:
 1. Выполните разрез 2,5 см в пупочной области.
 2. Сожмите пальцами внутреннее кольцо.
 3. Введите сжатое внутреннее кольцо в разрез в брюшной стенке
 4. Закрутите внешнее кольцо порта в толще брюшной стенки и закрепите на поверхности брюшной стенки.
 5. Соедините коннектор клапана с впускным клапаном газа.
 6. Отрегулируйте клапан так, чтобы чехол-ретрактор достаточно раздулся.
 7. Используйте различные инструменты, вводя их через инструментальные клапаны расширителя.
 8. Срежьте нижнюю часть чехла-ретрактора после операции и удалите извлеченную часть
 9. Потяните внутреннее кольцо для извлечения порта.
- 7) ВНИМАНИЕ:
 1. Не используйте бракованное или поврежденное изделие. Не нарушайте целостность стерильной упаковки изделия.
 2. Не используйте изделие по истечению срока годности.
 3. Будьте осторожны при работе с острыми инструментами.
 4. Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву.
 5. Не используйте повторно.
 6. Утилизируйте изделие в соответствии с установленными требованиями.
- 8) Изделие является медицинским.
- 9) Производитель: 1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha, Samjeong dong, Ojeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea).
- 10) Дата производства соответствует дате стерилизации.
- 11) Дата стерилизации:

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Модель: порт лапароскопический.

LOT	
REF	




1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha,
Samjeong dong, Ojeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea)

Per: Уд. ФЗС ##### от ####

NELIS New Life Start

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 330

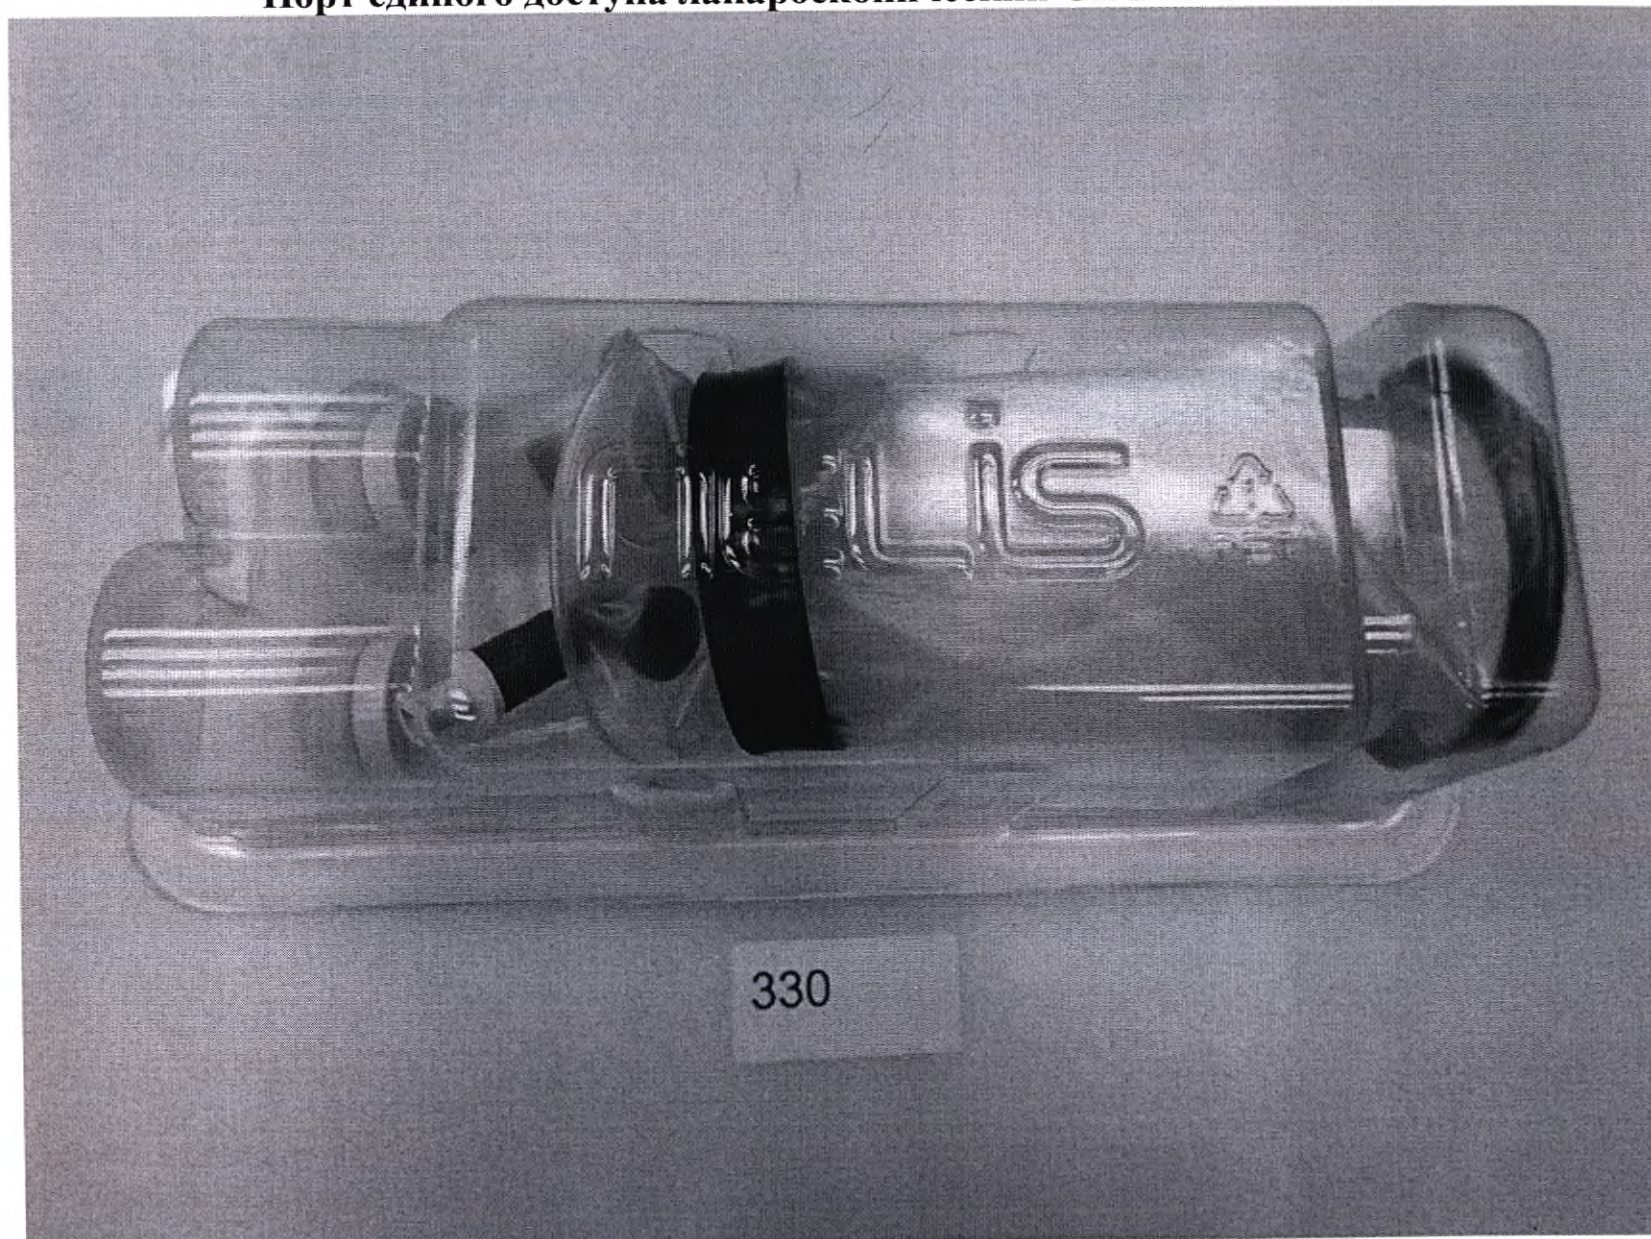

GLOVE PORT

- 1) Наименование изделия: Порт внешнего доступа лапароскопический
- 2) Модель: порт лапароскопический
- 3) Регистрационный номер № (ГЭЕОС) № 10-137)
- 4) Назначение: расширение области воздействия при помощи крючков, режущих, скапаторов и режигнеров.
- 5) Упаковка: 1 шт.
- 6) Инструкция по эксплуатации:
1. Выполните разрез 2,5 см в брюшной области.
2. Сожмите пальцами внутреннее кольцо.
3. Выдвиньте скапатор внутреннее кольцо в разрез в брюшной стенке
4. Заверните внешнее кольцо так, чтобы оно было в разрезе брюшной стенки и закройте на поверхности брюшной стенки.
5. Создайте конектор хвостом с впускной клипсой газа
6. Отверните конектор так, чтобы конектор был в разрезе брюшной стенки
7. Используйте различные инструменты, вводя их через конекторный клапан расширителя.
8. Сожмите нижнюю часть конектора после операции и удалите конекторную часть
9. Потяните внутреннее кольцо для извлечения порта
- 7) ВНИМАНИЕ:
1. Не используйте бракованные или поврежденные изделия. Не нарушайте целостность стерильной упаковки изделия.
2. Не используйте изделие по истечению срока годности.
3. Будьте осторожны при работе с острыми инструментами.
4. Не подваривайте изделие чрезмерному нагреву.
5. Не используйте повторно.
6. Утилизируйте изделие в соответствии с установленными требованиями
- 8) Изделие является медицинским
- 9) Производитель: 1005, 201 Dong Vuthien Techno Park Samgong 3 Cha, Samgong dong, Ojeong gu, Vuthien si, Gyeonggi do, Korea (Korea)
- 10) Дата производства соответствует дате стерилизации.
- 11) Дата стерилизации

срок годности
1005, 201

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Модель: порт лапароскопический.
Per: Yd ФДС ##### от ####




Инструкция по применению

1. Выполнив разрез 2,5 см в области пупка и сожмите пальцами внутреннее кольцо.
2. Выдвиньте внешнее кольцо так, чтобы внутреннее кольцо находилось в области пупка и сожмите пальцами внутреннее кольцо.
3. Выдвиньте внутреннее кольцо, как показано на рисунке.
4. Выдвиньте внутреннее кольцо, как показано на рисунке.

1005, 201 Dong Vuthien Techno Park Samgong 3 Cha, Samgong dong, Ojeong gu, Vuthien si, Gyeonggi do, Korea (Korea)

nelis

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 330-AL

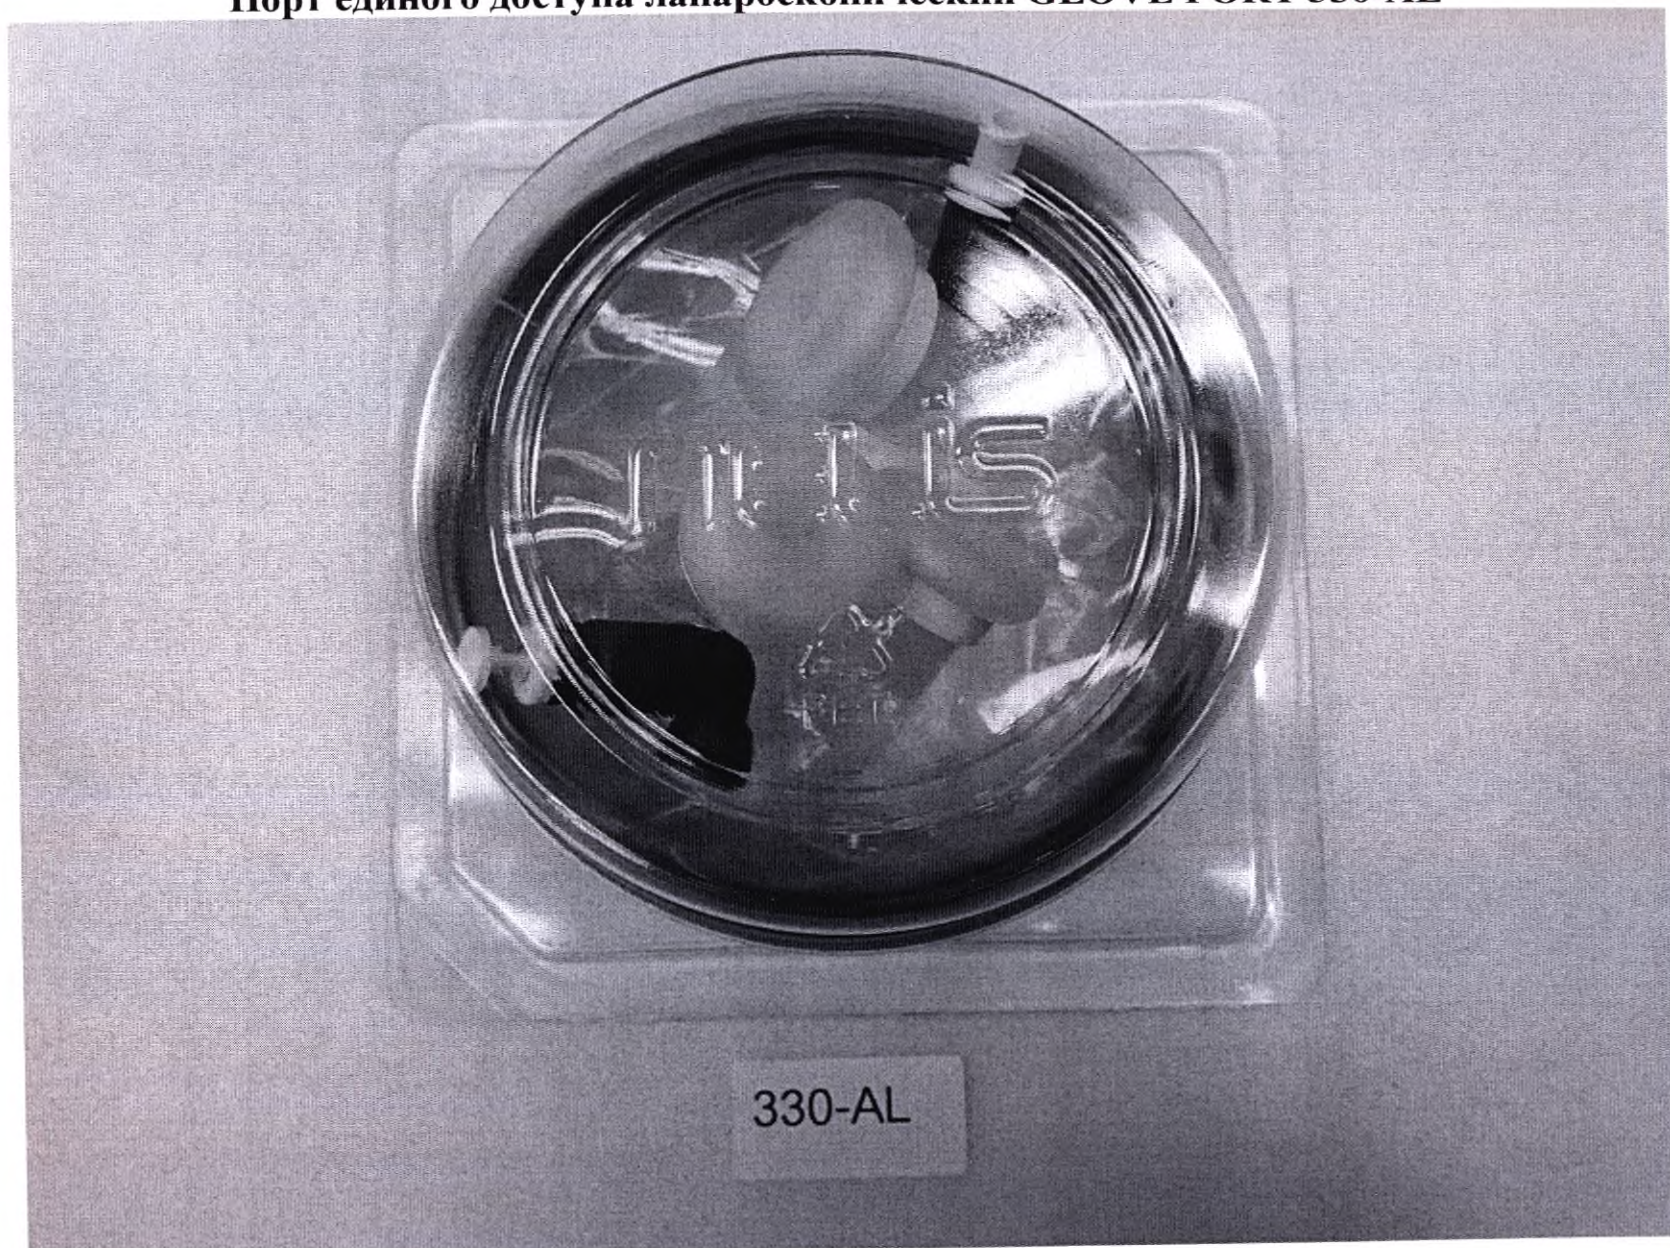


GLOVE PORT

- 1) Наименование изделия: Порт единого доступа лапароскопический.
 - 2) Модель: порт лапароскопический.
 - 3) Регистрационный номер № (GYEONGIN No. 10-137)
 - 4) Назначение: расширение области воздействия при помощи крючков, ретракторов, сепараторов и ретейнеров.
 - 5) Упаковка: 1 шт.
 - 6) Инструкция по эксплуатации:
 1. Выполните разрез 2,5 см в пупочной области.
 2. Сожмите пальцами внутреннее кольцо.
 3. Введите сжатое внутреннее кольцо в разрез в брюшной стенке
 4. Закрутите внешнее кольцо порта в толще брюшной стенки и закрепите на поверхности брюшной стенки.
 5. Соедините коннектор клапана с впускным клапаном газа.
 6. Отрегулируйте клапан так, чтобы чехол-ретрактор достаточно раздулся.
 7. Используйте различные инструменты, вводя их через инструментальные клапаны расширителя.
 8. Срежьте нижнюю часть чехла-ретрактора после операции и удалите извлеченную часть
 9. Потяните внутреннее кольцо для извлечения порта.
 - 7) ВНИМАНИЕ:
 1. Не используйте бракованное или поврежденное изделие. Не нарушайте целостность стерильной упаковки изделия.
 2. Не используйте изделие по истечению срока годности.
 3. Будьте осторожны при работе с острыми инструментами.
 4. Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву.
 5. Не используйте повторно.
 6. Утилизировать изделие в соответствии с установленными требованиями.
 - 8) Изделие является медицинским.
 - 9) Производитель: 1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha, Samjeong dong, Ojeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea).
 - 10) Дата производства соответствует дате стерилизации.
 - 11) Дата стерилизации:
- | | |
|--|--|
| LOT | |
| REF | |
|  | |
|  | |

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.


Модель:	порт лапароскопический.
---------	-------------------------



1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha,
Samjeong-dong, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea (Korea)
Per. Yd. Φ3C ***** 01 ****

nelis New Life Soap

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 413

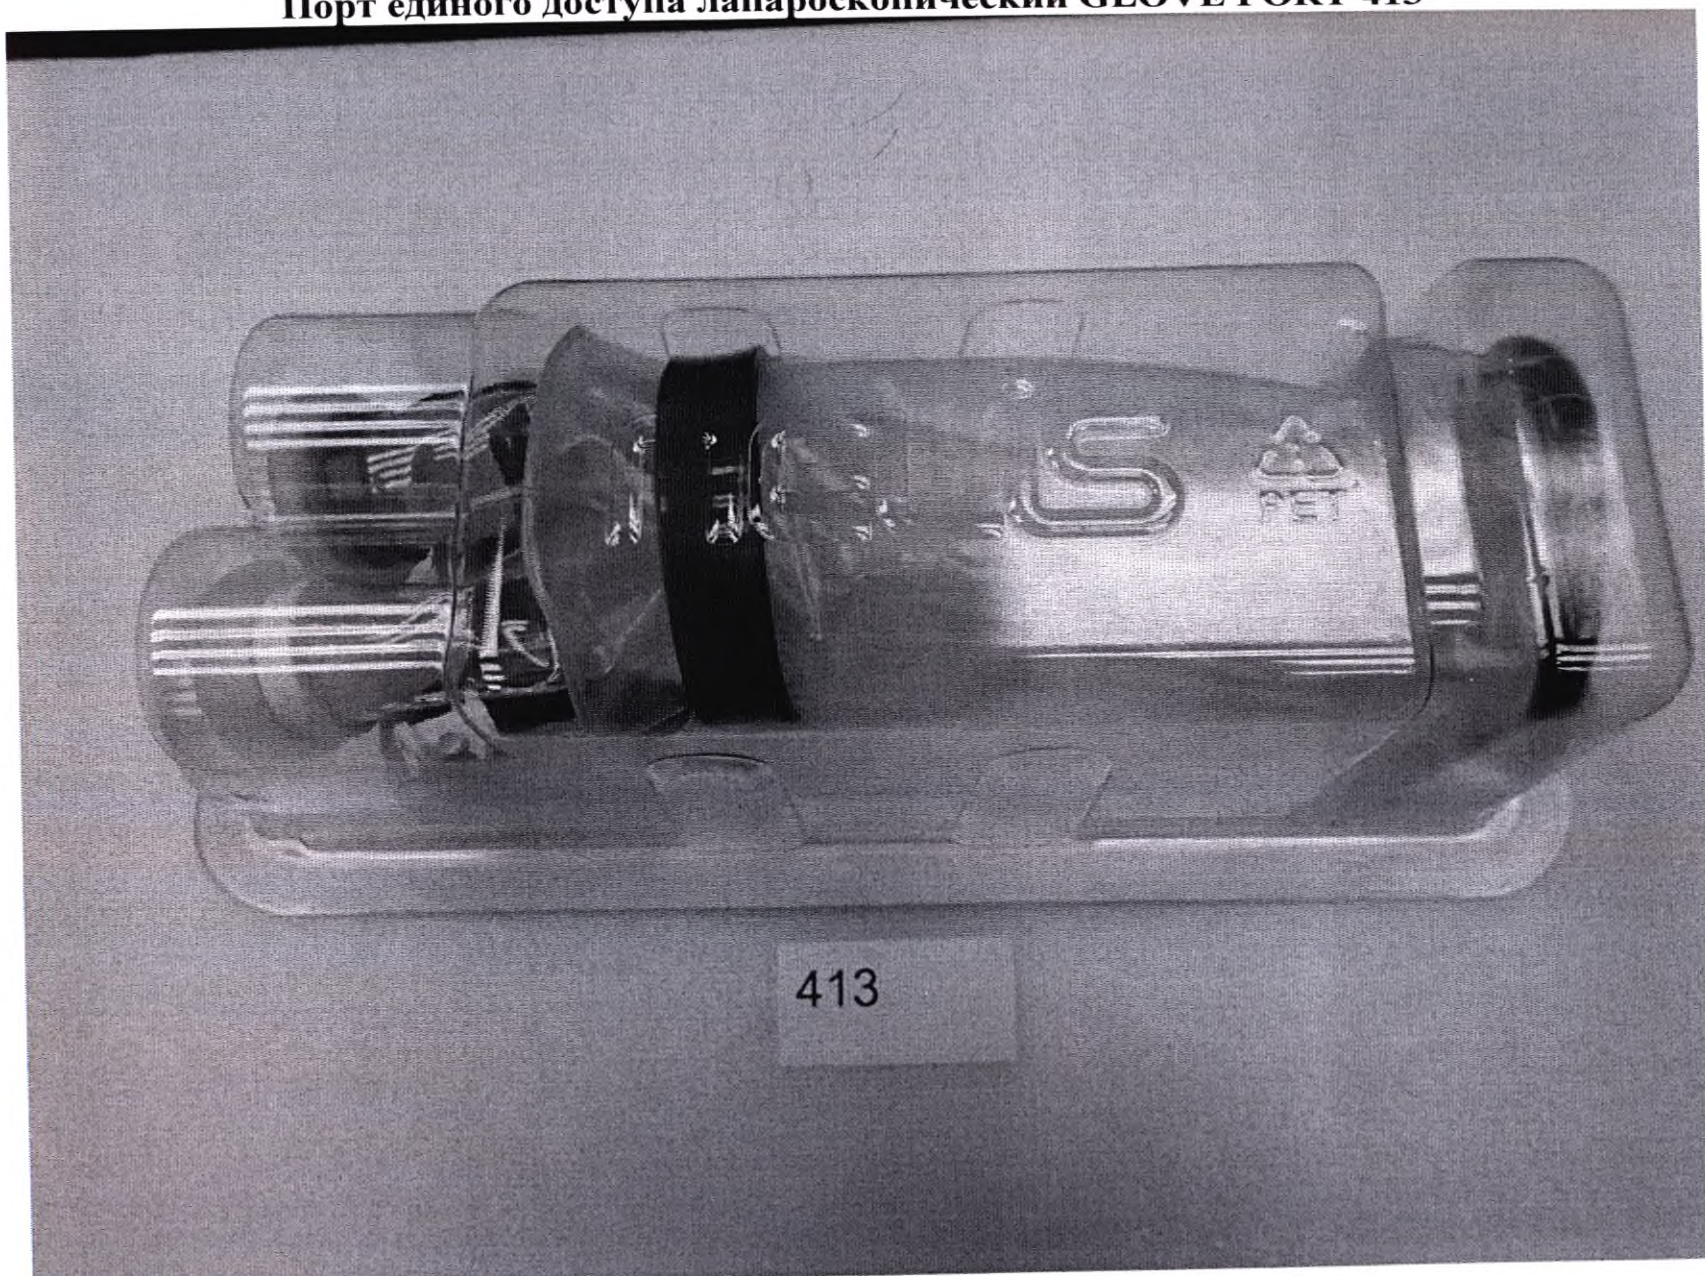

GLOVE PORT

- 1) Наименование изделия: Порт для прямого доступа лапароскопический.
- 2) Модель: порт лапароскопический.
- 3) Регистрационный номер № (GIFCONG №. 10.137)
- 4) Назначение: расширение области воздействия при помощи кроющих, ретракторов, самораскрывающихся и ретракторов.
- 5) Упаковка: 1 шт.
- 6) Измерения по эксплуатации:
 1. Выполните размер 2,5 см в поперечной области.
 2. Сожмите пальцами внутреннее кольцо.
 3. Вдавите сжатое внутреннее кольцо в разрез в брюшной стенке.
 4. Зафиксируйте внешнее кольцо порта в толще брюшной стенки и закрепите на поверхности брюшной стенки.
 5. Соедините концы трубки так, чтобы через ретрактор достигло нужное пространство.
 6. Отверните концы трубки так, чтобы через ретрактор достигло нужное пространство.
 7. Используйте различные инструменты, вводя их через лапароскопическую платформу расширения.
 8. Сожмите нижнюю часть, чтобы ретрактор после операции и удалять лапароскопическую часть.
 9. Подтяните внутреннее кольцо для дальнейшего доступа.
- 7) ВНИМАНИЕ:
 1. Не используйте бракованное или поврежденное изделие. Не нарушайте целостности стерильной упаковки изделия.
 2. Не используйте изделие по истечению срока годности.
 3. Будьте осторожны при работе с острыми инструментами.
 4. Не поджигайте изделие, чтобы избежать нагрева.
 5. Не используйте повторно.
 6. Утилизируйте изделие в соответствии с установленными требованиями.
 7. Изделие не является медицинским.
 8. Товарная марка: 1000, 201 Dong Vachon Techno Park Samung 3 Co., Samung dong, Oeong gu.
 9. Адрес: 1000, 201 Dong Vachon Techno Park Samung 3 Co., Samung dong, Oeong gu.
 - 10) Дата производства соответствует дате стерилизации.
 - 11) Дата стерилизации.

Открыть
Открыть в упаковке

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Модель: порт лапароскопический.

Рис. Уд. ФЗО № 1000 от 10.137




Инструкция по применению

1. Выполните размер 2,5 см в области пупка и сожмите пальцами внутреннее кольцо.
2. Вдавите внешнее кольцо так, чтобы внутреннее кольцо надвинулось на область пупка и сожмите пальцами с внутренней стороны абдоминальной стенки.
3. Введите и выведите трубку для газа (раздвинув для легкого введения газа и дыма).
4. Вытащите внутреннее кольцо, как показано на рисунке.

1000, 201 Dong Vachon Techno Park Samung 3 Co., Samung dong, Oeong gu.
Samung si, Gyeonggi do, Korea (Korea)

neils
Neils Glo Port

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 422

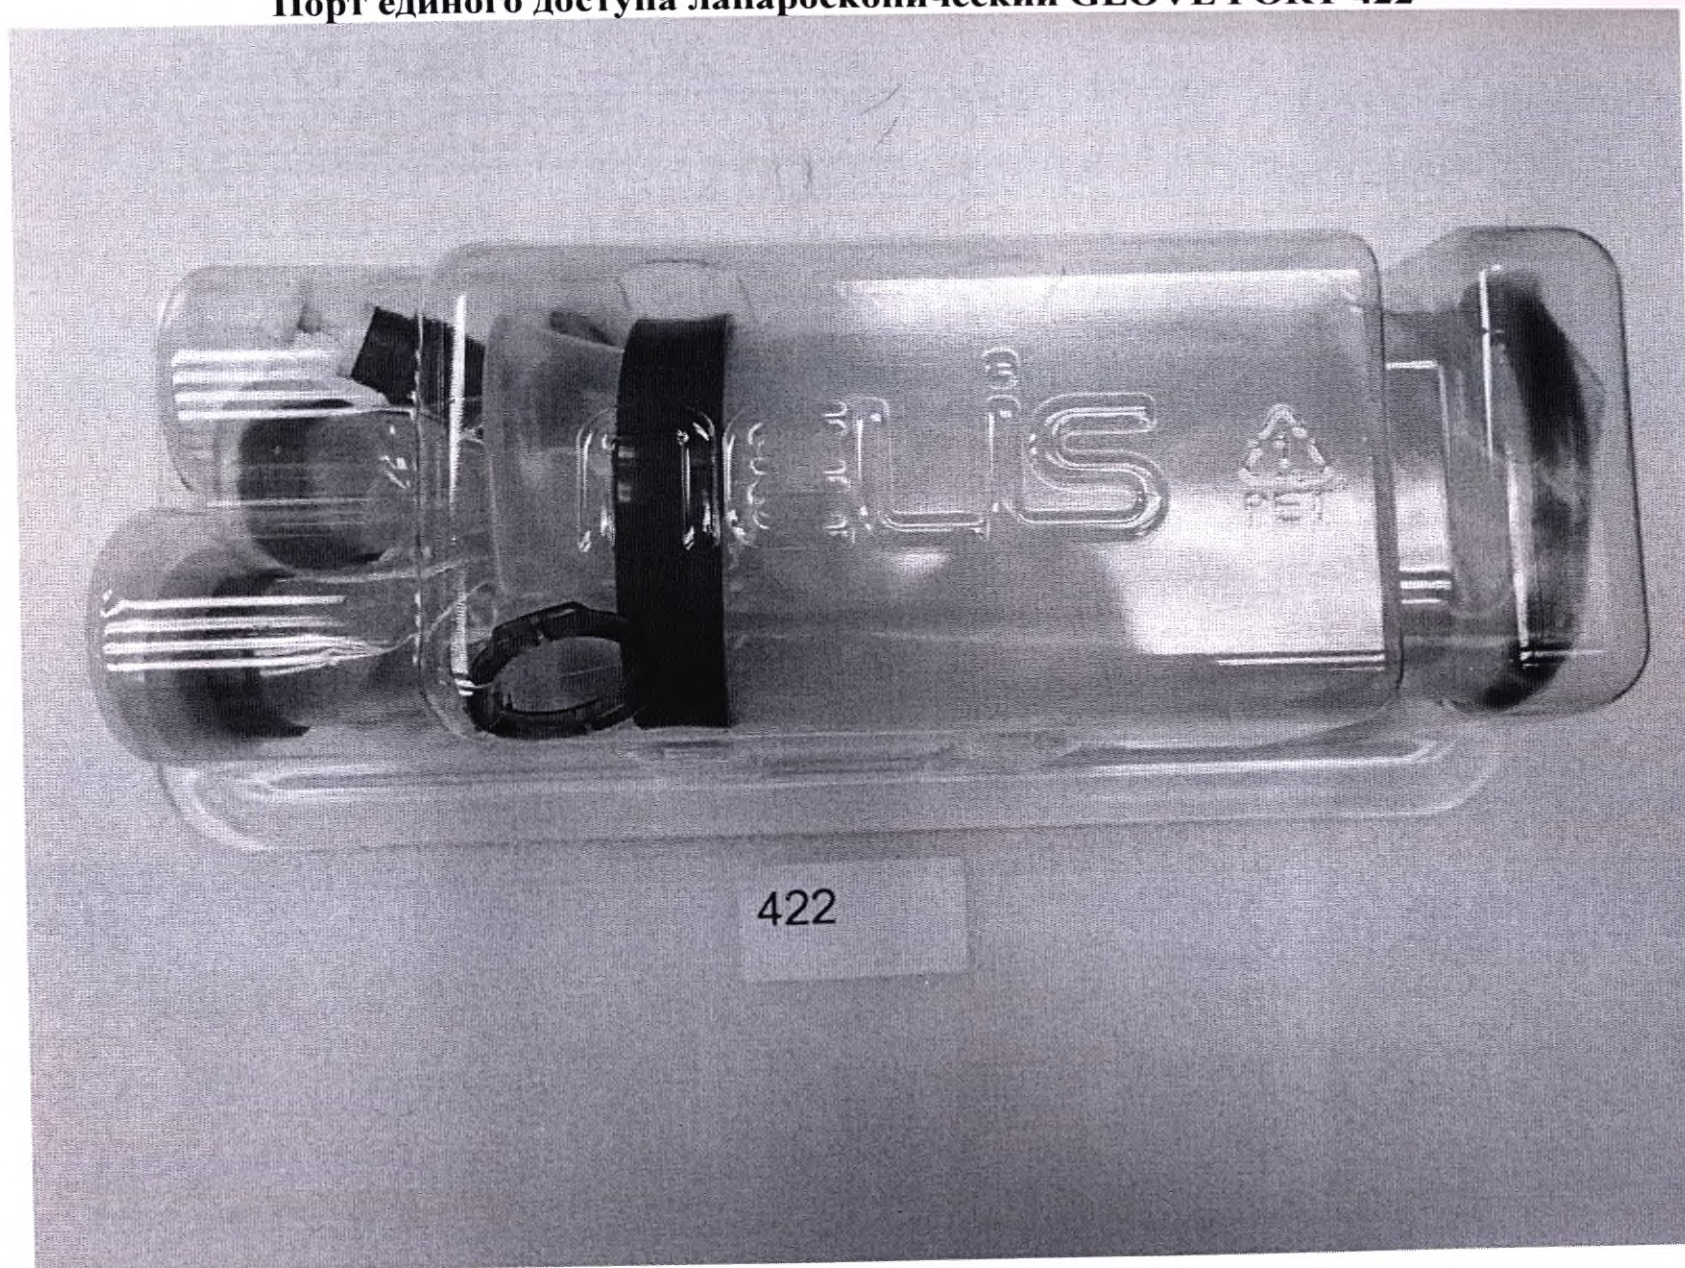

GLOVE PORT

- 1) Наименование изделия: Порт единого доступа лапароскопический.
- 2) Модель: порт лапароскопический.
- 3) Регистрационный номер № (GYEONGIN No.10-137)
- 4) Назначение: расширение области воздействия при помощи крючков, ретракторов, сепараторов и ретейнеров.
- 5) Упаковка: 1 шт.
- 6) Инструкция по эксплуатации:
 1. Выполните разрез 2,5 см в пупочной области.
 2. Сожмите пальцами внутреннее кольцо.
 3. Введите сжатое внутреннее кольцо в разрез в брюшной стенке.
 4. Закрутите внешнее кольцо порта в толще брюшной стенки и закрепите на поверхности брюшной стенки.
 5. Соедините конектор клапана с выпускным клапаном газа.
 6. Отрегулируйте клапан так, чтобы чехол-ретрактор достаточно раздулся.
 7. Используйте различные инструменты, вводя их через инструментальные клапаны расширителя.
 8. Срежьте нижнюю часть чехла-ретрактора после операции и удалите извлеченную часть.
 9. Потяните внутреннее кольцо для извлечения порта.
- 7) ВНИМАНИЕ:
 1. Не используйте бракованное или поврежденное изделие. Не нарушайте целостность стерильной упаковки изделия.
 2. Не используйте изделие по истечению срока годности.
 3. Будьте осторожны при работе с острыми инструментами.
 4. Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву.
 5. Не используйте повторно.
 6. Утилизируйте изделие в соответствии с установленными требованиями.
- 8) Изделие является медицинским.
- 9) Производитель: 1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha, Samjeong dong, Gyeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea).
- 10) Дата производства соответствует дате стерилизации.
- 11) Дата стерилизации:


Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Модель: порт лапароскопический.


Рег. Уд. ФЗС ##### от ####




■ Инструкция по применению




Выполните разрез 2,5 см в области пупка и сожмите пальцами внутреннее кольцо.



Вытяните внешнее кольцо так, чтобы внутреннее кольцо надлежало образом было расположено с внутренней стороны абдоминальной стенки.



Впускное и выпускное отверстие для газа разделены для легкого отведения газа и дыма.



Вытяните внутреннее кольцо, как показано на рисунке.

1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha, Samjeong dong, Gyeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea)

LOT
REF



NELIS New Life Start

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 422-AM



GLOVE PORT

- 1) Наименование изделия: Порт единого доступа лапароскопический.
- 2) Модель: порт лапароскопический.
- 3) Регистрационный номер № (GYEONGIN No.10-137)
- 4) Назначение: расширение области воздействия при помощи крючков, ретракторов, сепараторов и ретейнеров.
- 5) Упаковка: 1 шт.
- 6) Инструкция по эксплуатации:
 1. Выполните разрез 2,5 см в пупочной области.
 2. Сожмите пальцами внутреннее кольцо.
 3. Введите сжатое внутреннее кольцо в разрез в брюшной стенке
 4. Закрутите внешнее кольцо порта в толще брюшной стенки и закрепите на поверхности брюшной стенки.
 5. Соедините коннектор клапана с впускным клапаном газа.
 6. Отрегулируйте клапан так, чтобы чехол-ретрактор достаточно раздулся.
 7. Используйте различные инструменты, вводя их через инструментальные клапаны расширителя.
 8. Срежьте нижнюю часть чехла-ретрактора после операции и удалите извлеченную часть
 9. Потяните внутреннее кольцо для извлечения порта.
- 7) ВНИМАНИЕ:
 1. Не используйте бракованное или поврежденное изделие. Не нарушайте целостность стерильной упаковки изделия.
 2. Не используйте изделие по истечению срока годности.
 3. Будьте осторожны при работе с острыми инструментами.
 4. Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву.
 5. Не используйте повторно.
 6. Утилизируйте изделие в соответствии с установленными требованиями.
- 8) Изделие является медицинским.
- 9) Производитель: 1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha, Samjeong dong, Ojeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea).
- 10) Дата производства соответствует дате стерилизации.
- 11) Дата стерилизации:

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Модель: порт лапароскопический.


LOT	
REF	



1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha,
Samjeong dong, Ojeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea)
Per. Уд. Ф3С ##### от ####

NELIS New Life Start

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 431

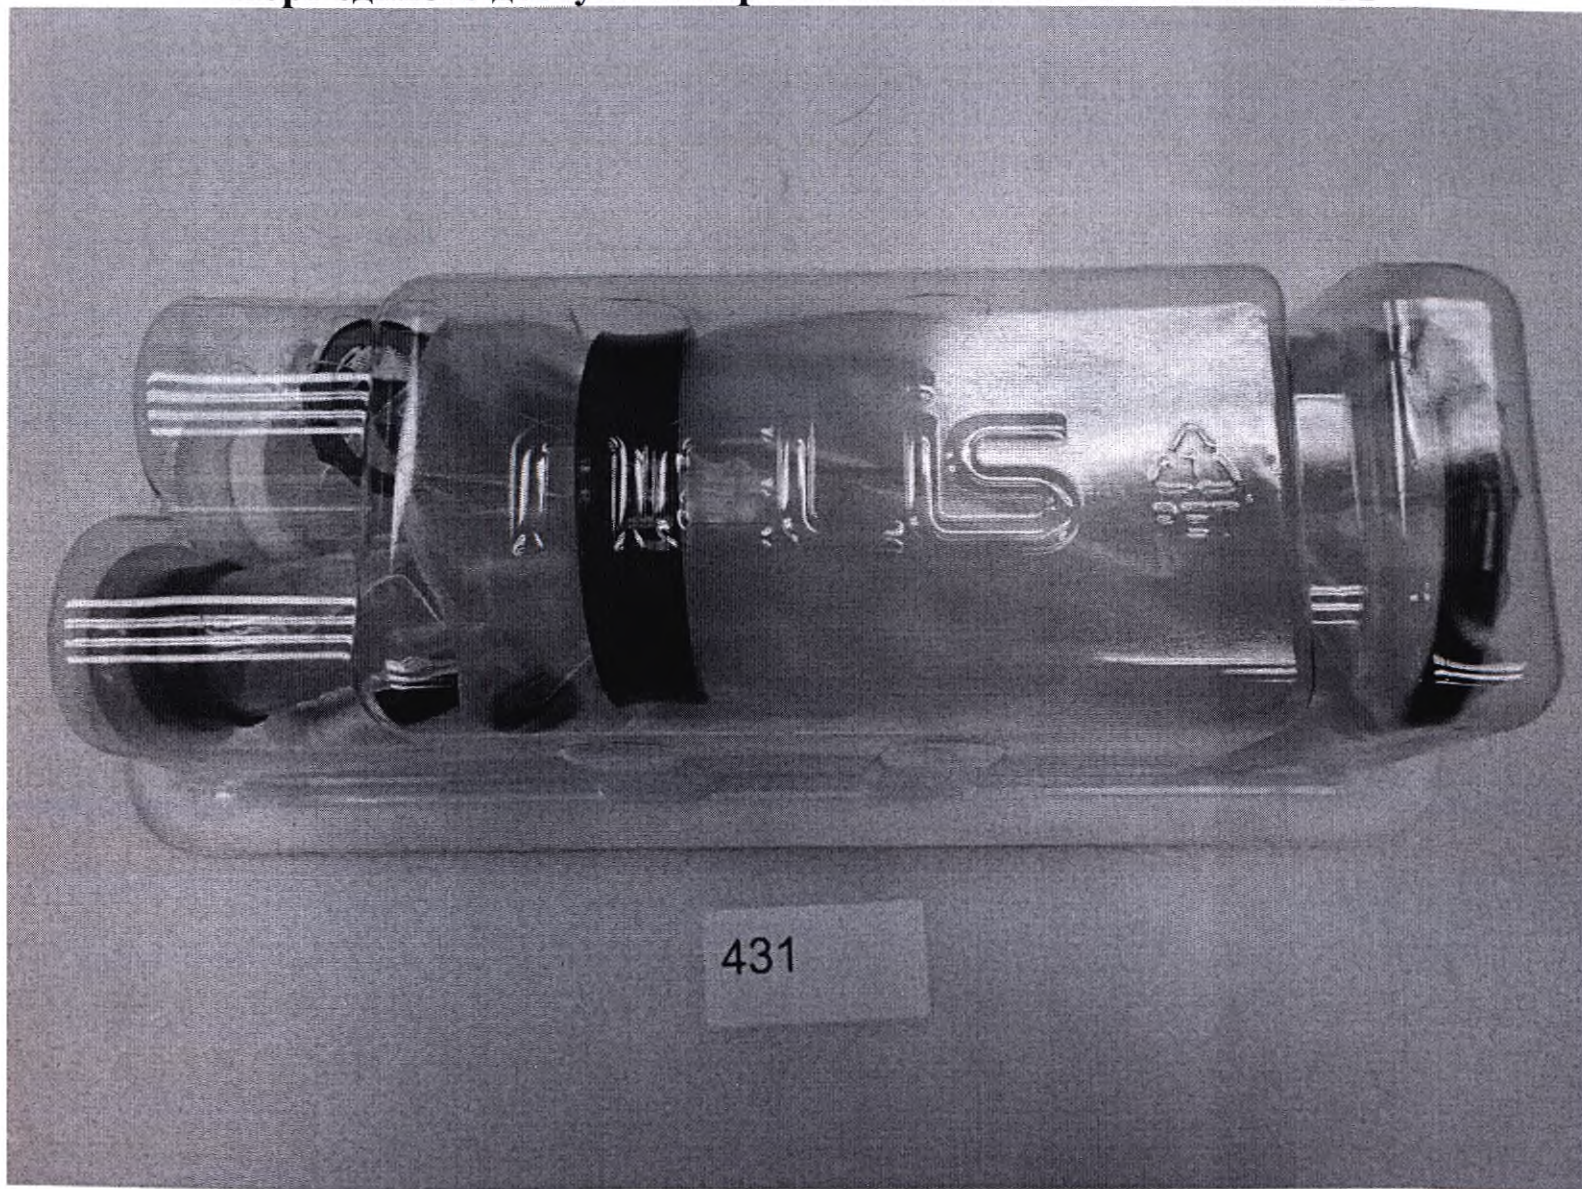

GLOVE PORT

- 1) Наименование изделия: Порт единого доступа лапароскопический.
- 2) Модель: порт лапароскопический.
- 3) Регистрационный номер № (GYEONGIN No.10-137)
- 4) Назначение: расширение области воздействия при помощи крючков, ретракторов, сепараторов и ретейнеров.
- 5) Упаковка: 1 шт.
- 6) Инструкция по эксплуатации:
 1. Выполните разрез 2,5 см в пупочной области.
 2. Сожмите пальцами внутреннее кольцо.
 3. Введите сжатое внутреннее кольцо в разрез в брюшной стенке.
 4. Закрутите внешнее кольцо порта в толще брюшной стенки и закрепите на поверхности брюшной стенки.
 5. Соедините конектор клапана с впускным клапаном газа.
 6. Отрегулируйте клапан так, чтобы чехол-ретрактор достаточно раздвинулся.
 7. Используйте различные инструменты, вводя их через инструментальные клапаны расширителя.
 8. Срежьте нижнюю часть чехла-ретрактора после операции и удалите извлеченную часть.
 9. Потяните внутреннее кольцо для извлечения порта.
- 7) ВНИМАНИЕ:
 1. Не используйте бракованное или поврежденное изделие. Не нарушайте целостность стерильной упаковки изделия.
 2. Не используйте изделие по истечению срока годности.
 3. Будьте осторожны при работе с острыми инструментами.
 4. Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву.
 5. Не используйте повторно.
 6. Утилизировать изделие в соответствии с установленными требованиями.
- 8) Изделие является медицинским.
- 9) Производитель: 1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha, Samjeong dong, Gyeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea).
- 10) Дата производства соответствует дате стерилизации.
- 11) Дата стерилизации:


Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Модель: порт лапароскопический.


Рег. Уд. ФЗС ##### от ####




■ Инструкция по применению




Выполните разрез 2,5 см в области пупка и сожмите пальцами внутреннее кольцо.



Вытяните внешнее кольцо так, чтобы внутреннее кольцо надлежало образом было расположено с внутренней стороны абдоминальной стенки.



Впускное и выпускное отверстие для газа разделены для легкого отведения газа и дыма.



Вытяните внутреннее кольцо, как показано на рисунке.

1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha, Samjeong dong, Gyeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea)

LOT
REF



NELIS New Life Start

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 431-AL



GLOVE PORT

- 1) Наименование изделия: Порт единого доступа лапароскопический.
- 2) Модель: порт лапароскопический.
- 3) Регистрационный номер № (GYEONGIN No.10-137)
- 4) Назначение: расширение области воздействия при помощи крючков, ретракторов, сепараторов и ретейнеров.
- 5) Упаковка: 1 шт.
- 6) Инструкция по эксплуатации:
 - 1.Выполните разрез 2,5 см в пупочной области.
 - 2.Сожмите пальцами внутреннее кольцо.
 3. Введите сжатое внутреннее кольцо в разрез в брюшной стенке
 - 4.Закрутите внешнее кольцо порта в толще брюшной стенки и закрепите на поверхности брюшной стенки.
 - 5.Соедините коннектор клапана с впускным клапаном газа.
 6. Отрегулируйте клапан так, чтобы чехол-ретрактор достаточно раздулся.
 - 7.Используйте различные инструменты, вводя их через инструментальные клапаны расширителя.
 - 8.Срежьте нижнюю часть чехла-ретрактора после операции и удалите извлеченную часть
 - 9.Потяните внутреннее кольцо для извлечения порта.
- 7) ВНИМАНИЕ:
 - 1.Не используйте бракованное или поврежденное изделие. Не нарушайте целостность стерильной упаковки изделия.
 - 2.Не используйте изделие по истечению срока годности.
 - 3.Будьте осторожны при работе с острыми инструментами.
 - 4.Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву.
 5. Не используйте повторно.
 - 6.Утилизируйте изделие в соответствии с установленными требованиями.
- 8) Изделие является медицинским.
- 9) Производитель: 1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha, Samjeong dong, Ojeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Корея).
- 10) Дата производства соответствует дате стерилизации.
- 11) Дата стерилизации:

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Модель: порт лапароскопический.




LOT	
REF	



1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha,
Samjeong dong, Ojeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Корея)
Рег. Уд. ФЗС ##### от ####

nelis New Life Start

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 440

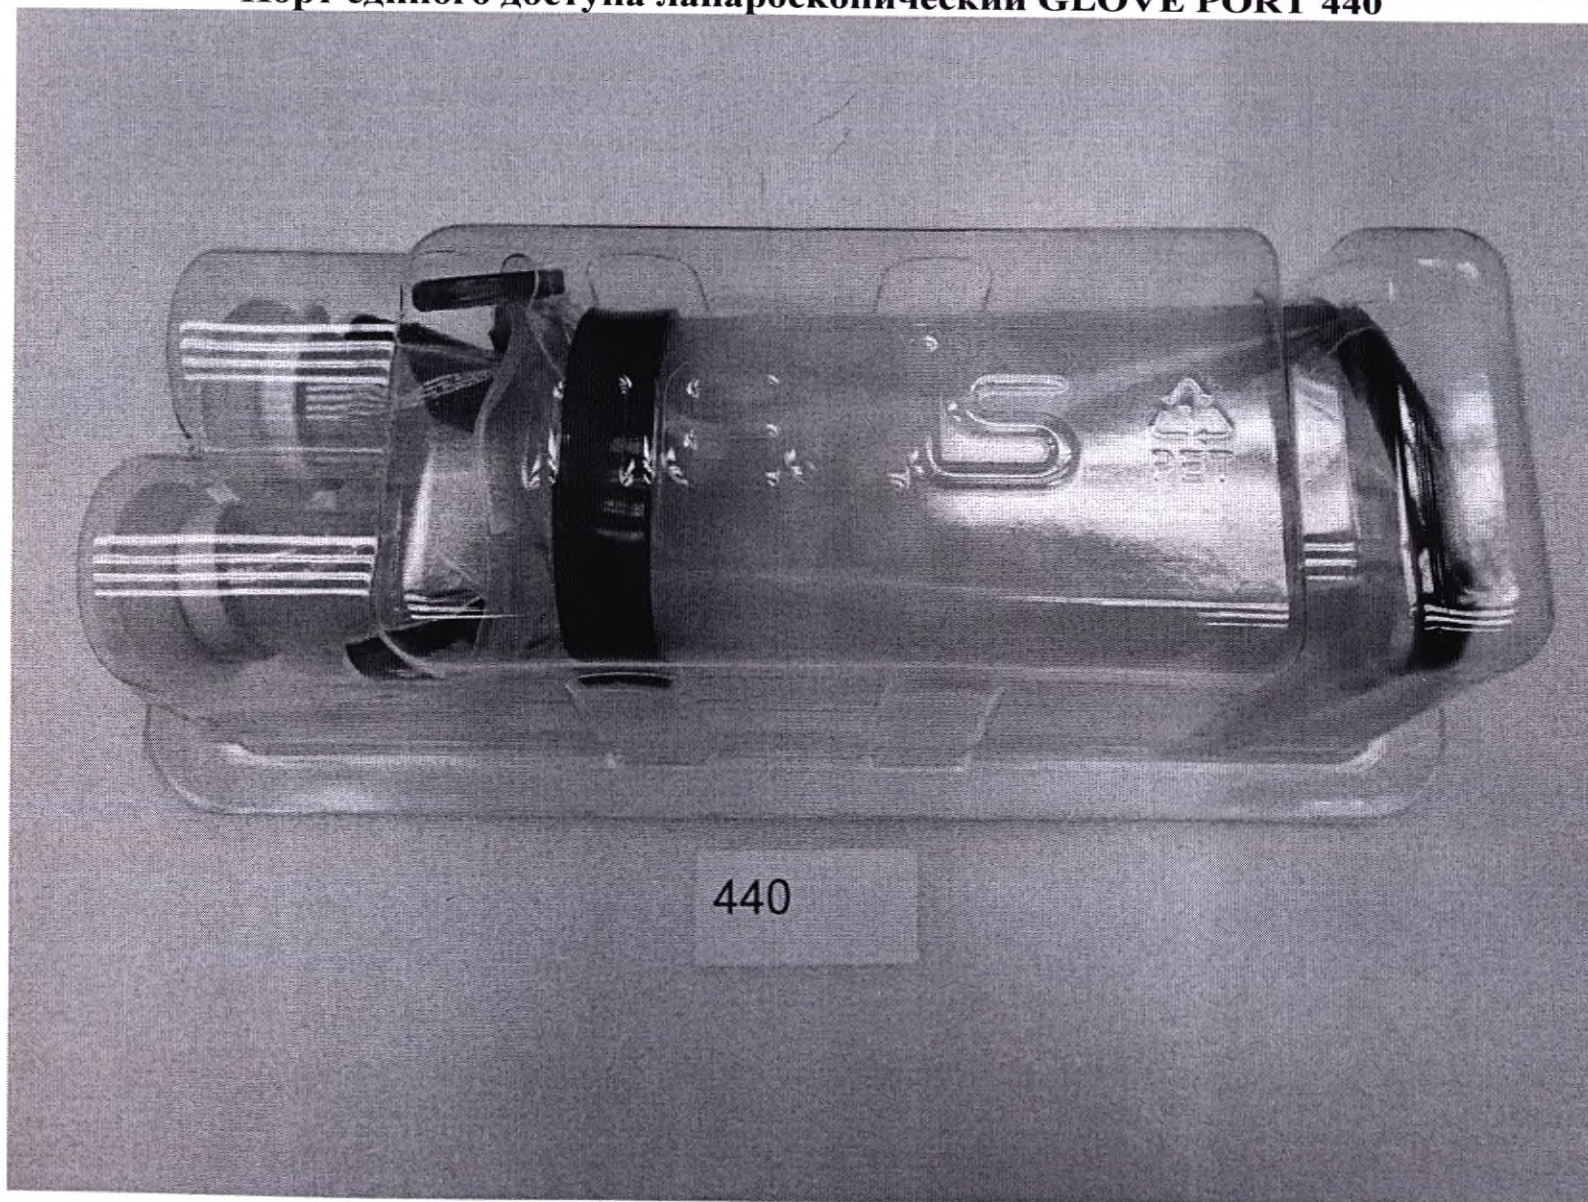


Open here
Ork post to 39600


- | | |
|---|------------------------------|
| Срок годности: 3 года с даты изготовления | Модель: морт-матрикс-мечетли |
|---|------------------------------|




■ Инструкция по применению




Выполните надрез 2,5 см в области
пупка и снимите пальцами внутреннее
кроводе.



Вытягивание внешнего кольца так, чтобы внутреннее кольцо надвигалось на образующую внутреннего кольца с внутренней стороны было расположено с внутренней стороны абдоминальной стенки.



различиями для первого отсчета газа и дыма.



Выявите внутреннее кольцо, как показано на рисунке.

1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Sangyong 3 Cha,
Samyeong-dong, Gyeongju, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea (Korea)

NEEL'S
Make the Most of Your Money

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 440-AS



GLOVE PORT

- 1) Наименование изделия: Порт единого доступа лапароскопический.
- 2) Модель: порт лапароскопический.
- 3) Регистрационный номер № (GYEONGIN No.10-137)
- 4) Назначение: расширение области воздействия при помощи крючков, ретракторов, сепараторов и ретейнеров.
- 5) Упаковка: 1 шт.
- 6) Инструкция по эксплуатации:
 - 1.Выполните разрез 2,5 см в пупочной области.
 - 2.Сожмите пальцами внутреннее кольцо.
 3. Введите сжатое внутреннее кольцо в разрез в брюшной стенке
 - 4.Закрутите внешнее кольцо порта в толще брюшной стенки и закрепите на поверхности брюшной стенки.
 - 5.Соедините коннектор клапана с впускным клапаном газа.
 6. Отрегулируйте клапан так, чтобы чехол-ретрактор достаточно раздулся.
 - 7.Используйте различные инструменты, вводя их через инструментальные клапаны расширителя.
 - 8.Срежьте нижнюю часть чехла-ретрактора после операции и удалите извлеченную часть
 - 9.Потяните внутреннее кольцо для извлечения порта.
- 7) ВНИМАНИЕ:
 - 1.Не используйте бракованное или поврежденное изделие. Не нарушайте целостность стерильной упаковки изделия.
 - 2.Не используйте изделие по истечению срока годности.
 - 3.Будьте осторожны при работе с острыми инструментами.
 - 4.Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву.
 5. Не используйте повторно.
 - 6.Утилизируйте изделие в соответствии с установленными требованиями.
- 8) Изделие является медицинским.
- 9) Производитель: 1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha, Samjeong dong, Ojeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Корея).
- 10) Дата производства соответствует дате стерилизации.
- 11) Дата стерилизации:

LOT	
REF	

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.


Модель: порт лапароскопический.



1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha,
Samjeong dong, Ojeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea)
Per. Уд. ФЗС ##### от ####

NELIS New Life Start

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 550-AM

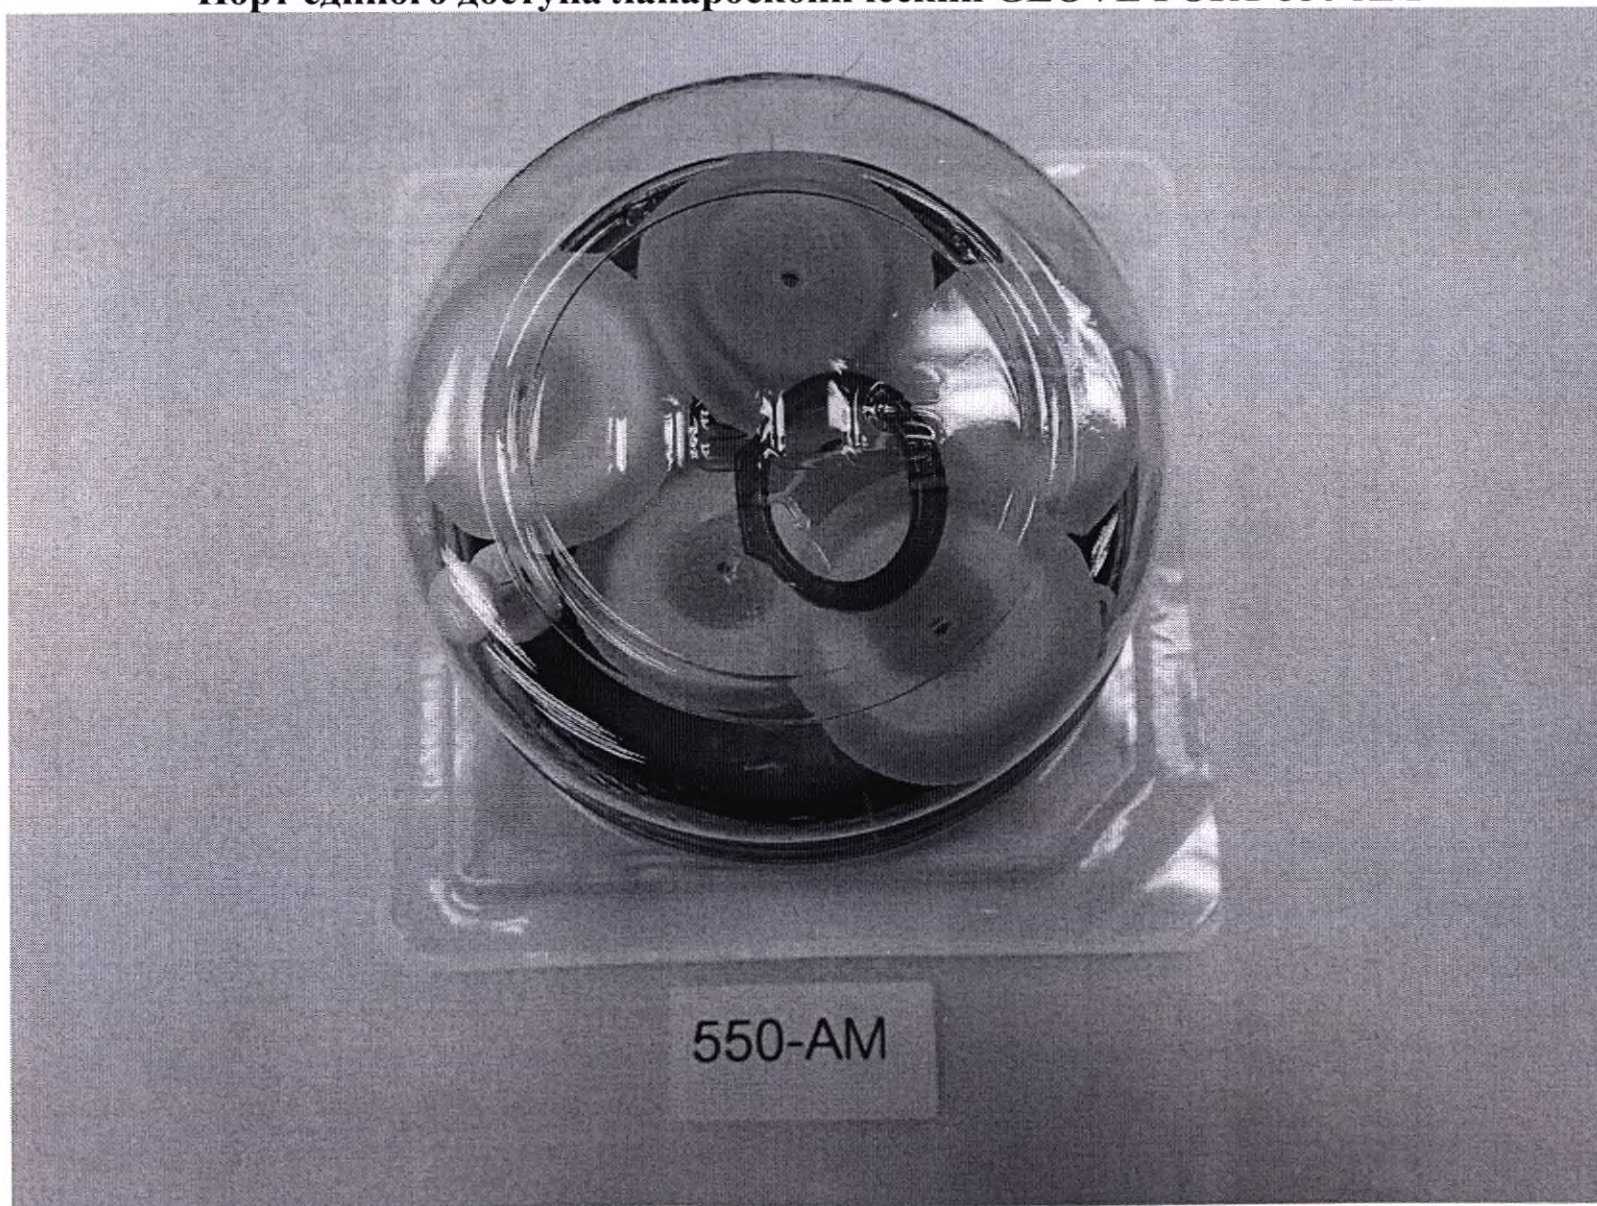

GLOVE PORT

- 1) Наименование изделия: Порт единого доступа лапароскопический.
 - 2) Модель: порт лапароскопический.
 - 3) Регистрационный номер № (GYEONGIN No.10-137)
 - 4) Назначение: расширение области воздействия при помощи крючков, ретракторов, сепараторов и ретейнеров.
 - 5) Упаковка: 1 шт.
 - 6) Инструкция по эксплуатации:
 1. Выполните разрез 2,5 см в пупочной области.
 2. Сожмите пальцами внутреннее кольцо.
 3. Введите сжатое внутреннее кольцо в разрез в брюшной стенке
 4. Закрутите внешнее кольцо порта в толще брюшной стенки и закрепите на поверхности брюшной стенки.
 5. Соедините коннектор клапана с впускным клапаном газа.
 6. Отрегулируйте клапан так, чтобы чехол-ретрактор достаточно раздулся.
 7. Используйте различные инструменты, вводя их через инструментальные клапаны расширителя.
 8. Срежьте нижнюю часть чехла-ретрактора после операции и удалите извлеченную часть
 9. Потяните внутреннее кольцо для извлечения порта.
 - 7) ВНИМАНИЕ:
 1. Не используйте бракованное или поврежденное изделие. Не нарушайте целостность стерильной упаковки изделия.
 2. Не используйте изделие по истечению срока годности.
 3. Будьте осторожны при работе с острыми инструментами.
 4. Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву.
 5. Не используйте повторно.
 6. Утилизируйте изделие в соответствии с установленными требованиями.
 - 8) Изделие является медицинским.
 - 9) Производитель: 1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha, Samjeong dong, Ojeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea).
 - 10) Дата производства соответствует дате стерилизации.
 - 11) Дата стерилизации:
- | | |
|---|--|
| LOT | |
| REF | |
|  | |

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Модель:	порт лапароскопический.
---------	-------------------------




Open here

1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha,
Samjeong-dong, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea (Korea)
Per. Уд. Ф3С ##### ст #####

NELIS New Life Store

Порт единого доступа лапароскопический GLOVE PORT 633-AL

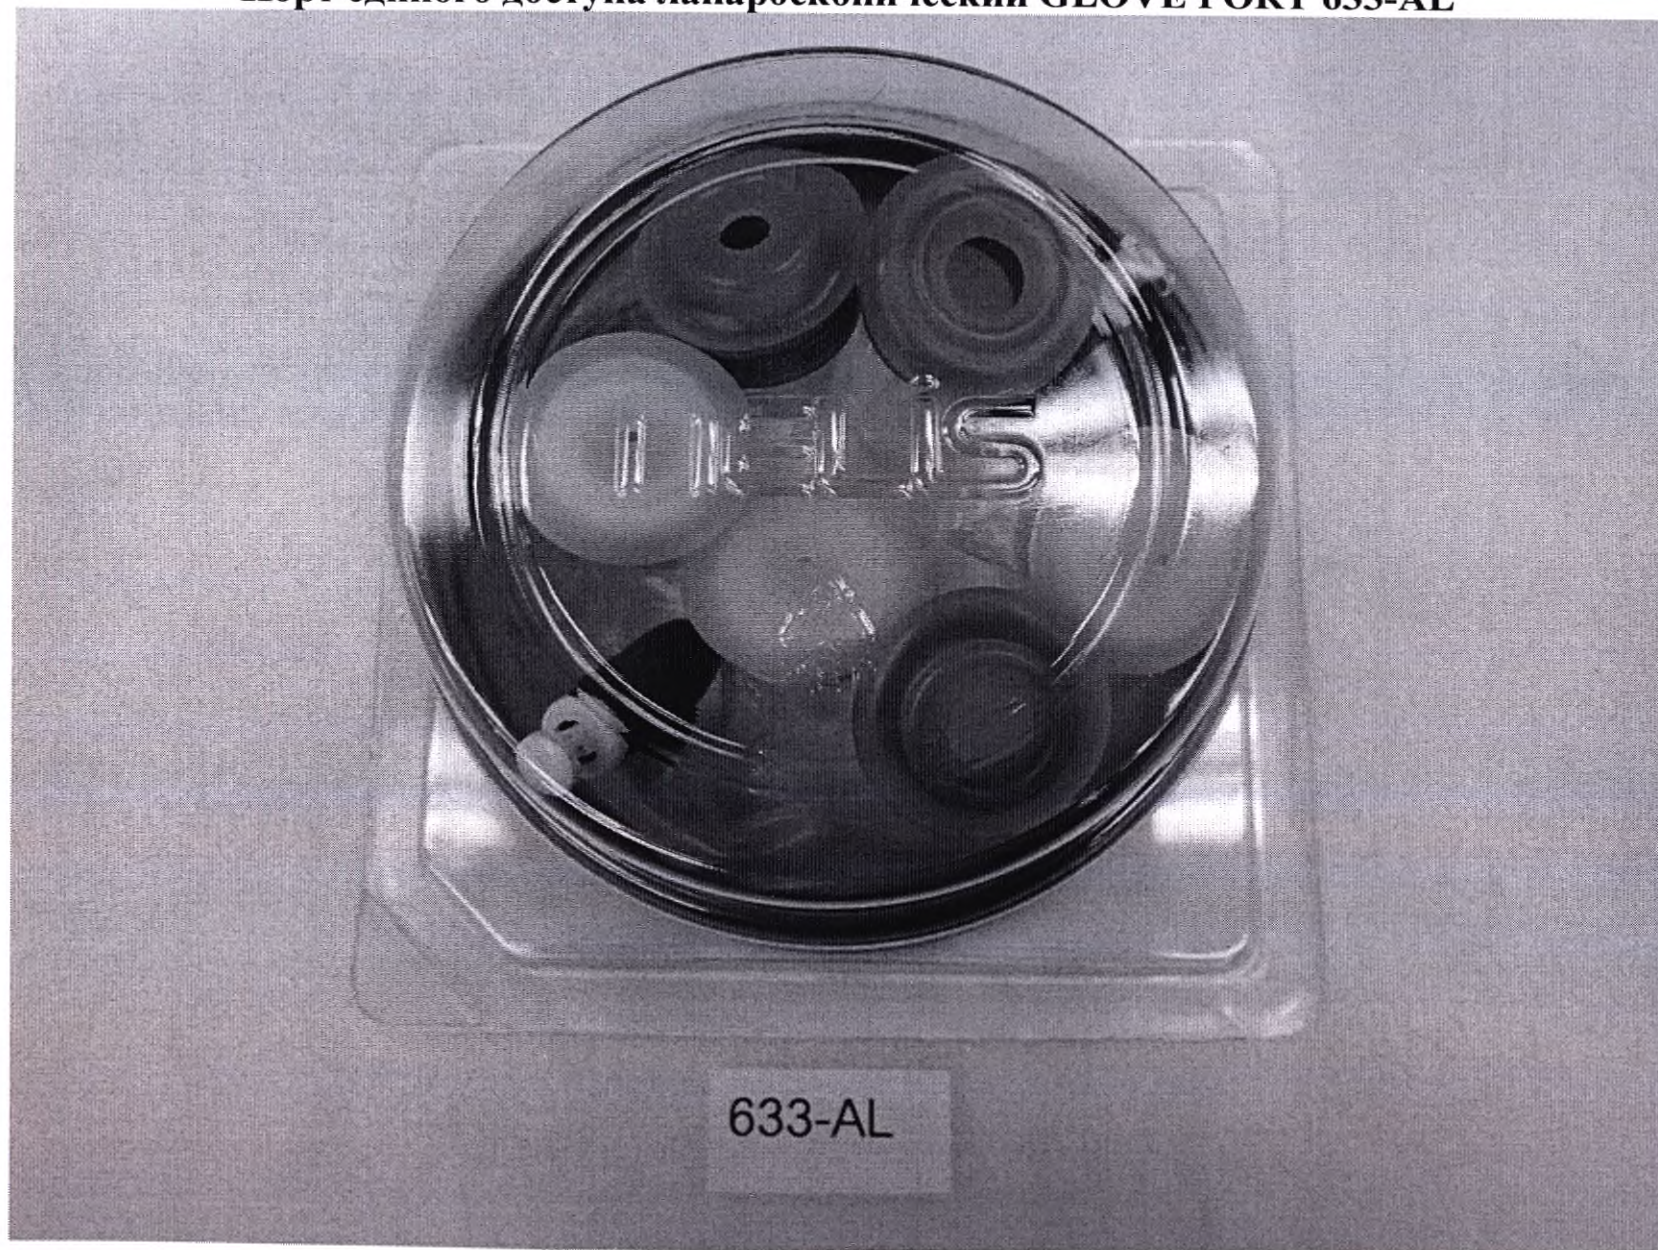

GLOVE PORT

- 1) Наименование изделия: Порт единого доступа лапароскопический.
- 2) Модель: порт лапароскопический.
- 3) Регистрационный номер № (GYEONGIN No.10-137)
- 4) Назначение: расширение области воздействия при помощи крючков, ретракторов, сепараторов и ретейнеров.
- 5) Упаковка: 1 шт.
- 6) Инструкция по эксплуатации:
 1. Выполните разрез 2,5 см в пупочной области.
 2. Сожмите пальцами внутреннее кольцо.
 3. Введите сжатое внутреннее кольцо в разрез в брюшной стенке
 4. Закрутите внешнее кольцо порта в толще брюшной стенки и закрепите на поверхности брюшной стенки.
 5. Соедините коннектор клапана с впускным клапаном газа.
 6. Отрегулируйте клапан так, чтобы чехол-ретрактор достаточно раздулся.
 7. Используйте различные инструменты, вводя их через инструментальные клапаны расширителя.
 8. Срежьте нижнюю часть чехла-ретрактора после операции и удалите извлеченную часть
 9. Потяните внутреннее кольцо для извлечения порта.
- 7) ВНИМАНИЕ:
 1. Не используйте бракованное или поврежденное изделие. Не нарушайте целостность стерильной упаковки изделия.
 2. Не используйте изделие по истечению срока годности.
 3. Будьте осторожны при работе с острыми инструментами.
 4. Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву.
 5. Не используйте повторно.
 6. Утилизируйте изделие в соответствии с установленными требованиями.
- 8) Изделие является медицинским.
- 9) Производитель: 1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha, Samjeong dong, Ojeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea).
- 10) Дата производства соответствует дате стерилизации.
- 11) Дата стерилизации:

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Модель: порт лапароскопический.

LOT	
REF	



1005, 201 Dong Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha,
Samjeong dong, Ojeong gu, Bucheon si, Gyeonggi do, Korea (Korea)
Per. Уд. ФЗС ##### от #####

NELIS New Life Start

Принято и
подписано 29 января
Генерального директора
Редченко Иван Сергеевич

