


Ультразвуковой прибор для диагностики околоносовых пазух «Ангиодин-Лор»



1. Электронный блок «Ангиодин-Лор» БМАР.469146.034






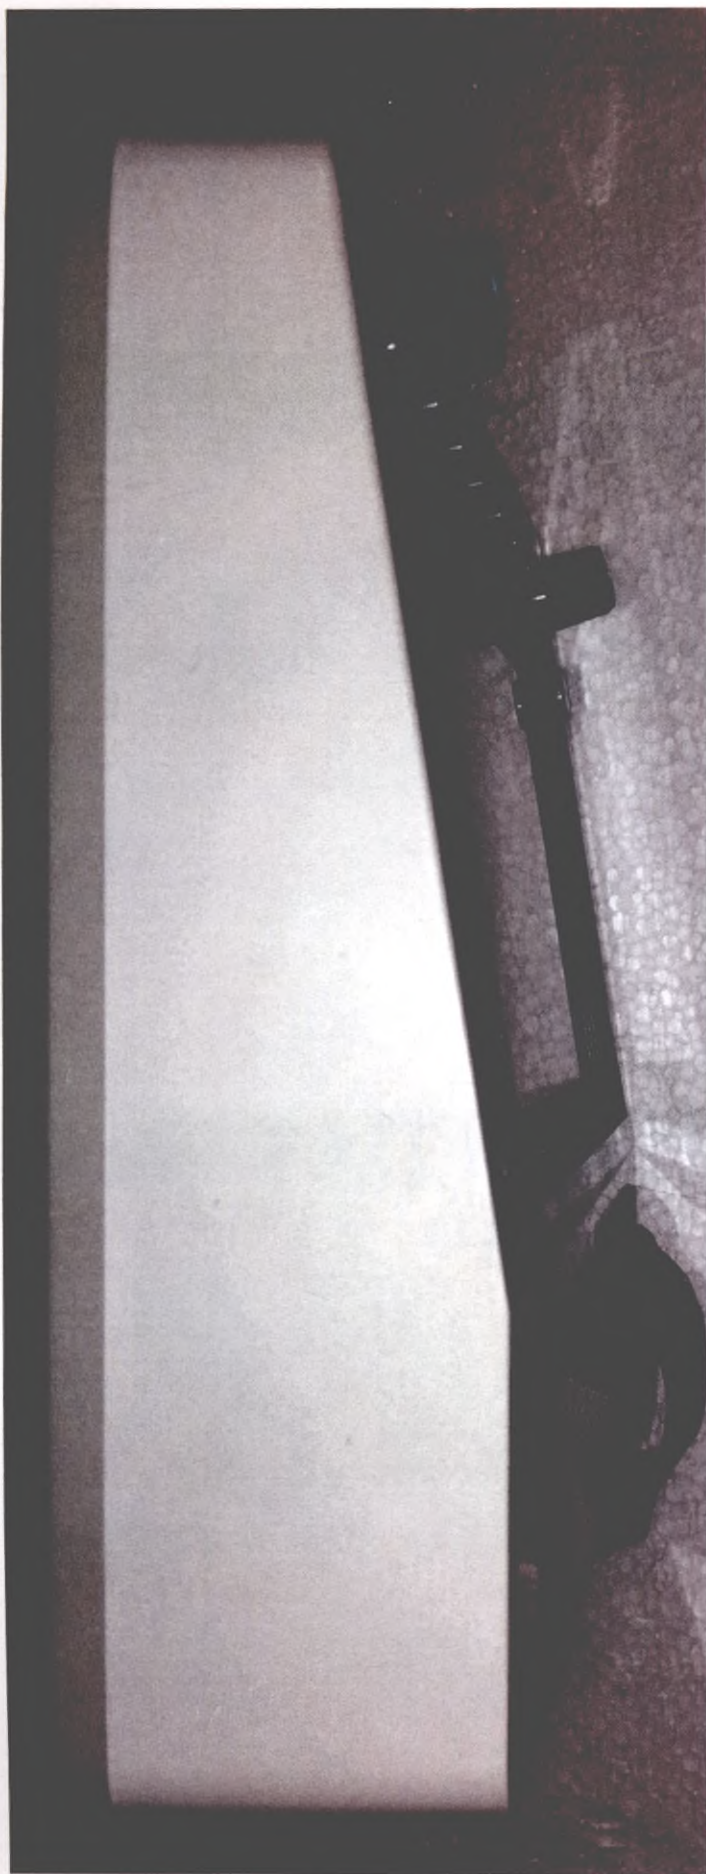

2. Источник питания сетевой AFM45US12C2, XP Power, Китай



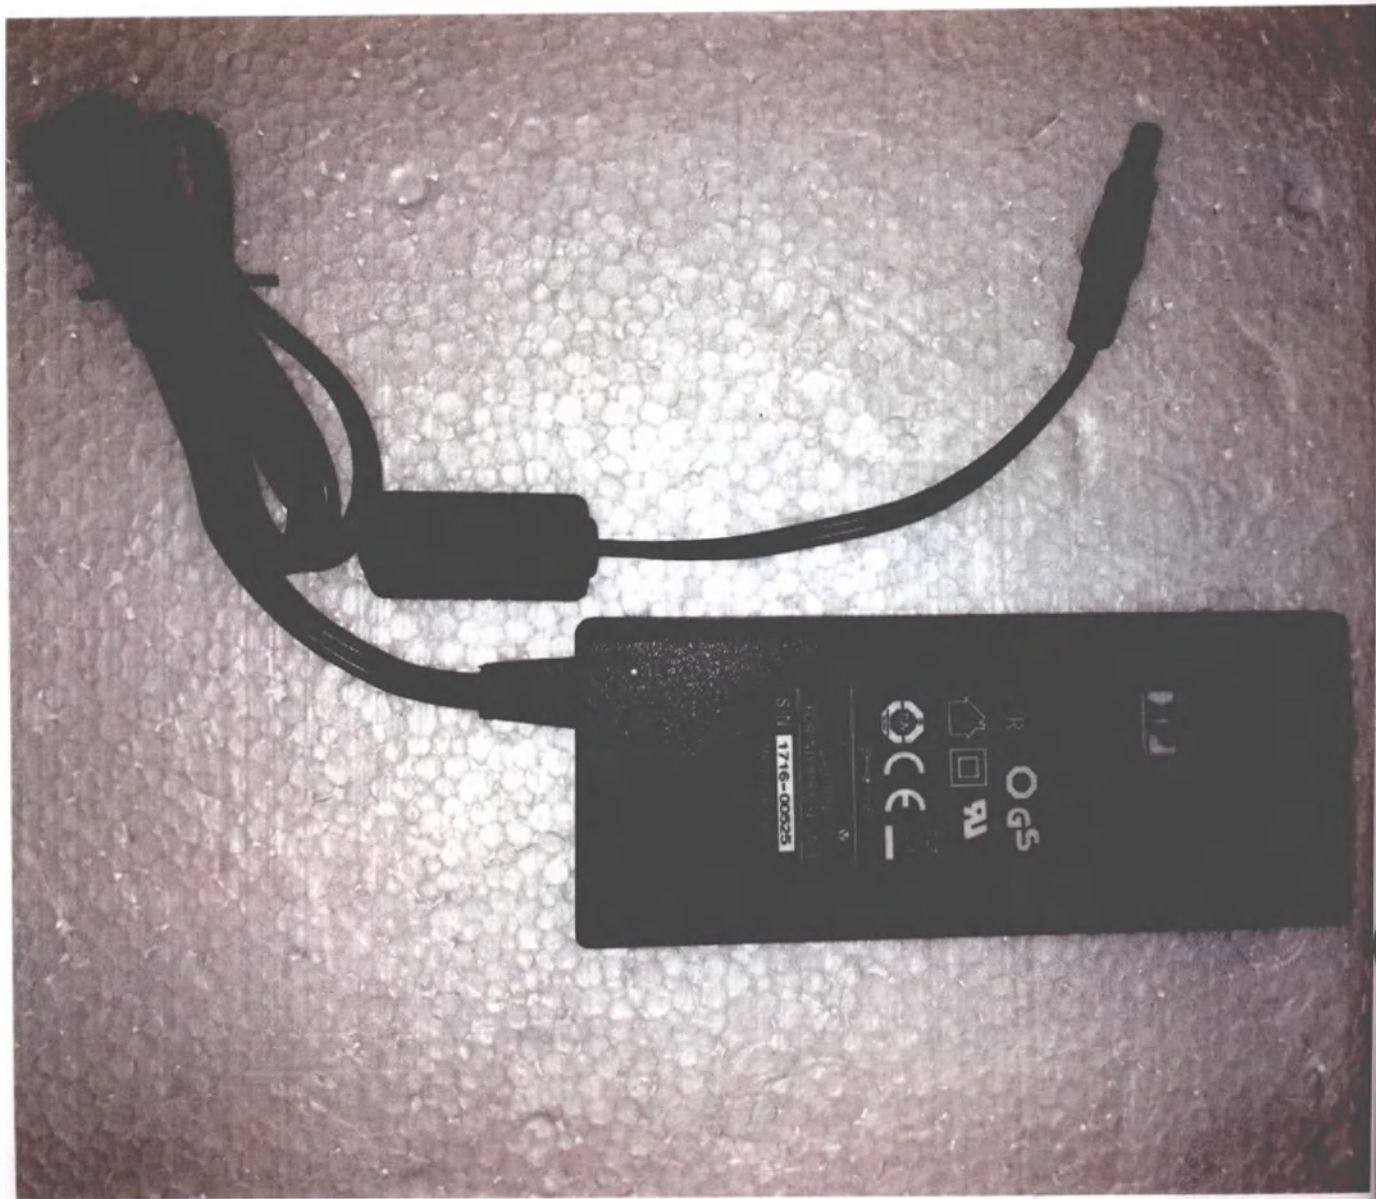

3. Кабель питания 220 В, 1,8 м, XVI-H03VVH2F2x075-C7/1,8m, Feller GMBH, Австрия




4. Ультразвуковой зонд 3 МГц 07.0000.01, Medizintechnik Basler AG, Швейцария



5. Ультразвуковой зонд 5 МГц 02.0169.0505.01, Medizintechnik Basler AG, Швейцария



6. Переключатель ножной одиночный Р1 БМАР.943139.003

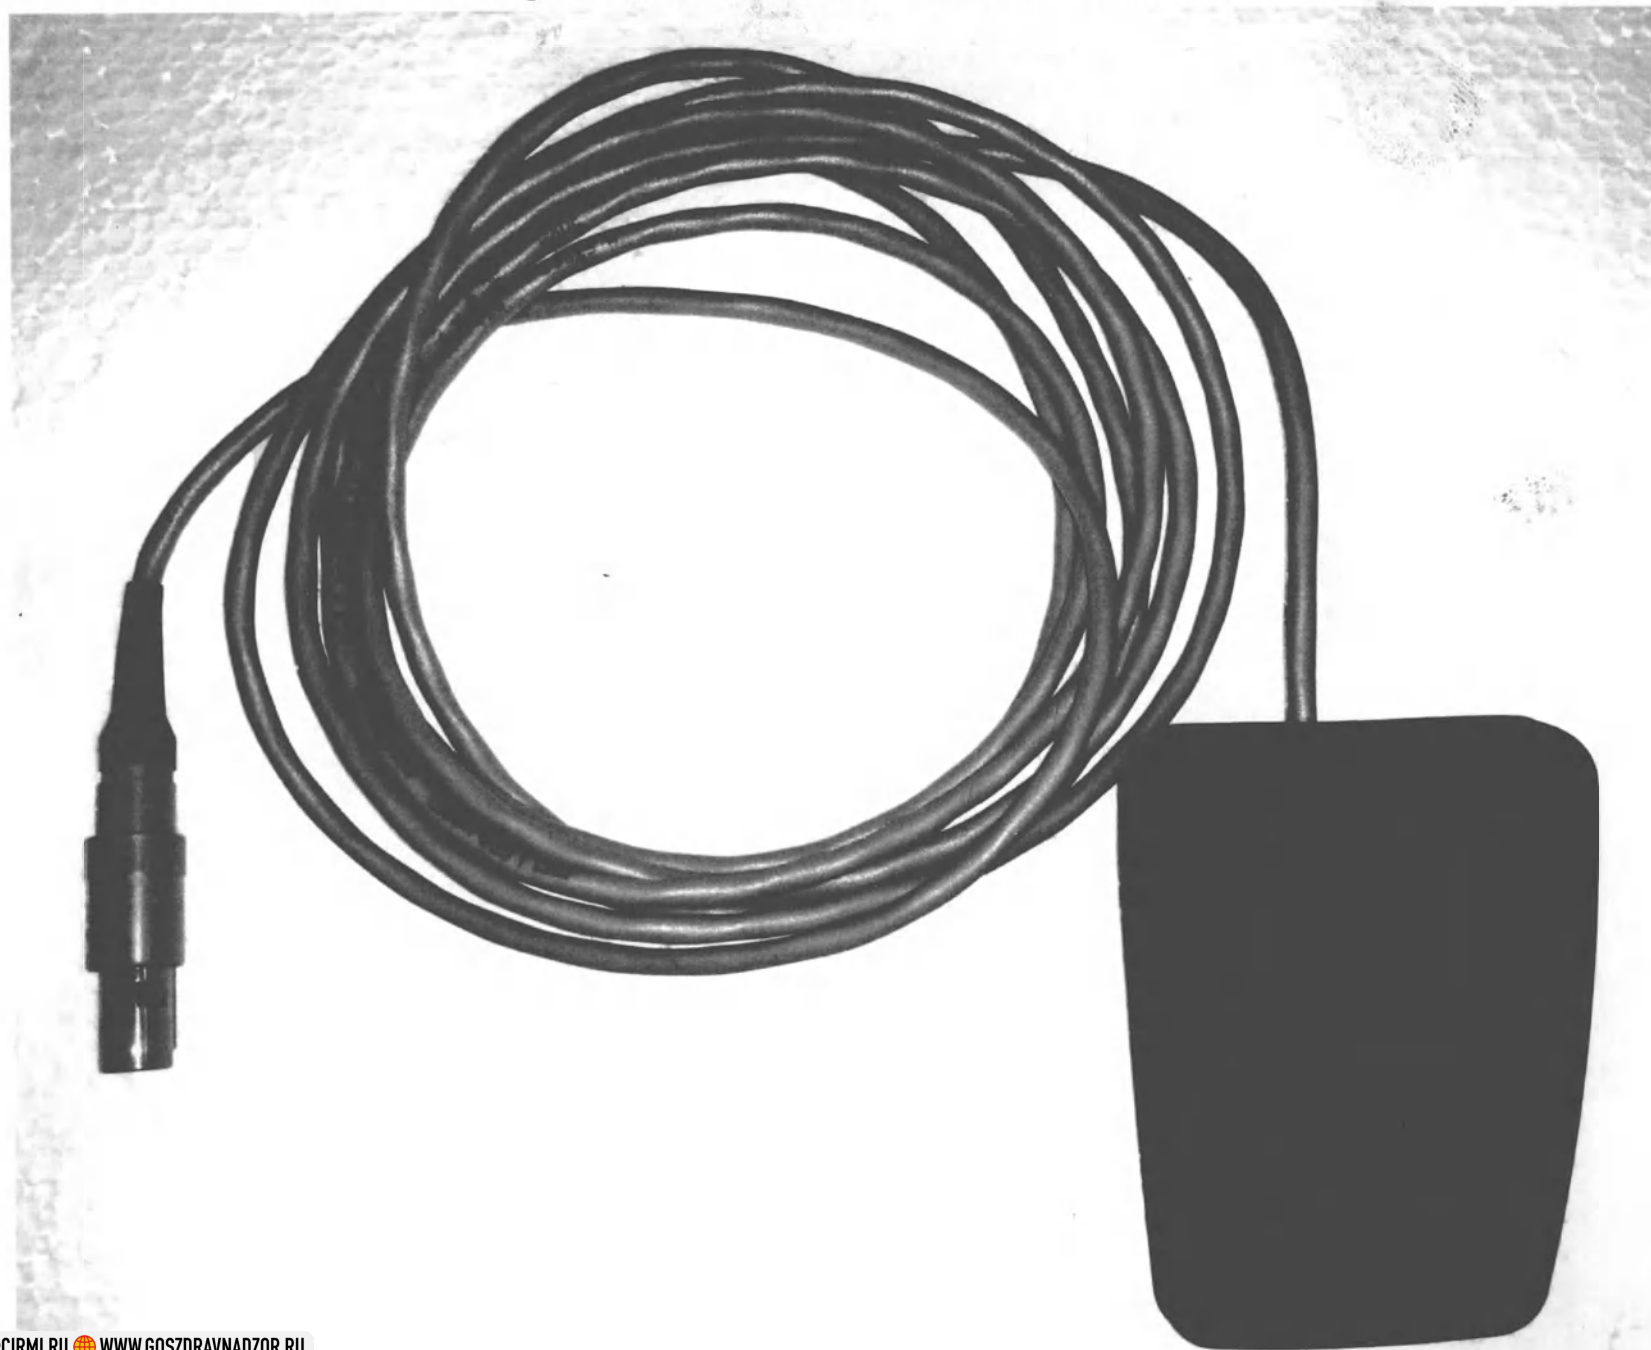



7. Термобумага 57 мм x Ø30 мм, 10 м



БИСС

АНГИОДИН-ЛОР

Термобумага 57 x Ø 30 мм, 10 м

REF

62002

LOT

A19-1020

8. Транспортная упаковка



Температура		Влажность	
Хранение	Транспортирование	Хранение	Транспортирование
10°C	35°C	20%	80%
0°C	45°C	10%	95%

БИОСС Ультразвуковой прибор для диагностики окопных пазух «Ангиодин-Пор» по ТУ 26.60.12-020-17201375-2018		
АО «НПФ «БИОСС» 124489, Россия, г. Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1 www.bloss.ru		
Масса	Брутто 3,0 кг Нetto 2,5 кг	Сделано в России

ОСТОРОЖНО!

Литий-полимерная батарея внутри!
Обращаться осторожно!
Пожароопасна при повреждении!
При повреждении упаковки
изолируйте батарею. Дальнейшее
транспортирование запрещено!
Для получения дополнительной
информации обратитесь к
производителю:

АО «НПФ «БИОСС»
124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград,
Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
www.bloss.ru

Пронумеровано, прошито **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**
скреплено печатью на **13 АО «НПФ «БЮСС»**
триста девяносто листах **И.И. БИЛИН**

