




Фотографии медицинского изделия
Система универсальная рентгенографическая
диагностическая «УнивеРС-МТ»,
производства АО «МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия.

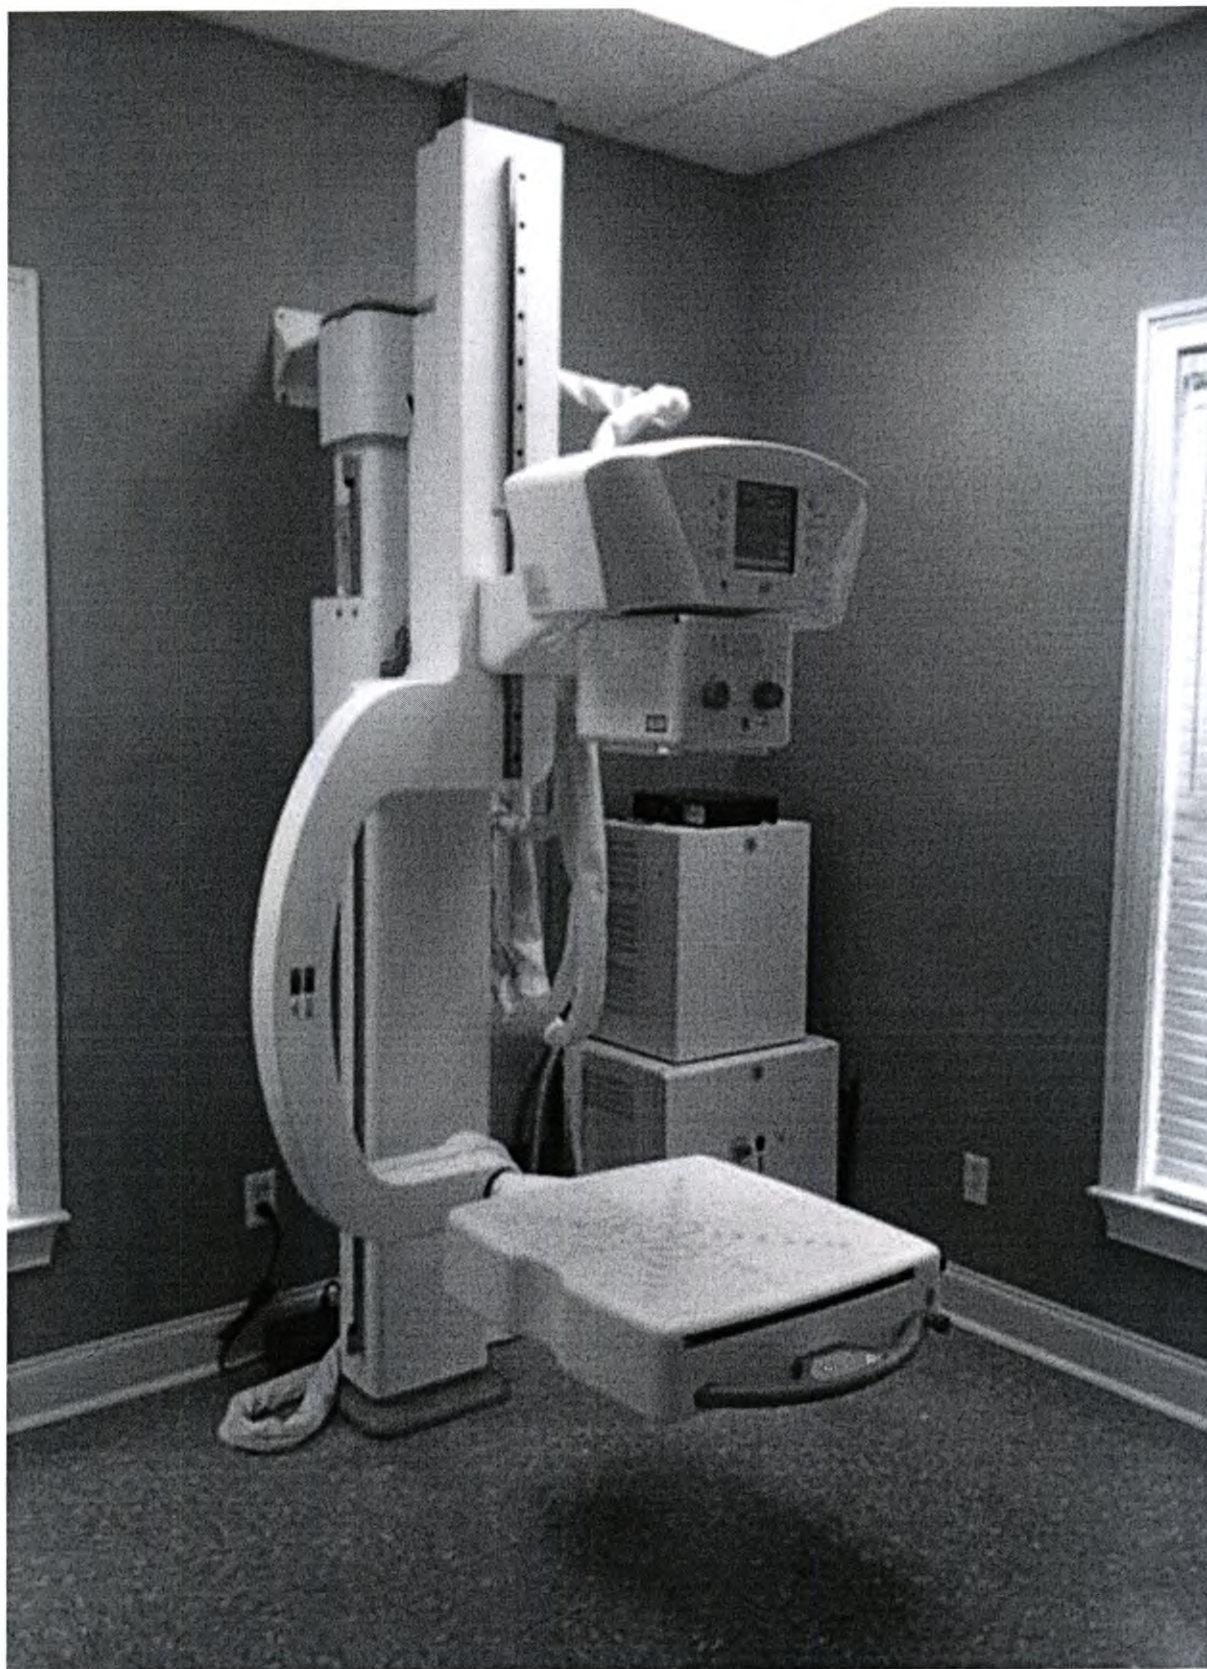


**Система универсальная рентгенографическая
диагностическая «УнивеРС-МТ», производства
АО «МТЛ», Россия**

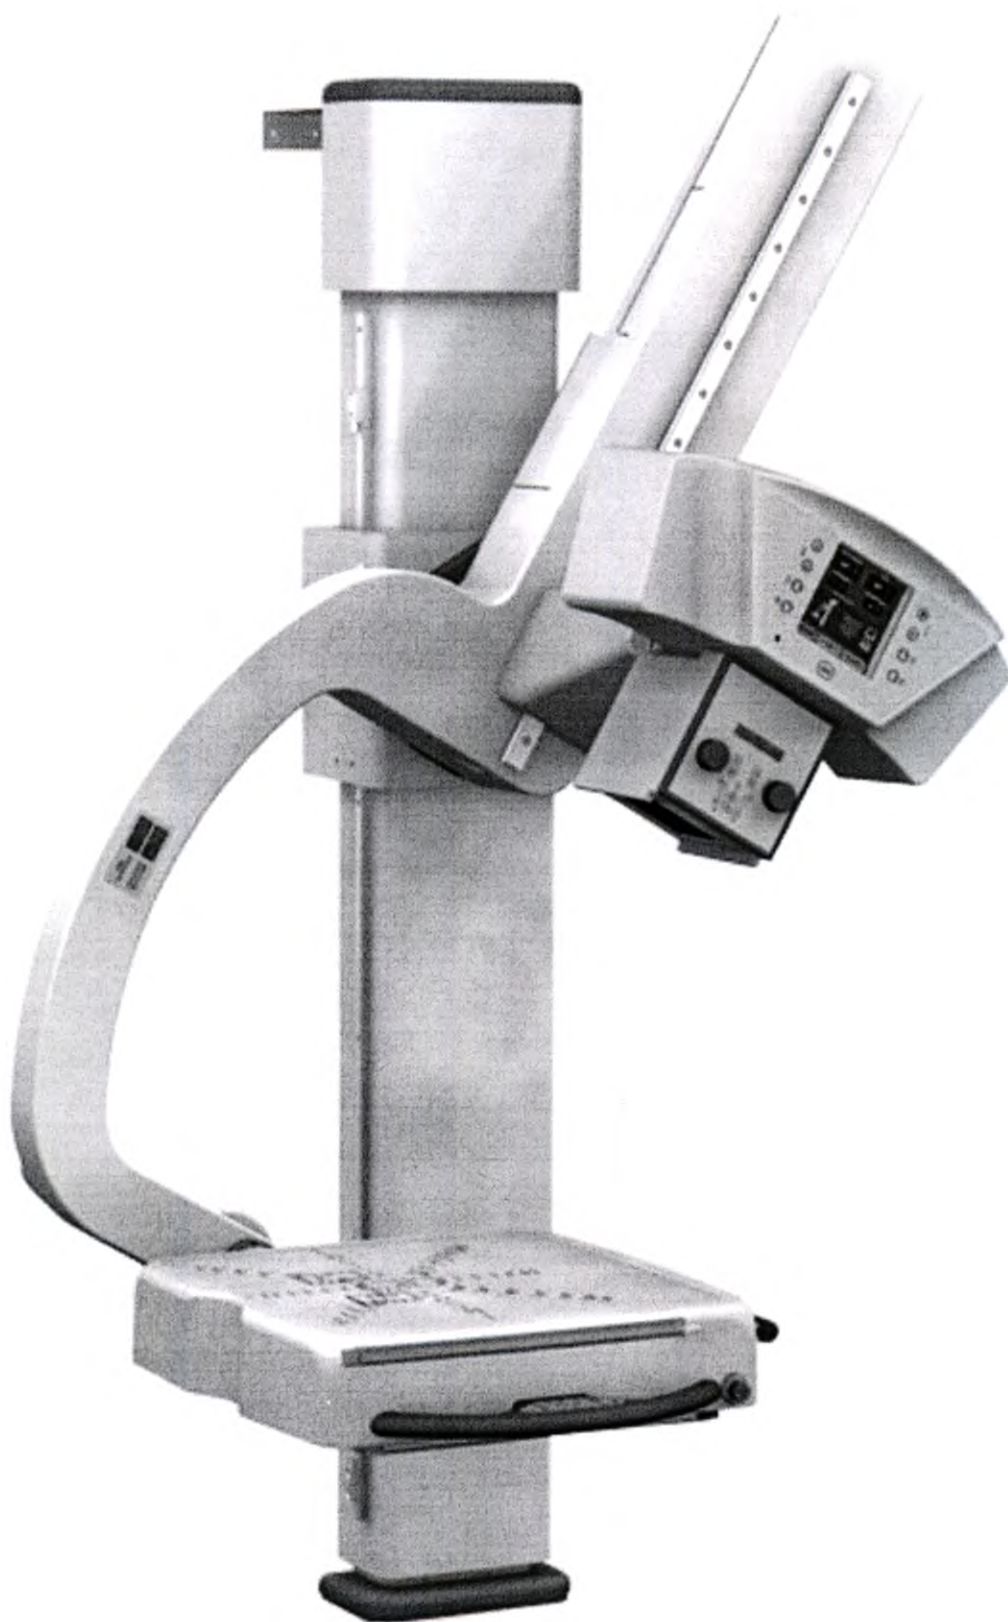


Универсальный рентгенографический штатив с блоком управления, производства фирмы Sedecal S.A., Испания

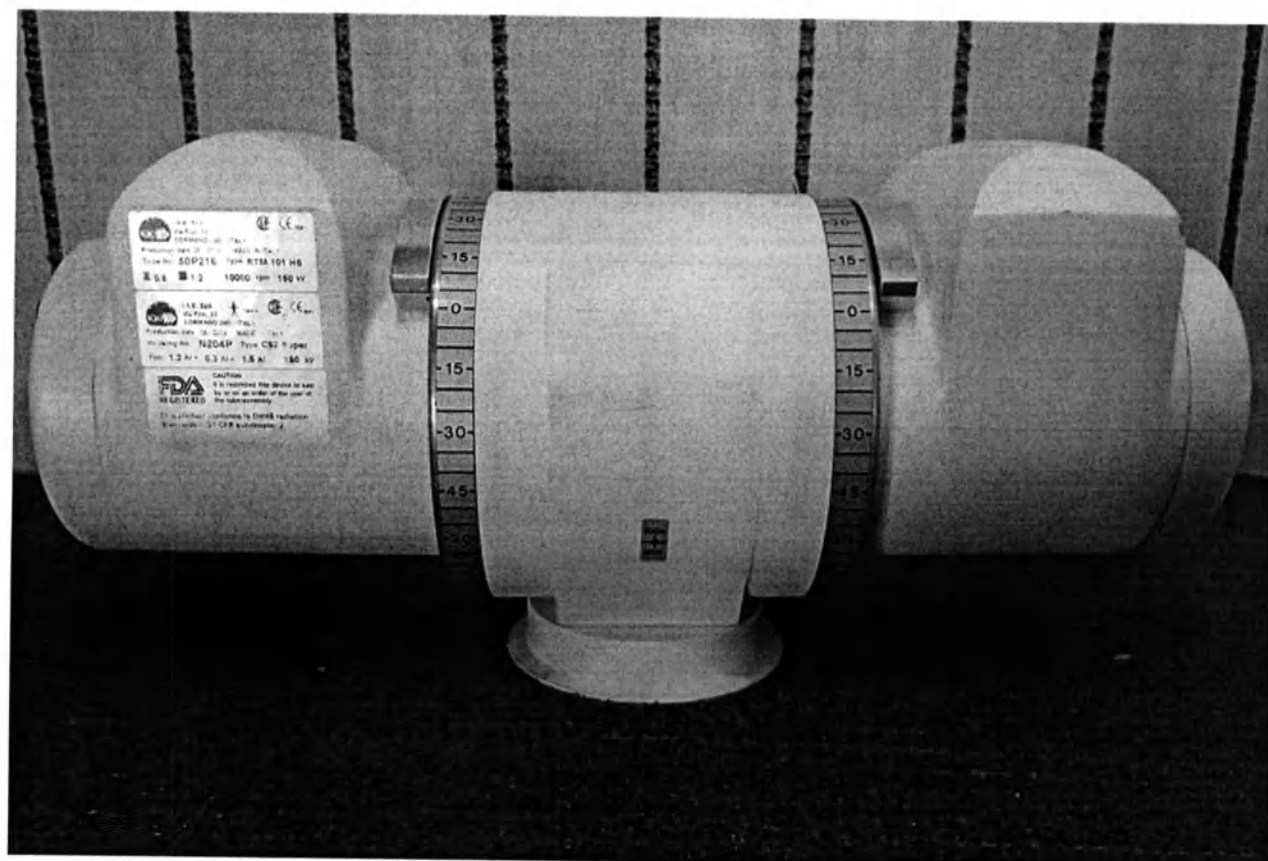

Излучатель рентгеновский типа C52 с рентгеновской трубкой X42,
X50, RTM782, RTM78HS, RTM782H, RTM782HS, RTM101H,
RTM101HS, RTM102HS, RTM102H, RTC600, RTC600HS, RTC700,
RTC700HS, RTC1200, RTC1200HS, производства фирмы I.A.E.
S.p.a., Италия.

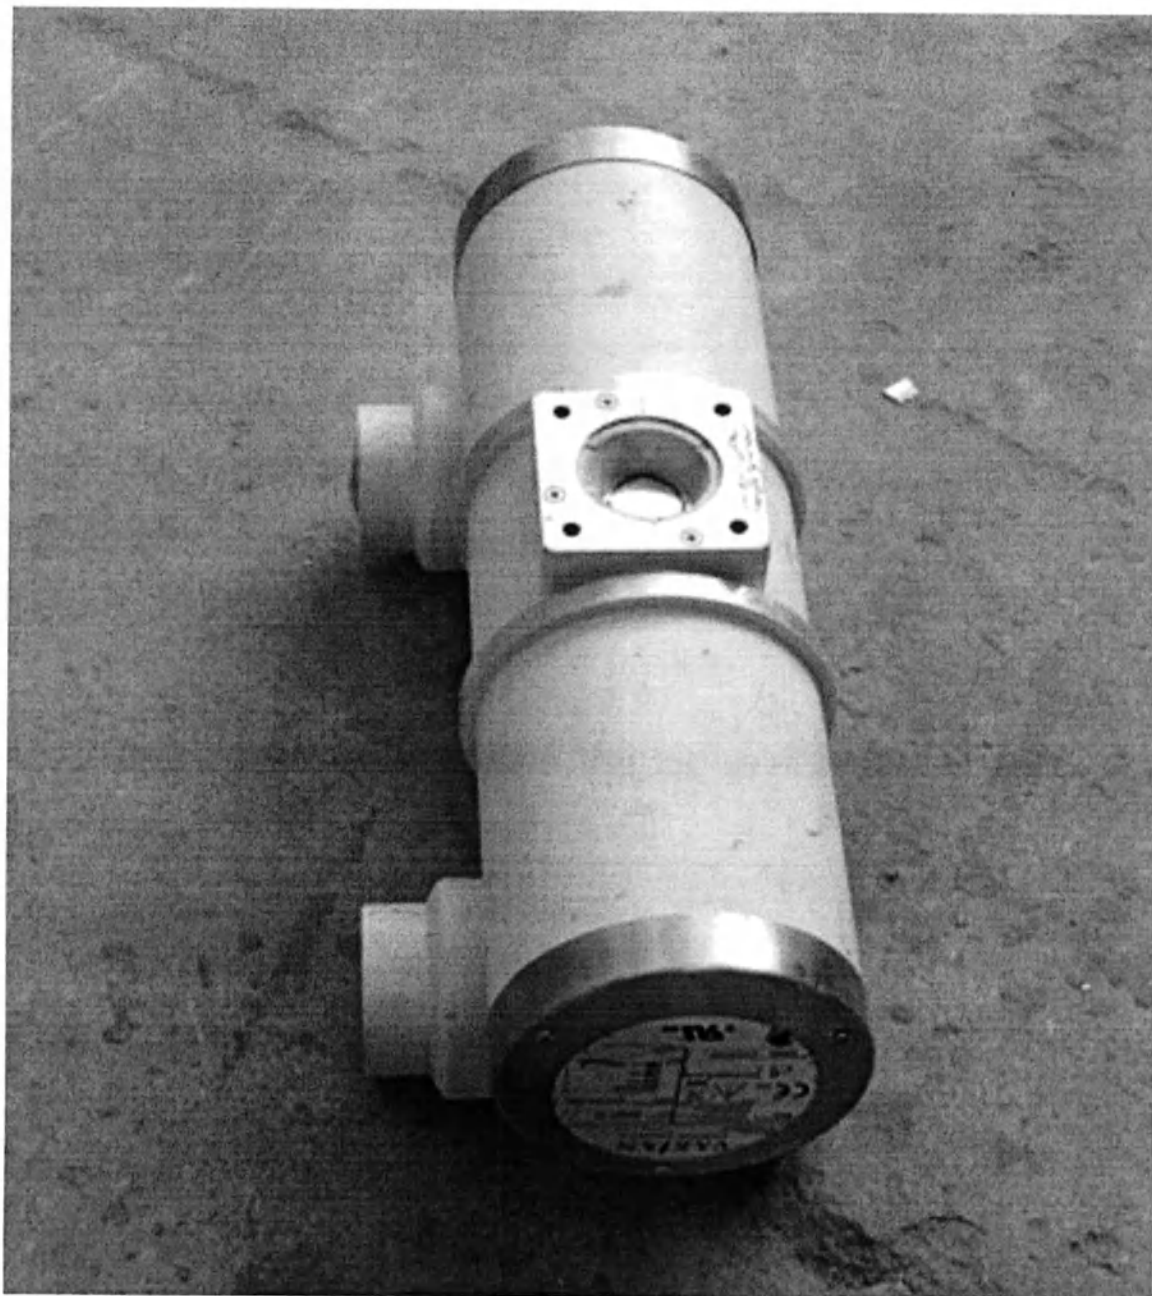

Излучатель рентгеновский типа C52 с рентгеновской трубкой RAD-8, RAD-10, RAD-12, RAD-13, RAD-14, RAD-21, RAD-44, RAD-56, RAD-60, RAD-68, RAD-74, RAD-92, Rad-94, A-102, A-132, A-134 Grid, A-144 Grid, A-145, производства фирмы Varian, США.

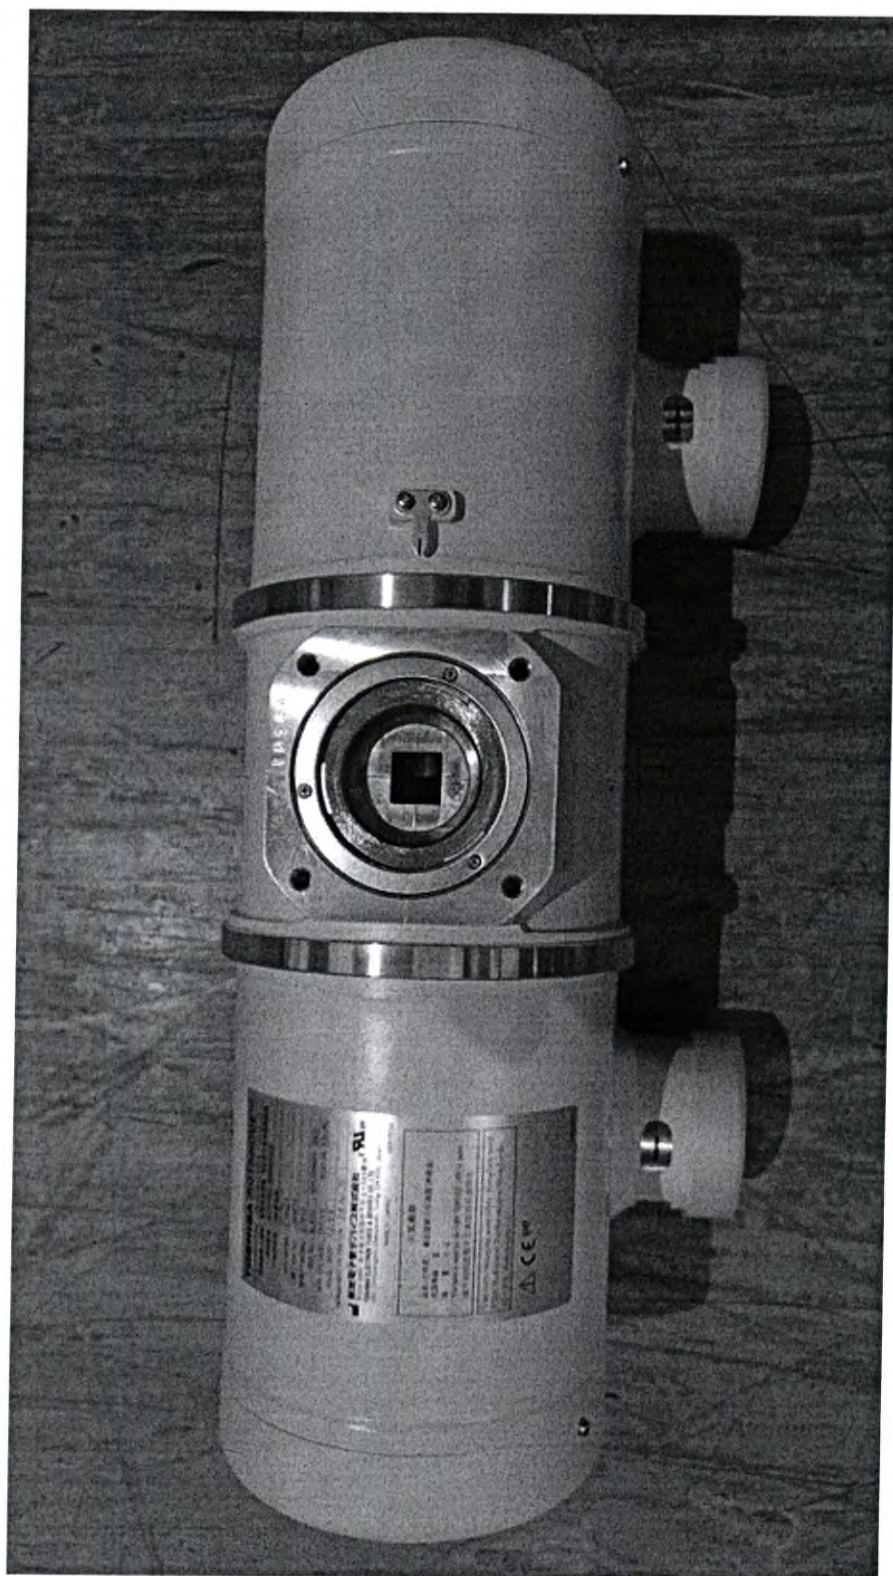

Излучатель рентгеновский типа C52 с рентгеновской трубкой E7239X, E7242X, E7843, E7252X, E7254X, E7254FX, E7869X, E7876X, E7884X, производства Canon Electron Tubes&Devices Co., Ltd., Япония.




ИК пульт дистанционного управления рентгенографическим штативом, производства фирмы Sedecal S.A., Испания




Растр отсеивающий, производства фирмы JPI Healthcare Co., Южная
Корея, варианты исполнения:

- JPI FD140cm 70 L/cm R17
- JPI FD100cm 80 L/cm R10
- JPI FD 100 (или120, или140, или 180) cm 80L/cm R12
- JPI FD 130 cm 85 L/cm R8
- JPI FD 100 (или 140) cm L/Inch R12
- JPI FD 130 cv 215 L/Inch R8
- JPI FD 130 cm 230 L/Inch R8
- JPI FD 120-180 cm 230 L/Inch R8
- JPI FD 120-180 cm 230 L/Inch R10
- JPI FD 100 (или120, или140, или 180) cm 90L/cm R12
- JPI FD 130 cm 90L/cm R12


На изображении представлен растр JPI FD140cm 70 L/cm R17

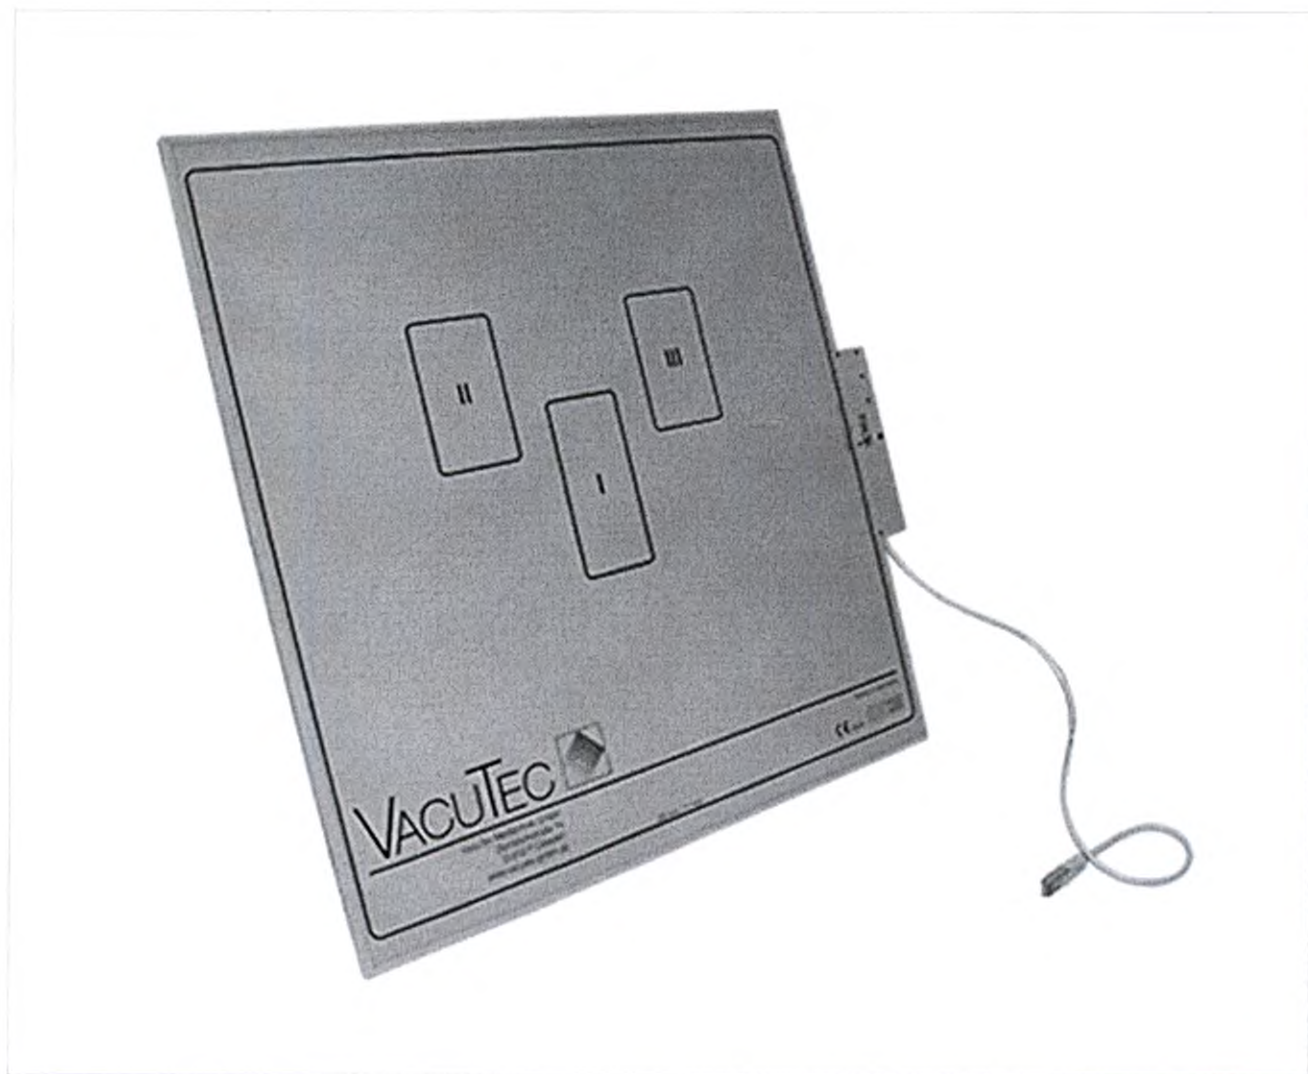

Ионизационная камера производства фирмы VACUTEC, Германия

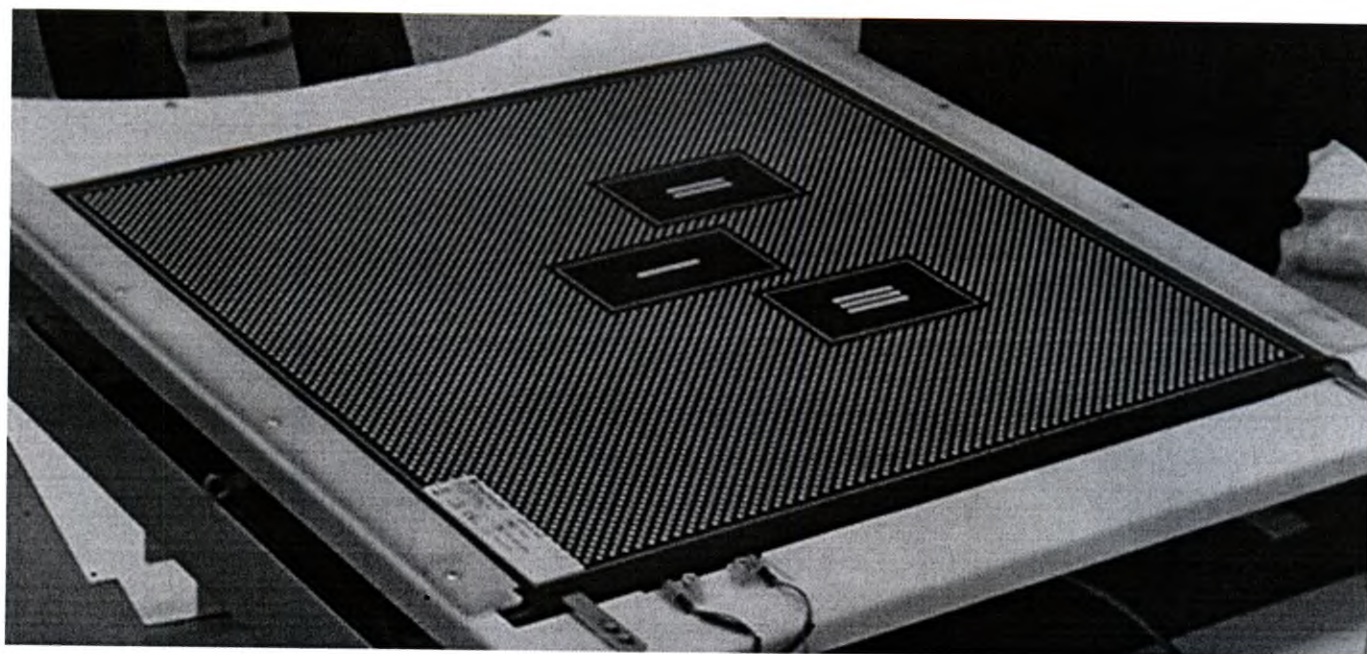


Ионизационная камера производства фирмы Varex Imaging Corporation, США

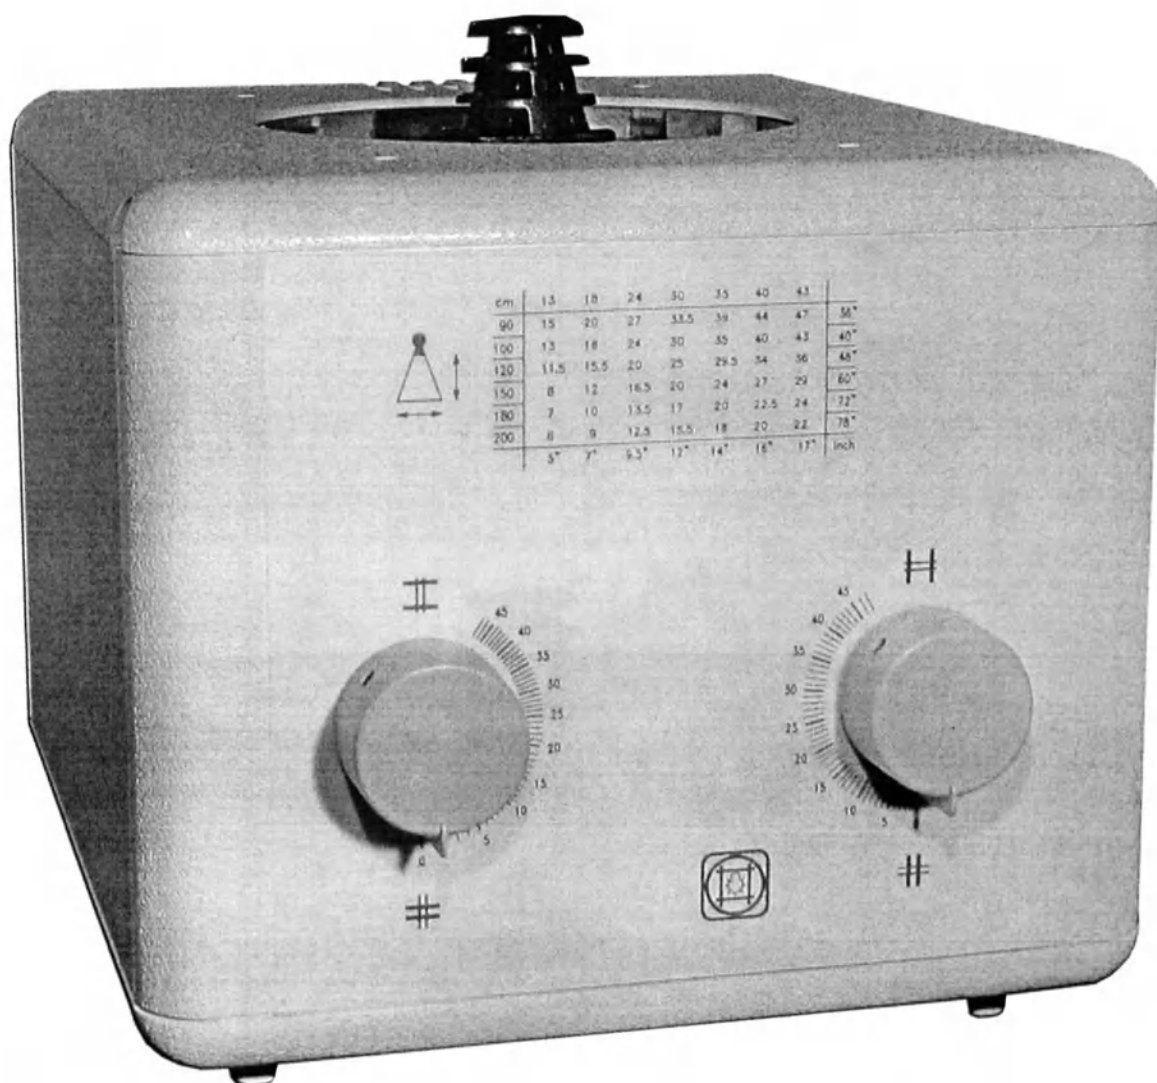


Коллиматор с соединительными элементами с ручным управлением
производства фирмы Ralco S.r.l, Италия, варианты исполнения:



Коллиматор с соединительными элементами с автоматическим управлением производства фирмы Ralco S.r.l, Италия

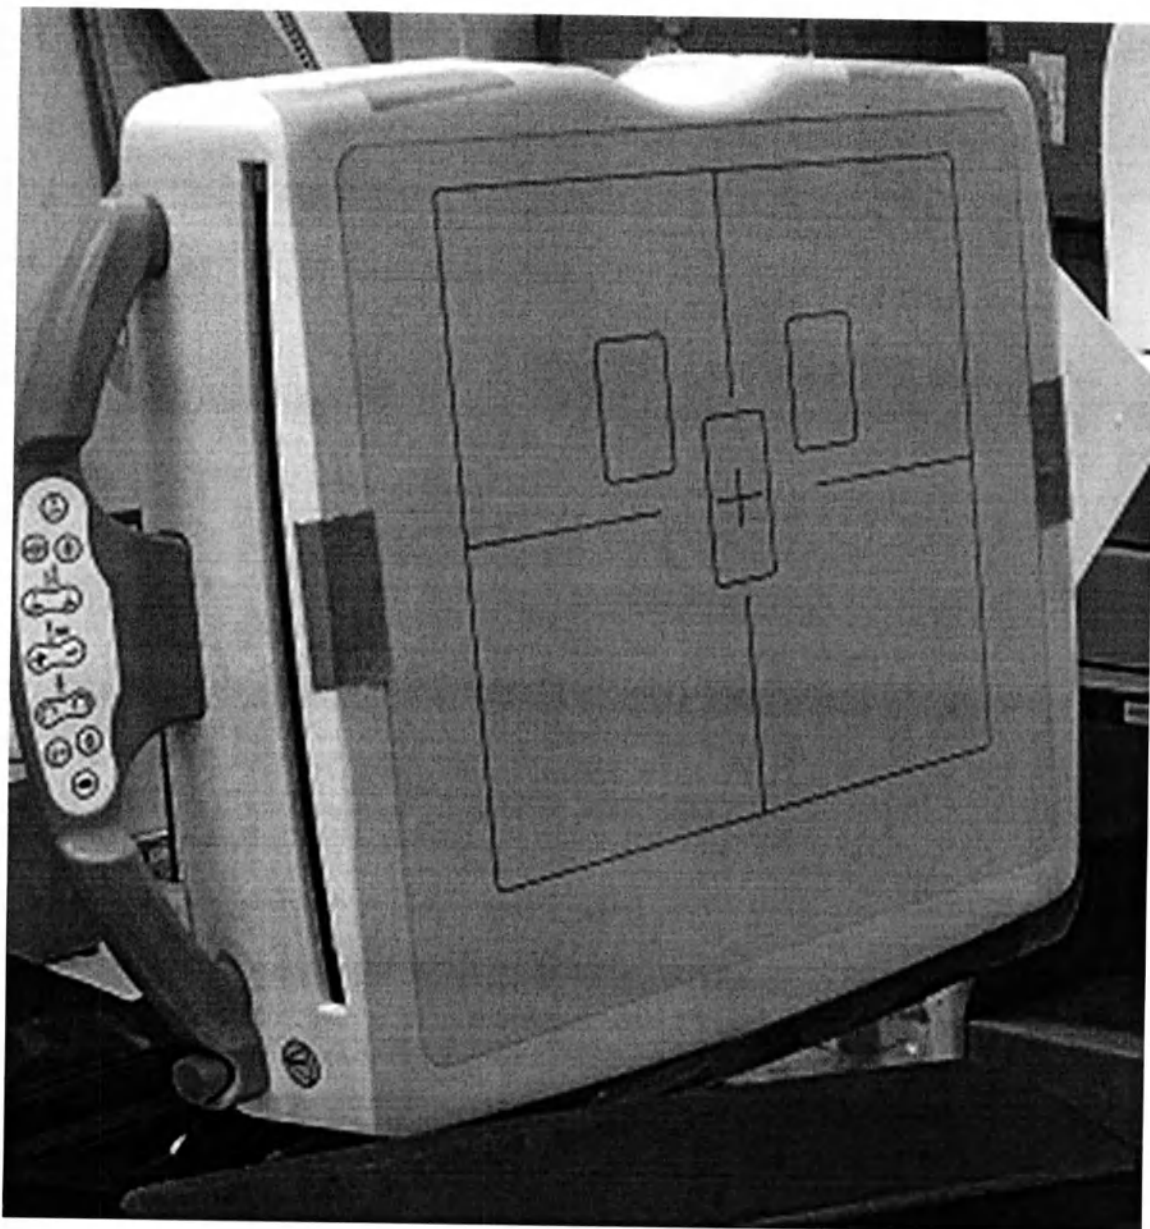


Устройство Букки с отсеивающим растром, производства фирмы
MIDWEST X-RAY EQUIPMENT CO., США

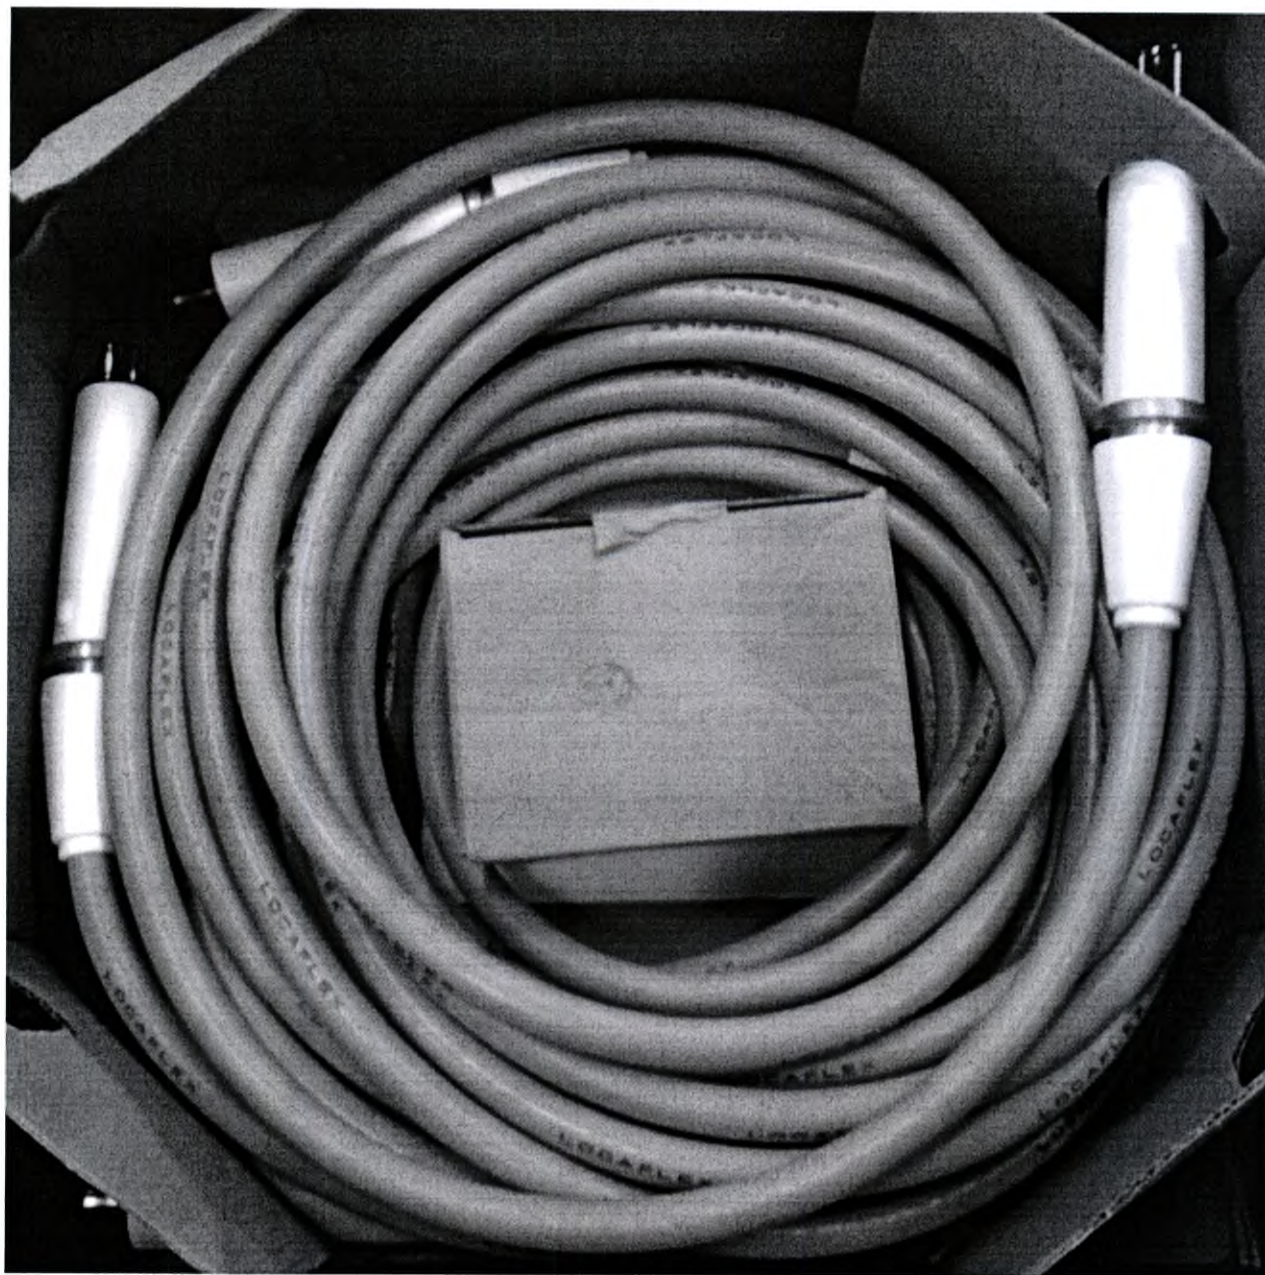

Комплект высоковольтных кабелей с наконечниками (может комплектоваться соединительными элементами) производства фирмы Varex Imaging Corporation, США или производства фирмы Varex Imaging Corporation, Нидерланды, варианты исполнения: -HT Cables 9 mt, HT Cables 16 mt, HT Cables 18 mt, HT Cables 20 mt




- Устройство включения экспозиции варианты исполнения:
- производства фирмы Communications & Power Industries Inc.,
Канада
 - производства фирмы Sedecal S.A., Испания
 - производства фирмы OMRON Corporation, Япония

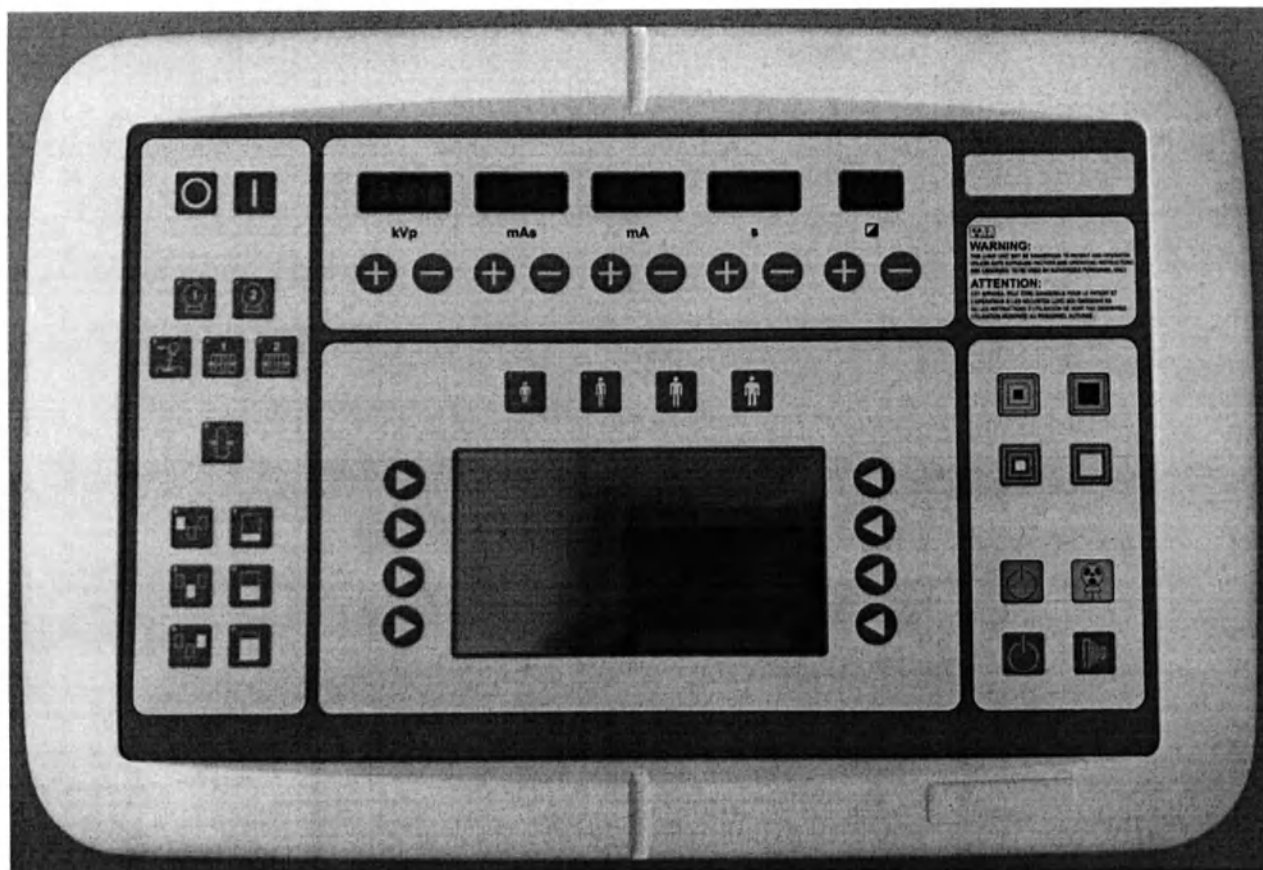


Консоль управления генератора мембранная, производства фирмы Sedecal S.A., Испания




Консоль управления генератора тач-скрин, производства фирмы Sedecal S.A., Испания, варианты исполнения:

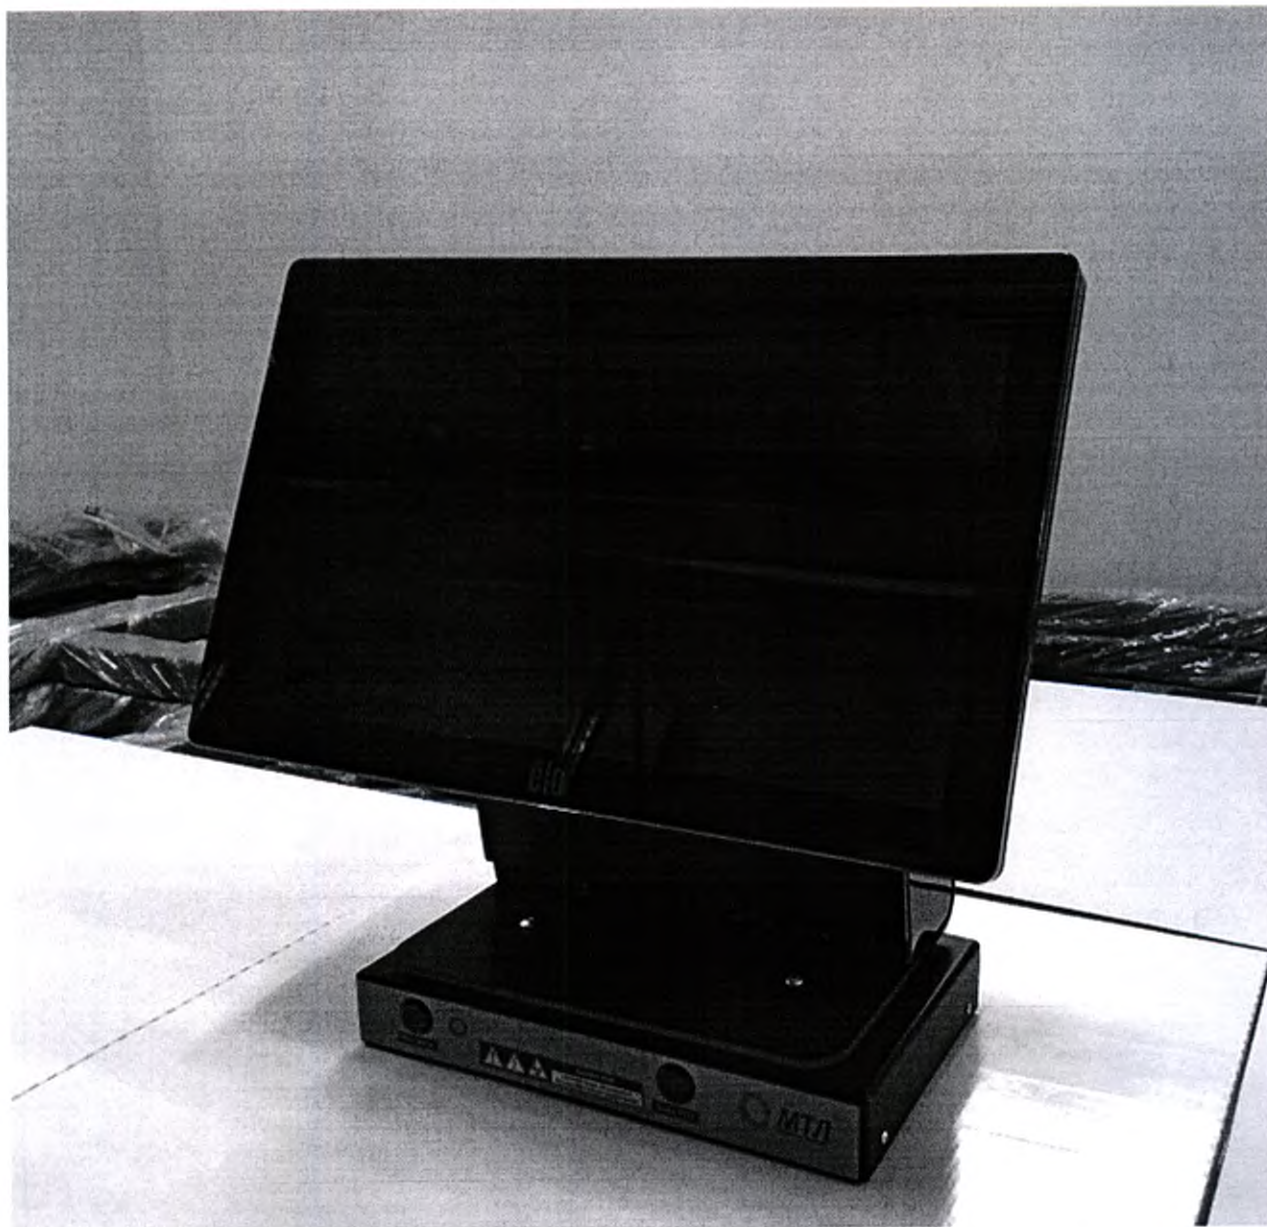

Консоль управления генератора тач-скрин, производства фирмы АО
«МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия.

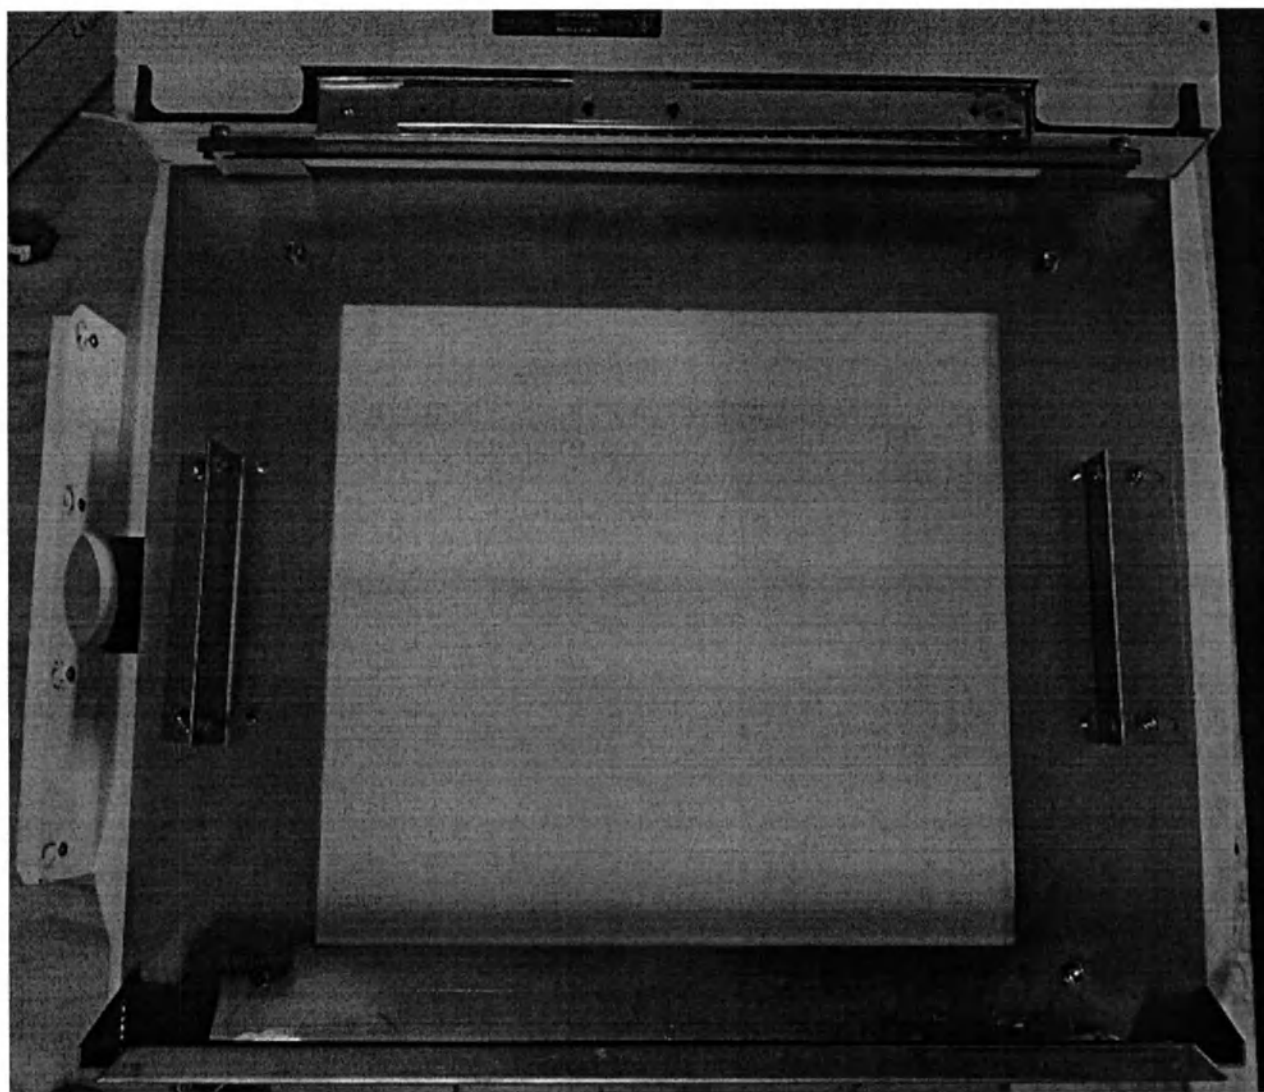

Кассетоприемник для кассеты с пленкой, производства фирмы
MIDWEST X-RAY EQUIPMENT CO., США

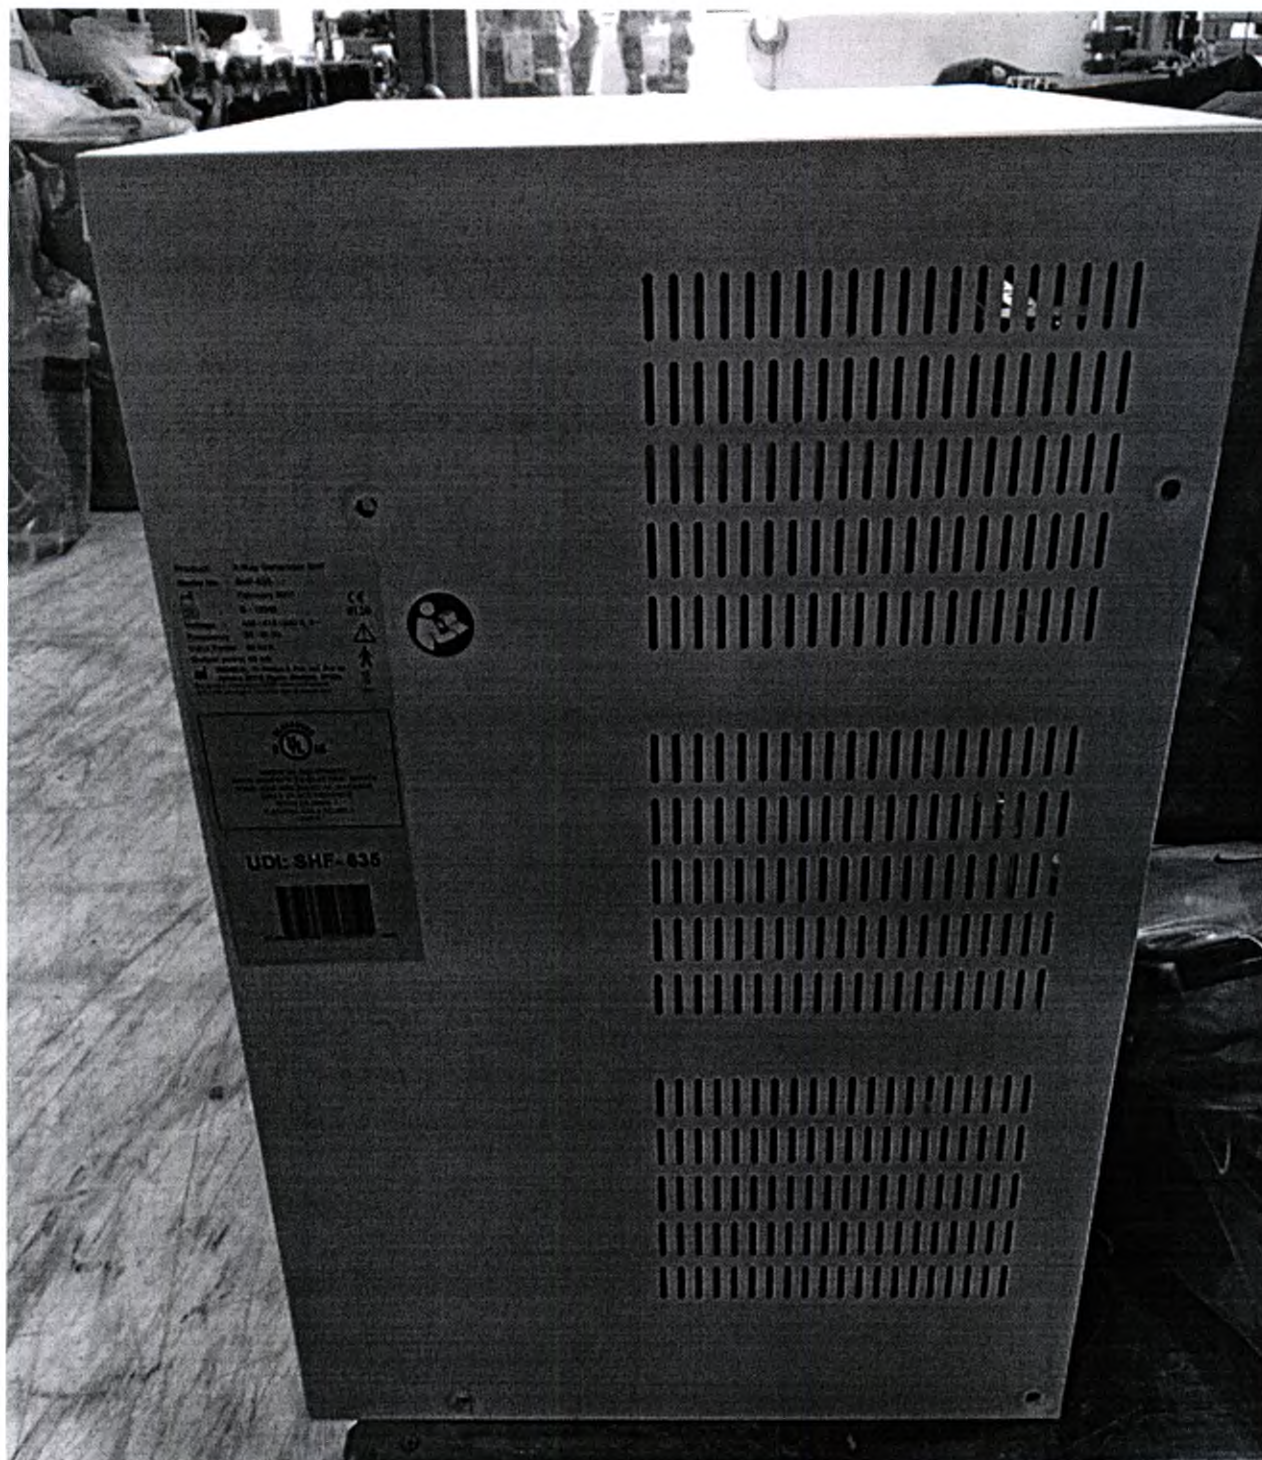


Рентгеновское питающее устройство (генератор) на одну трубку с функцией APR и рентгенэкспонетром, производства фирмы Sedecal S.A., Испания, варианты исполнения:

- SHF410, SHF415, SHF420, SHF425, SHF430, SHF435, SHF510, SHF515, SHF520, SHF525, SHF530, SHF535, SHF610, SHF615, SHF620, SHF625, SHF630, SHF635, SHF835, SHF410-C, SHF415-C, SHF510-C, SHF515-C


На фото представлен SHF635




Комплекс аппаратно-программный для получения, обработки, передачи и архивирования цифровых медицинских рентгеновских изображений «ДИАРМ-МТ», производства фирмы АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия.

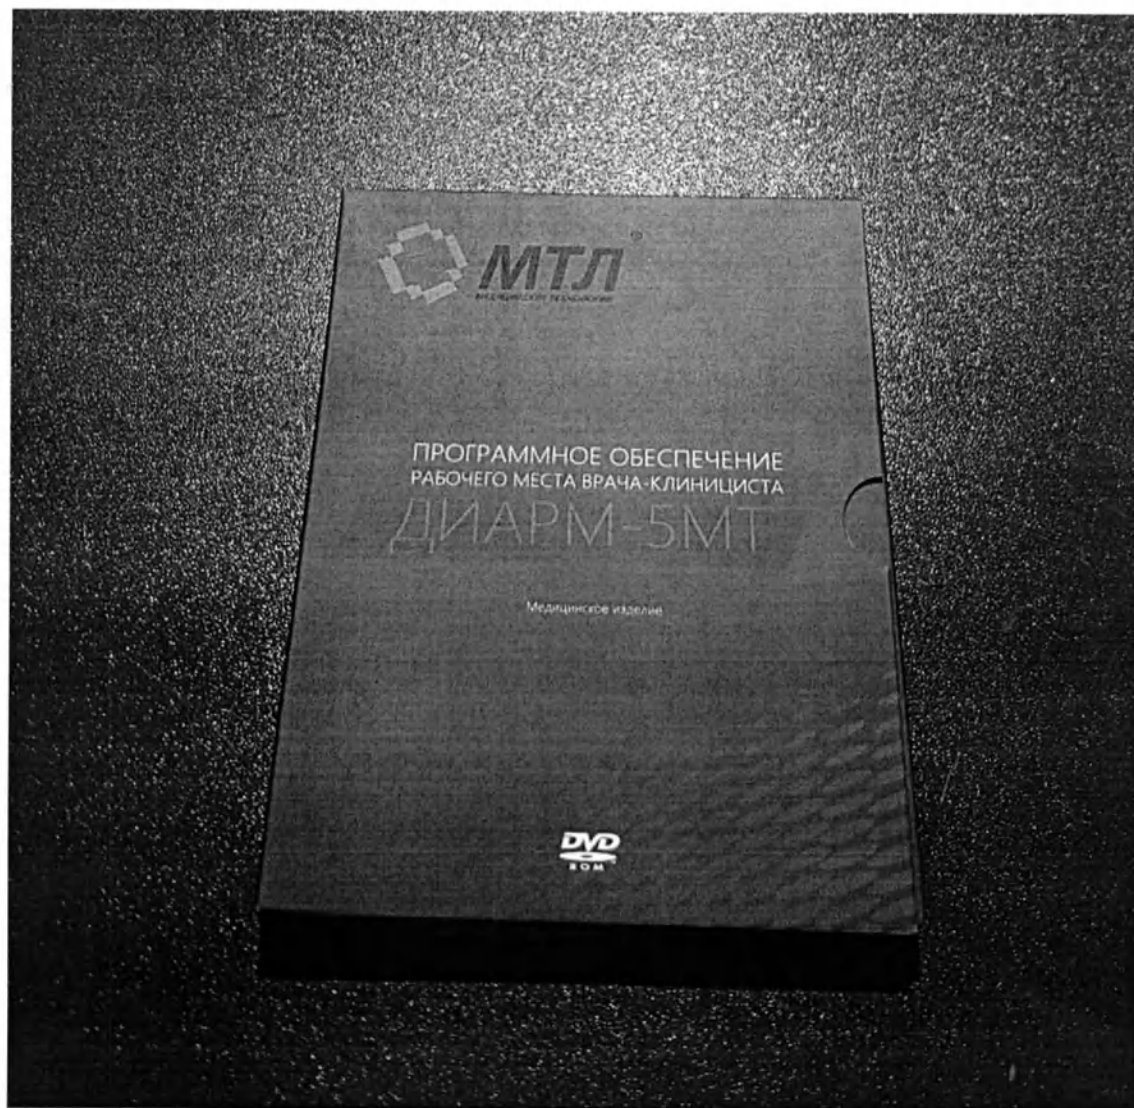


Комплекс программный для получения, обработки, передачи и архивирования цифровых медицинских рентгеновских изображений «ДИАРМ-5МТ», производства фирмы АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия.

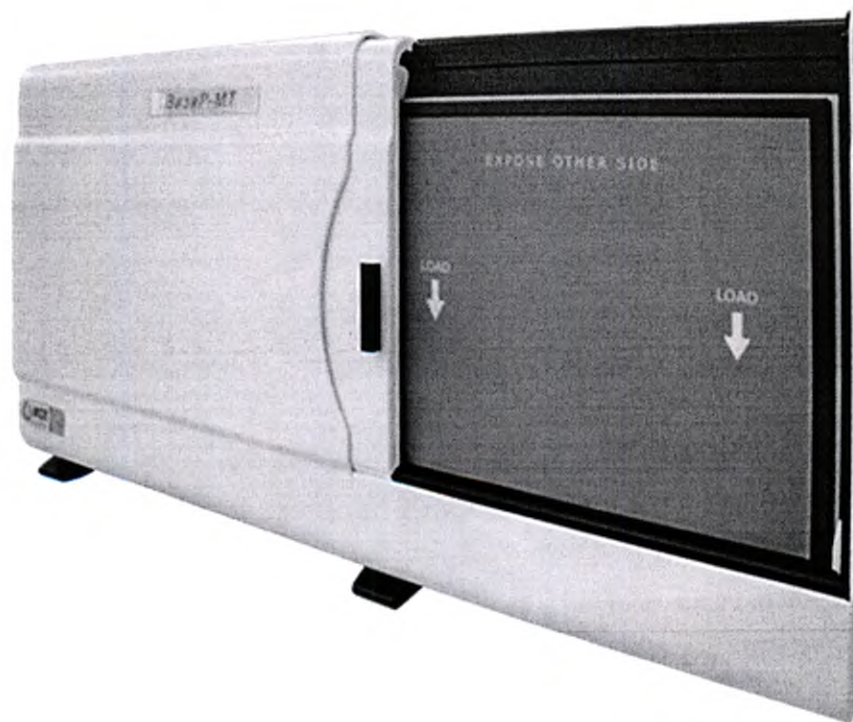

Комплекс аппаратно-программный для регистрации и цифровой обработки рентгеновского изображения «ВизиР-«МТ», производства АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия.

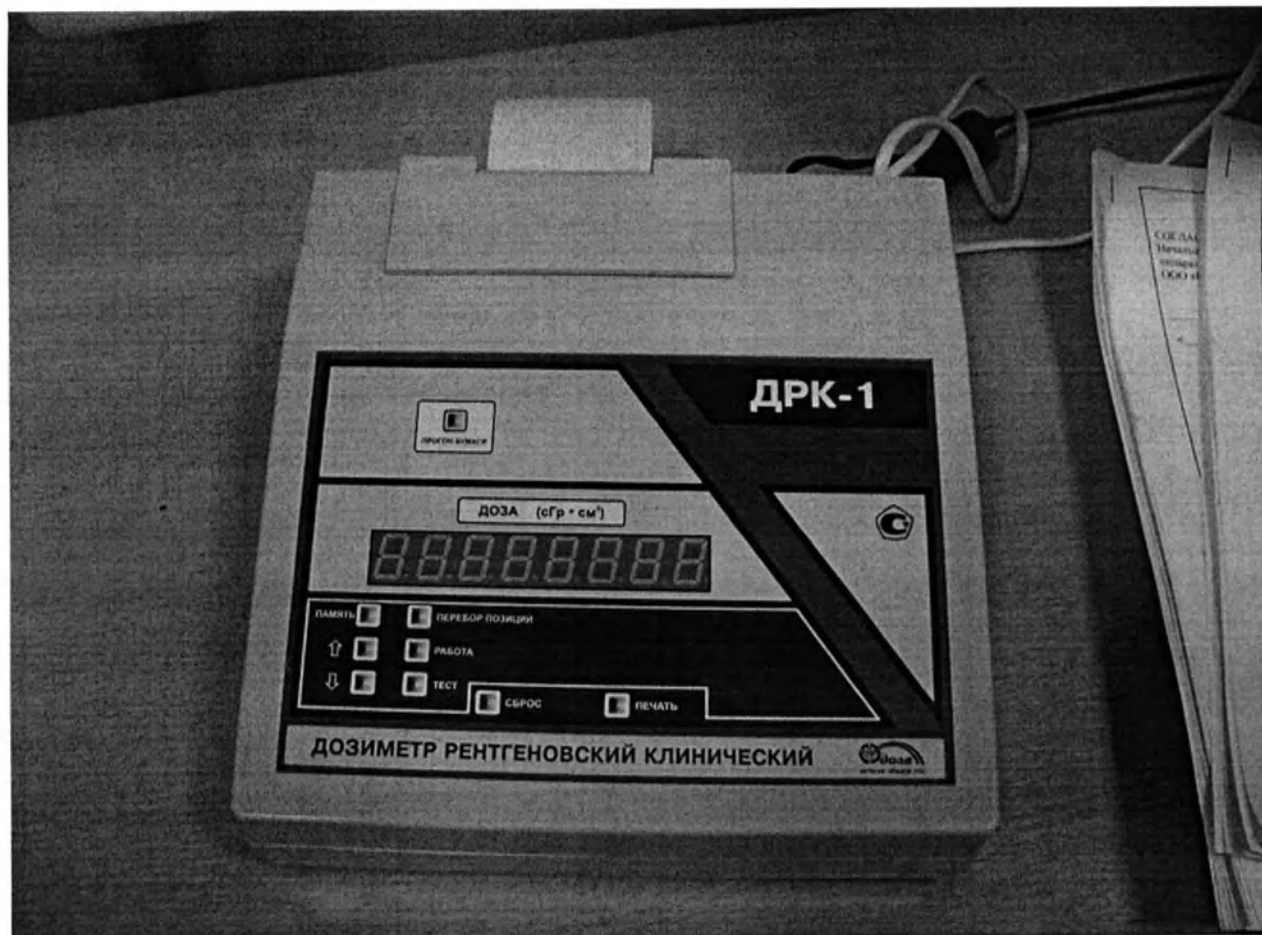

Дозиметр рентгеновского излучения ДРК-1 однокамерный,
производства фирмы НПП «Доза», Россия

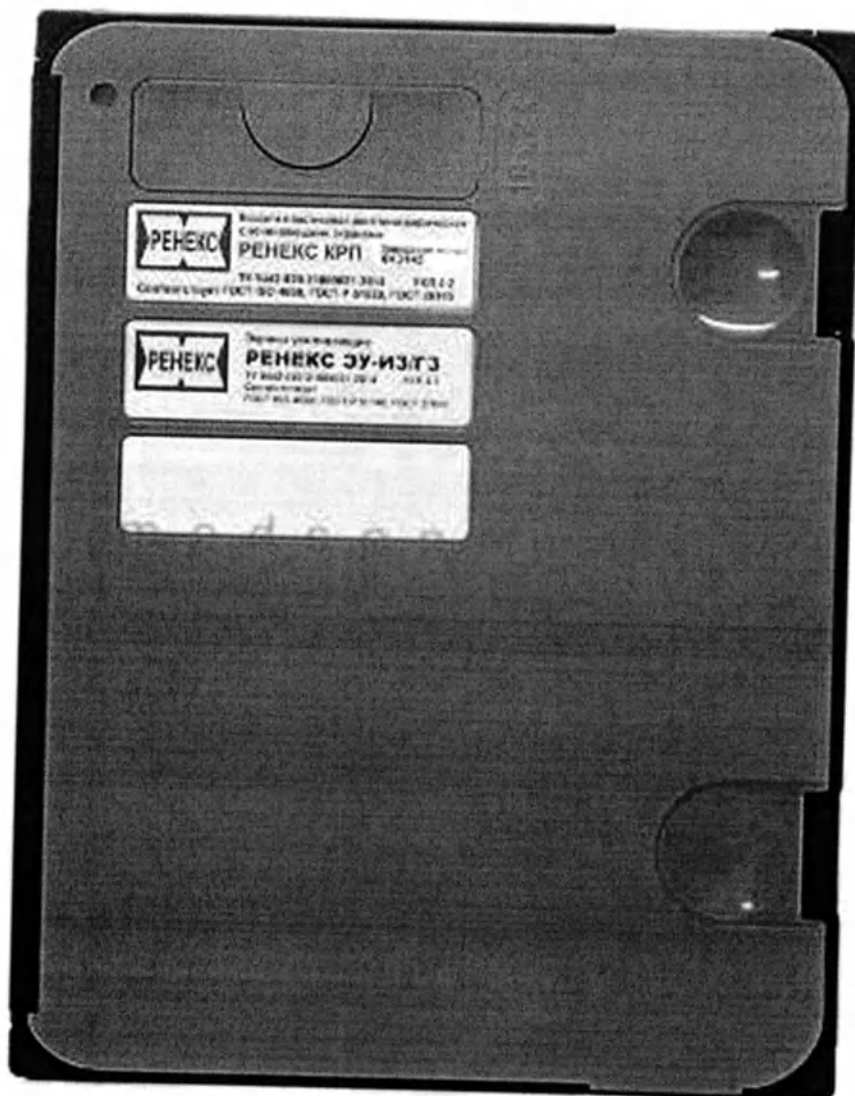


Комплект рентгеновских кассет производства фирмы ЗАО
«РЕНЕКС», Россия,



Комплект рентгеновских кассет производства фирмы Carestream Health Inc. (Kodak), США




Комплект рентгеновских кассет производства фирмы Agfa N.V.,
Бельгия

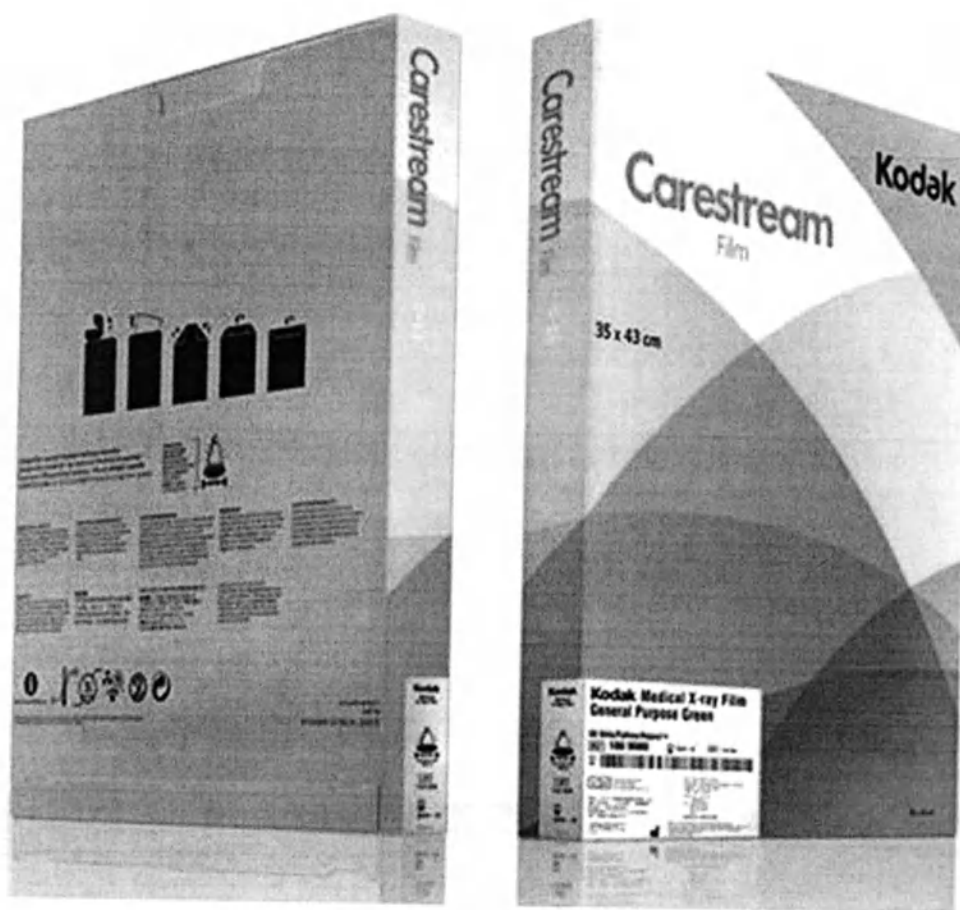


Комплект рентгеновской пленки, производства фирмы Carestream Health Inc. (Kodak), США



Комплект рентгеновской пленки производства фирмы Agfa N.V.,
Бельгия

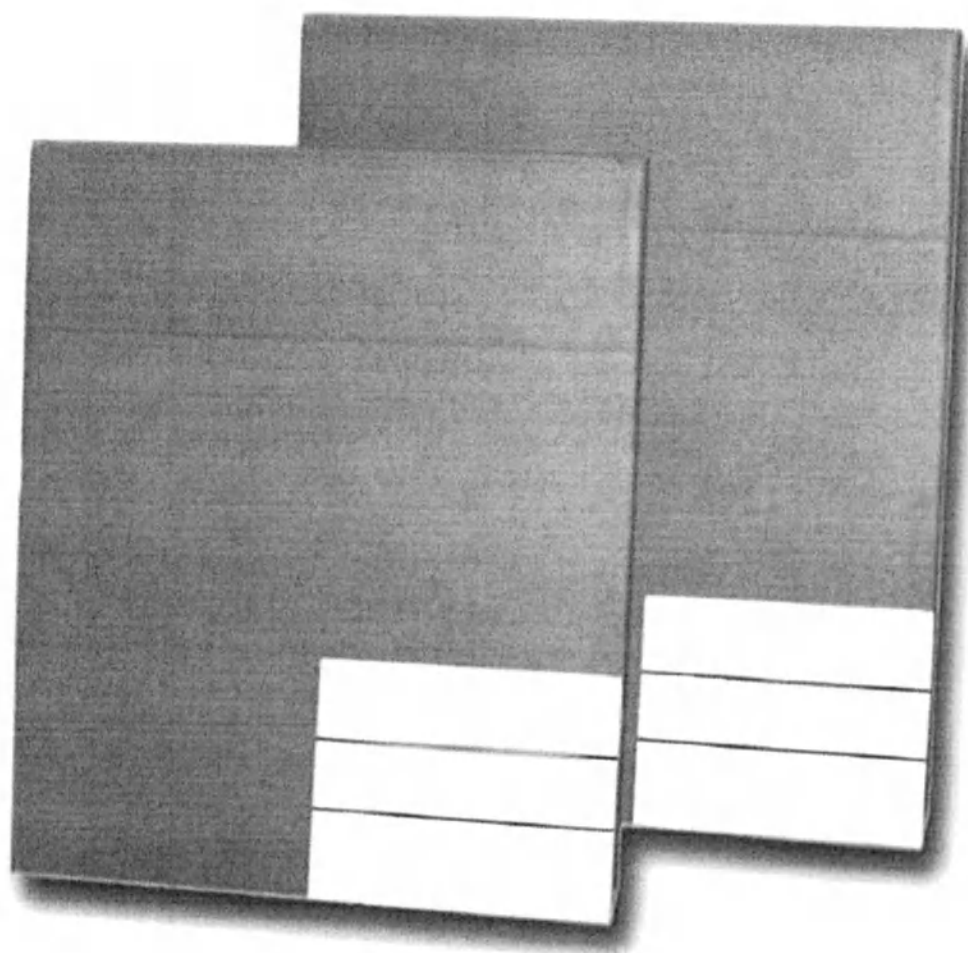

Комплект рентгеновской пленки производства фирмы АО
«МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия.

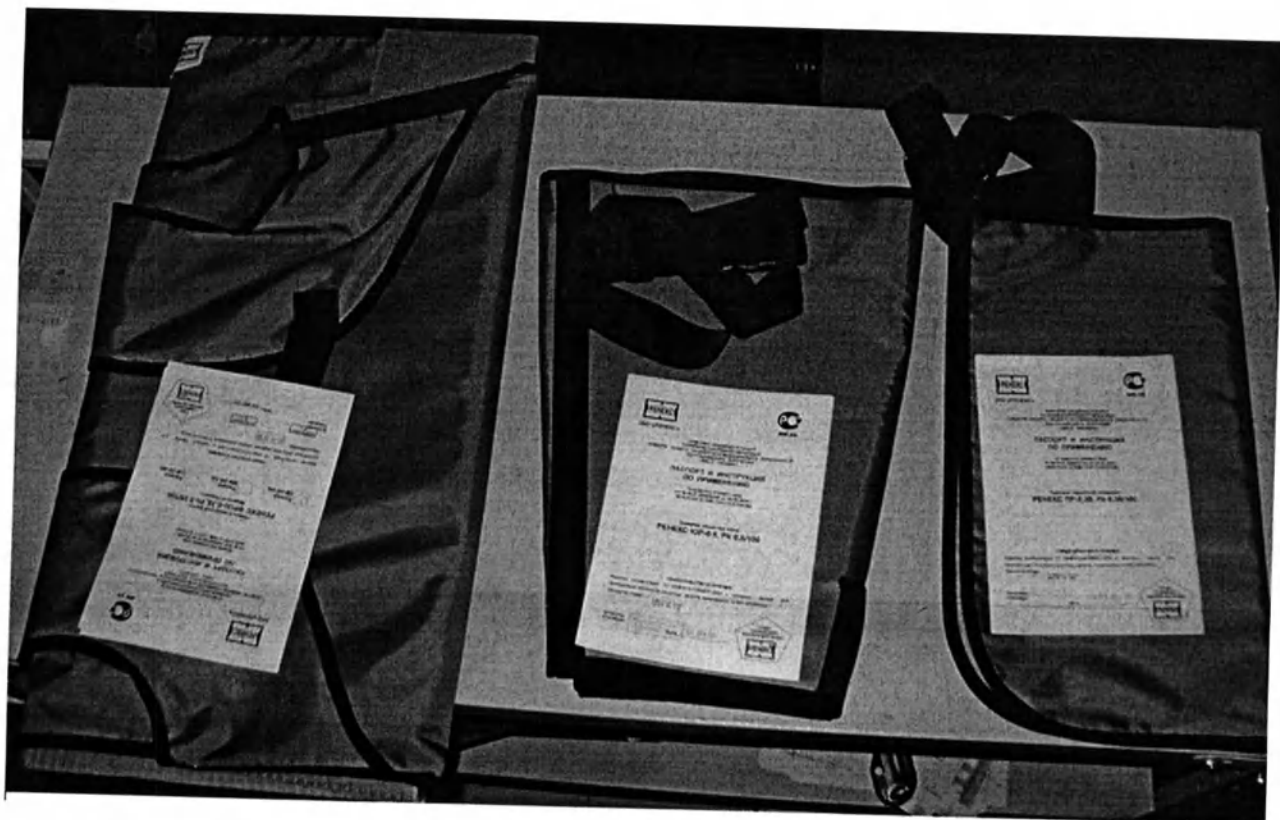

Комплект рентгеновской одежды для пациентов и персонала
производства фирмы ООО «Рентген-Комплект», Россия, или
производства фирмы «Малое предприятие научно-производственная
фирма «ГАММАМЕД-П», Россия, или производства фирмы ЗАО
«РЕНЕКС», Россия

На фото представлен комплект производства фирмы ЗАО
«РЕНЕКС»



Машина проявочная автоматическая для листовых
радиографических медицинских пленок «МиниМед-4МТ»,
производства фирмы АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд»,
Россия



Носители пленочные для термической печати диагностических медицинских изображений, производства фирмы Codonics, Inc., США, варианты исполнения:


- Direct Vista 14"x17" (35x43 см) (100 л.)
- Direct Vista 8"x10" (20x25 см) (100 л.)




Носители бумажные для термической печати диагностических медицинских изображений Direct VistaA4 21x29,7 см (80 л.), производства фирмы Codonics, Inc., США




Комплект для монтажа, производства фирмы Sedecal S.A., Испания
или производства фирмы АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лтд», Россия

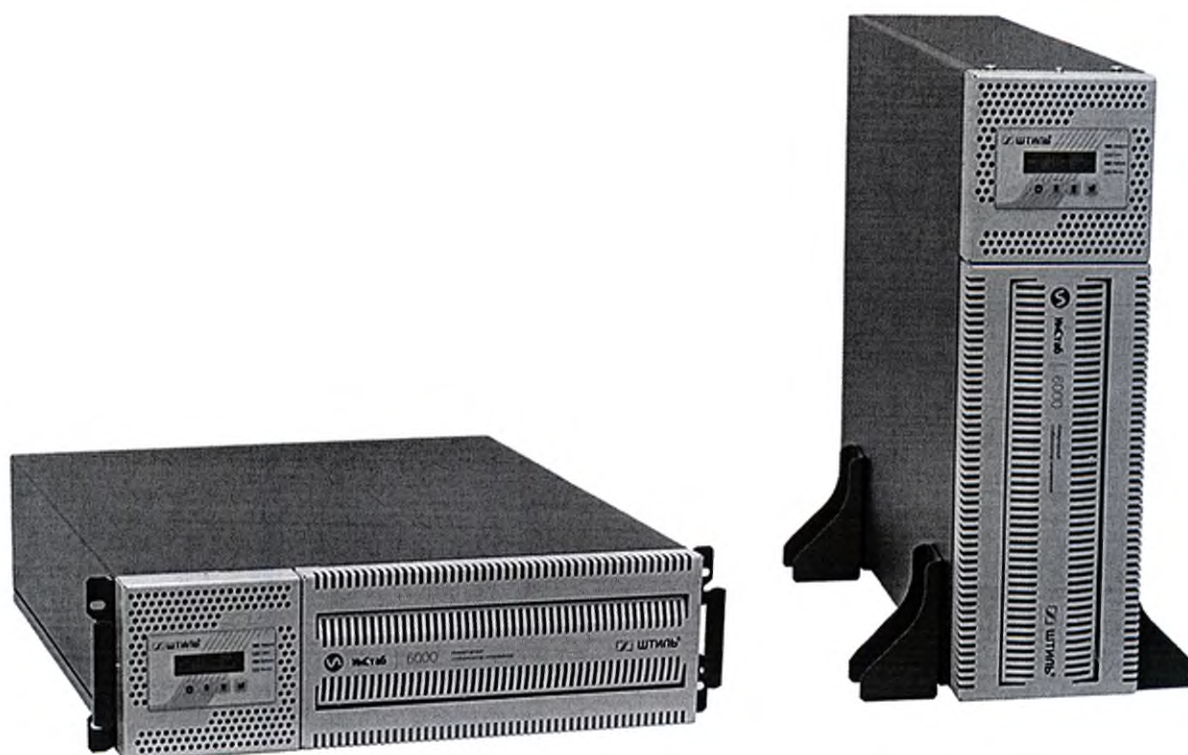

Трехфазный стабилизатор, производства фирмы ГК Штиль, Россия

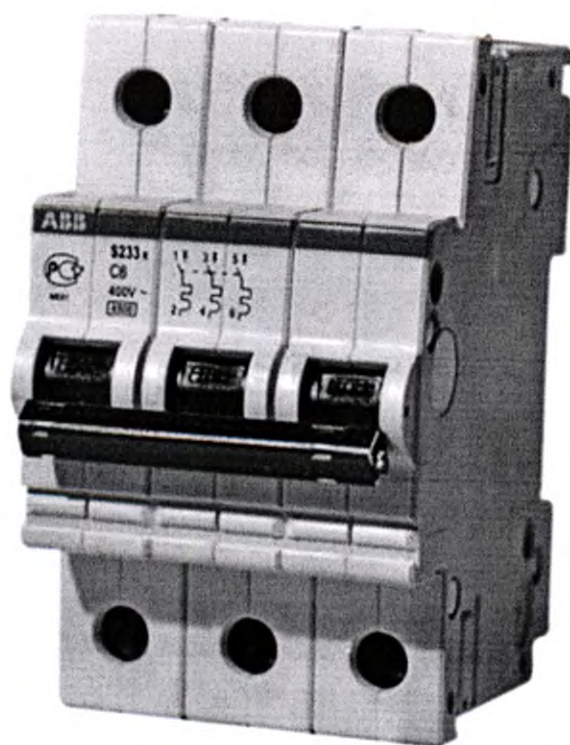


Автоматический выключатель, производства фирмы Asea Brown
Boveri Ltd., Швейцария и Швеция

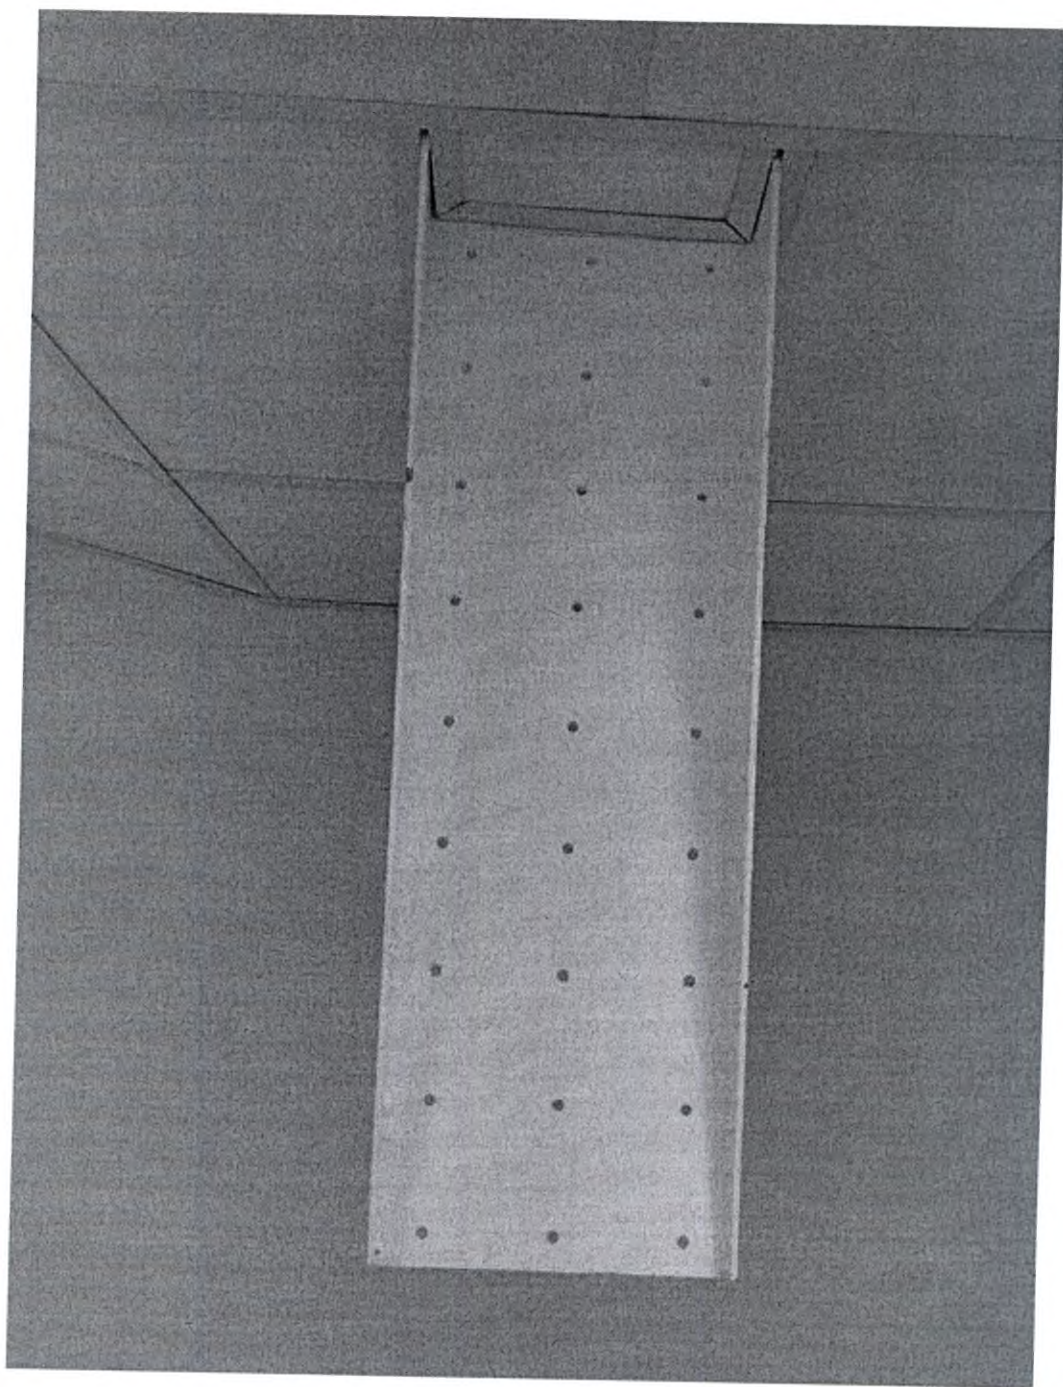


Монтажный комплект для рентгенографического штатива с
крепежными элементами потолочный, производства фирмы ООО
«БелгородРентген», Россия




Переговорное устройство двухстороннее (лаборант - пациент),
производства фирмы Commax, Южная Корея

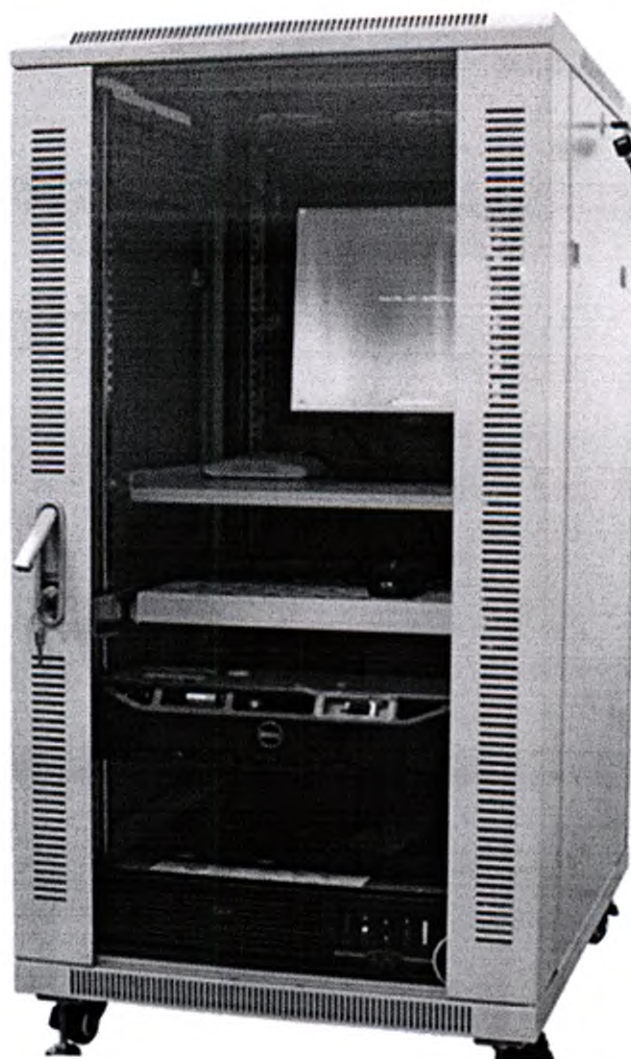


Радиологическая Информационная Система «ИнтеГРИС-МТ»,
производства фирмы АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛТД»,
Россия

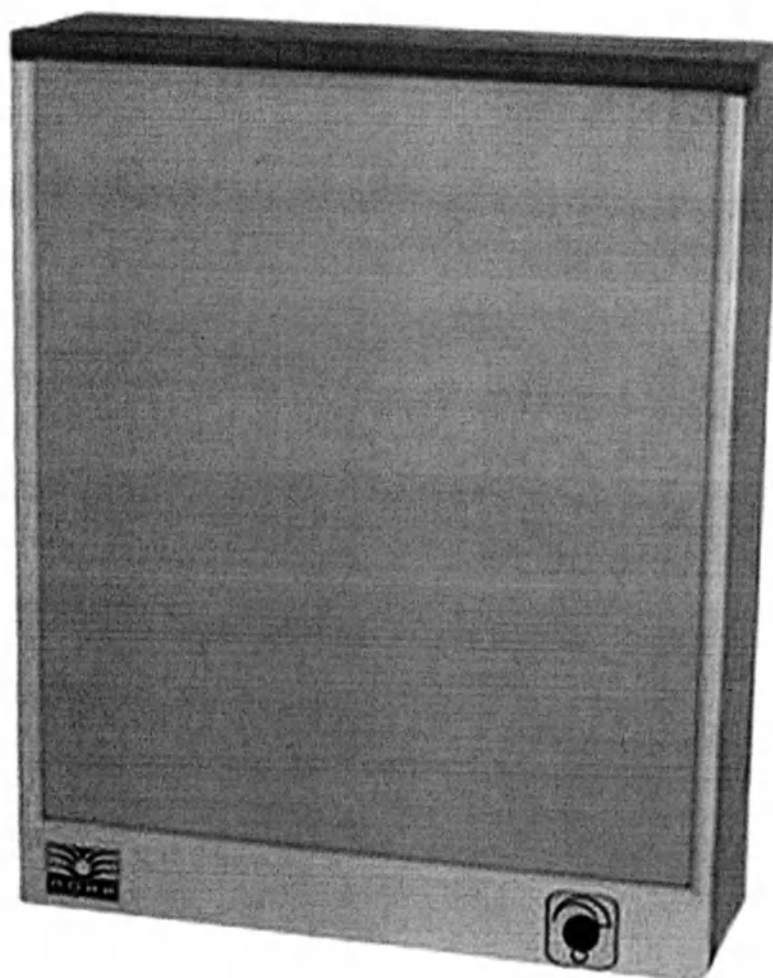


Негатоскоп общего назначения, производства фирмы
ЗАО «ПОНИ», Россия

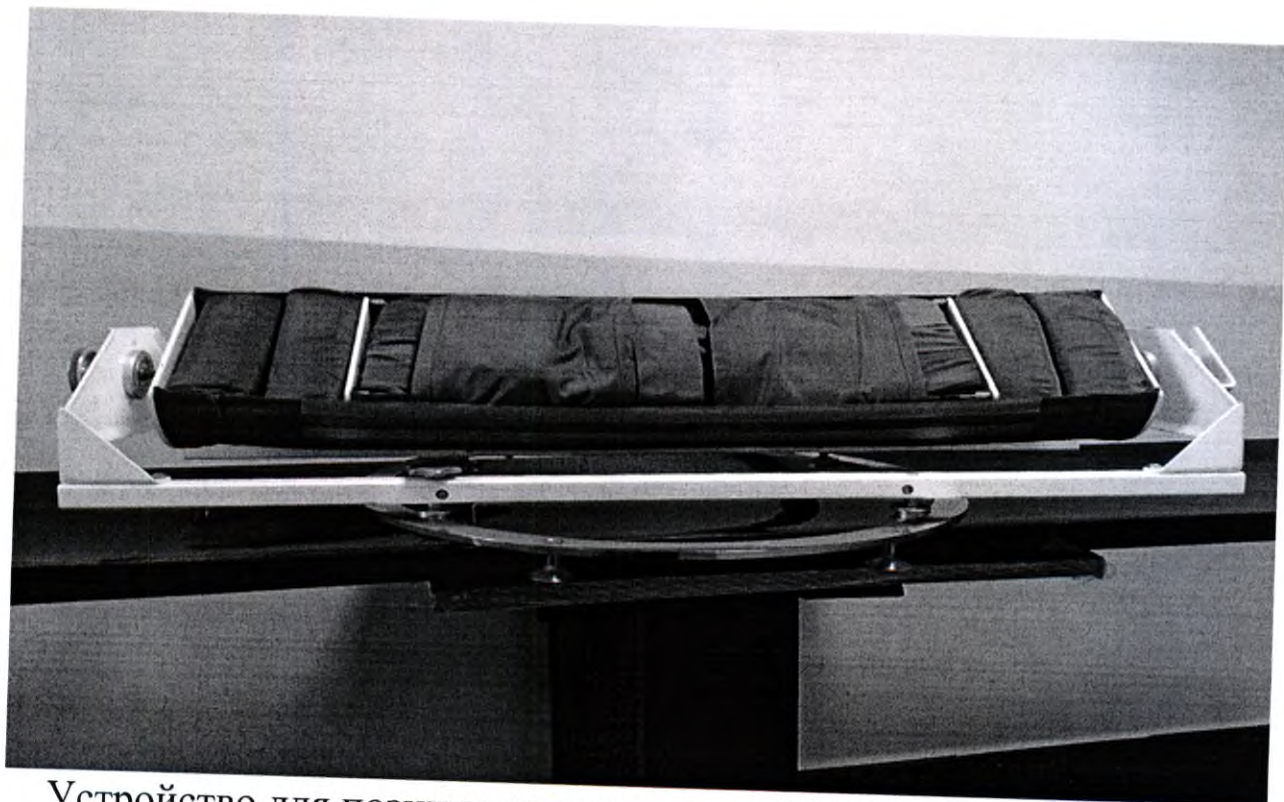


Устройство для позиционирования детей ЛДДП-1, производства
фирмы ООО «СпектрАп», Россия

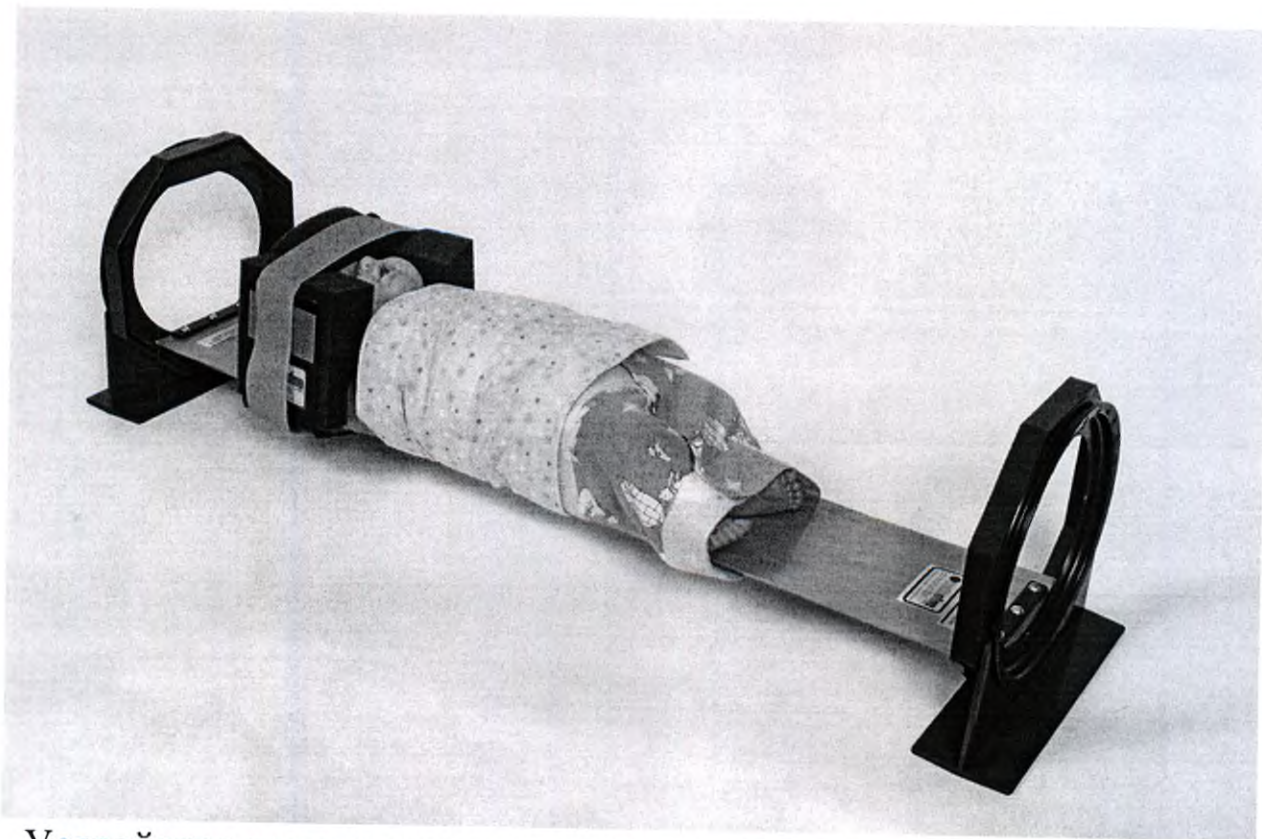

Устройство для позиционирования детей Ostopaque, производства
фирмы Oktostop inc. Канада

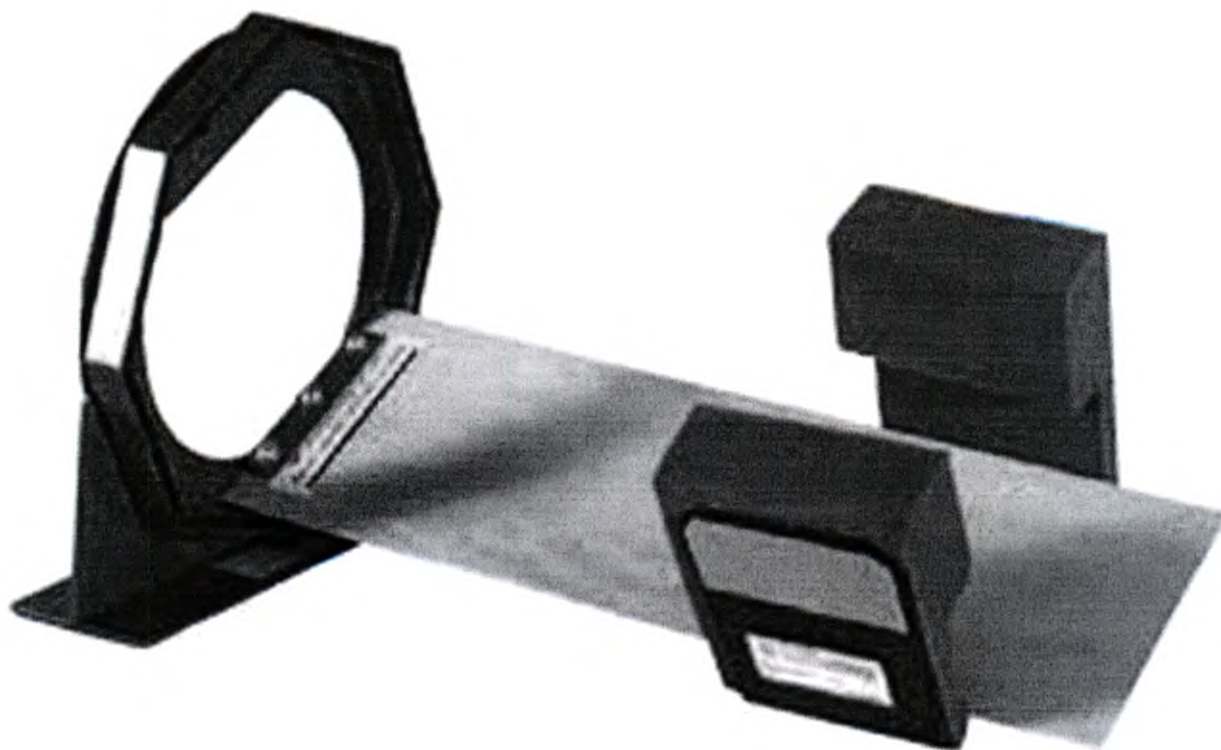

Устройство для позиционирования детей Minipaque, производства
фирмы Oktostop inc. Канада

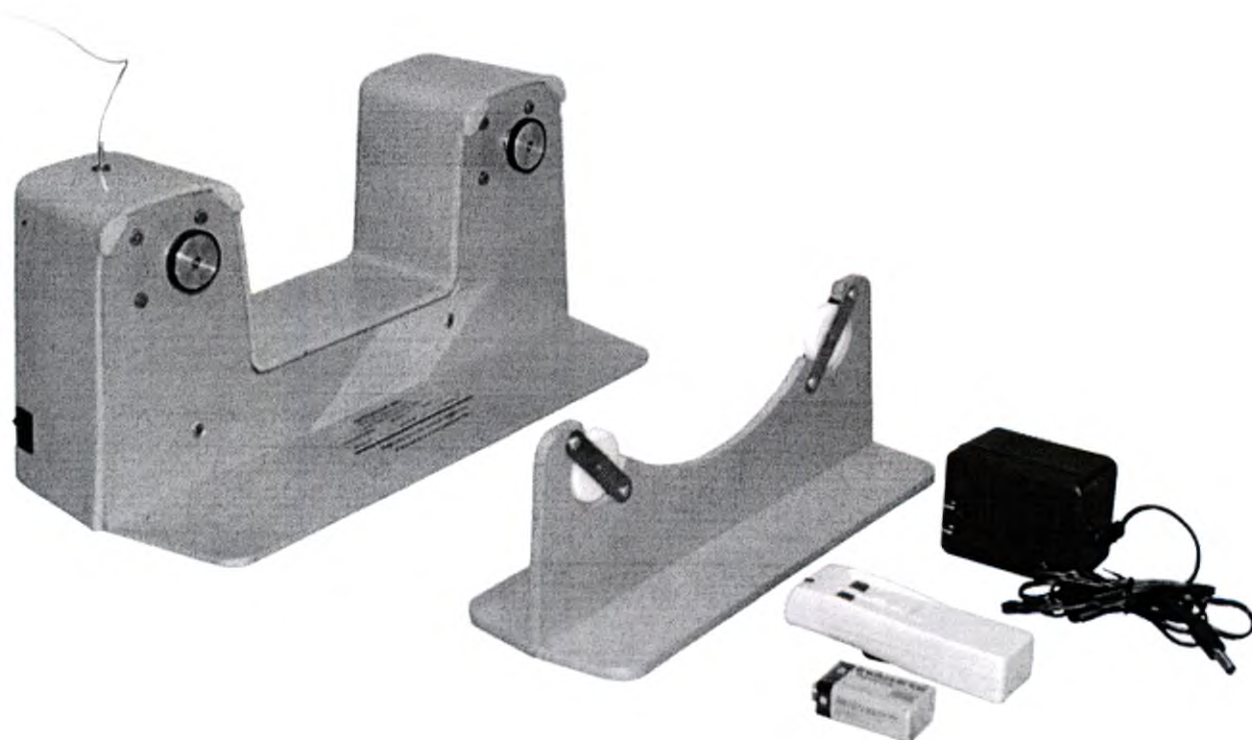


Устройство для позиционирования детей Octoroll, производства
фирмы Oktostop inc. Канада




Устройство для позиционирования детей «РЕНЕКС УРИД»
производства фирмы ЗАО «РЕНЕКС», Россия



**Фотографии упаковки и макета
маркировки медицинского изделия
«Система универсальная
рентгенографическая диагностическая
«УнивеРС-МТ»,
производства АО «МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия**

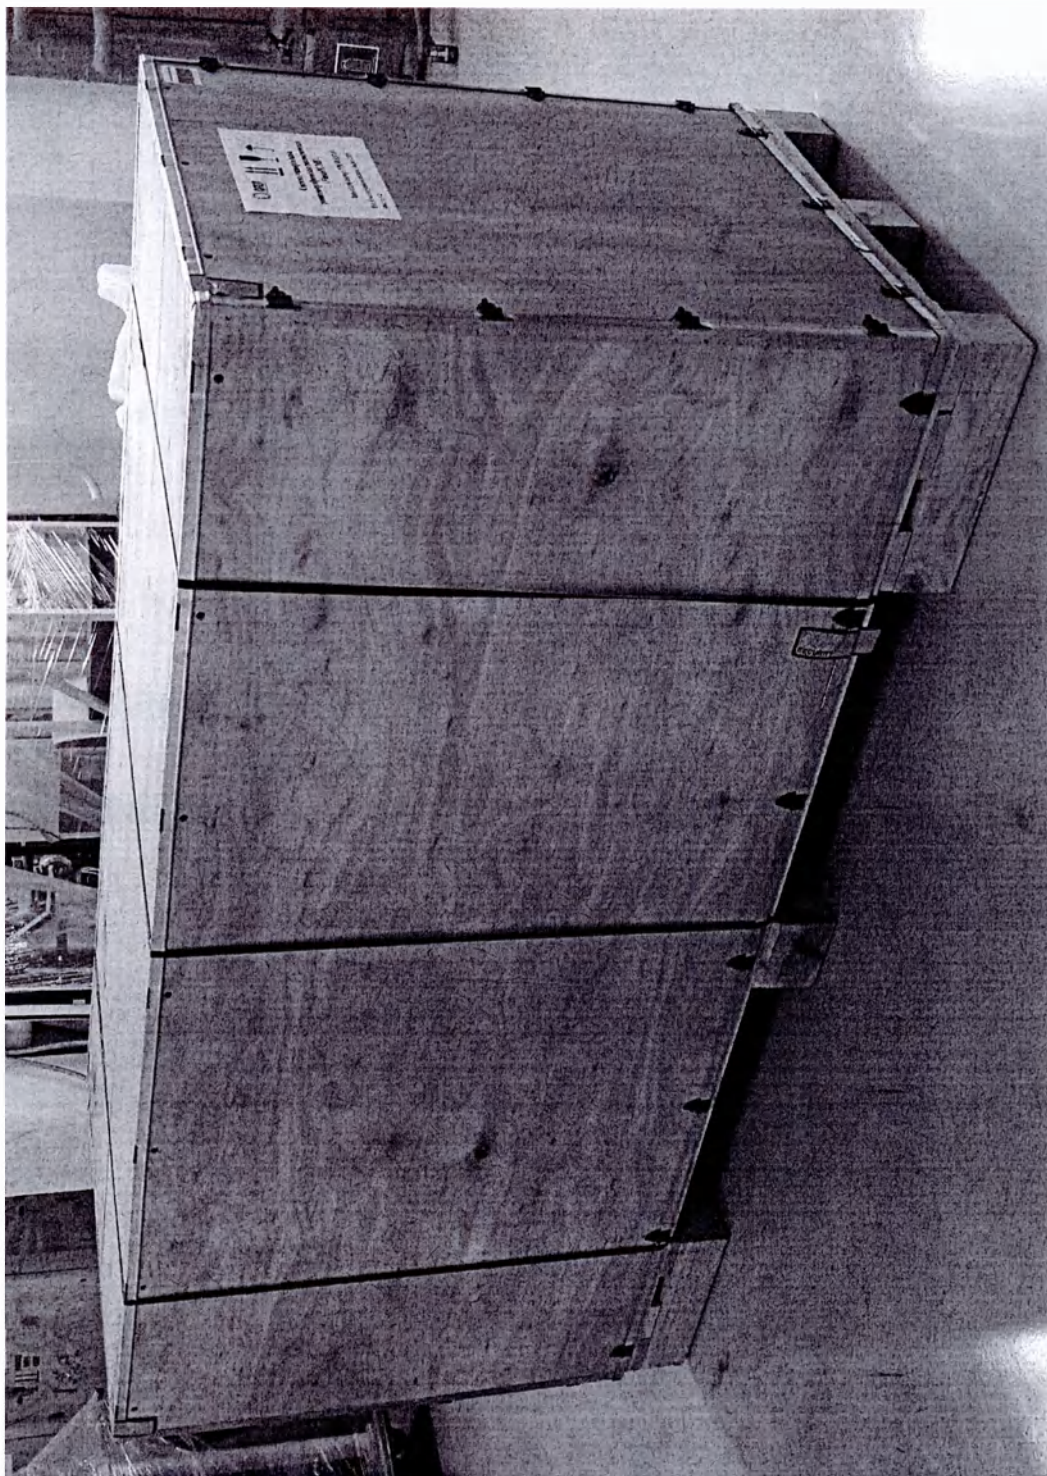

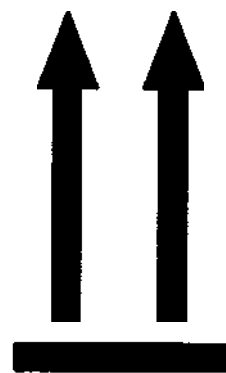

**Система универсальная
рентгенографическая диагностическая
«УнивеРС-МТ»**

Заводской номер:

Год и месяц упаковывания:

Макет маркировки изделия

АО «МТЛ»	
Система универсальная рентгенографическая диагностическая «УнивеРС-МТ»	
Исполнение «УнивеРС- МТ-__»	Потребляемая мощность: ____ кВА
Зав. номер УРС-__-__	Питание: 3 ~ 380 В 50 Гц
ТУ 9442-024-47245915-2007	Выходная мощность: ____ кВт
Дата выпуска ____ 20__ г.	Класс I 
	
Сделано в России	

Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения наносится методом стикерования.

