

**Компрессор медицинский Vi Air
по ТУ 32.50.11-007-77929798-2019
в вариантах исполнения**

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ООО ТПК «Виталия»

620017, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3 А, литер 9

Компрессор медицинский Vi Air
по ТУ 32.50.11-007-77929798-2019
вариант исполнения Vi Air 1

Зав. № 007-001

~ 220В ± 10% 50 ± 1%Гц IP 24  20.05.2019 г

Максимальная потребляемая мощность 0.75 кВт



Регистрационное удостоверение № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Рис.1 – Маркировка. Компрессор медицинский Vi Air по ТУ 32.50.11-007-77929798-2019, вариант исполнения Vi Air 1

ООО ТПК «Виталия»

620017, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3 А, литер 9

Компрессор медицинский Vi Air
по ТУ 32.50.11-007-77929798-2019
вариант исполнения Vi Air 2

Зав. № 007-002

~ 220В ± 10% 50 ± 1% Гц IP 24  20.05.2019 г.

Максимальная потребляемая мощность 1,5 кВт



Регистрационное удостоверение № _____ от «___» _____ 20__ г.

Рис.2 – Маркировка. Компрессор медицинский Vi Air по ТУ 32.50.11-007-77929798-2019,
вариант исполнения Vi Air 2

ООО ТПК «Виталия»

620017, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3 А, литер 9

Компрессор медицинский Vi Air
по ТУ 32.50.11-007-77929798-2019
вариант исполнения Vi Air 3

Зав. № 007-003

~ 220В ± 10% 50 ± 1%Гц IP 24  20.05.2019 г

Максимальная потребляемая мощность 1,5 кВт



Регистрационное удостоверение № _____ от «___» _____ 20__ г.

Рис.3 – Маркировка. Компрессор медицинский Vi Air по ТУ 32.50.11-007-77929798-2019, вариант исполнения Vi Air 3

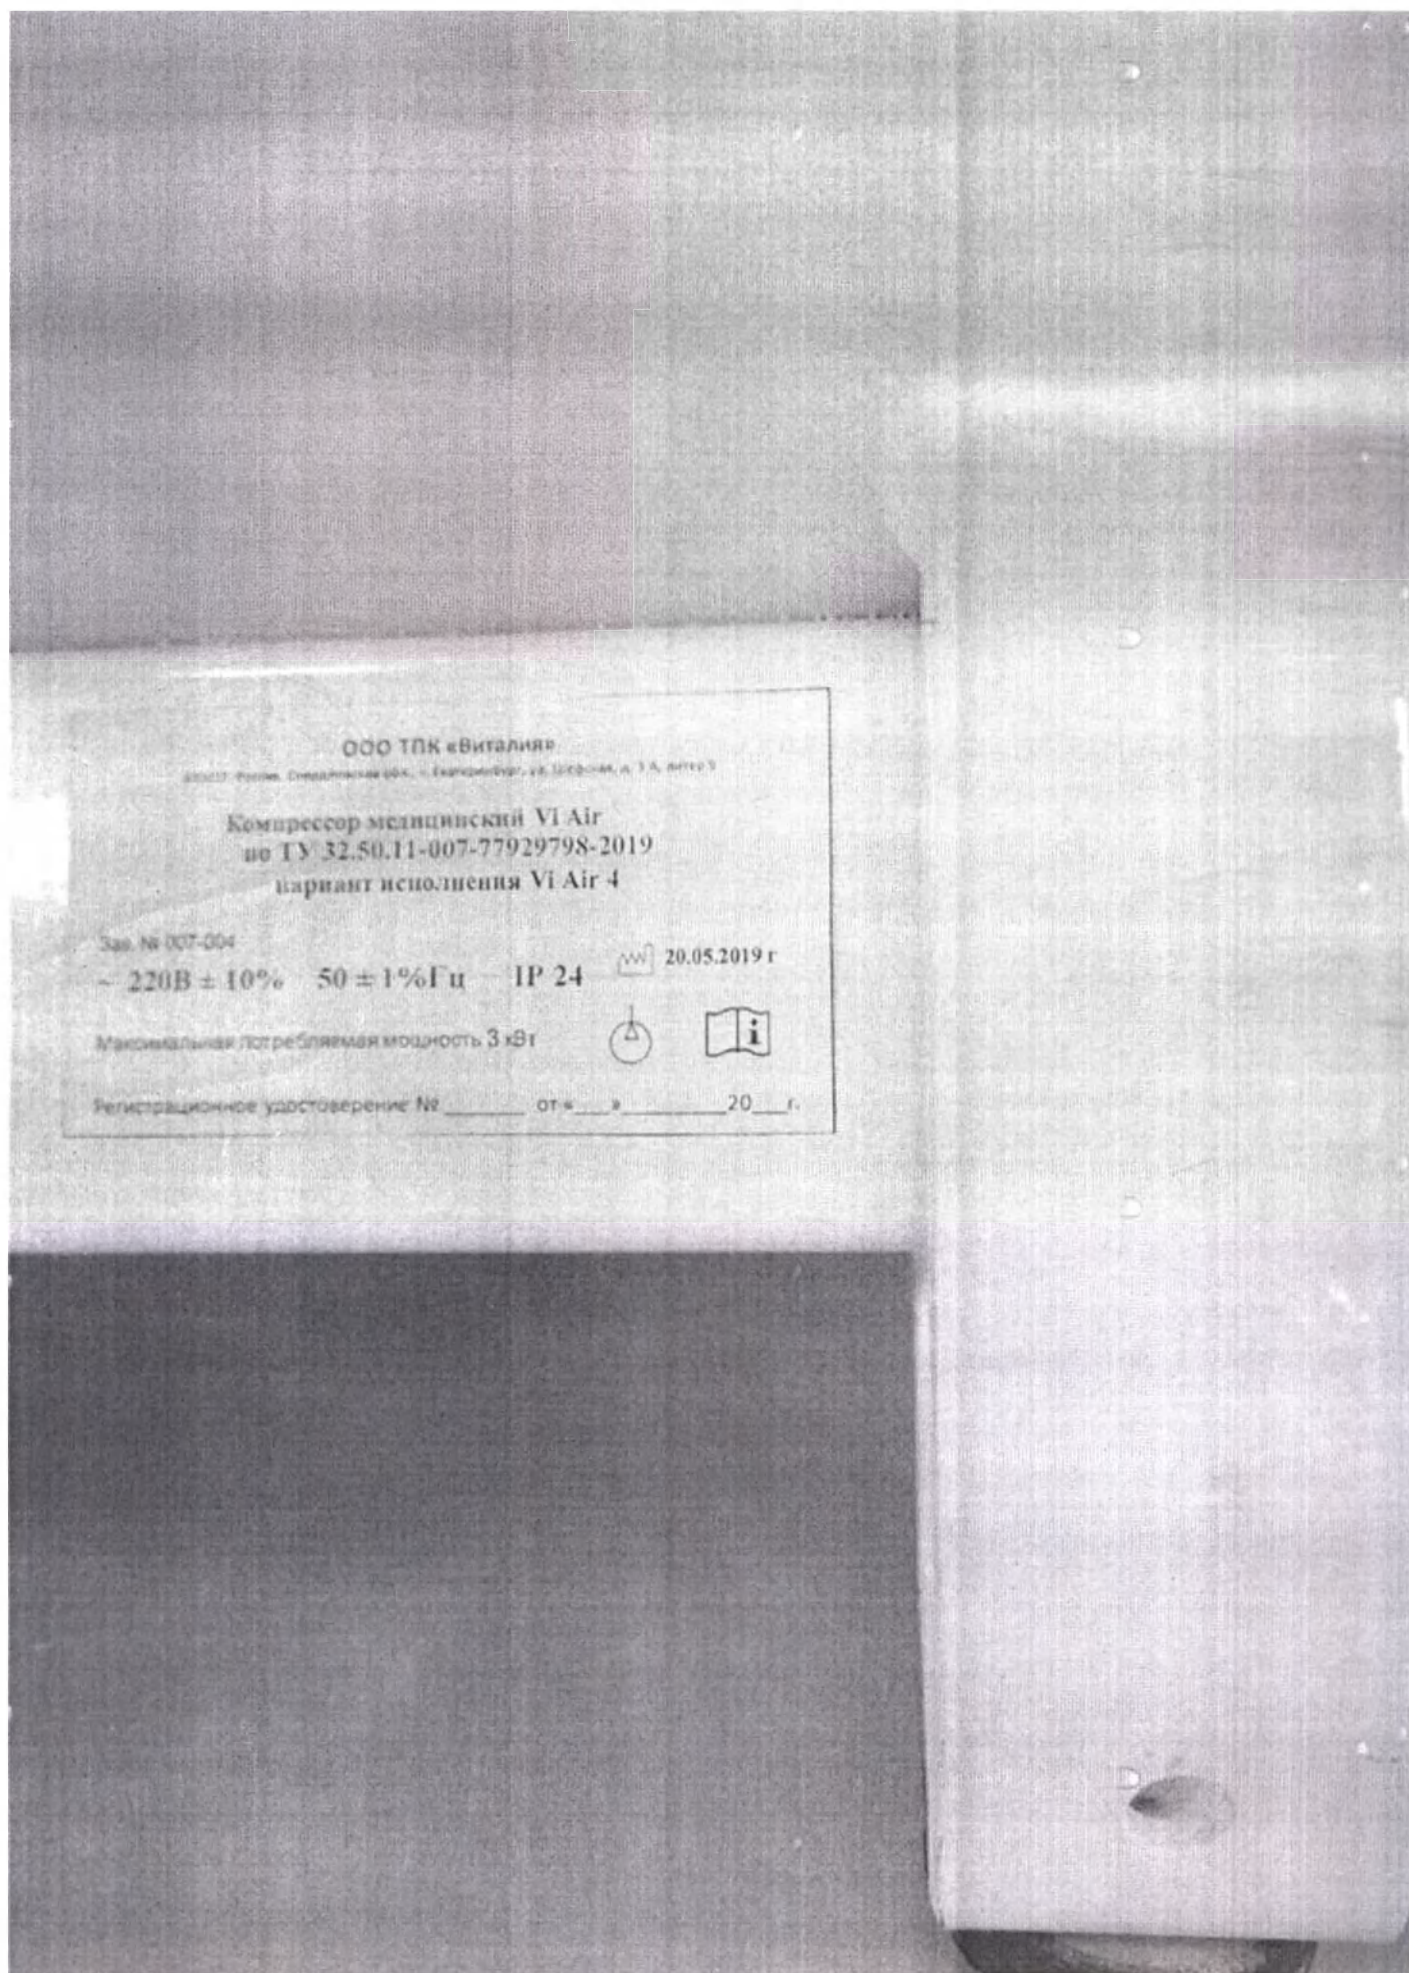


Рис.4 – Маркировка. Компрессор медицинский Vi Air по ТУ 32.50.11-007-77929798-2019, вариант исполнения Vi Air 4

Прошнуровано и пронумеровано

Количество страниц 5



Директор

ООО «ТПК «Виталия»

Шаповалов С.В.