

EGRO

ООО «ЕГРО»
195027, г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская 11
ИНН 780 655 84 10
КПП 780 601 001
ОГРН 119 784 706 9090

ООО «ЕГРО»

Генеральный директор
Мякишев А. В.



(Подпись)

2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Стол операционный VIVAX OT-02 с принадлежностями, в вариантах исполнения,

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФИМЕД»
(INFIMED Spółka z ograniczona odpowiedzialnością)

2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стол операционный VIVAX OT-02, в вариантах исполнения с принадлежностями:

I. Стол операционный VIVAX OT-02, в вариантах исполнения:

1. Стол операционный VIVAX-OT-02-422 в составе:
 - 1.1. Секция головная - 1 шт.
 - 1.2. Секция спинная - 1 шт.
 - 1.3. Секция тазовая - 1 шт.
 - 1.4. Секция ножная левая - 1 шт.
 - 1.5. Секция ножная правая - 1 шт.
 - 1.6. Матрац головной секции - 1 шт.
 - 1.7. Матрац спинной секции - 1 шт.
 - 1.8. Матрац тазовой секции - 1 шт.
 - 1.9. Матрац ножной секции левой- 1 шт.
 - 1.10. Матрац ножной секции правой- 1 шт.
 - 1.11. Пульт управления ручной - 1 шт.
 - 1.12. Стойка инфузионная специальная (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.13. Пульт управления ножной (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.14. Пульт управления беспроводной (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.15. Панель управления на колонне (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.16. Основание мобильное (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.17. Привод альтернативный дублирующий (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.18. Привод регулировки спинной секции электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.19. Привод регулировки продольного сдвига электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.20. Привод блокировки колес электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.21. Секция ножная раздельная левая в комплекте с матрацем (при необходимости) - 1 шт.
 - 1.22. Секция ножная раздельная правая в комплекте с матрацем (при необходимости) - 1 шт.
2. Стол операционный VIVAX-OT-02-522 в составе:
 - 2.1. Секция головная - 1 шт.
 - 2.2. Секция спинная верхняя - 1 шт.
 - 2.3. Секция спинная нижняя - 1 шт.
 - 2.4. Секция тазовая - 1 шт.
 - 2.5. Секция ножная левая - 1 шт.

- 2.6. Секция ножная правая - 1 шт.
- 2.7. Матрац головной секции- 1 шт.
- 2.8. Матрац спинной секции верхней - 1 шт.
- 2.9. Матрац спинной секции нижней - 1 шт.
- 2.10. Матрац тазовой секции - 1 шт.
- 2.11. Матрац ножной секции левой - 1 шт.
- 2.12. Матрац ножной секции правой - 1 шт.
- 2.13. Пульт управления ручной - 1 шт.
- 2.14. Стойка инфузионная специальная (при необходимости) - 1 шт.
- 2.15. Пульт управления ножной (при необходимости) - 1 шт.
- 2.16. Пульт управления беспроводной (при необходимости) - 1 шт.
- 2.17. Панель управления на колонне (при необходимости) - 1 шт.
- 2.18. Основание мобильное (при необходимости) - 1 шт.
- 2.19. Привод альтернативный дублирующий (при необходимости) - 1 шт.
- 2.20. Привод регулировки спинной секции электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
- 2.21. Привод регулировки продольного сдвига электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
- 2.22. Привод регулировки излома спинной секции электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
- 2.23. Привод блокировки колес электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
- 2.24. Секция ножная раздельная левая в комплекте с матрацем (при необходимости) - 1 шт.
- 2.25. Секция ножная раздельная правая в комплекте с матрацем (при необходимости) - 1 шт.

3. Стол операционный VIVAX-OT-02-546 в составе:

- 3.1. Секция головная - 1 шт.
- 3.2. Секция спинная верхняя - 1 шт.
- 3.3. Секция спинная нижняя - 1 шт.
- 3.4. Секция тазовая - 1 шт.
- 3.5. Секция ножная левая - 1 шт.
- 3.6. Секция ножная правая - 1 шт.
- 3.7. Матрац головной секции - 1 шт.
- 3.8. Матрац спинной секции верхней - 1 шт.
- 3.9. Матрац спинной секции нижней - 1 шт.
- 3.10. Матрац тазовой секции - 1 шт.
- 3.11. Матрац ножной секции левой - 1 шт.
- 3.12. Матрац ножной секции правой - 1 шт.
- 3.13. Секция расширения ложа в комплекте с матрацем - 4 шт.
- 3.14. Пульт управления ручной - 1 шт.
- 3.15. Стойка инфузионная специальная (при необходимости) - 1 шт.
- 3.16. Пульт управления ножной (при необходимости) - 1 шт.

- 3.17. Пульт управления беспроводной (при необходимости) - 1 шт.
- 3.18. Панель управления на колонне (при необходимости) - 1 шт.
- 3.19. Основание мобильное (при необходимости) - 1 шт.
- 3.20. Привод альтернативный дублирующий (при необходимости) - 1 шт.
- 3.21. Привод регулировки спинной секции электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
- 3.22. Привод регулировки продольного сдвига электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
- 3.23. Привод регулировки излома спинной секции электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
- 3.24. Привод блокировки колес электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
- 3.25. Секция ножная раздельная левая в комплекте с матрасом (при необходимости) - 1 шт.
- 3.26. Секция ножная раздельная правая в комплекте с матрасом (при необходимости) - 1 шт.

4. Стол операционный VIVAX-OT-02-322 в составе:

- 4.1. Секция головная - 1 шт.
- 4.2. Секция спинная центральная - 1 шт.
- 4.3. Секция спинная левая - 1 шт.
- 4.4. Секция спинная правая - 1 шт.
- 4.5. Секция спинная нижняя - 1 шт.
- 4.6. Секция тазовая - 1 шт.
- 4.7. Секция ножная левая - 1 шт.
- 4.8. Секция ножная правая - 1 шт.
- 4.9. Матрац головной секции - 1 шт.
- 4.10. Матрац спинной секции центральной - 1 шт.
- 4.11. Матрац спинной секции левой - 1 шт.
- 4.12. Матрац спинной секции правой - 1 шт.
- 4.13. Матрац спинной секции нижней - 1 шт.
- 4.14. Матрац тазовой секции - 1 шт.
- 4.15. Матрац ножной секции левой - 1 шт.
- 4.16. Матрац ножной секции правой - 1 шт.
- 4.17. Стойка инфузионная специальная (при необходимости) - 1 шт.
- 4.18. Пульт управления ручной - 1 шт.
- 4.19. Пульт управления ножной (при необходимости) - 1 шт.
- 4.20. Пульт управления беспроводной (при необходимости) - 1 шт.
- 4.21. Панель управления на колонне (при необходимости) - 1 шт.
- 4.22. Основание мобильное (при необходимости) - 1 шт.
- 4.23. Привод альтернативный дублирующий (при необходимости) - 1 шт.
- 4.24. Привод регулировки спинной секции электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
- 4.25. Привод регулировки продольного сдвига электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
- 4.26. Привод блокировки колес электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.

- 4.27. Секция ножная раздельная левая в комплекте с матрацем (при необходимости) - 1 шт.
- 4.28. Секция ножная раздельная правая в комплекте с матрацем (при необходимости) - 1 шт.

5. Стол операционный VIVAX-OT-02-722 в составе:

- 5.1. Секция ложа - 1 шт.
- 5.2. Матрац (при необходимости) - 1 шт.
- 5.3. Пульт управления проводной - 1 шт.
- 5.4. Пульт управления беспроводной (при необходимости) - 1 шт.
- 5.5. Стойка инфузионная специальная (при необходимости) - 1 шт.
- 5.6. Пульт управления в виде джойстика (при необходимости) - 1 шт.
- 5.7. Привод регулировки продольного сдвига электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.
- 5.8. Привод регулировки латерального сдвига электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.

II. Принадлежности для всех вариантов исполнения:

- 1. Зажим для дополнительного оборудования из нержавеющей стали - не более 6 шт.
- 2. Зажим для дополнительного оборудования из карбонового углеродного волокна - не более 6 шт.
- 3. Зажим однопозиционный - не более 25 шт.
- 4. Зажим мультипозиционный - не более 14 шт.
- 5. Опора для колена - не более 2 шт.
- 6. Опора для руки регулируемая - не более 2 шт.
- 7. Опора для руки - не более 2 шт.
- 8. Держатель бедер - не более 2 шт.
- 9. Упор для плеча/ Упор боковой - не более 4 шт.
- 10. Упор боковой - не более 4 шт.
- 11. Дуга анестезиолога - не более 1 шт.
- 12. Дуга анестезиолога с регулировкой ширины - не более 1 шт.
- 13. Держатель руки/Держатель голени - не более 2 шт.
- 14. Опора колена для операций на мениске - не более 2 шт.
- 15. Опора для руки с горизонтальным смещением - не более 2 шт.
- 16. Упор для плеча/ Упор боковой регулируемый - не более 4 шт.
- 17. Ремень для фиксации голени с пряжкой - не более 2 шт.
- 18. Ремень для фиксации бедра с пряжкой - не более 2 шт.
- 19. Ремень для фиксации туловища с пряжкой - не более 1 шт.
- 20. Ремень для фиксации запястья с пряжкой - не более 2 шт.
- 21. Лоток гинекологический - не более 1 шт.
- 22. Лоток урологический с дренажной системой - не более 1 шт.
- 23. Приставка гинекологическая - не более 1 шт.

24. Приставка урологическая - не более 1 шт.
25. Тележка для аксессуаров на роликах - не более 1 шт.
26. Приставка для операций на руке - не более 1 шт.
27. Держатель анестезиологических трубок и шлангов - не более 1 шт.
28. Лоток для инструментария - не более 1 шт.
29. Держатель рентген кассеты - не более 1 шт.
30. Опора грудной клетки - не более 1 шт.
31. Приставка для операции колена - не более 1 шт.
32. Опора лобковая - не более 1 шт.
33. Опора для ног (1-секционная) - не более 1 шт.
34. Приставка проктологическая - не более 1 шт.
35. Рельс боковой - не более 6 шт.
36. Секция удлинения ложа - не более 1 шт.
37. Ремень для стабилизации руки на стойке анестезиолога - не более 2 шт.
38. Секция расширения ложа - не более 4 шт.
39. Опора для ноги (2-х секционная) - не более 2 шт.
40. Секция рентгенпрозрачная ножная - не более 2 шт.
41. Приставка ортопедическая - не более 1 шт.
42. Подпорка - стержень - не более 2 шт.
43. Подпорка ноги - не более 2 шт.
44. Подпорка для гипсования - не более 1 шт.
45. Зажим держателя стопы - не более 2 шт.
46. Держатель стопы - не более 2 шт.
47. Зажим для ортопедической приставки - не более 4 шт.
48. Приставка для операции на колене для ортопедической приставки - не более 2 шт.
49. Держатель бедра для боковой позиции - не более 2 шт.
50. Опора напольная для плеч ортопедической приставки (пара) - не более 2 шт.
51. Опора колена для боковой позиции - не более 2 шт.
52. Тележка для ортопедической приставки в собранном виде - не более 1 шт.
53. Тележка для аксессуаров ортопедической приставки в разобранном виде - не более 1 шт.
54. Ботинки для тракционного аппарата - не более 2 шт.
55. Приставка тракционная для хирургии руки - не более 1 шт.
56. Приставка для хирургии плеча, включая головную секцию - не более 1 шт.
57. Приставка Лор-офтальмологическая - не более 1 шт.
58. Секция Лор-офтальмологическая головная с регулировкой расстояния - не более 1 шт.
59. Секция специализированная головная в форме подковы - не более 1 шт.
60. Секция ортопедическая головная - не более 1 шт.
61. Секция торакальная головная - не более 1 шт.

- 62. Адаптер для головных секций - не более 1 шт.
- 63. Поддержка рук хирурга - не более 1 шт.
- 64. Матрац для хирургии позвоночника - не более 1 шт.
- 65. Приставка нейрохирургическая - не более 1 шт.
- 66. Блок регулируемый базовый - не более 1 шт.
- 67. Адаптер шарнирный - не более 1 шт.
- 68. Зажим черепной - не более 1 шт.
- 69. Штыри многоразовые для черепа (детские) - не более 3 шт.
- 70. Штыри многоразовые для черепа (взрослые) - не более 3 шт.
- 71. Перекладина для нейрохирургических операций в положении «сидя» - не более 1 шт.
- 72. Зажим для перекладины - не более 2 шт.
- 73. Крепление подковообразного подголовника для взрослых- не более 2 шт.
- 74. Подушка подковообразная взрослая, правая - не более 1 шт.
- 75. Подушка подковообразная взрослая, левая - не более 1 шт.
- 76. Крепление подковообразного подголовника для детей - не более 2 шт.
- 77. Подушка подковообразная детская, правая - не более 1 шт.
- 78. Подушка подковообразная детская, левая - не более 1 шт.
- 79. Подголовник гелевый - не более 1 шт.
- 80. Подлокотник гелевый - не более 2 шт.
- 81. Подставка для пятки гелевая - не более 2 шт.
- 82. Валик грудной гелевый - не более 1 шт.
- 83. Подушка гелевая универсальная - не более 3 шт.
- 84. Коврик гелевый на операционный стол - не более 2 шт.

1. Стол операционный VIVAX-OT-02-422



 **INFIMED**



Infimed Sp. z o. o.
ul. Kabaty 1
34-300 Zywiec
Made in POLAND



IP-X4



Symbol: **VIVAX OT-02-422**

SN: 0819 / 430

~230V / 50-60Hz

200VA

2 min / 18 min

1.1. Секция головная - 1 шт.



1.2. Секция спинная




1.4. Секция ножная левая.



1.5. Секция ножная правая.




1.6. Матрац головной секции.

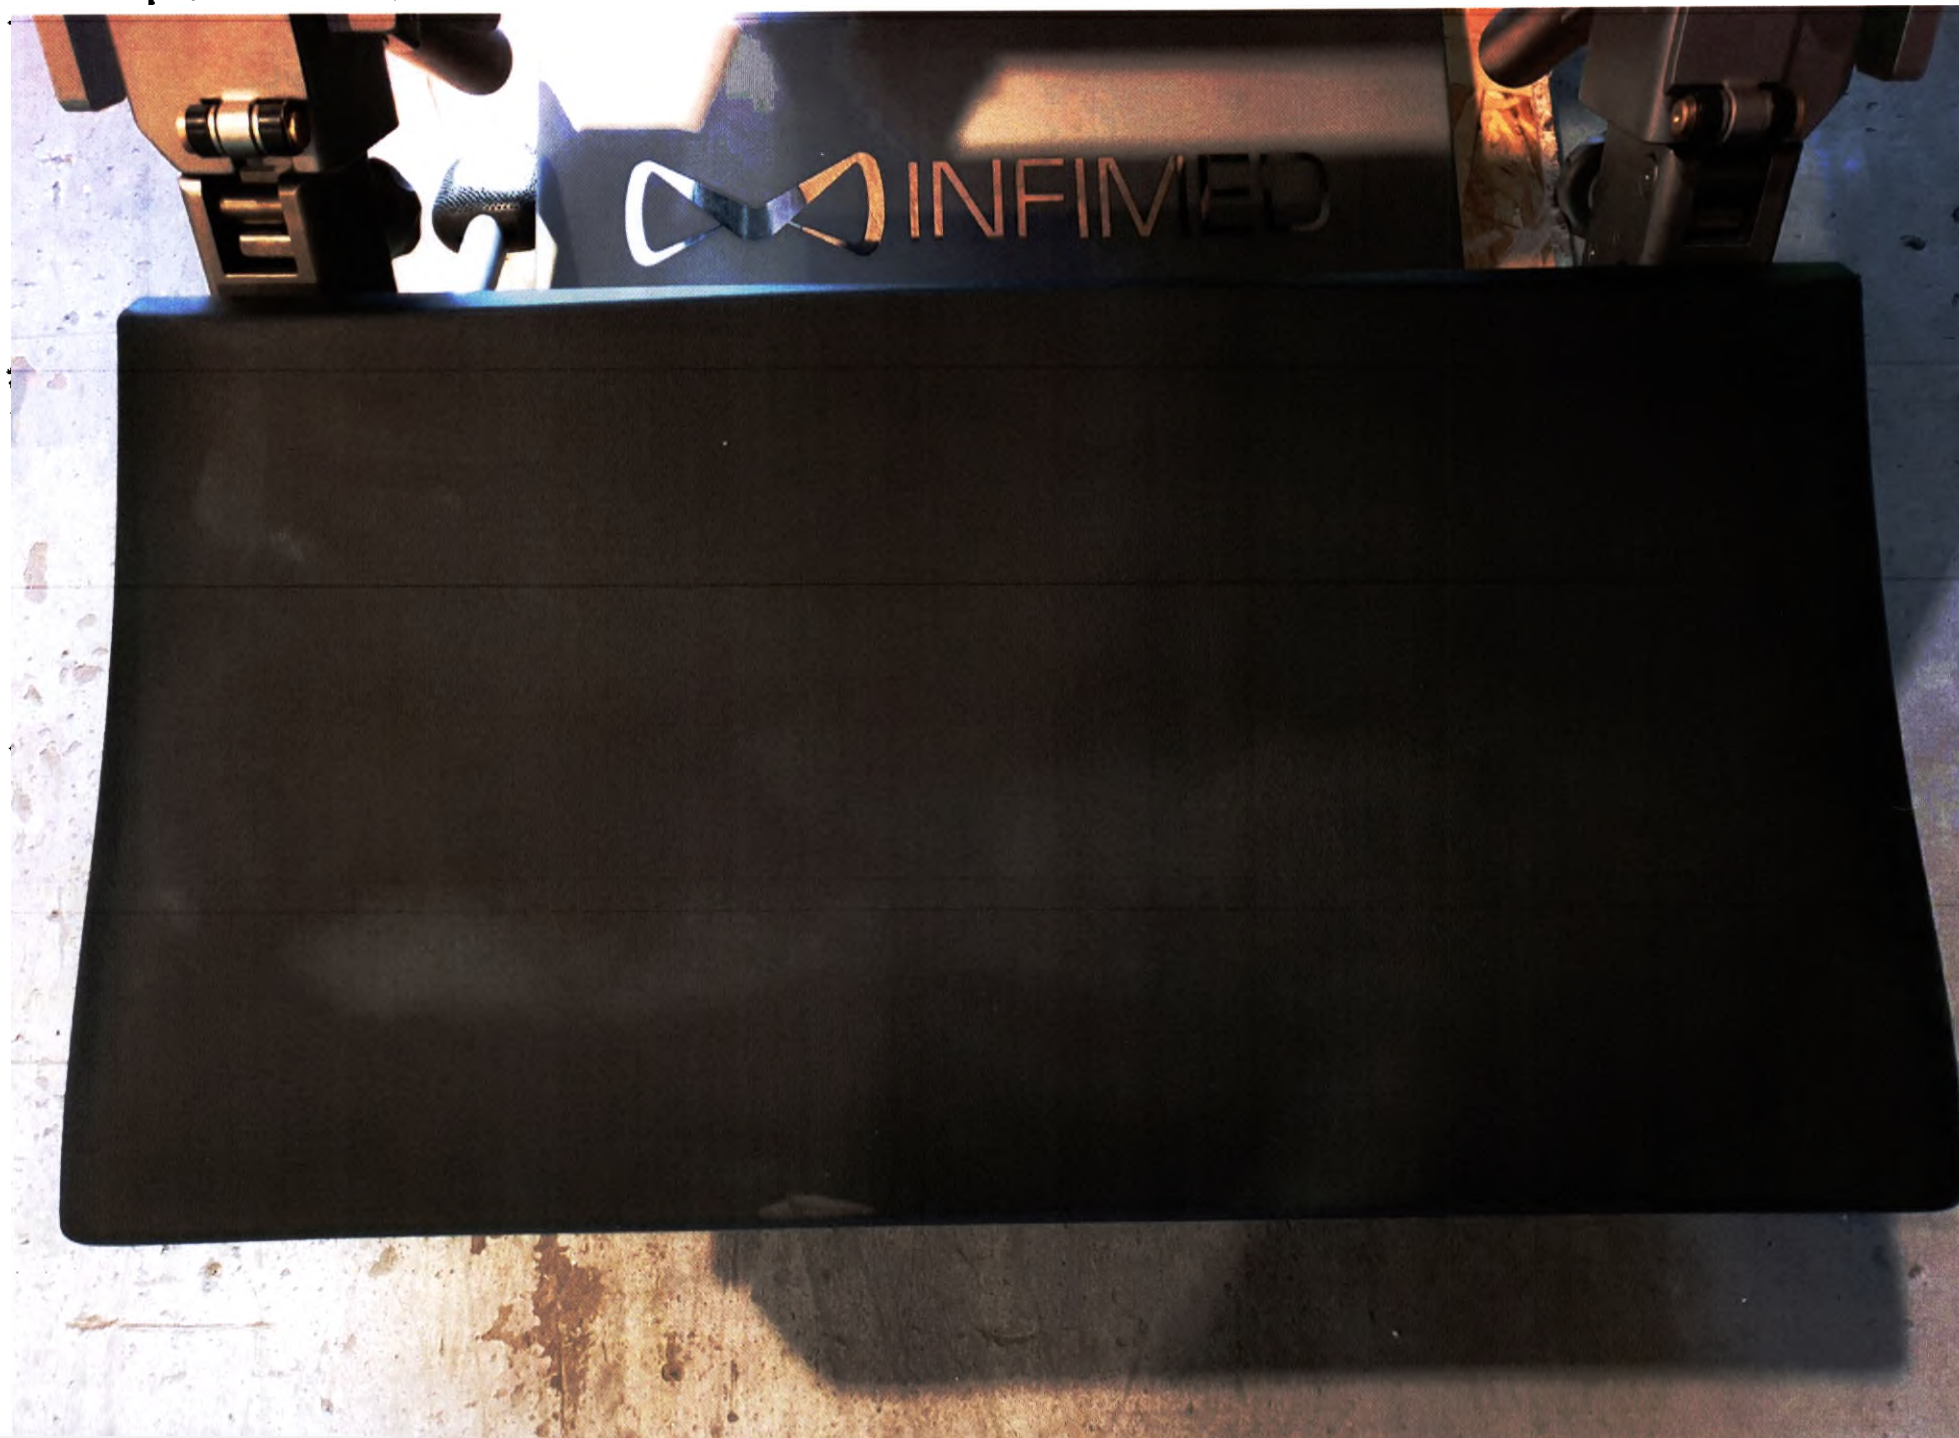

1.7. Матрац спинной секции.



1.8. Матрац тазовой секции.

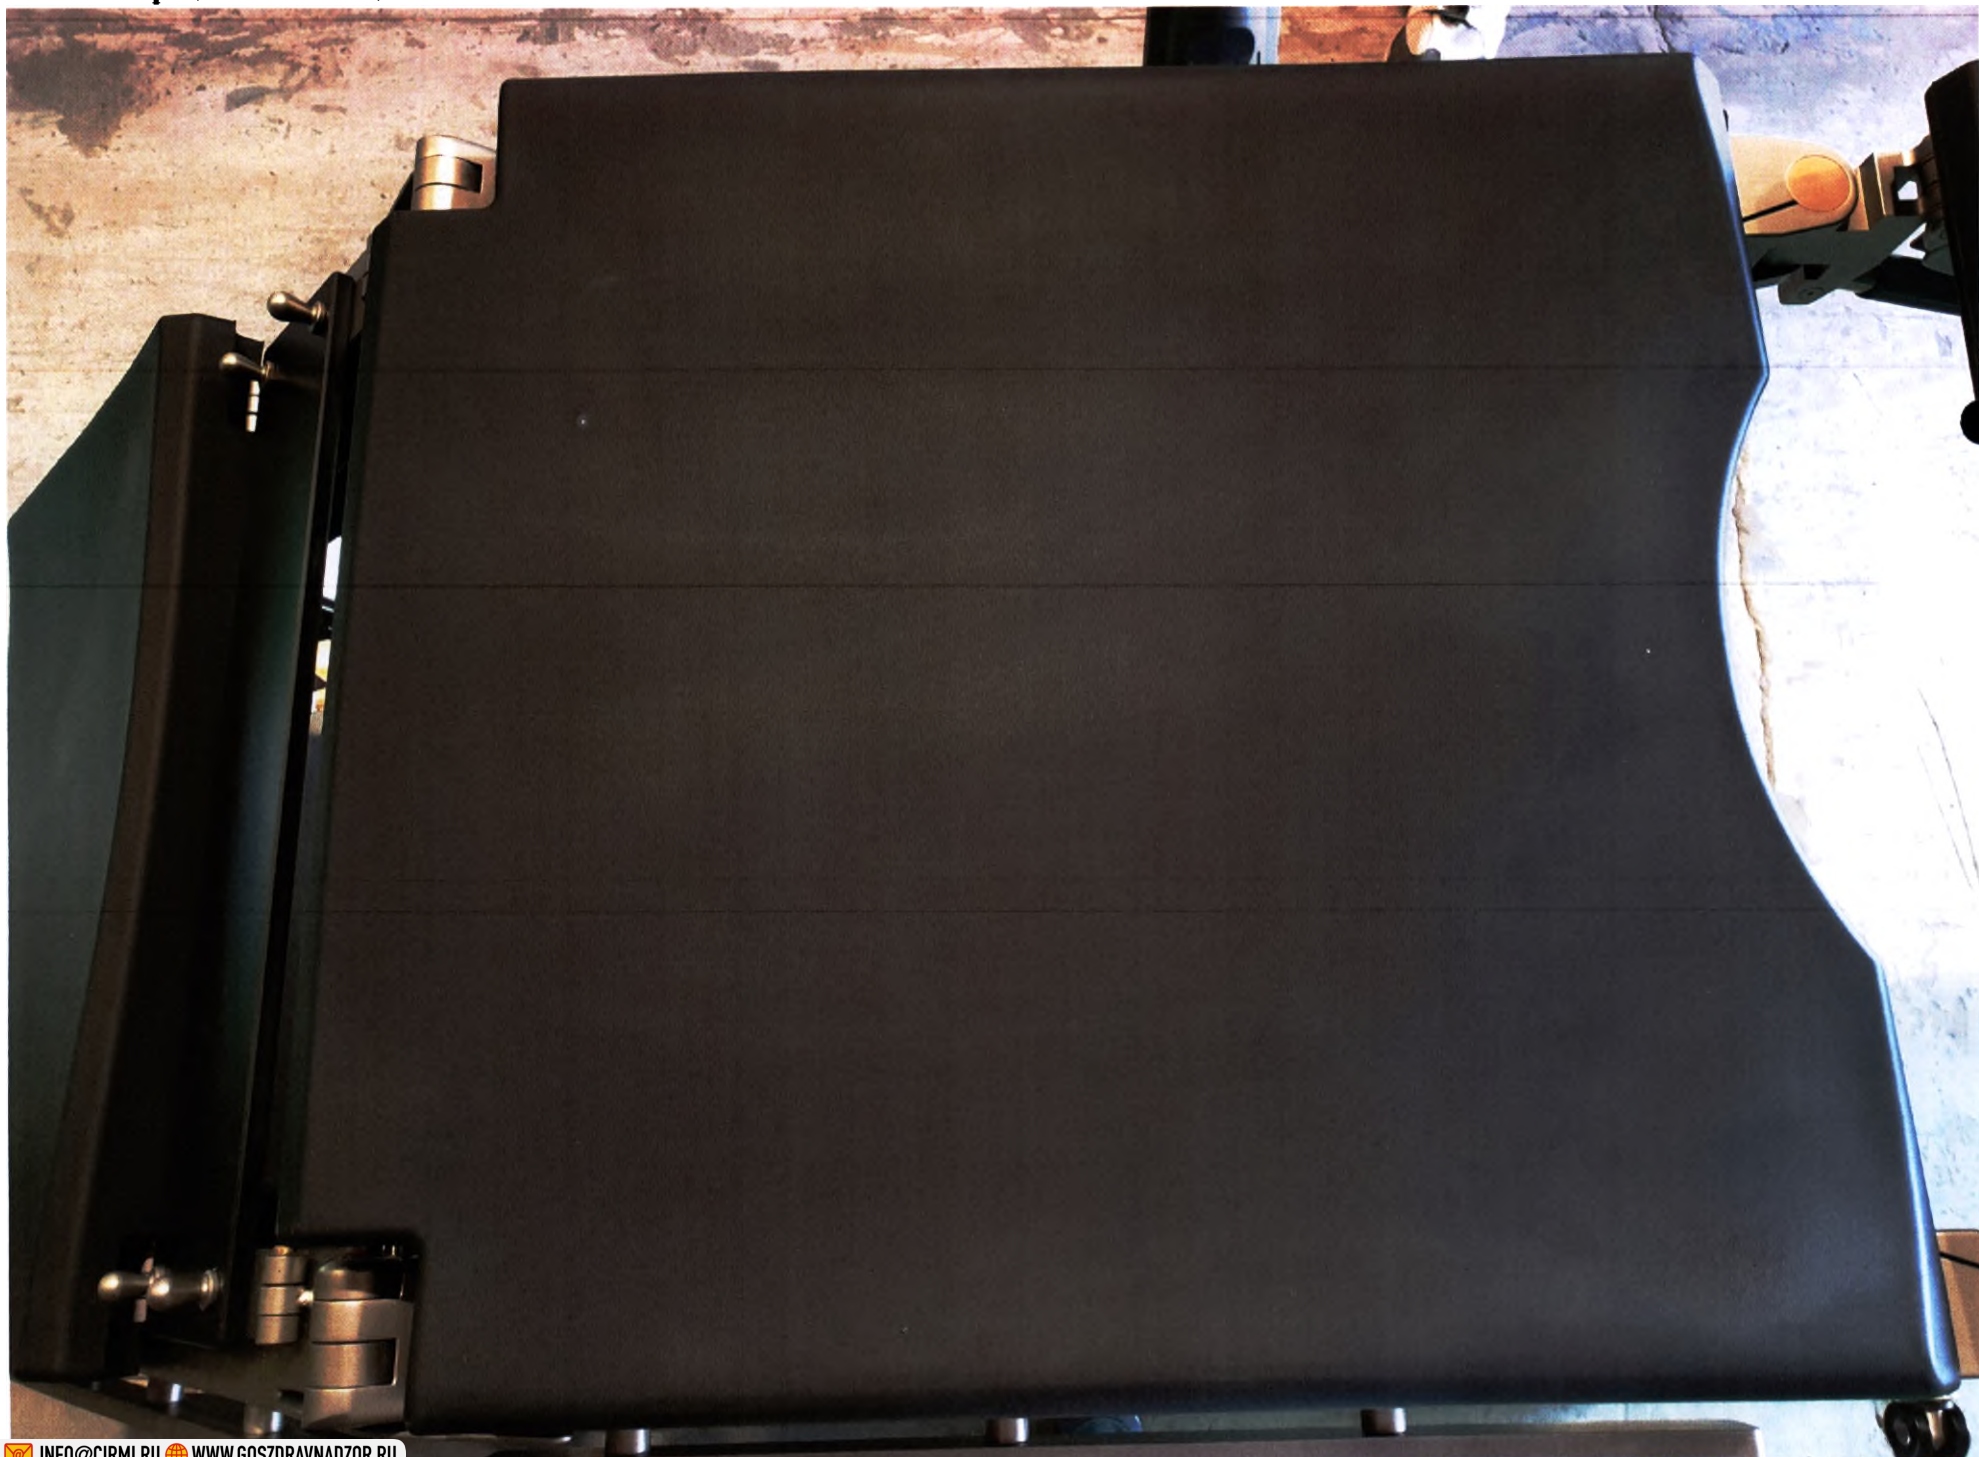

1.9. Матрац ножной секции левой.



1.10. Матрац ножной секции правой.



1.11. Пульт управления ручной.



1.12. Стойка инфузионная специальная (при необходимости).



1.13. Пульт управления ножной (при необходимости).



1.14. Пульт управления беспроводной (при необходимости).



1.15. Панель управления на колонне (при необходимости).



1.16. Основание мобильное (при необходимости).



1.17. Привод альтернативный дублирующий (при необходимости).



1.18. Привод регулировки спинной секции электрогидравлический (при необходимости).



1.19. Привод регулировки продольного сдвига электрогидравлический (при необходимости).



1.20. Привод блокировки колес электрогидравлический (при необходимости).




1.21. Секция ножная раздельная левая в комплекте с матрасом (при необходимости).



1.22. Секция ножная раздельная правая в комплекте с матрасом (при необходимости).



Стол операционный VIVAX-OT-02-522.

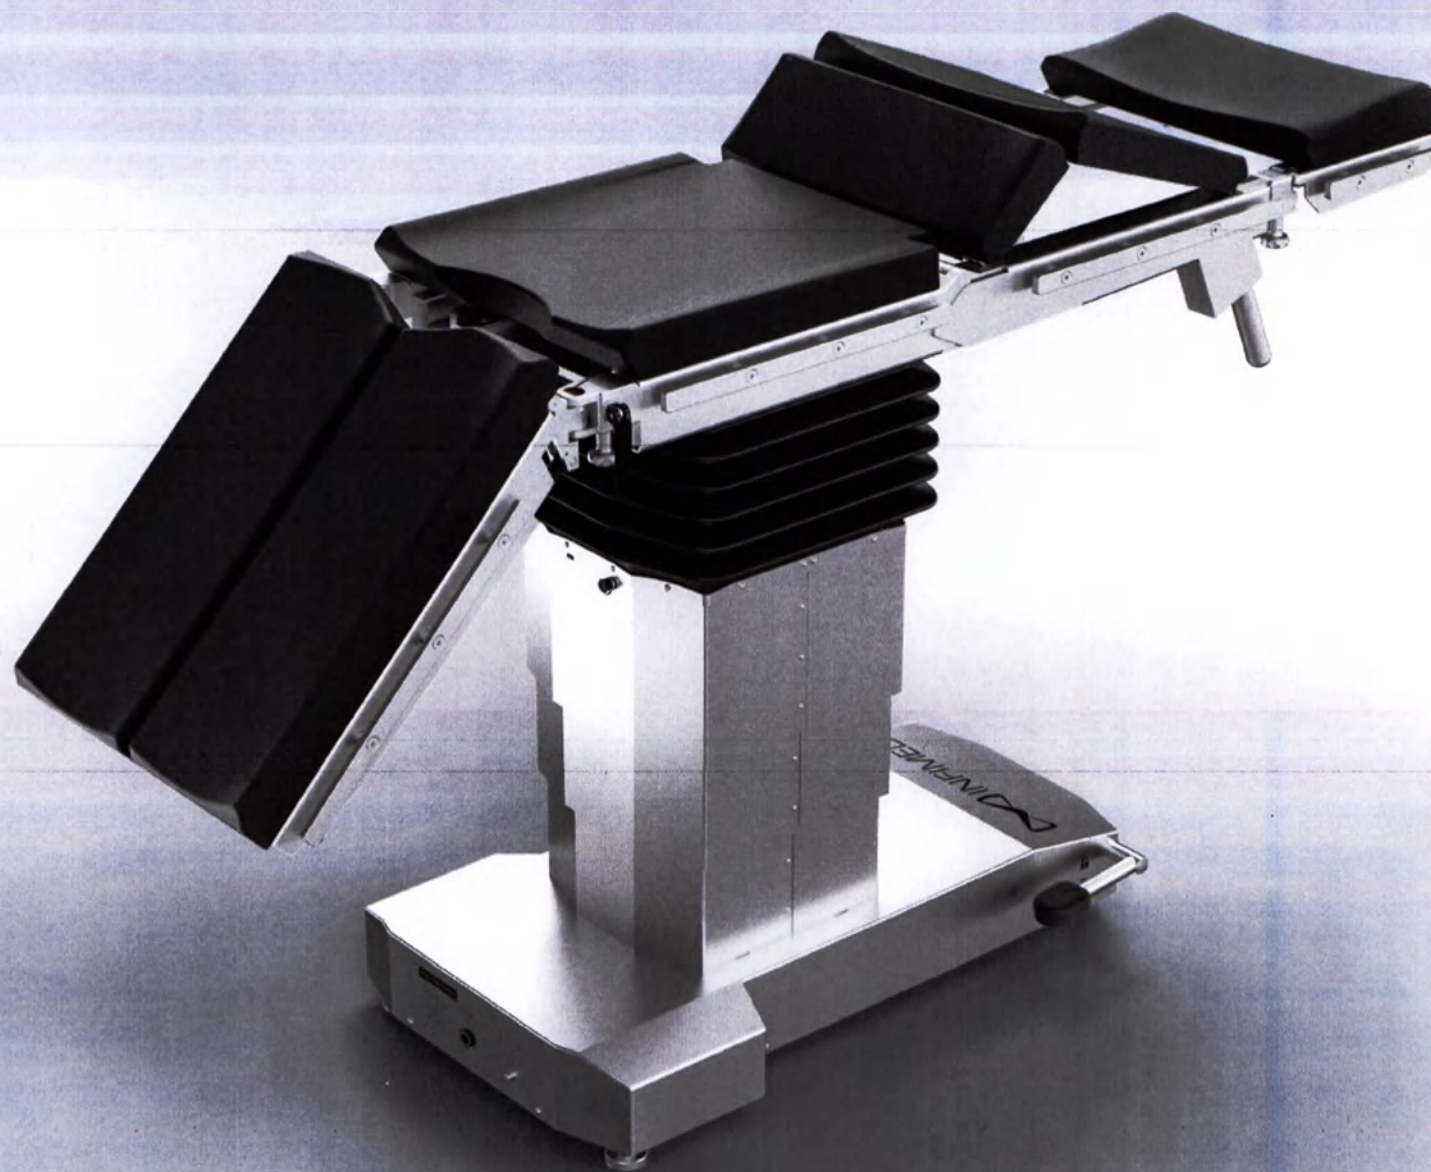

 **INFIMED**



Infimed Sp. z o. o.
ul. Kabaty 1
34-300 Zywiec
Made in POLAND



IP-X4



Symbol: **VIVAX OT-02-522**

SN: 0819 / 429

2 min / 18 min

~230V / 50-60Hz
200VA

2.1. Секция головная.




2.2. Секция спинная верхняя.



2.3. Секция спинная нижняя.




2.4. Секция тазовая.

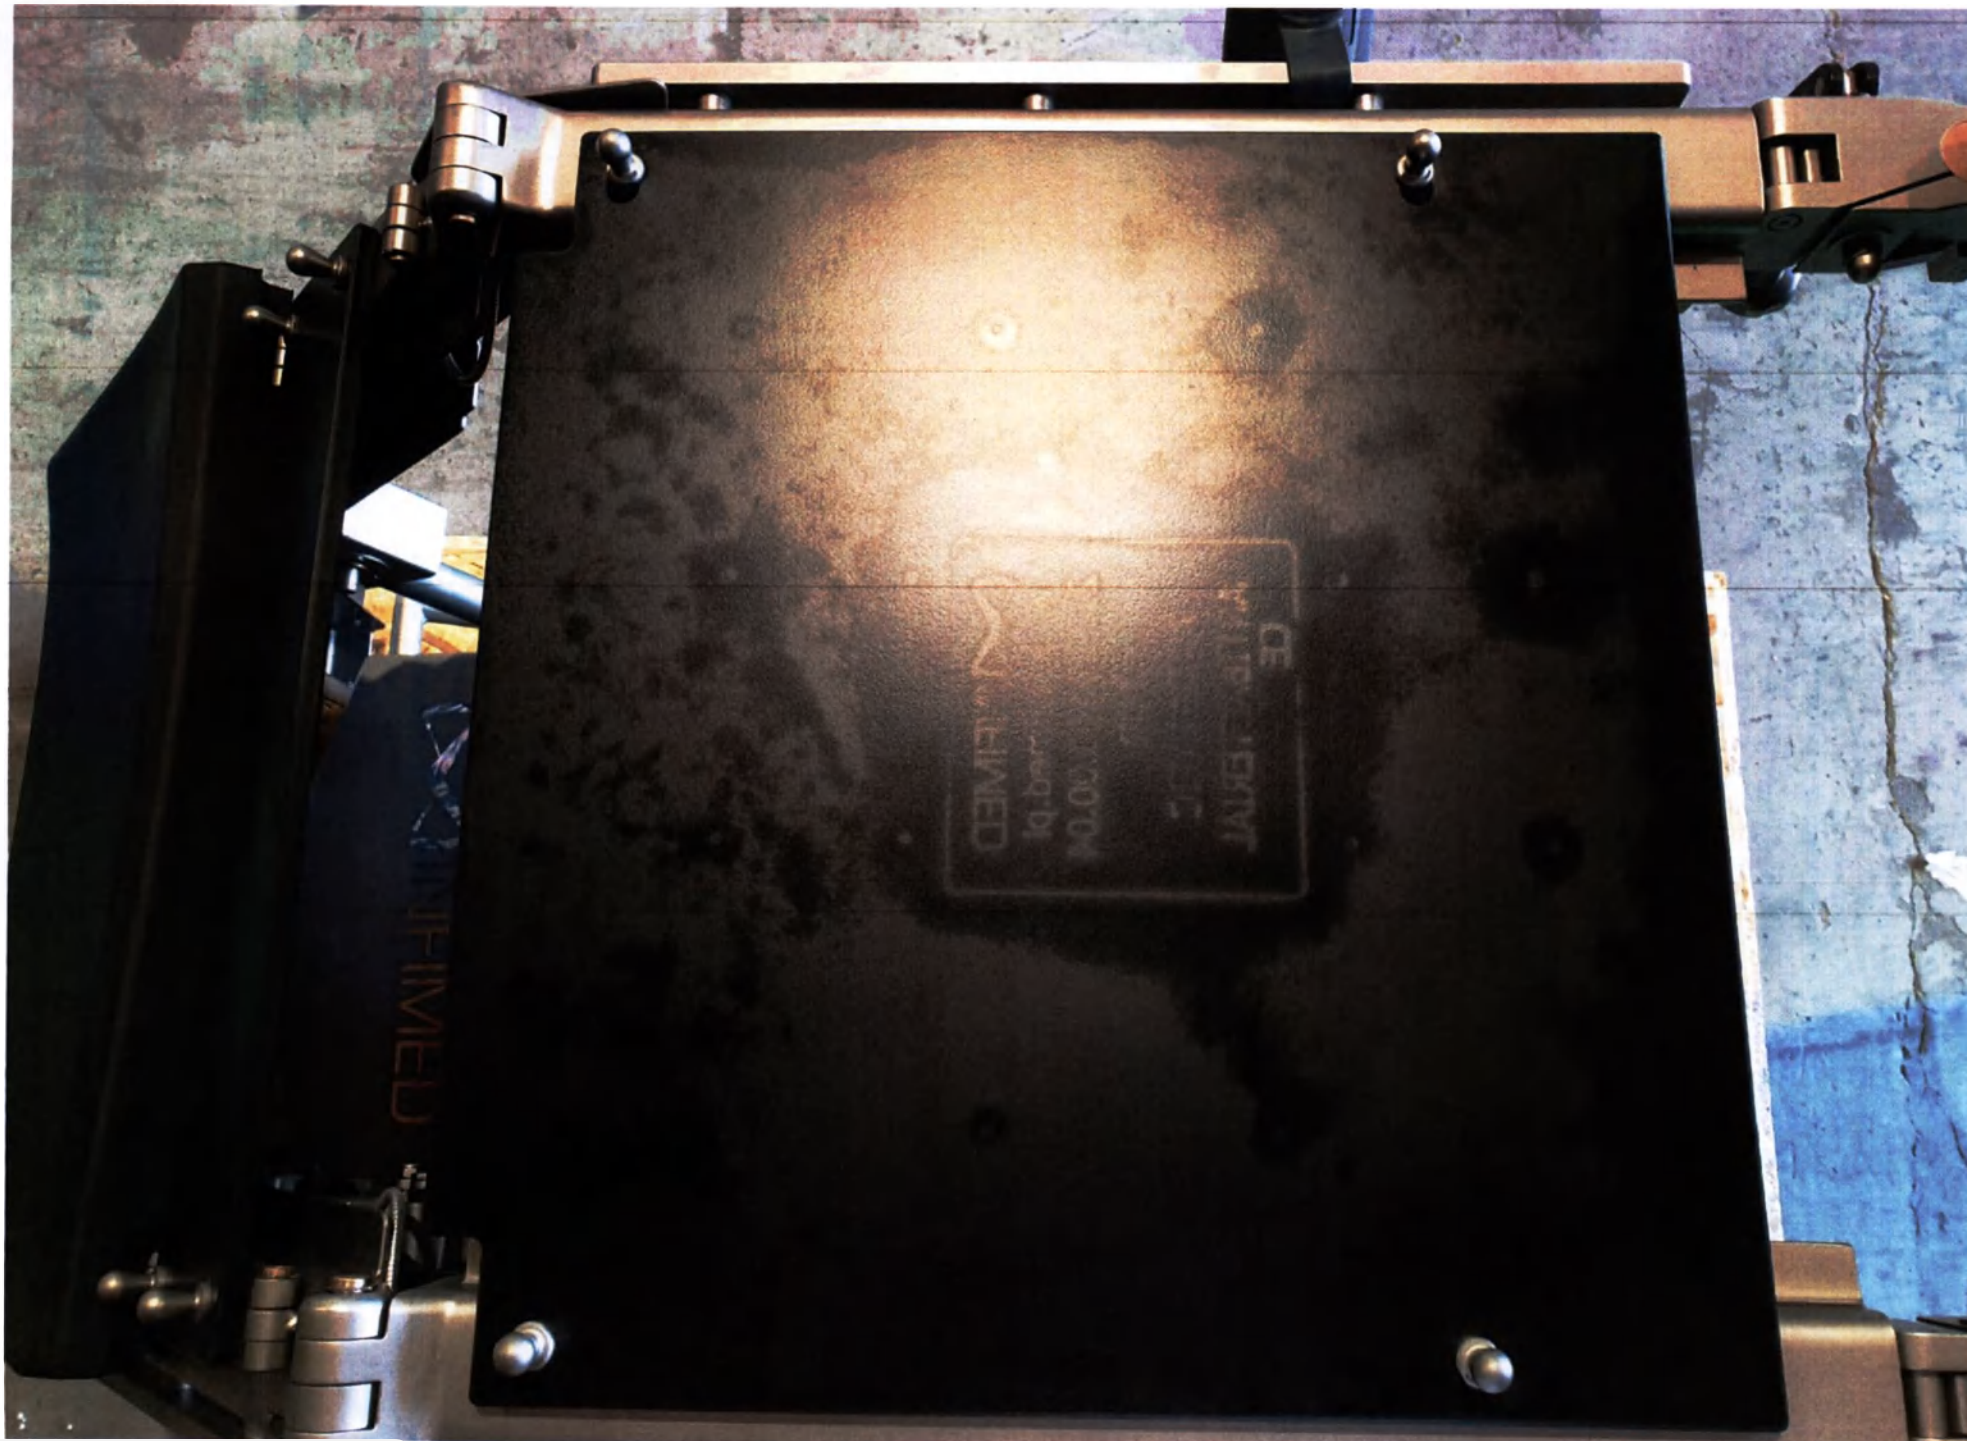


2.5. Секция ножная левая.



2.6. Секция ножная правая.

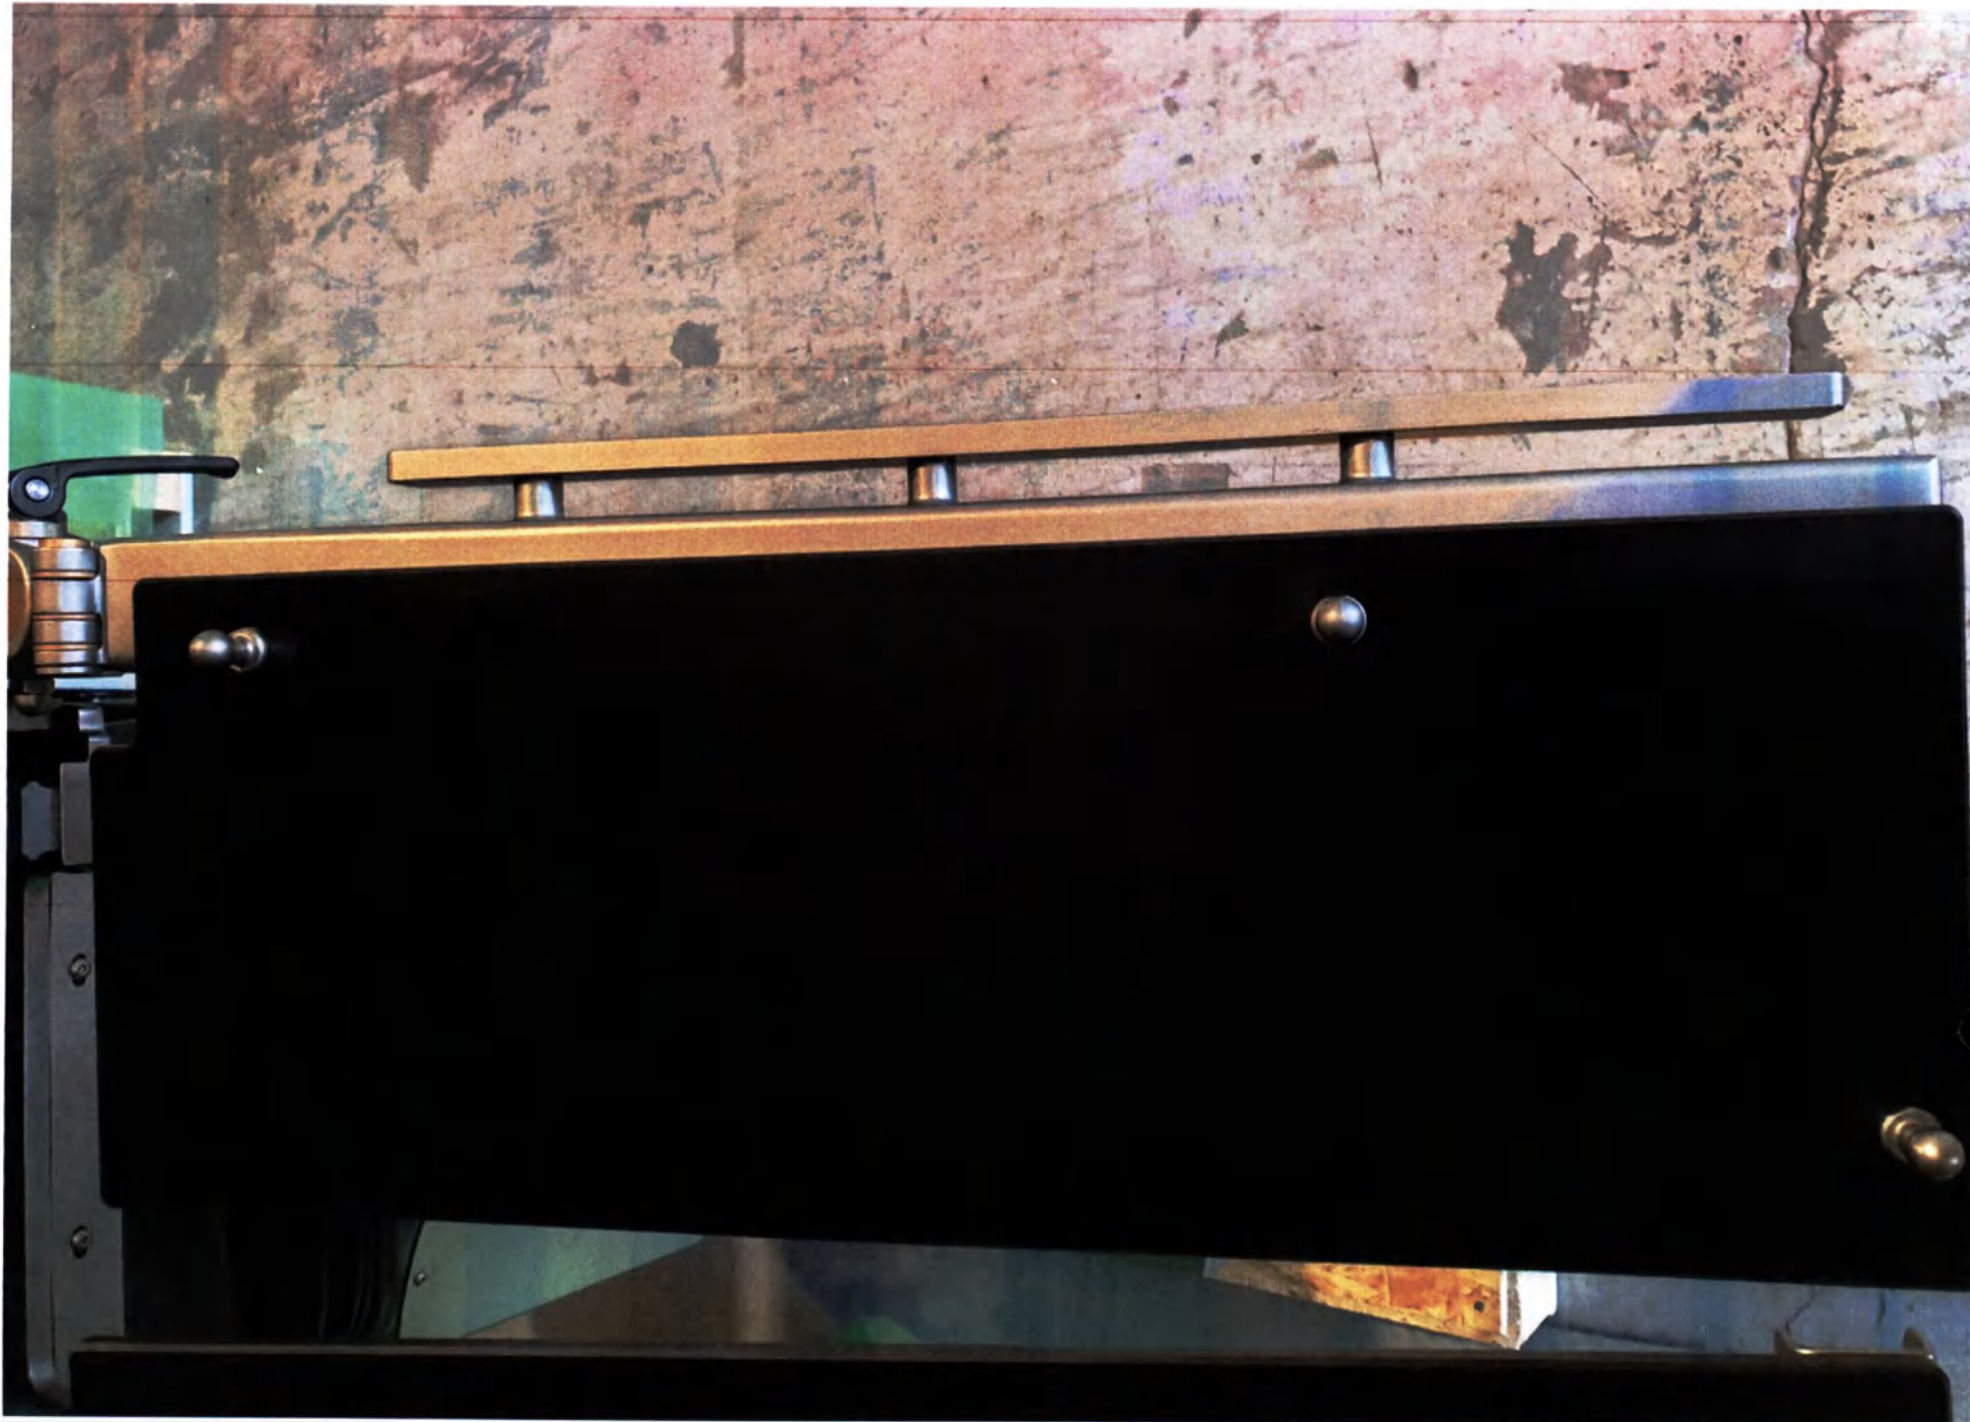

2.7. Матрац головной секции.

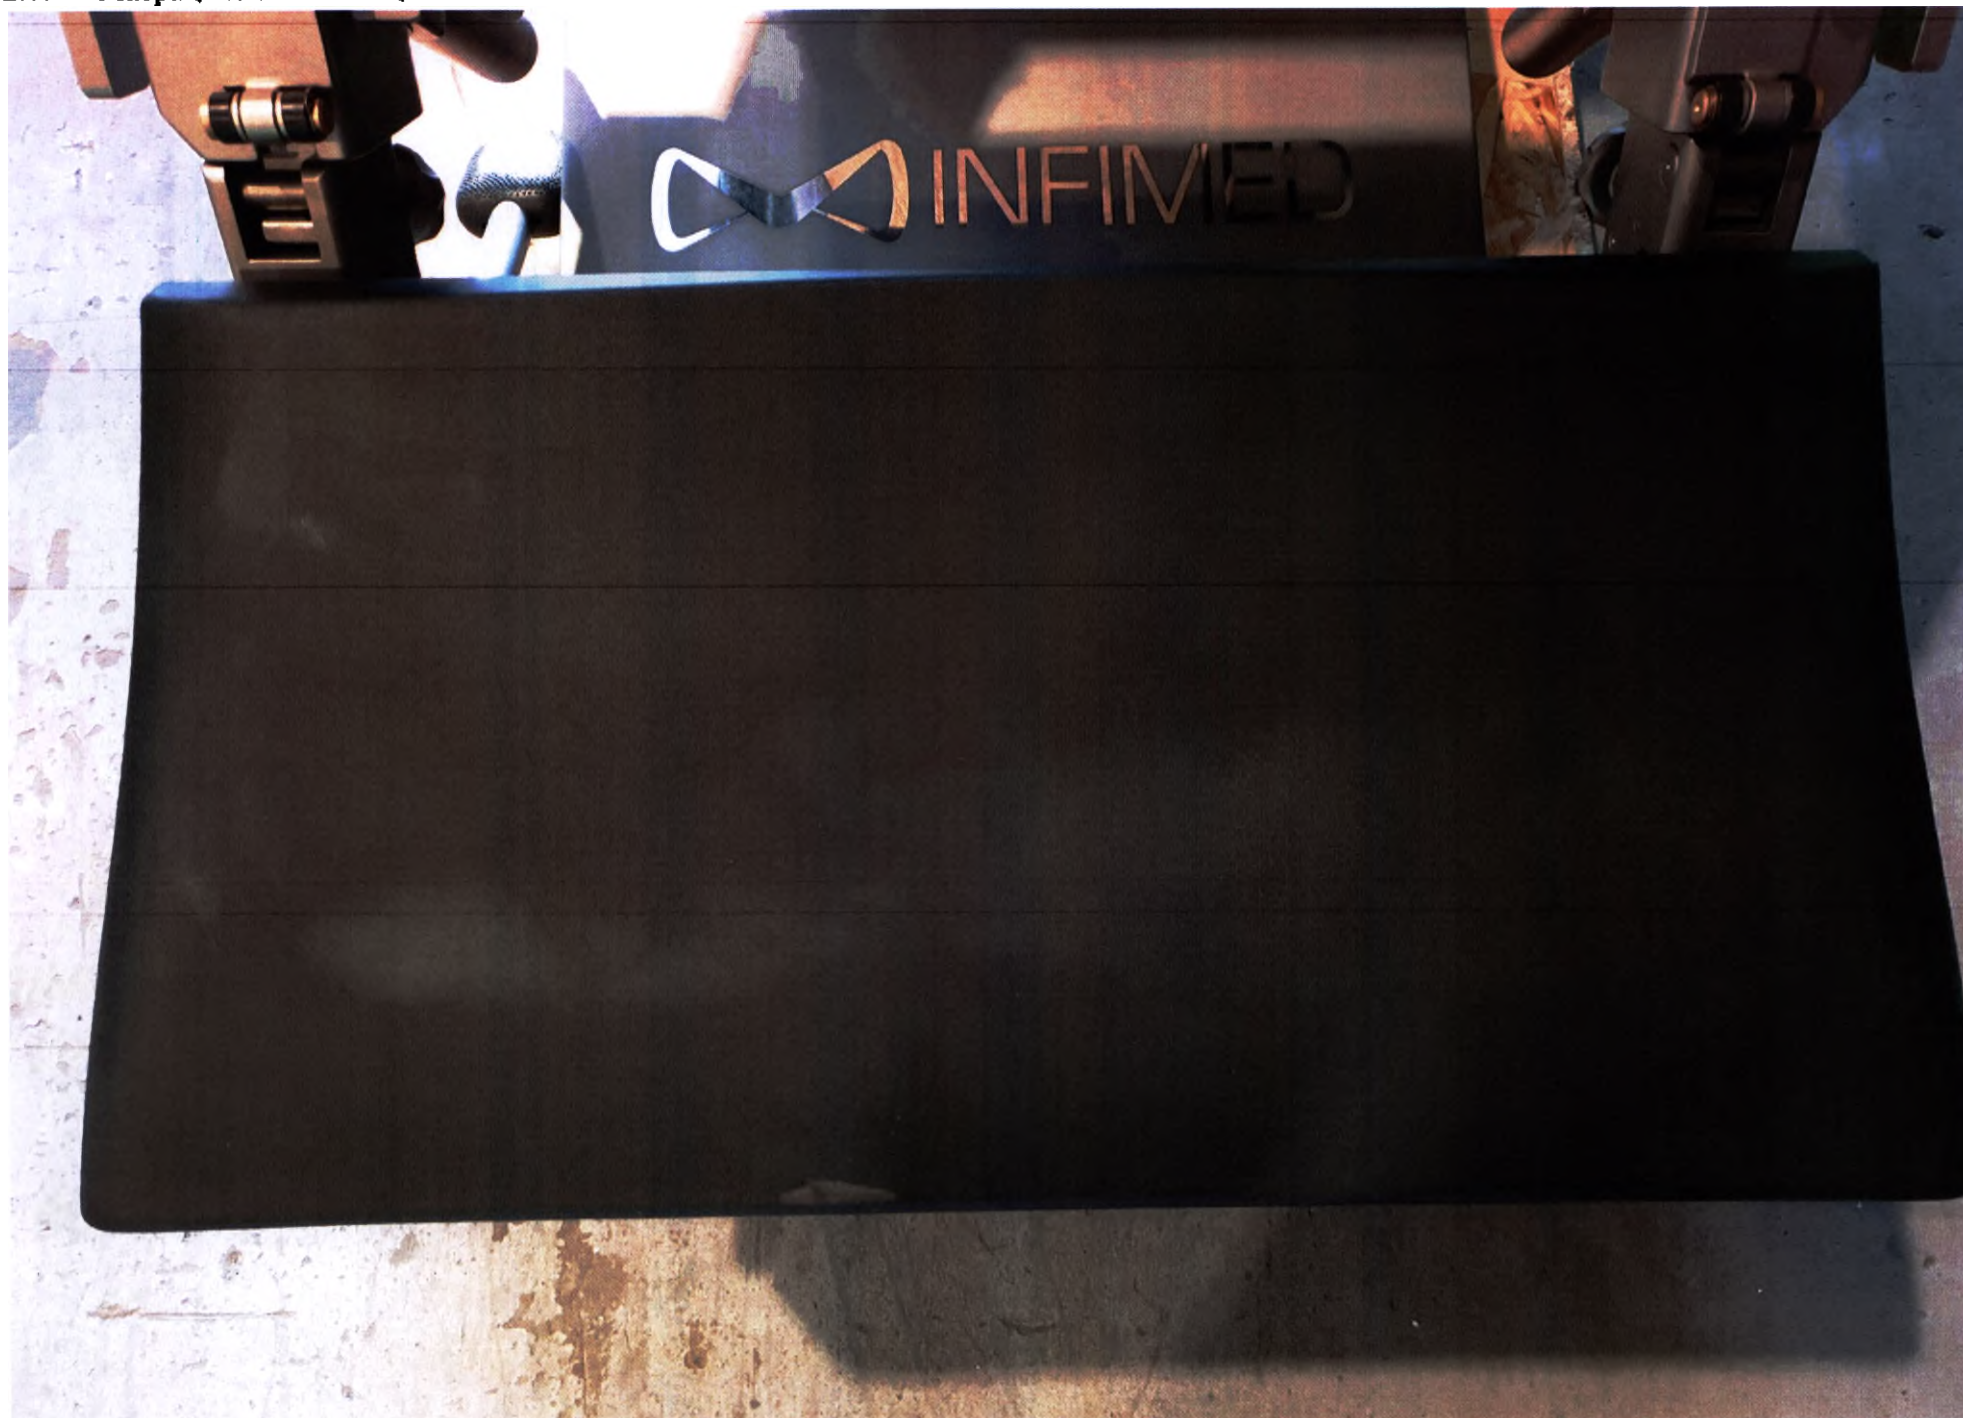


2.8. Матрац спинной секции верхней.



2.9. Матрац спинной секции нижней.



2.10. Матрац тазовой секции.

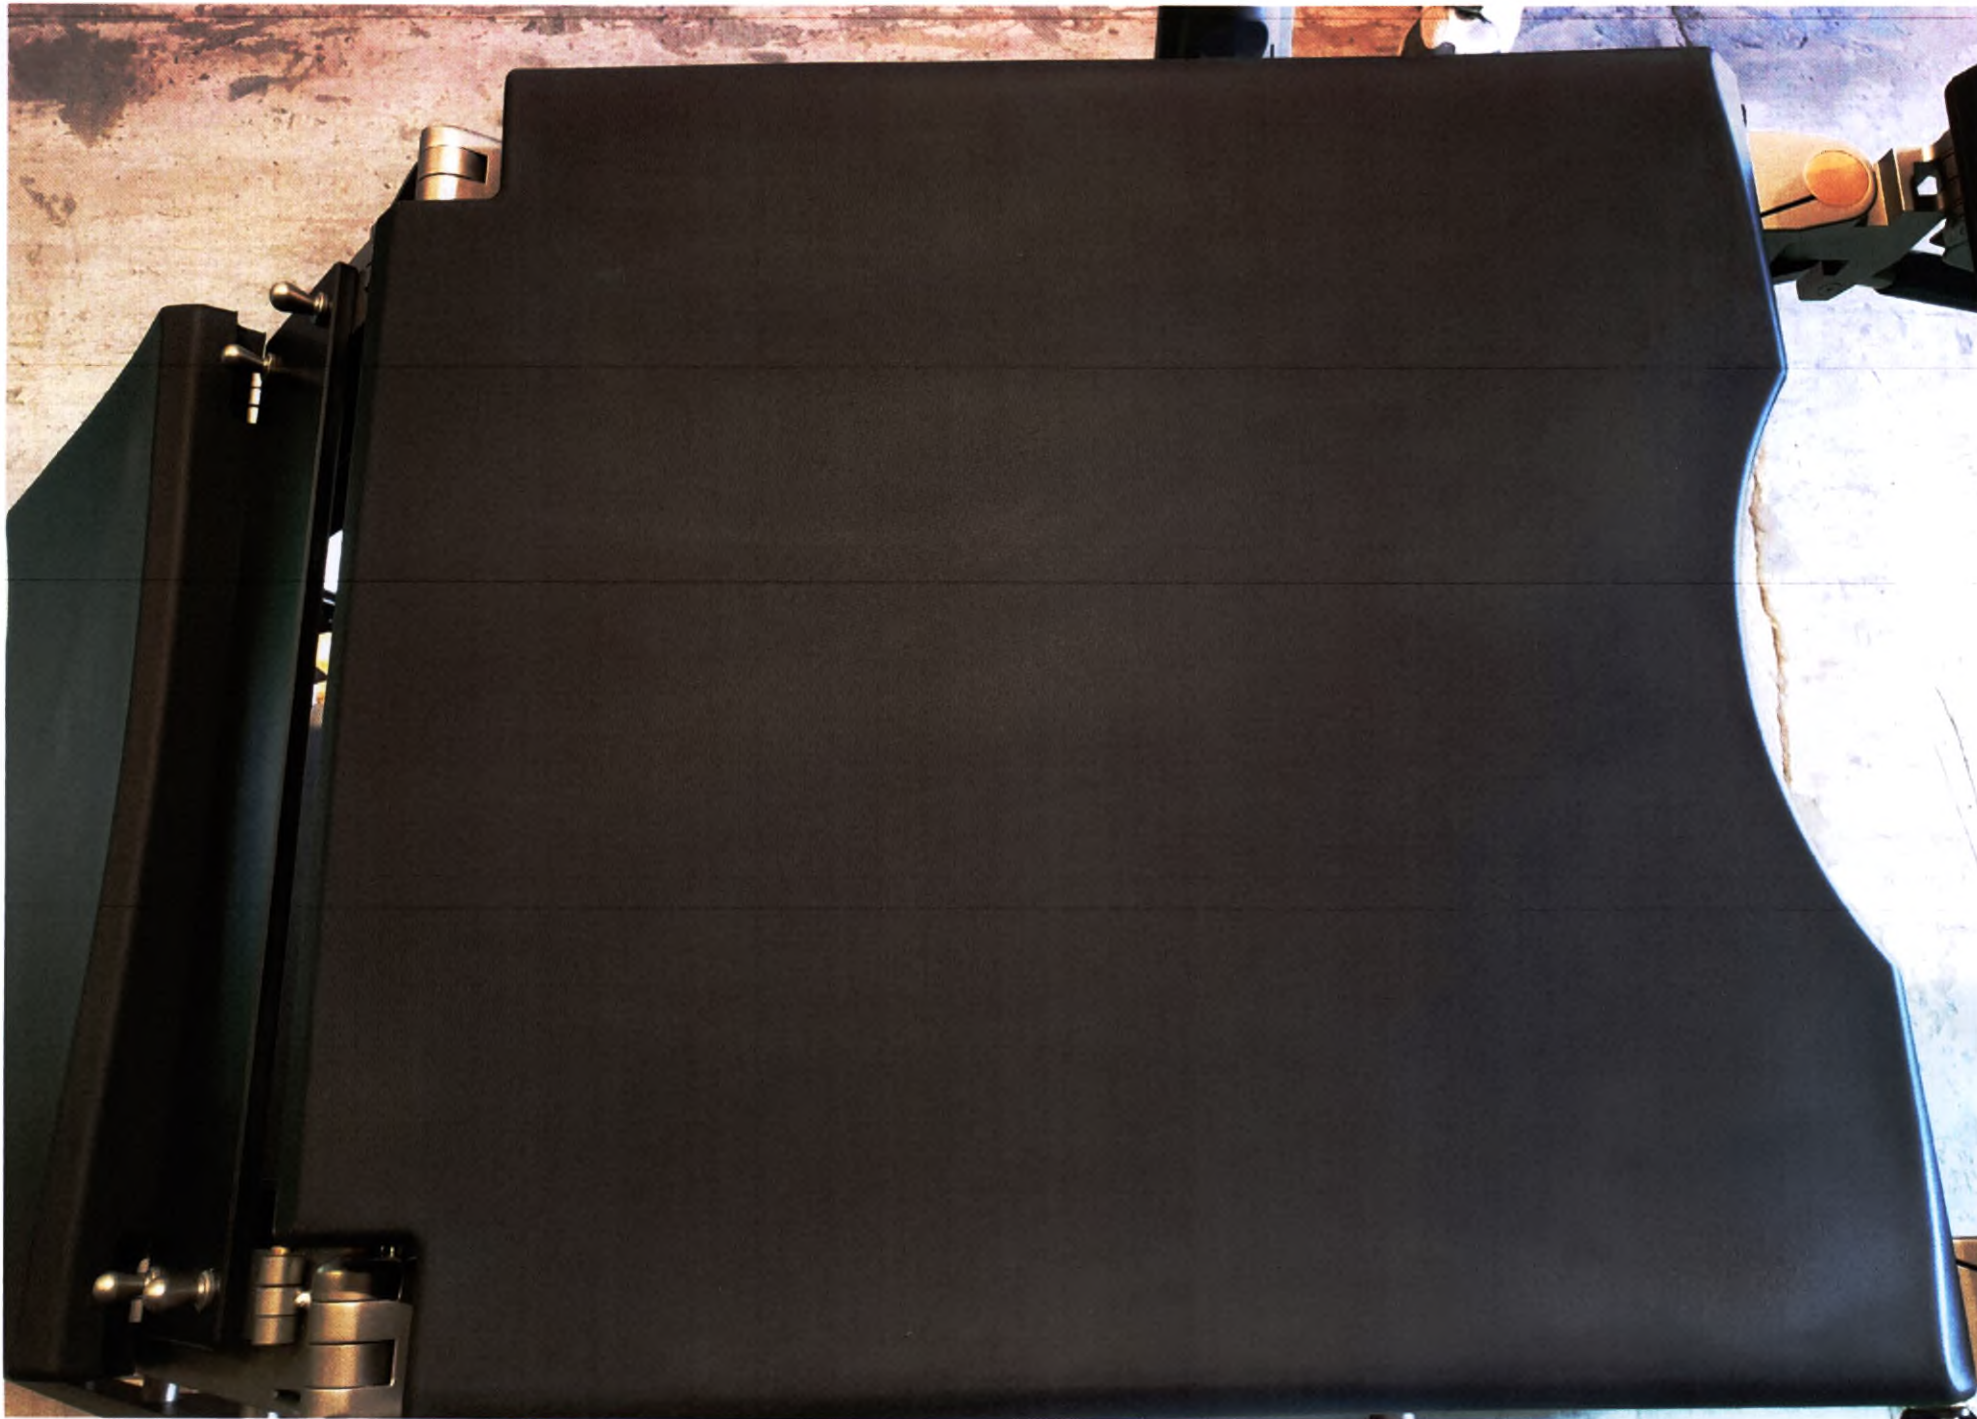

2.11. Матрац ножной секции левой.



2.12. Матрац ножной секции правой.



2.13. Пульт управления ручной.



2.14. Стойка инфузионная специальная (при необходимости).



2.15. Пульт управления ножной (при необходимости).



2.16. Пульт управления беспроводной (при необходимости).



2.17. Панель управления на колонне (при необходимости).



2.18. Основание мобильное (при необходимости).



2.19. Привод альтернативный дублирующий (при необходимости).




2.20. Привод регулировки спинной секции электрогидравлический (при необходимости).




2.21. Привод регулировки продольного сдвига электрогидравлический (при необходимости).



2.22. Привод регулировки излома спинной секции электрогидравлический (при необходимости).

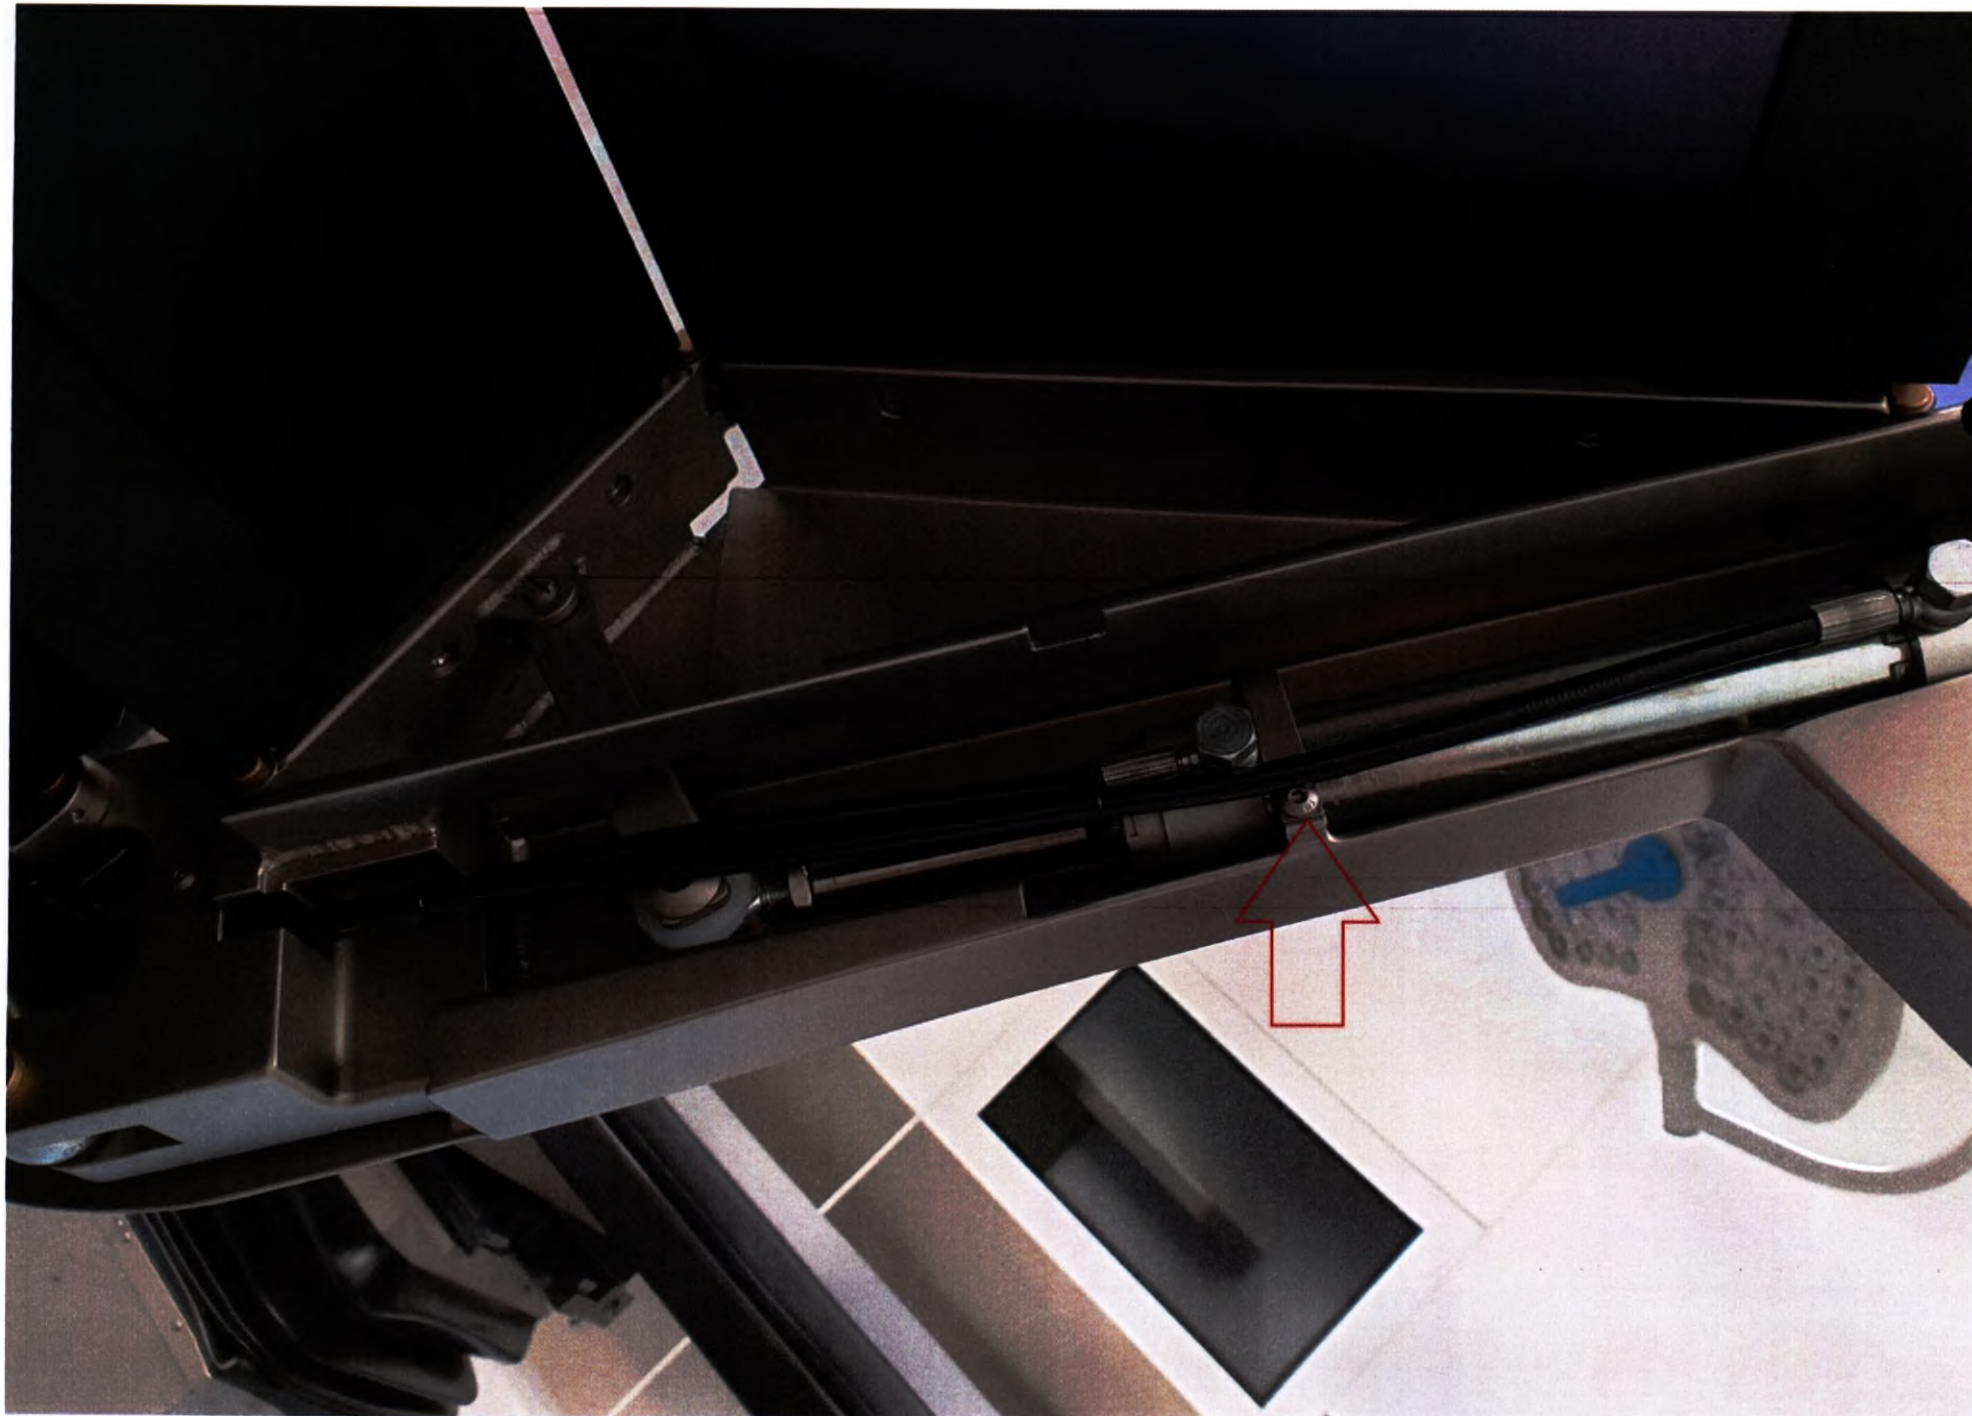

2.23. Привод блокировки колес электрогидравлический (при необходимости).

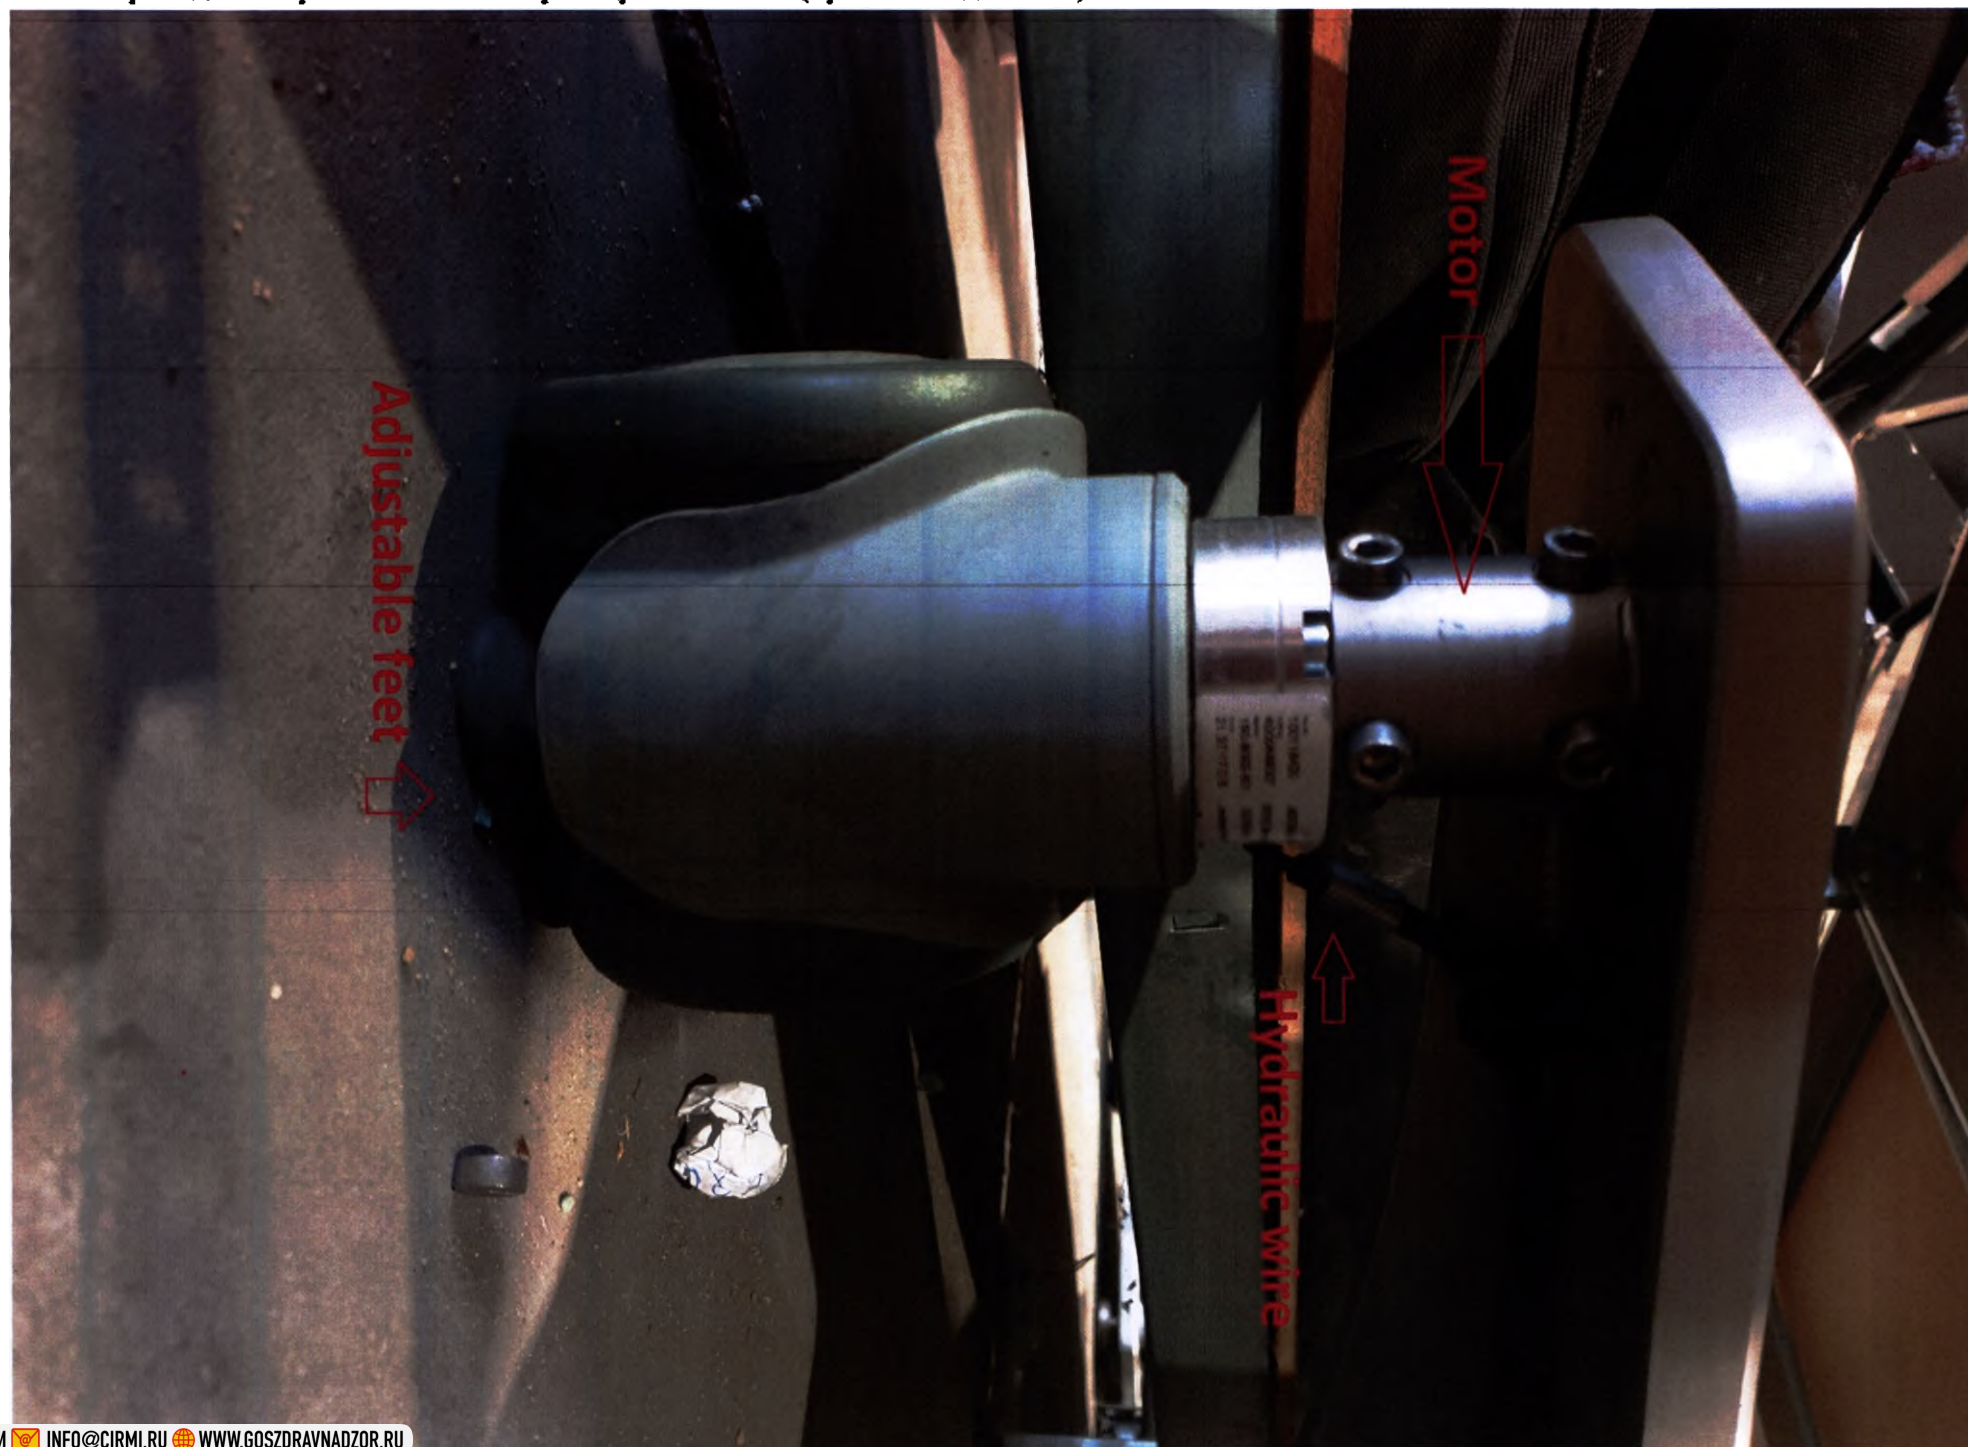

2.24. Секция ножная раздельная левая в комплекте с матрасом (при необходимости).




2.25. Секция ножная раздельная правая в комплекте с матрасом (при необходимости).





 **INFIMED**



Infimed Sp. z o. o.
ul. Kabaty 1
34-300 Zywiec
Made in POLAND



IP-X4



Symbol: **VIVAX OT-02-546**

SN: 0819 / 431

2 min / 18 min

~230V / 50-60Hz
200VA

3.1. Секция головная.




3.2. Секция спинная верхняя.



3.3. Секция спинная нижняя.




3.4. Секция тазовая.

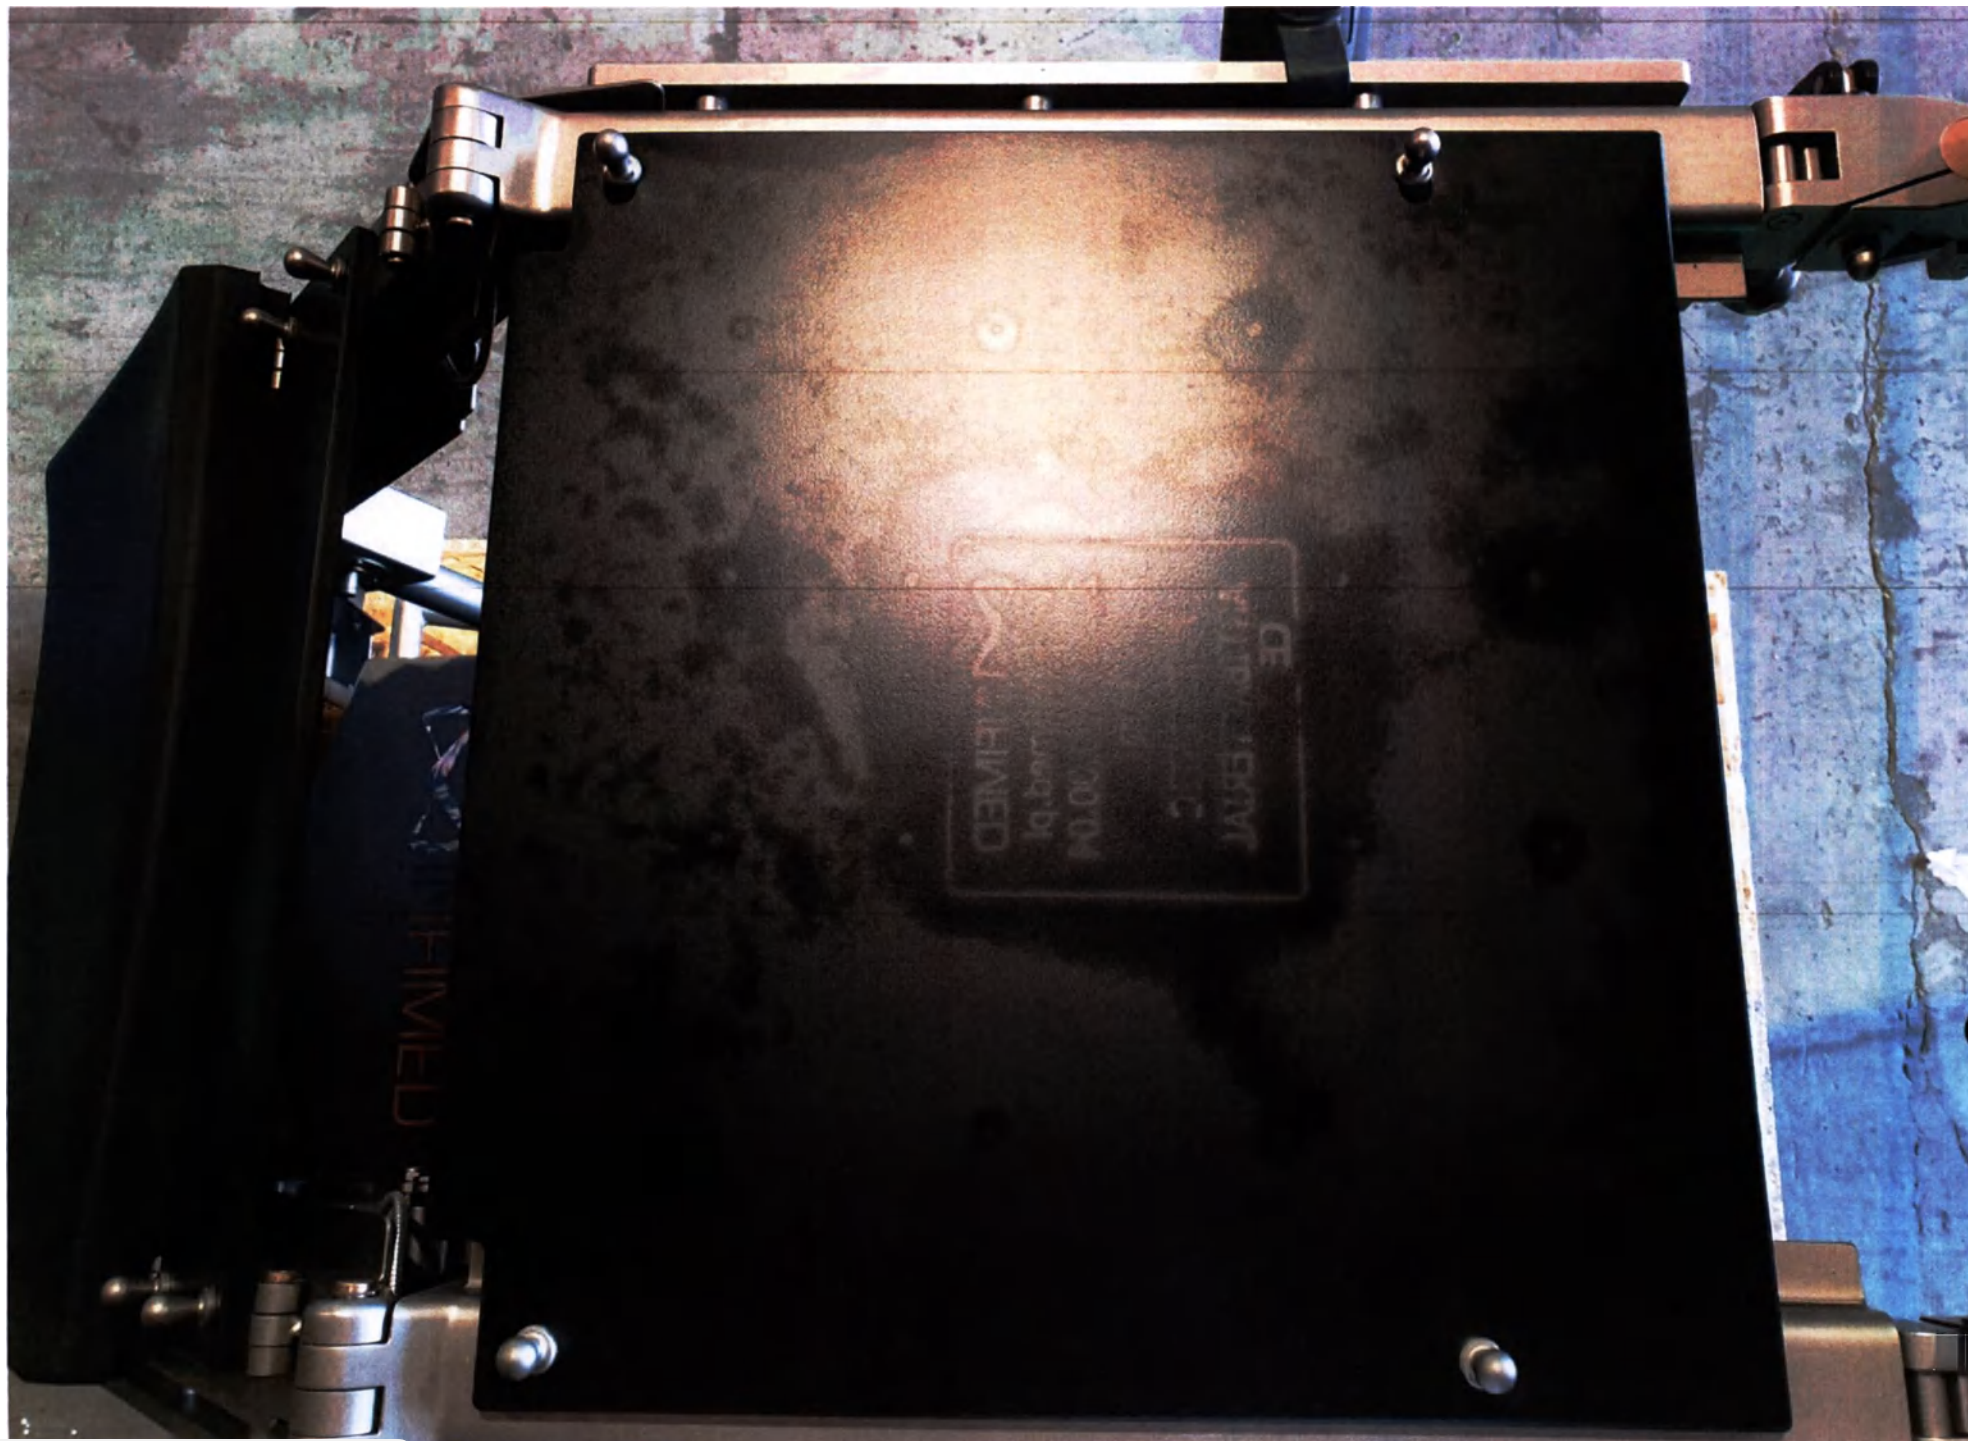

3.5. Секция ножная левая.



3.6. Секция ножная правая.

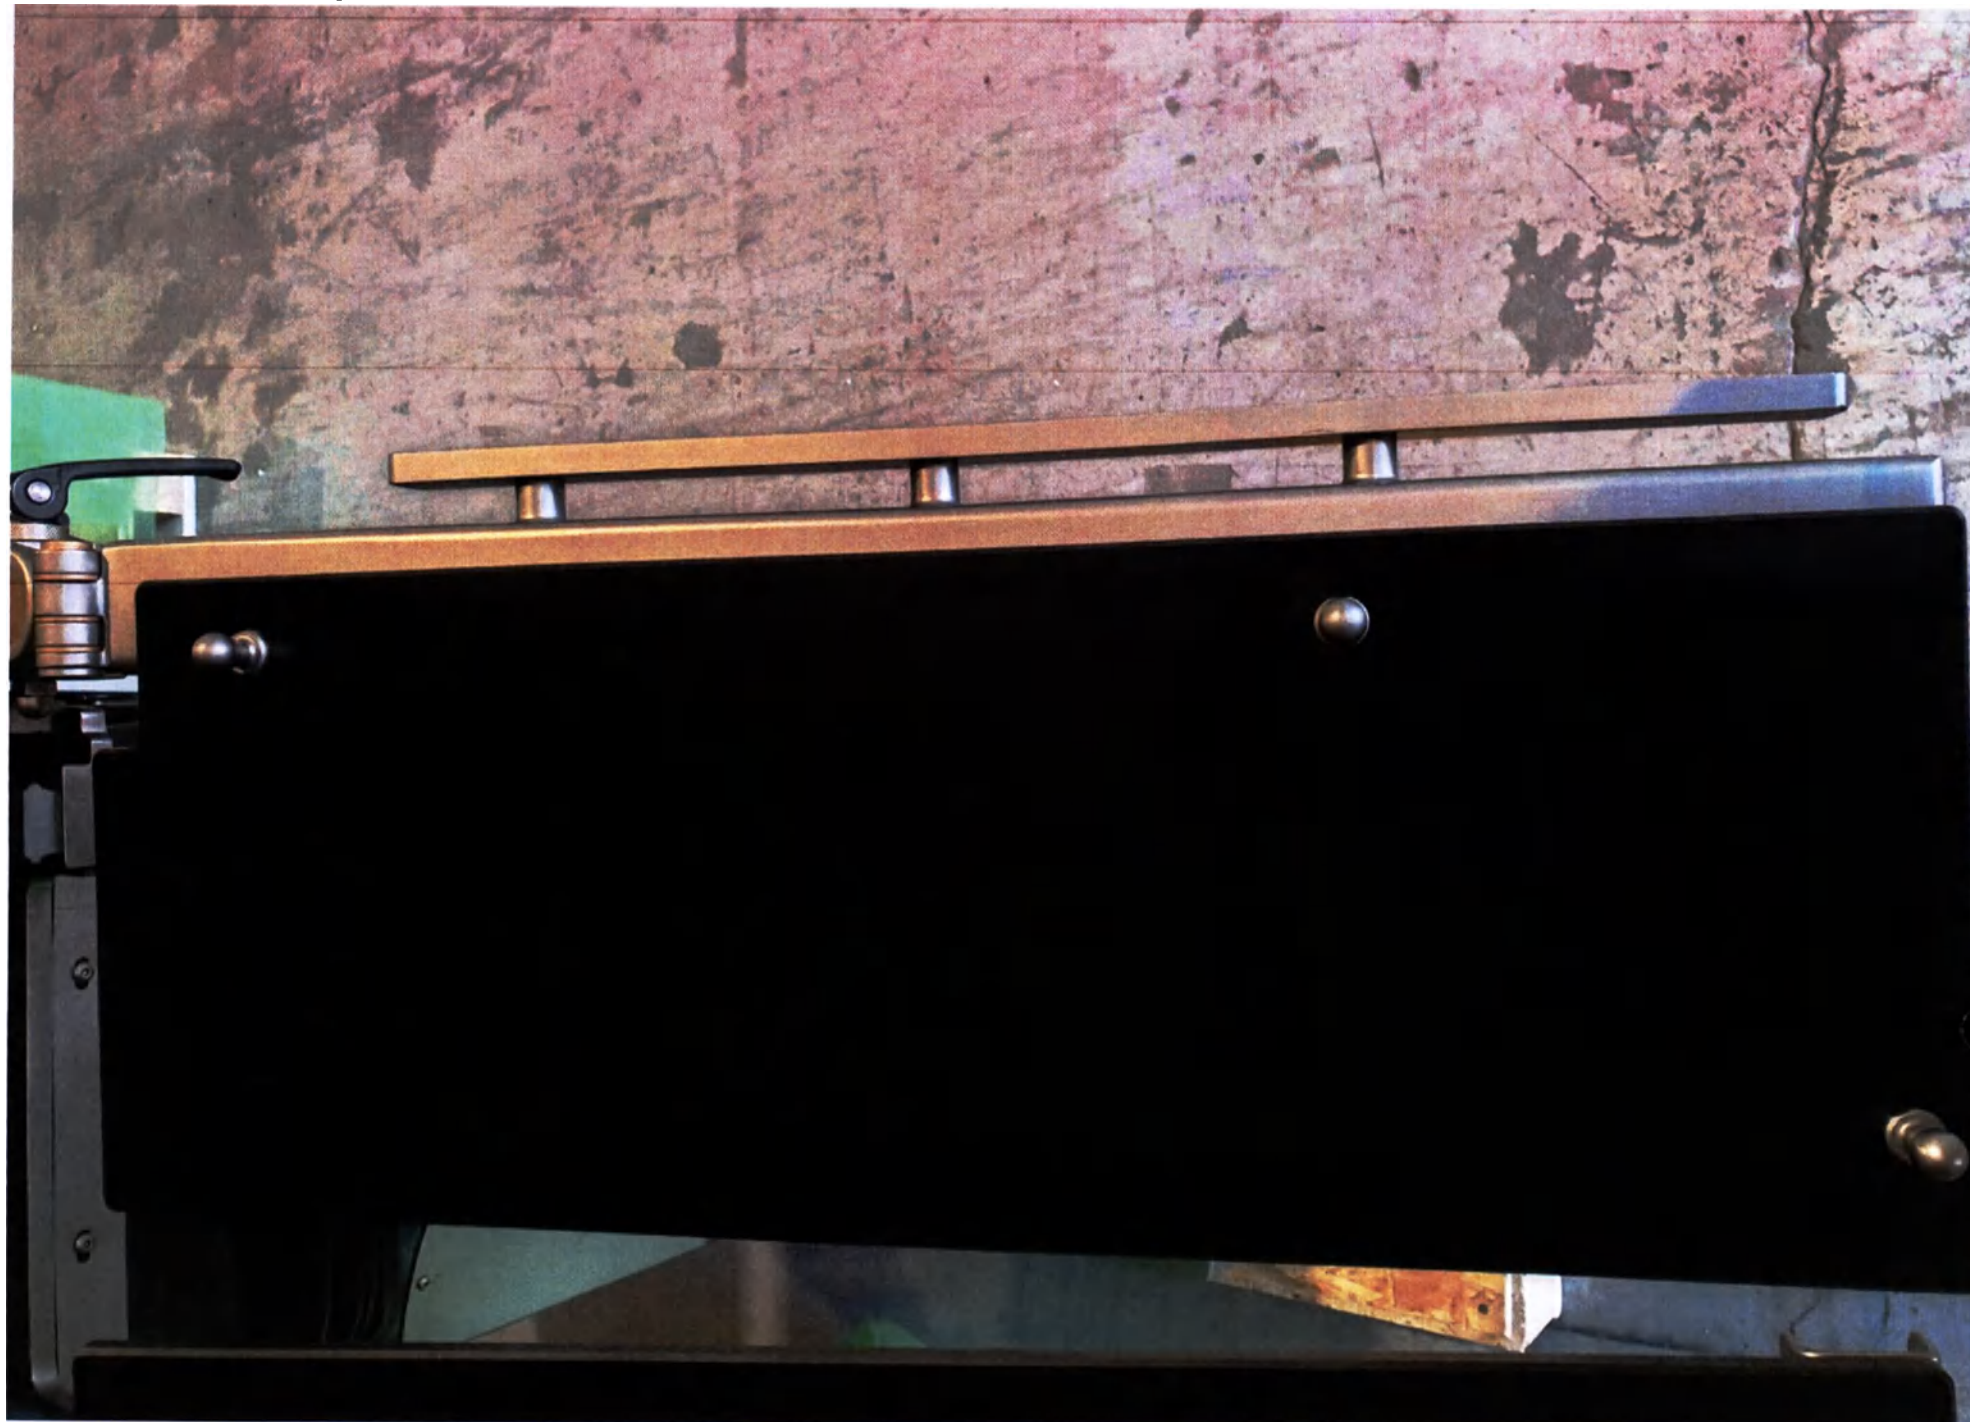

3.7. Матрац головной секции.



3.8. Матрац спинной секции верхней.



3.9. Матрац спинной секции нижней.



3.10. Матрац тазовой секции.



3.11. Матрац ножной секции левой.



3.12. Матрац ножной секции правой.



3.13. Секция расширения ложа в комплекте с матрасом.




3.14. Пульт управления ручной.



3.15. Стойка инфузионная специальная (при необходимости).



3.16. Пульт управления ножной (при необходимости).

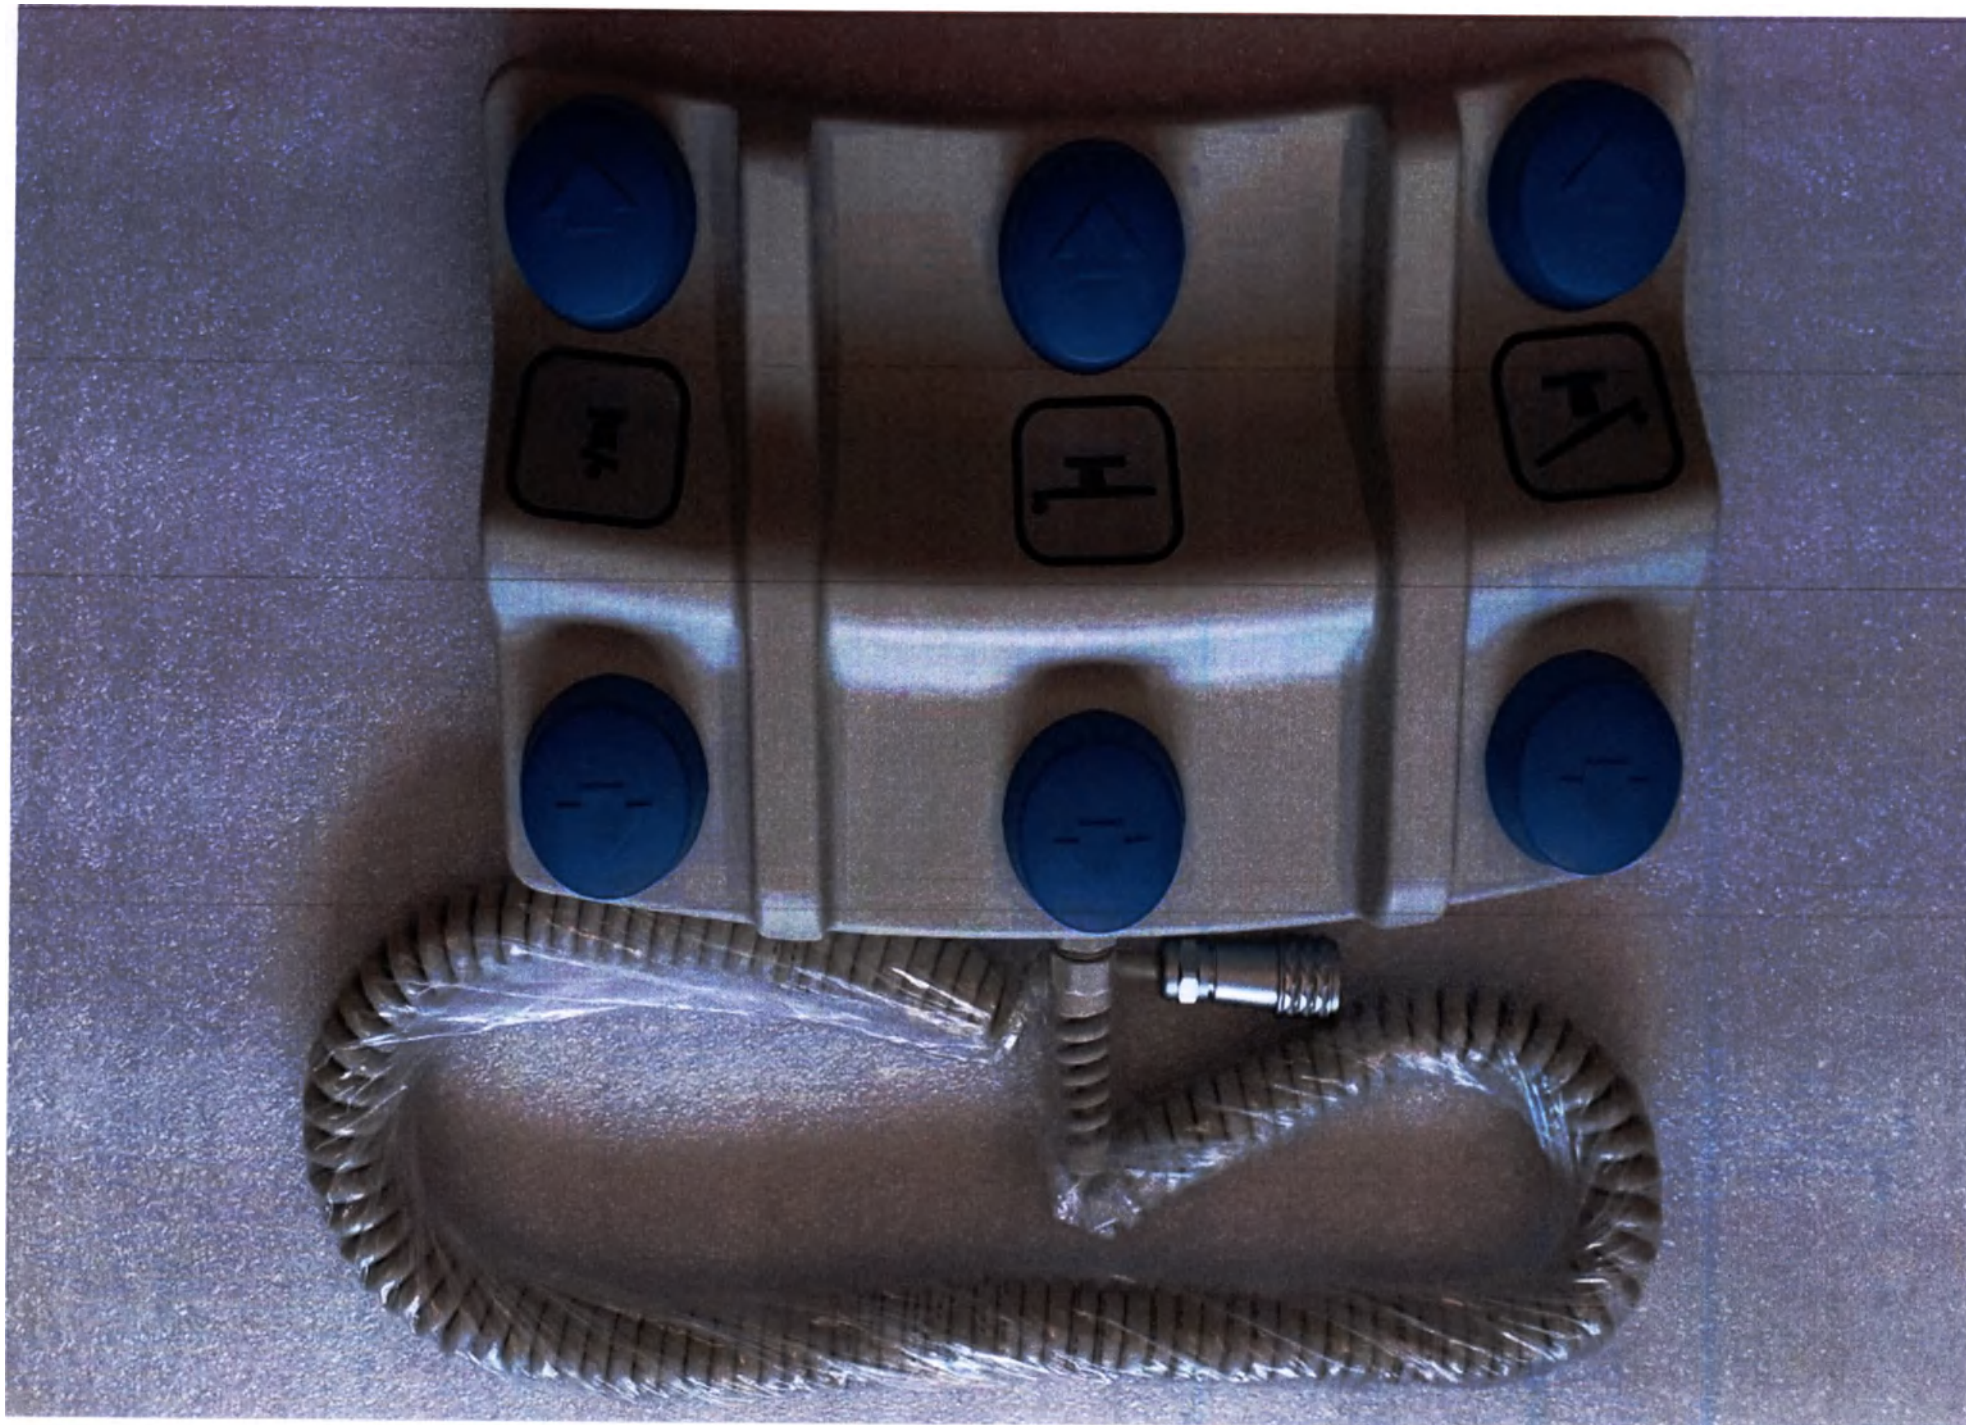

3.17. Пульт управления беспроводной (при необходимости).



3.18. Панель управления на колонне (при необходимости).



3.19. Основание мобильное (при необходимости).



3.20. Привод альтернативный дублирующий (при необходимости).



3.21. Привод регулировки спинной секции электрогидравлический (при необходимости).




3.22. Привод регулировки продольного сдвига электрогидравлический (при необходимости).



3.23. Привод регулировки излома спинной секции электрогидравлический (при необходимости).



3.24. Привод блокировки колес электрогидравлический (при необходимости).

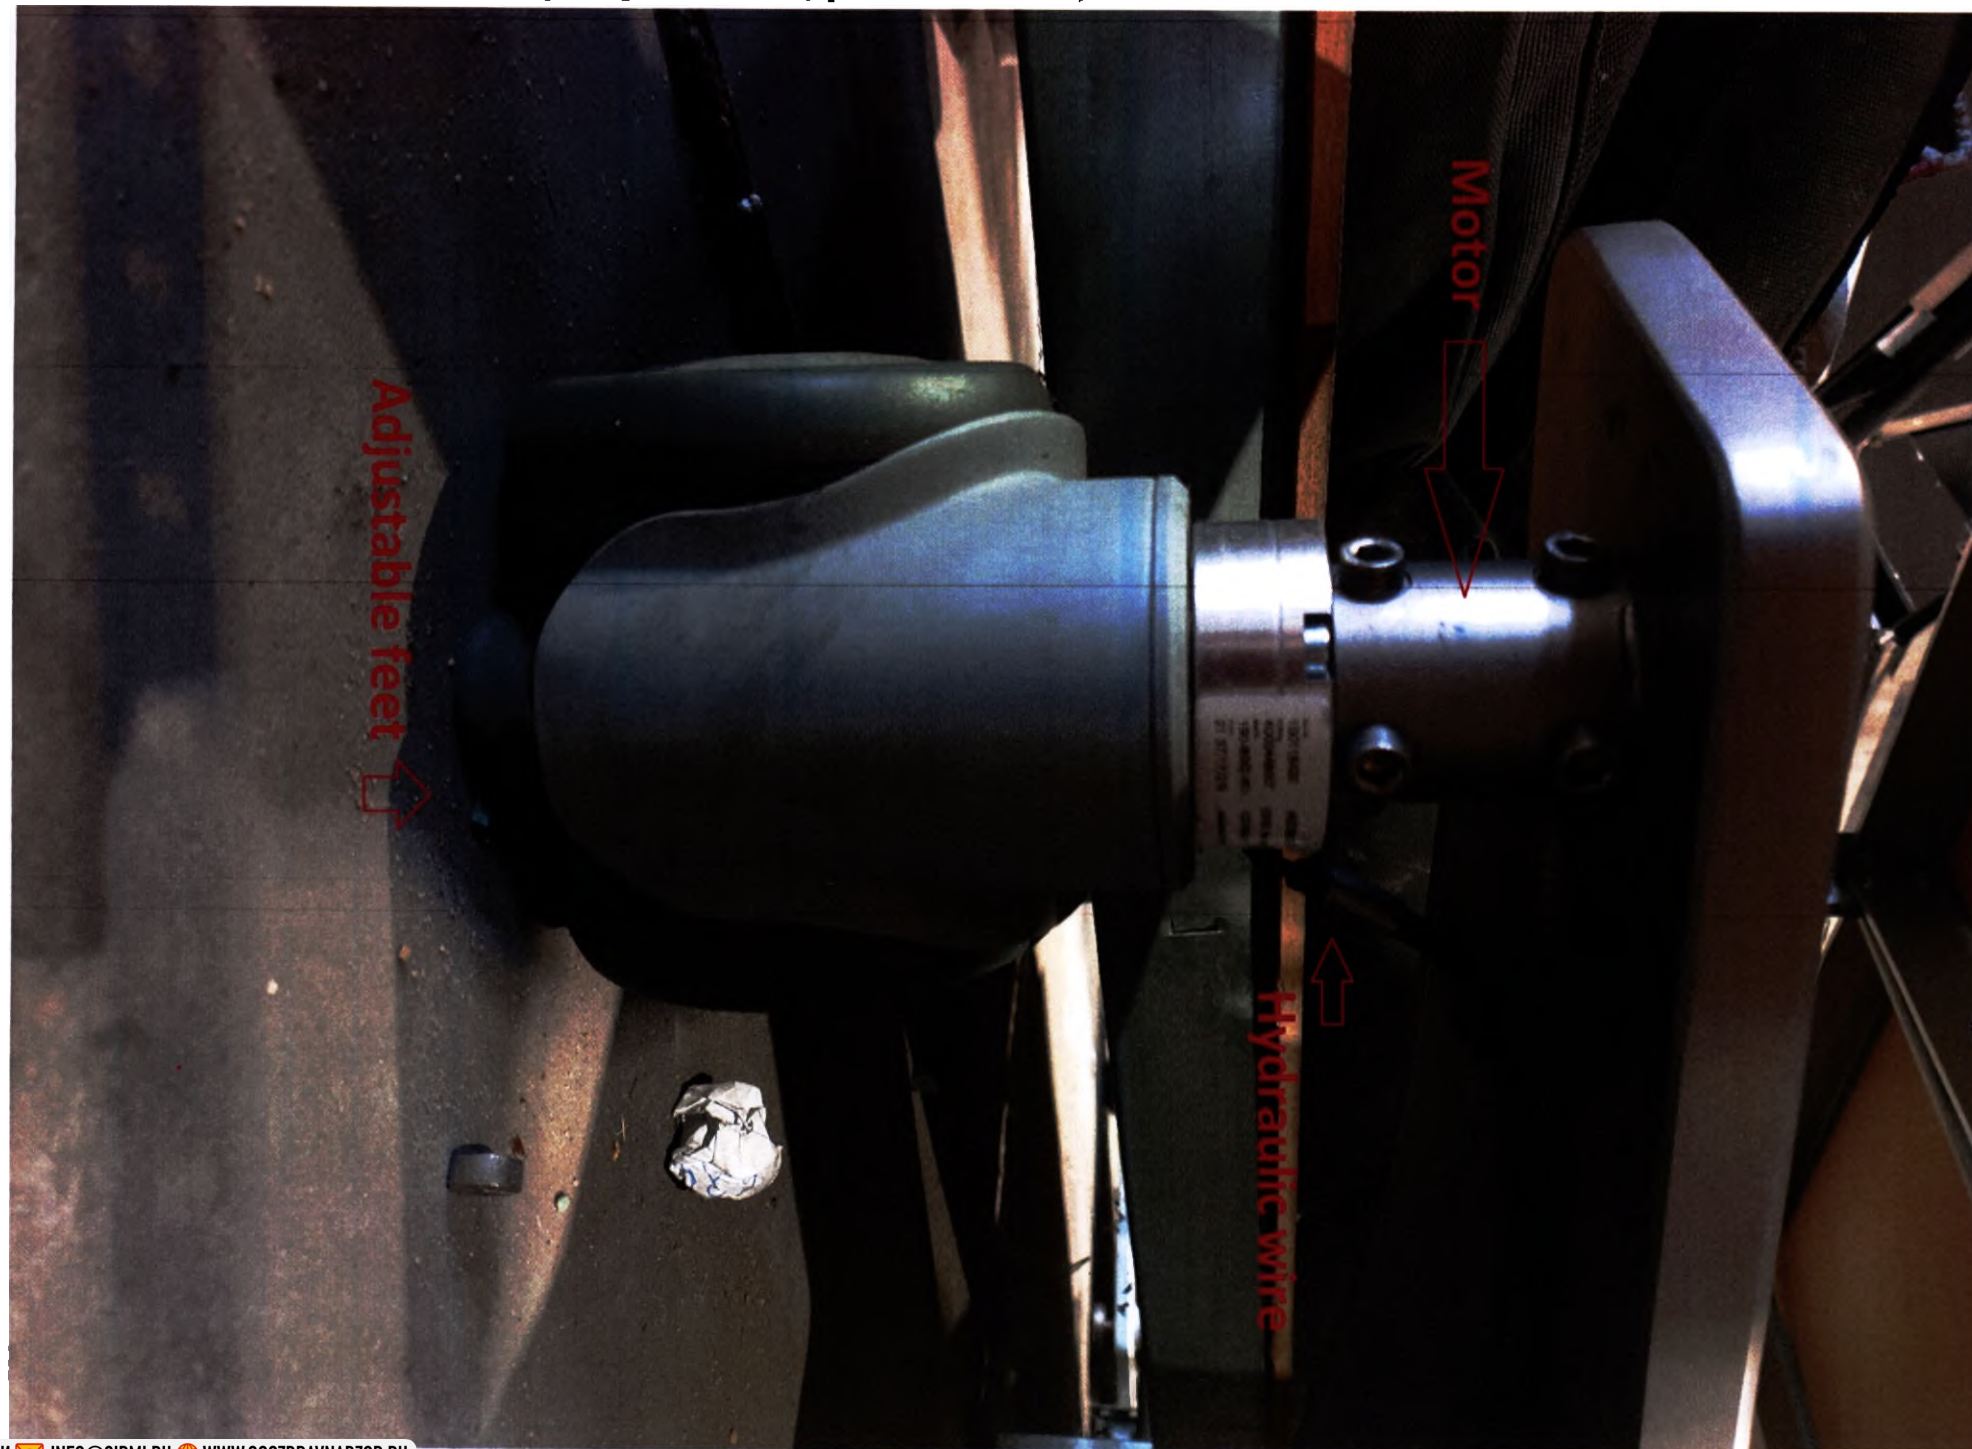


3.25. Секция ножная раздельная левая в комплекте с матрасом (при необходимости).



3.26. Секция ножная раздельная правая в комплекте с матрасом (при необходимости).



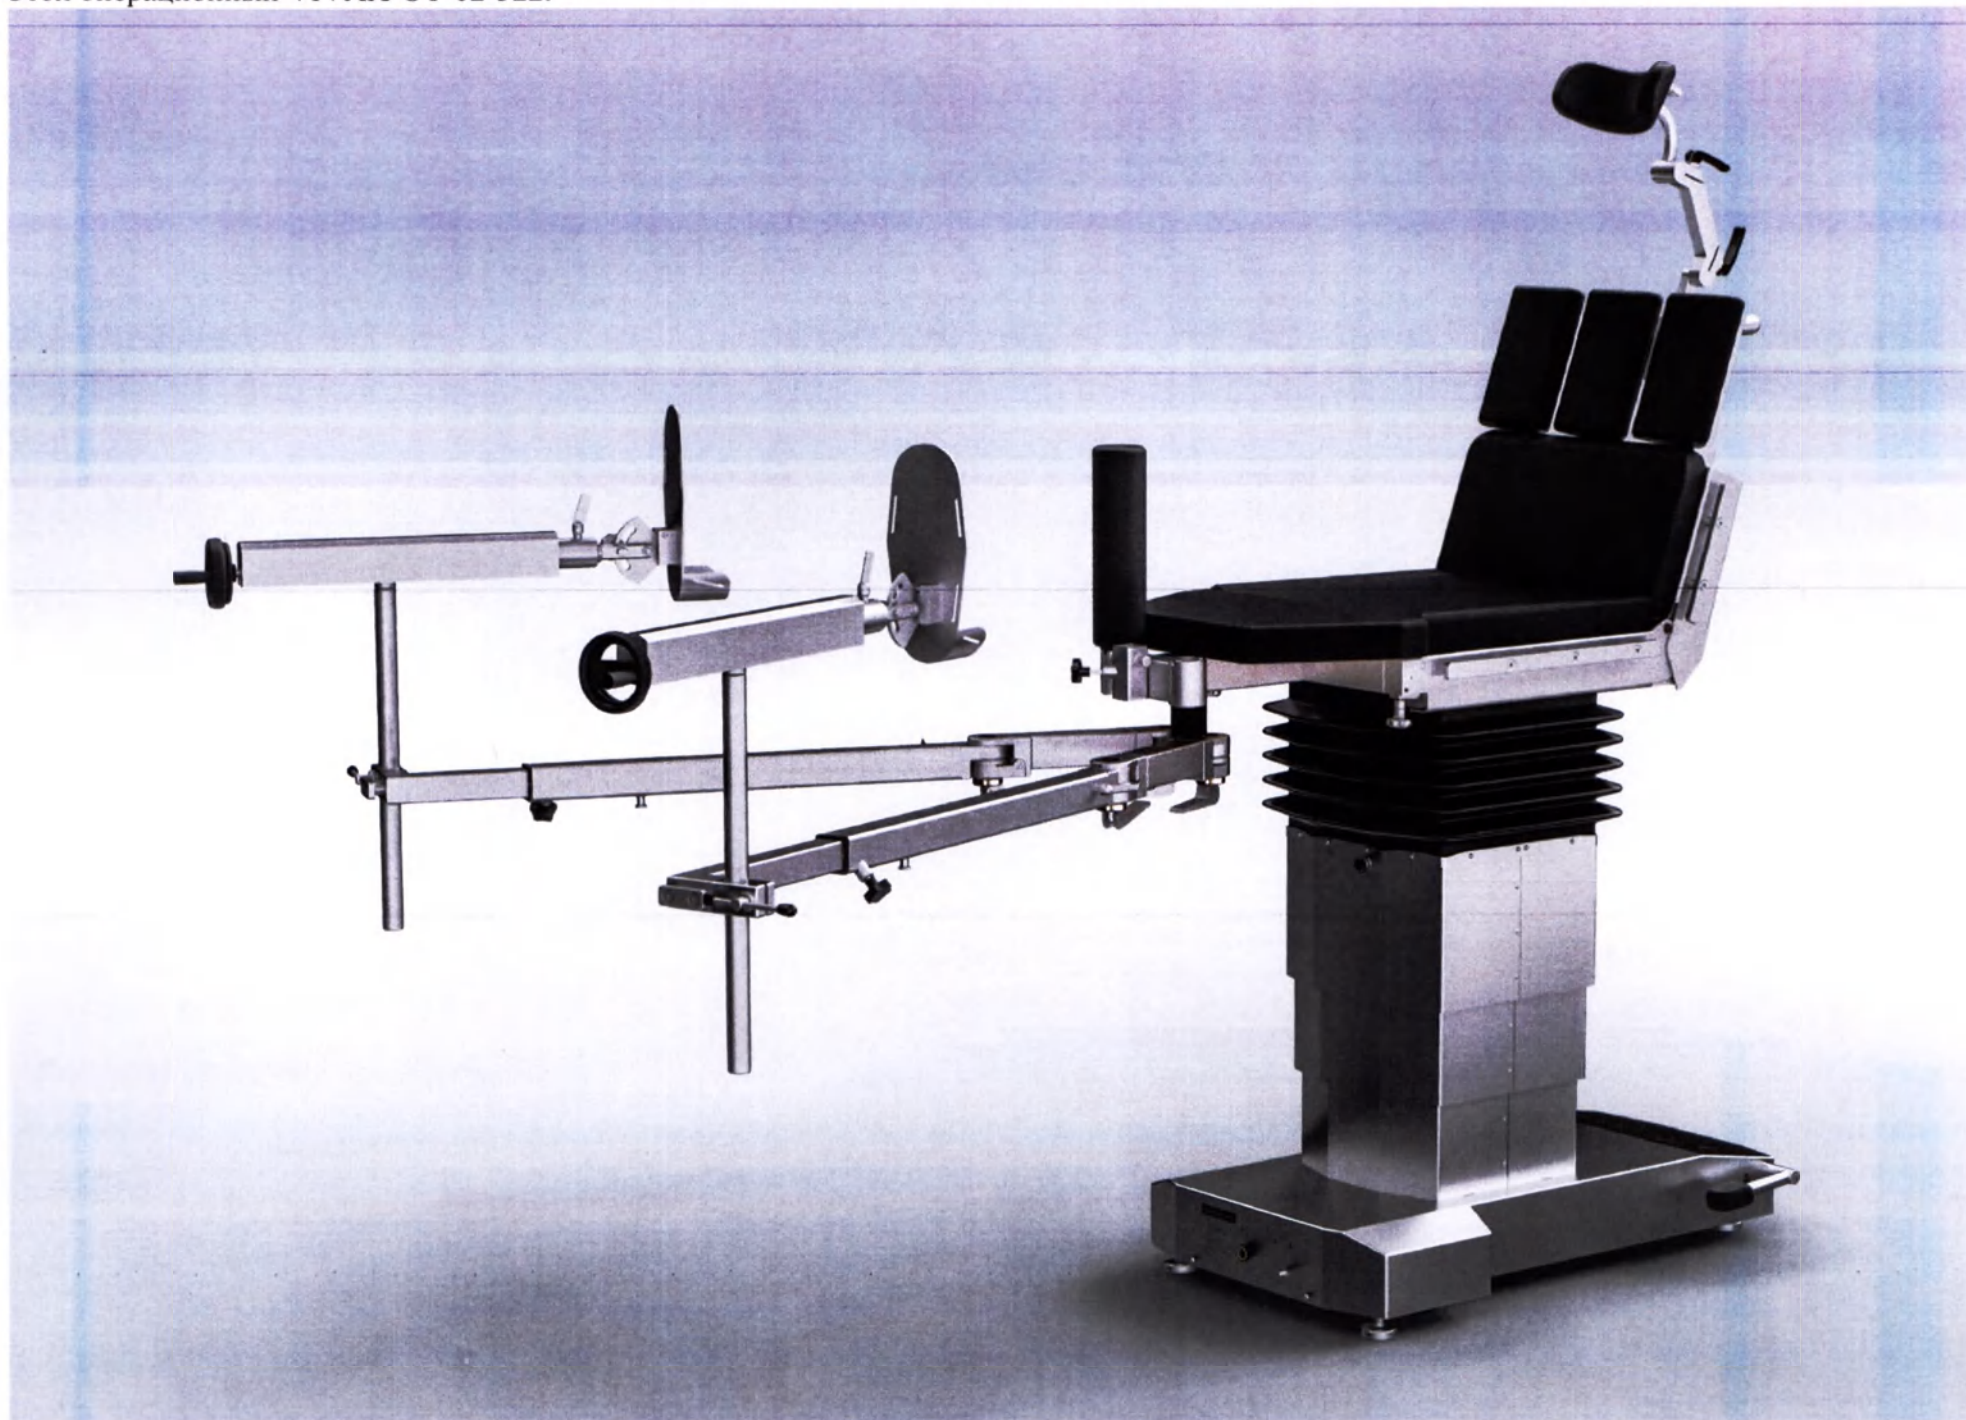

 **INFIMED**



Infimed Sp. z o. o.
ul. Kabaty 1
34-300 Zywiec
Made in POLAND



IP-X4



Symbol: **VIVAX OT-02-322**

SN: 0819 / 432

~230V / 50-60Hz


200VA

2 min / 18 min


4.1. Секция головная.




4.2. Секция спинная центральная.

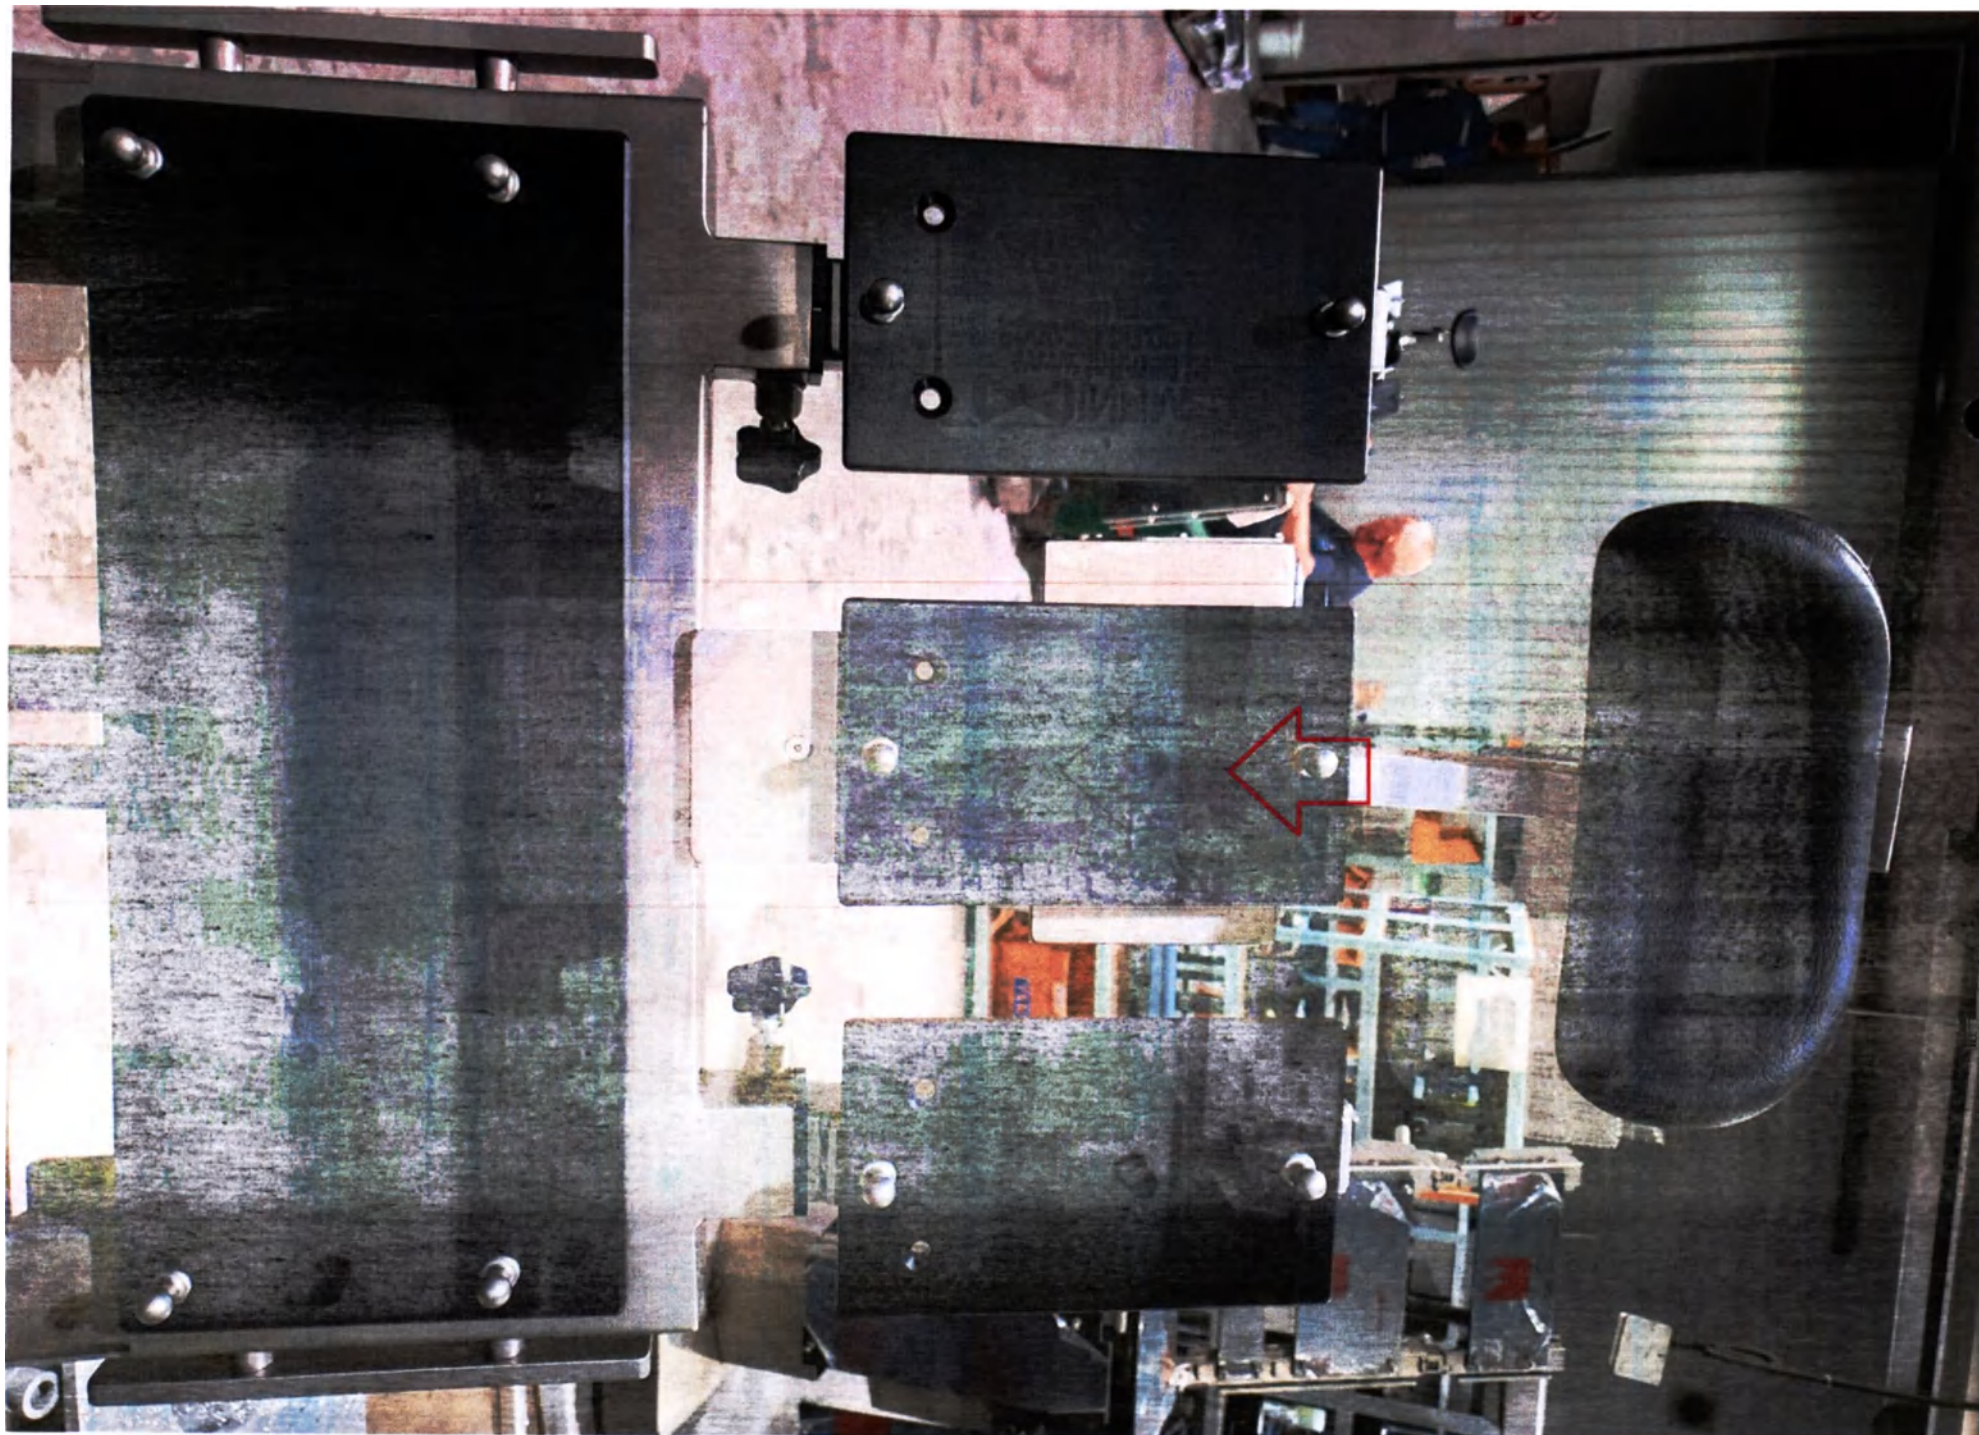


4.3. Секция спинная левая.

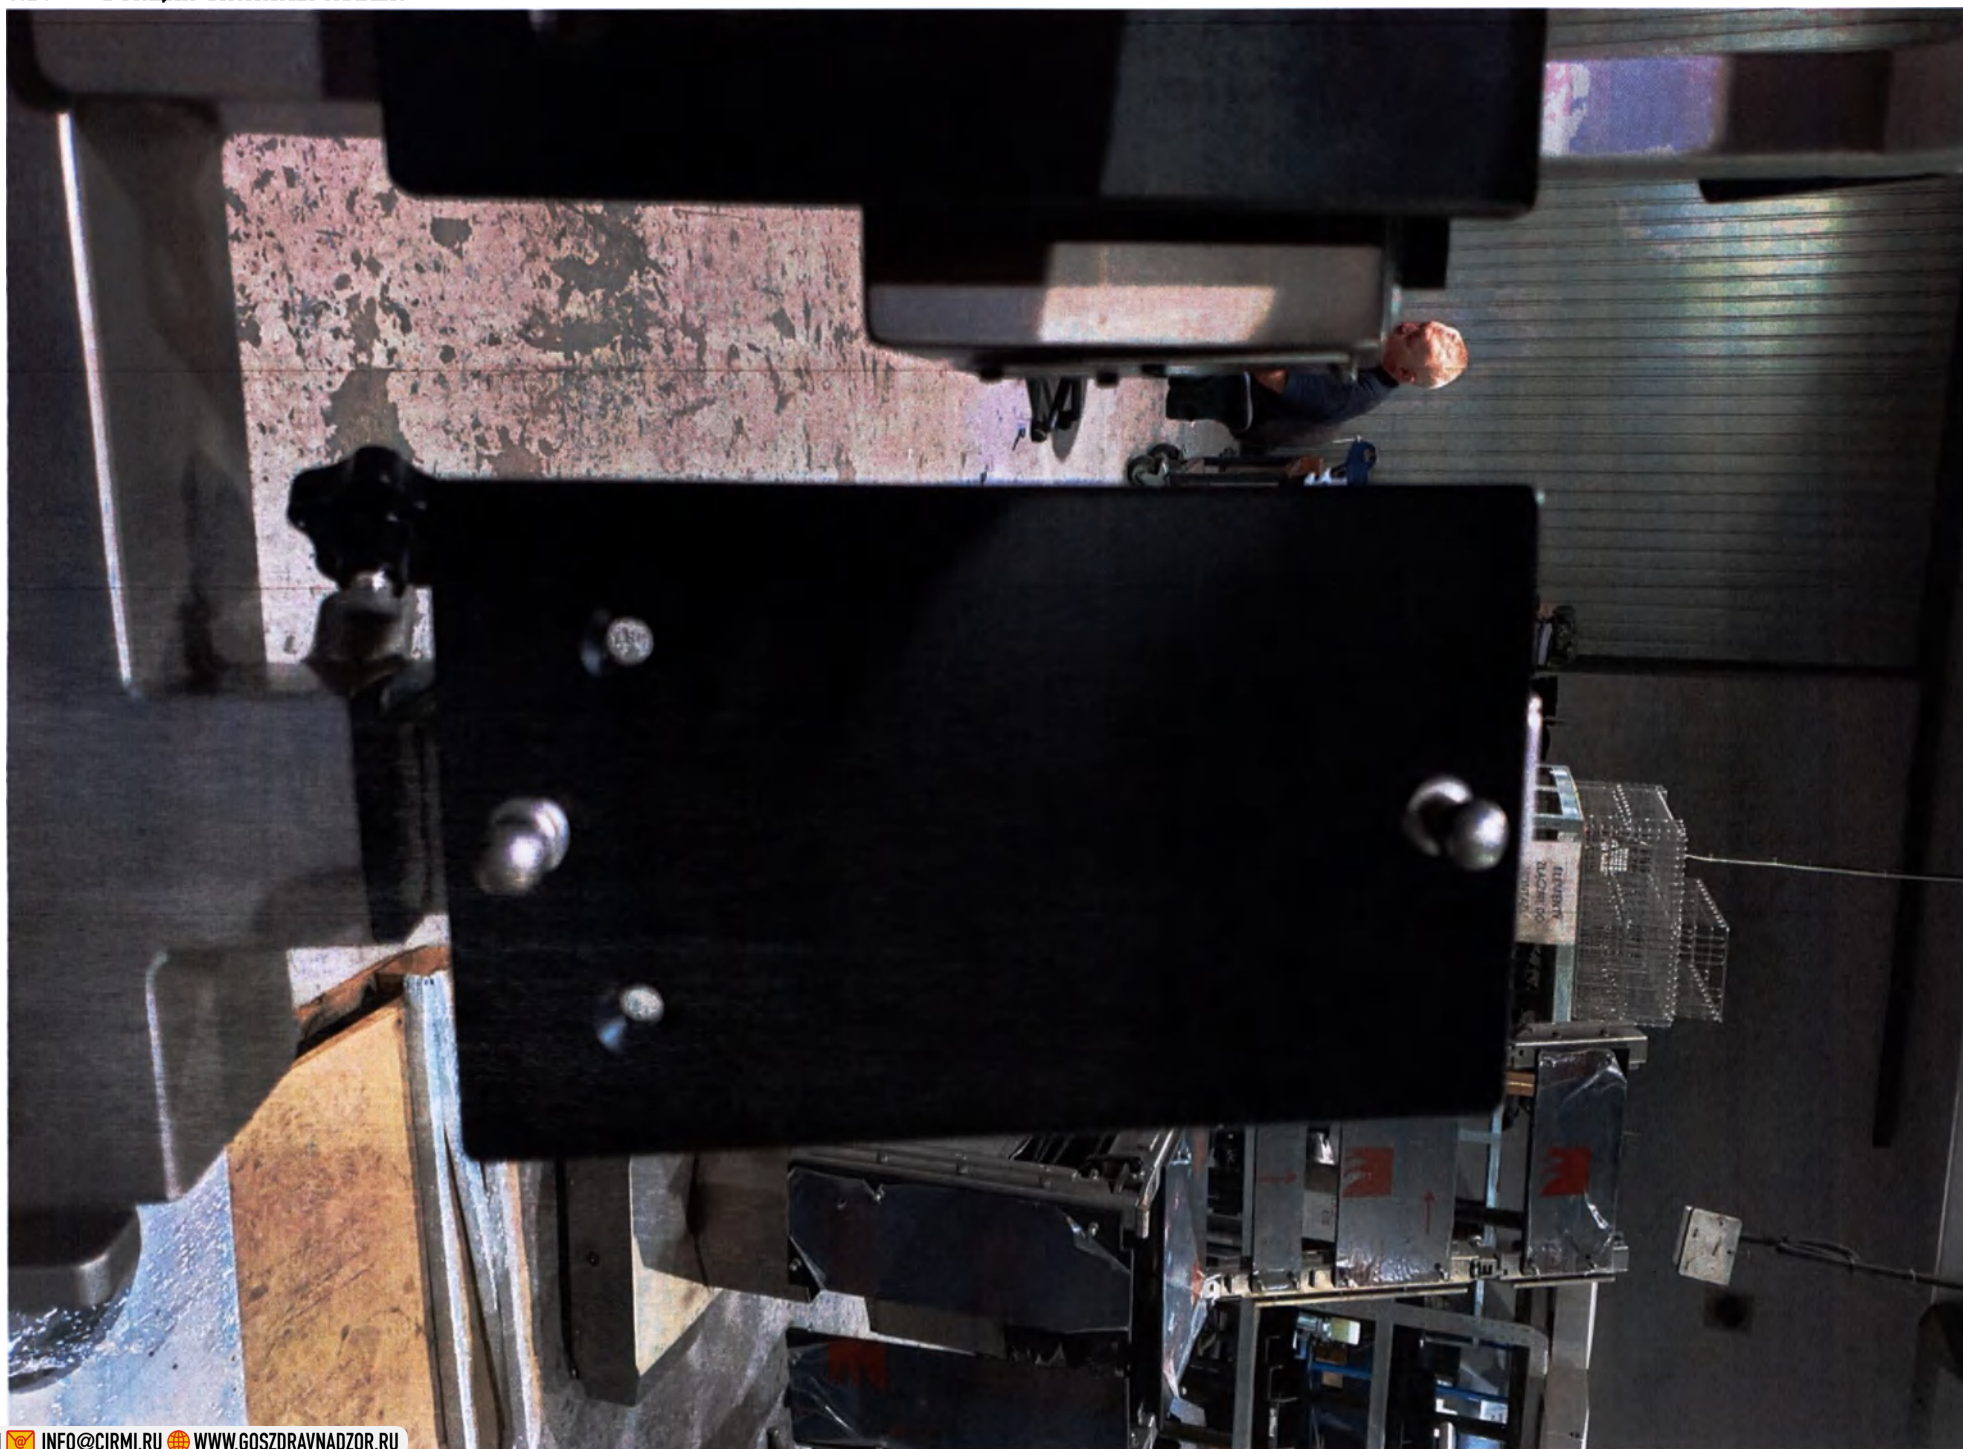


4.4. Секция спинная правая.

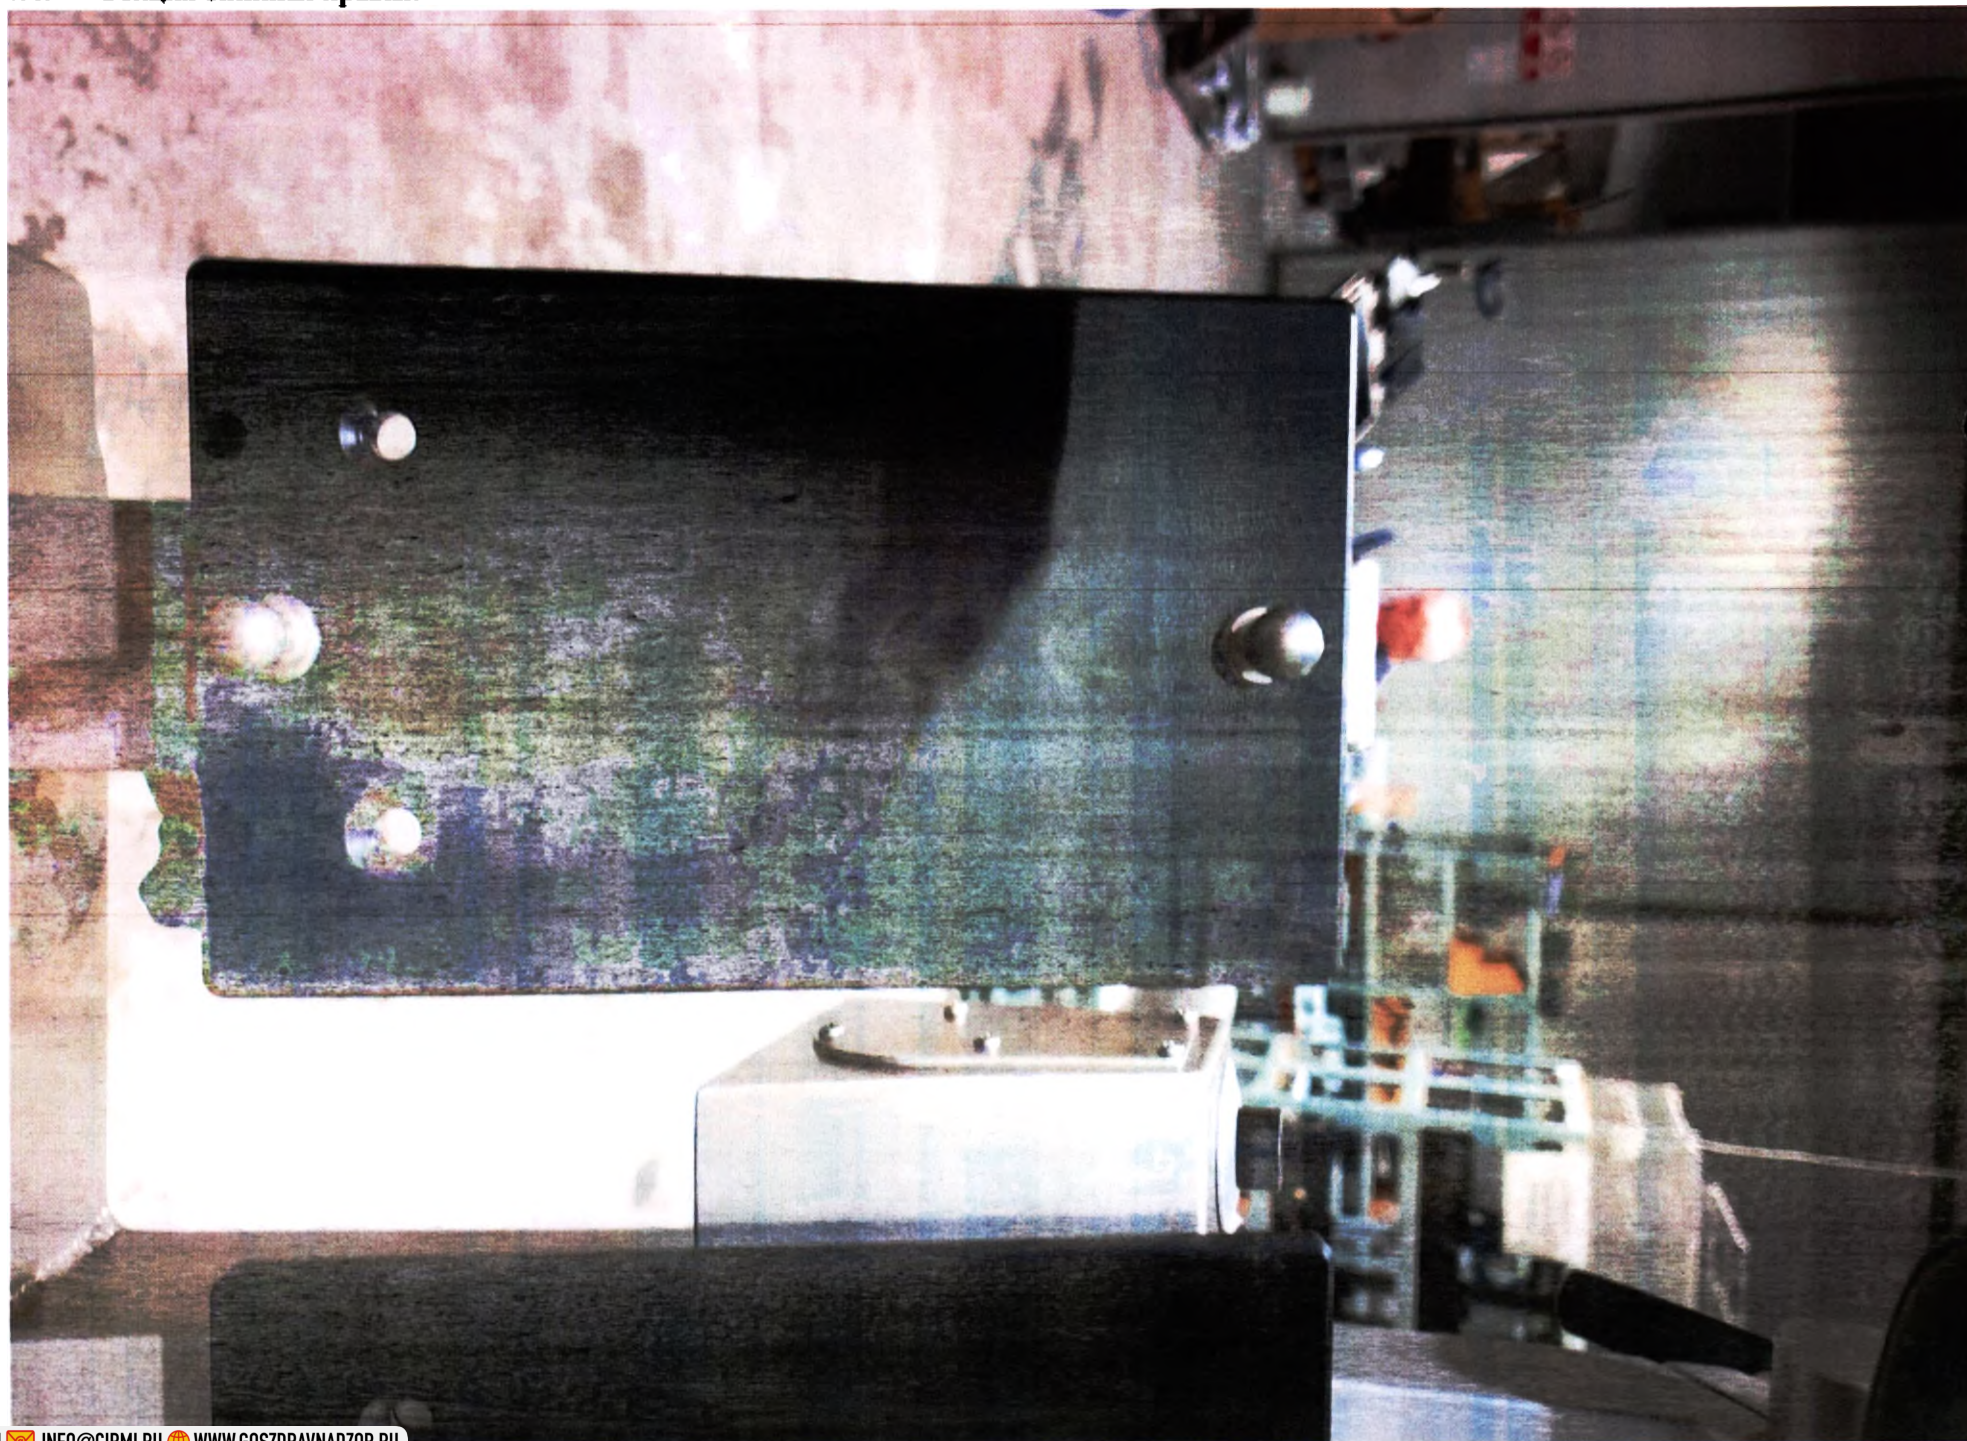

4.5. Секция спинная нижняя.

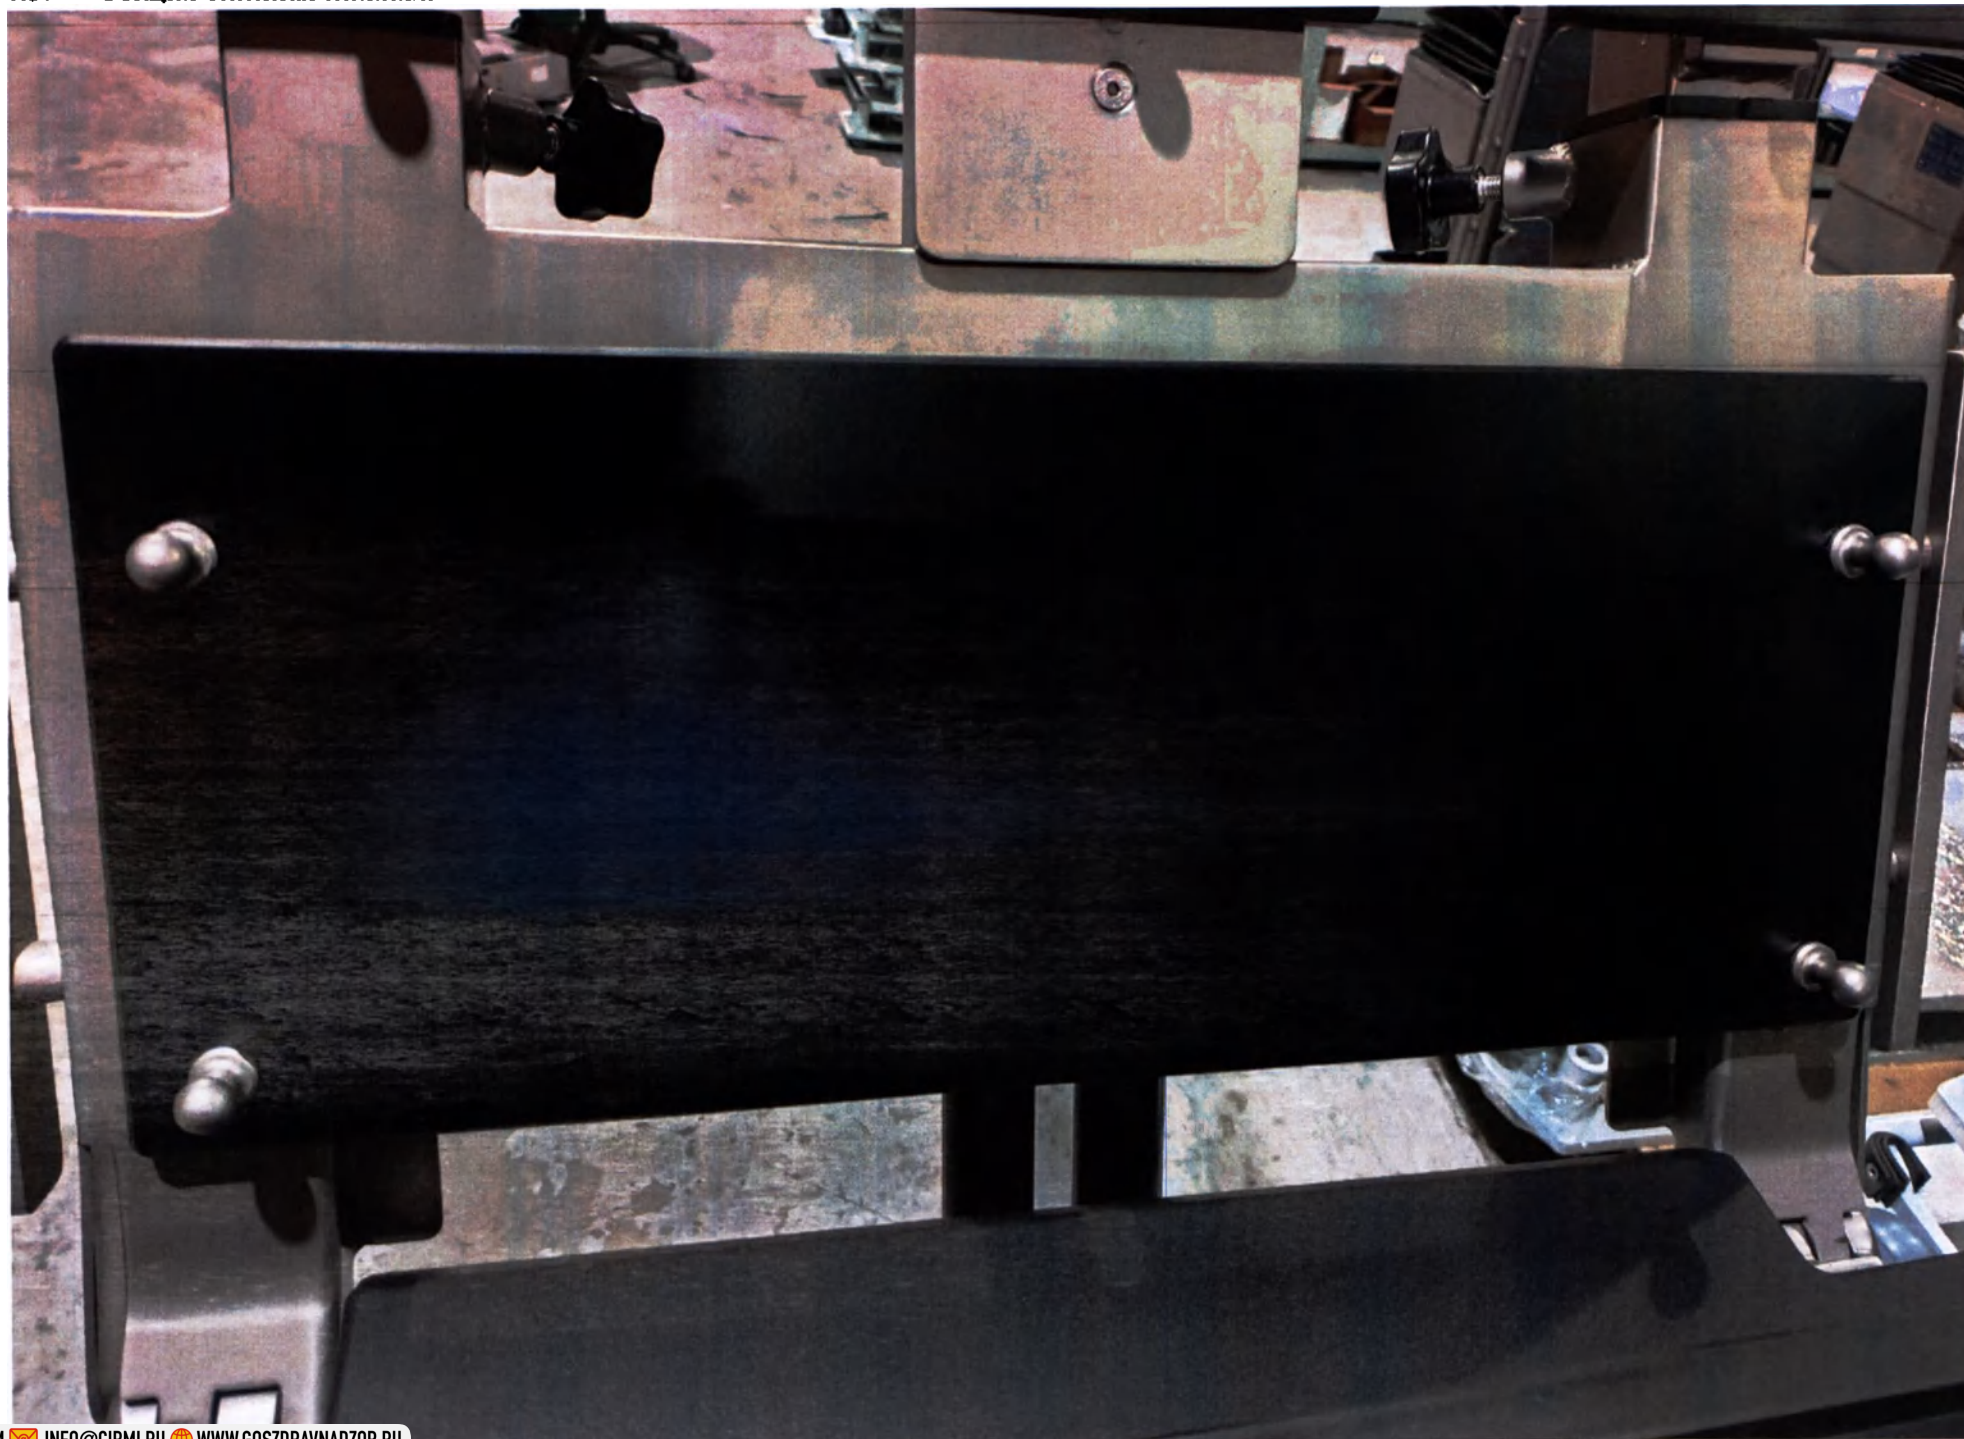


4.6. Секция тазовая.

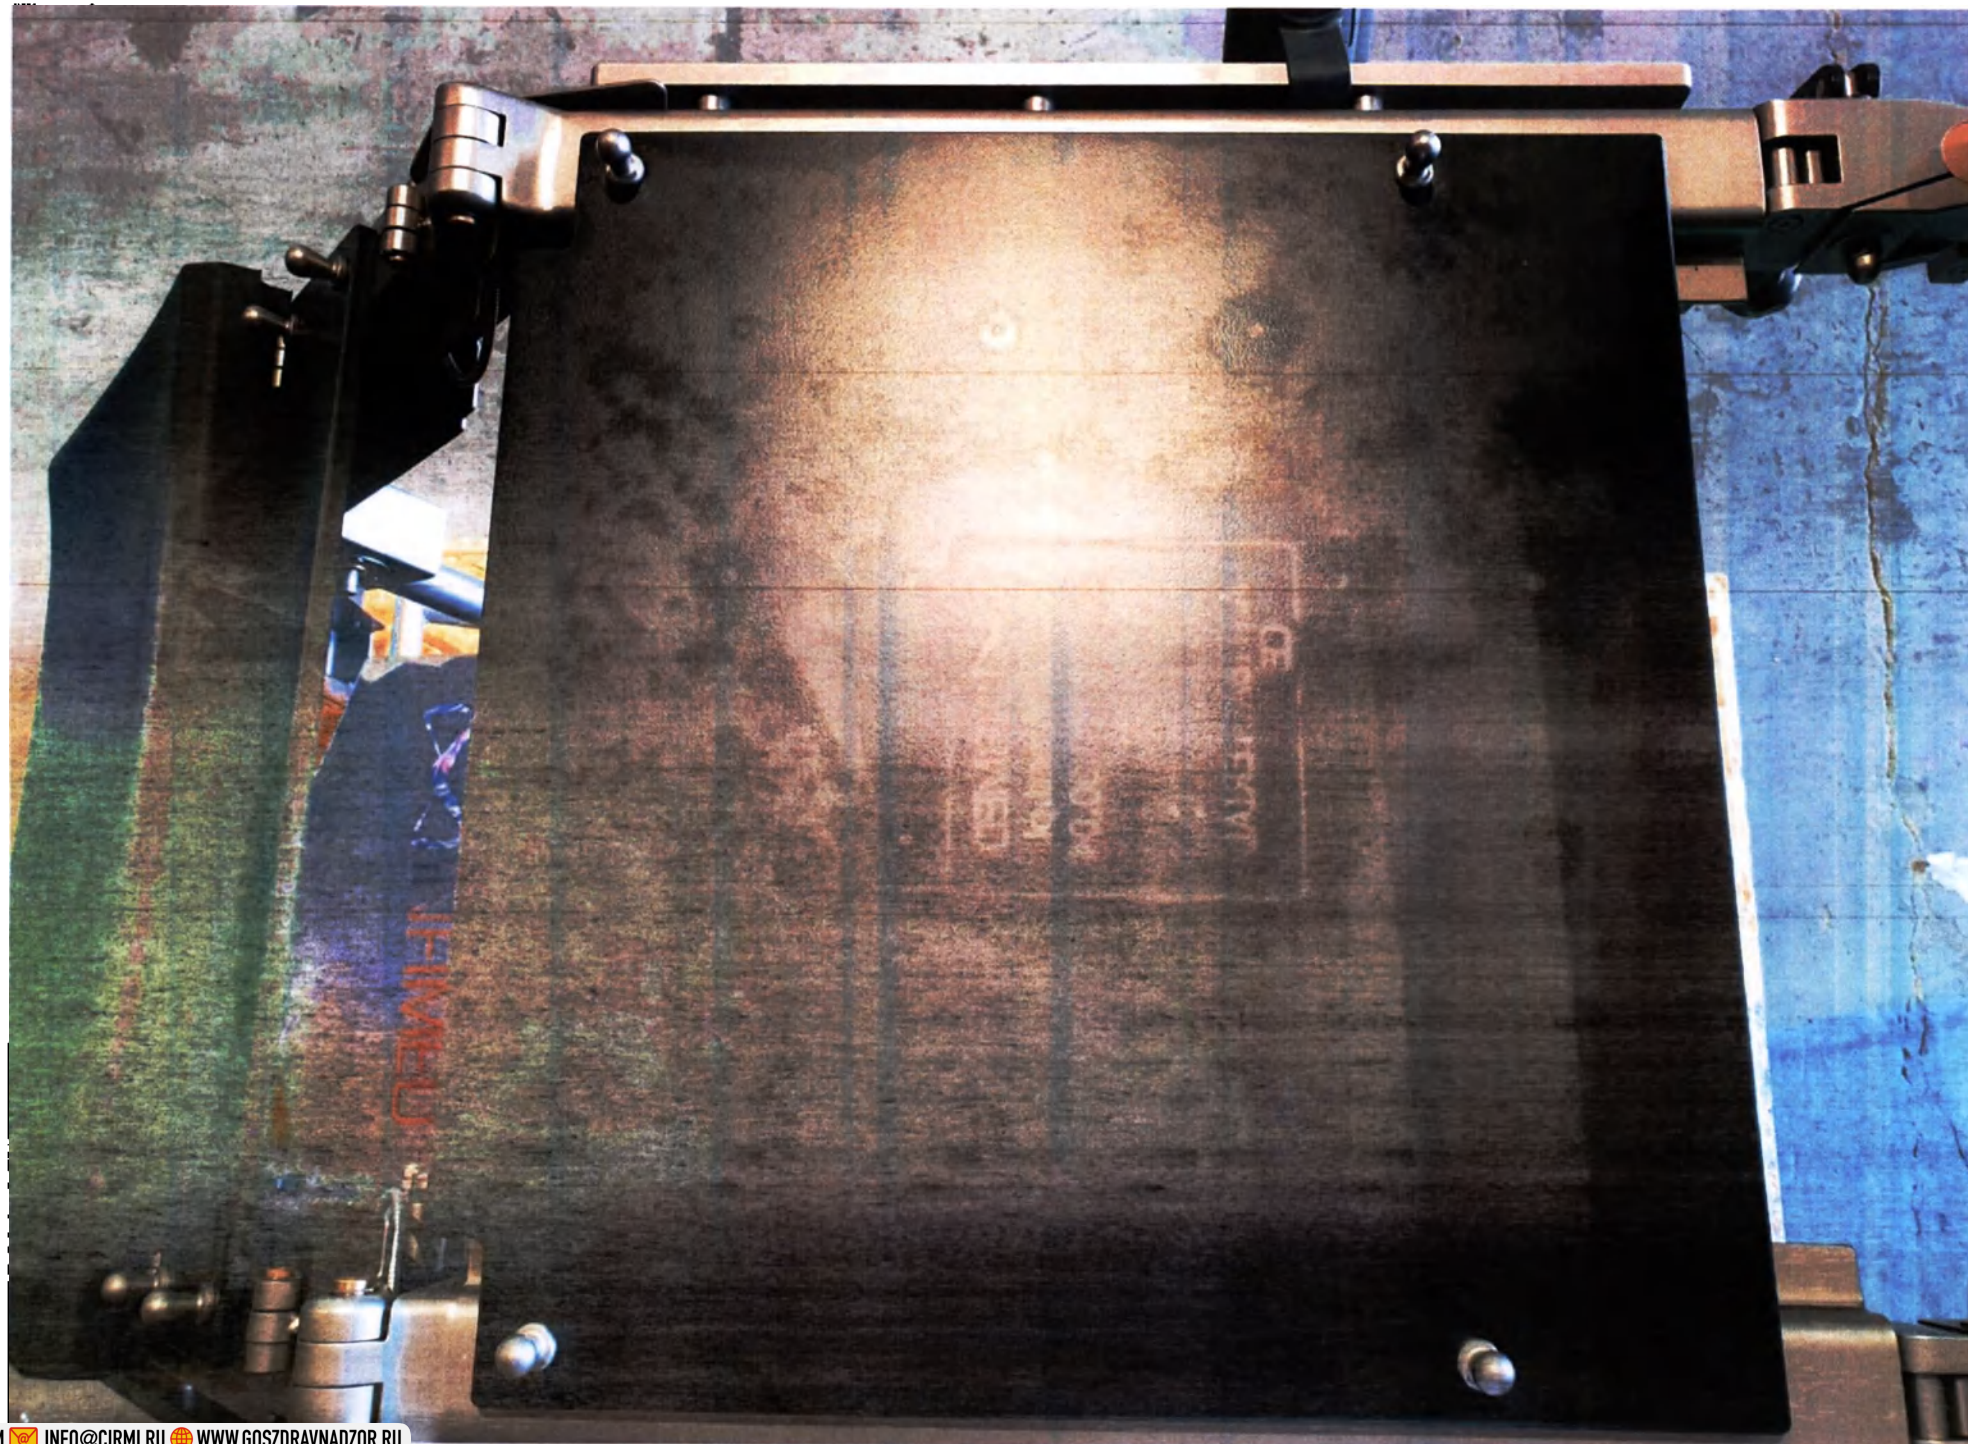


4.7. Секция ножная левая.



4.8. Секция ножная правая.

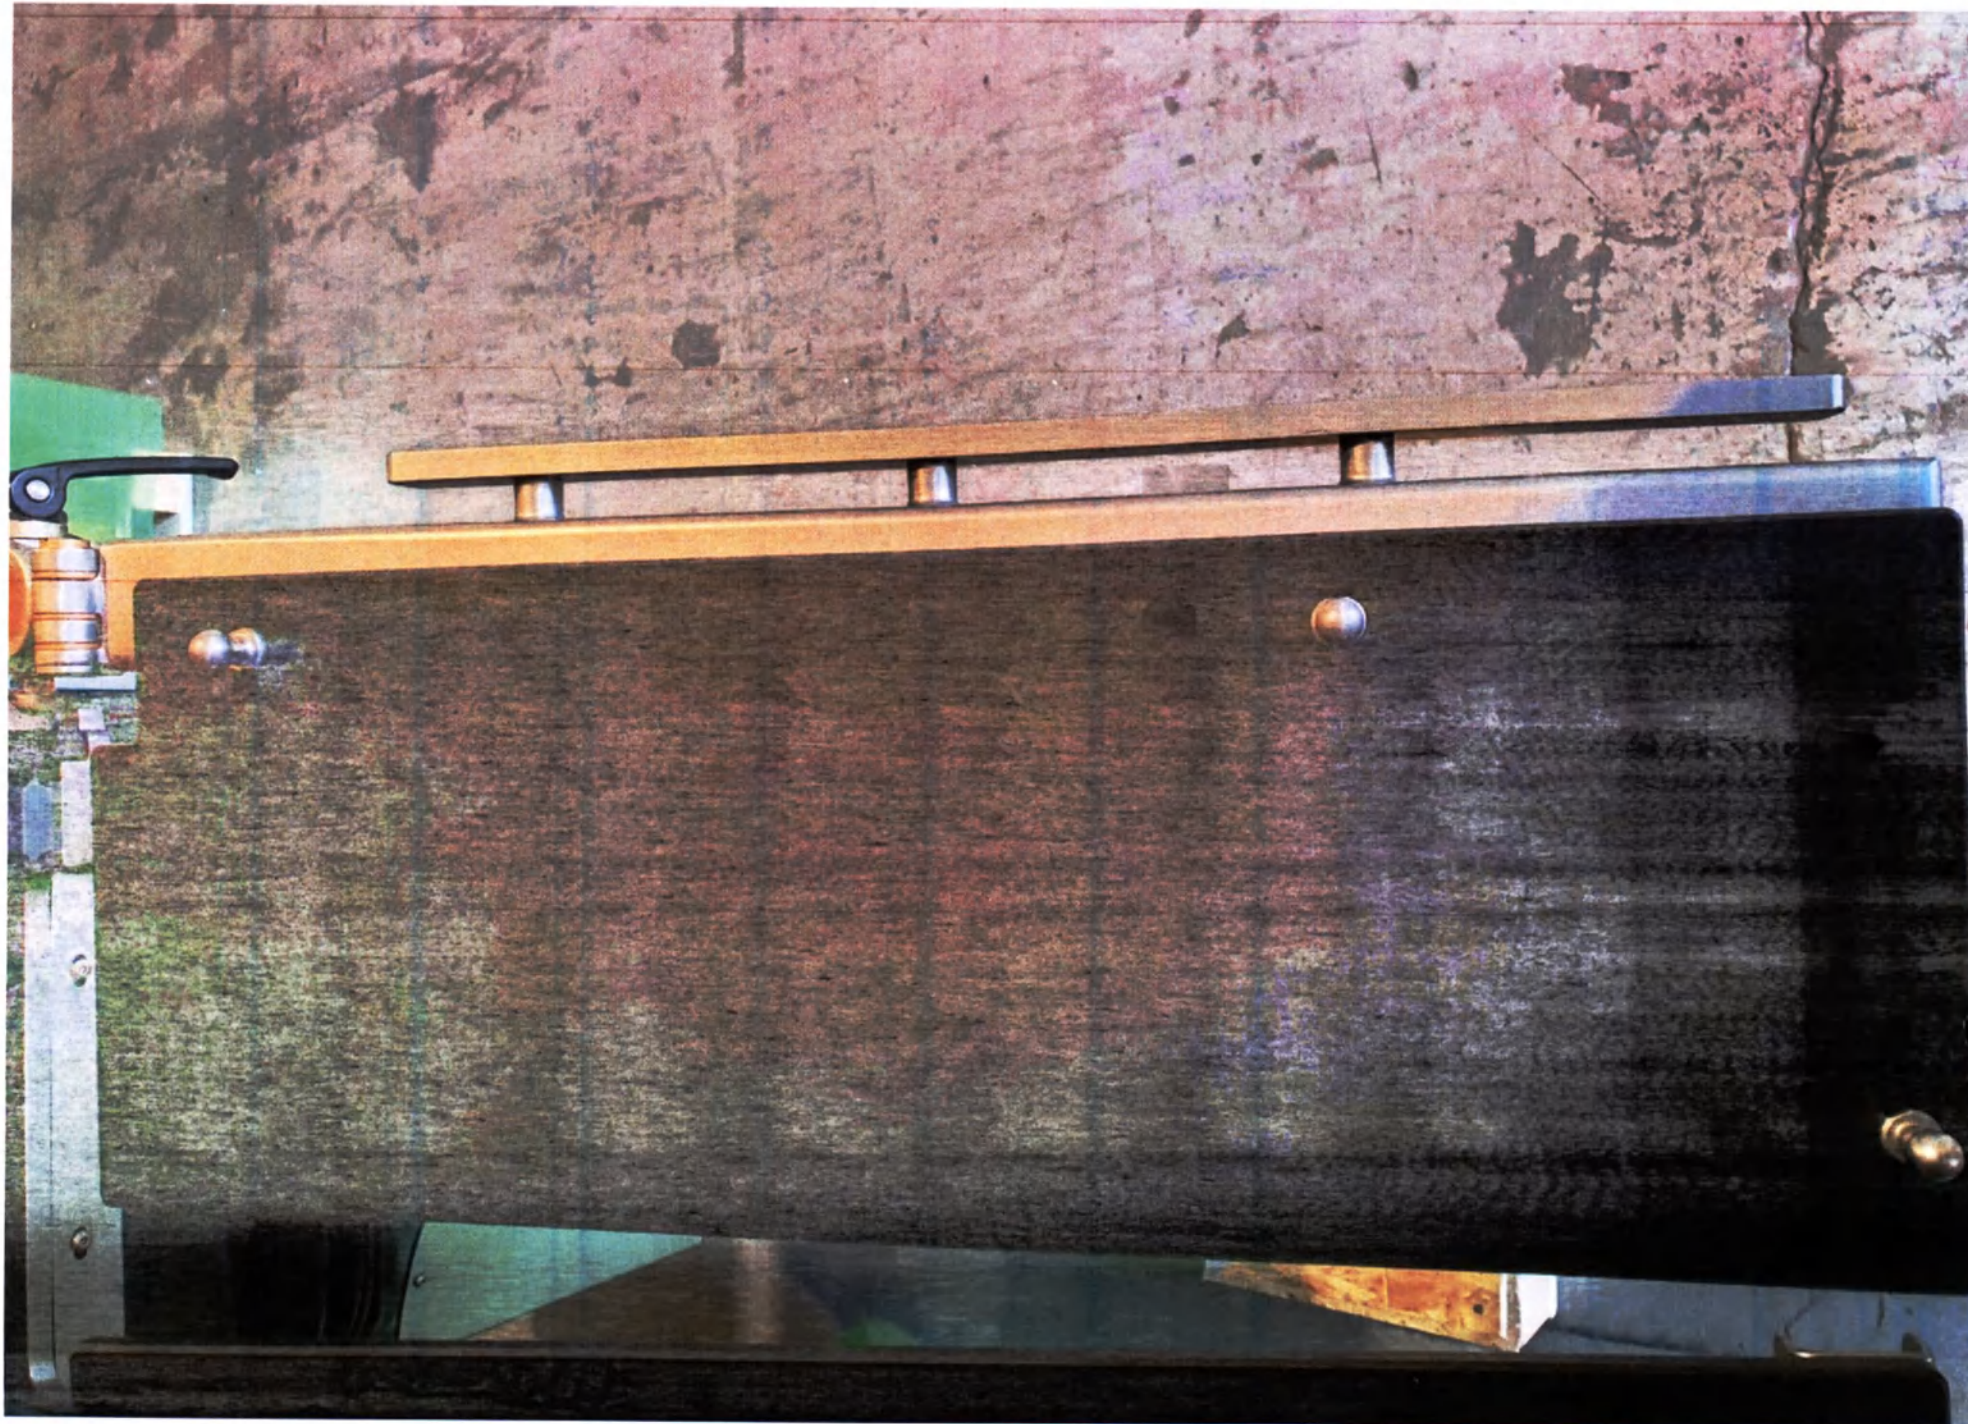

4.9. Матрац головной секции.

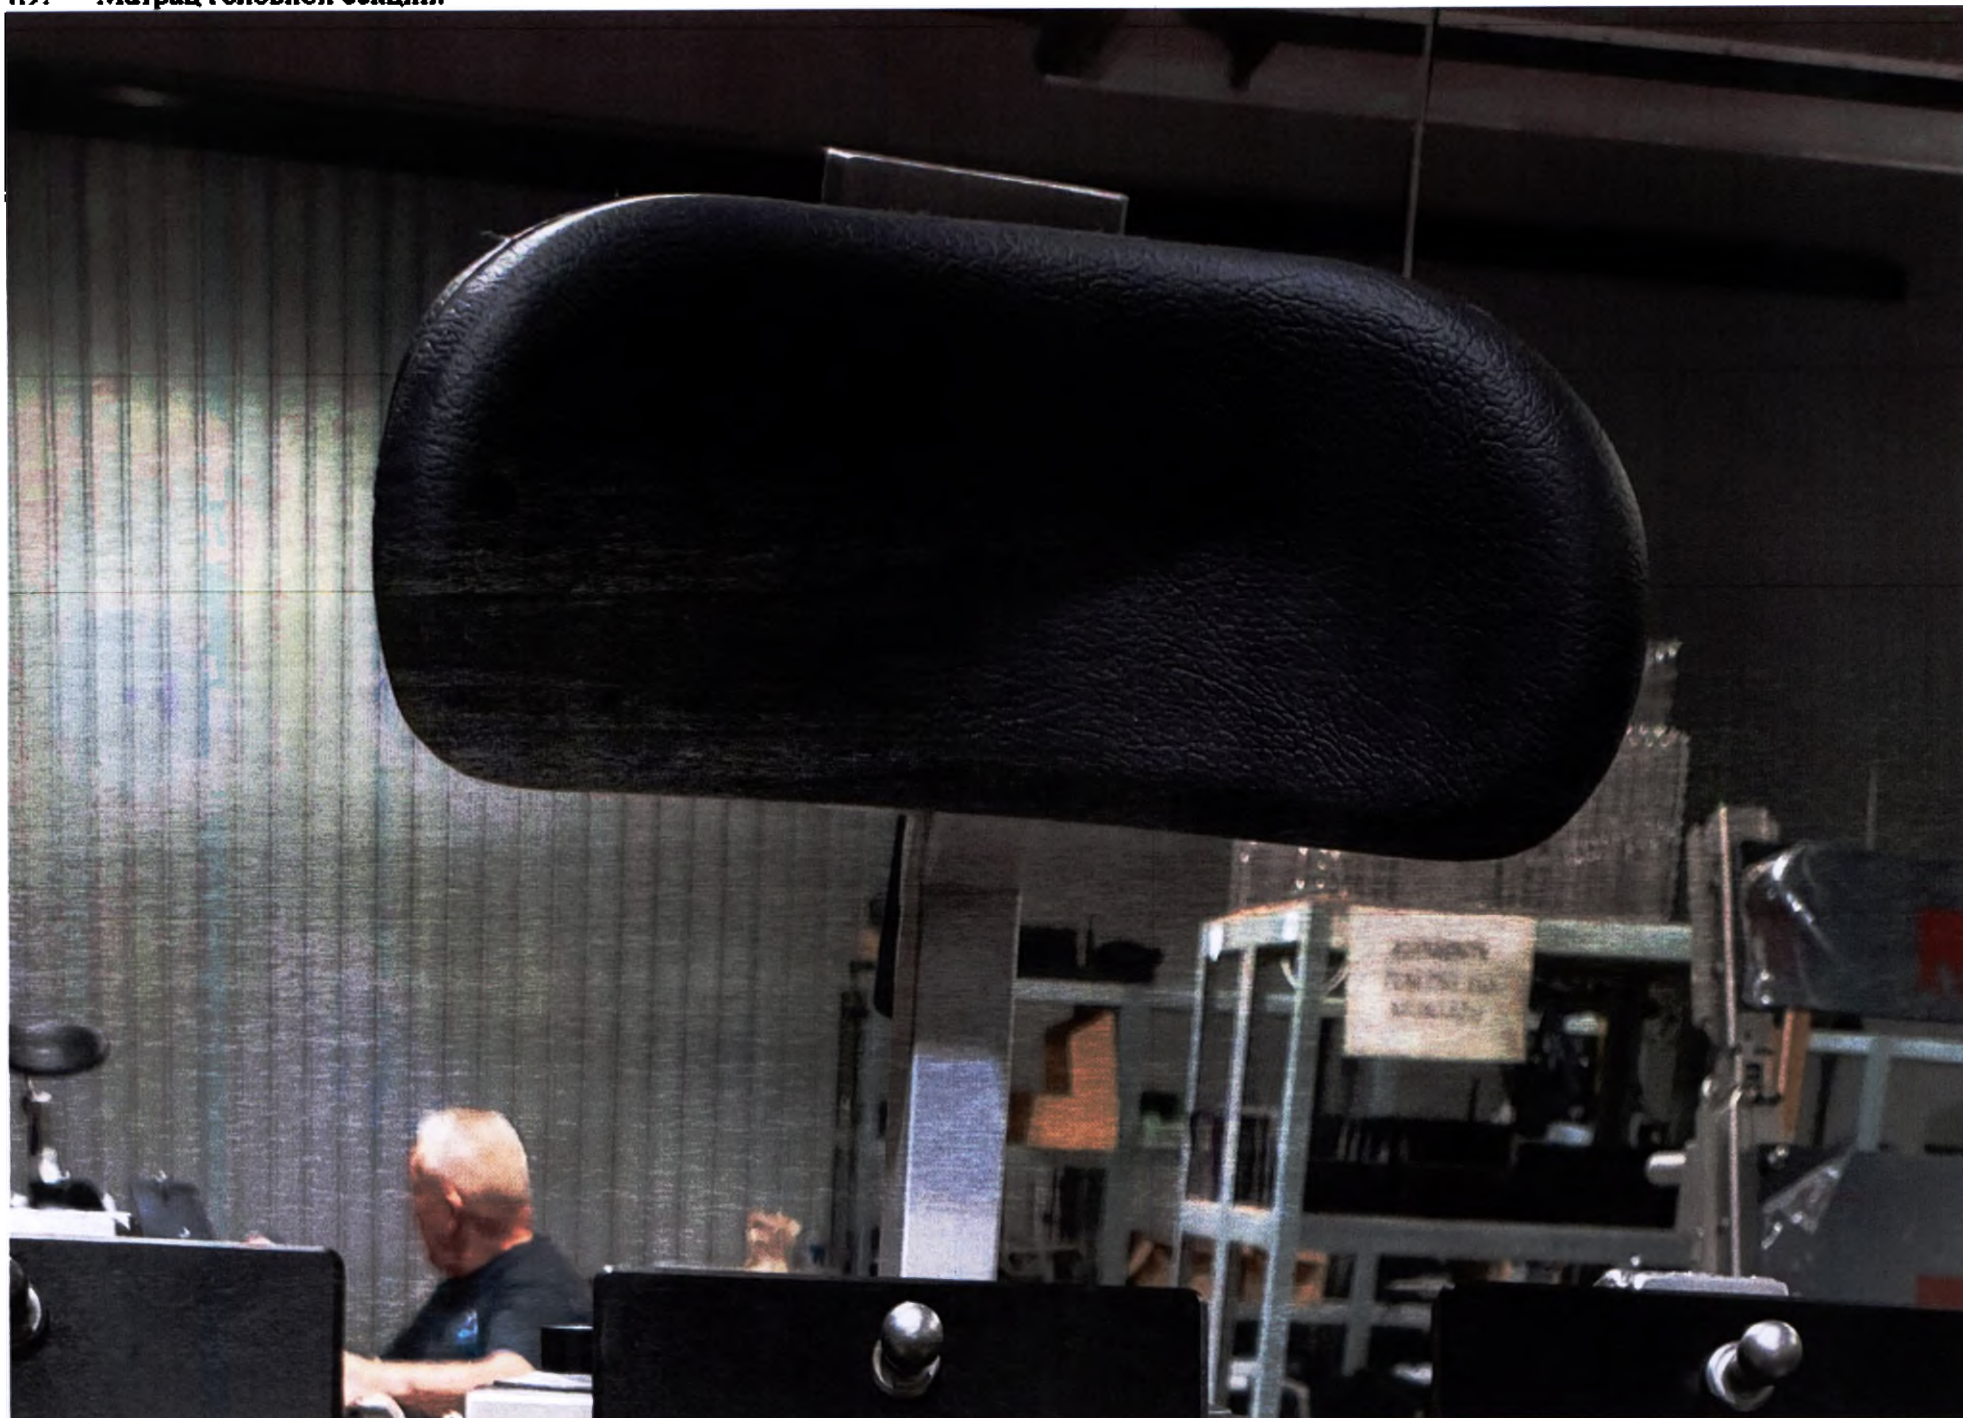

4.10. Матрац спинной секции центральной.



4.11. Матрац спинной секции левой.




4.12. Матрац спинной секции правой.



4.13. Матрац спинной секции нижней.




4.14. Матрац тазовой секции.

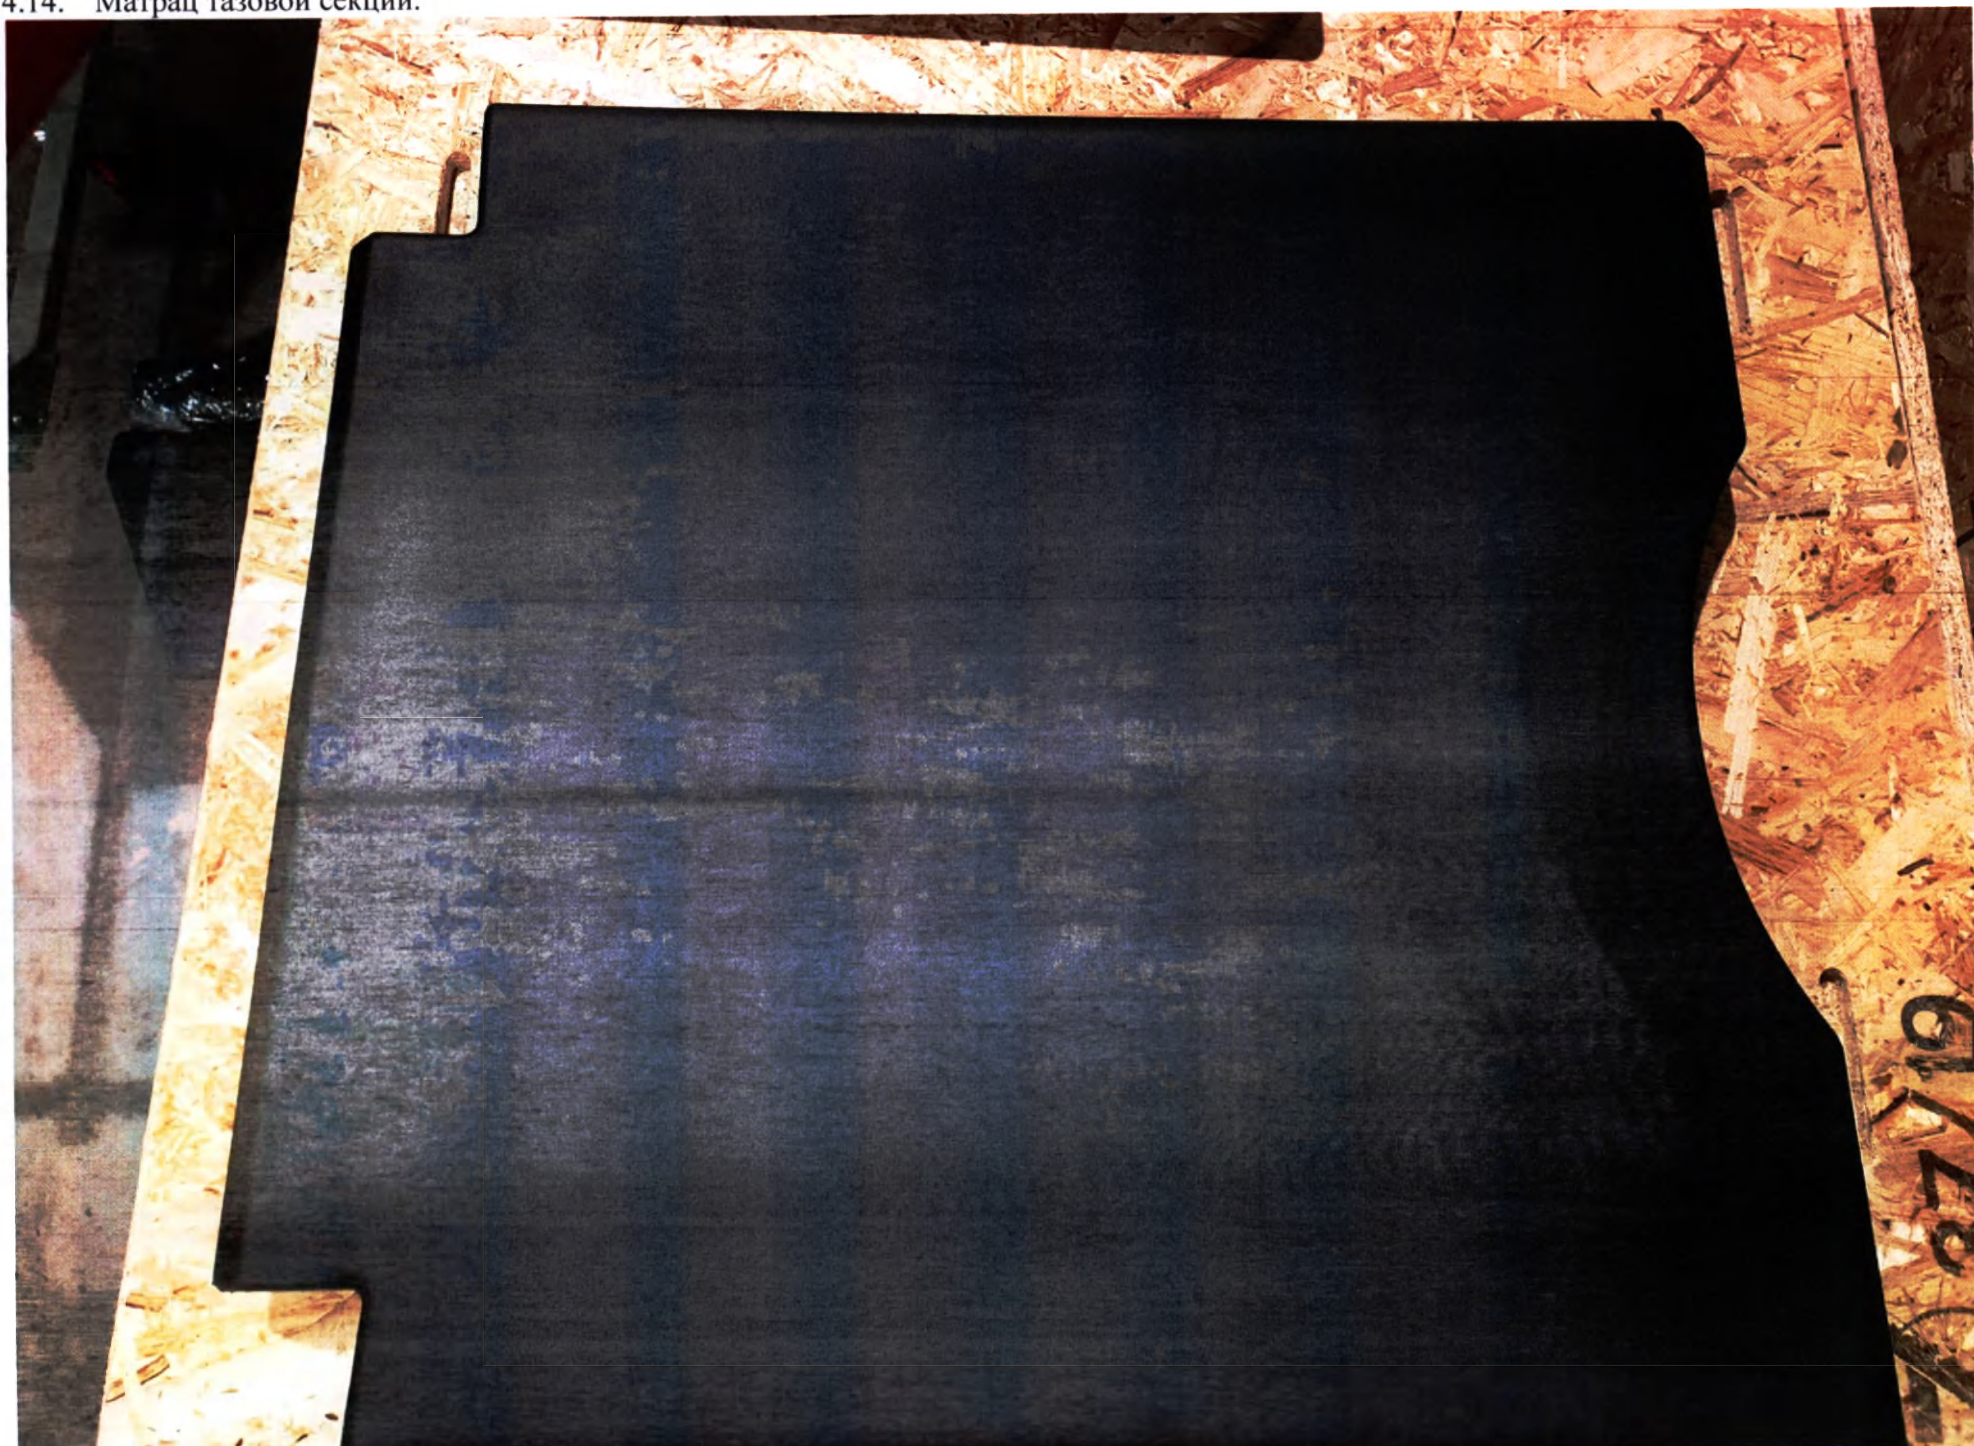

4.15. Матрац ножной секции левой.



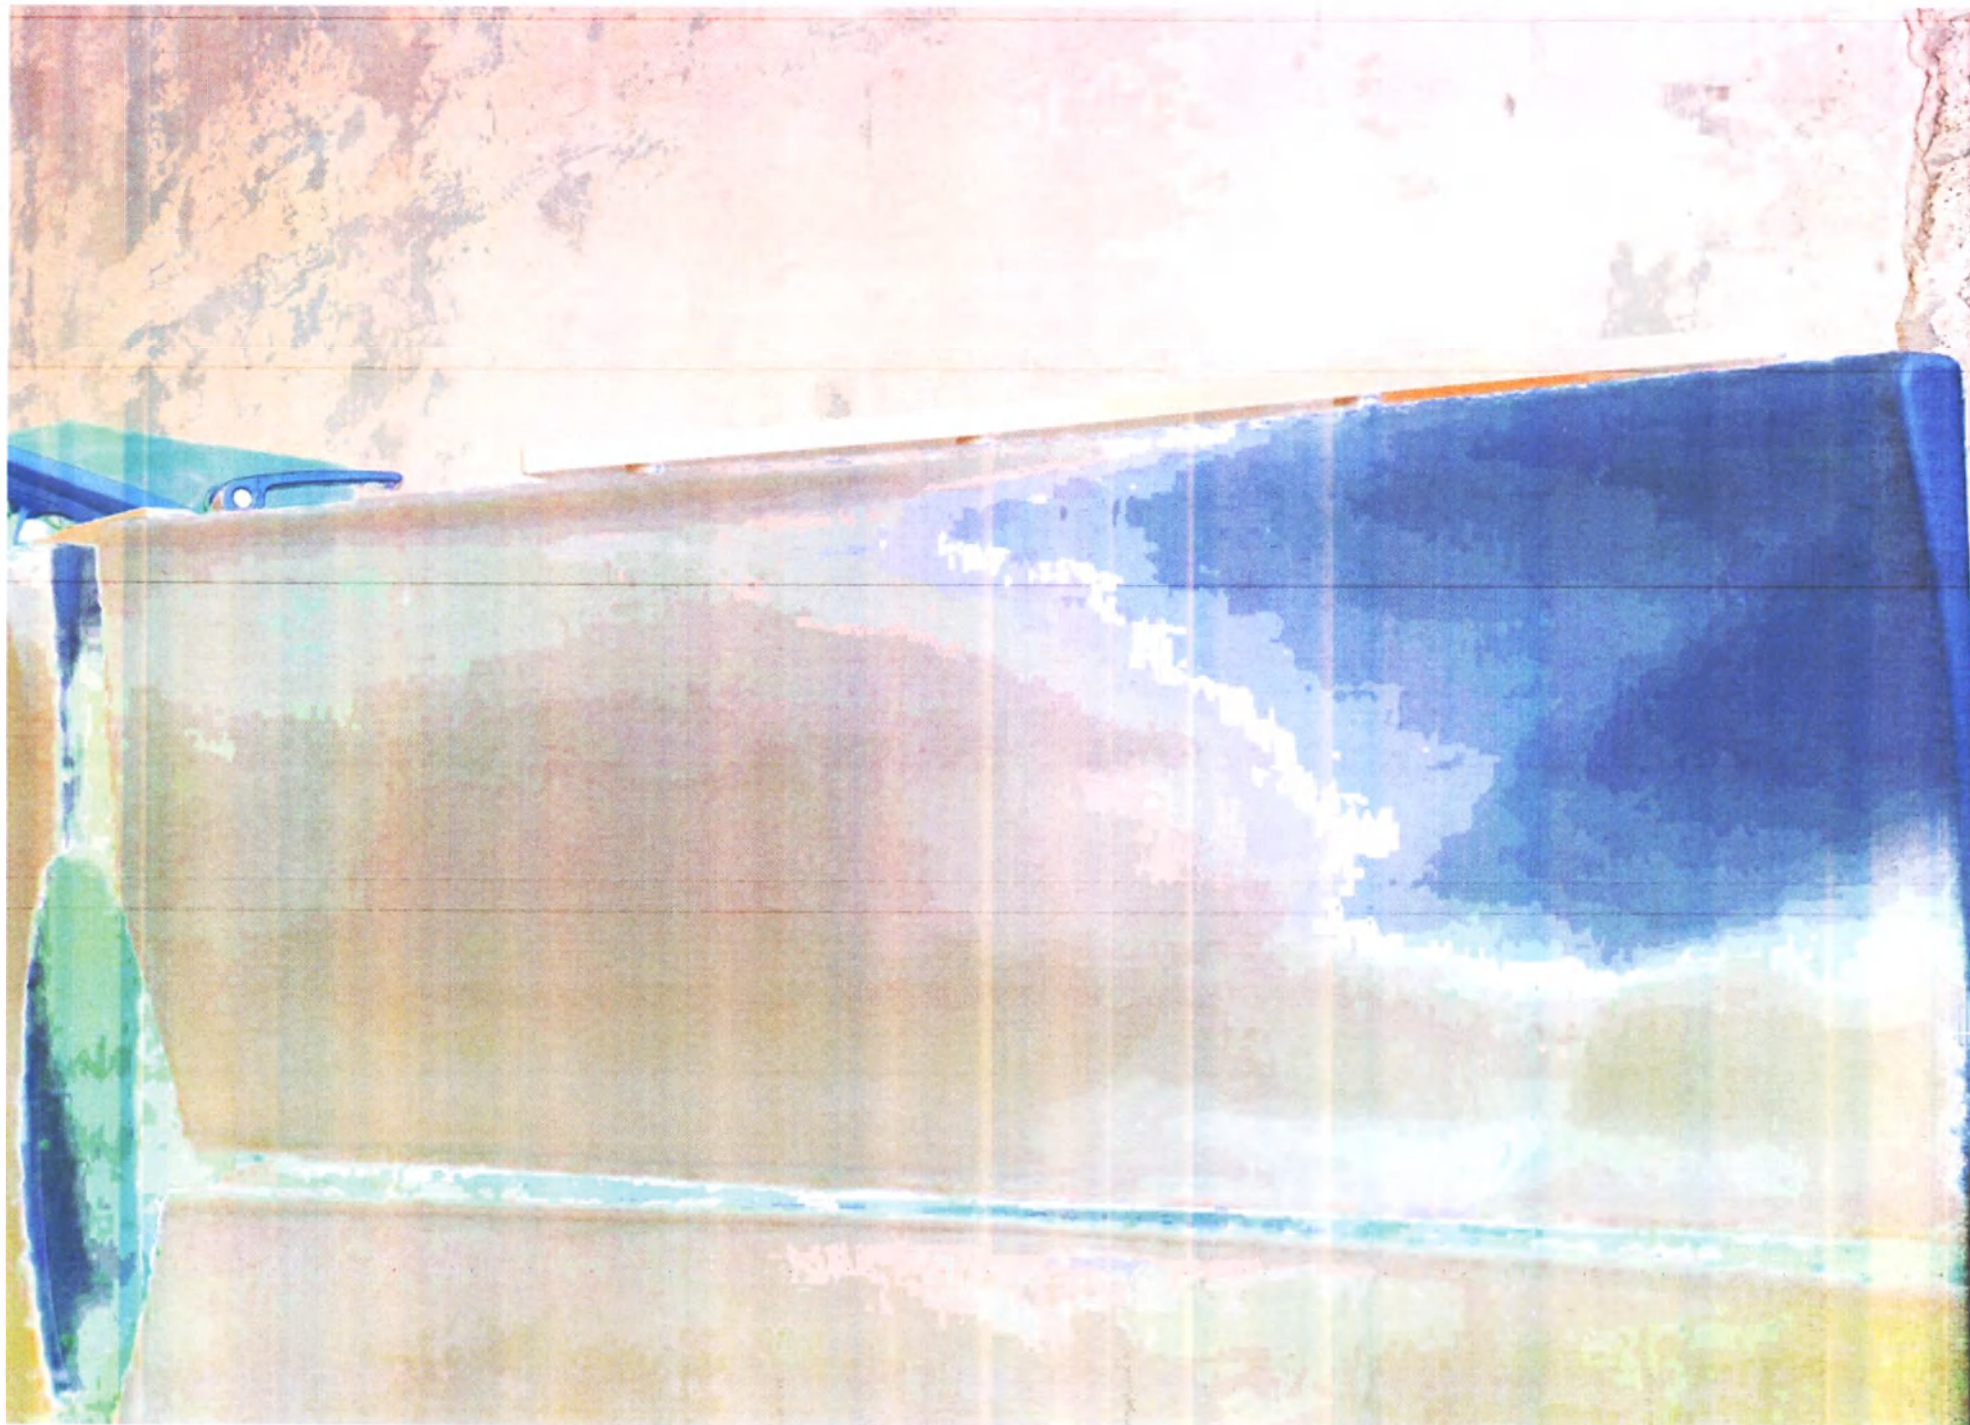

4.17. Стойка инфузионная специальная (при необходимости).



4.18. Пульт управления ручной.



4.19. Пульт управления ножной (при необходимости).



4.20. Пульт управления беспроводной (при необходимости).



4.21. Панель управления на колонне (при необходимости).



4.22. Основание мобильное (при необходимости).



4.23. Привод альтернативный дублирующий (при необходимости).




4.24. Привод регулировки спинной секции электрогидравлический (при необходимости).




4.25. Привод регулировки продольного сдвига электрогидравлический (при необходимости).



4.26. Привод блокировки колес электрогидравлический (при необходимости).

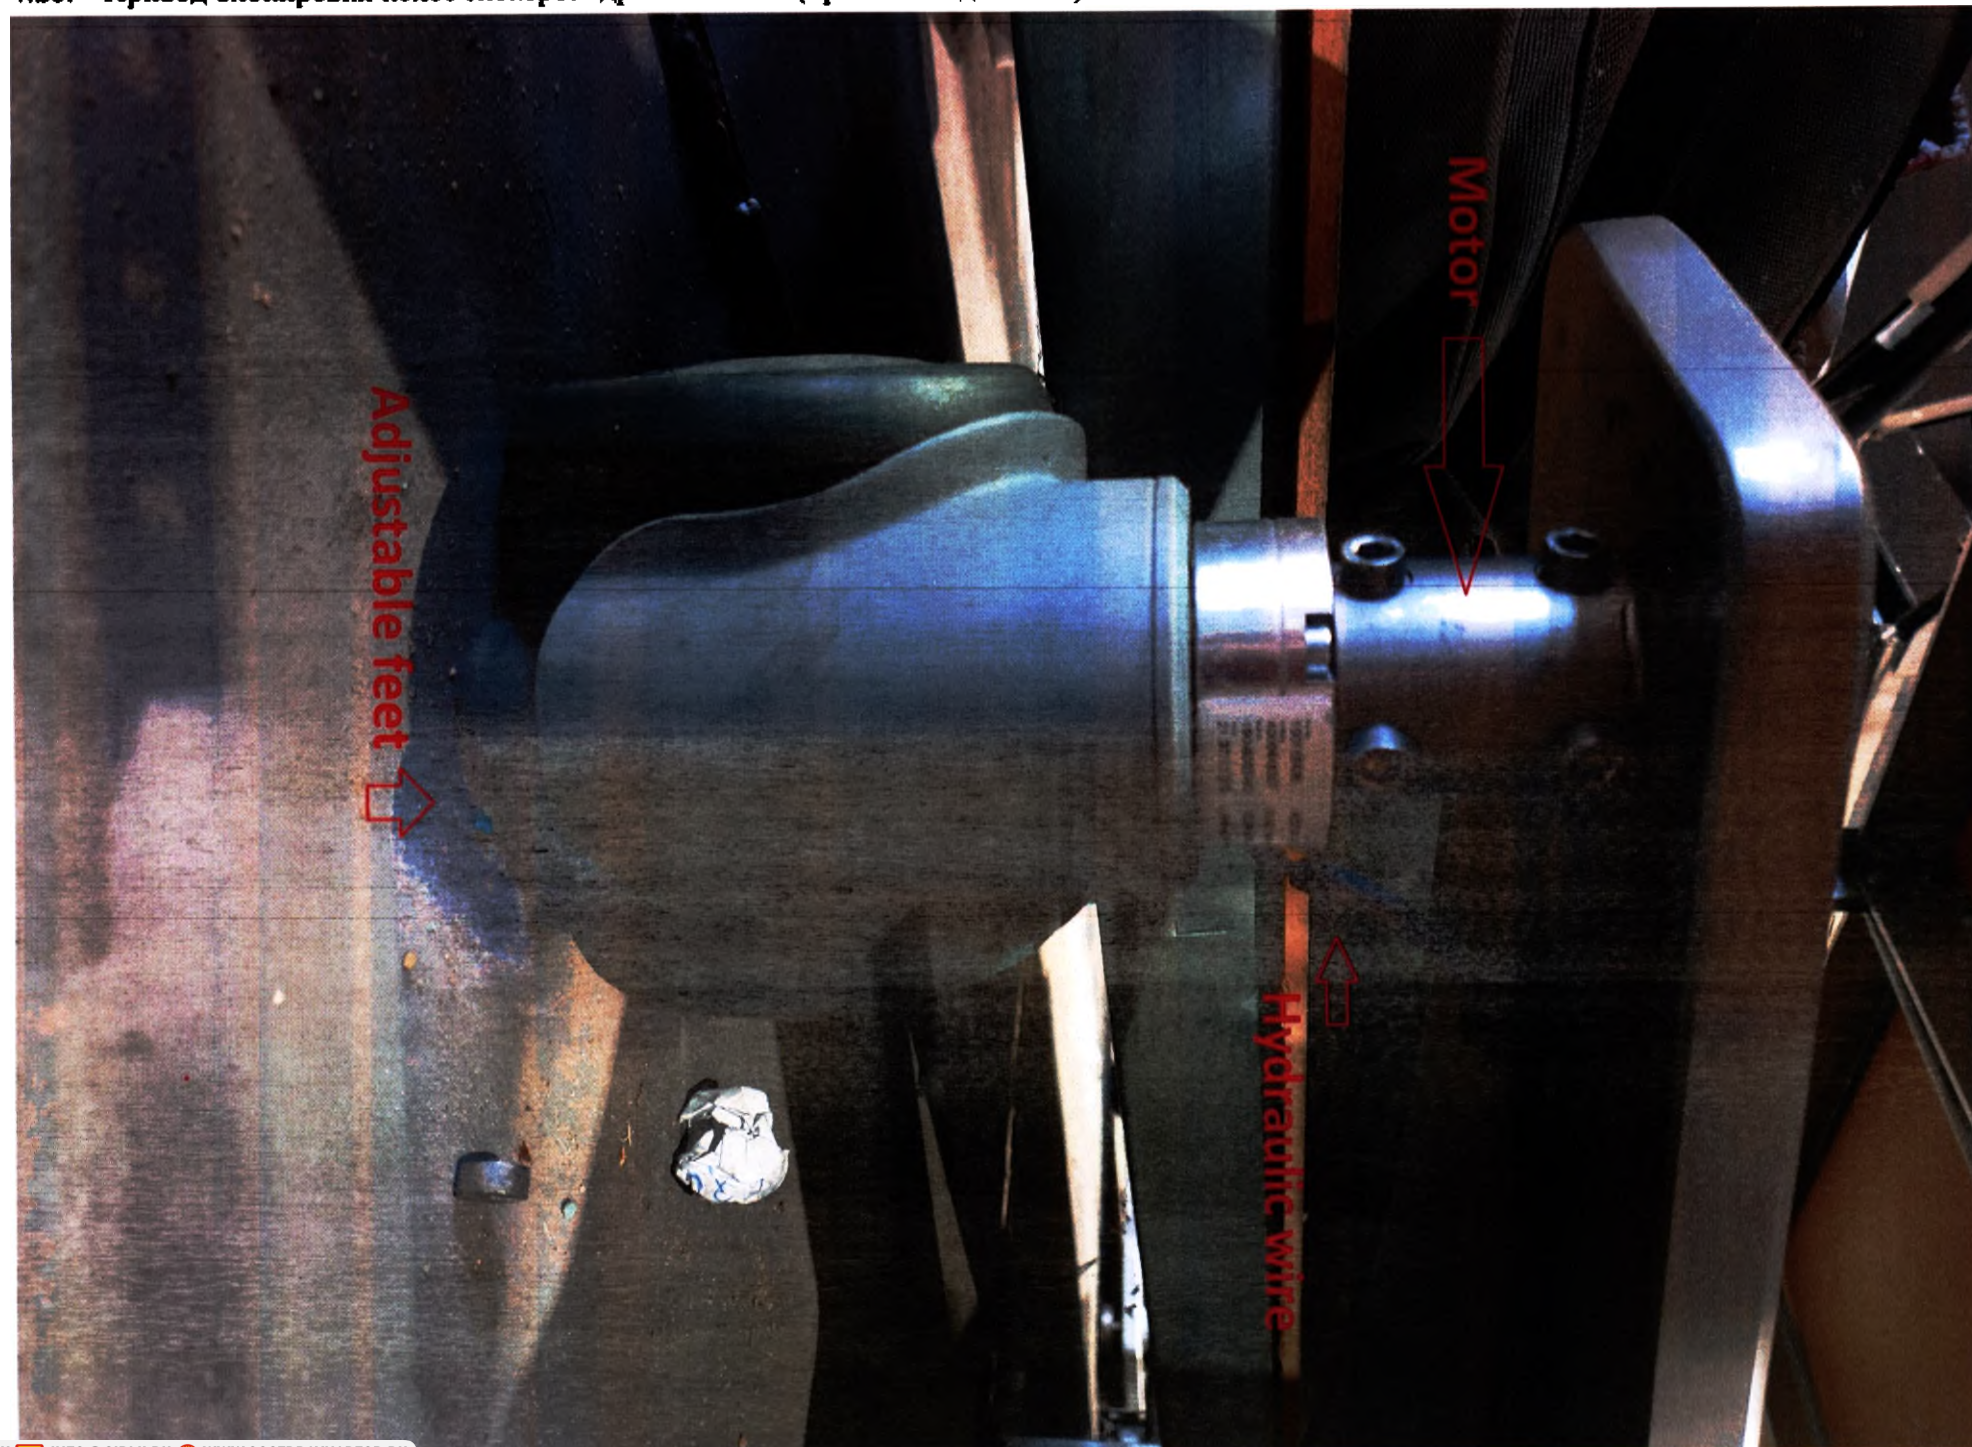

4.27. Секция ножная раздельная левая в комплекте с матрасом (при необходимости).

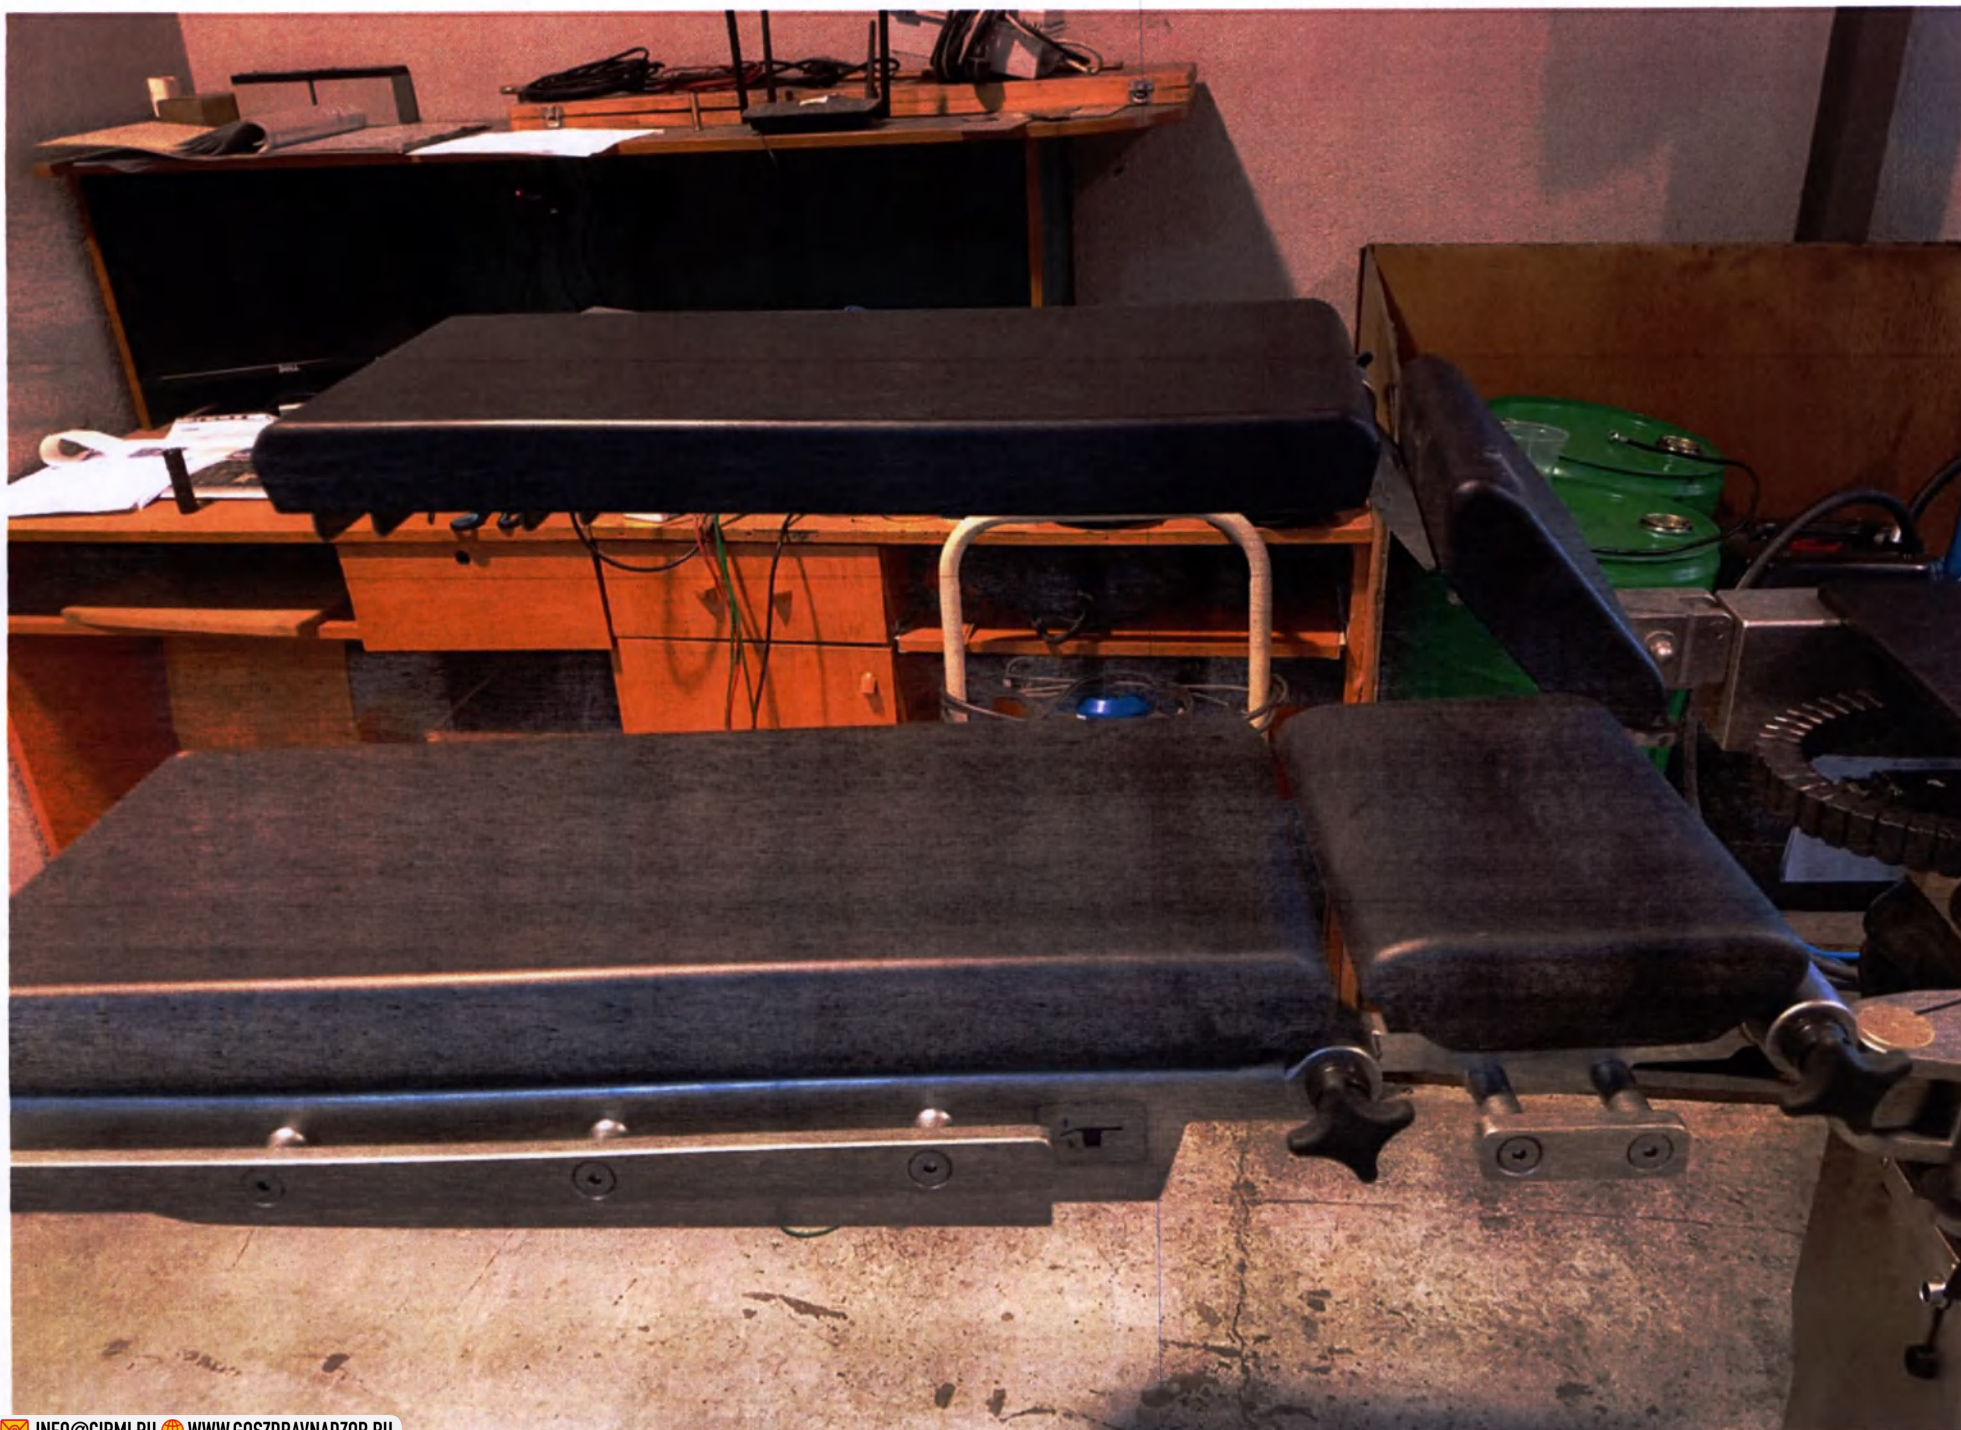

4.28. Секция ножная раздельная правая в комплекте с матрасом (при необходимости).





 **INFIMED**



Infimed Sp. z o. o.

ul. Kabaty 1

34-300 Zywiec

Made in POLAND



IP-X4



Symbol: **VIVAX OT-02-722**

SN: 0819 / 433

~230V / 50-60Hz


200VA

2 min / 18 min

5.1. Секция ложа.



5.2. Матрац (при необходимости).

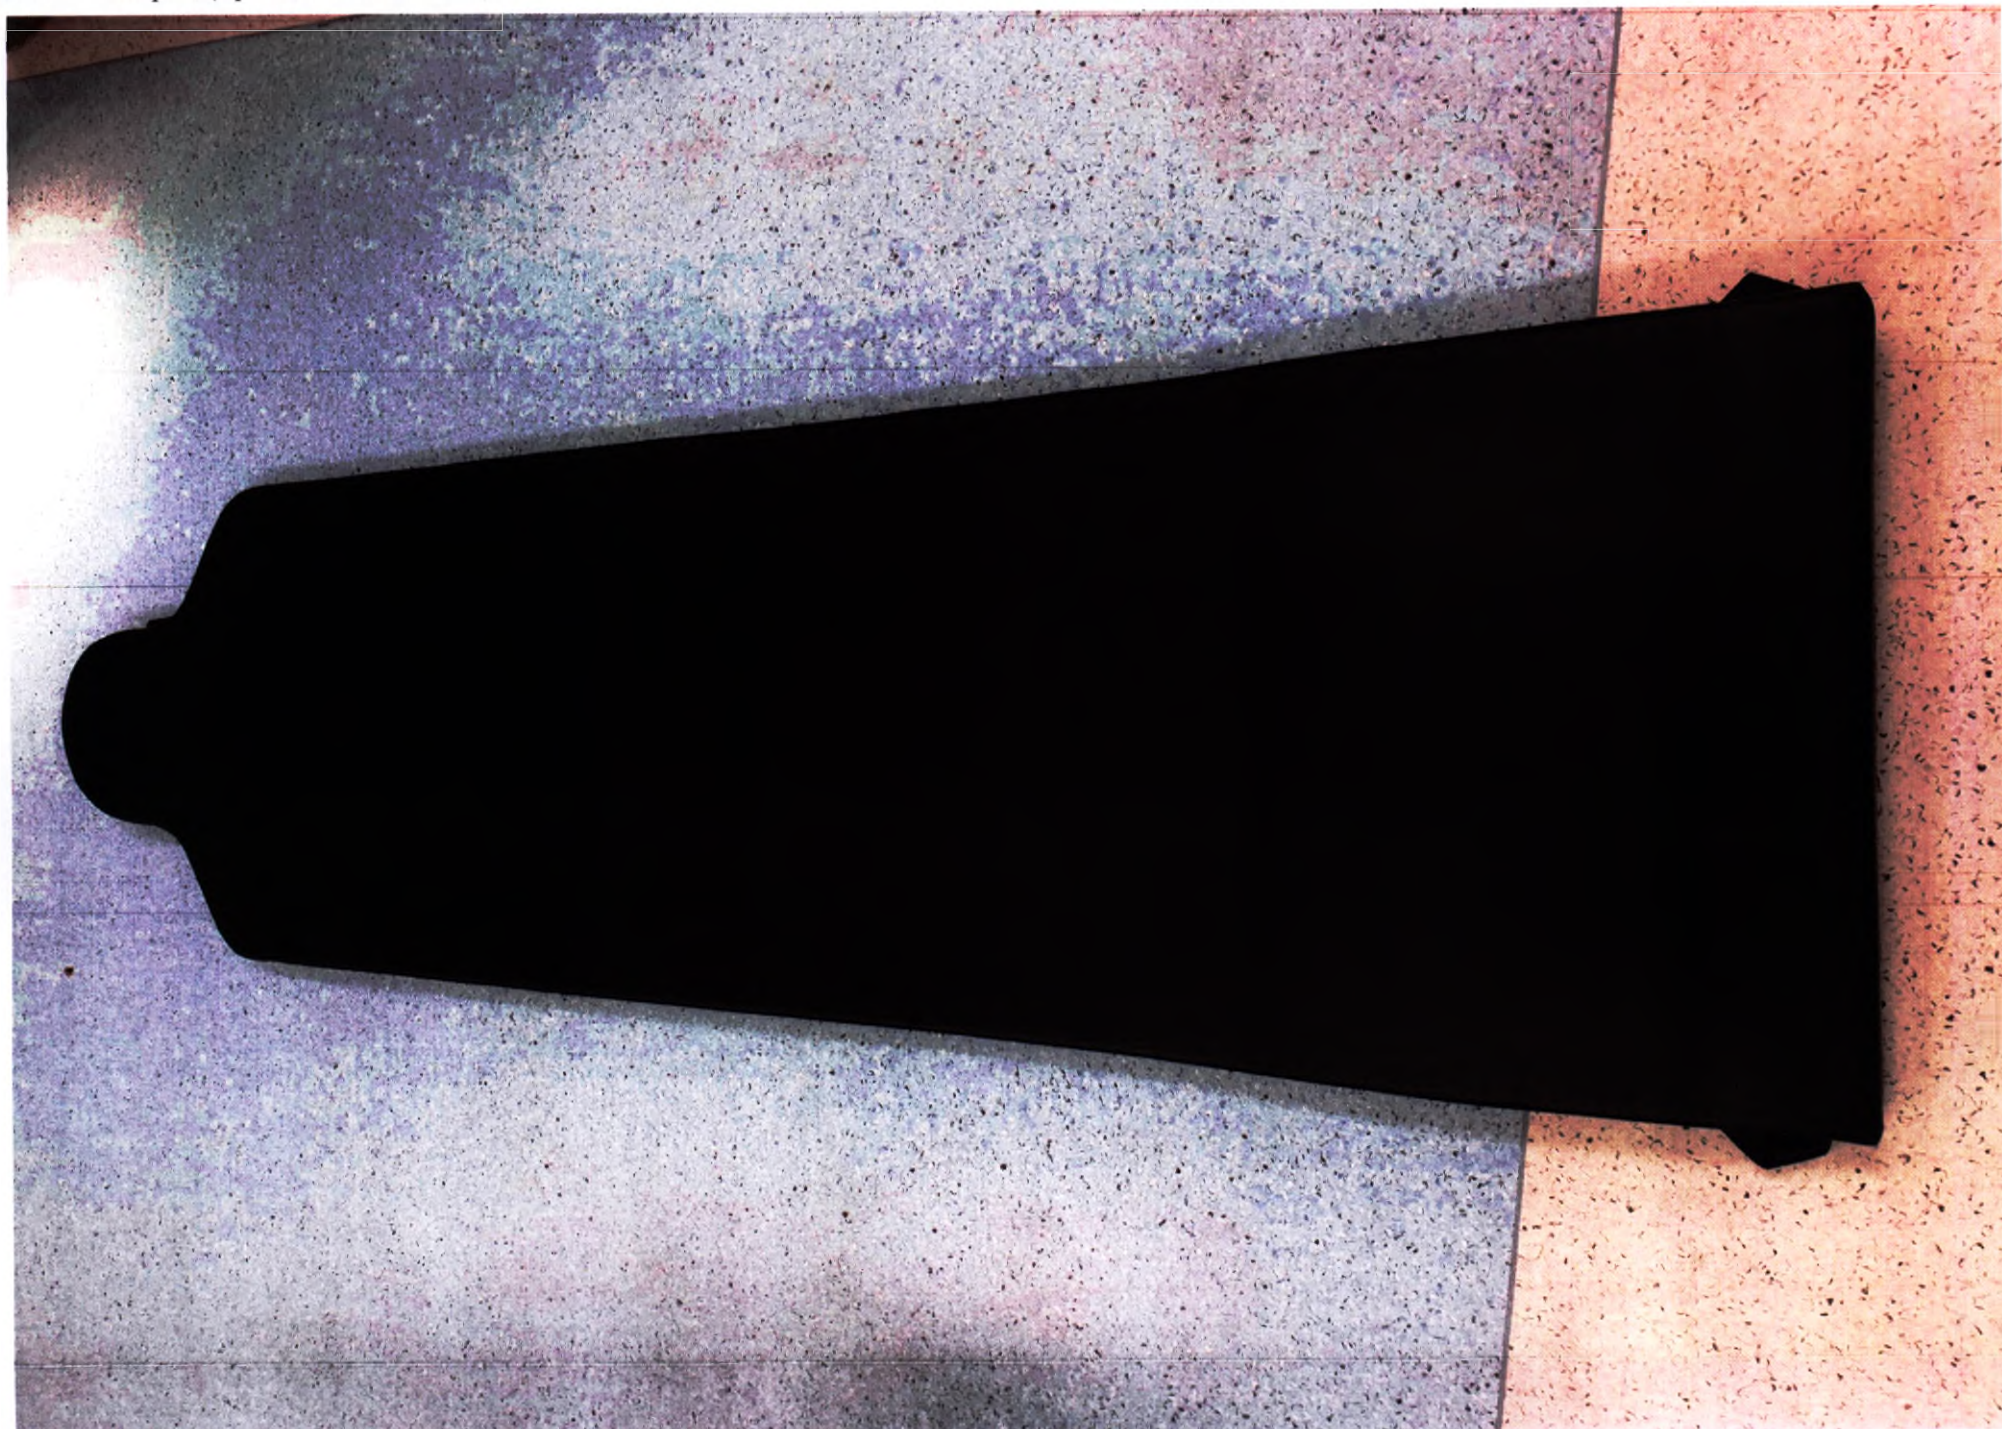

5.3. Пульт управления проводной.



5.4. Пульт управления беспроводной (при необходимости).




5.5. Стойка инфузионная специальная (при необходимости).




5.6. Пульт управления в виде джойстика (при необходимости).




5.7. Привод регулировки продольного сдвига электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.

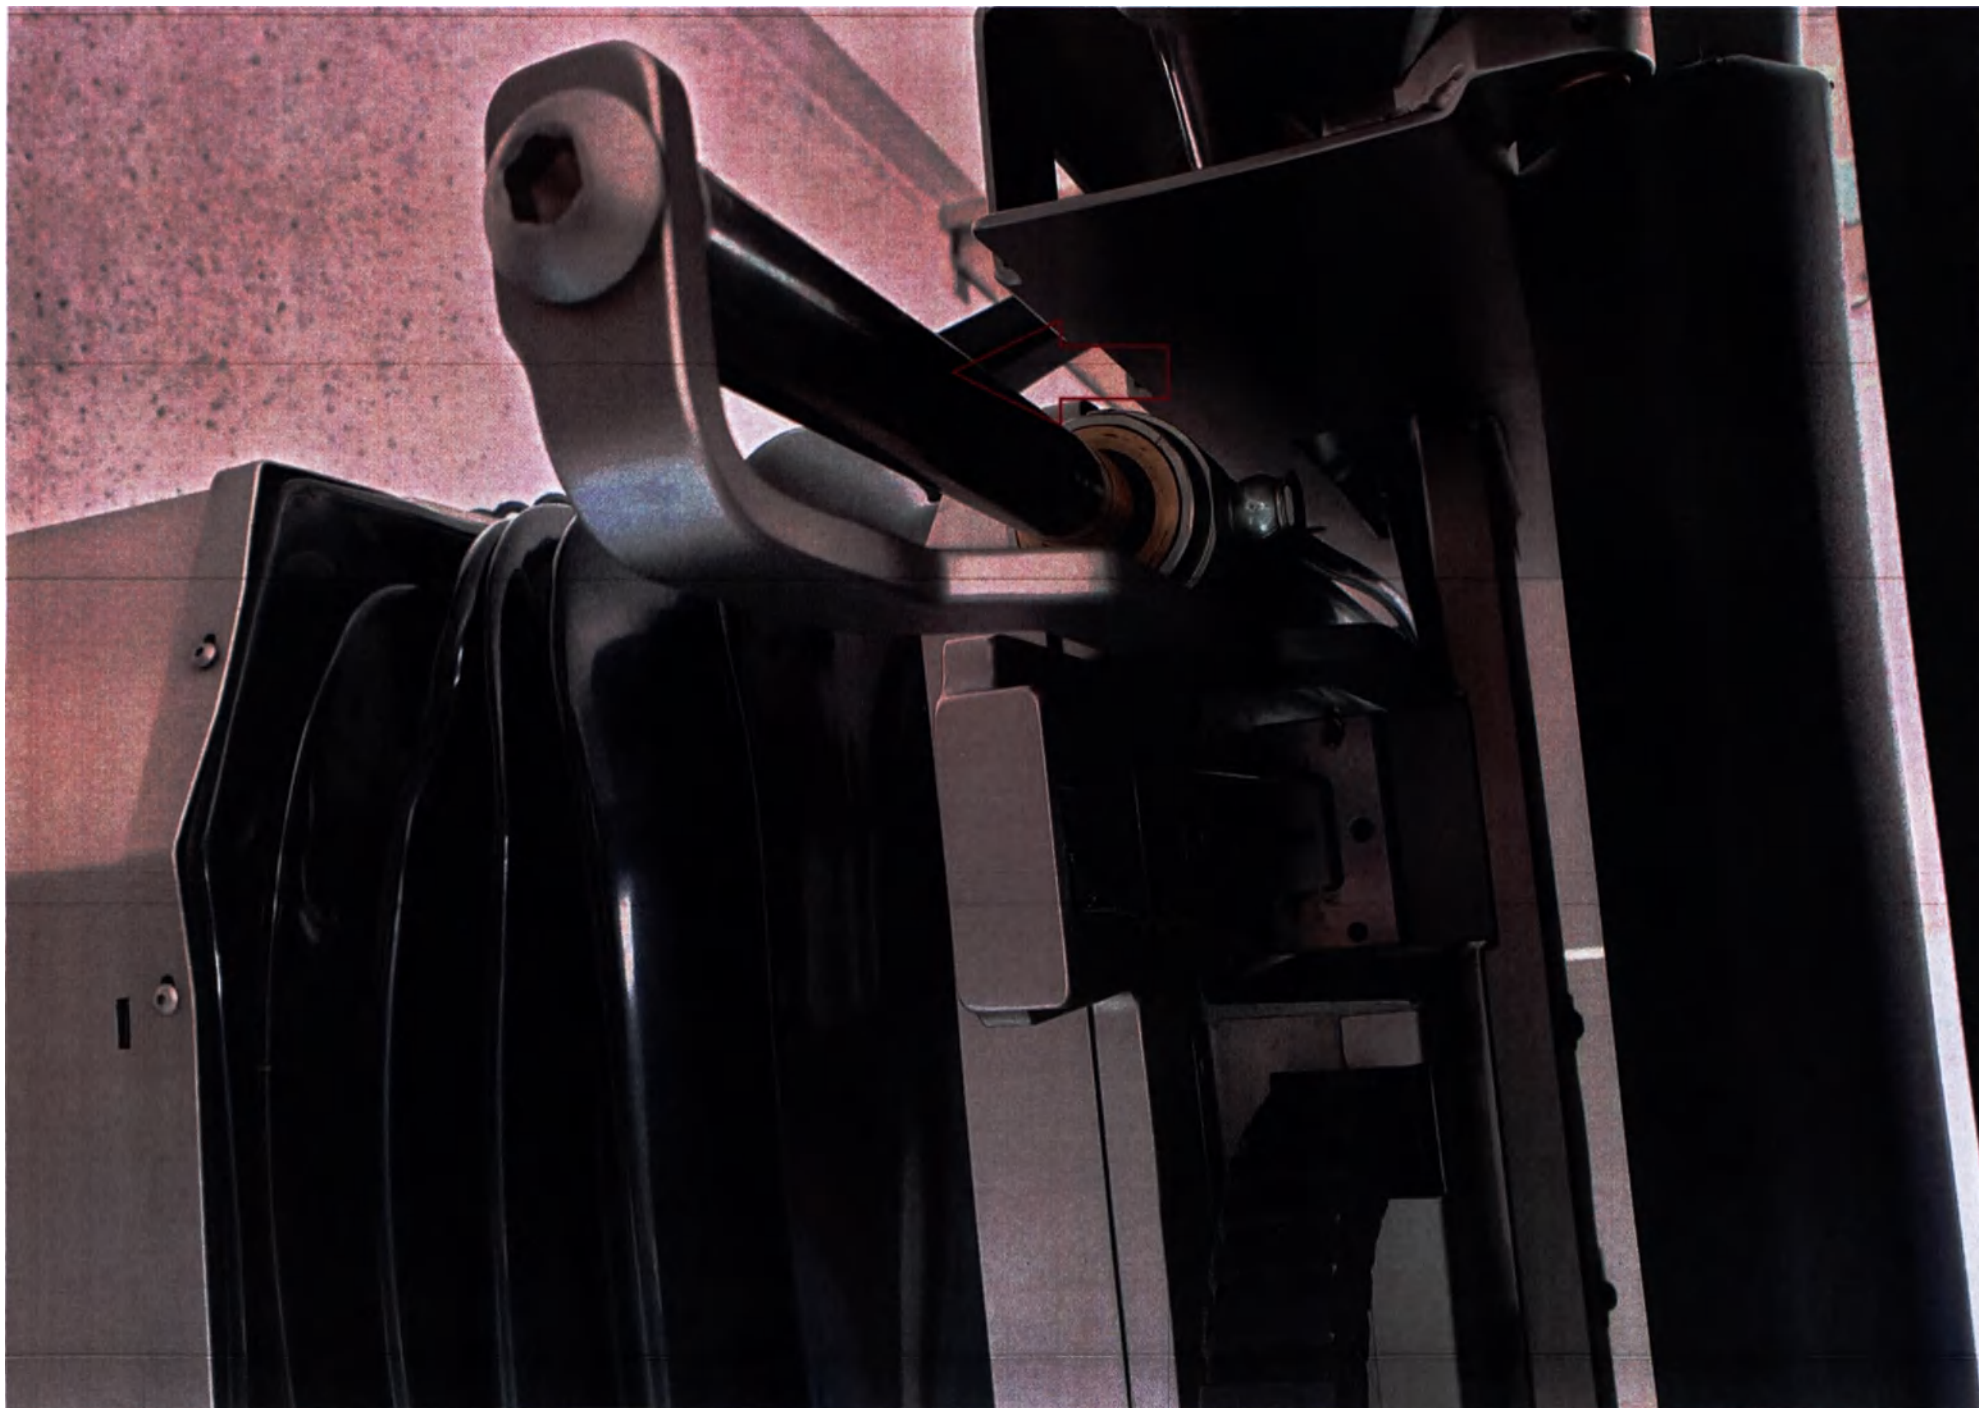

5.8. Привод регулировки латерального сдвига электрогидравлический (при необходимости) - 1 шт.

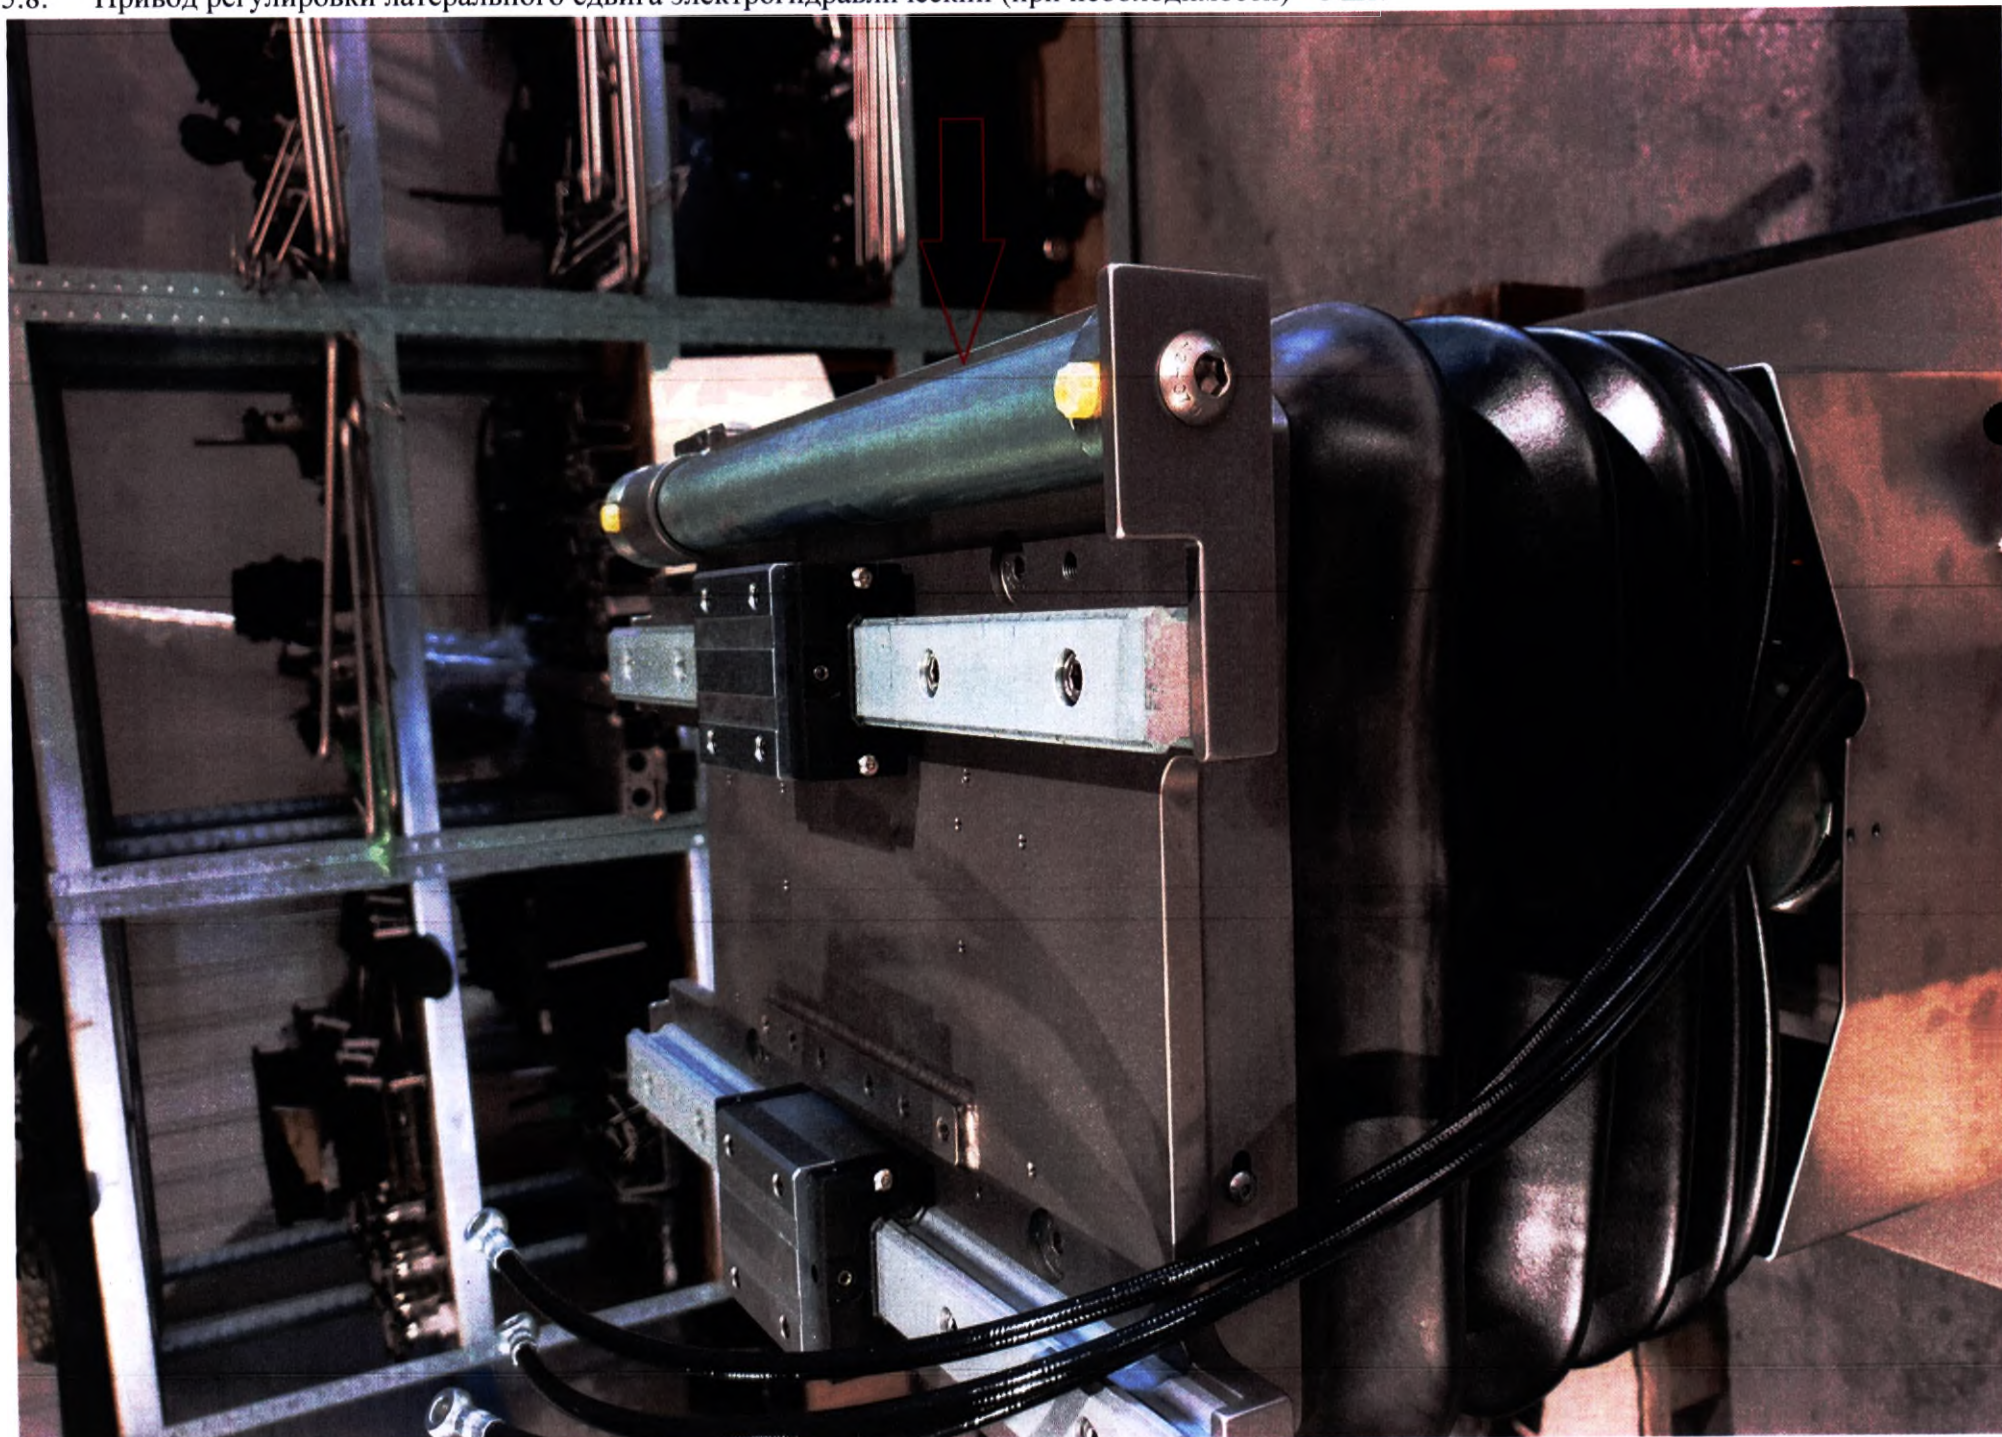

1. **Зажим для дополнительного оборудования из нержавеющей стали.**

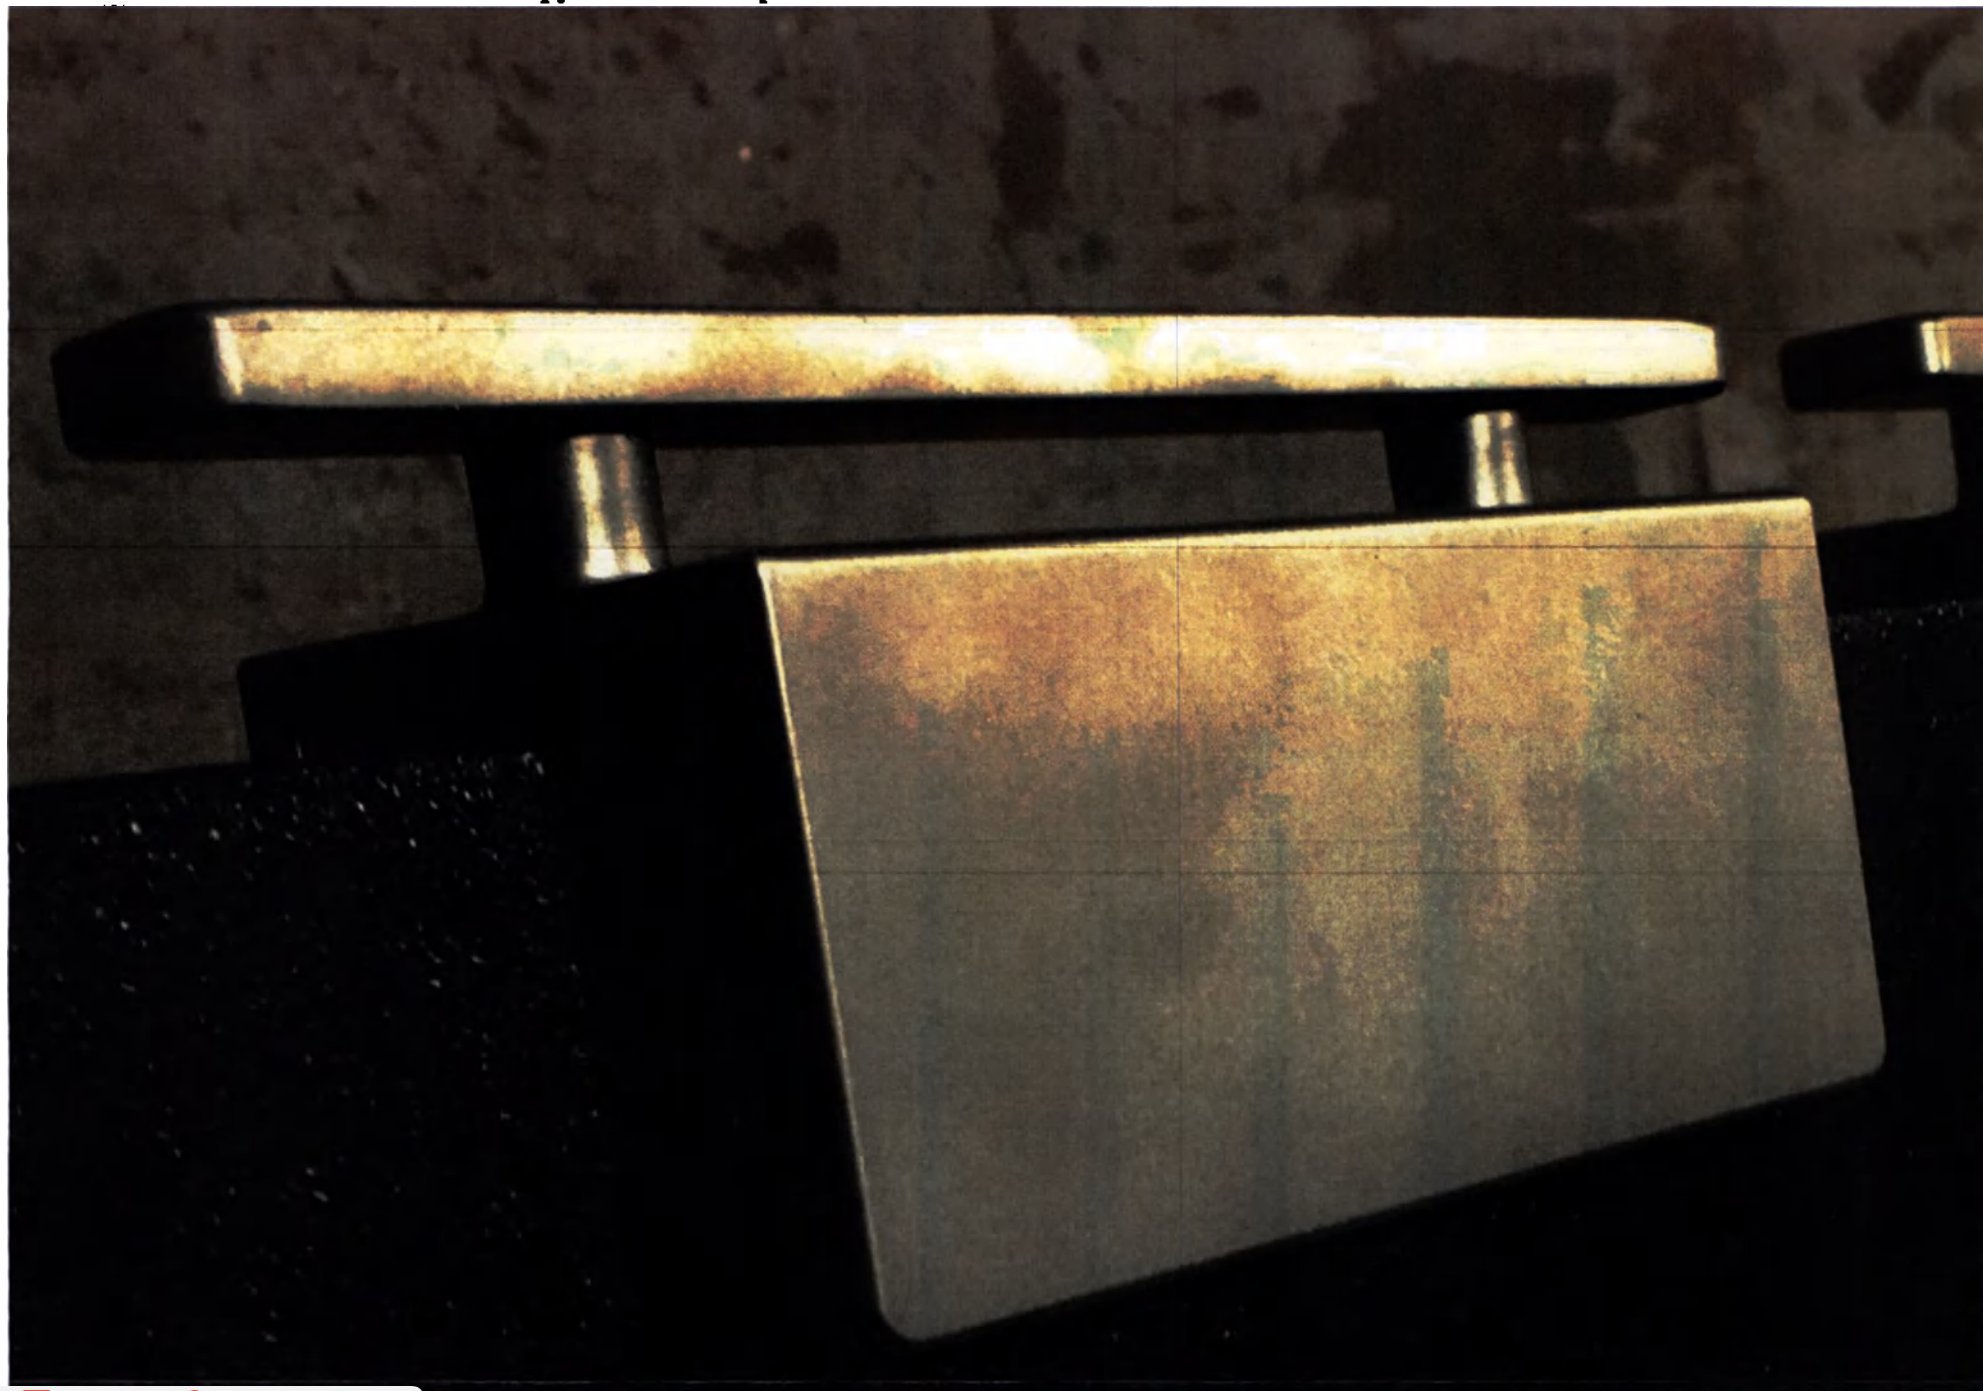


2. Зажим для дополнительного оборудования из карбонового углеродного волокна.




3. Зажим однопозиционный.



4. Зажим мультипозиционный.

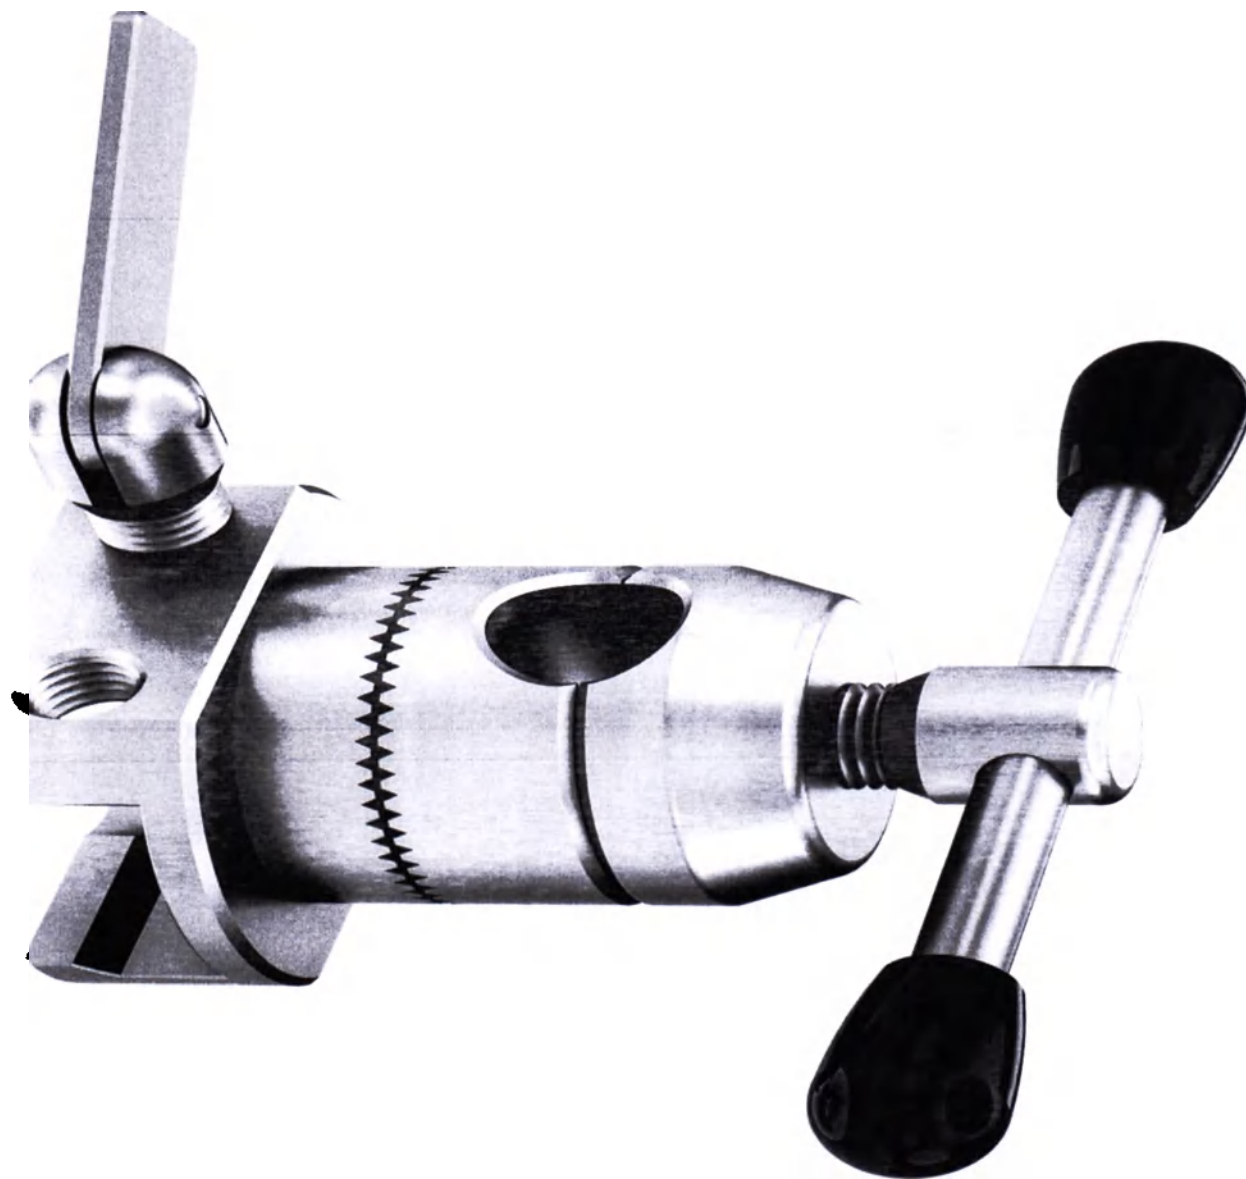

5. Опора для колена.

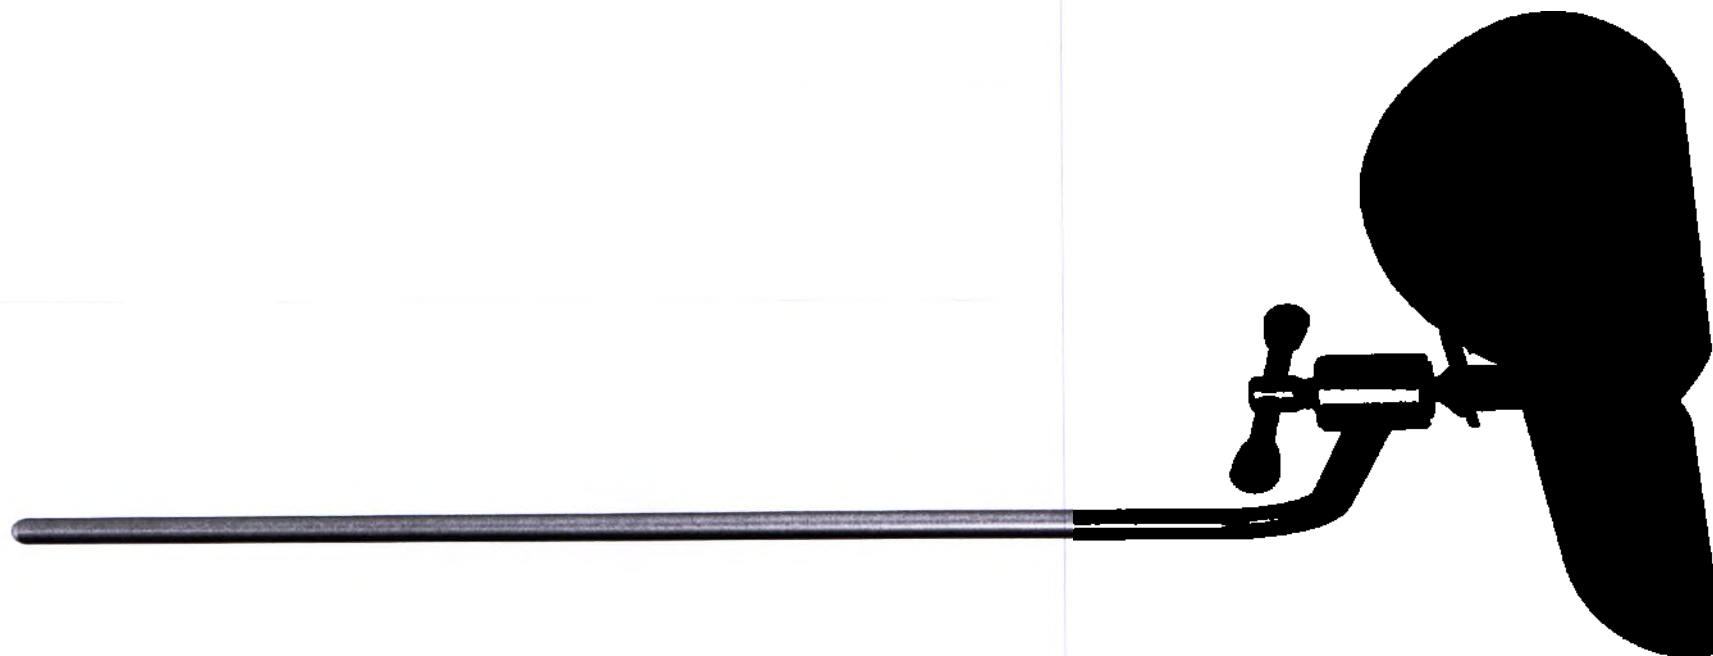

6. Опора для руки регулируемая.




7. Опора для руки.



8. Держатель бедер.




9. Упор для плеча/ Упор боковой.

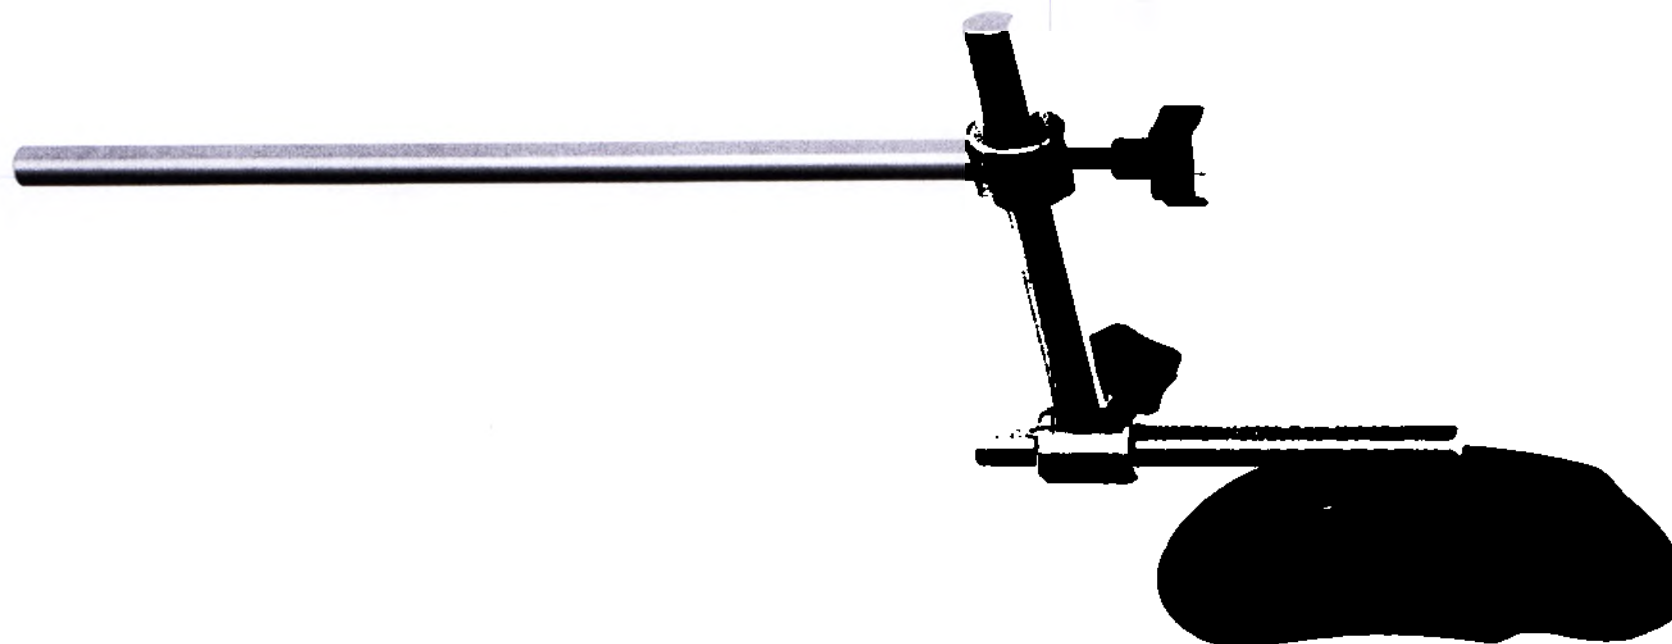


10. Упор боковой.




11. Дуга анестезиолога.

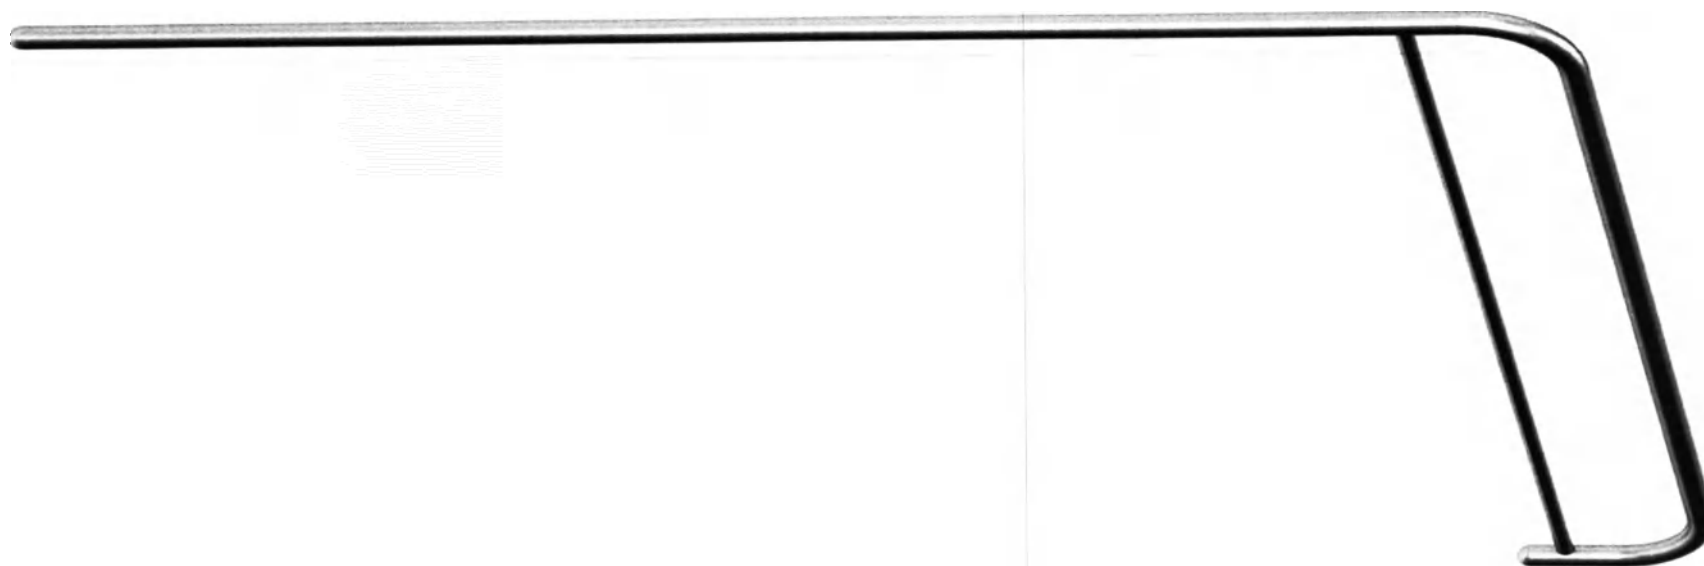


12. Дуга анестезиолога с регулировкой ширины.

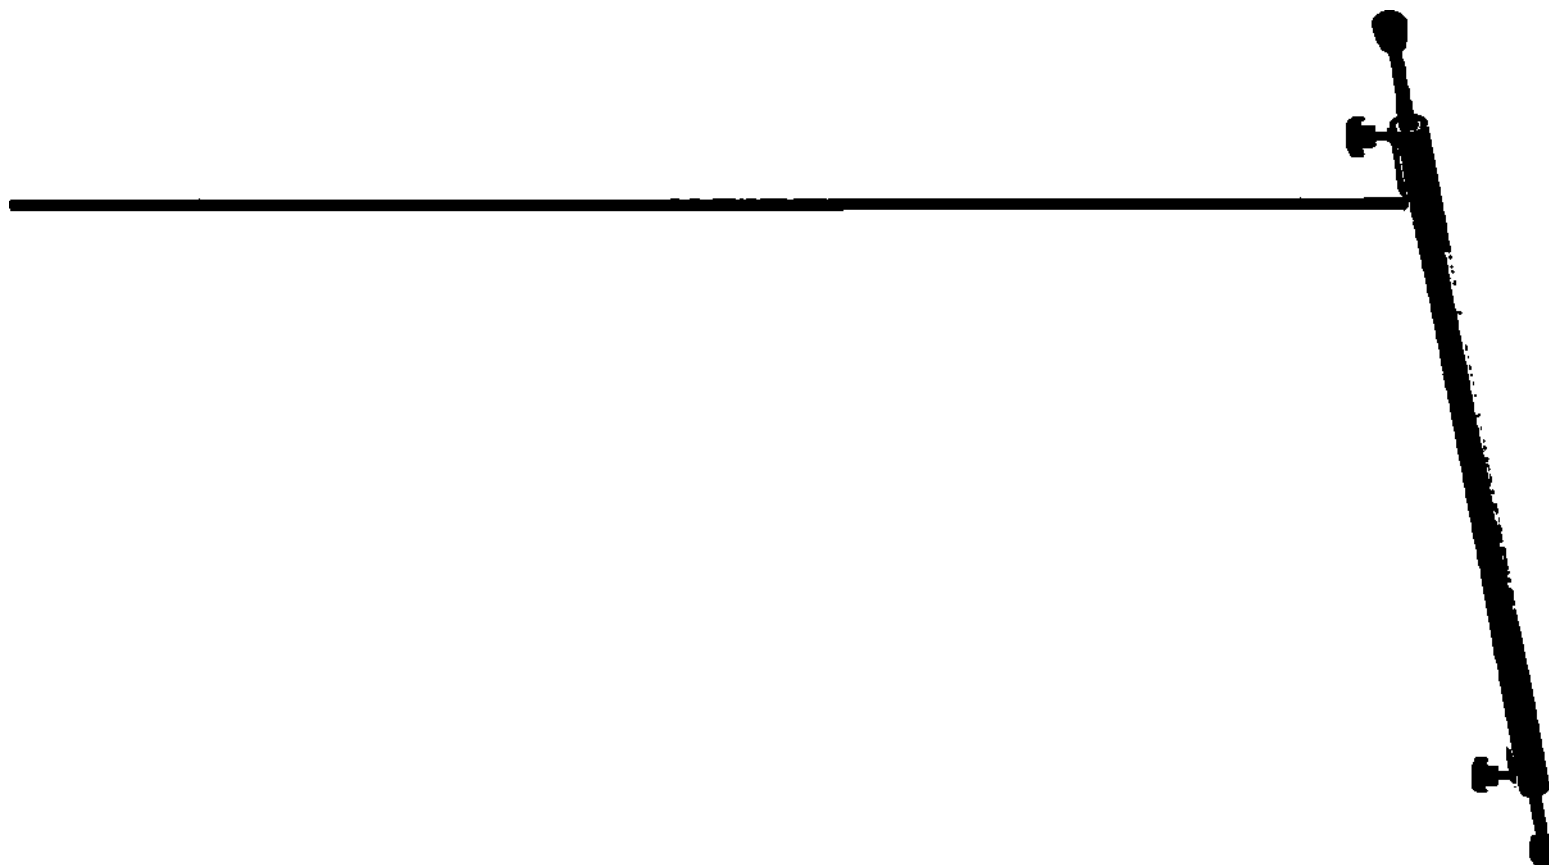

13. Держатель руки/Держатель голени.

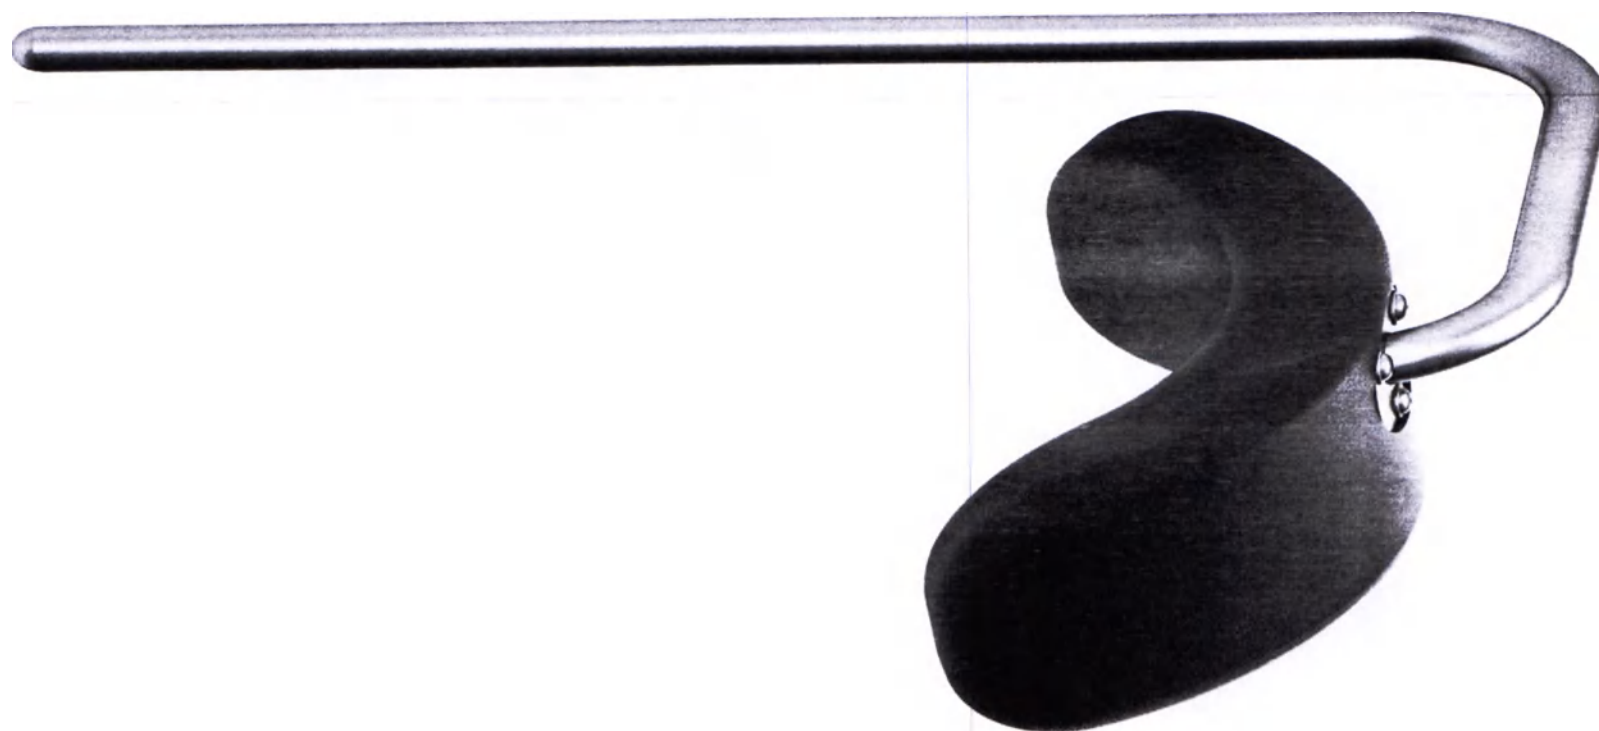


14. Опора колена для операций на мениске.

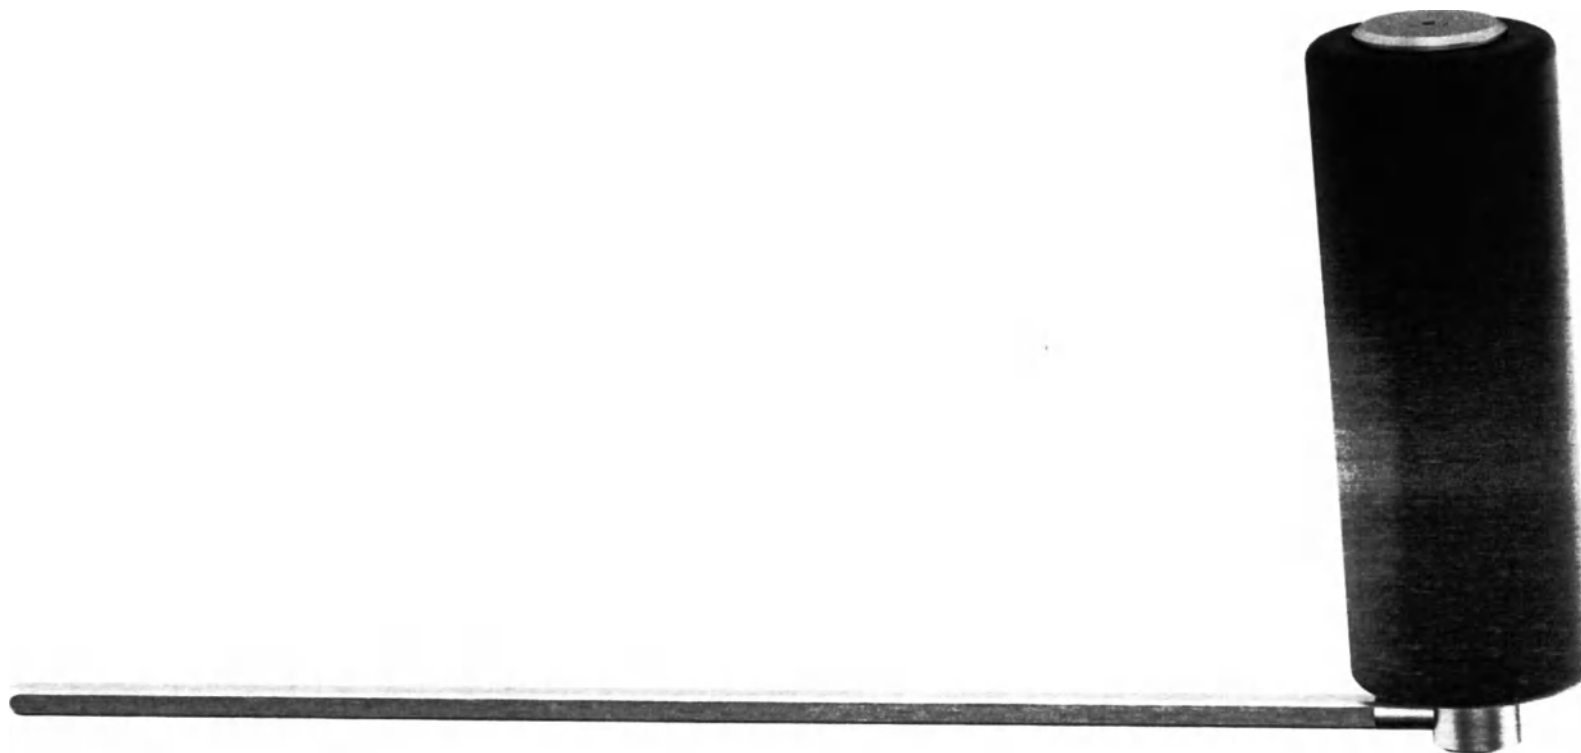


15. Опора для руки с горизонтальным смещением.




16. Упор для плеча/ Упор боковой регулируемый.

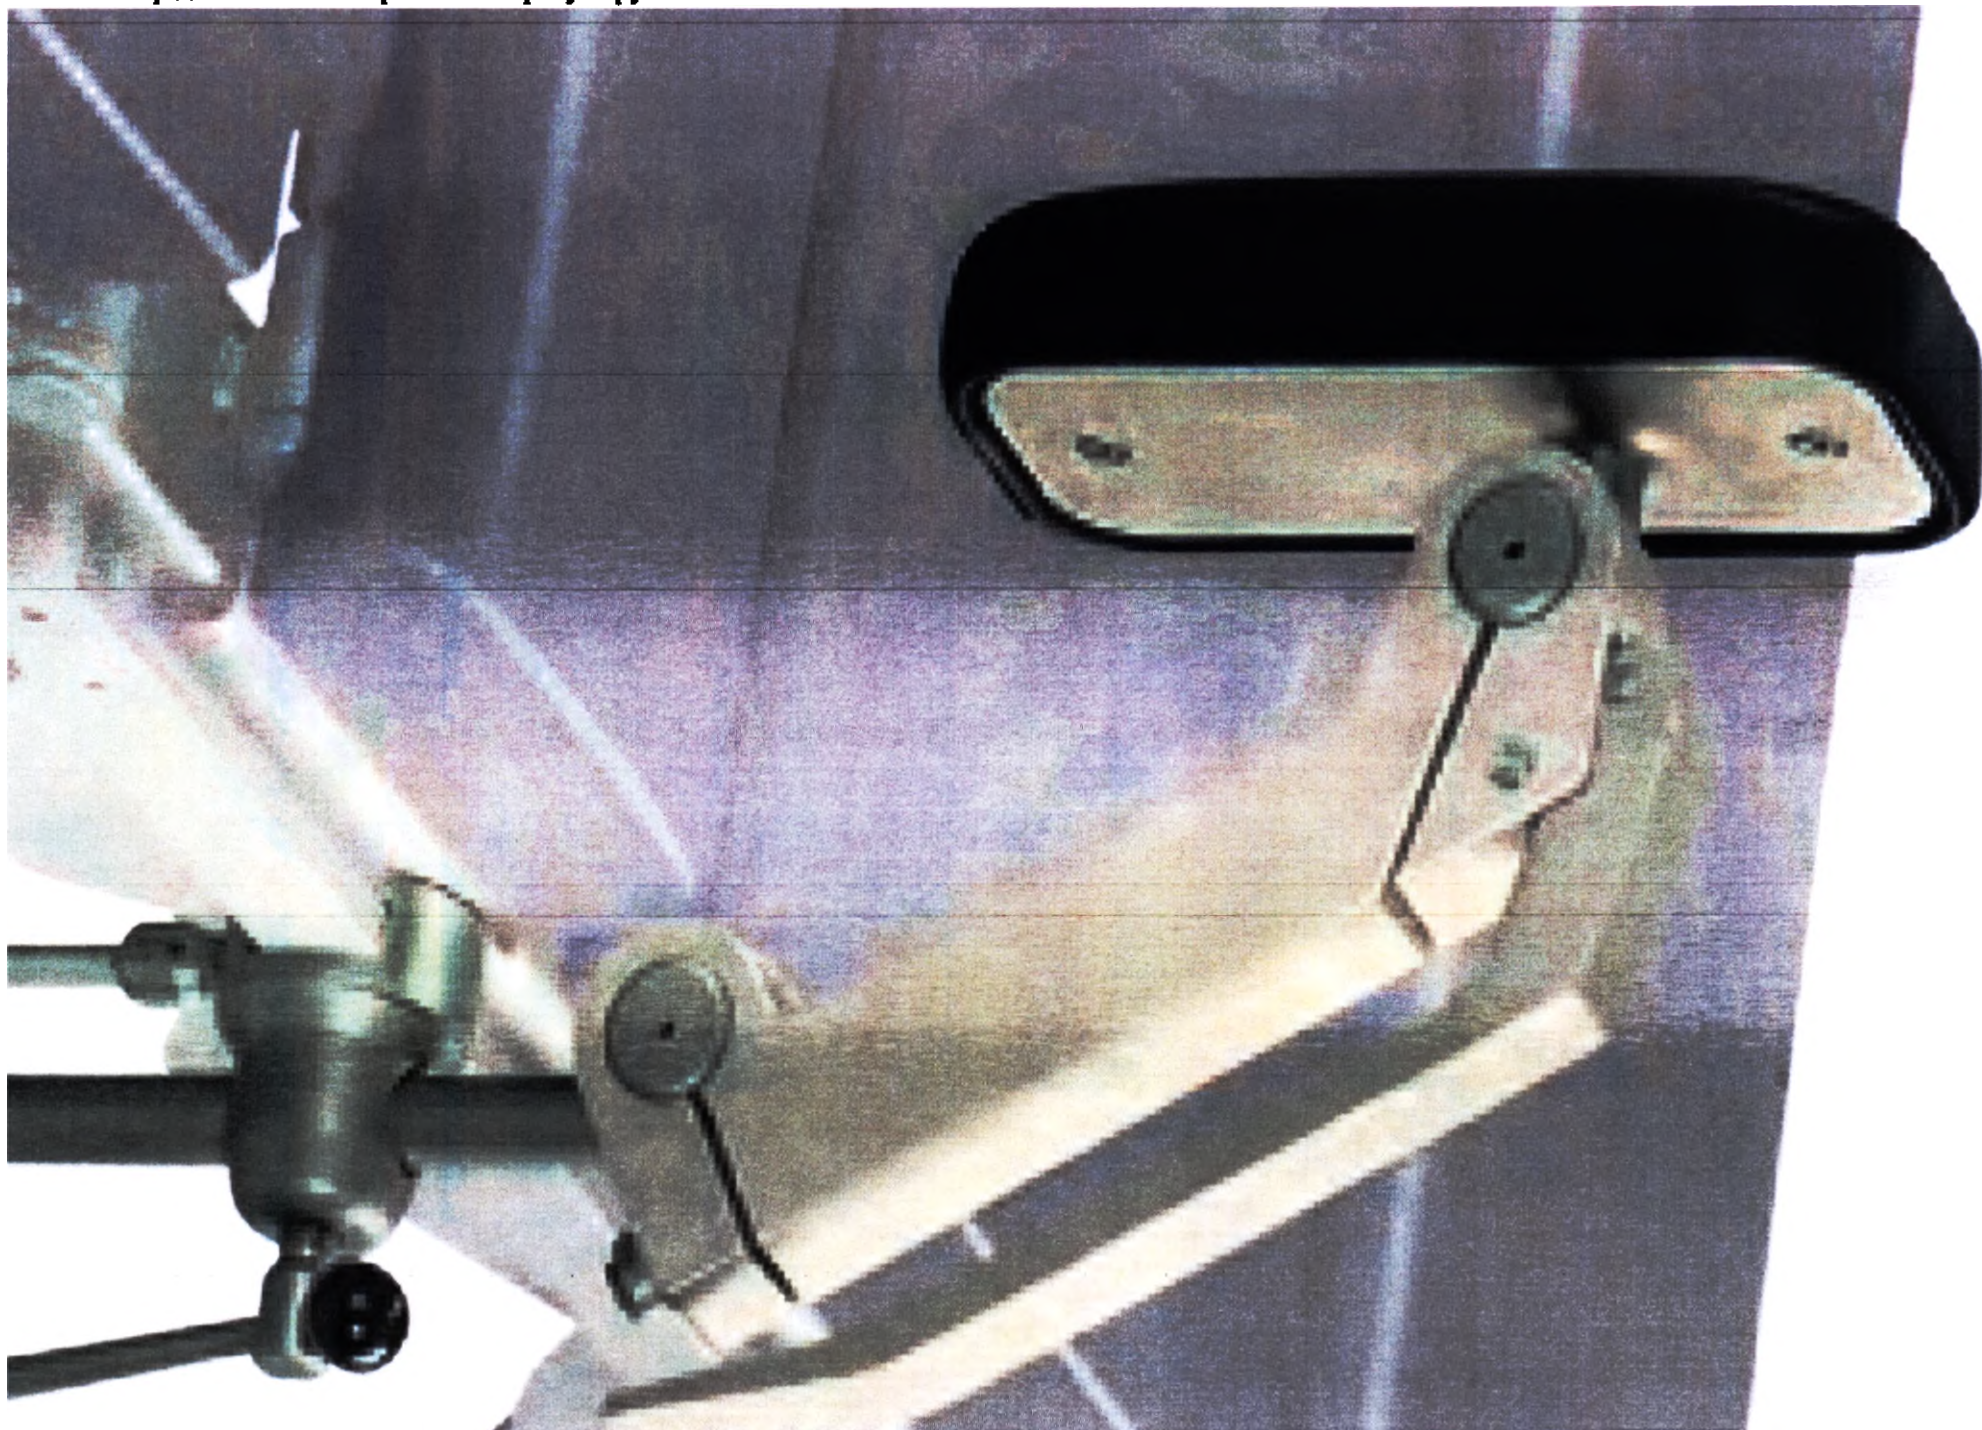

17. Ремень для фиксации голени с пряжкой.

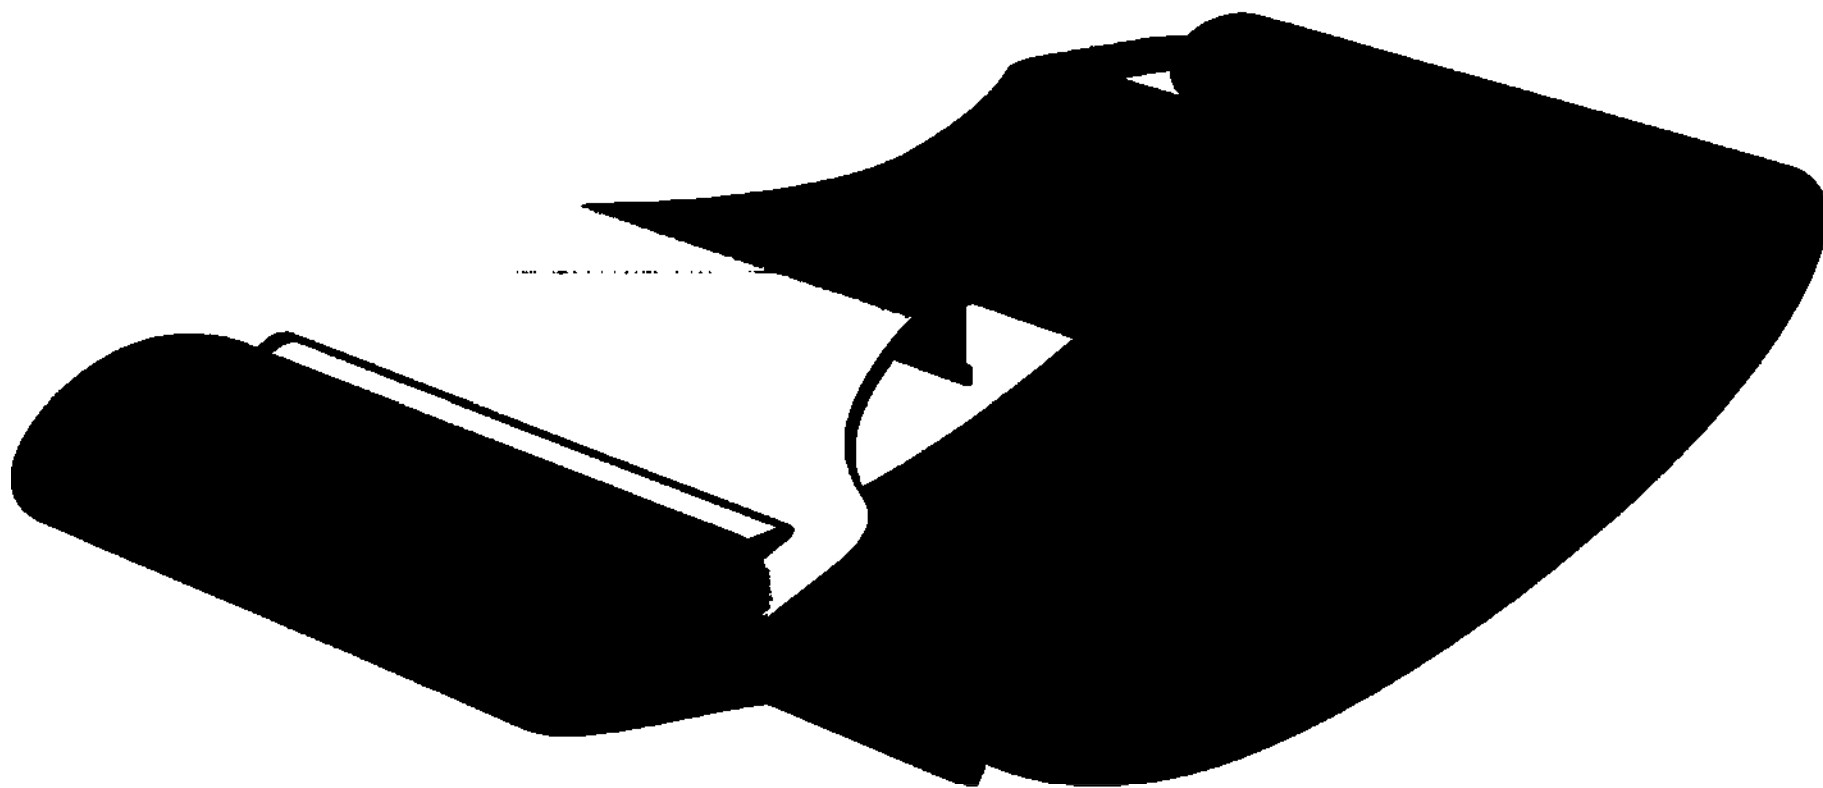


18. Ремень для фиксации бедра с пряжкой.

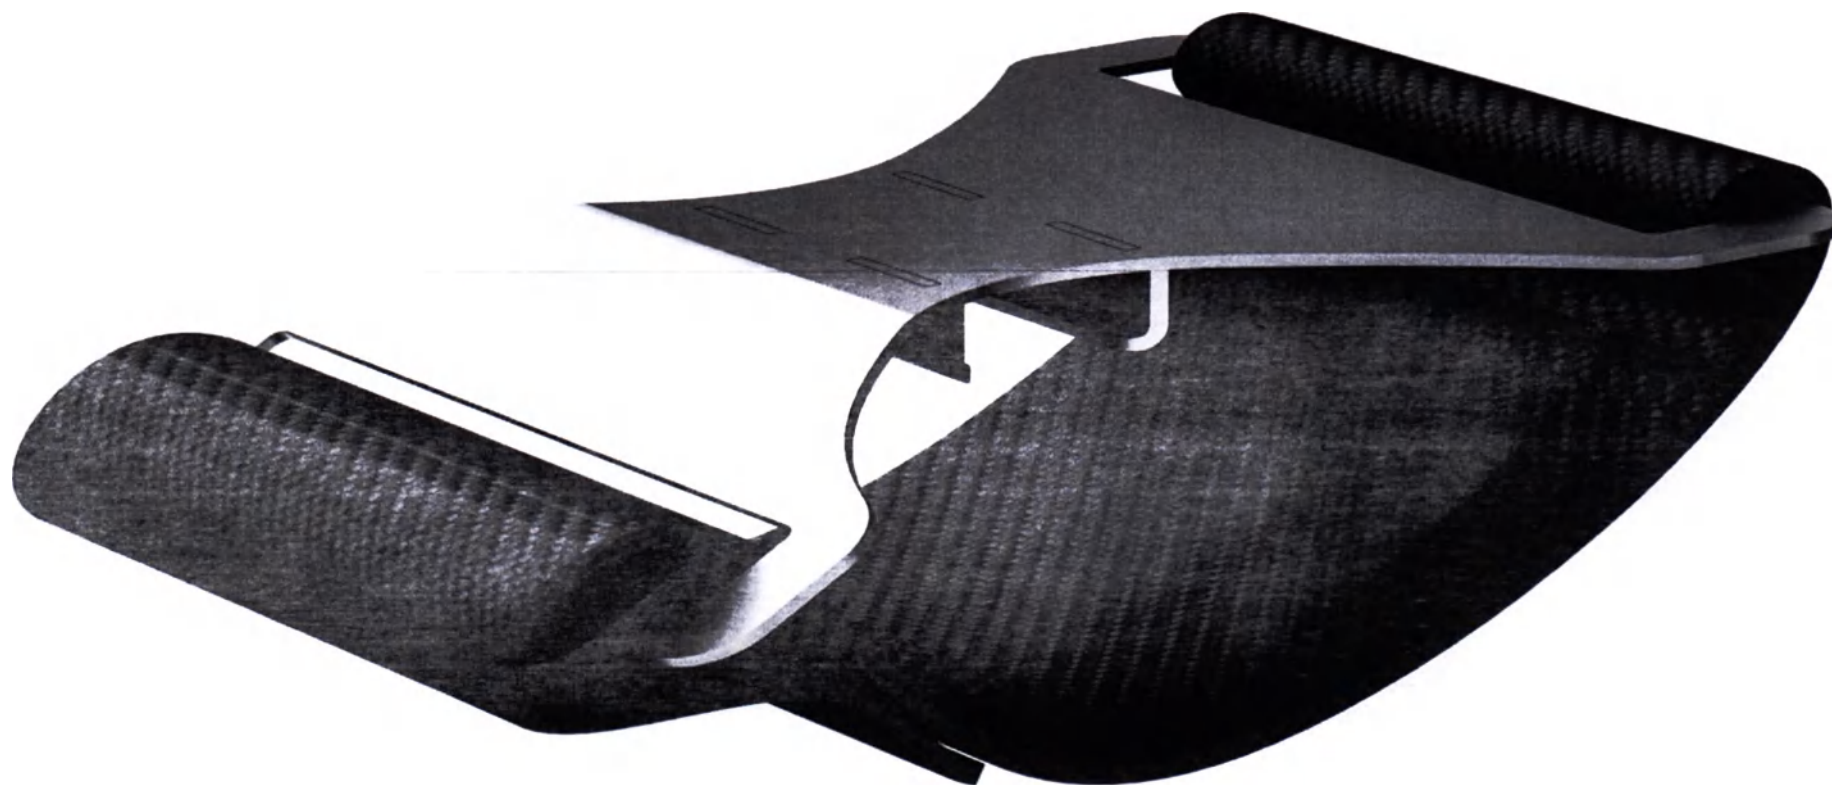


19. Ремень для фиксации туловища с пряжкой.




20. Ремень для фиксации запястья с пряжкой.

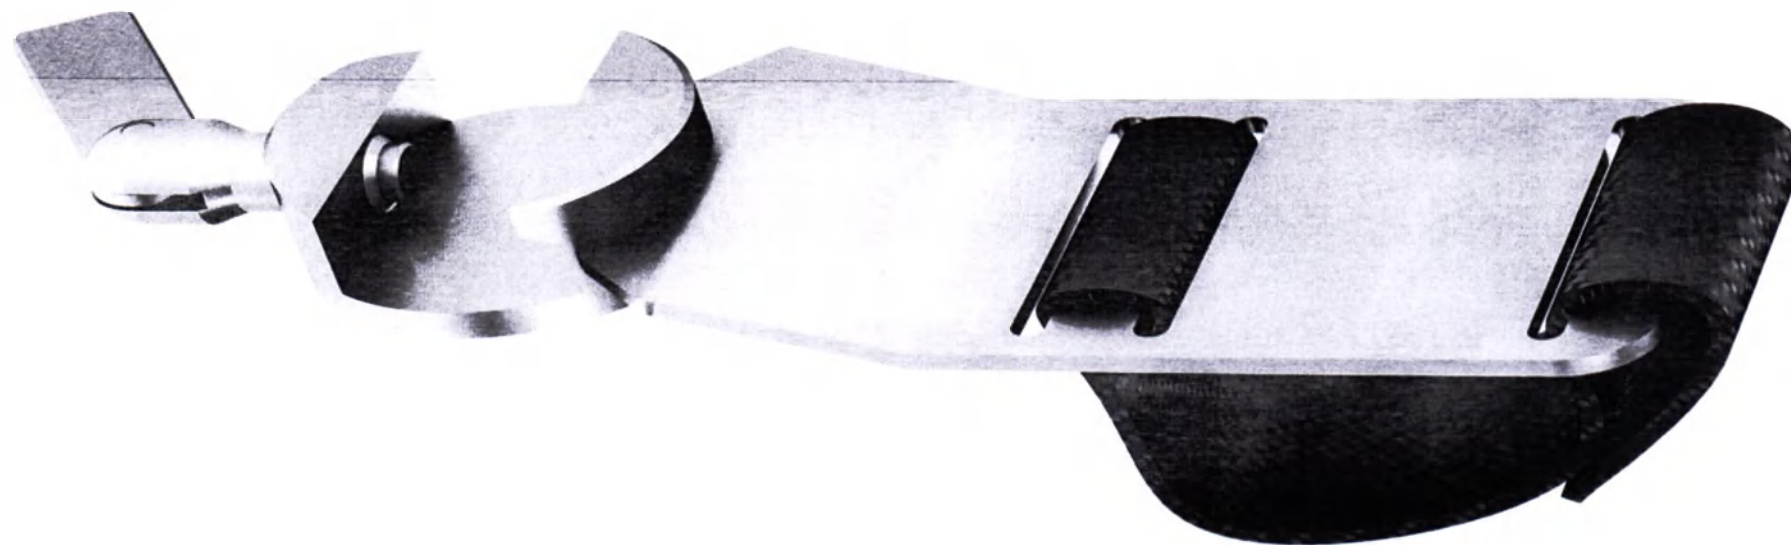

21. Лоток гинекологический.

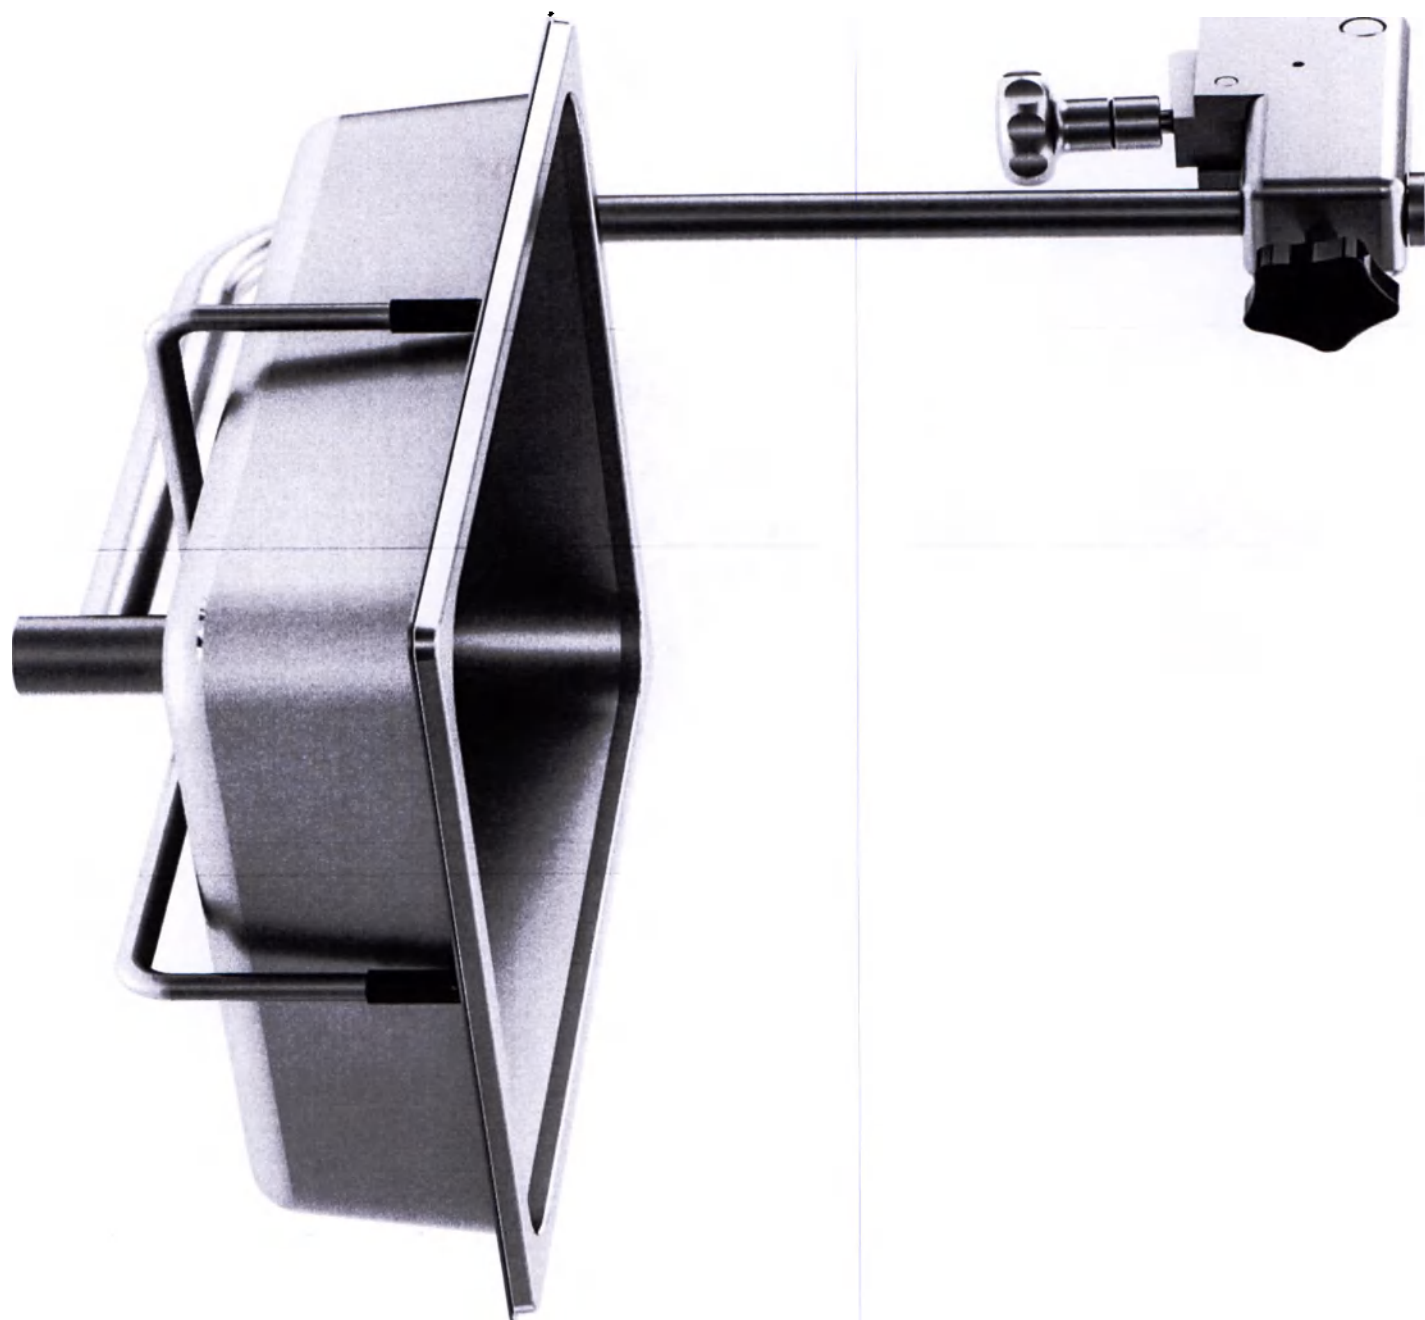

22. Лоток урологический с дренажной системой.

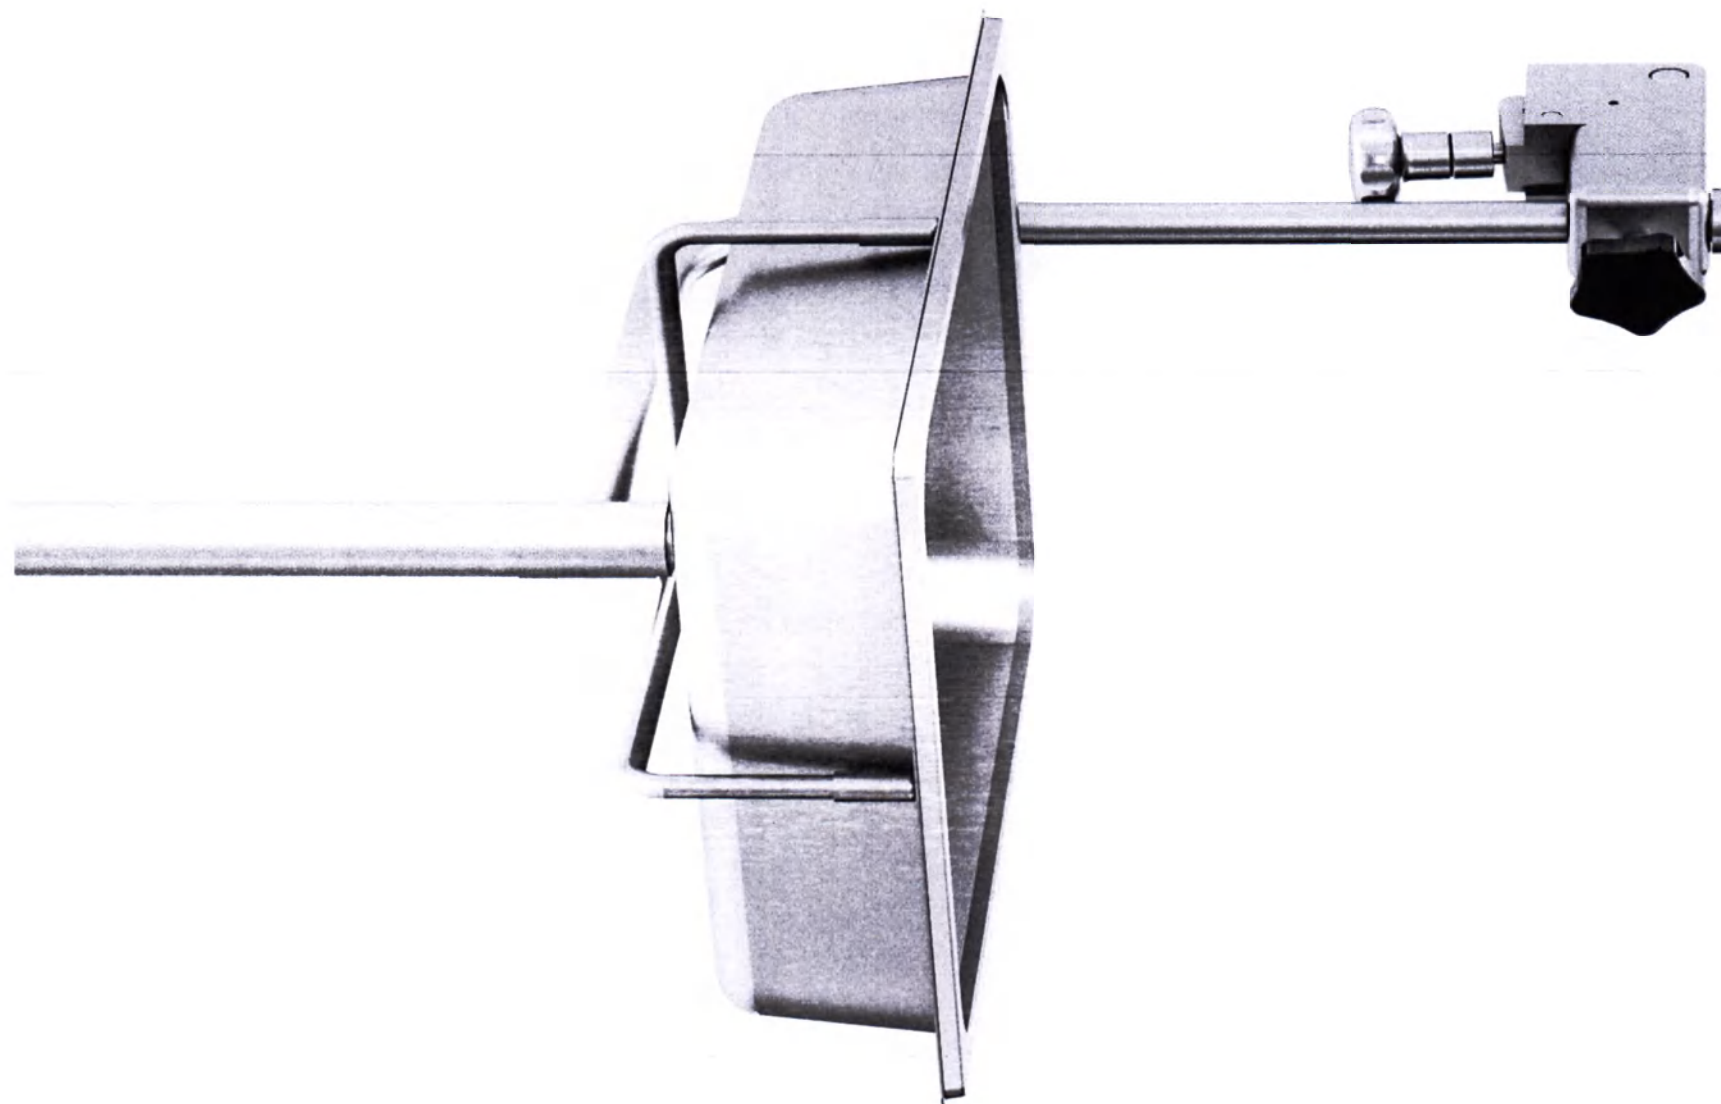


23. Приставка гинекологическая.




24. Приставка урологическая.




25. Тележка для аксессуаров на роликах.

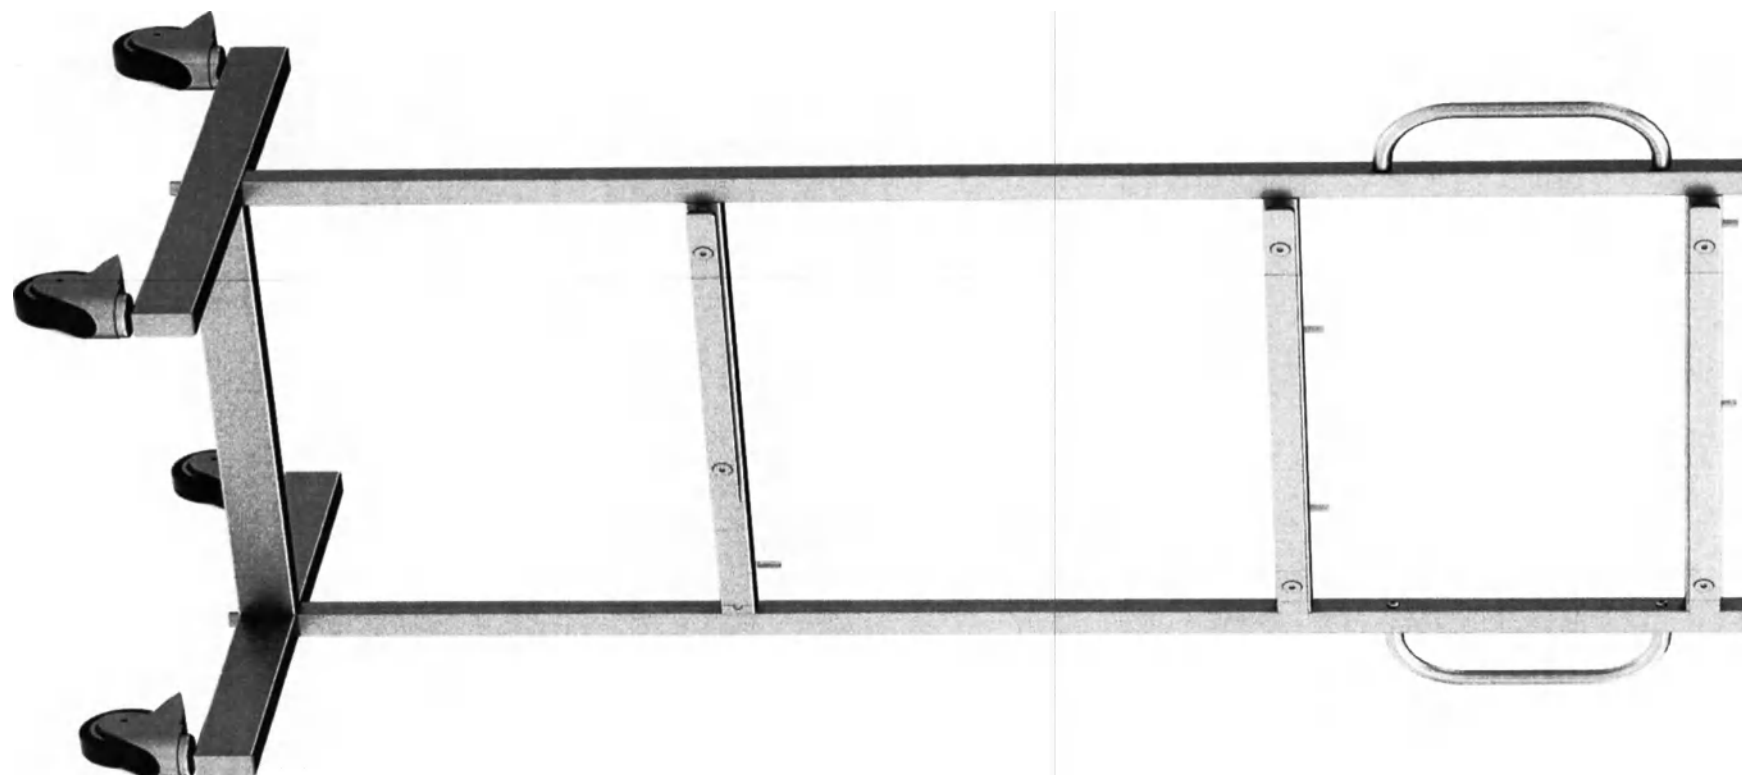


26. Приставка для операций на руке.

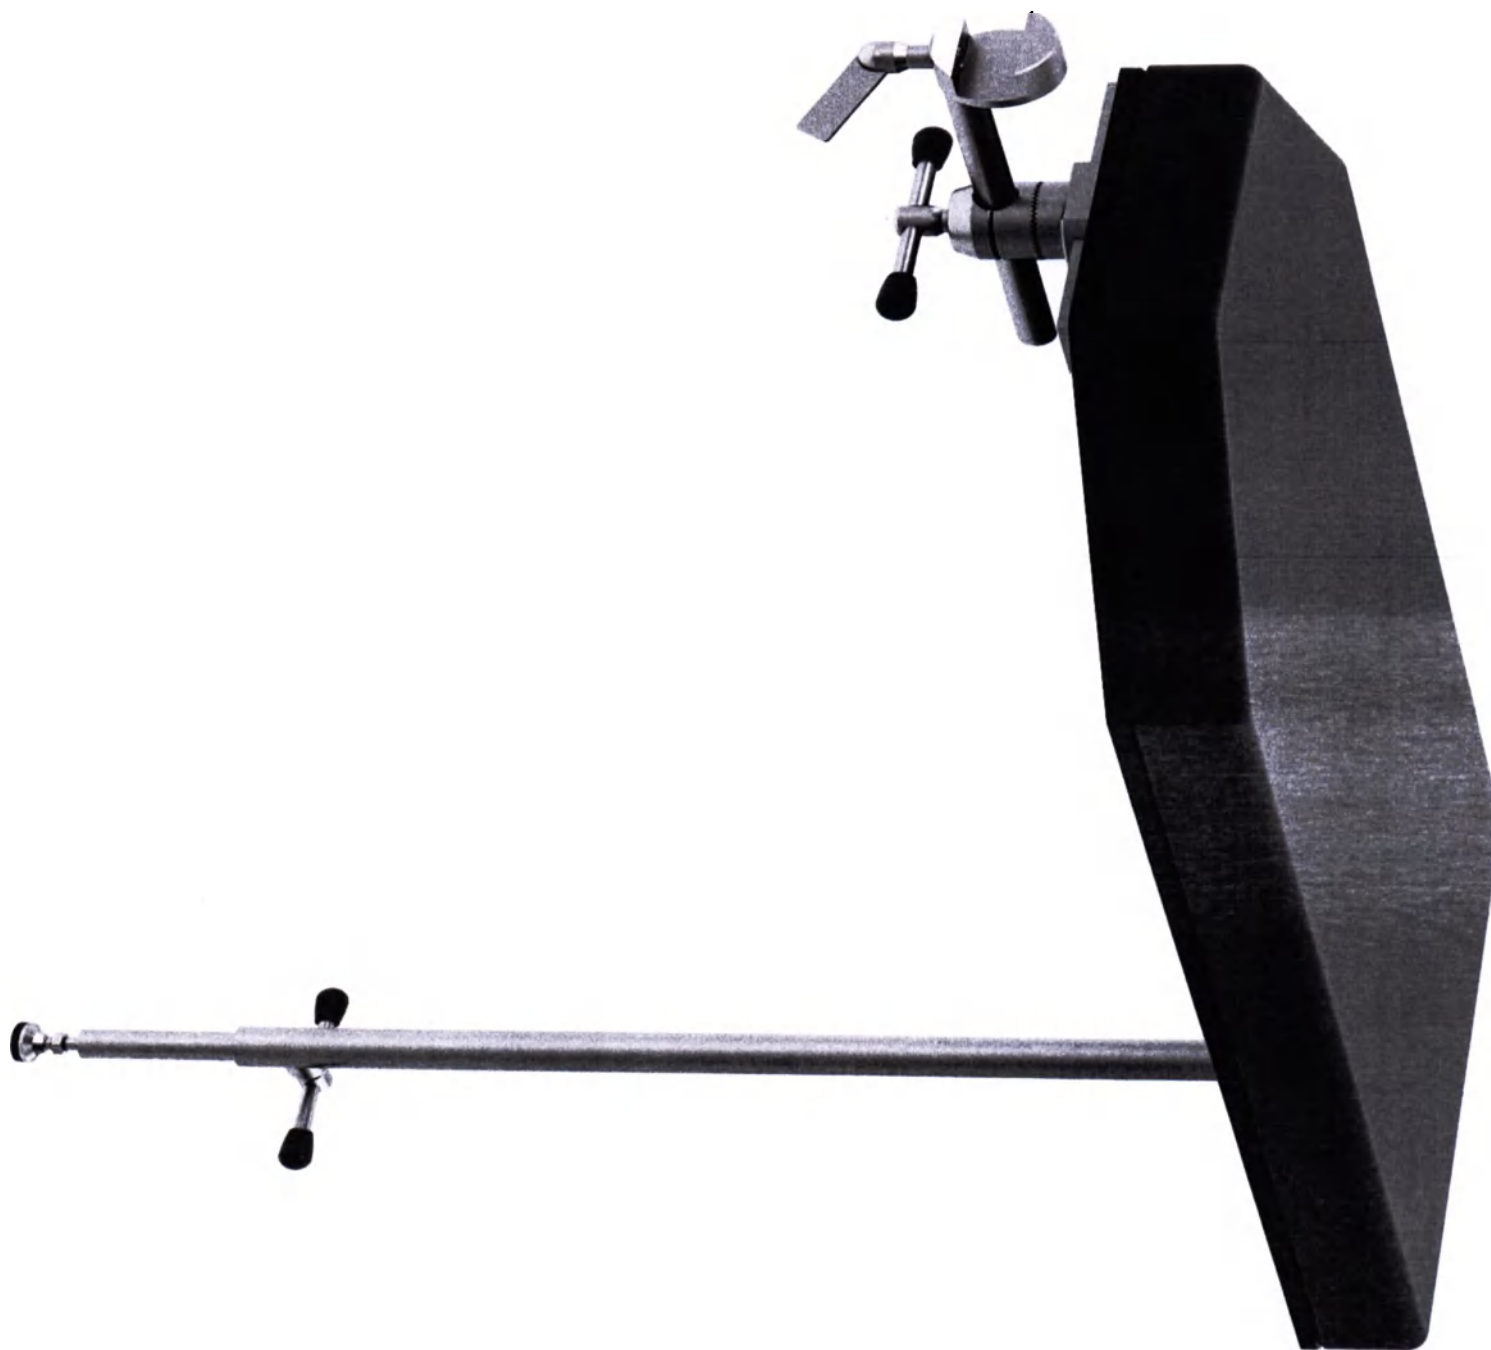


27. Держатель анестезиологических трубок и шлангов.

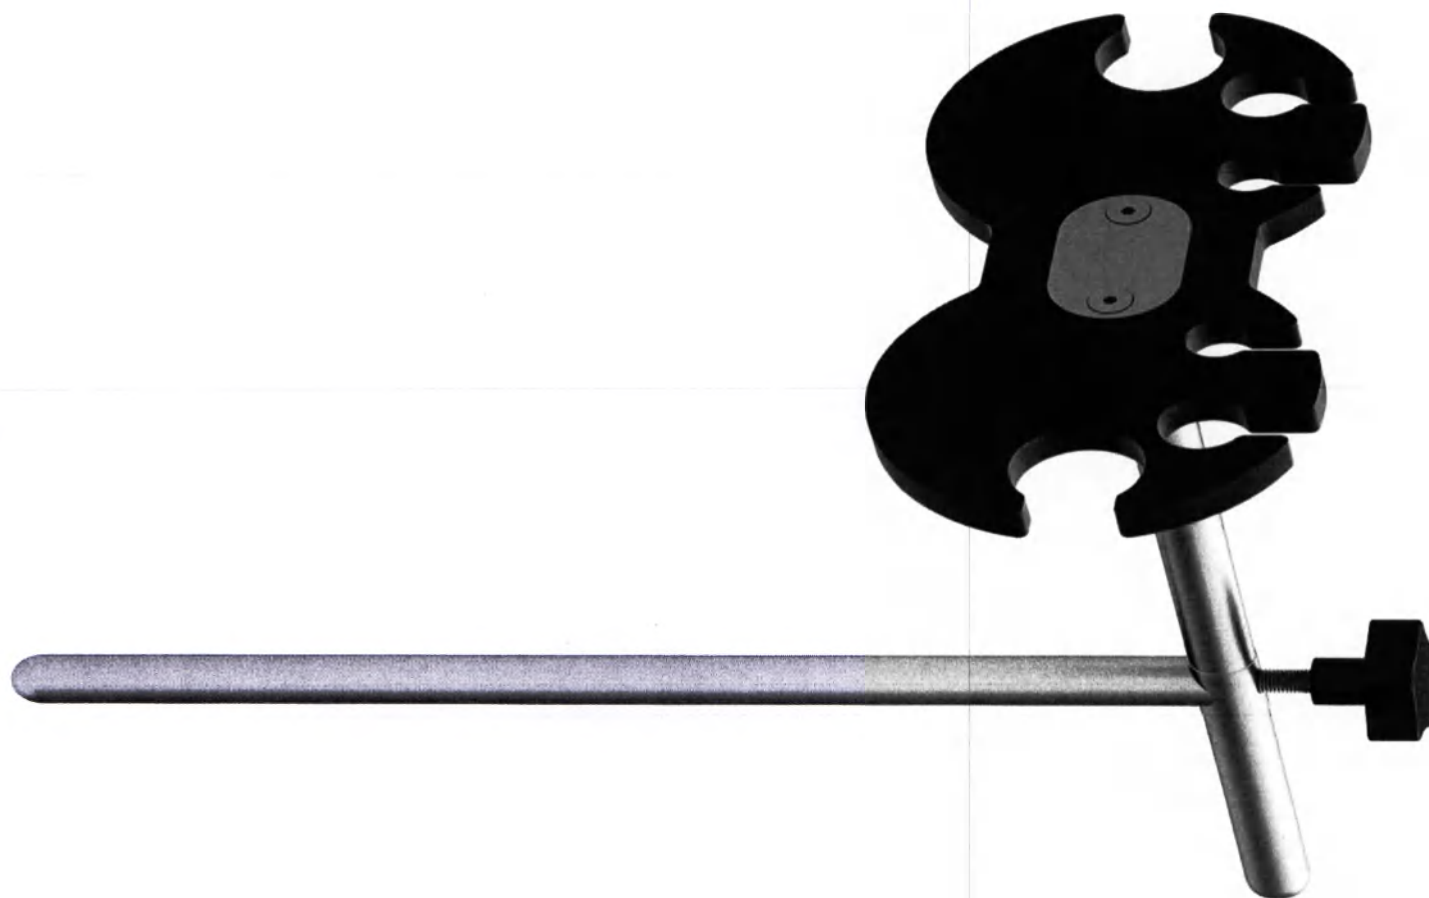


28. Лоток для инструментария.

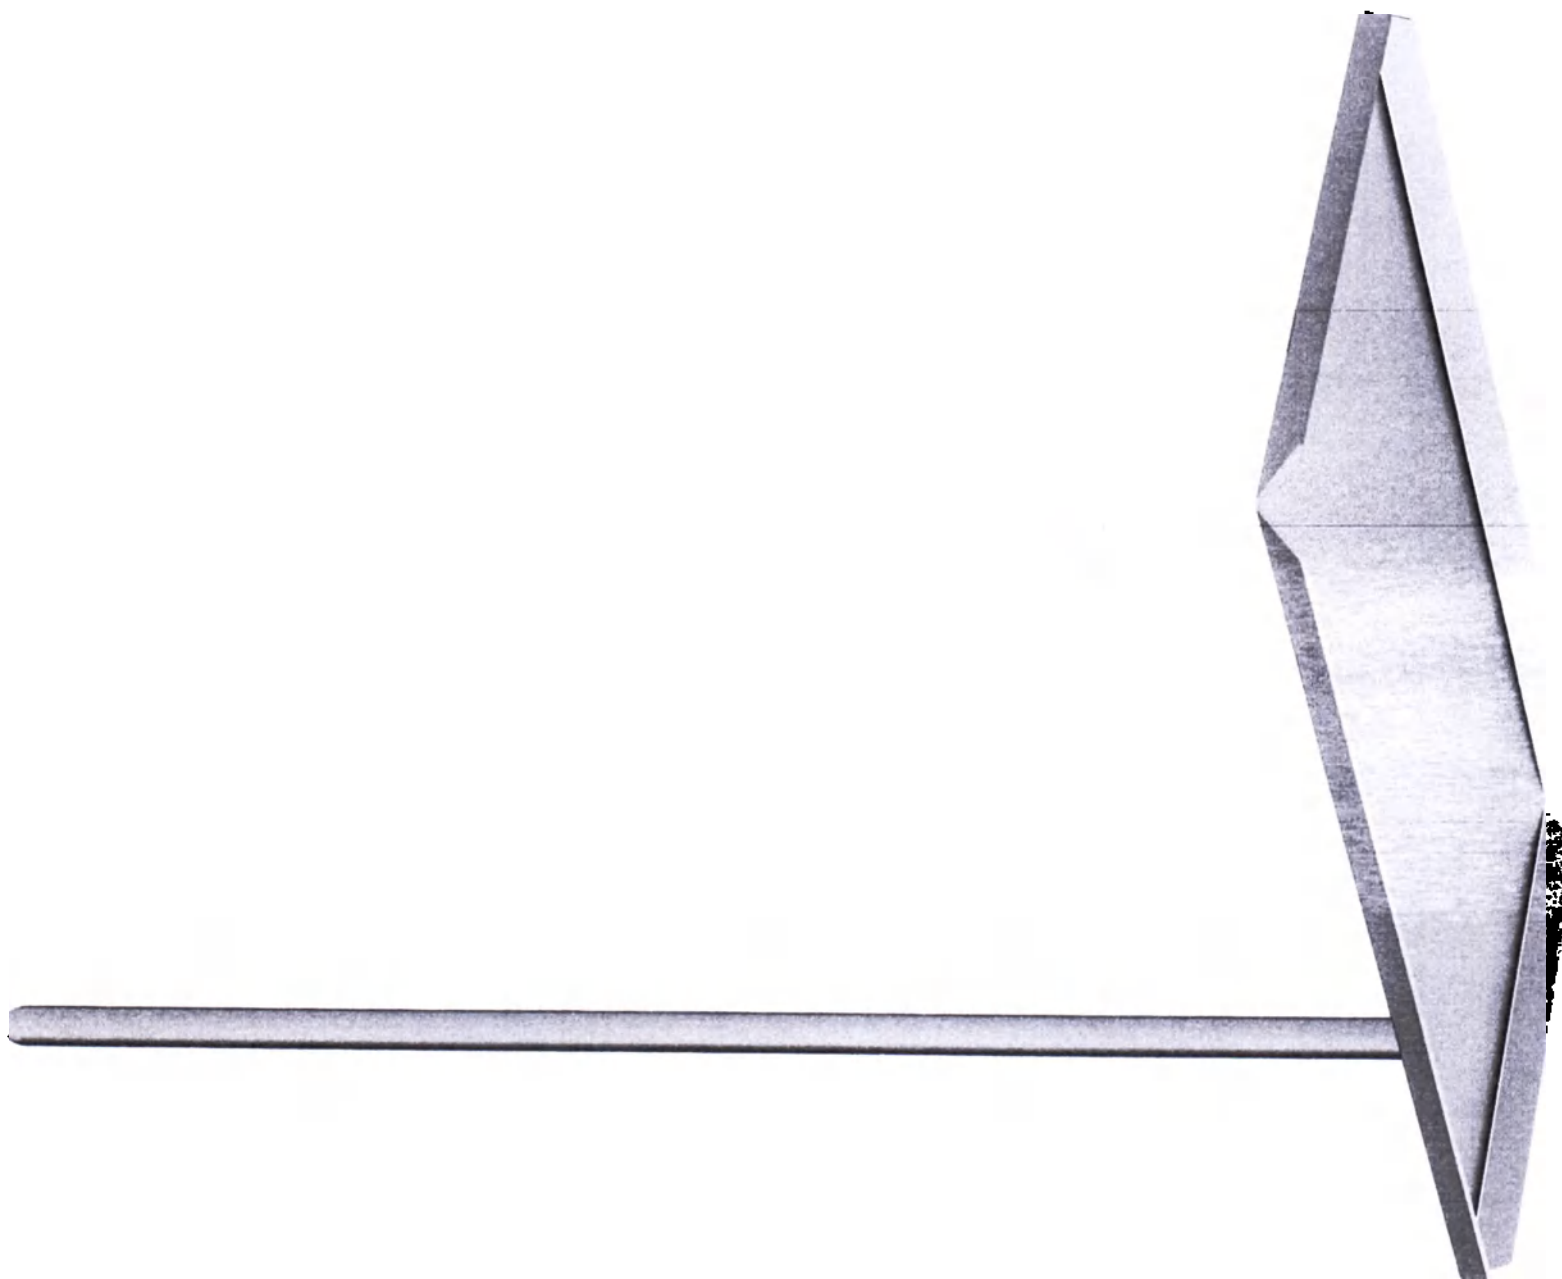


29. Держатель рентген кассеты.

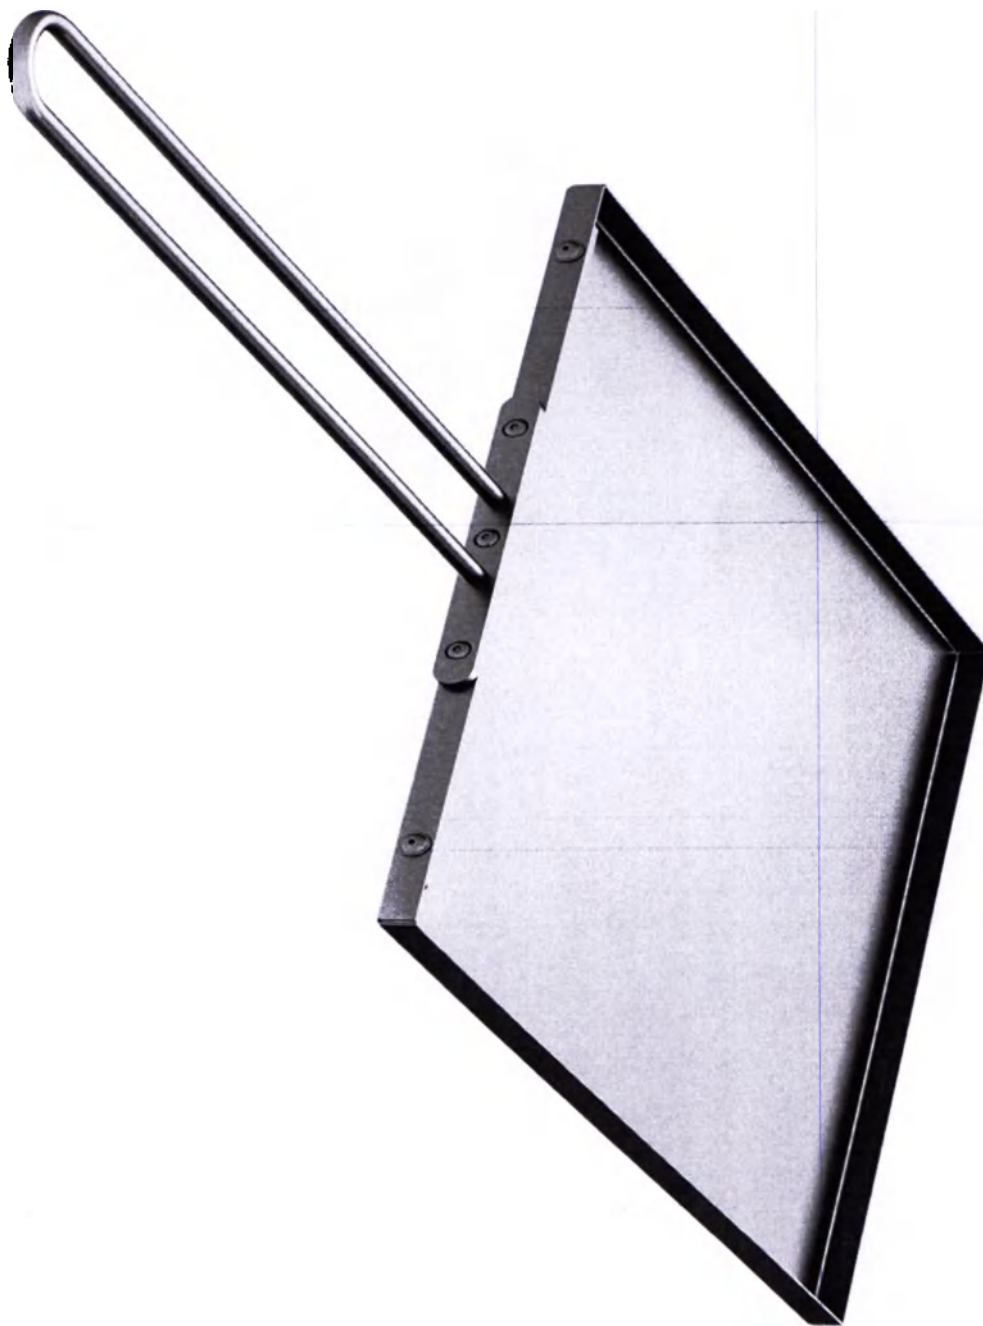

30. Опора грудной клетки.

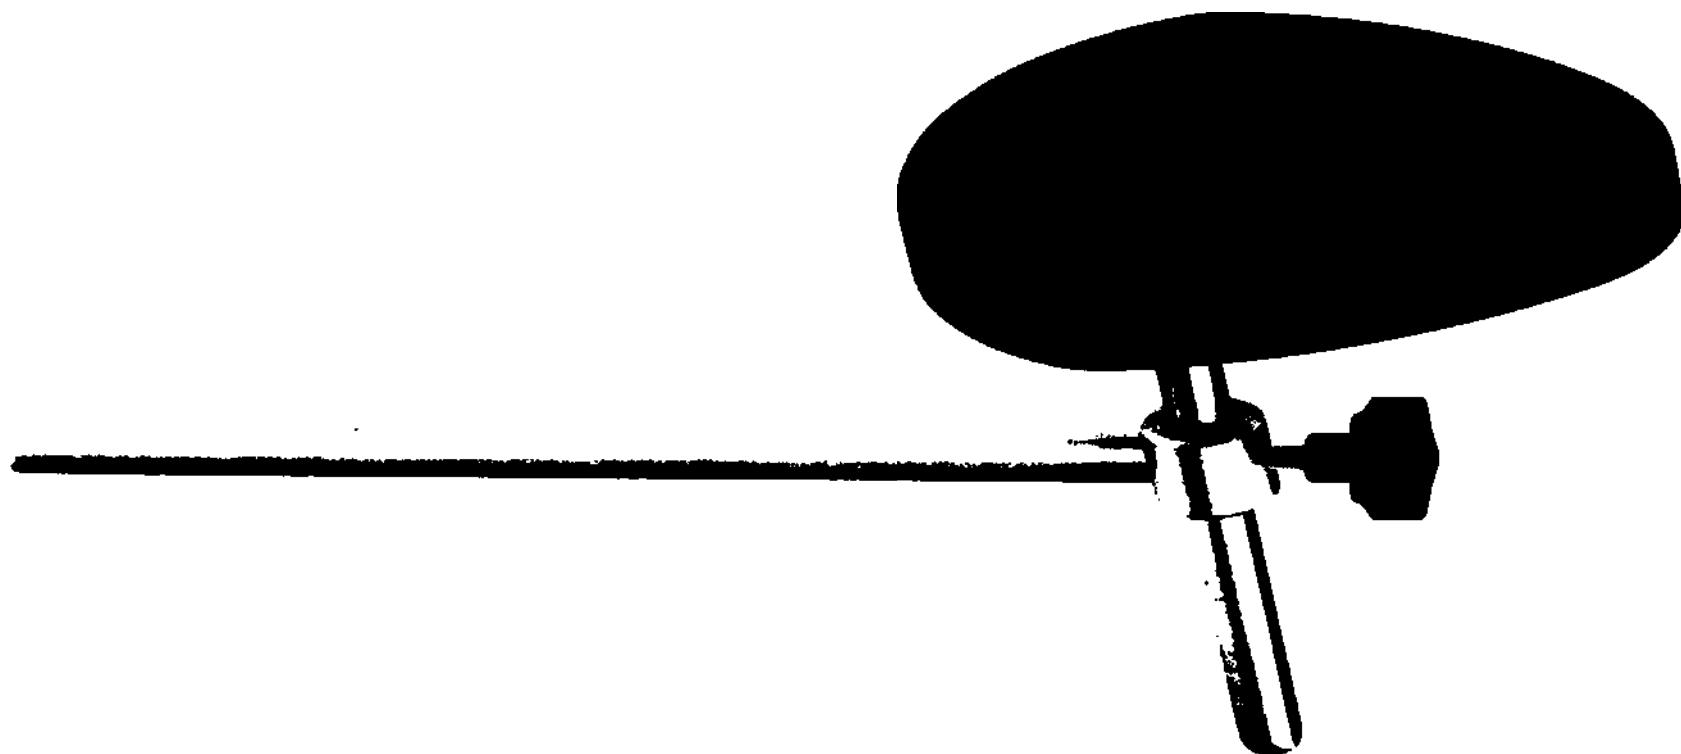

31. Приставка для операции колена.

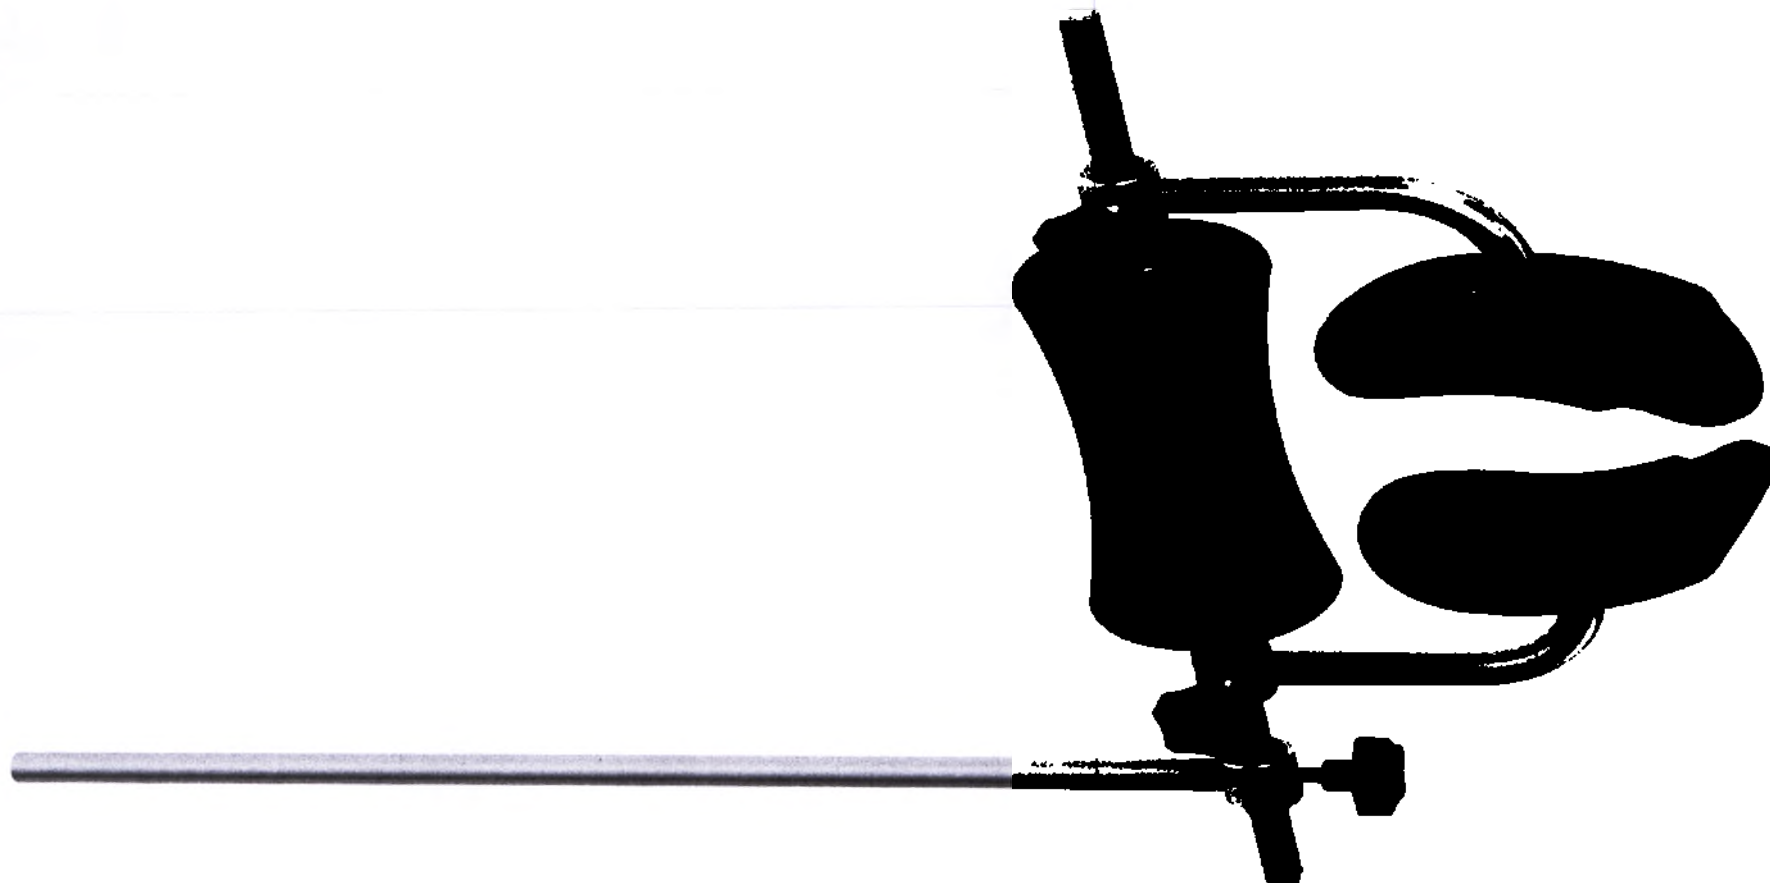





33. Опора для ног (1-секционная).



34. Приставка проктологическая.

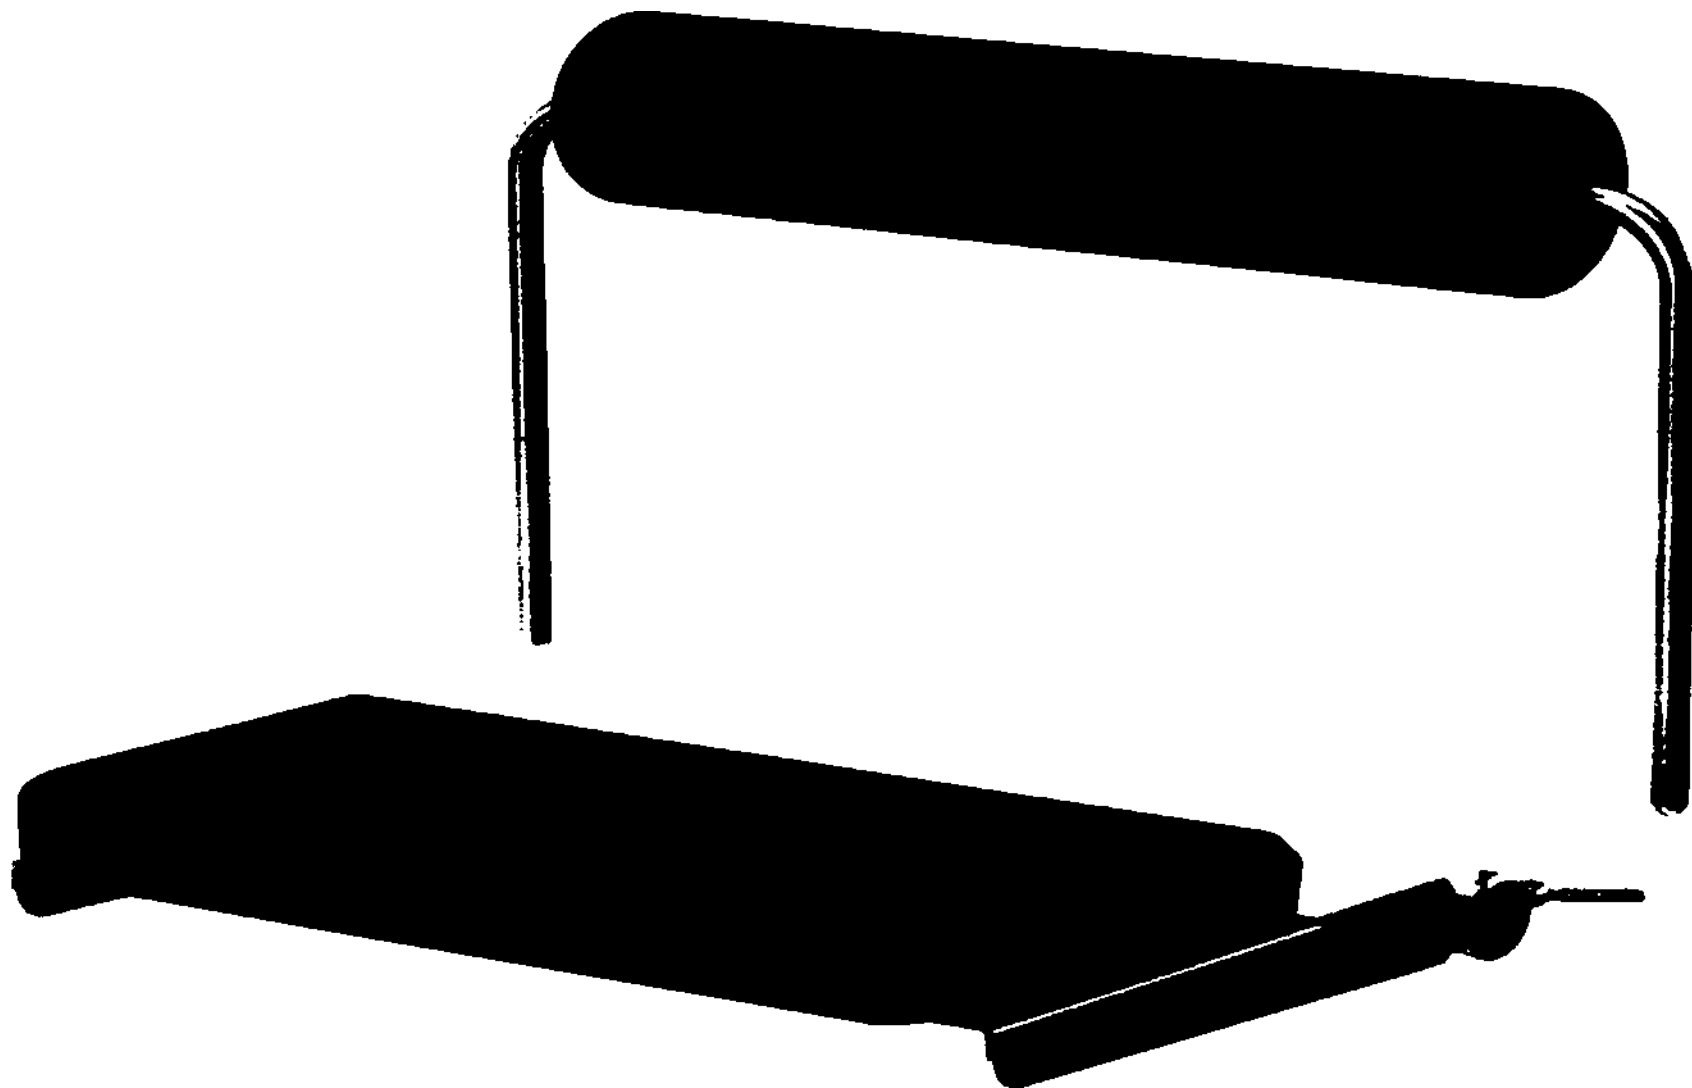

35. Рельс боковой.

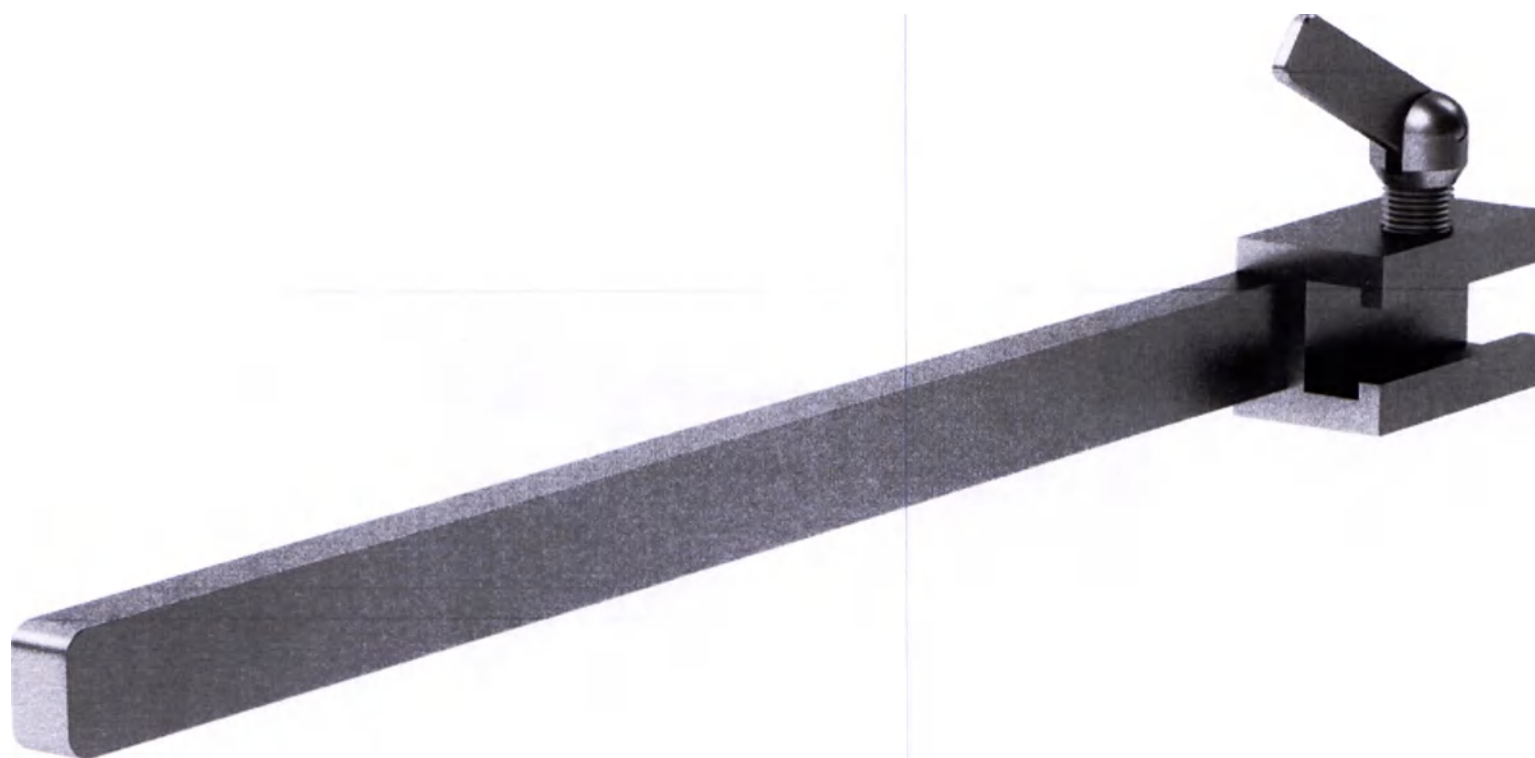


36. Секция удлинения ложа.



37. Ремень для стабилизации руки на стойке анестезиолога.




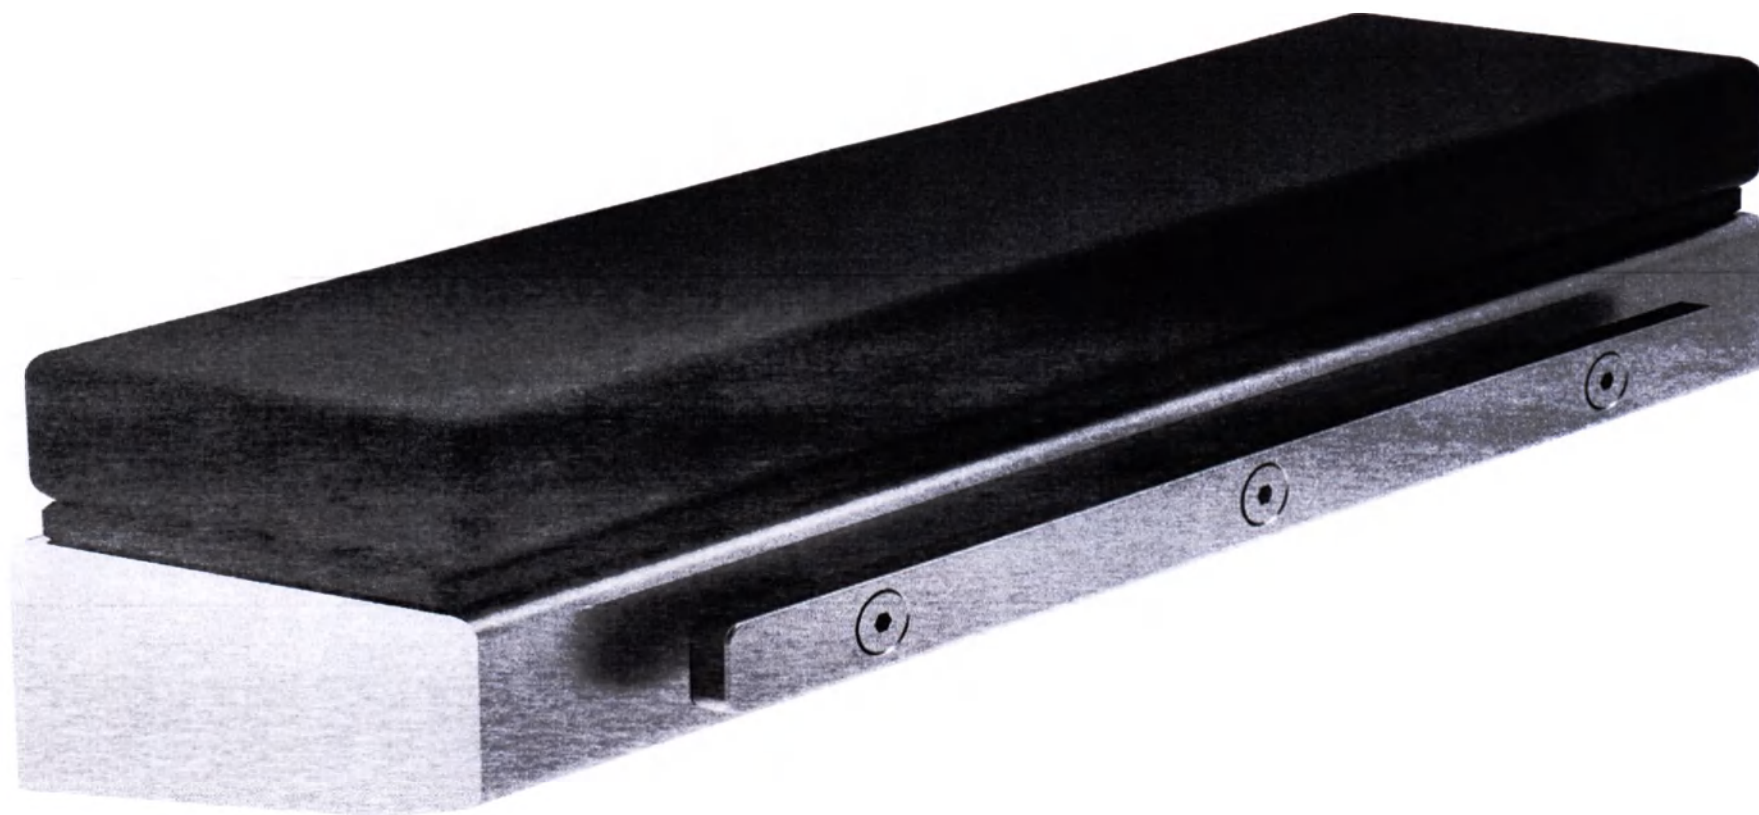

39. Опора для ноги (2-х секционная).



40. Секция рентгенпрозрачная ножная.

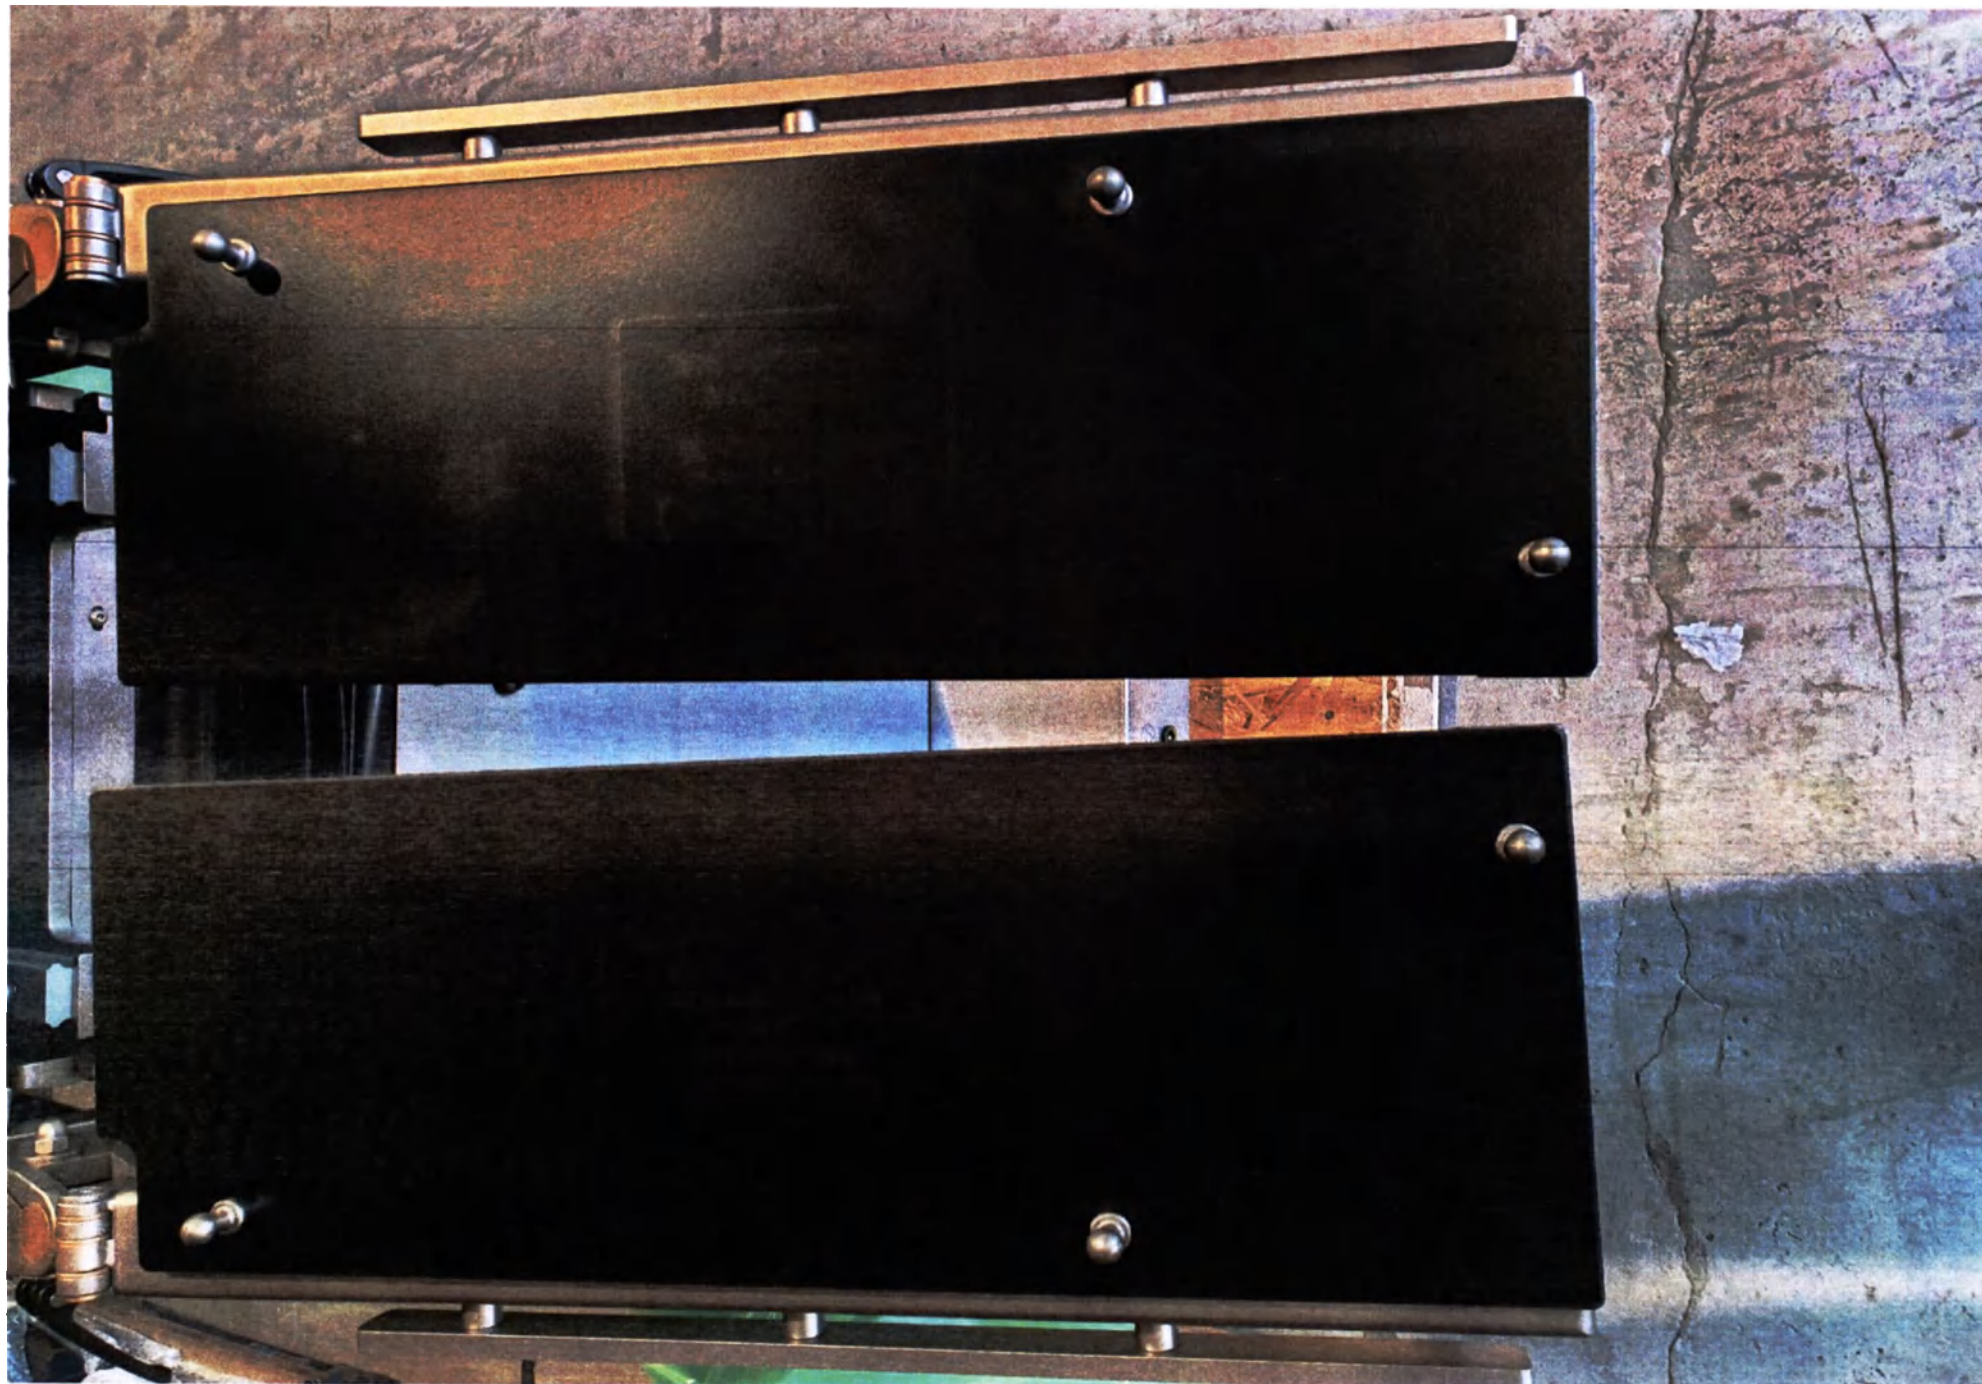


41. Приставка ортопедическая.




42. Подпорка - стержень.




43. Подпорка ноги.

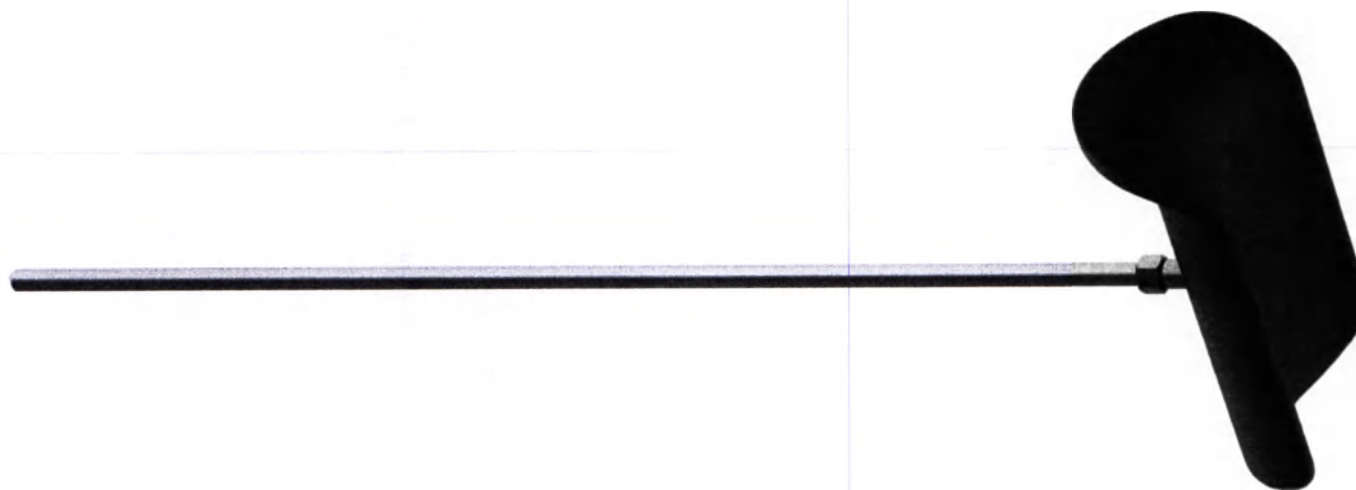

44. Подпорка для гипсования.

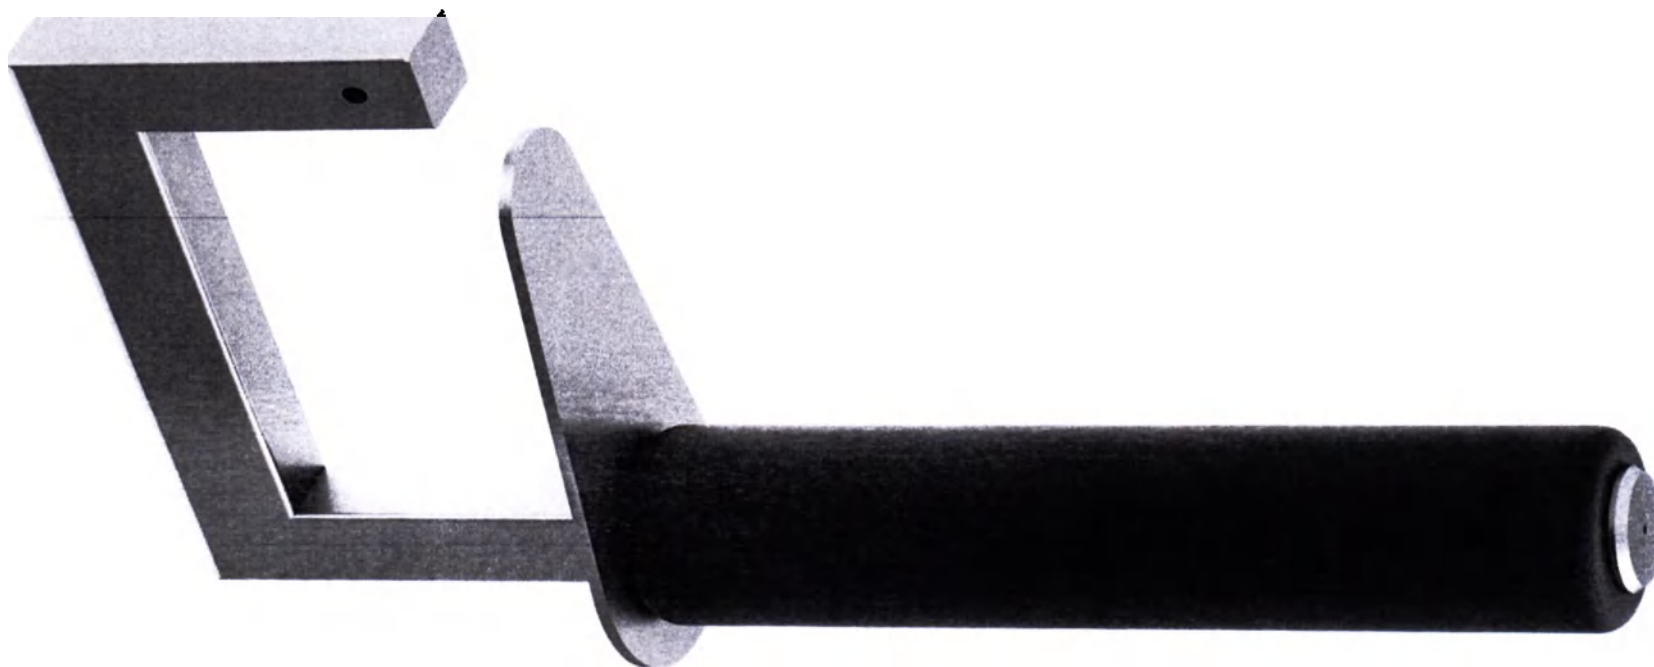


45. Зажим держателя стопы.

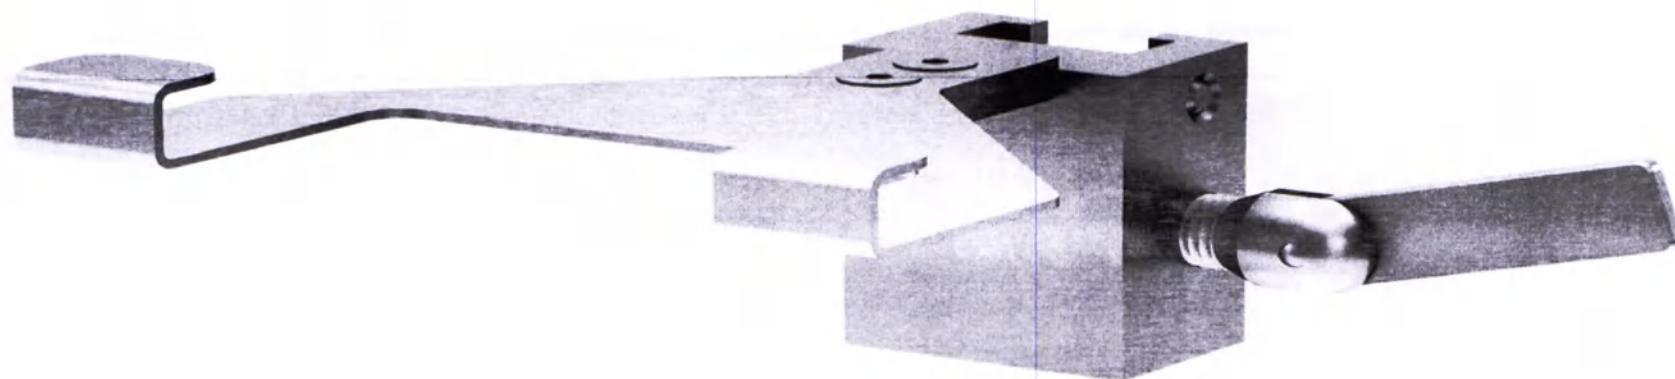





47. Зажим для ортопедической приставки.

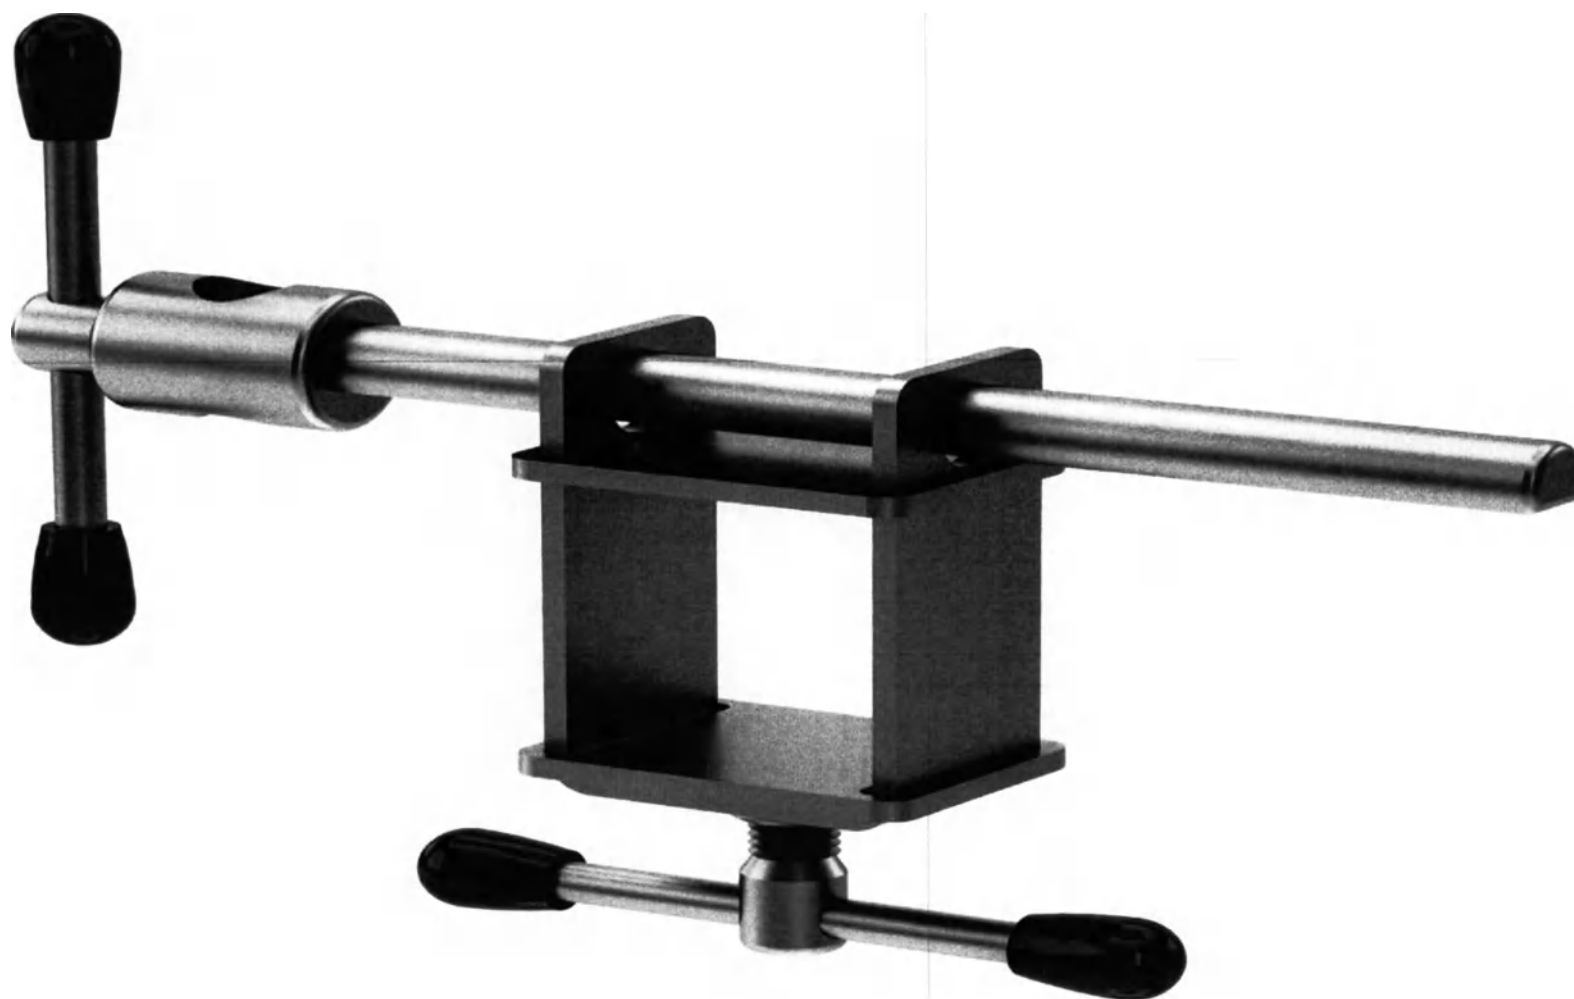

48. Приставка для операции на колене для ортопедической приставки.

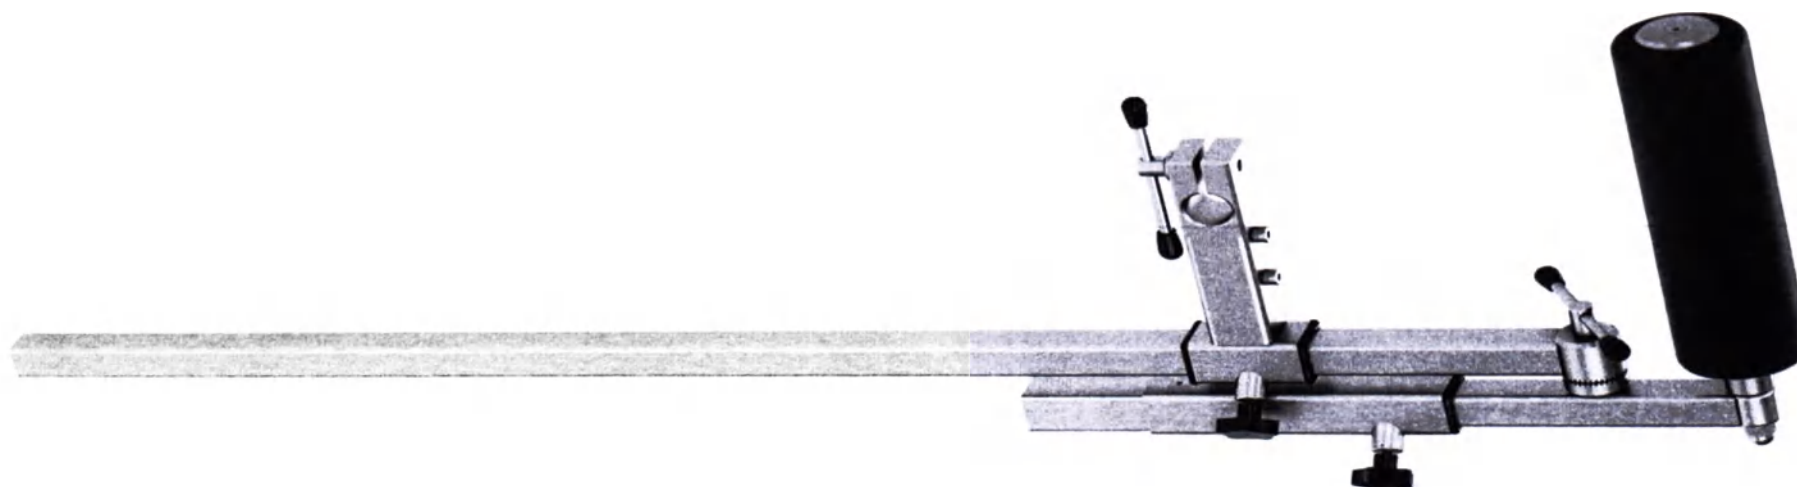

49. Держатель бедра для боковой позиции.

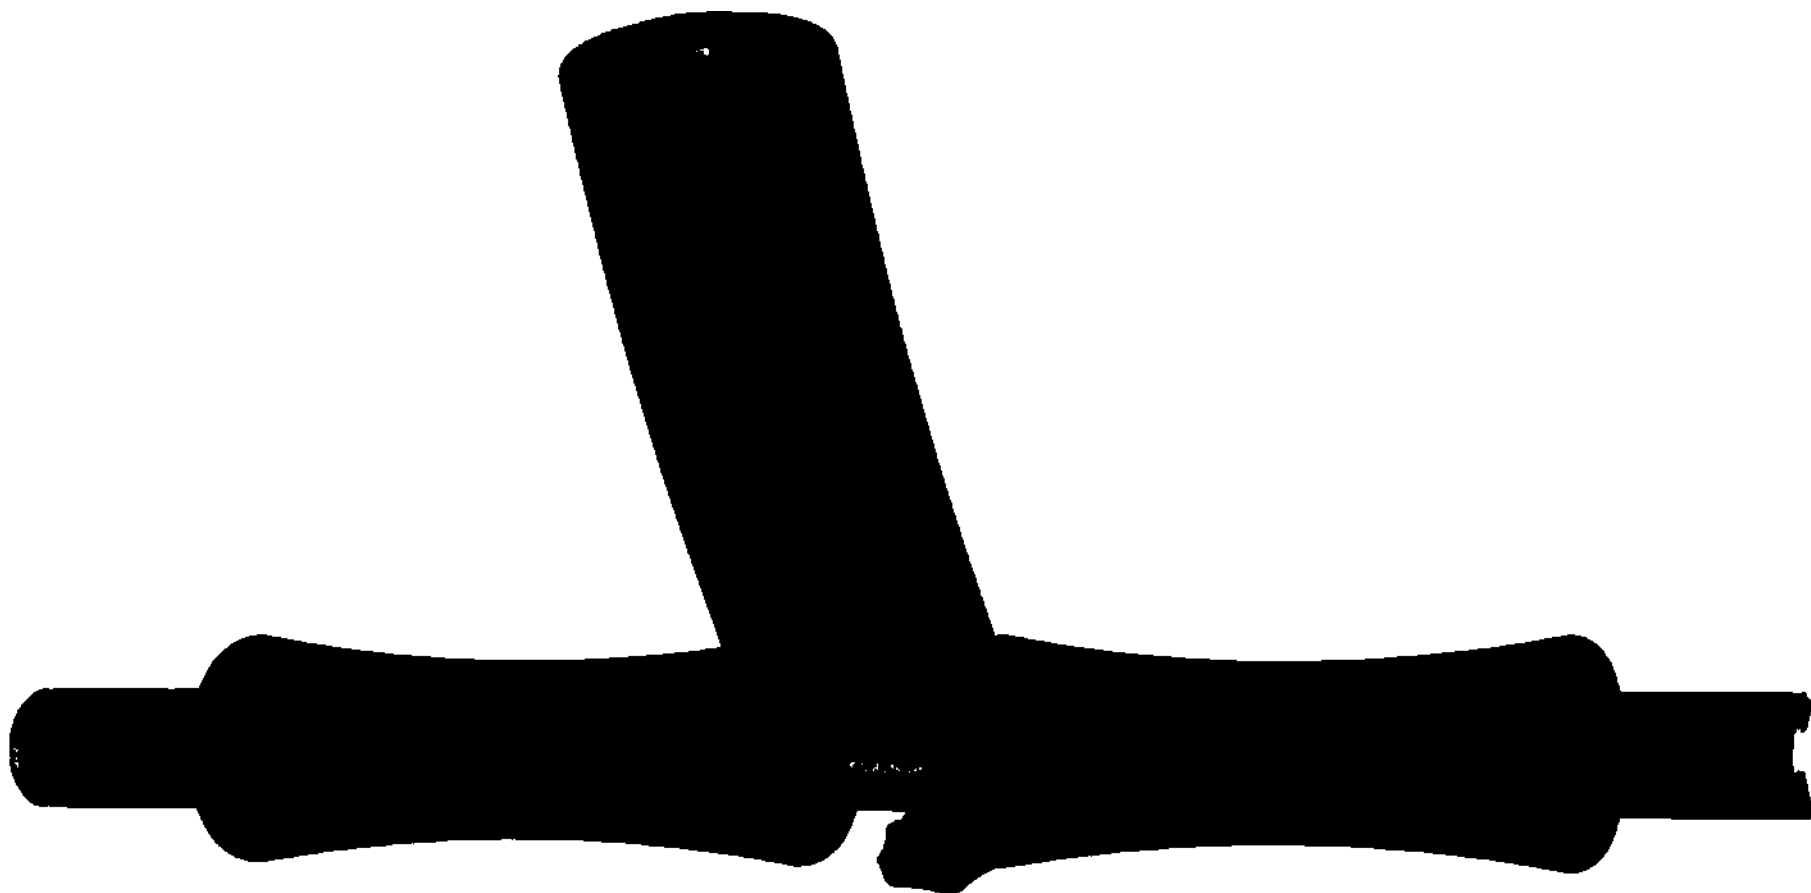


50. Опора напольная для плеч ортопедической приставки (пара).






52. Тележка для ортопедической приставки в собранном виде.

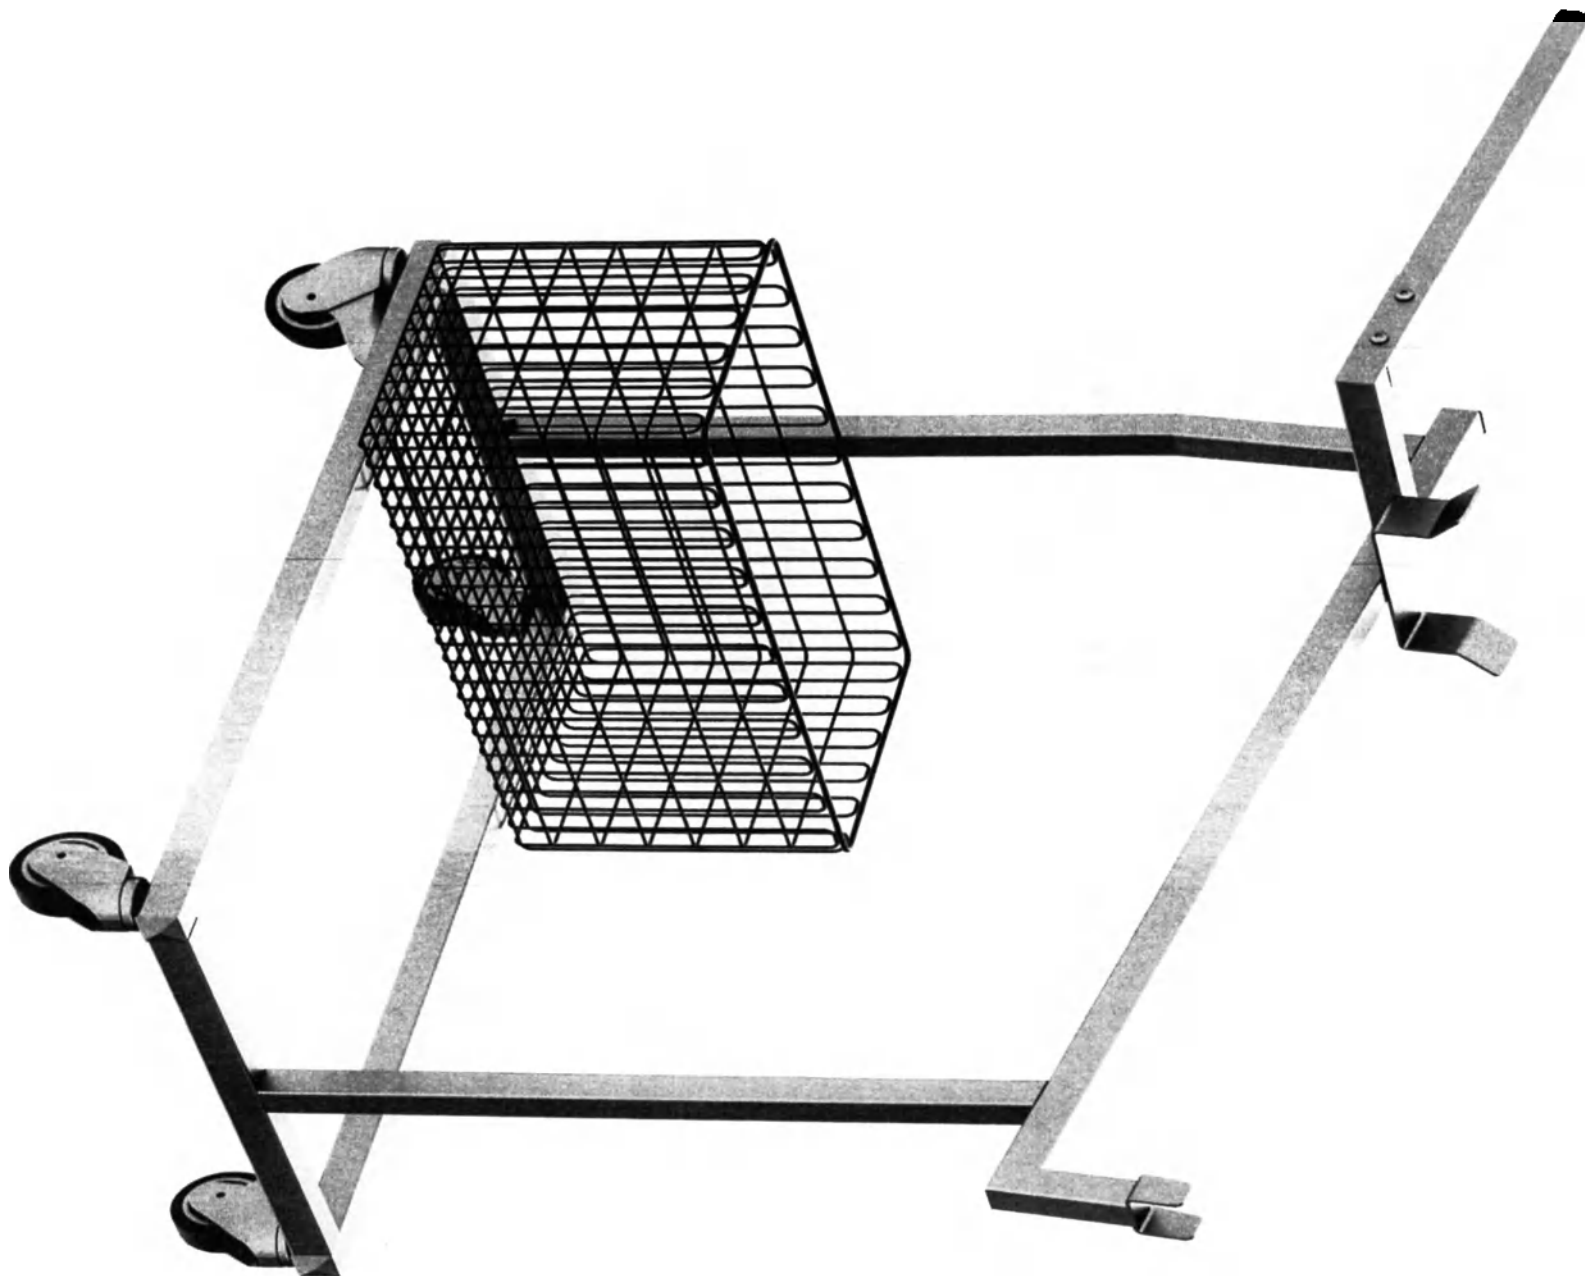


53. Тележка для аксессуаров ортопедической приставки в разобранном виде.

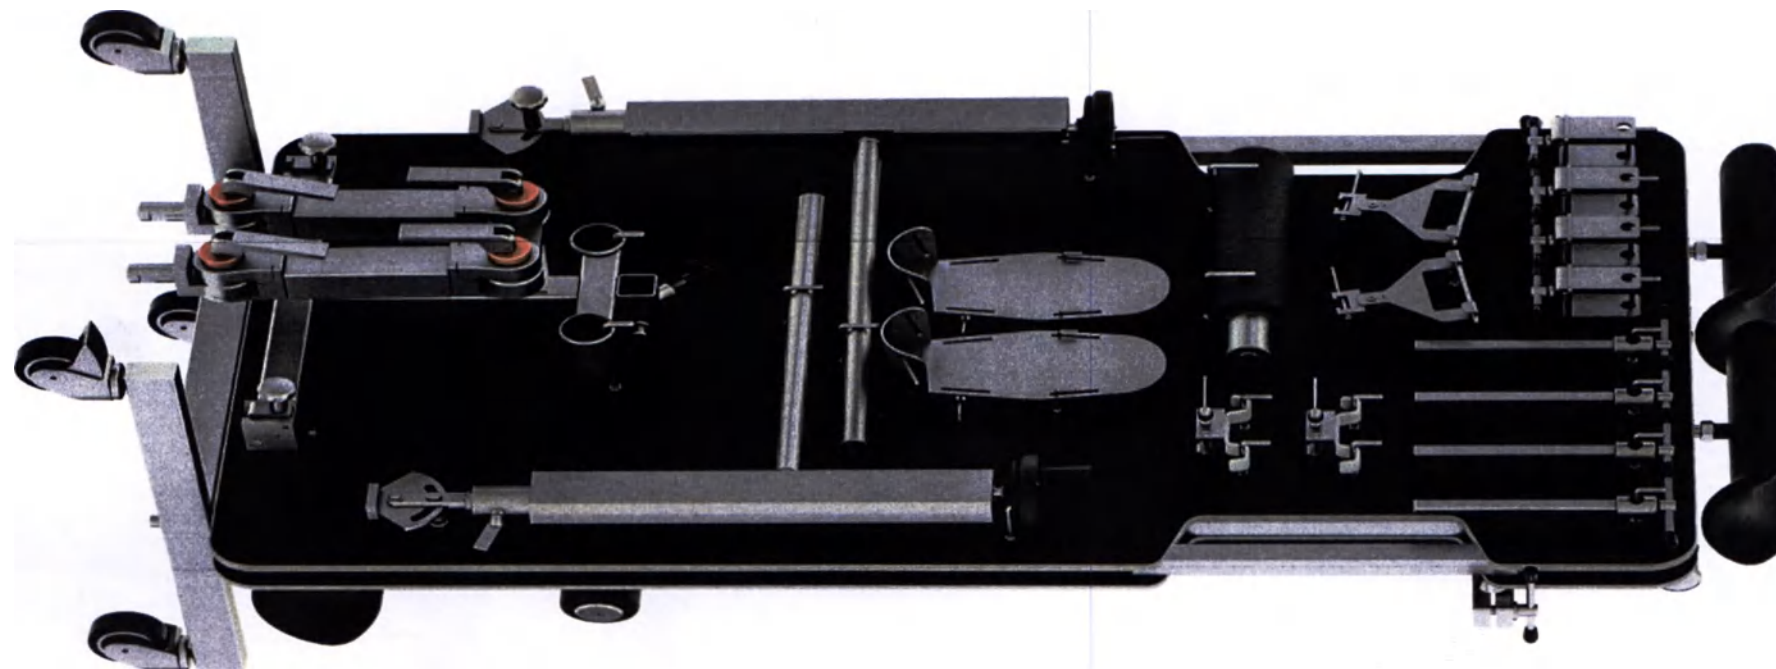


54. Ботинки для тракционного аппарата.



55. Приставка тракционная для хирургии руки.

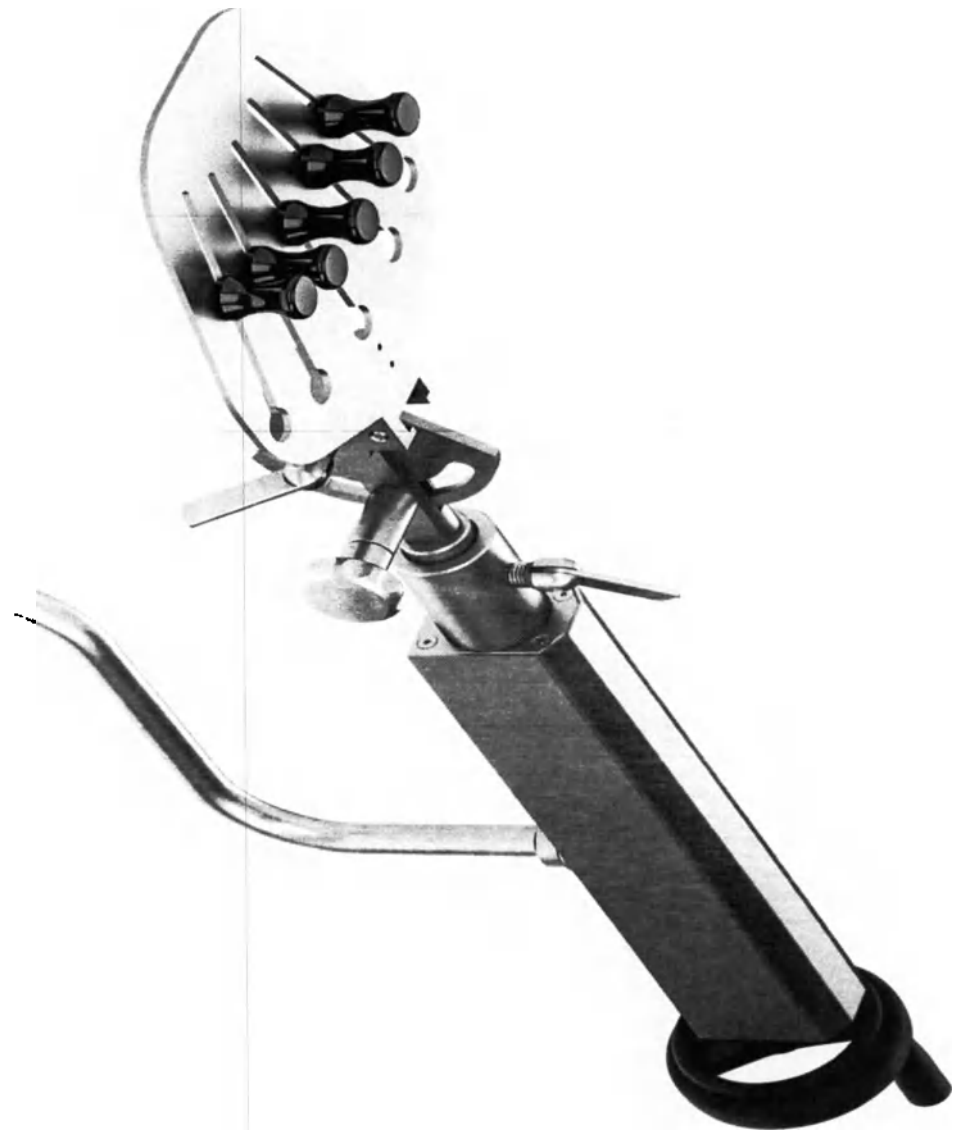

56. Приставка для хирургии плеча, включая головную секцию.

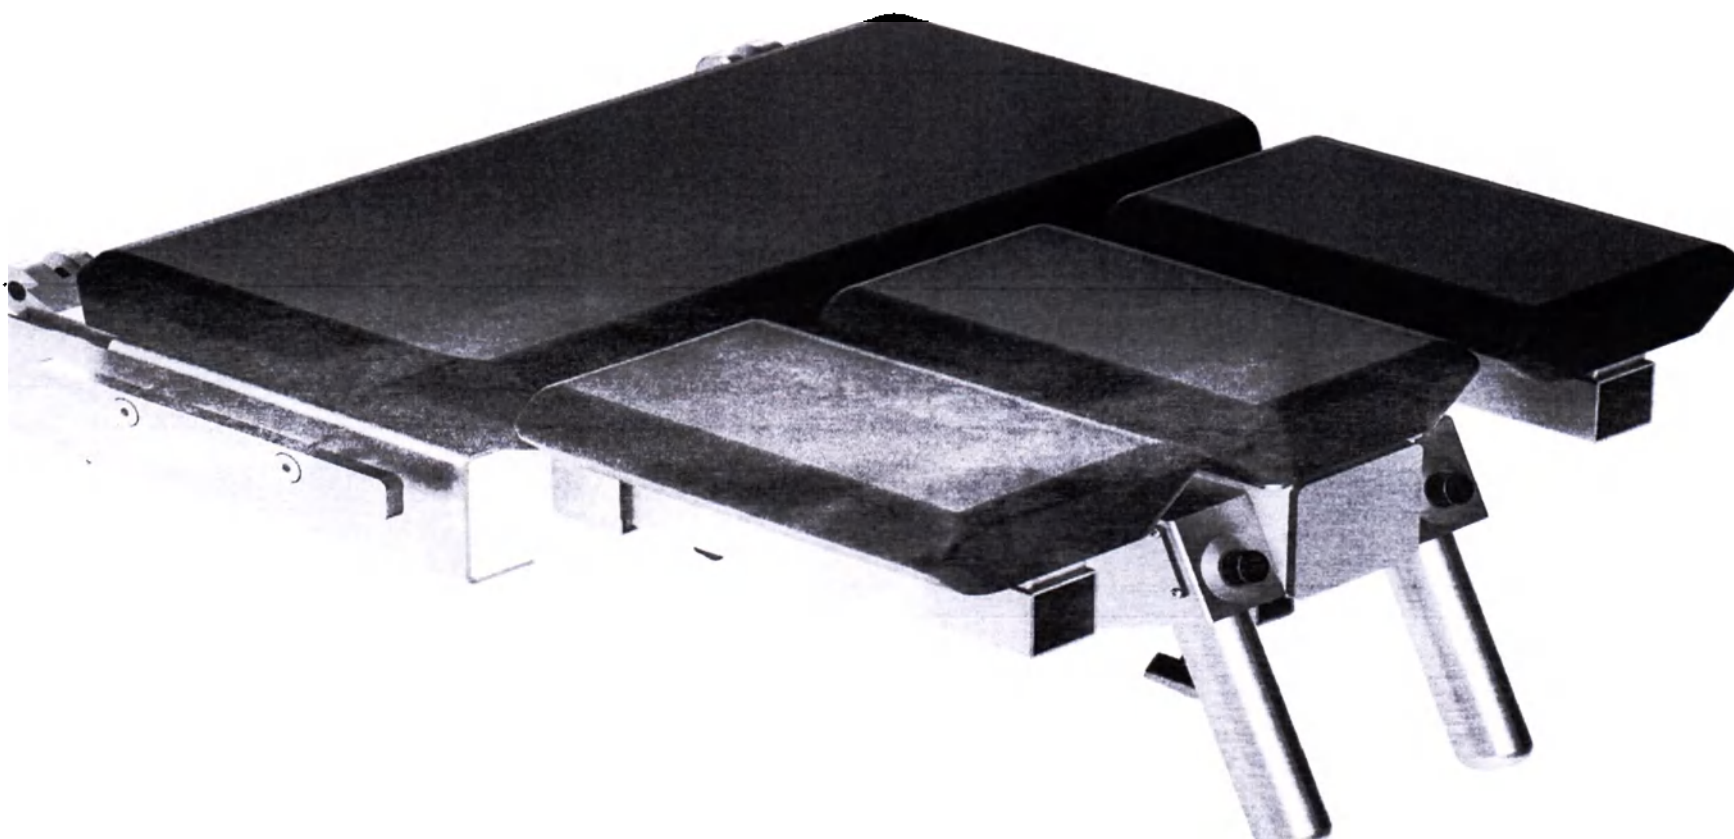

57. Приставка Лор-офтальмологическая.



58. Секция Лор-офтальмологическая головная с регулировкой расстояния.




59. Секция специализированная головная в форме подковы.





60. Секция ортопедическая головная.



61. Секция торакальная головная.

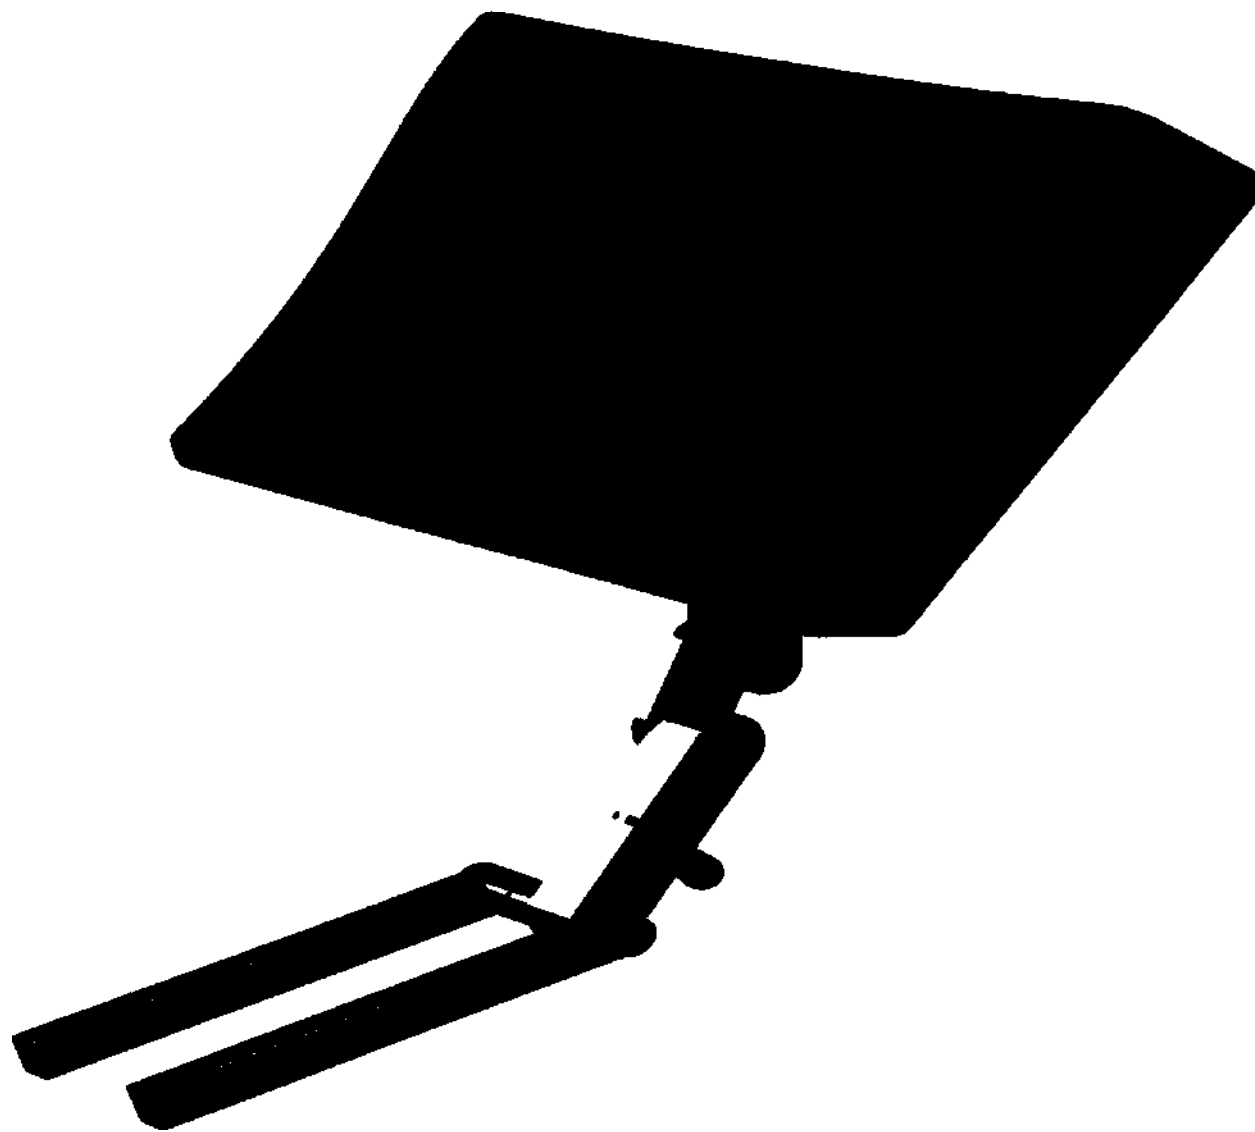

62. Адаптер для головных секций.

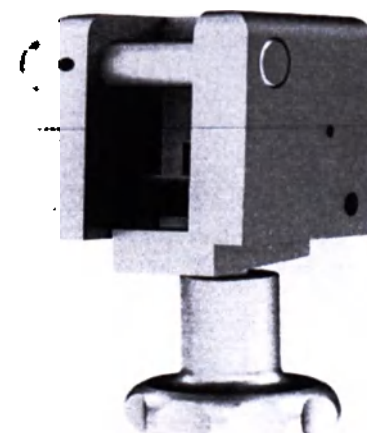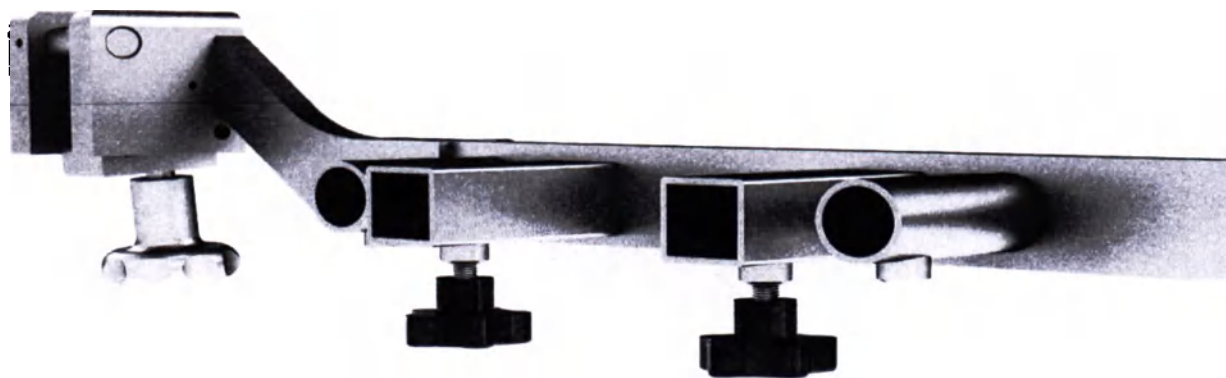


63. Поддержка рук хирурга.




64. Матрац для хирургии позвоночника.



65. Приставка нейрохирургическая.

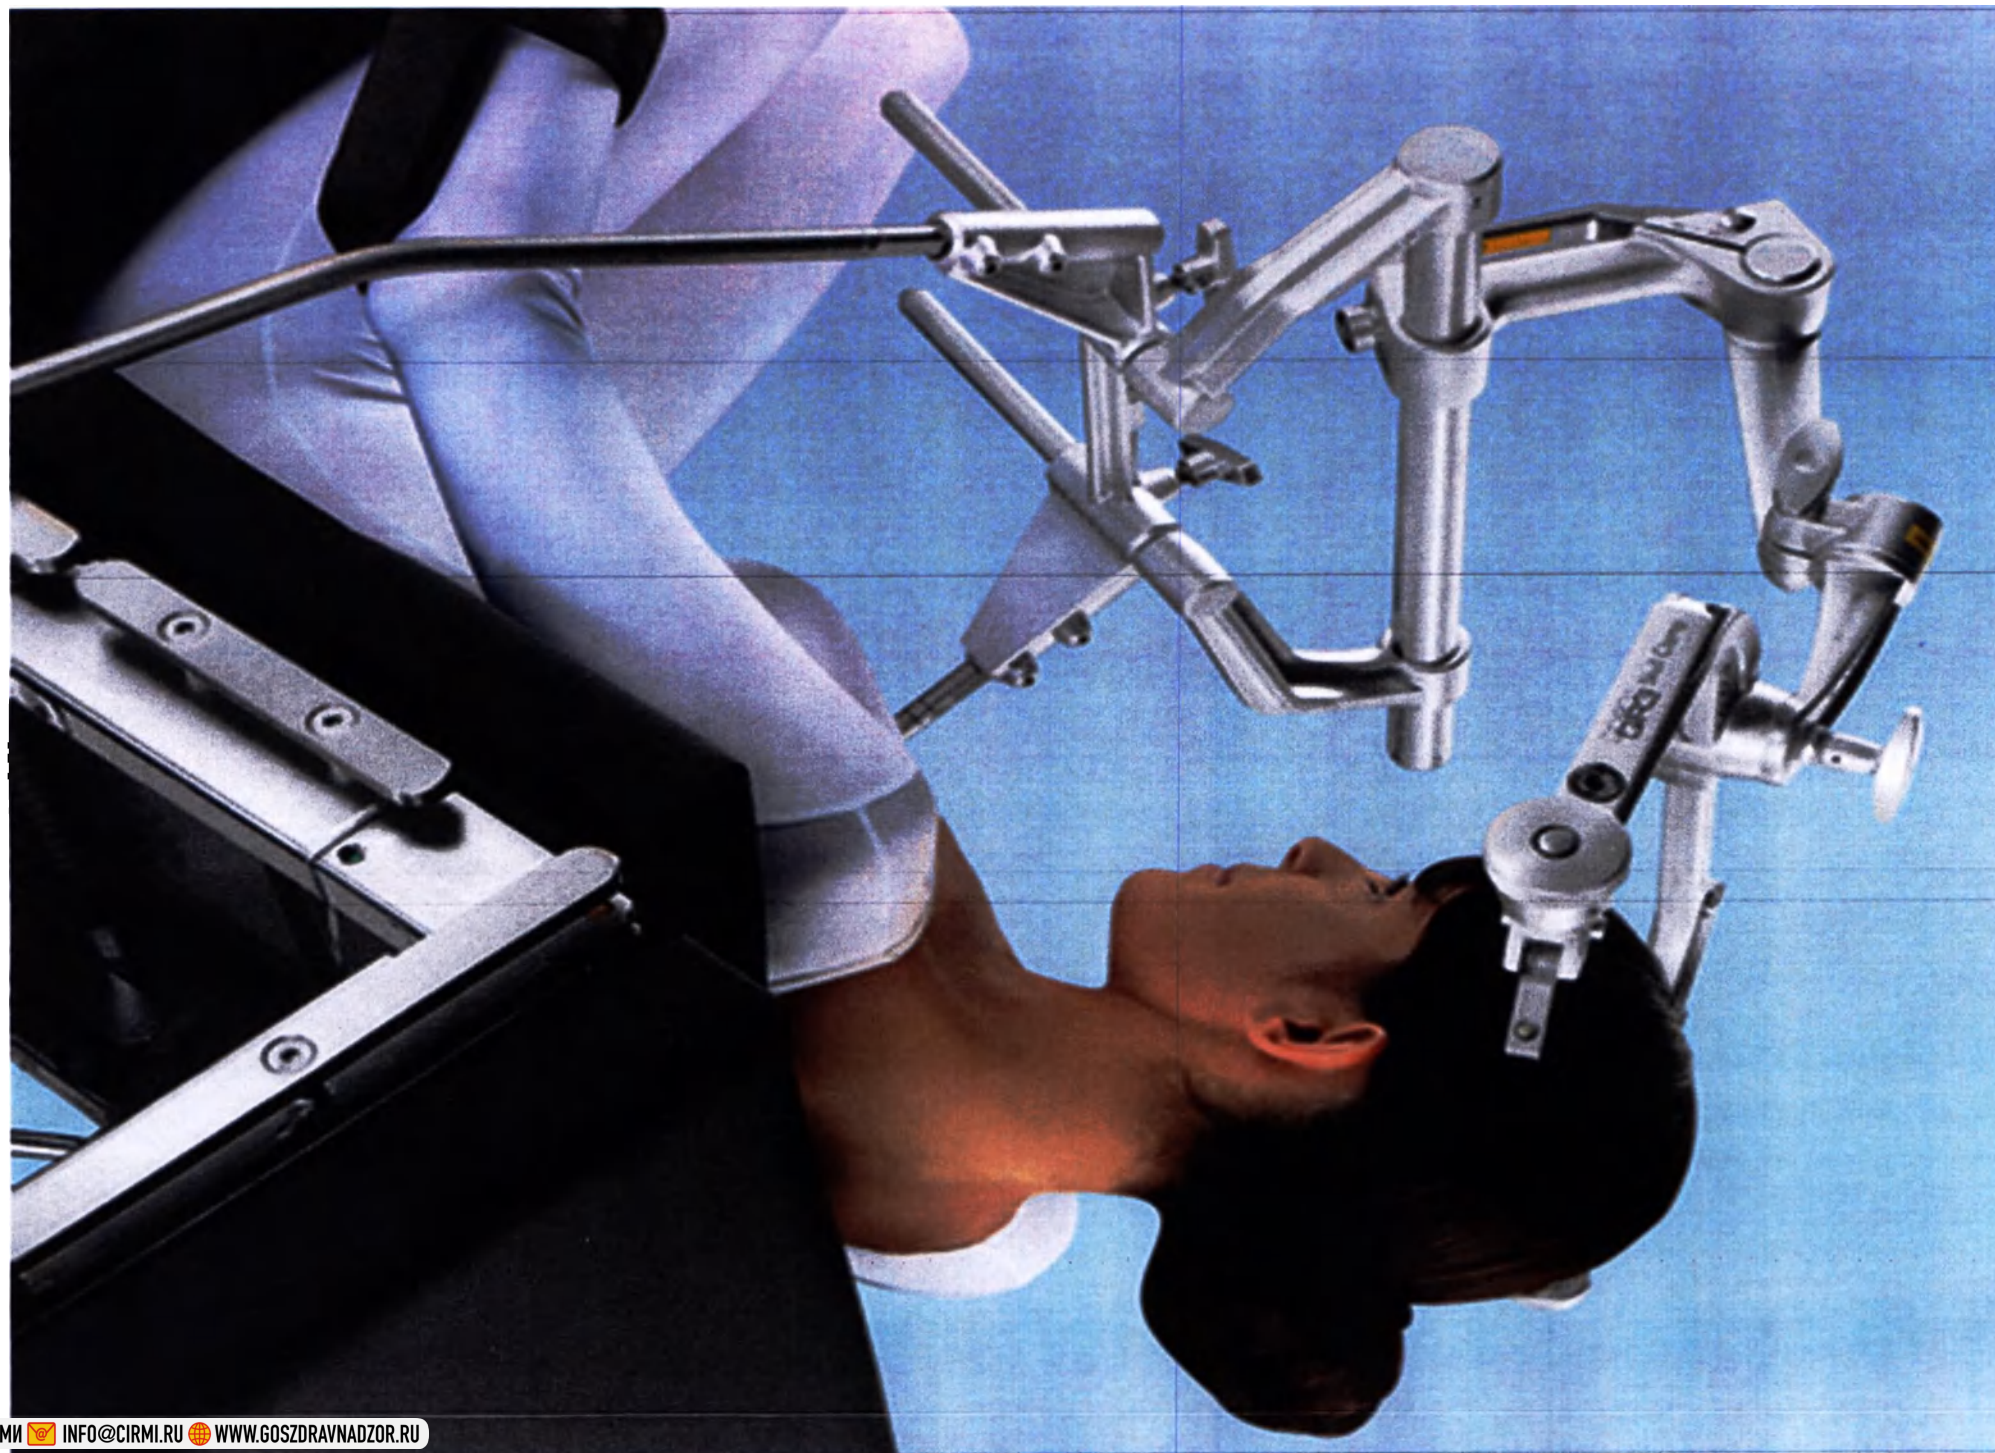


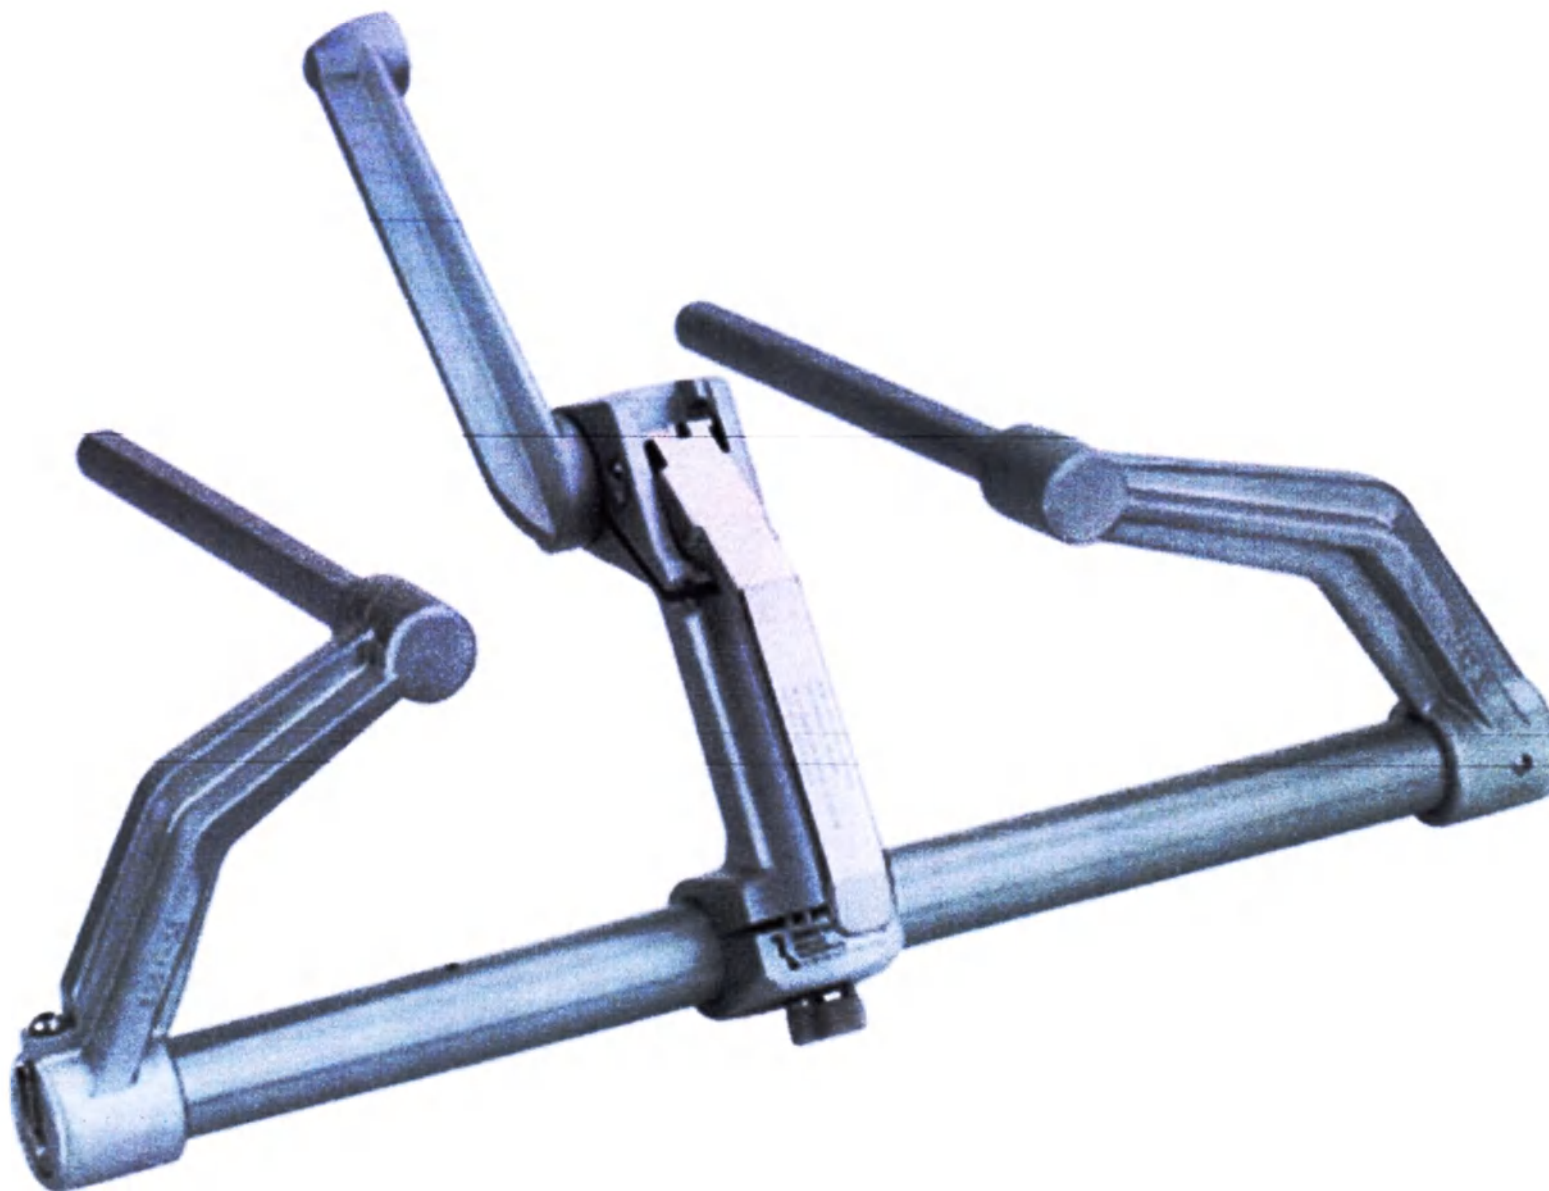


67. Адаптер шарнирный.




68. Зажим черепной.

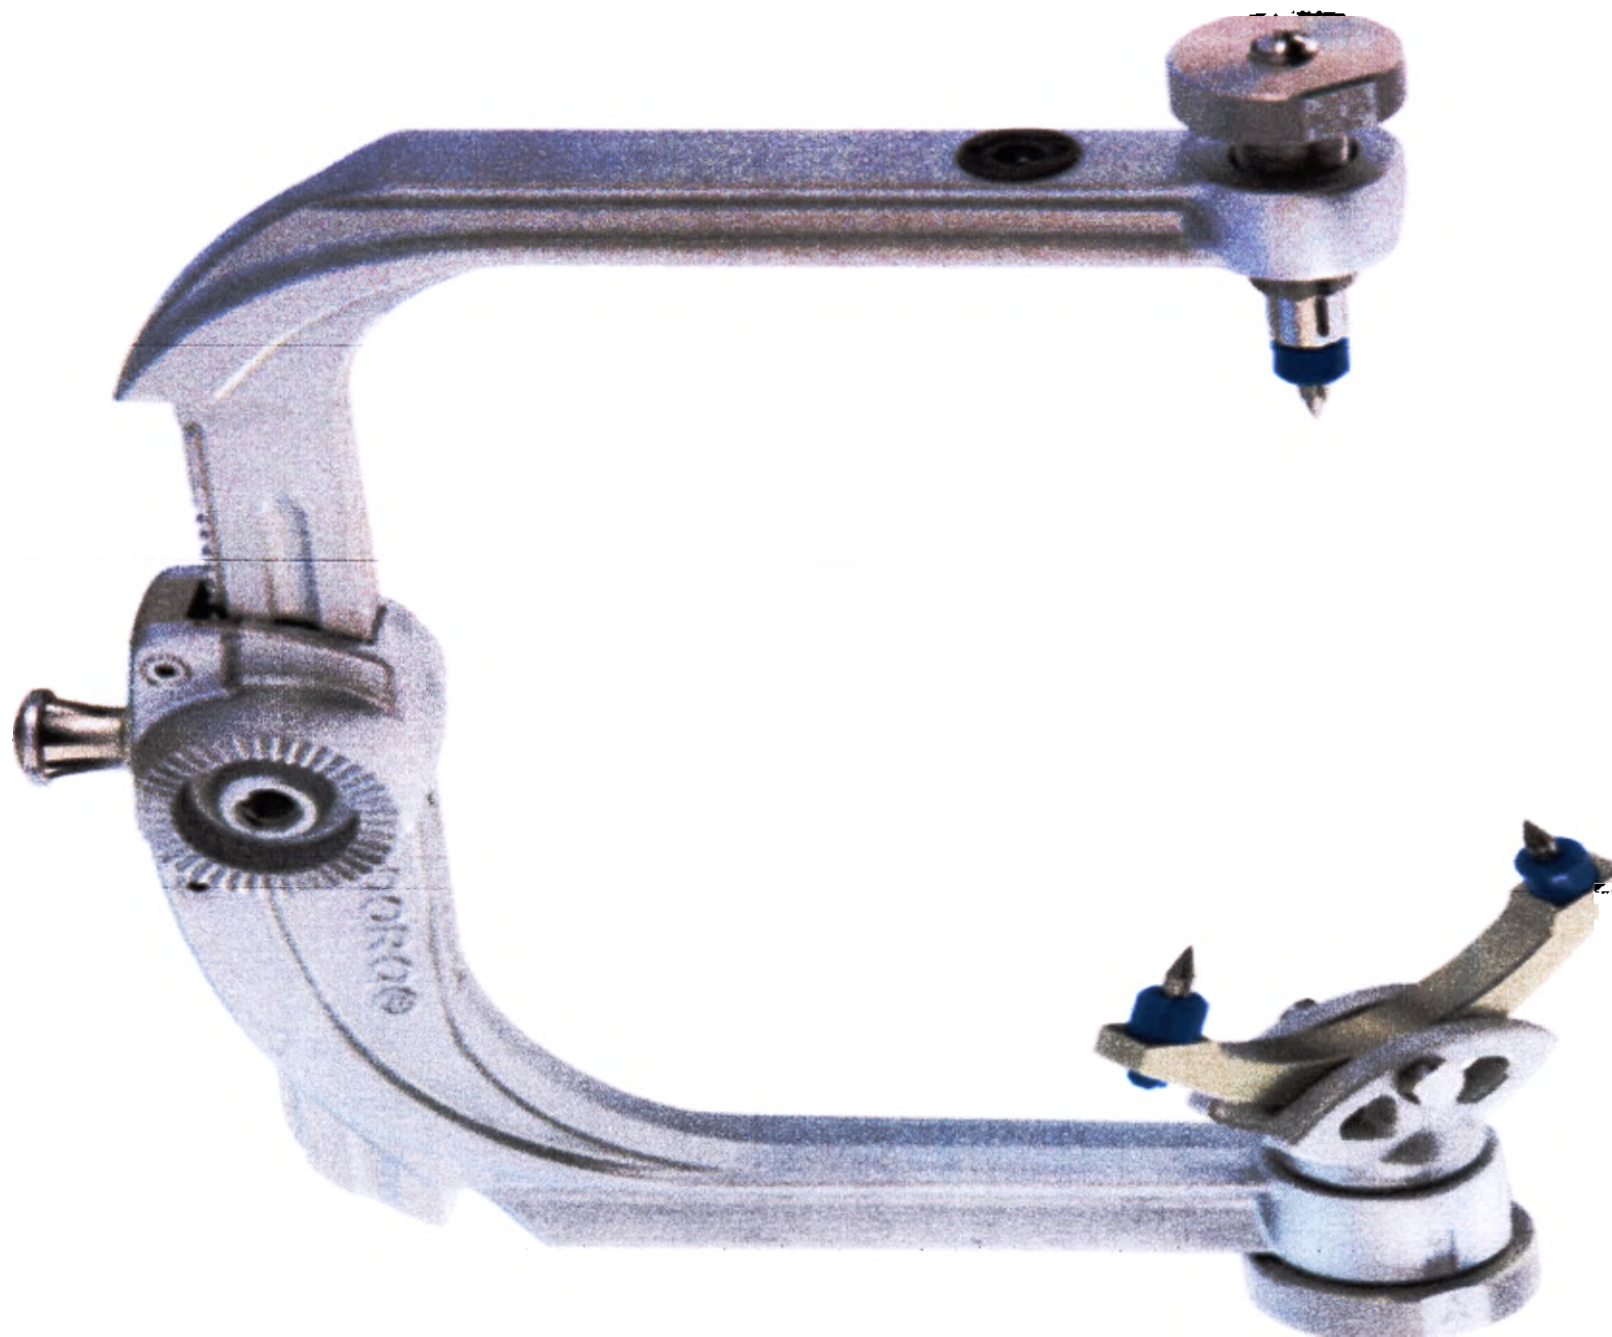


69. Штыри многогранные для черепа (детские).

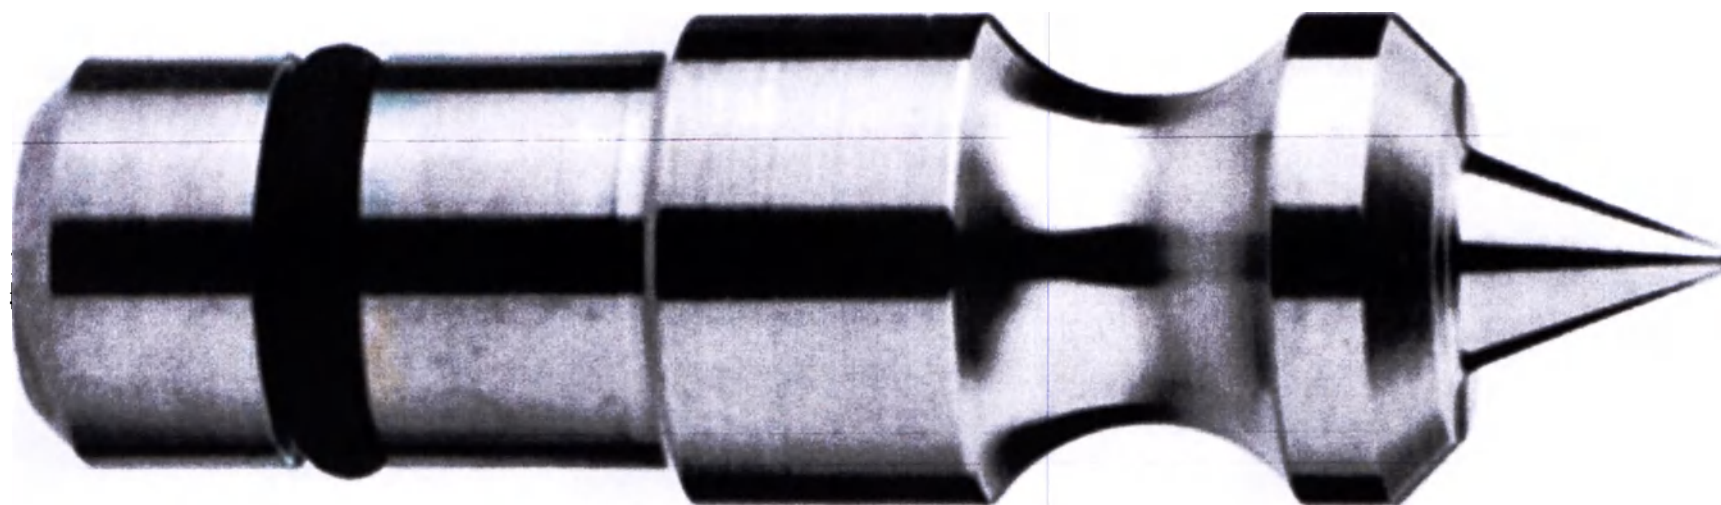

70. Штыри многоразовые для черепа (взрослые).

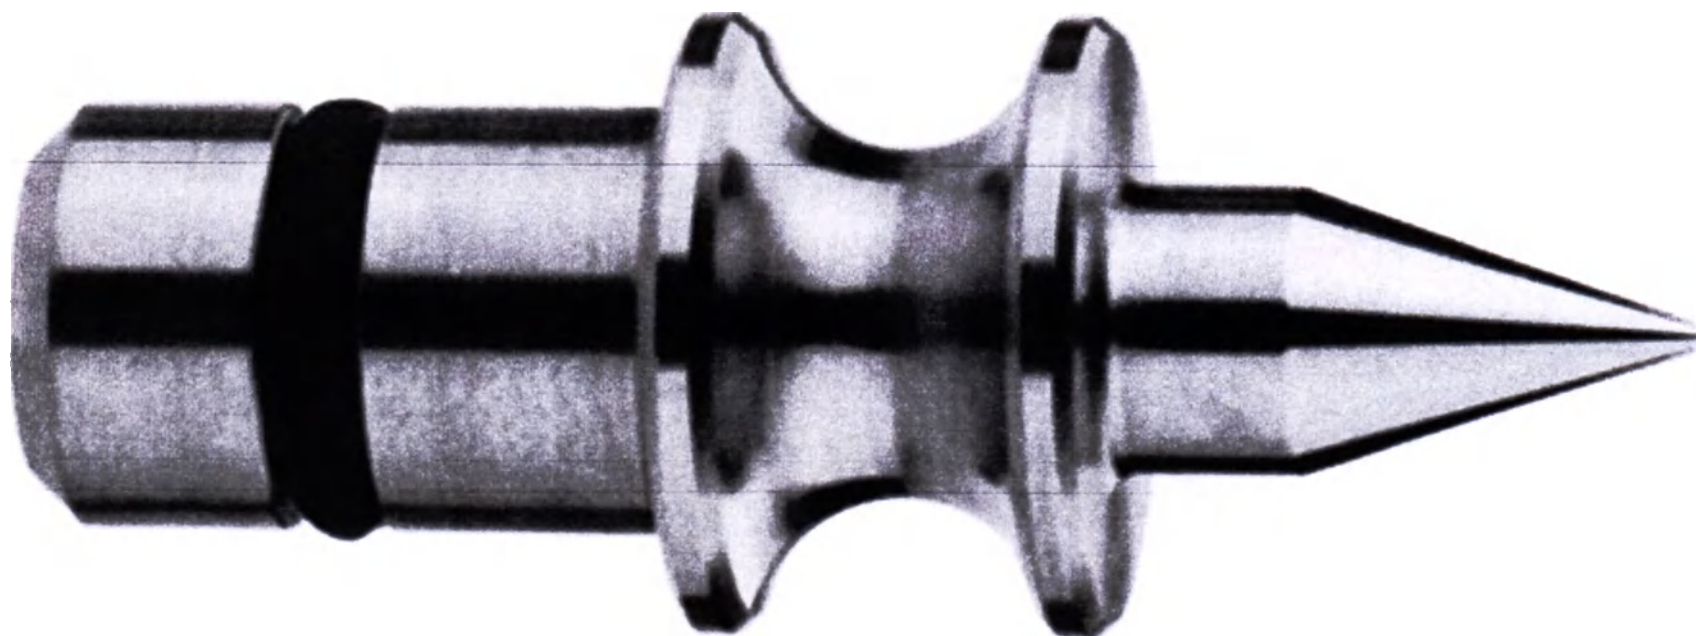

71. Перекладина для нейрохирургических операций в положении «сидя»

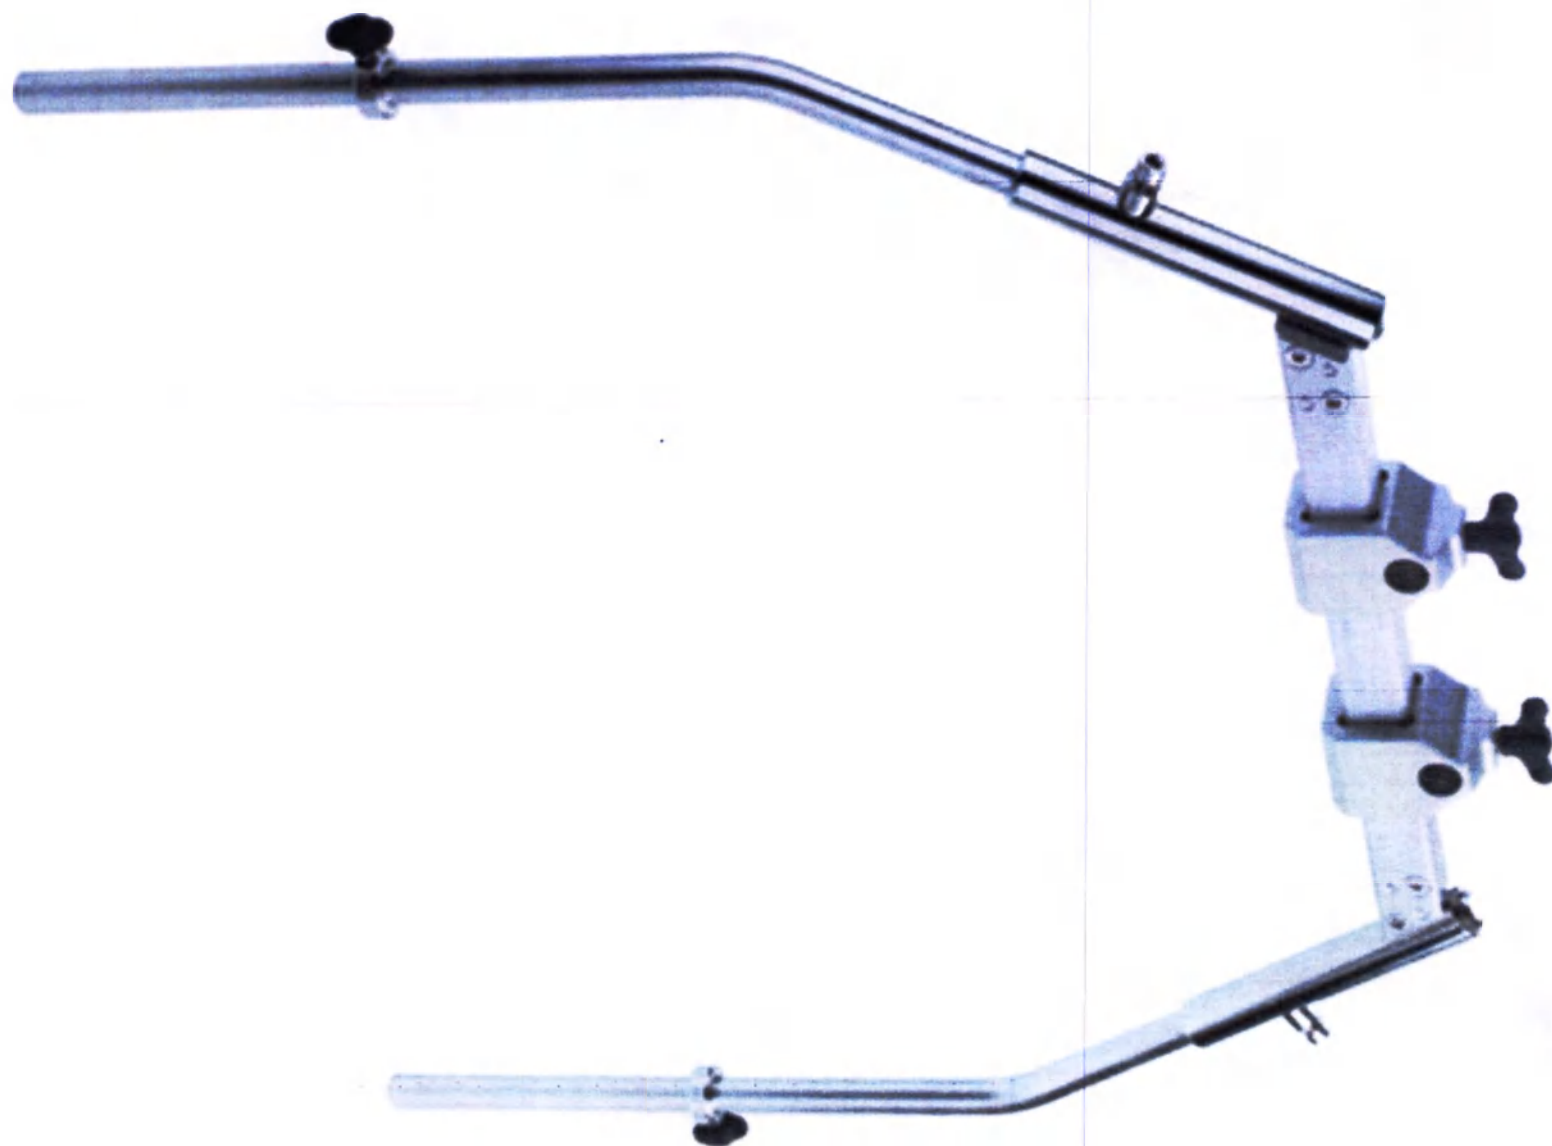



73. Крепление подковообразного подголовника для взрослых.



74. Подушка подковообразная взрослая, правая.



75. Подушка подковообразная взрослая, левая.



76. Крепление подковообразного подголовника для детей.



77. Подушка подковообразная детская, правая.




78. Подушка подковообразная детская, левая.







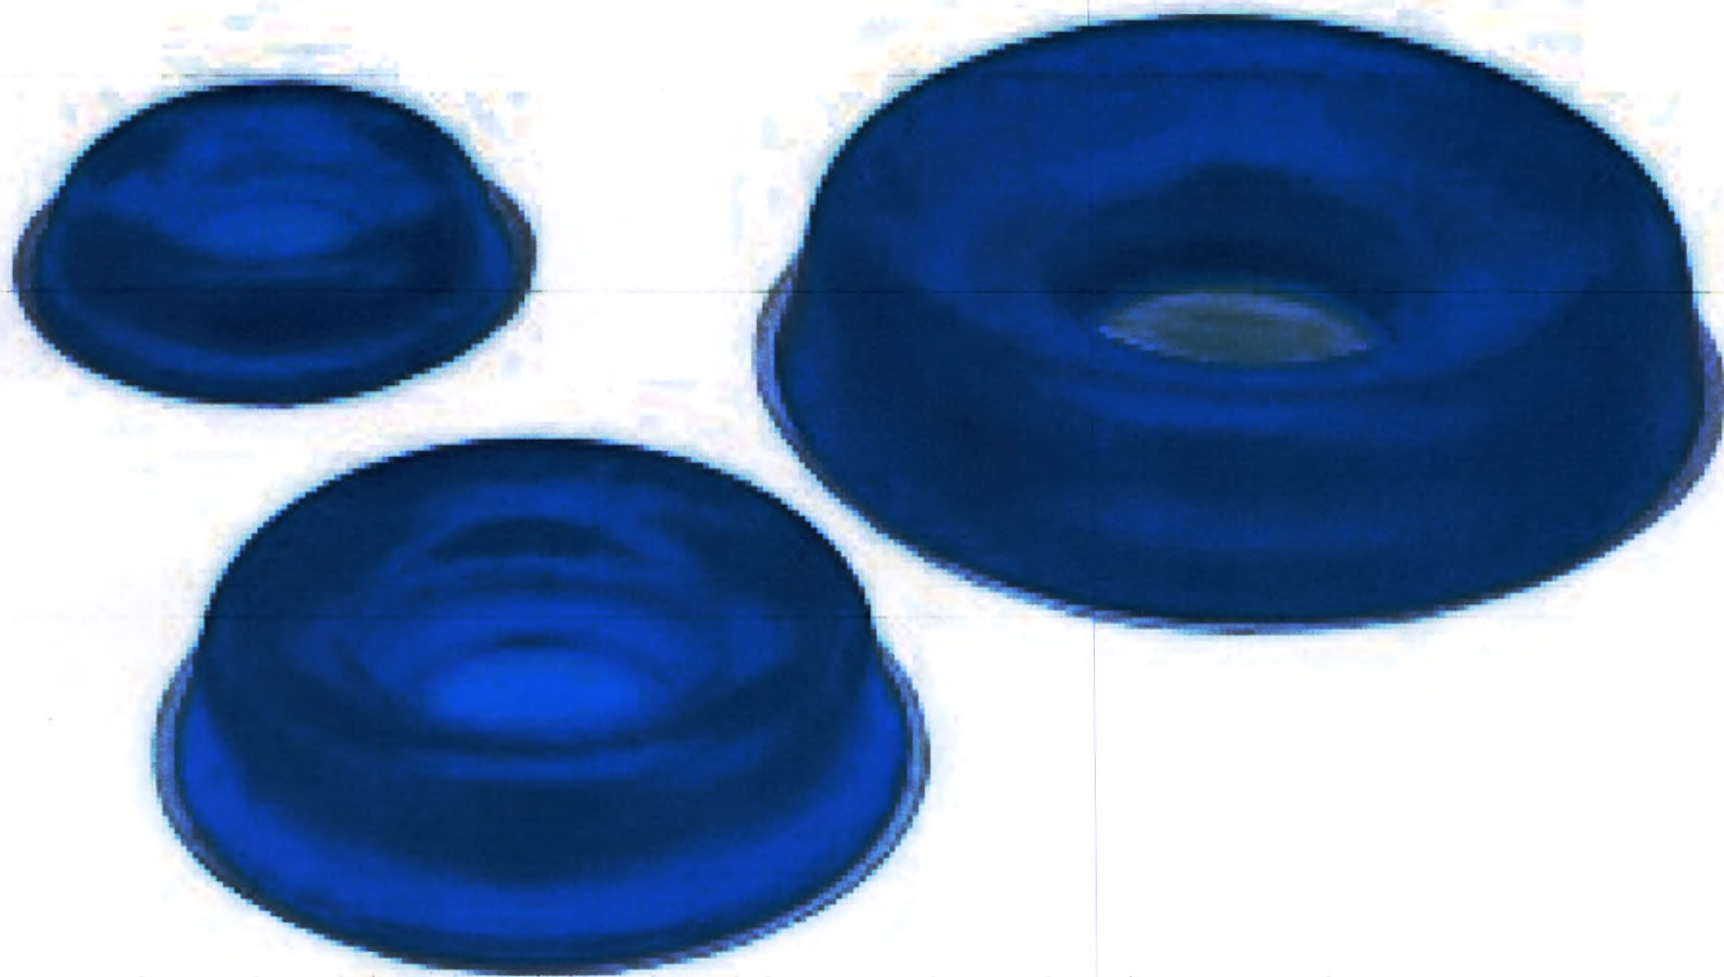

82. Валик грудной гелевый.






84. Коврик гелевый на операционный стол - не более 2 шт.



Прошито, пронумеровано
И скреплено печатью 110 листов

Генеральный директор
ООО «ЕГРО»



Мякишев А.В.



14 ФЕВ 2020