


УТВЕРЖДАЮ




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**«Имплантаты дентальные Straumann», в вариантах исполнения,
производства Institut Straumann AG («Институт Штрауманн АГ»), Швейцария**

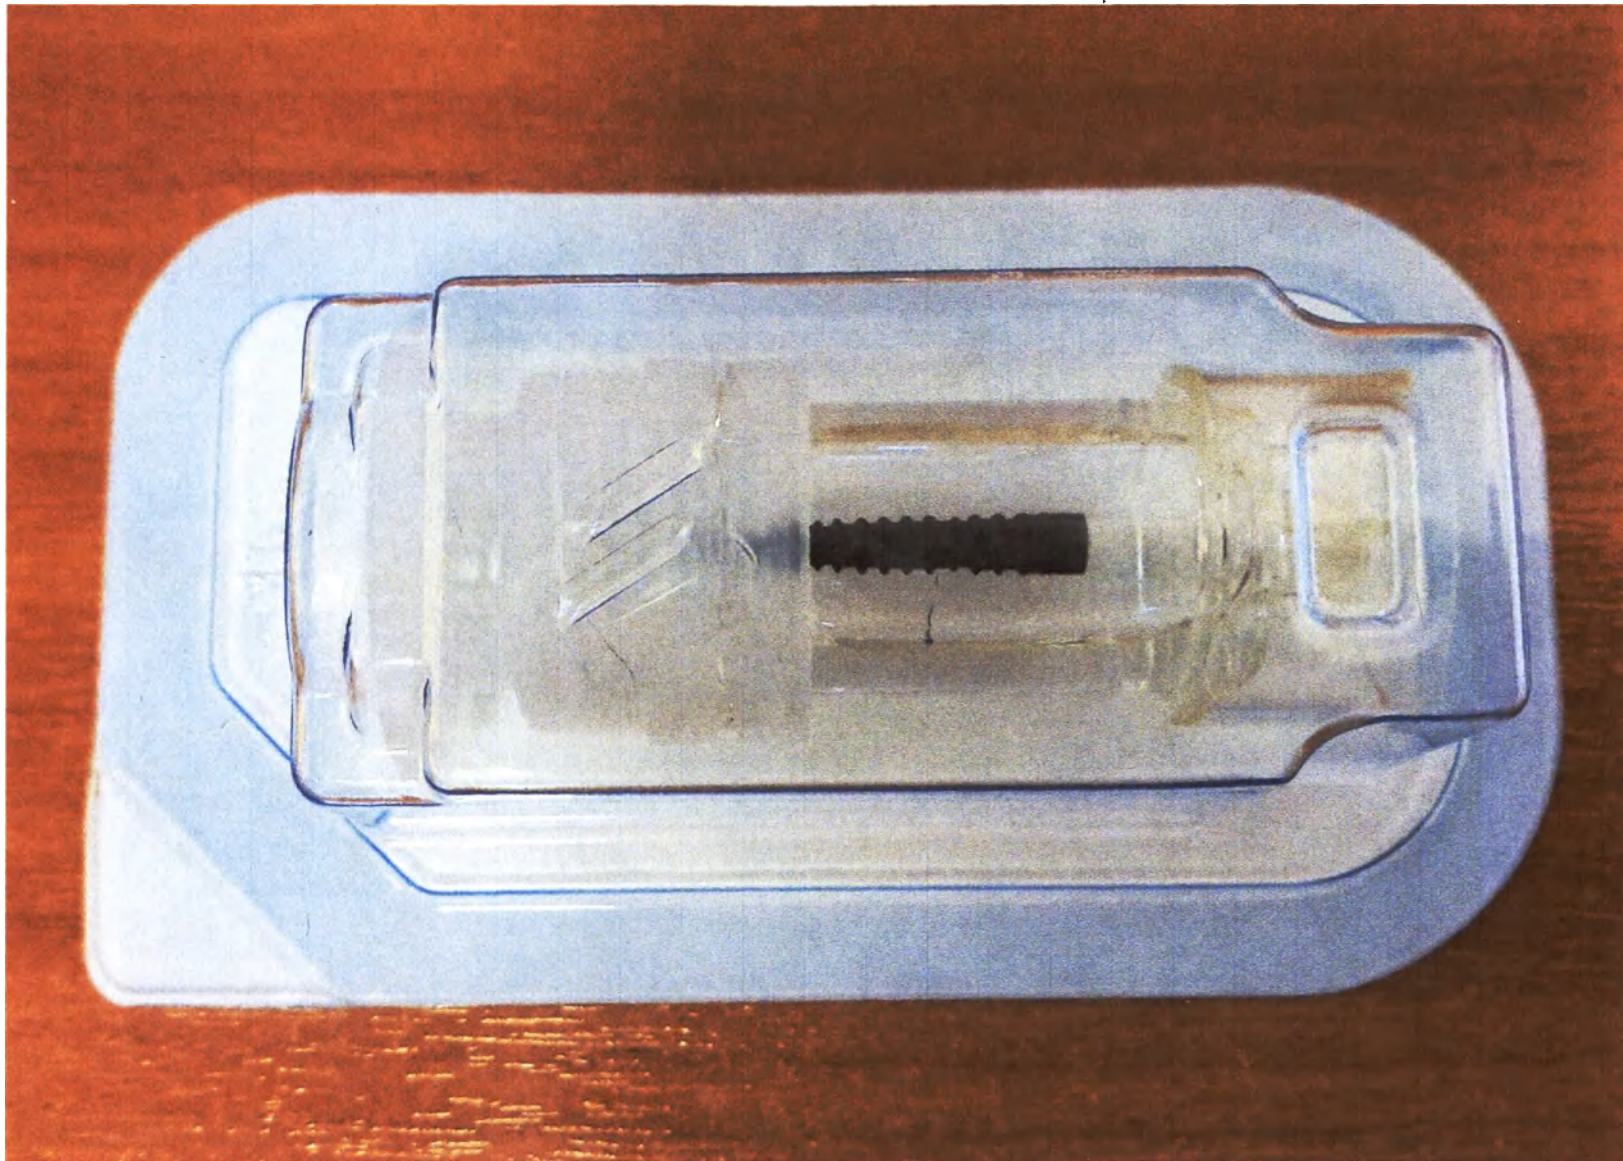


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann (позиции 1-6 приложения к заявлению о государственной регистрации медицинского изделия) на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 3.5мм RB, SLActive® 18мм, Roxolid®

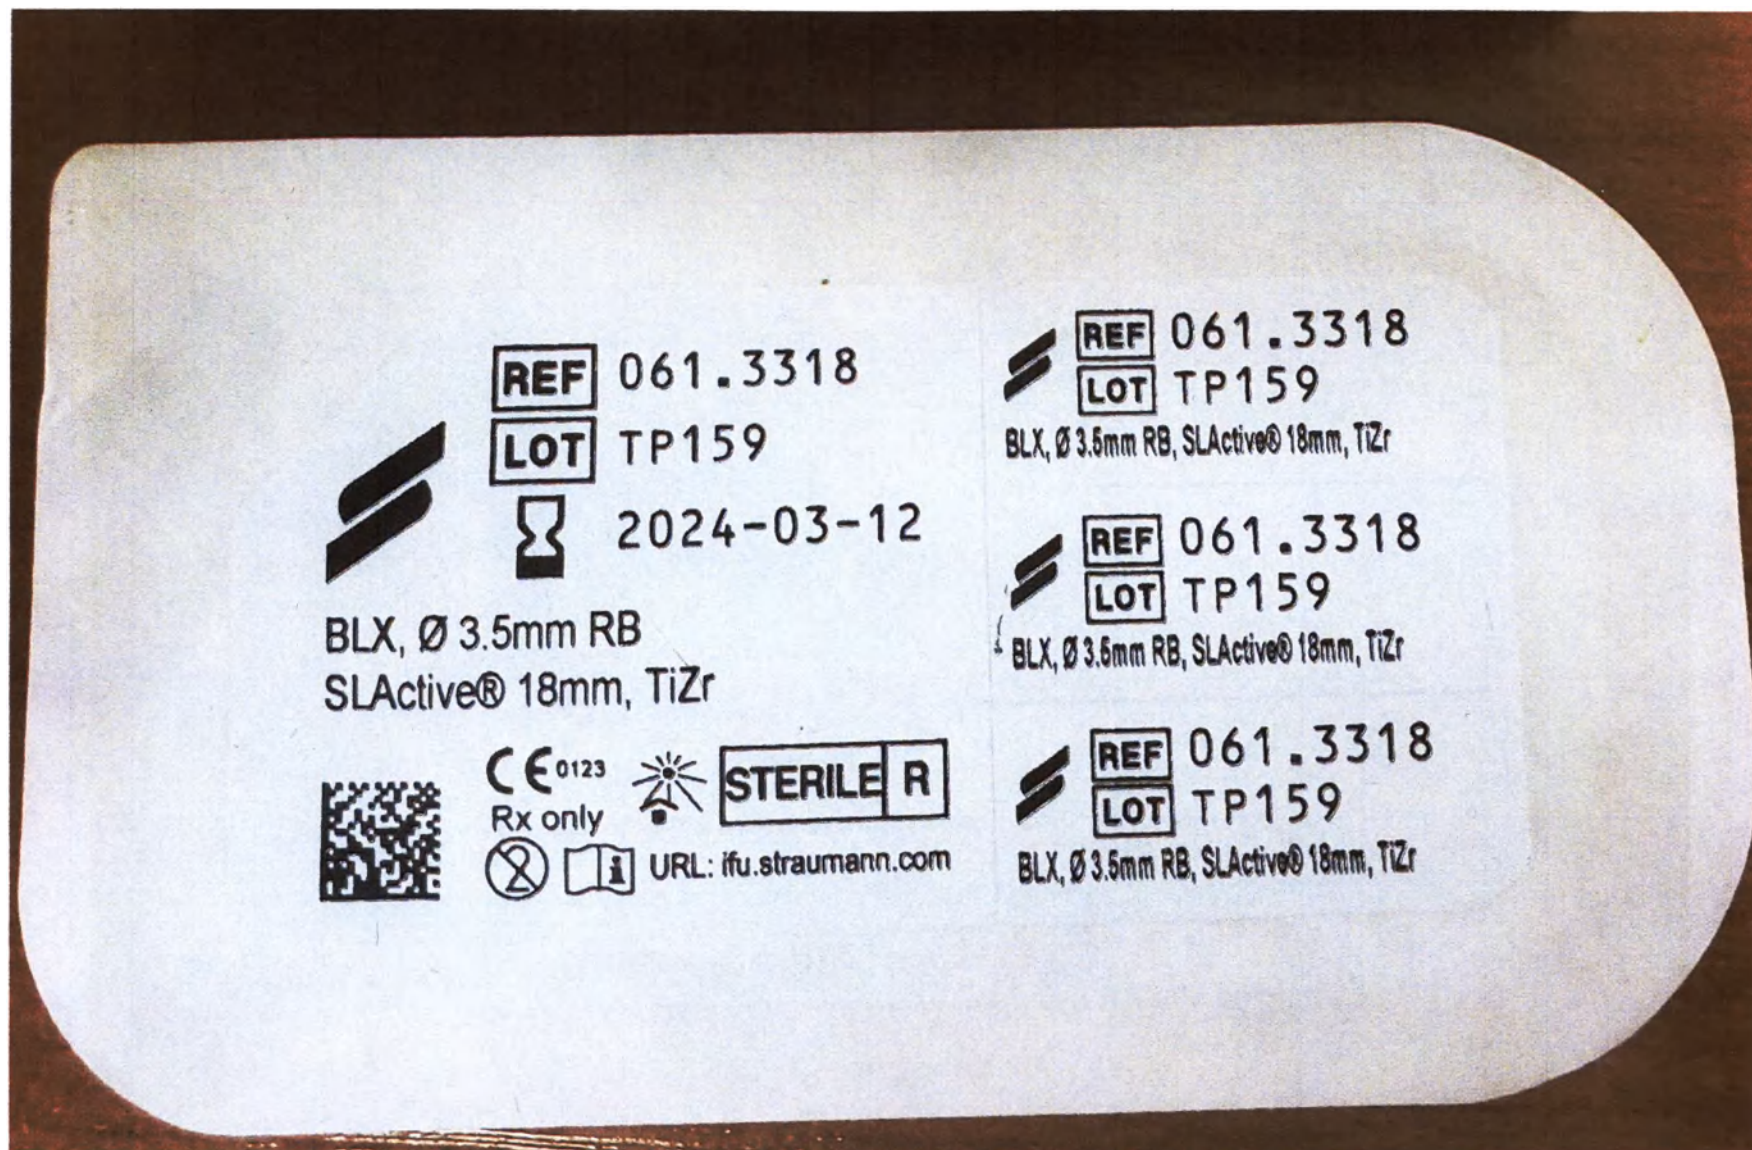


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann (позиции 1-6 приложения к заявлению о государственной регистрации медицинского изделия) на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 3.5mm RB, SLActive® 18mm, Roxolid®

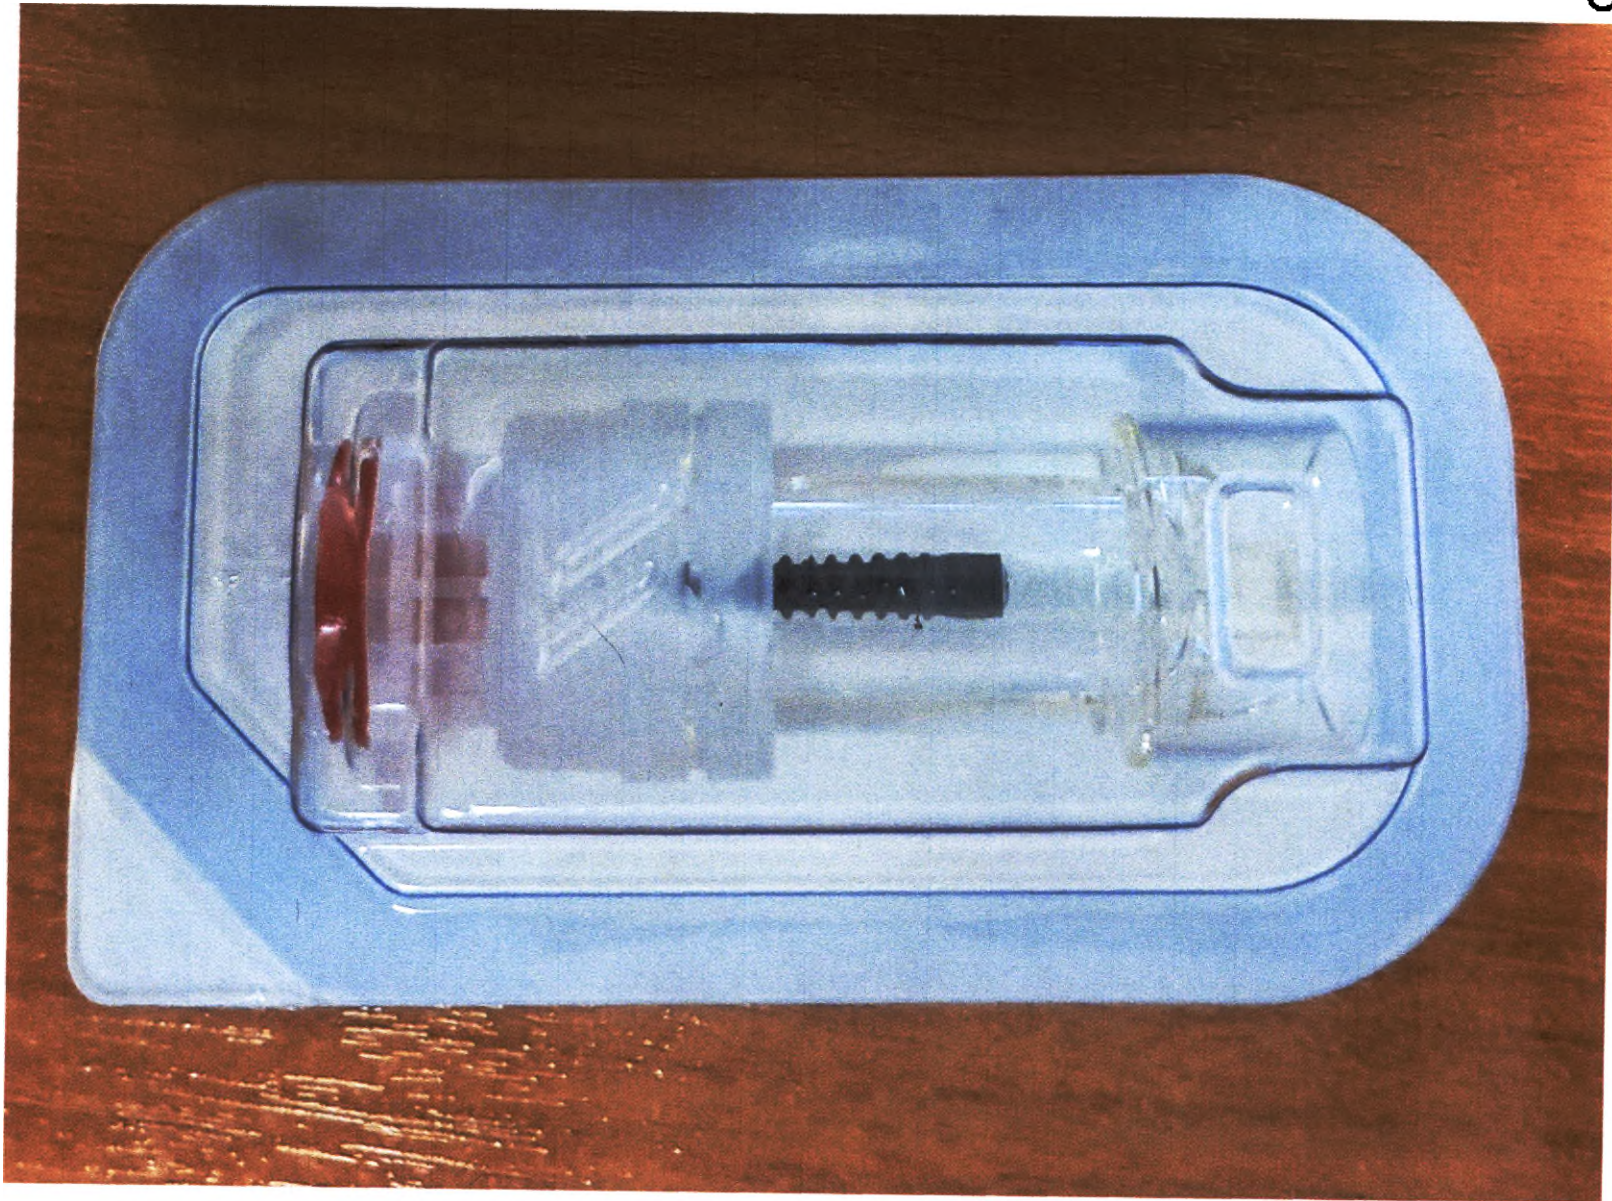

Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann (позиции 7-13 приложения к заявлению о государственной регистрации медицинского изделия) на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 3.75мм RB, SLActive® 16мм, Roxolid®

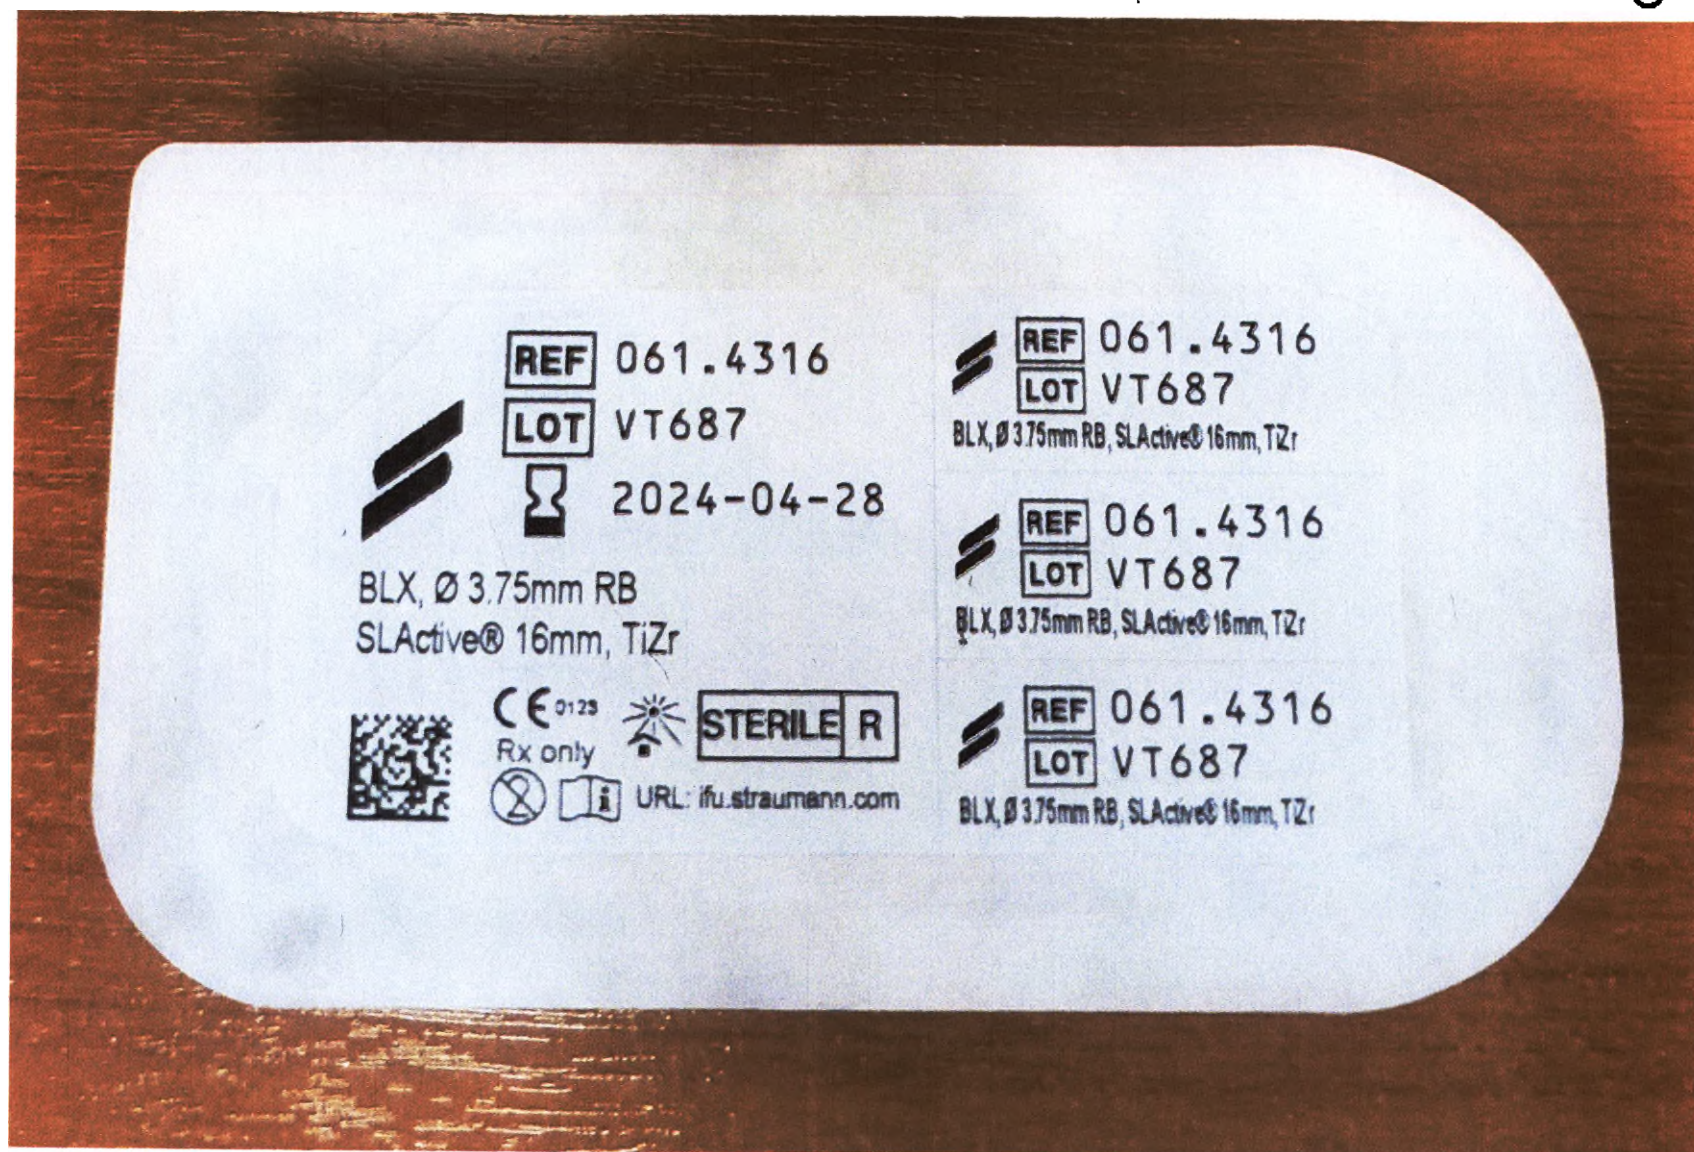

Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann (позиция 7-13 приложения к заявлению о государственной регистрации медицинского изделия) на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 3.75mm RB, SLActive® 16mm, Roxolid®

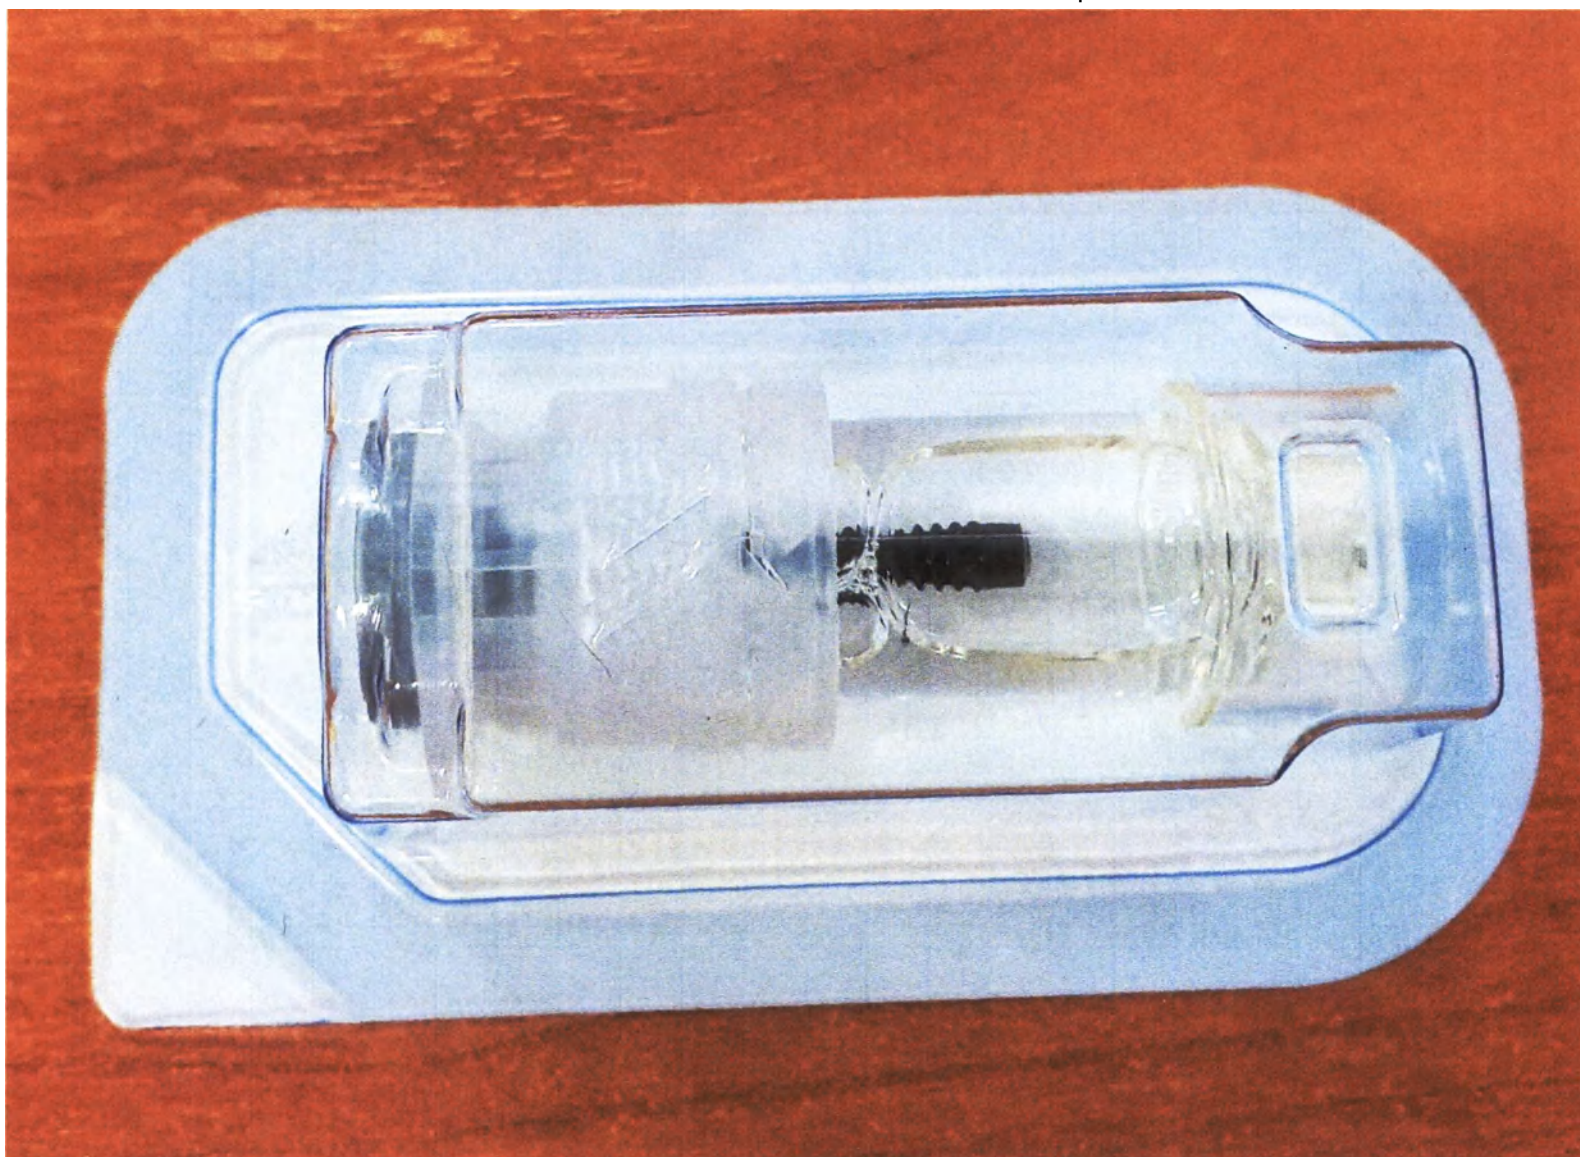

Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann (позиции 14-20 приложения к заявлению о государственной регистрации медицинского изделия) на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 4.0мм RB, SLActive® 14мм, Roxolid®

 **REF** 061.5314
LOT TP139
 2024-01-28


BLX, Ø 4.0mm RB
SLActive® 14mm, TiZr



CE 0123
Rx only



STERILE R




URL: ifu.straumann.com

 **REF** 061.5314
LOT TP139
BLX, Ø 4.0mm RB, SLActive® 14mm, TiZr


 **REF** 061.5314
LOT TP139
BLX, Ø 4.0mm RB, SLActive® 14mm, TiZr

 **REF** 061.5314
LOT TP139
BLX, Ø 4.0mm RB, SLActive® 14mm, TiZr


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann (позиции 14-20 приложения к заявлению о государственной регистрации медицинского изделия) на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 4.0mm RB, SLActive® 14mm, Roxolid®

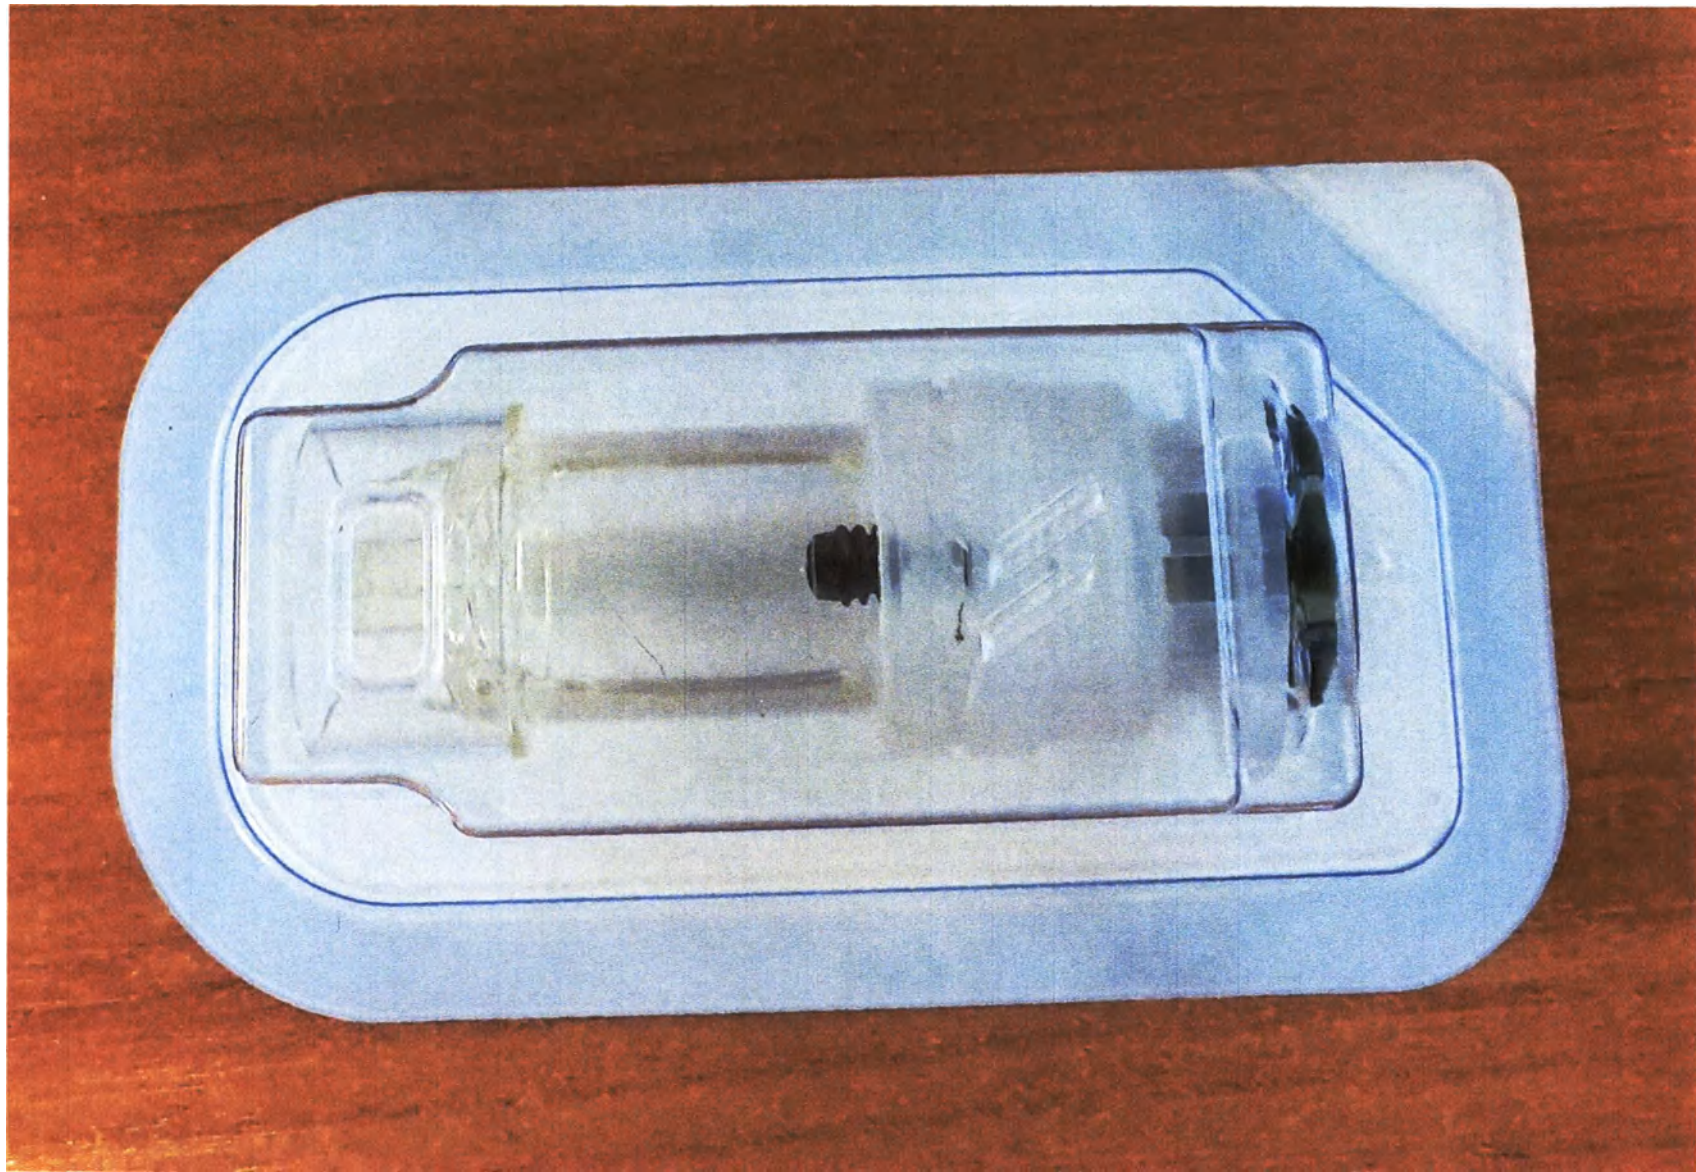


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann (позиции 21-27 приложения к заявлению о государственной регистрации медицинского изделия) на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 4.5мм RB, SLActive® 6мм, Roxolid®

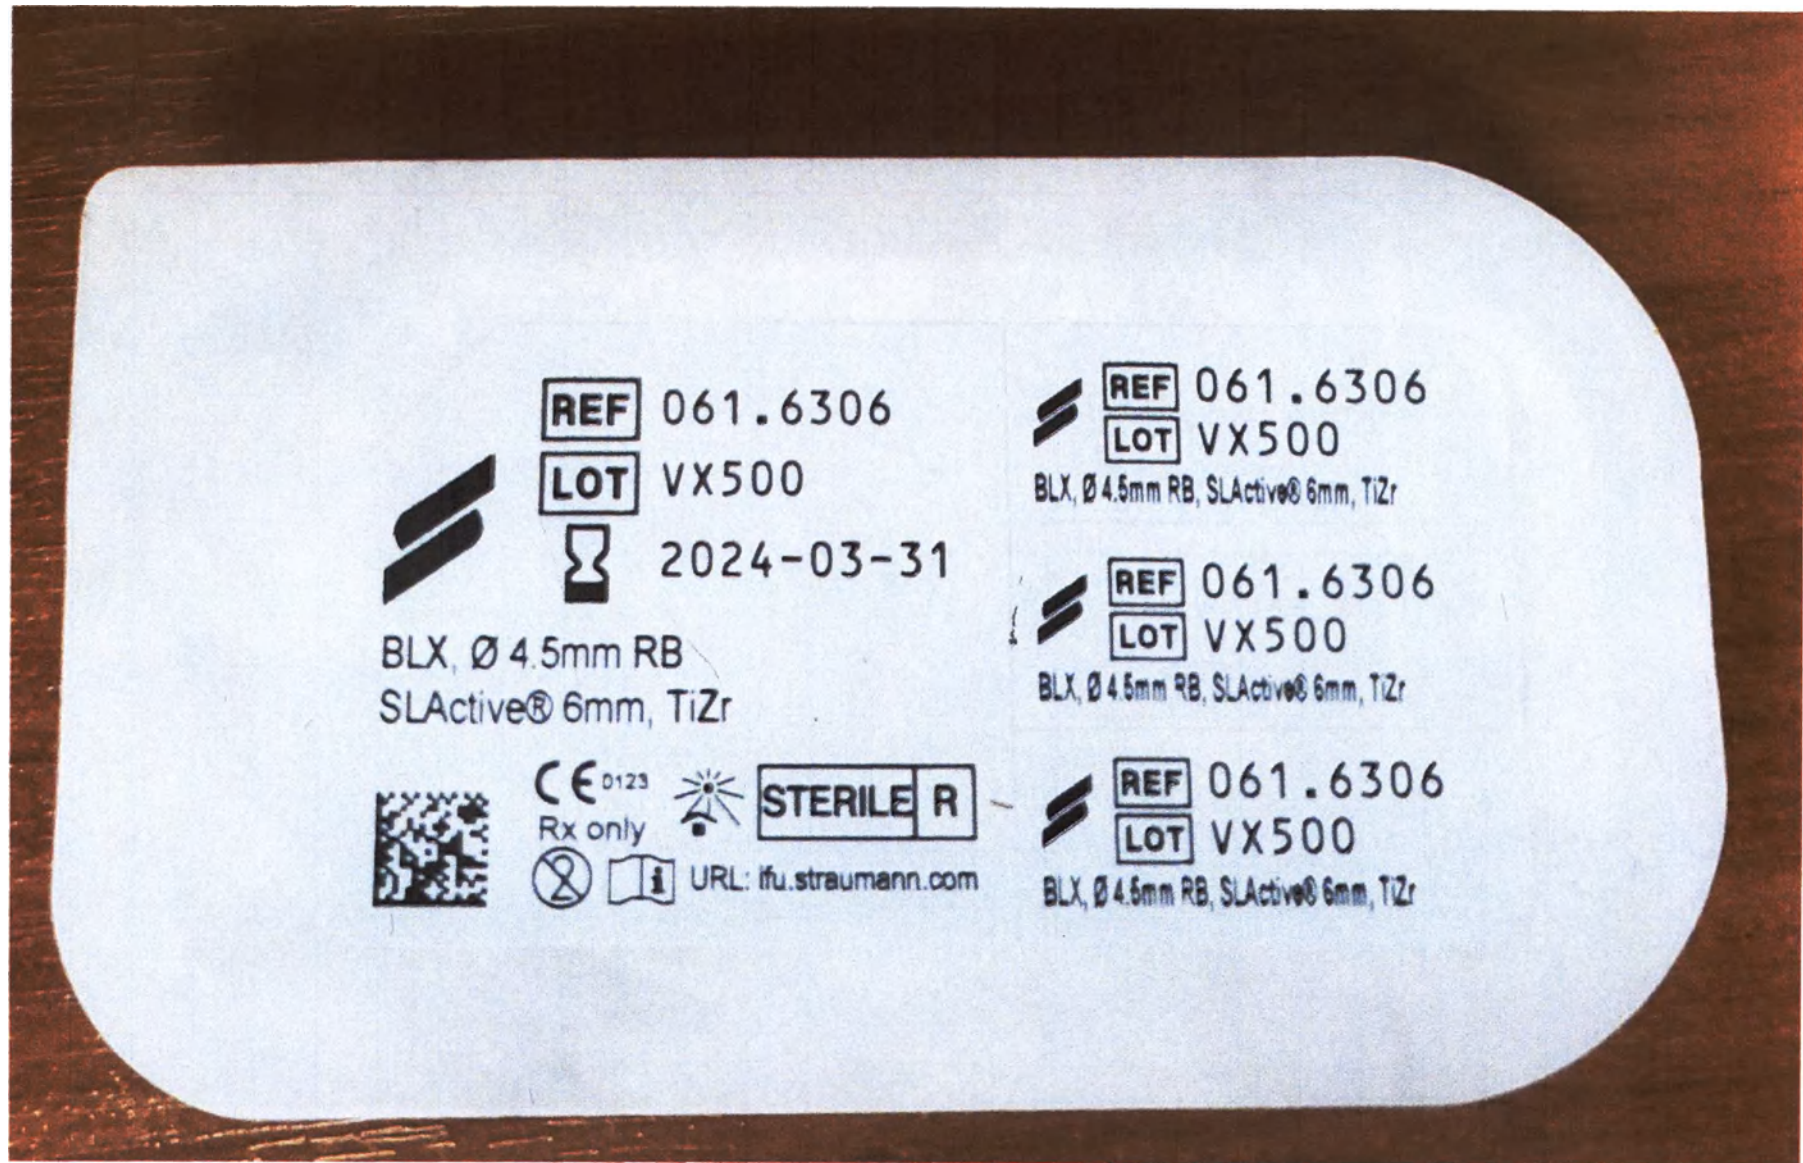


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann (позиции 21-27 приложения к заявлению о государственной регистрации медицинского изделия) на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 4.5мм RB, SLActive® 6мм, Roxolid®

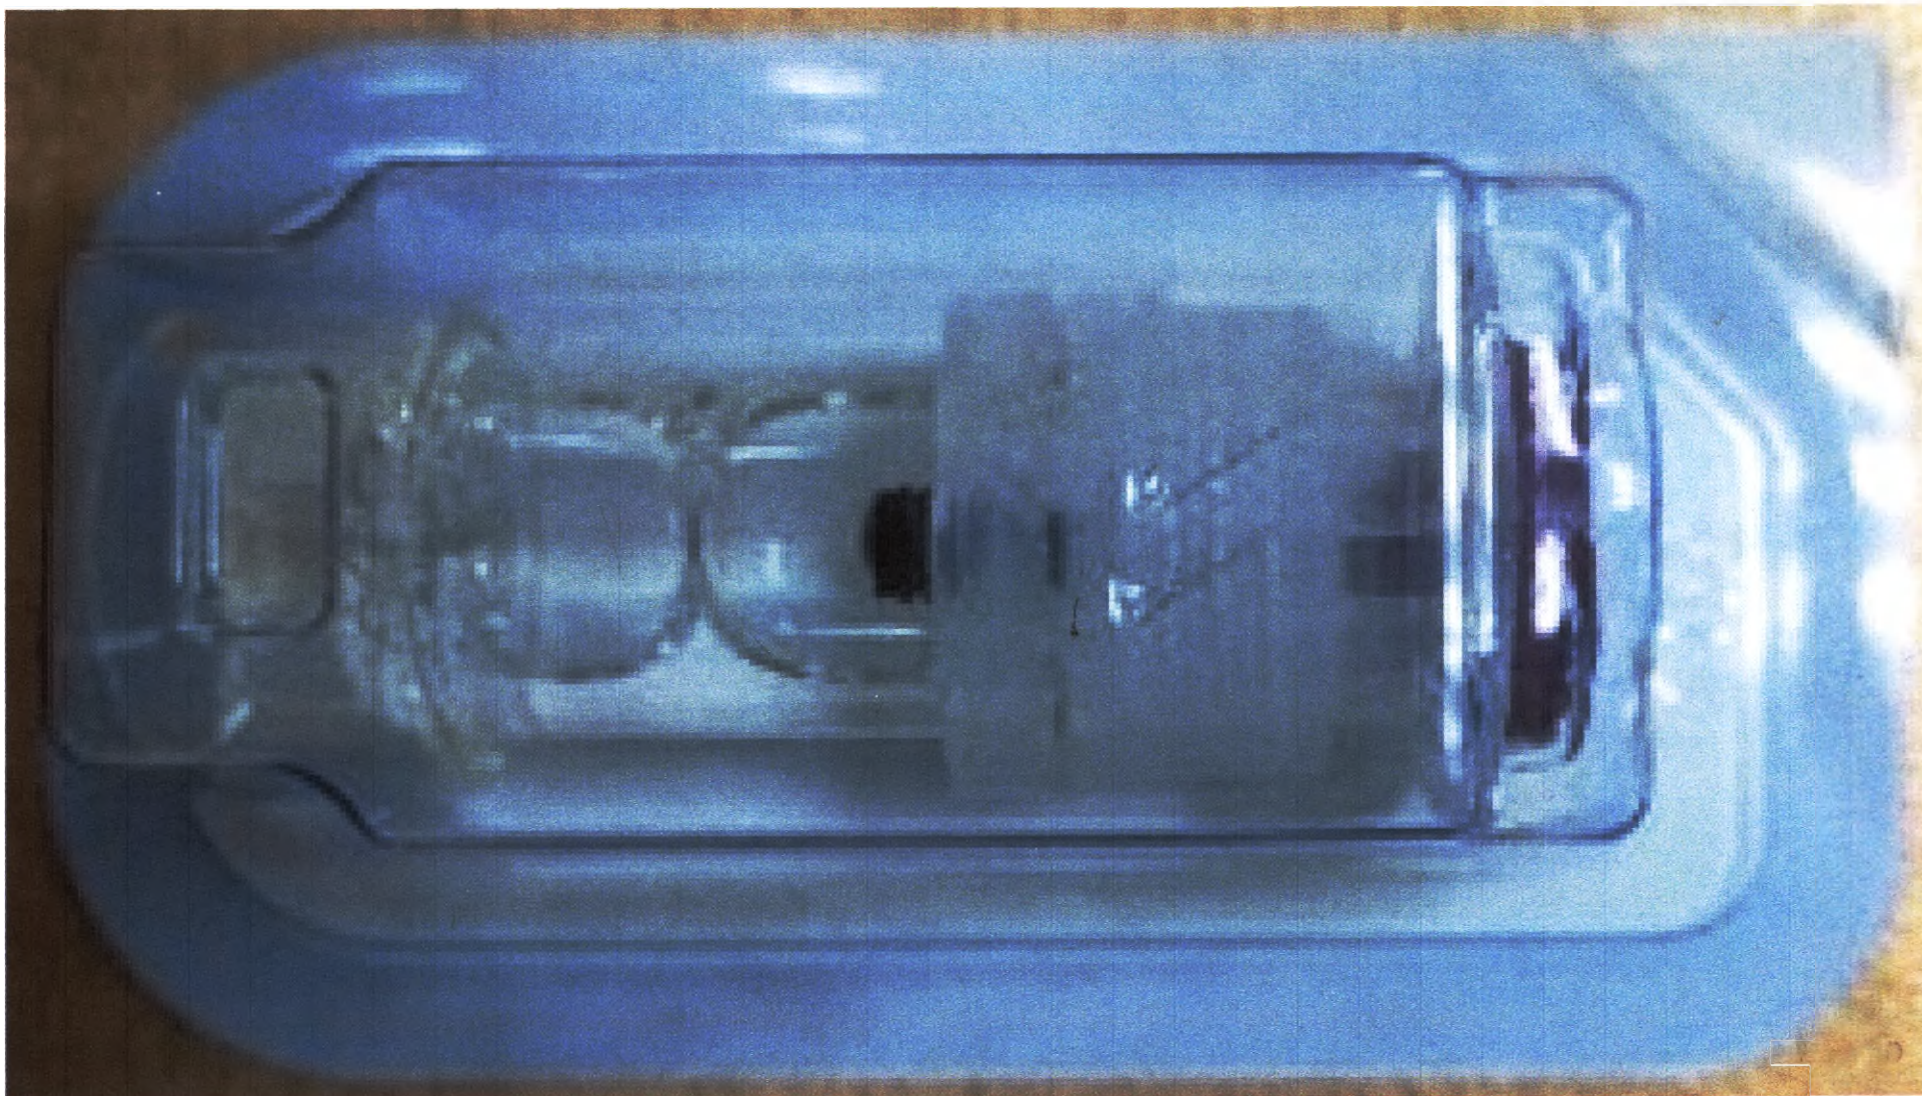


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®

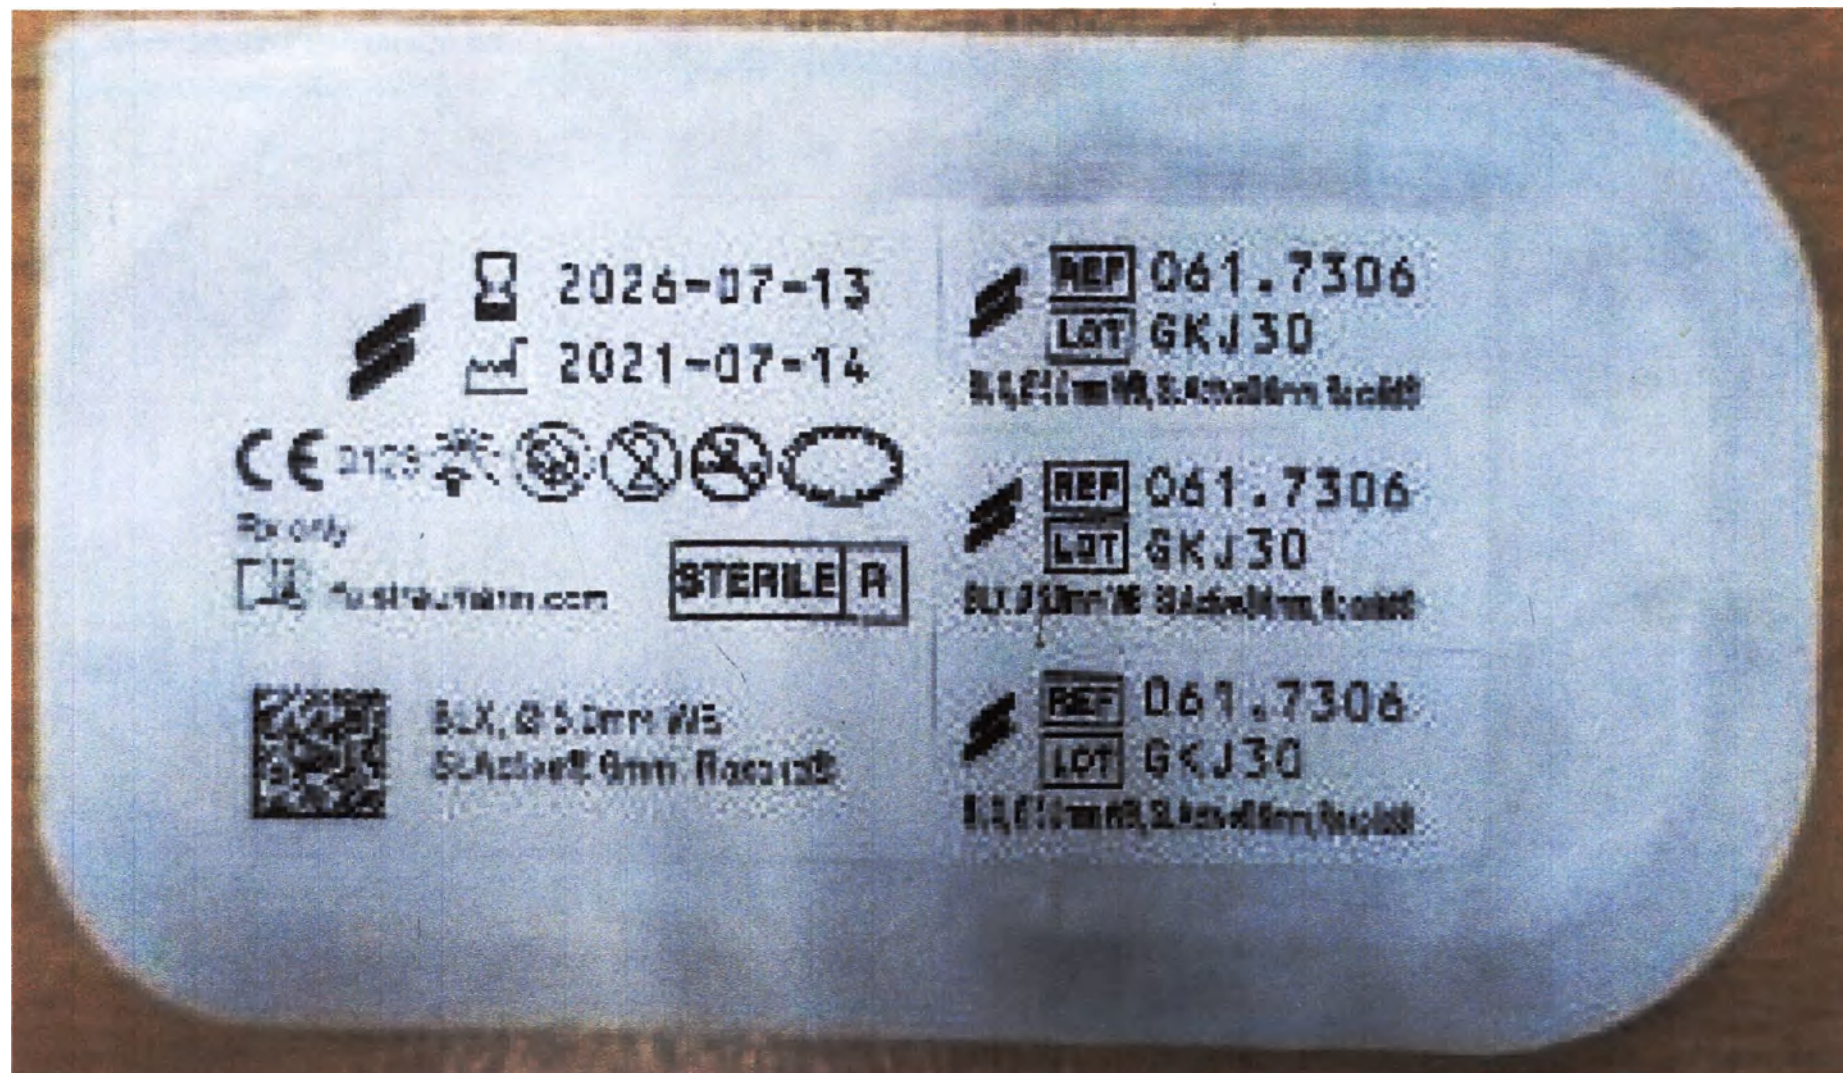


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®

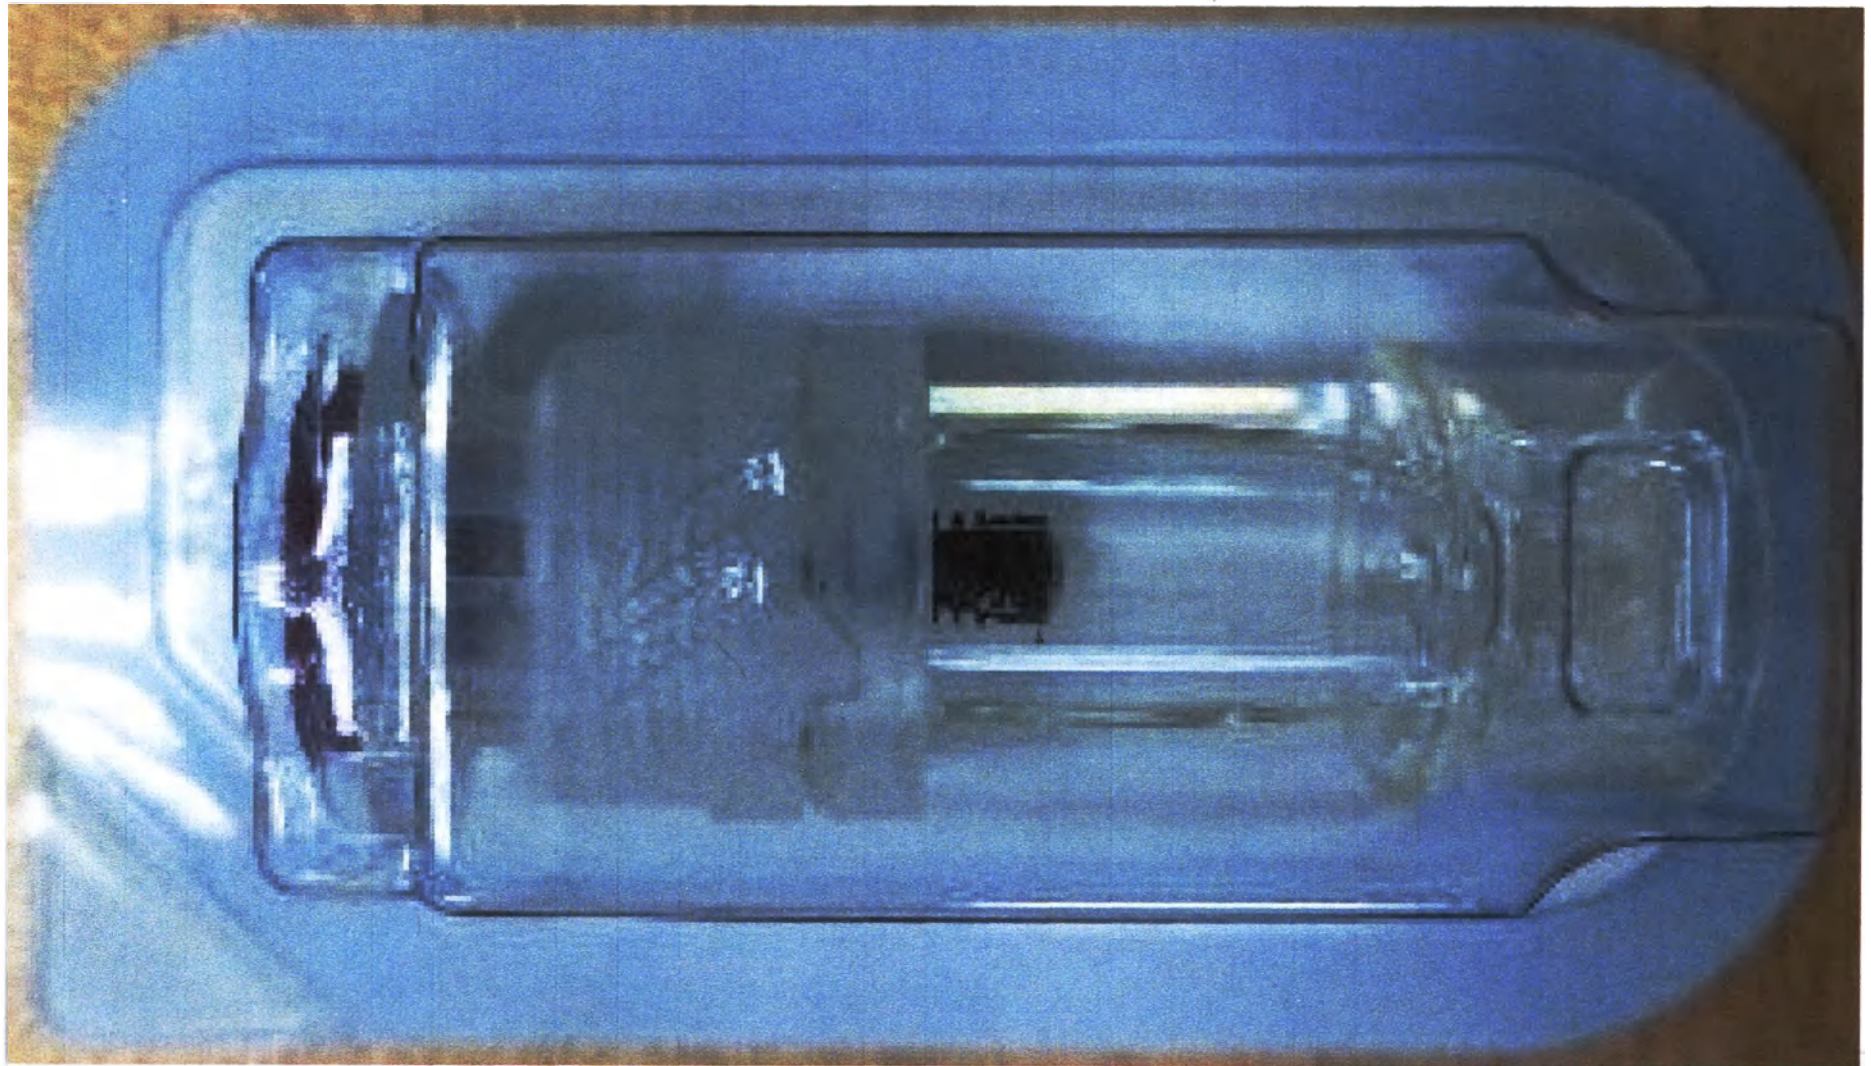


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®

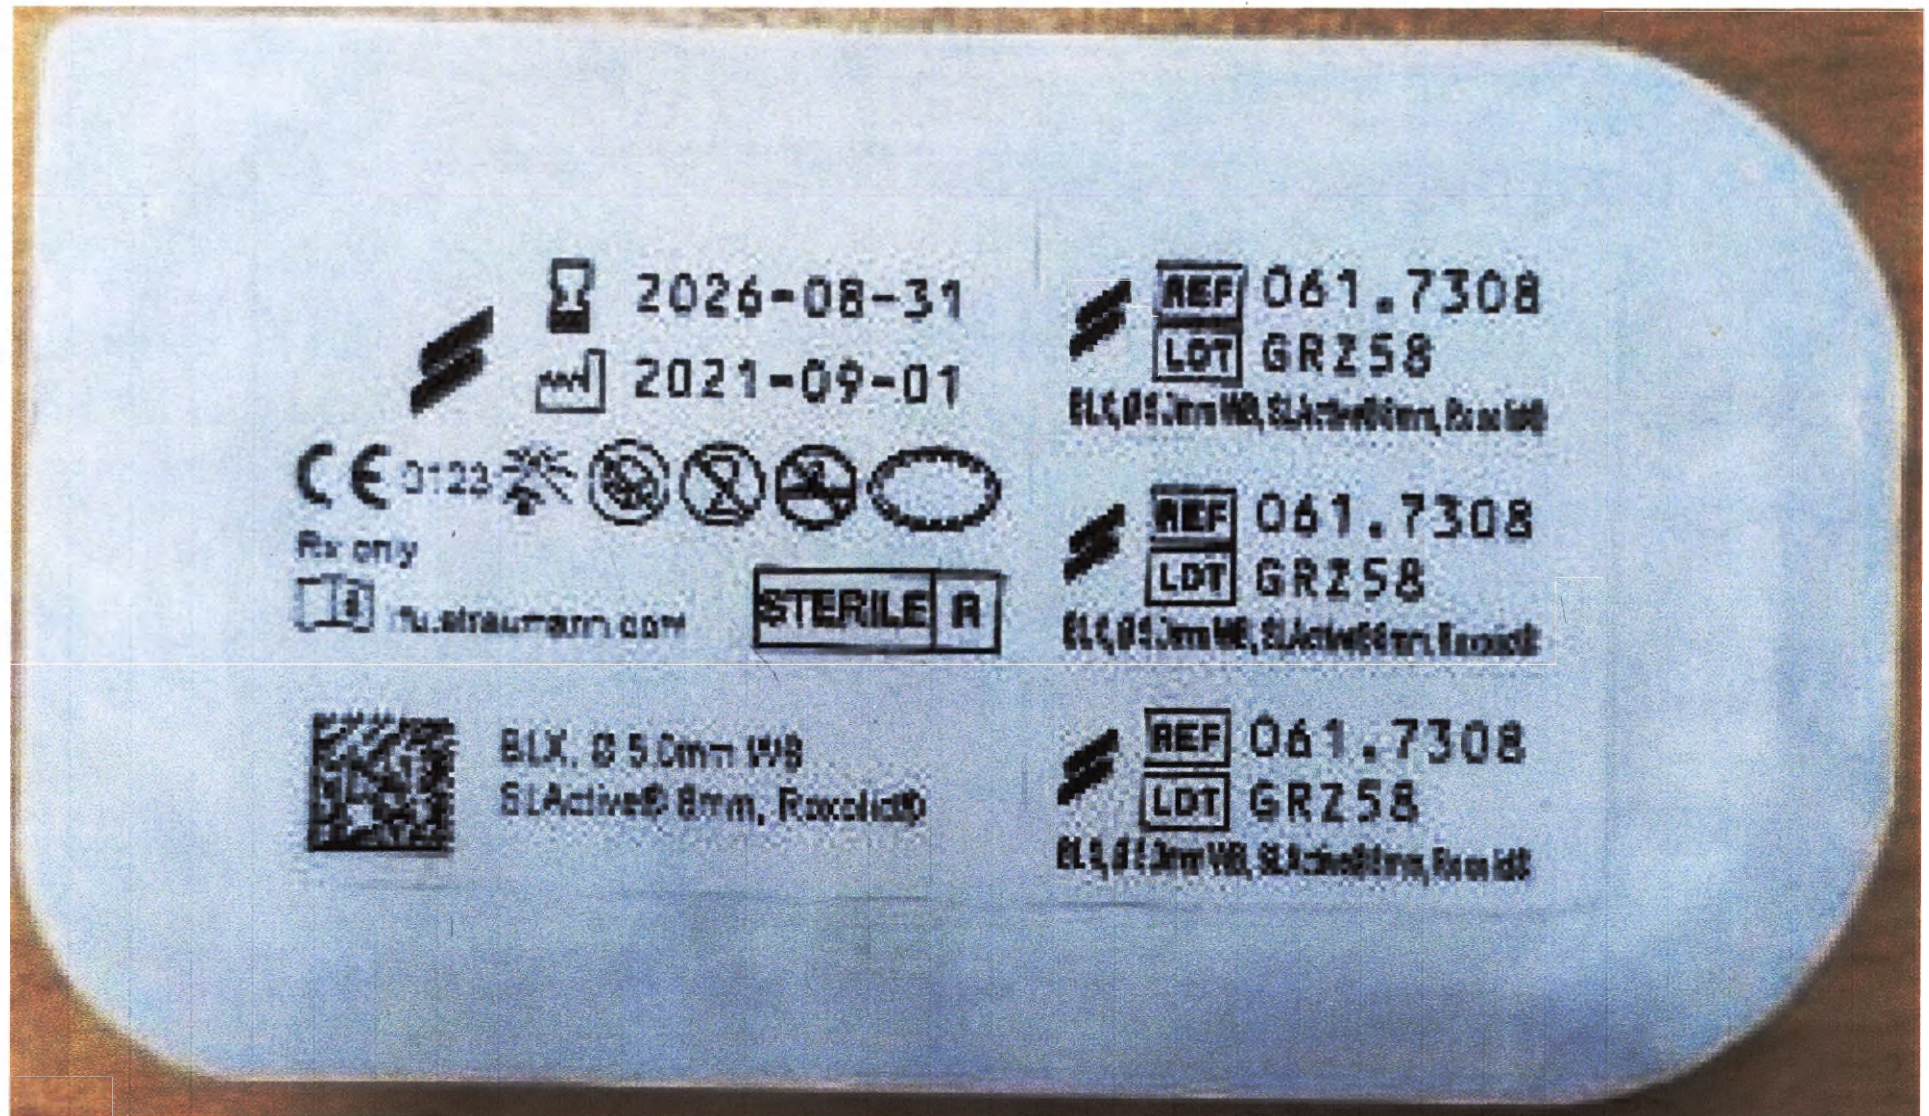


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®

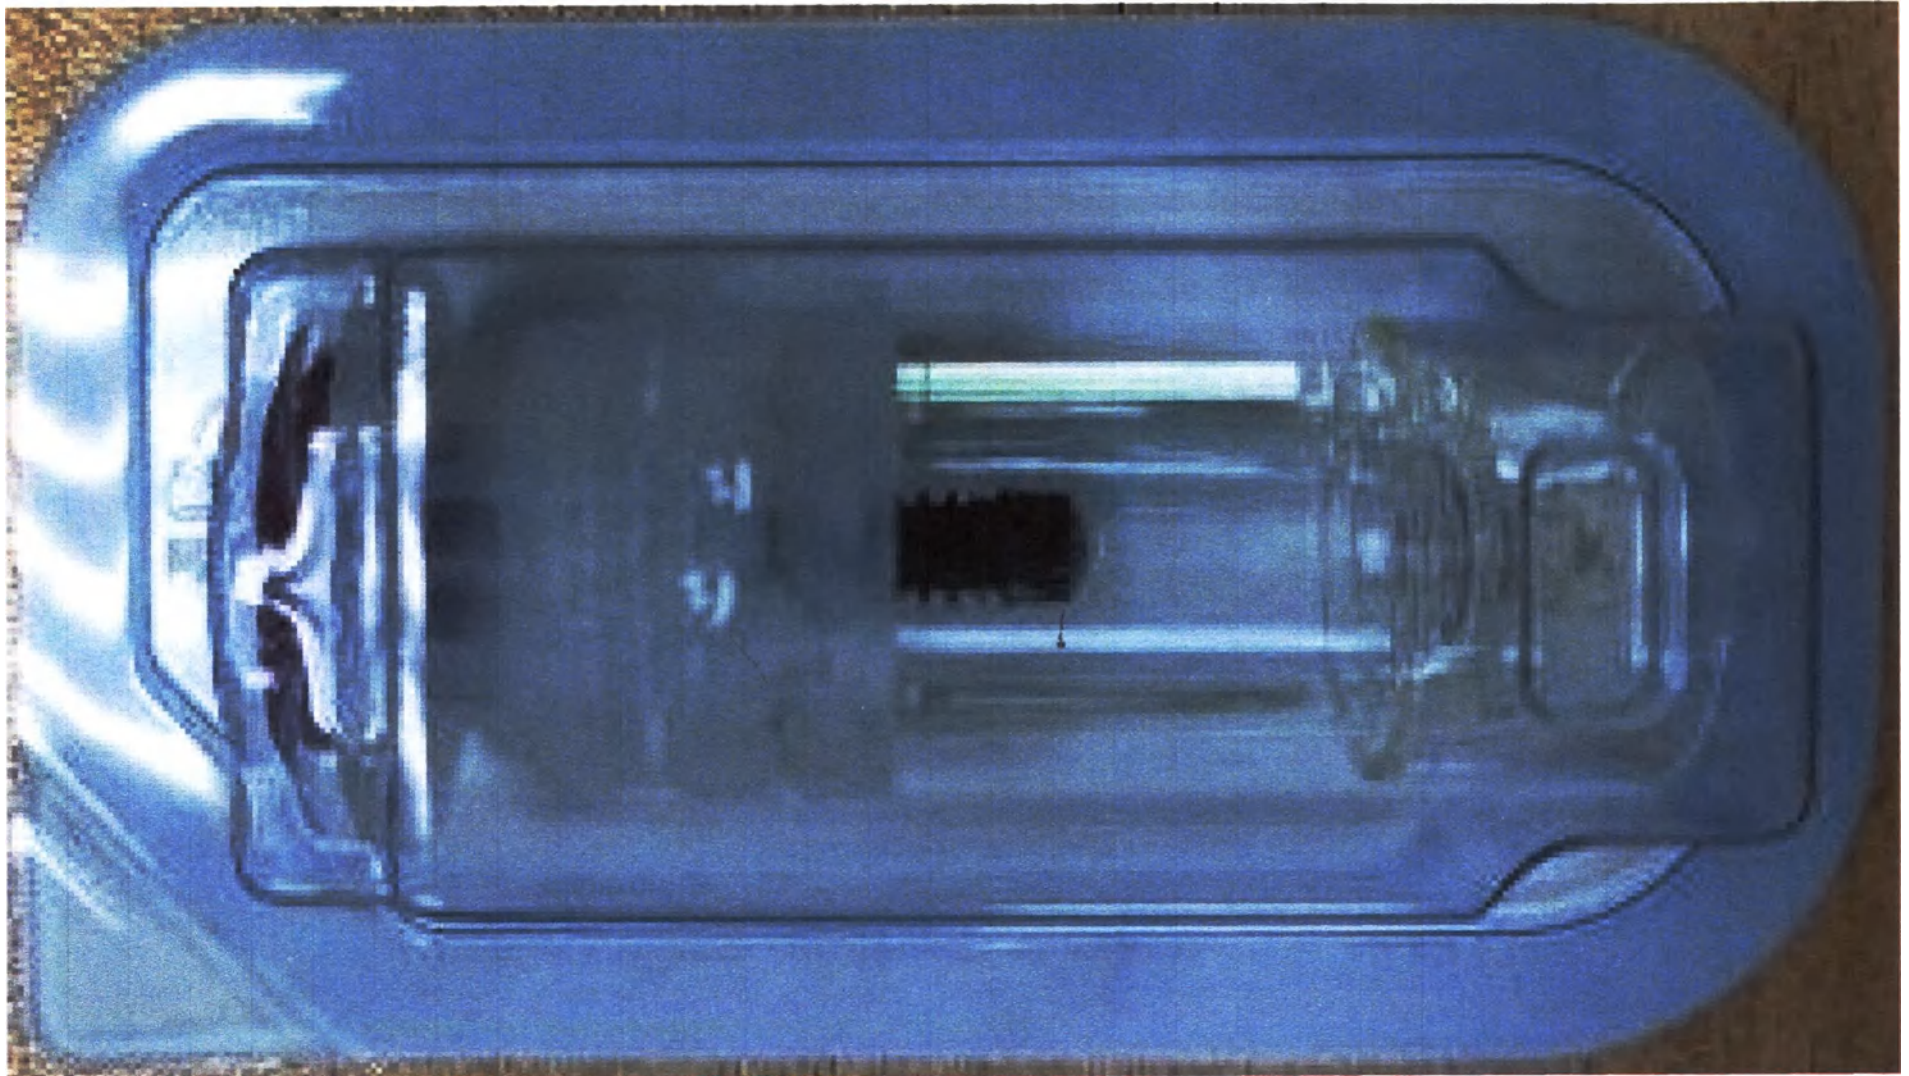

Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 10мм, Roxolid®

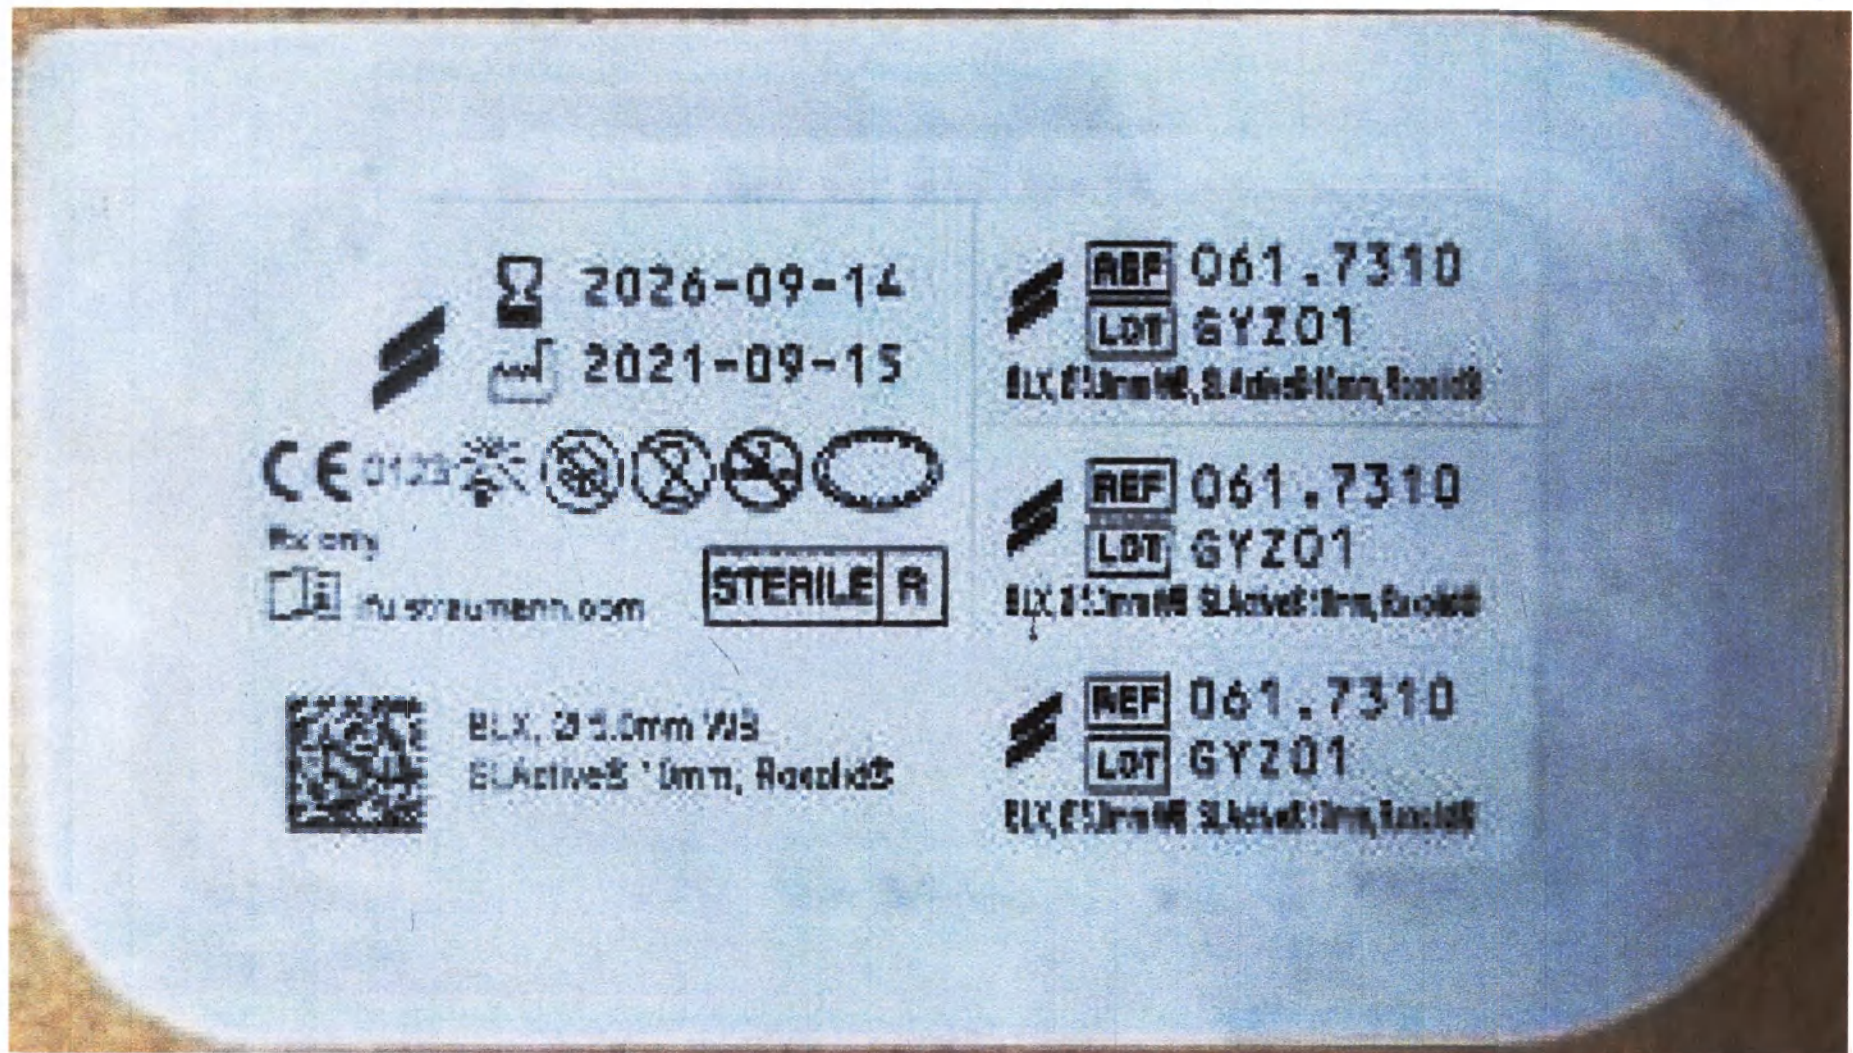


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 10мм, Roxolid®

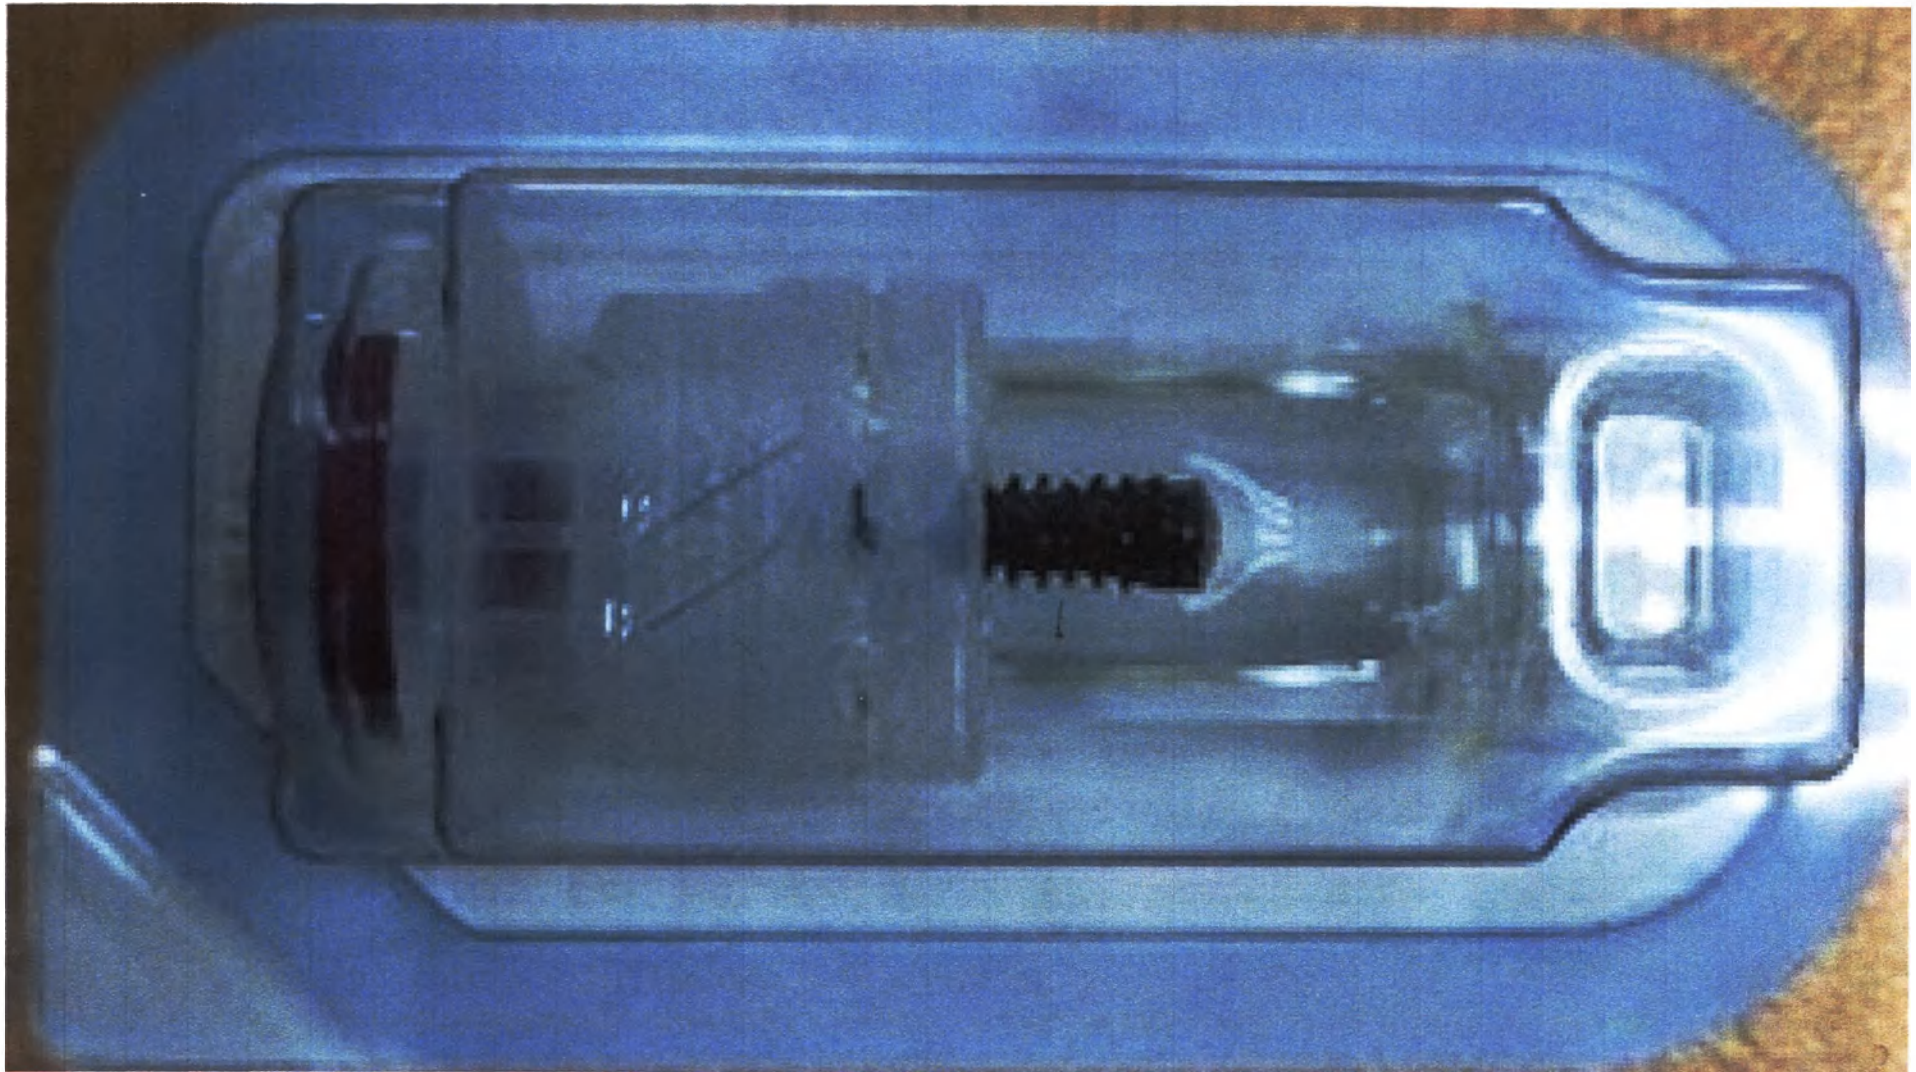


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 12мм, Roxolid®




Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 12мм, Roxolid®

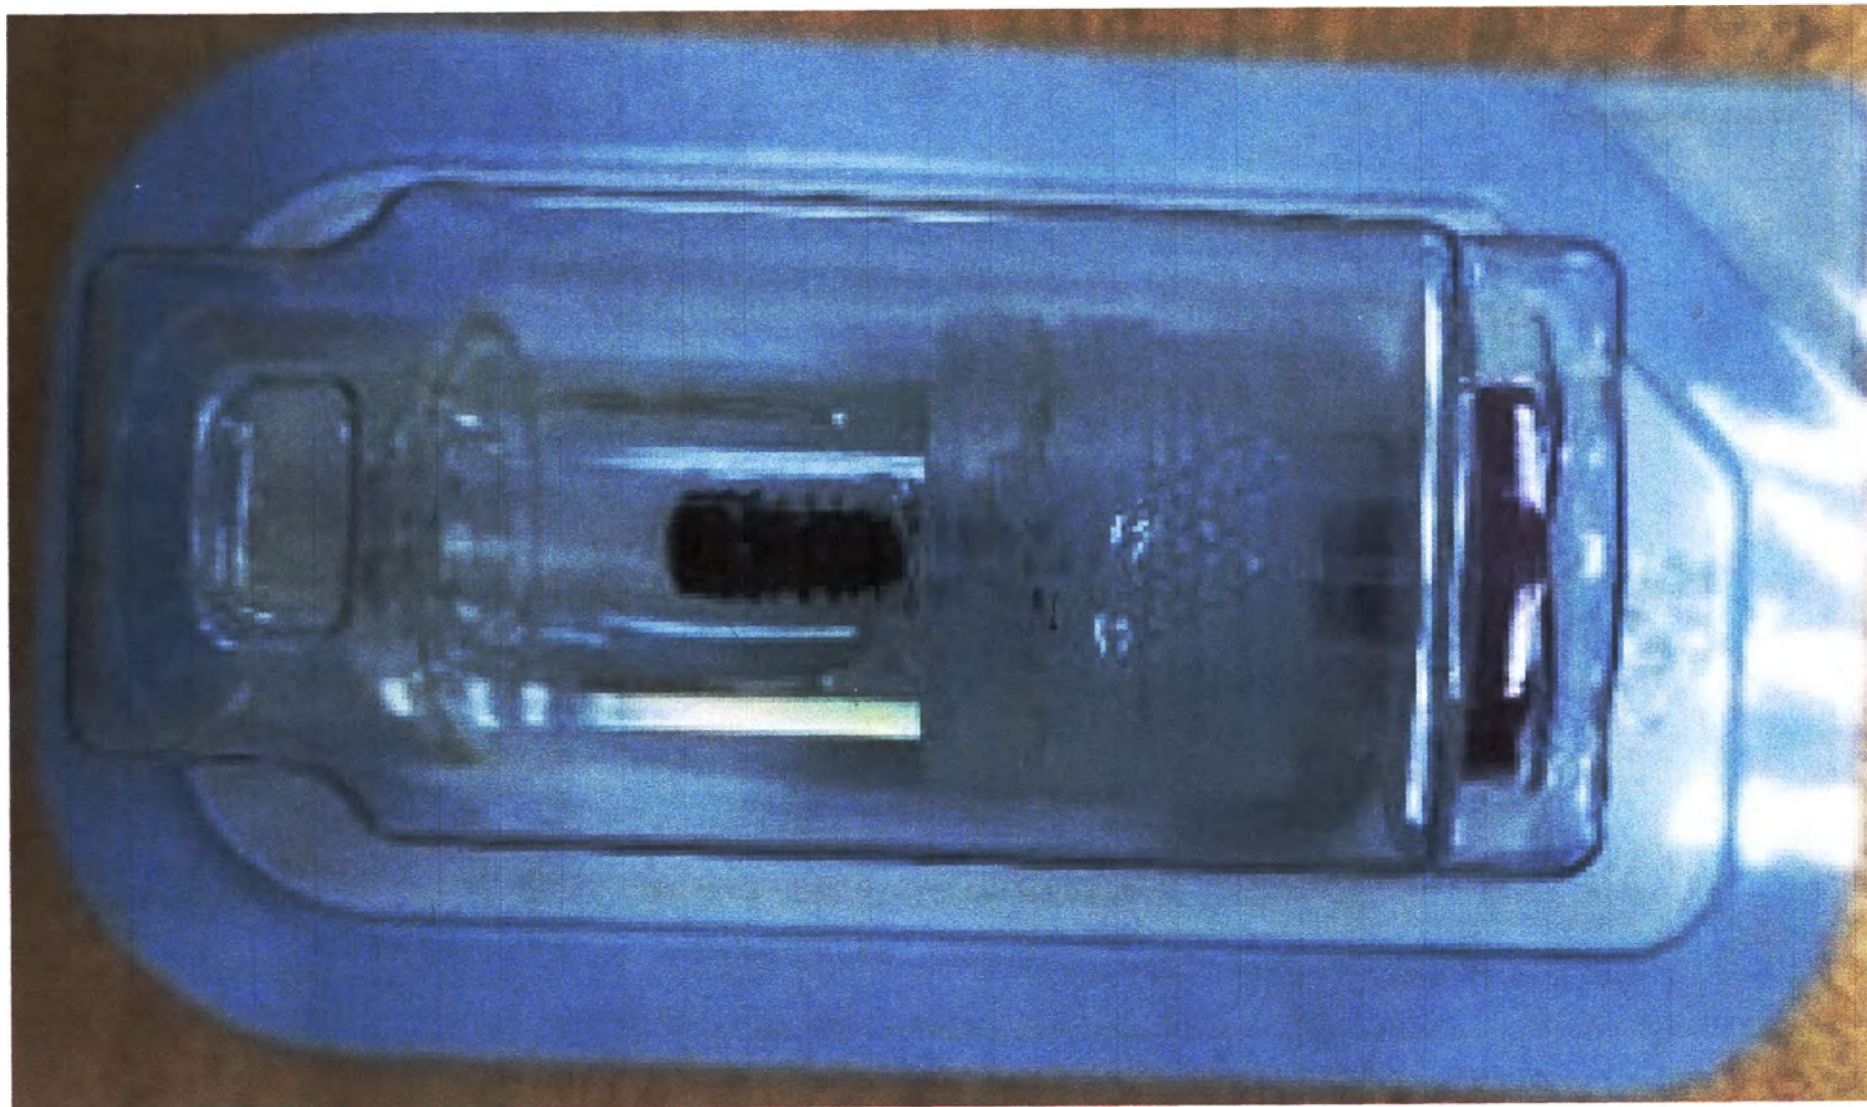


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 14мм, Roxolid®

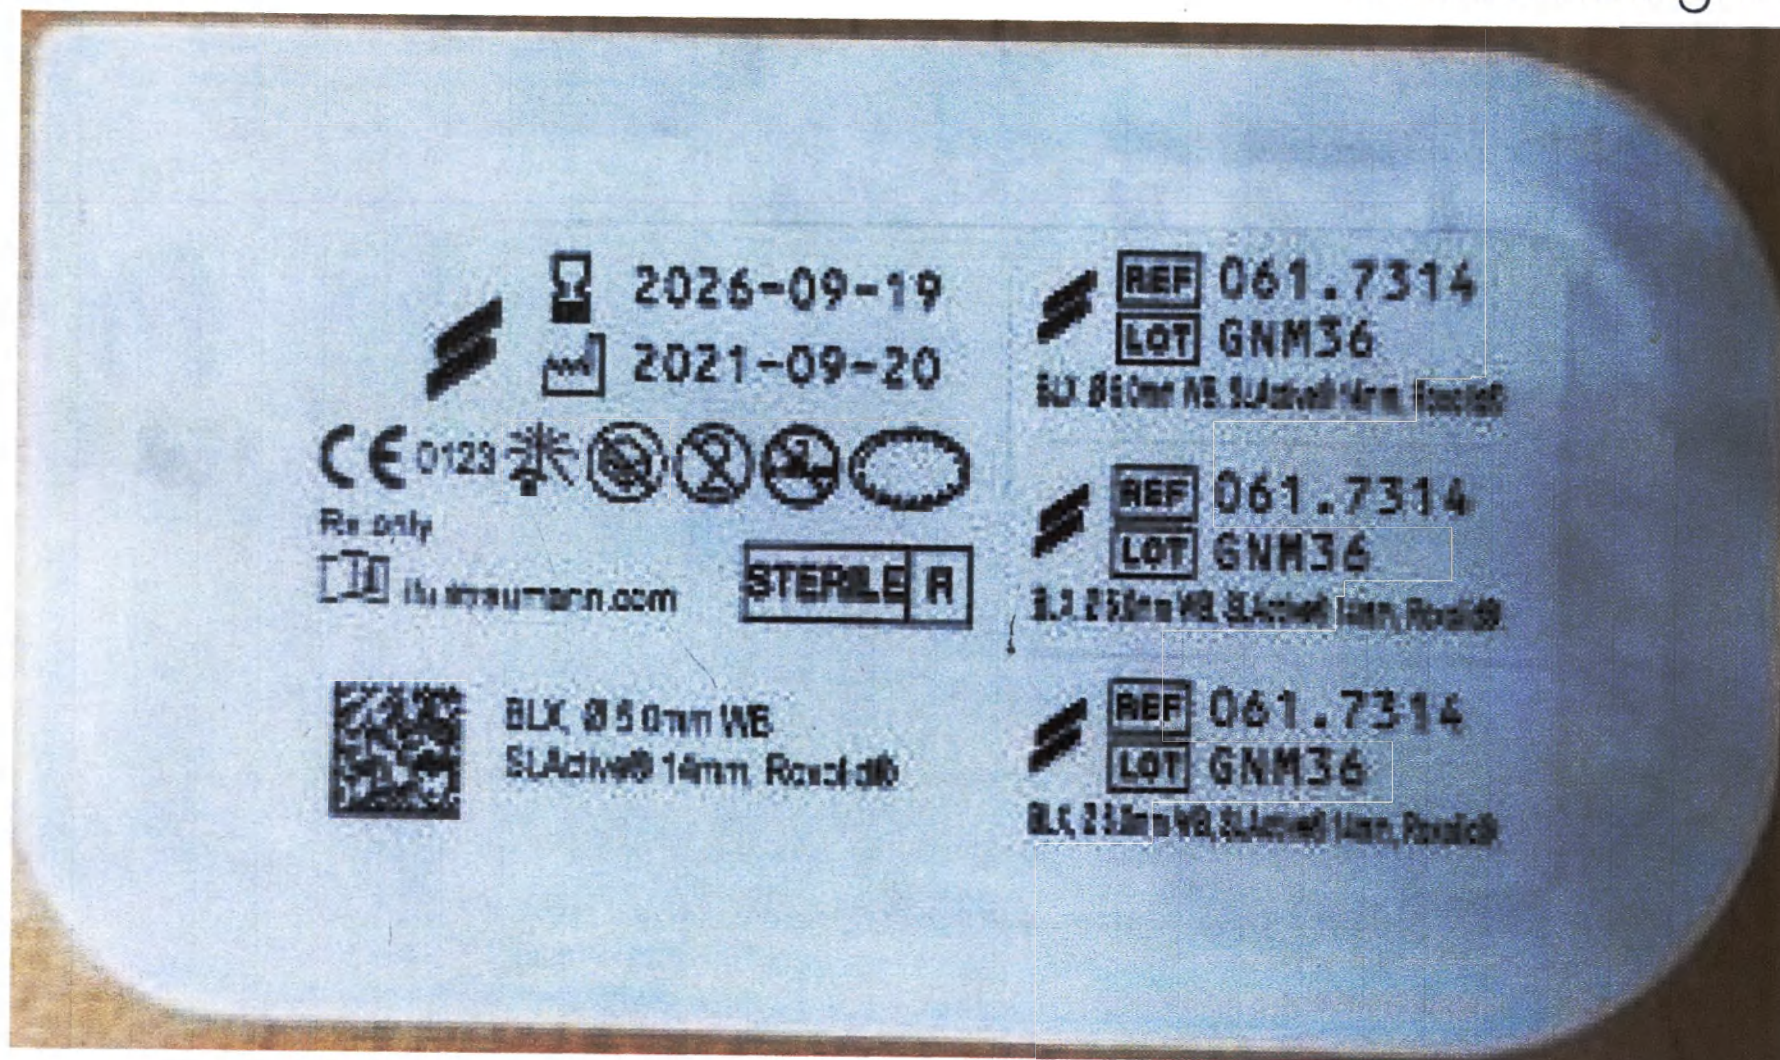


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 14мм, Roxolid®

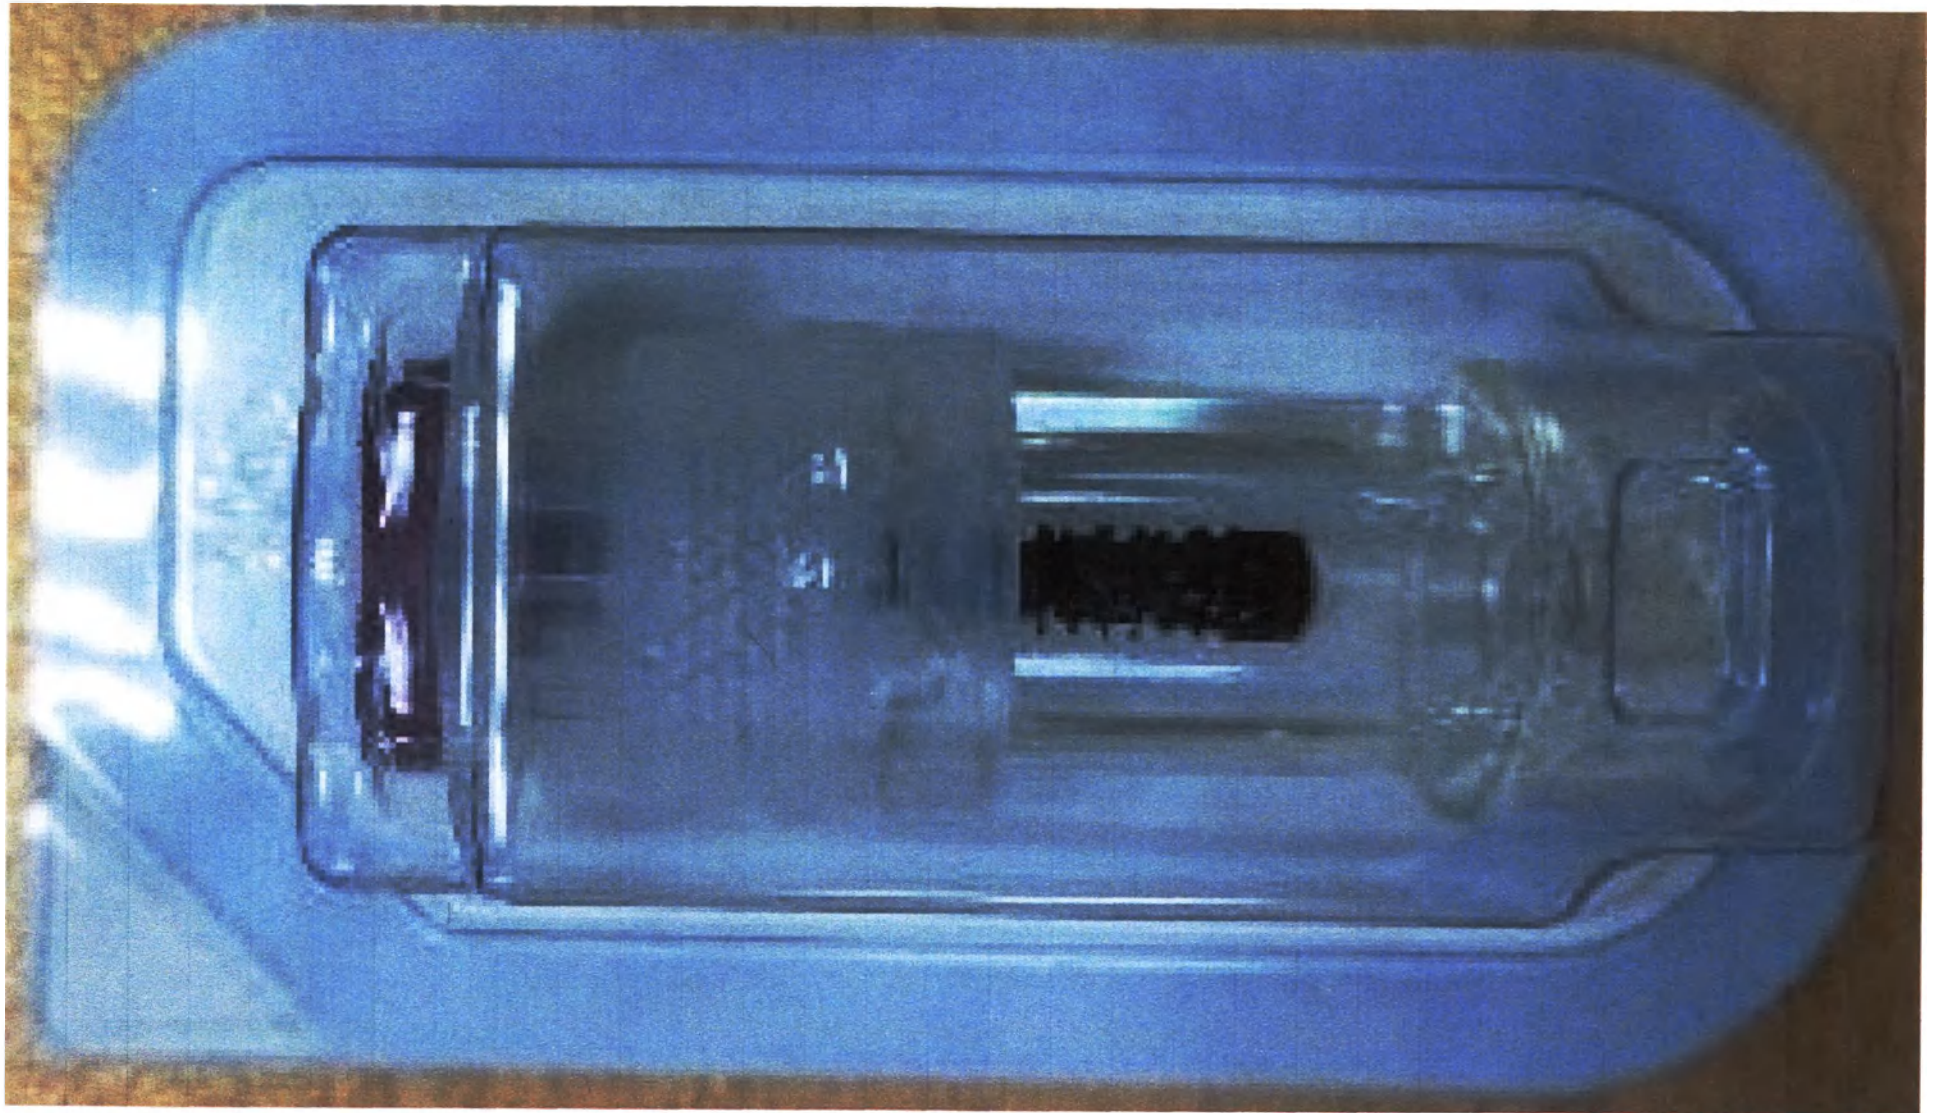


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 16мм, Roxolid®

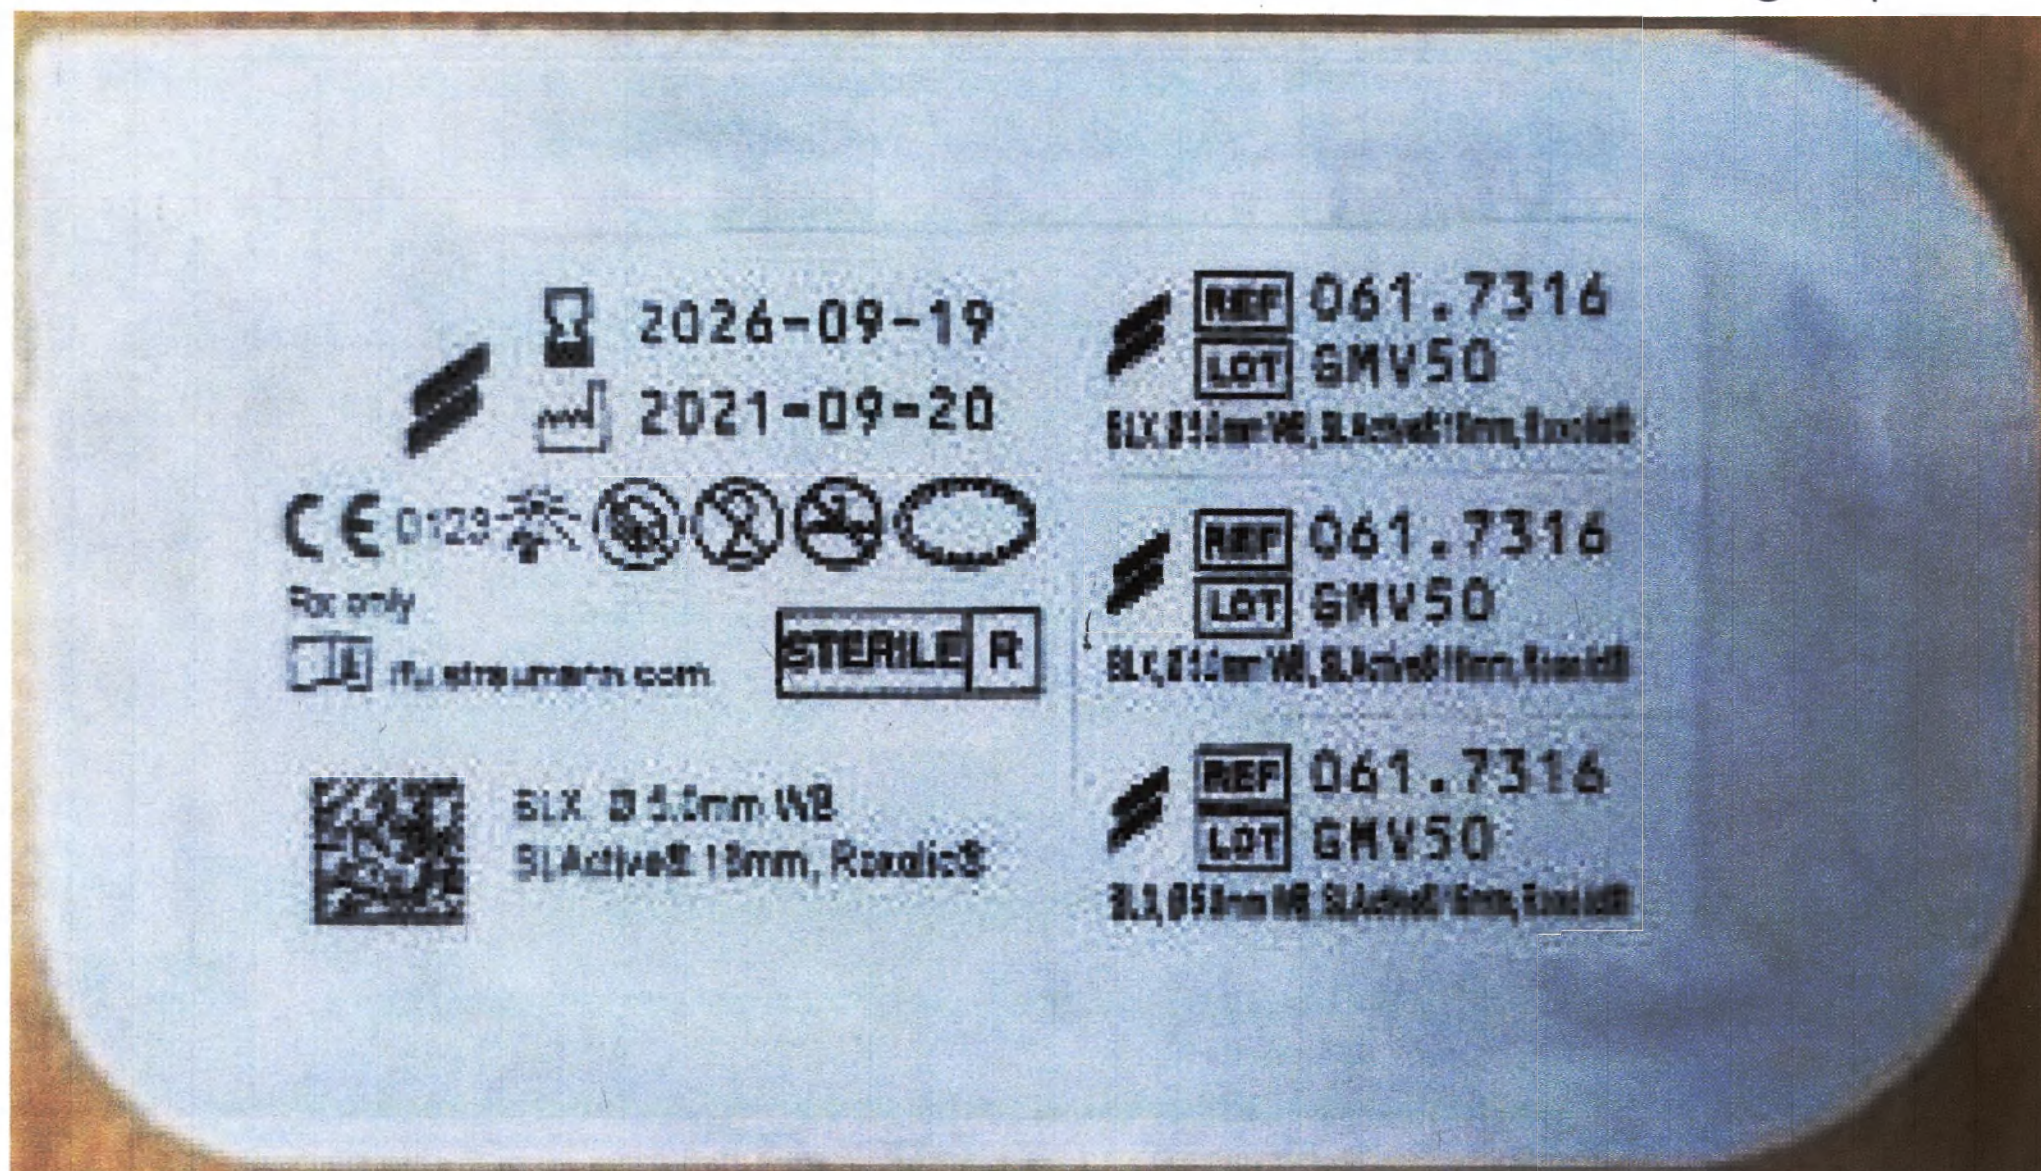


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 16мм, Roxolid®

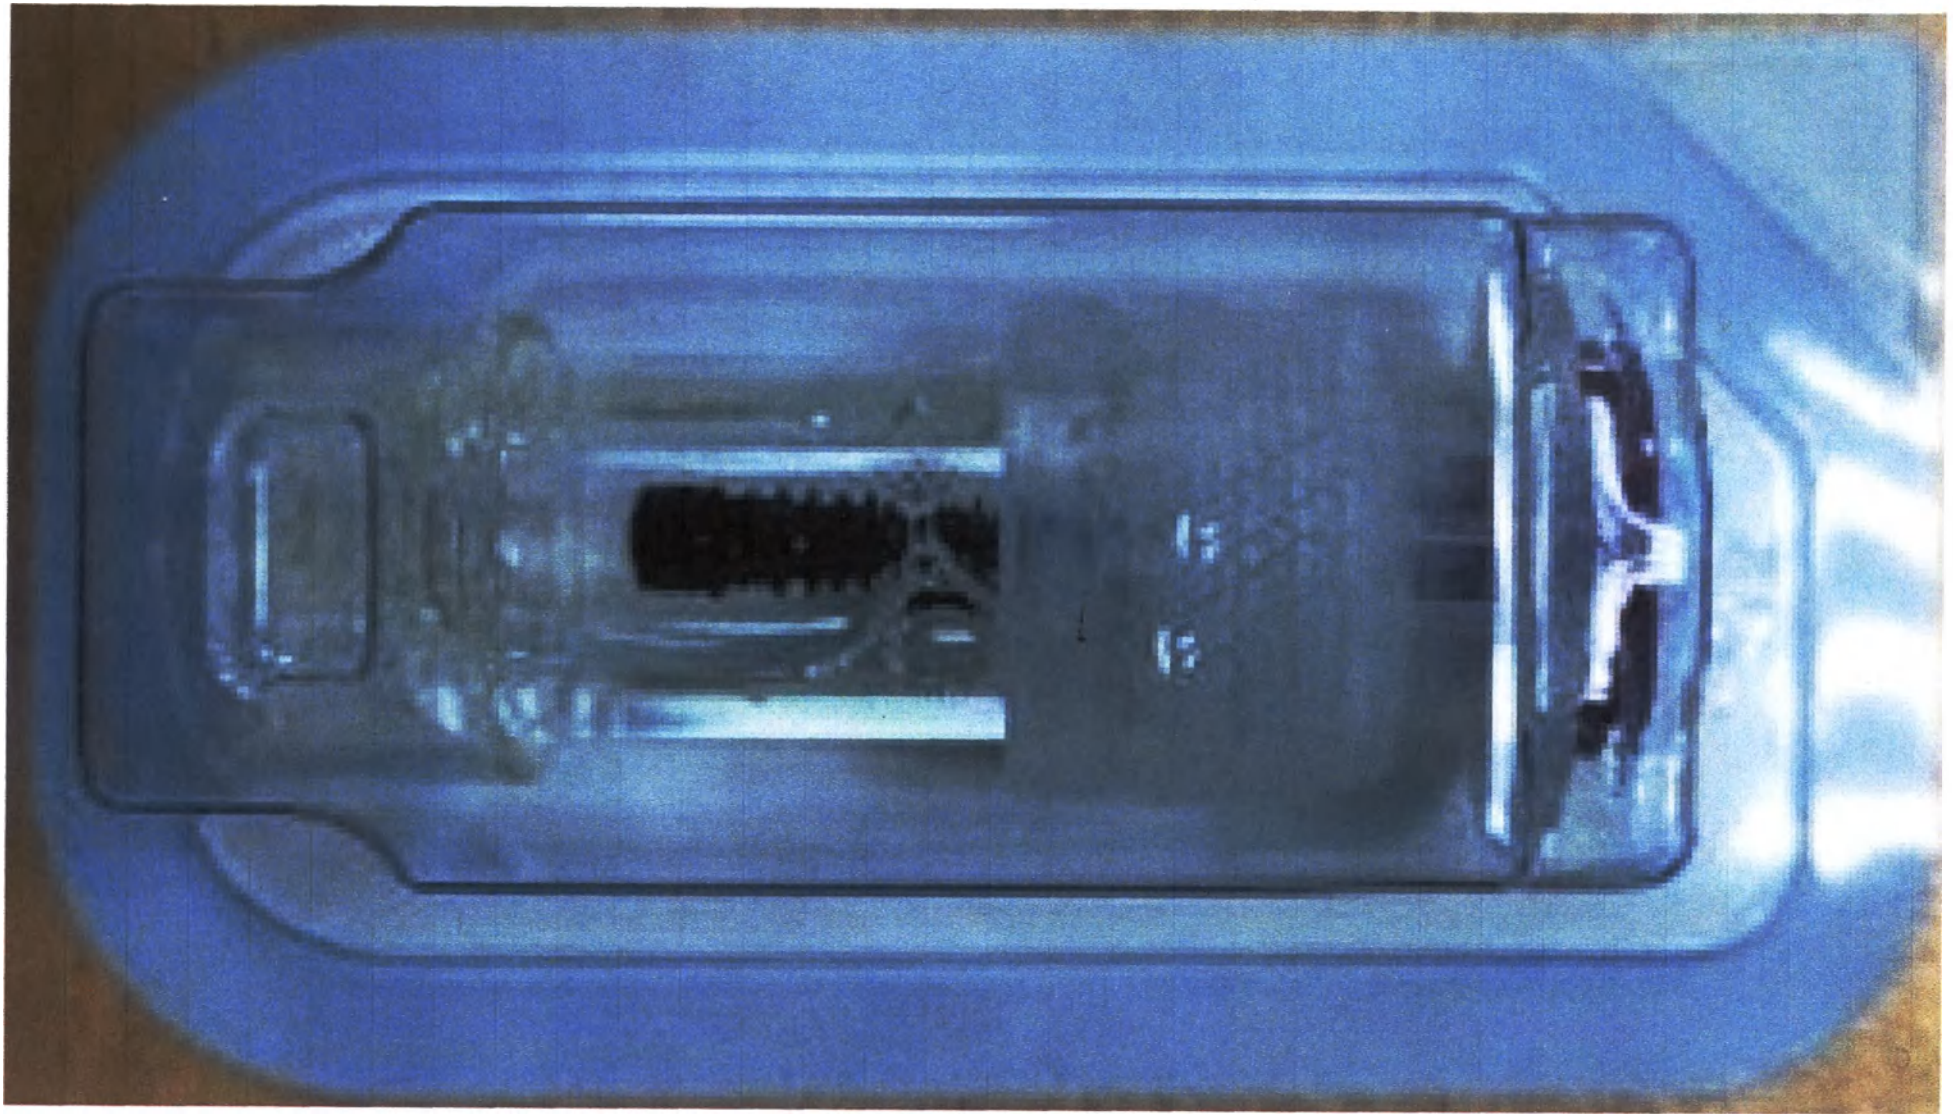


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 18мм, Roxolid®

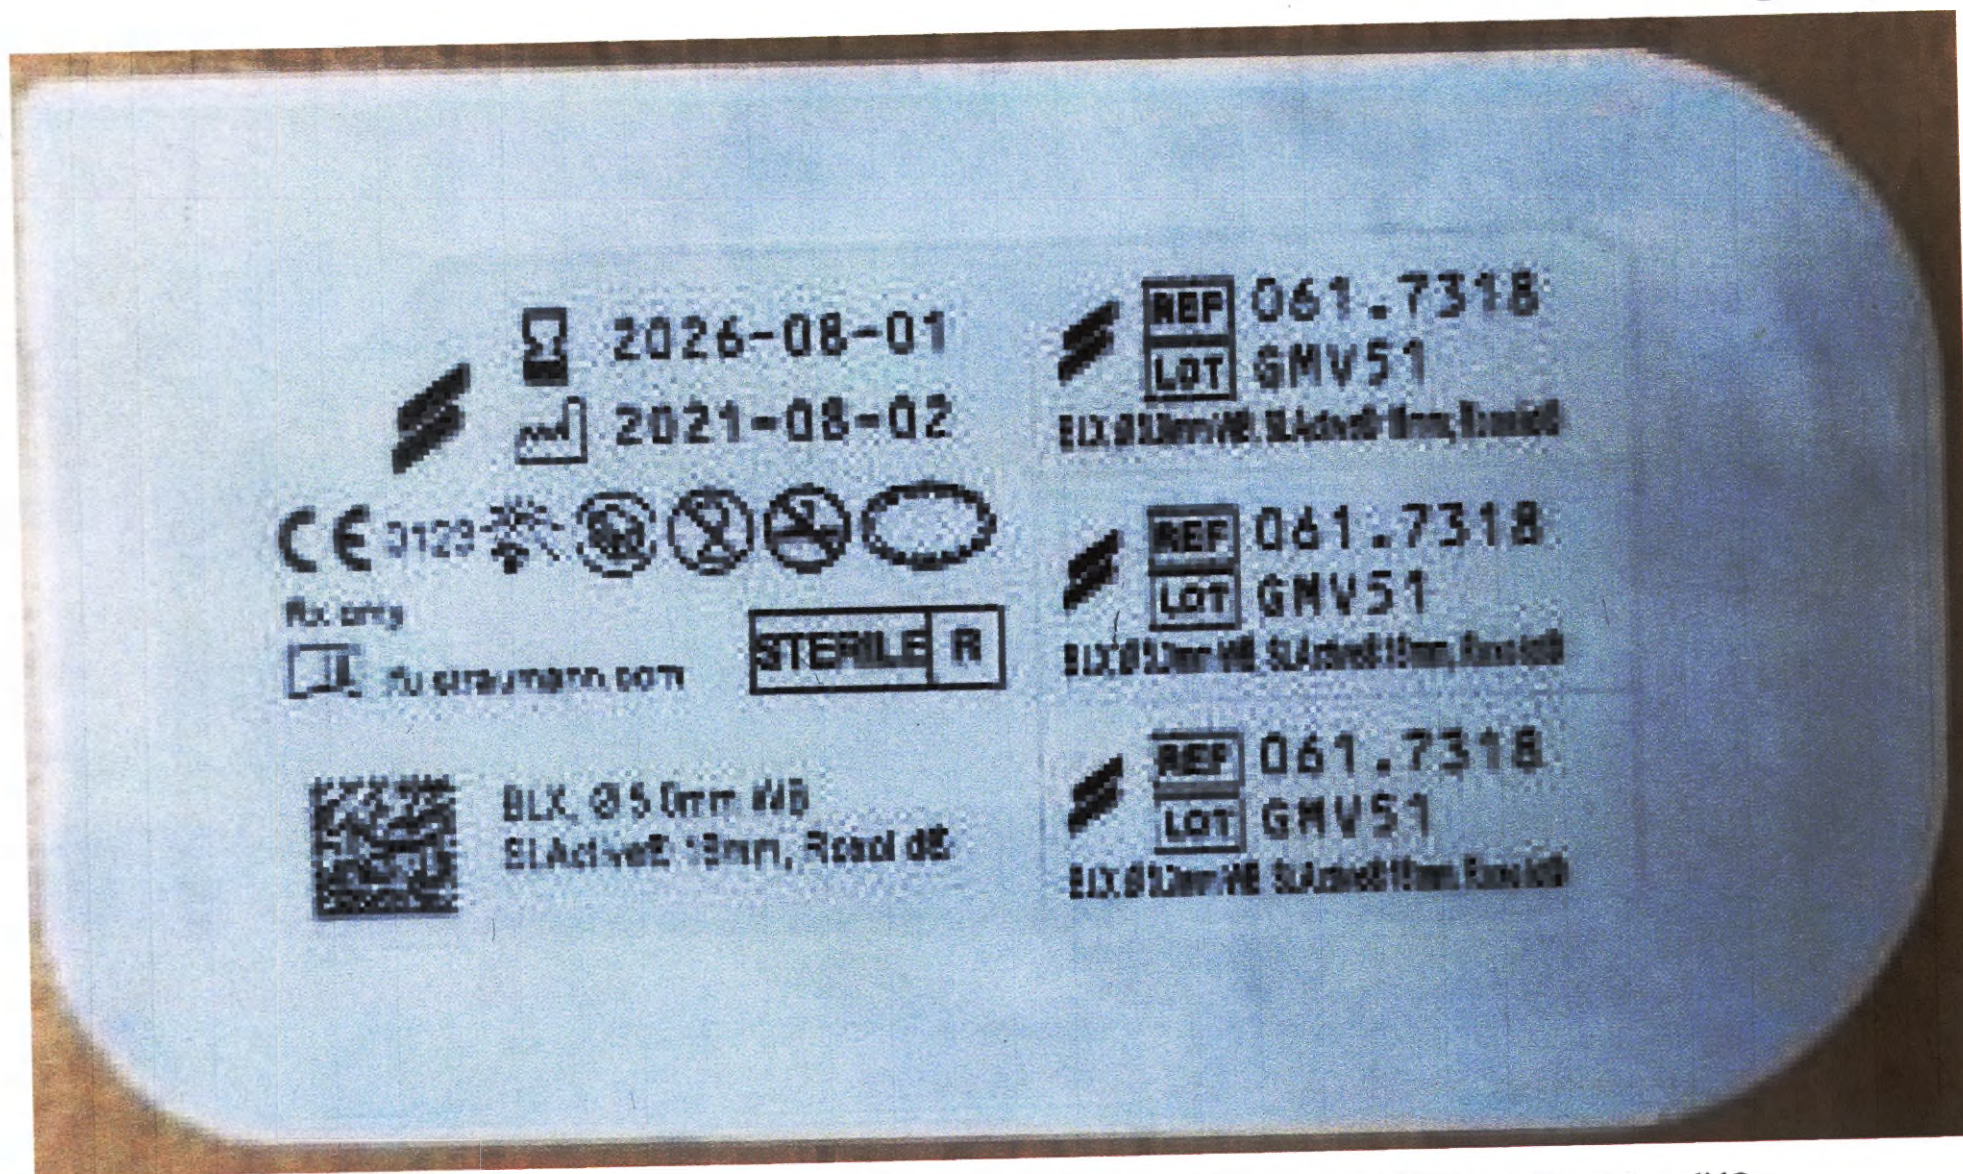


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 18мм, Roxolid®

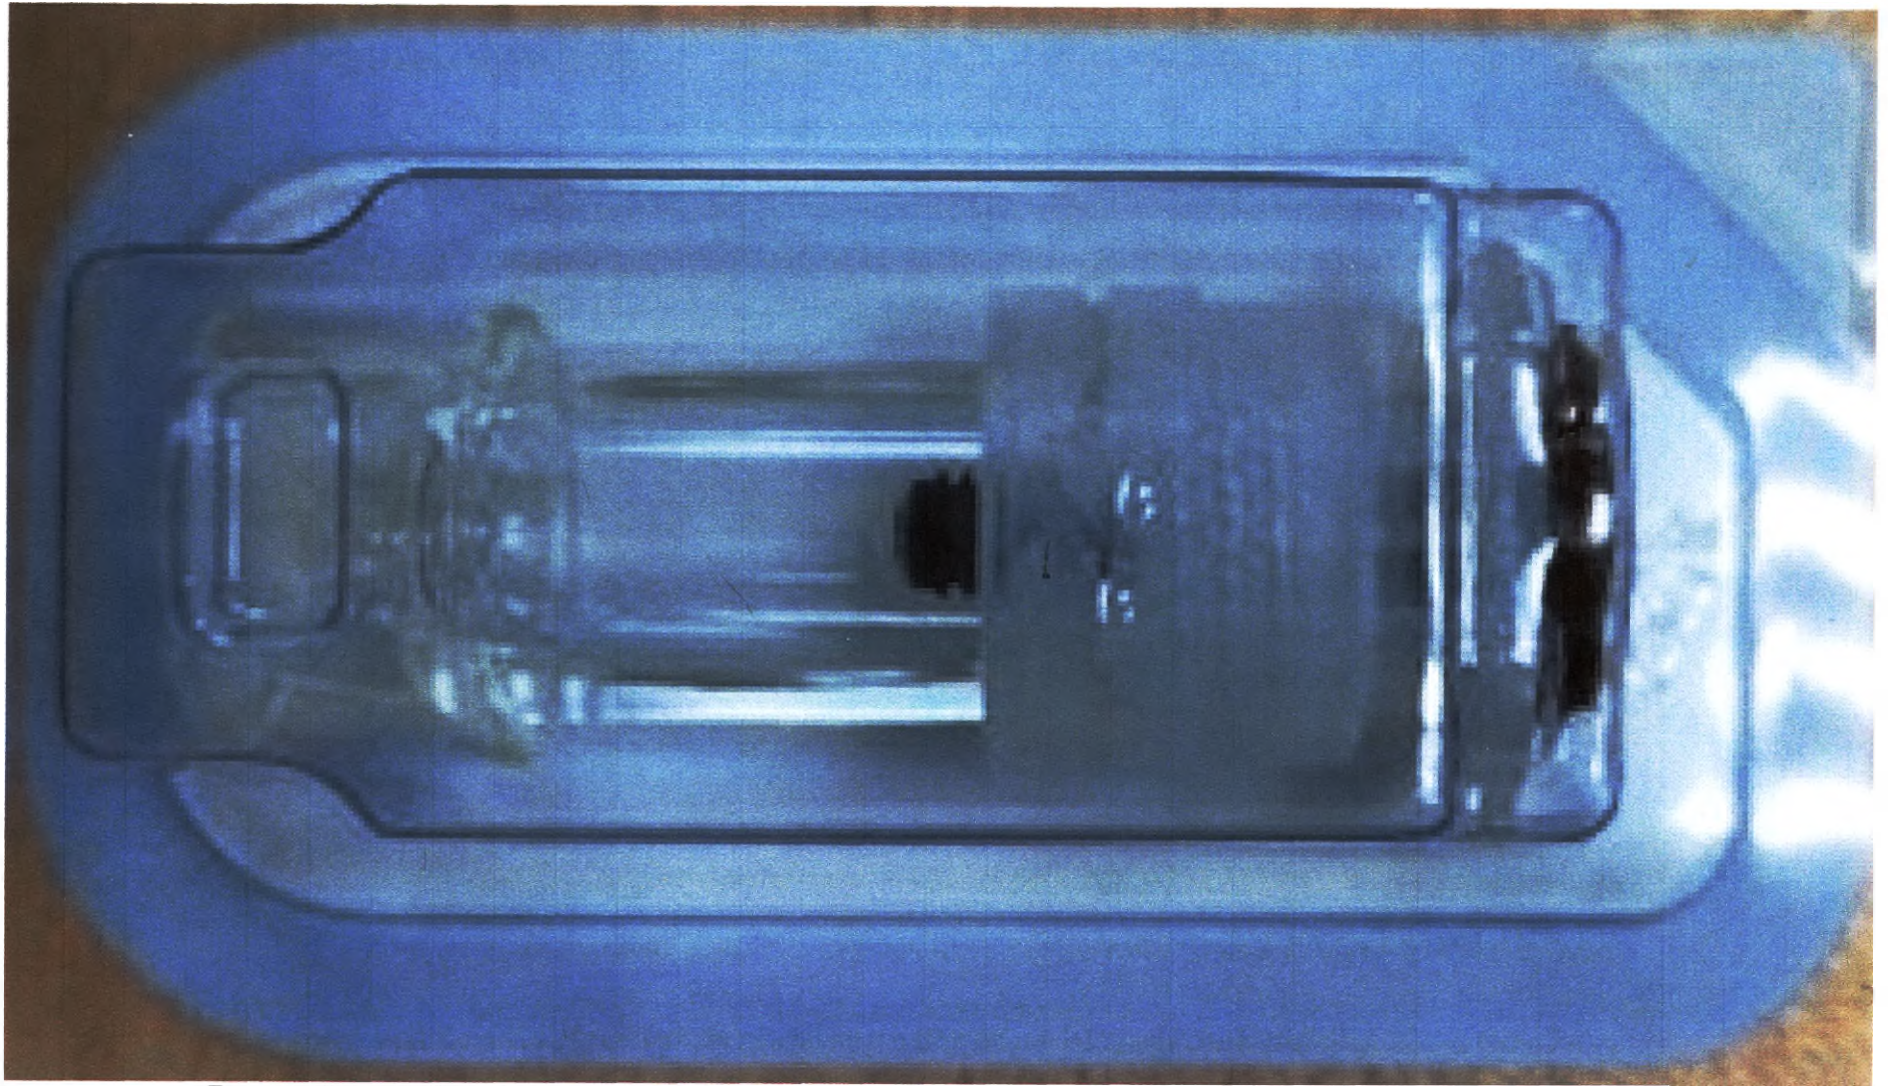


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®

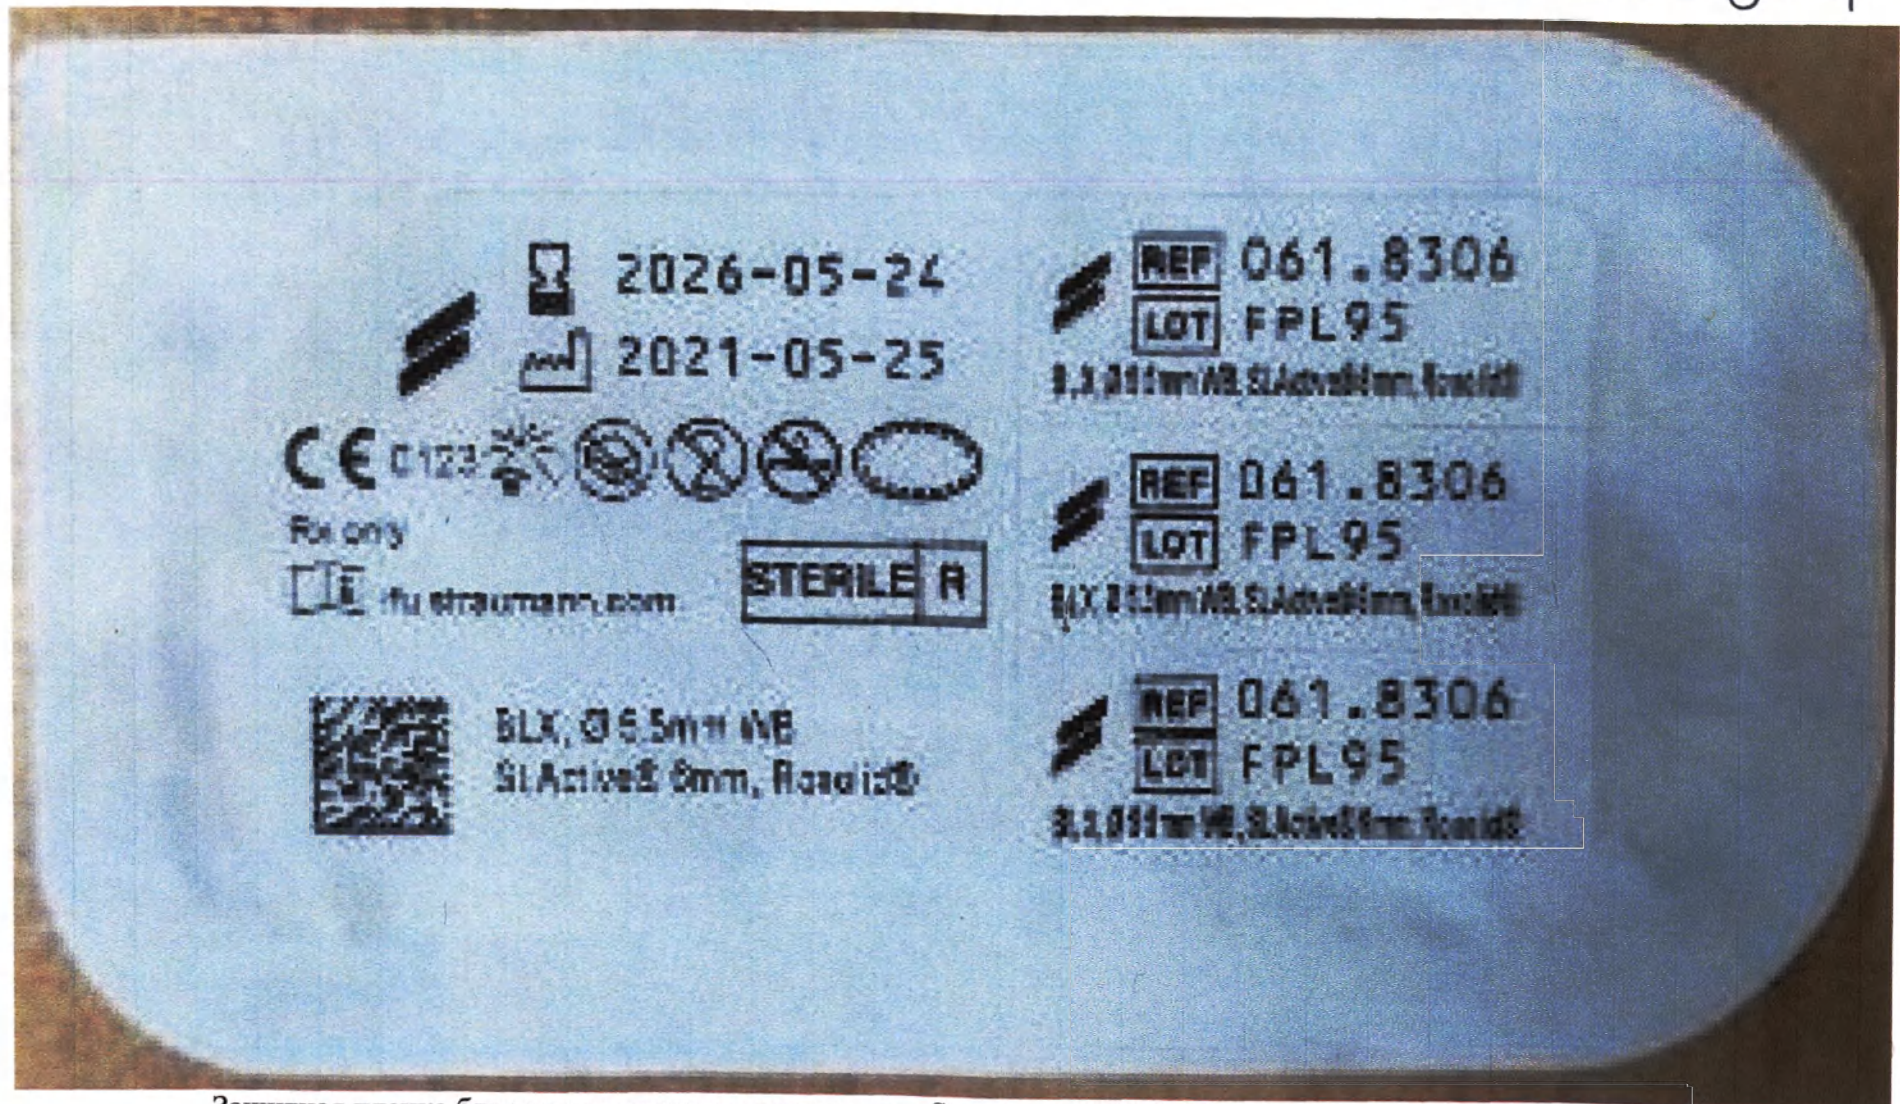


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®

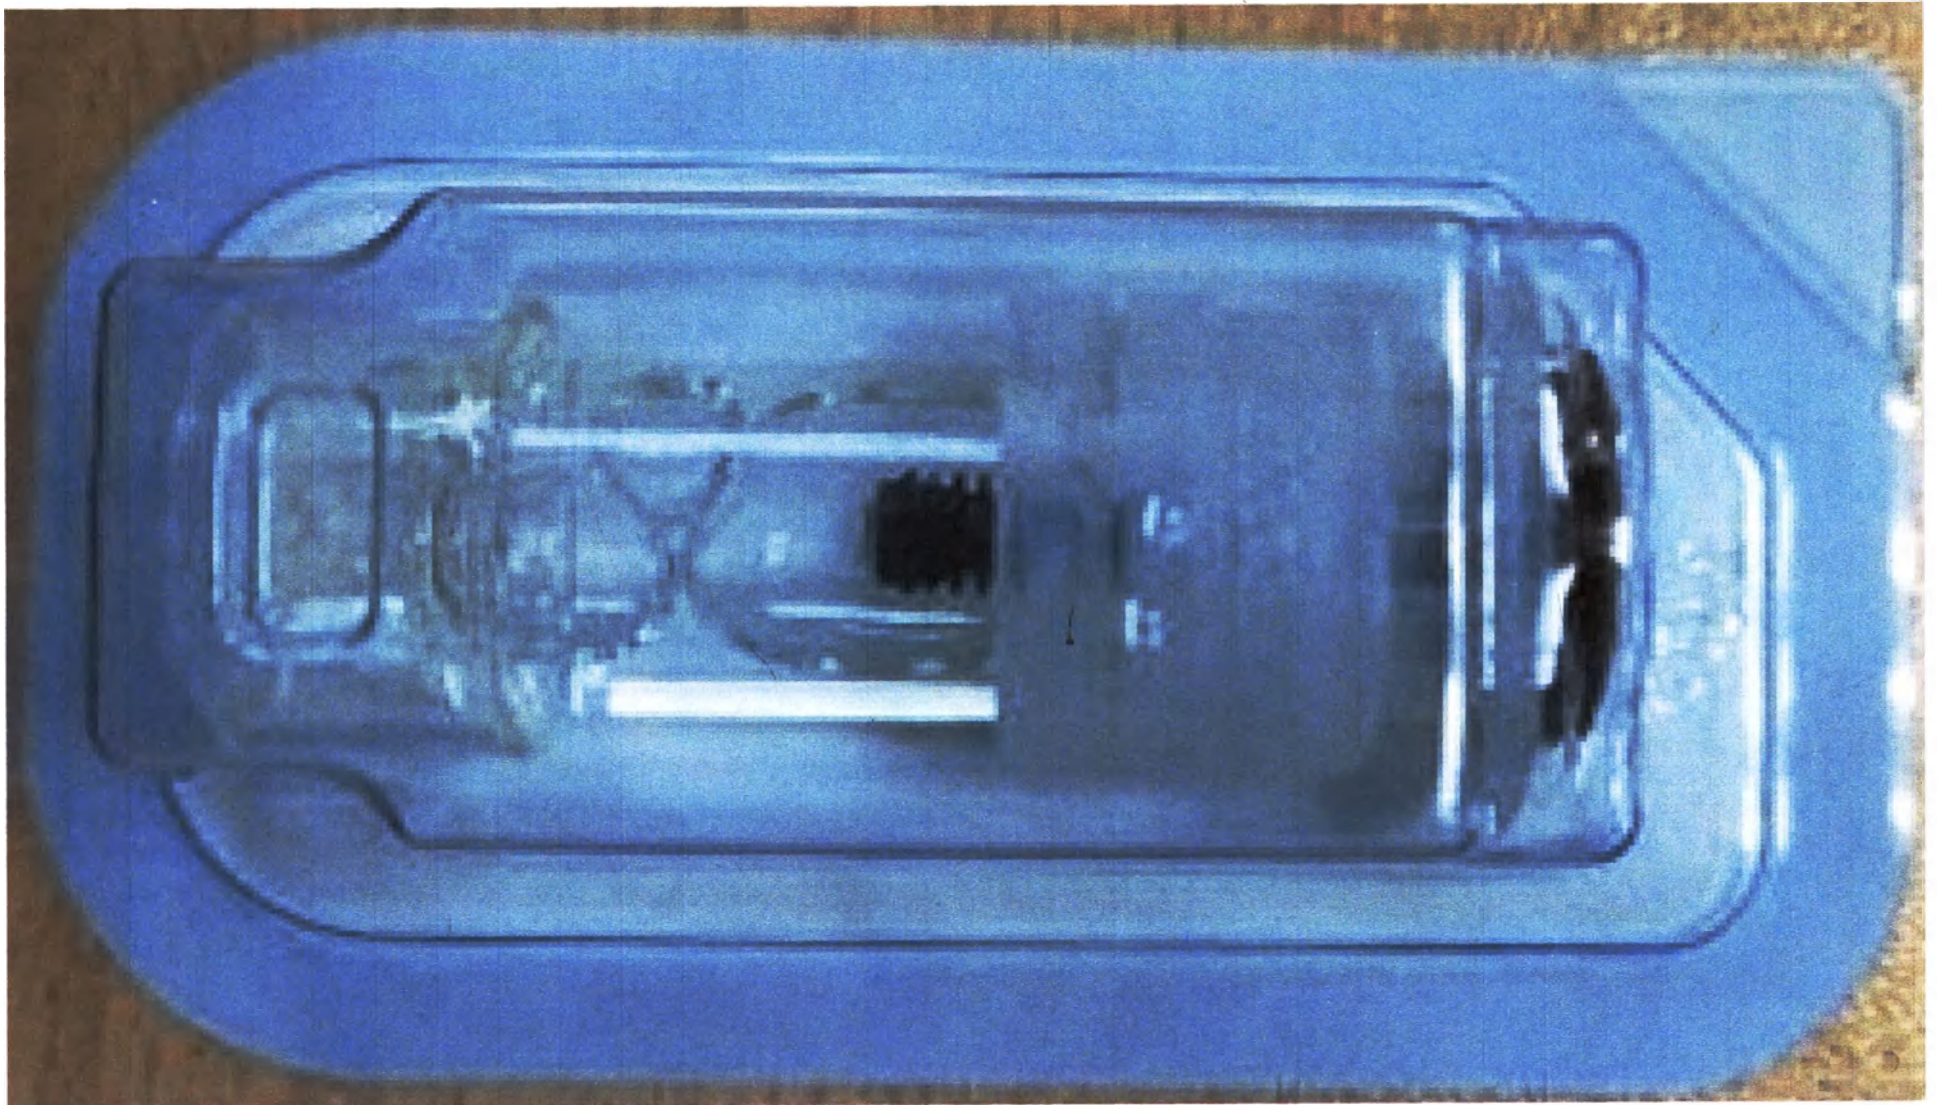


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®

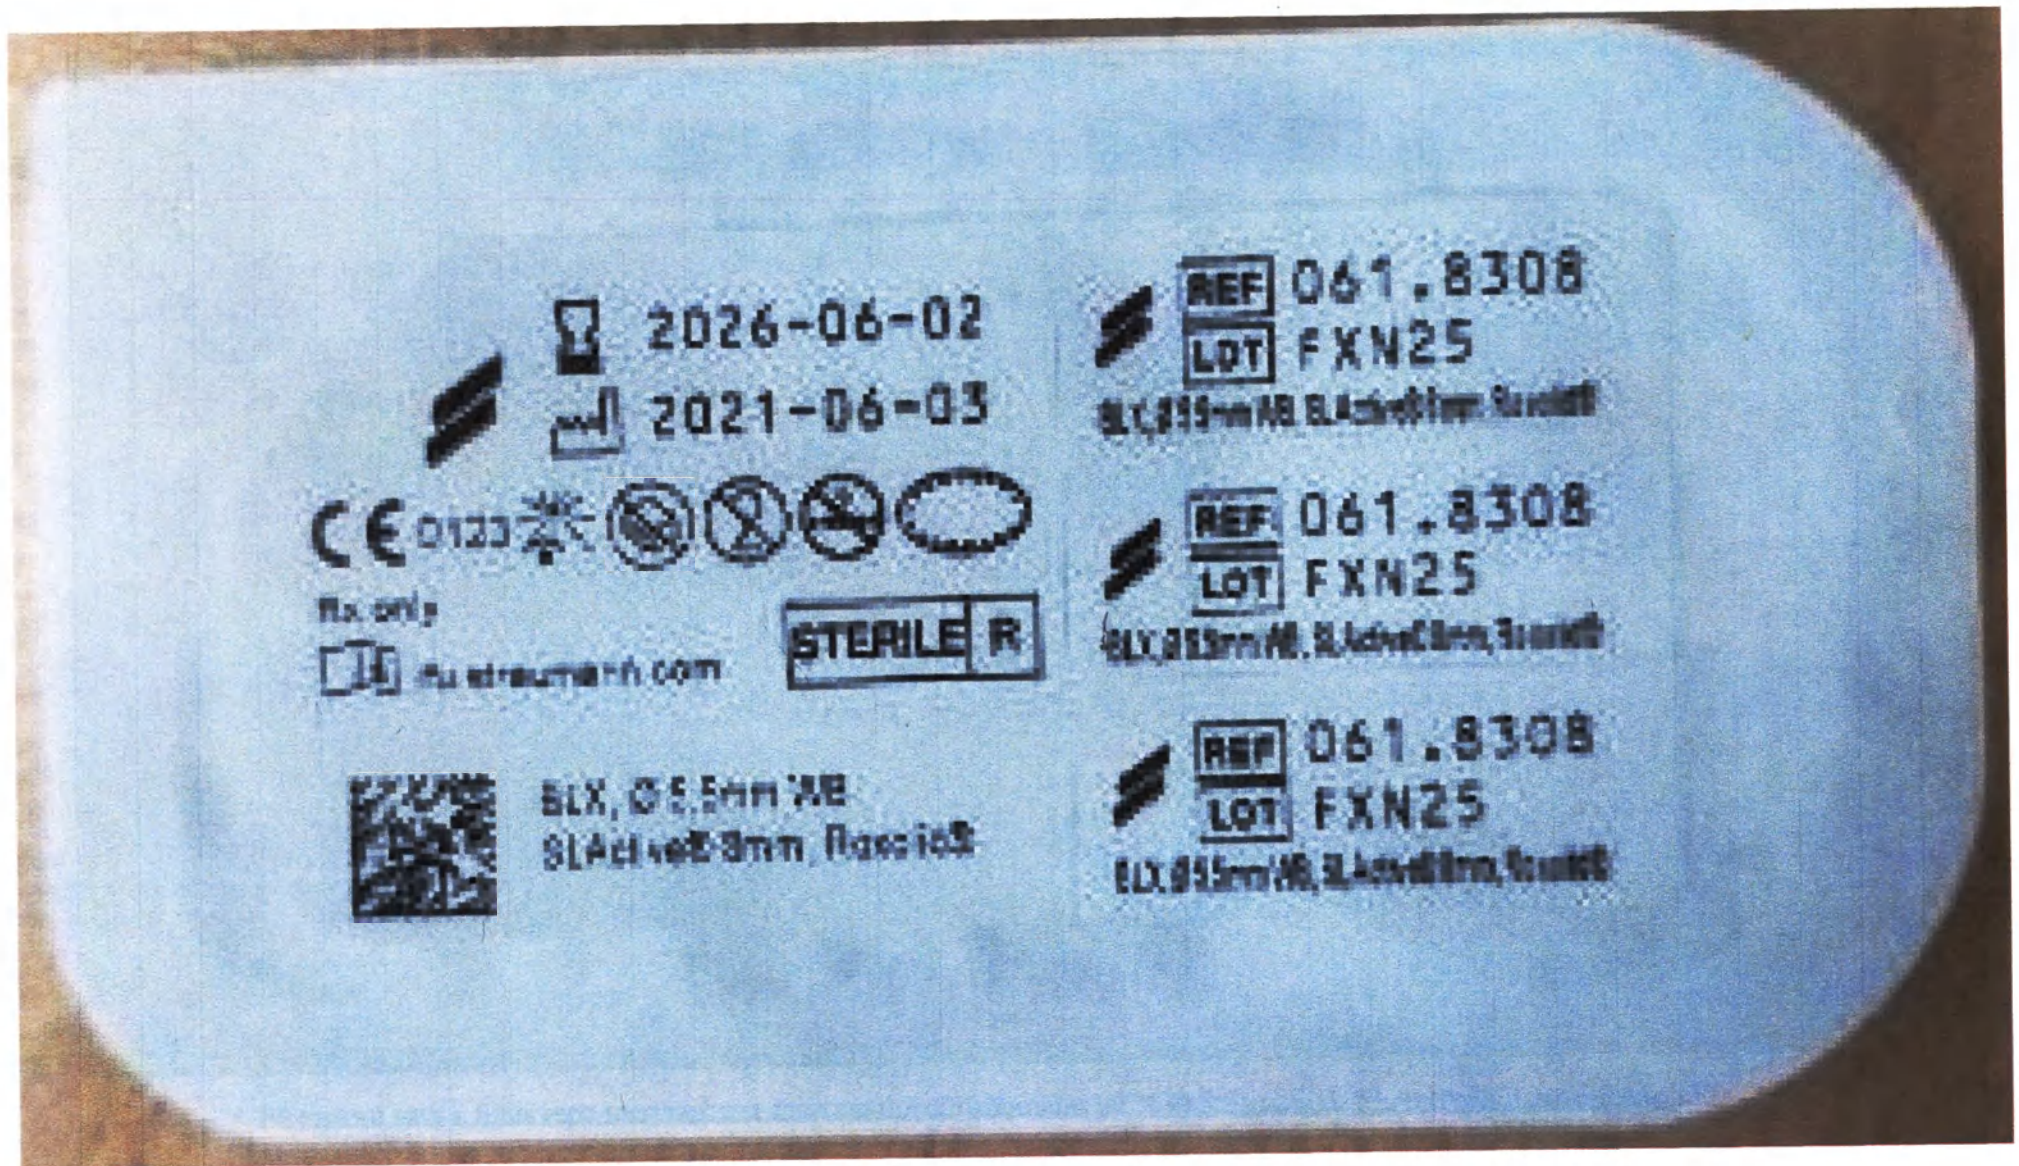


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®

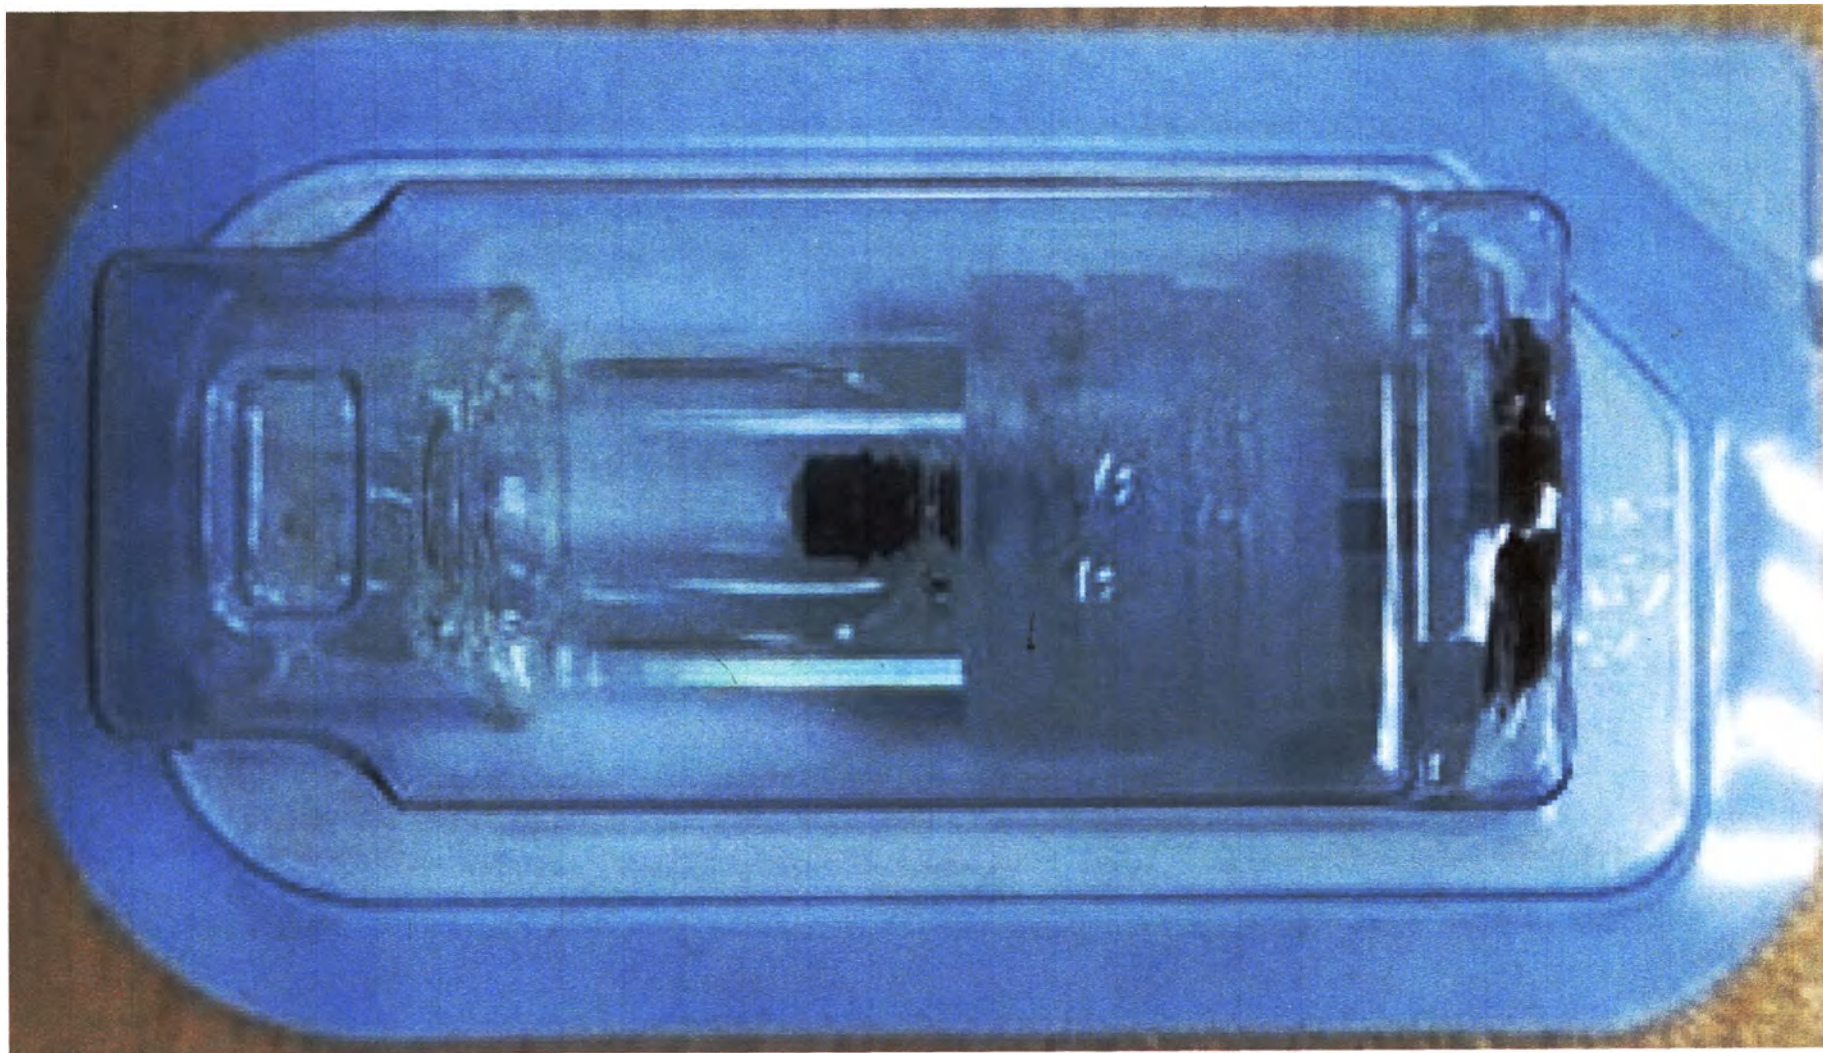


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 10мм, Roxolid®

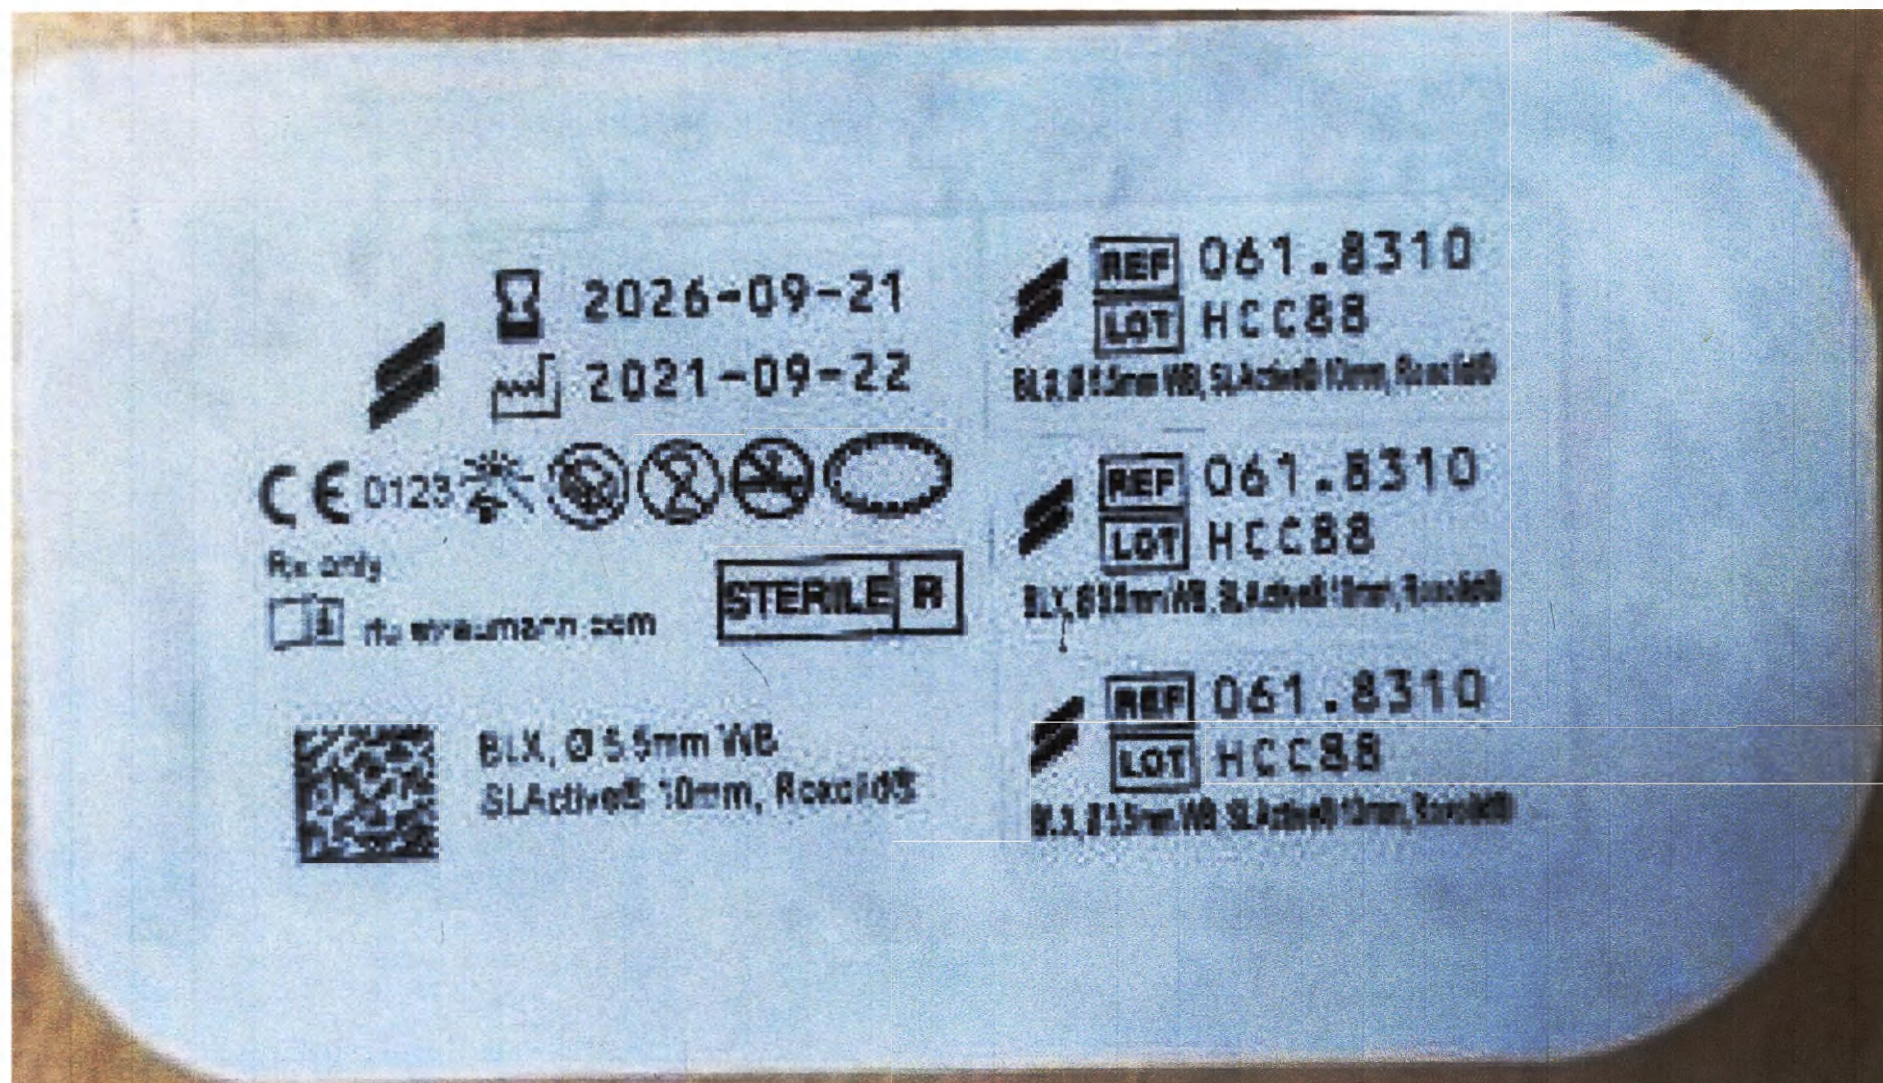


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 10мм, Roxolid®

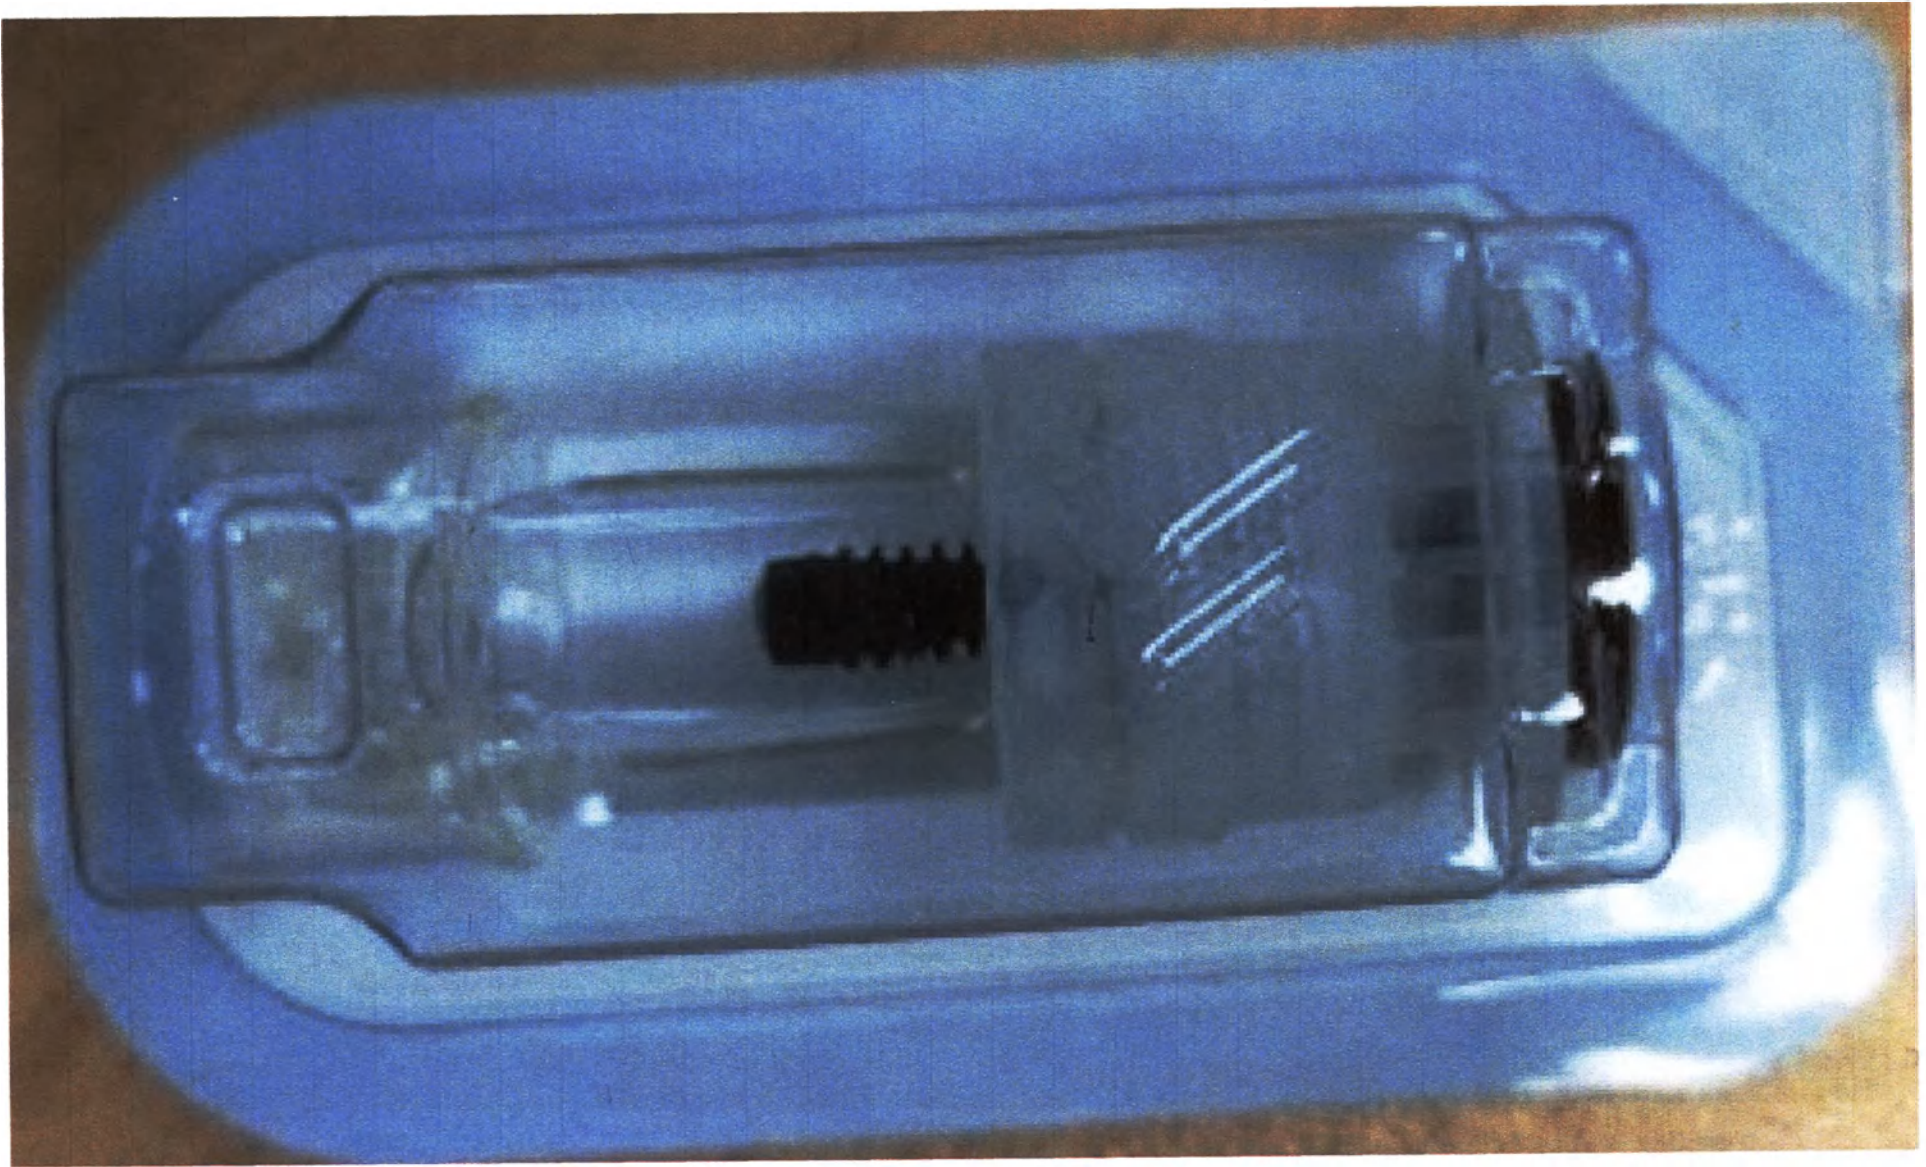


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 12мм, Roxolid®

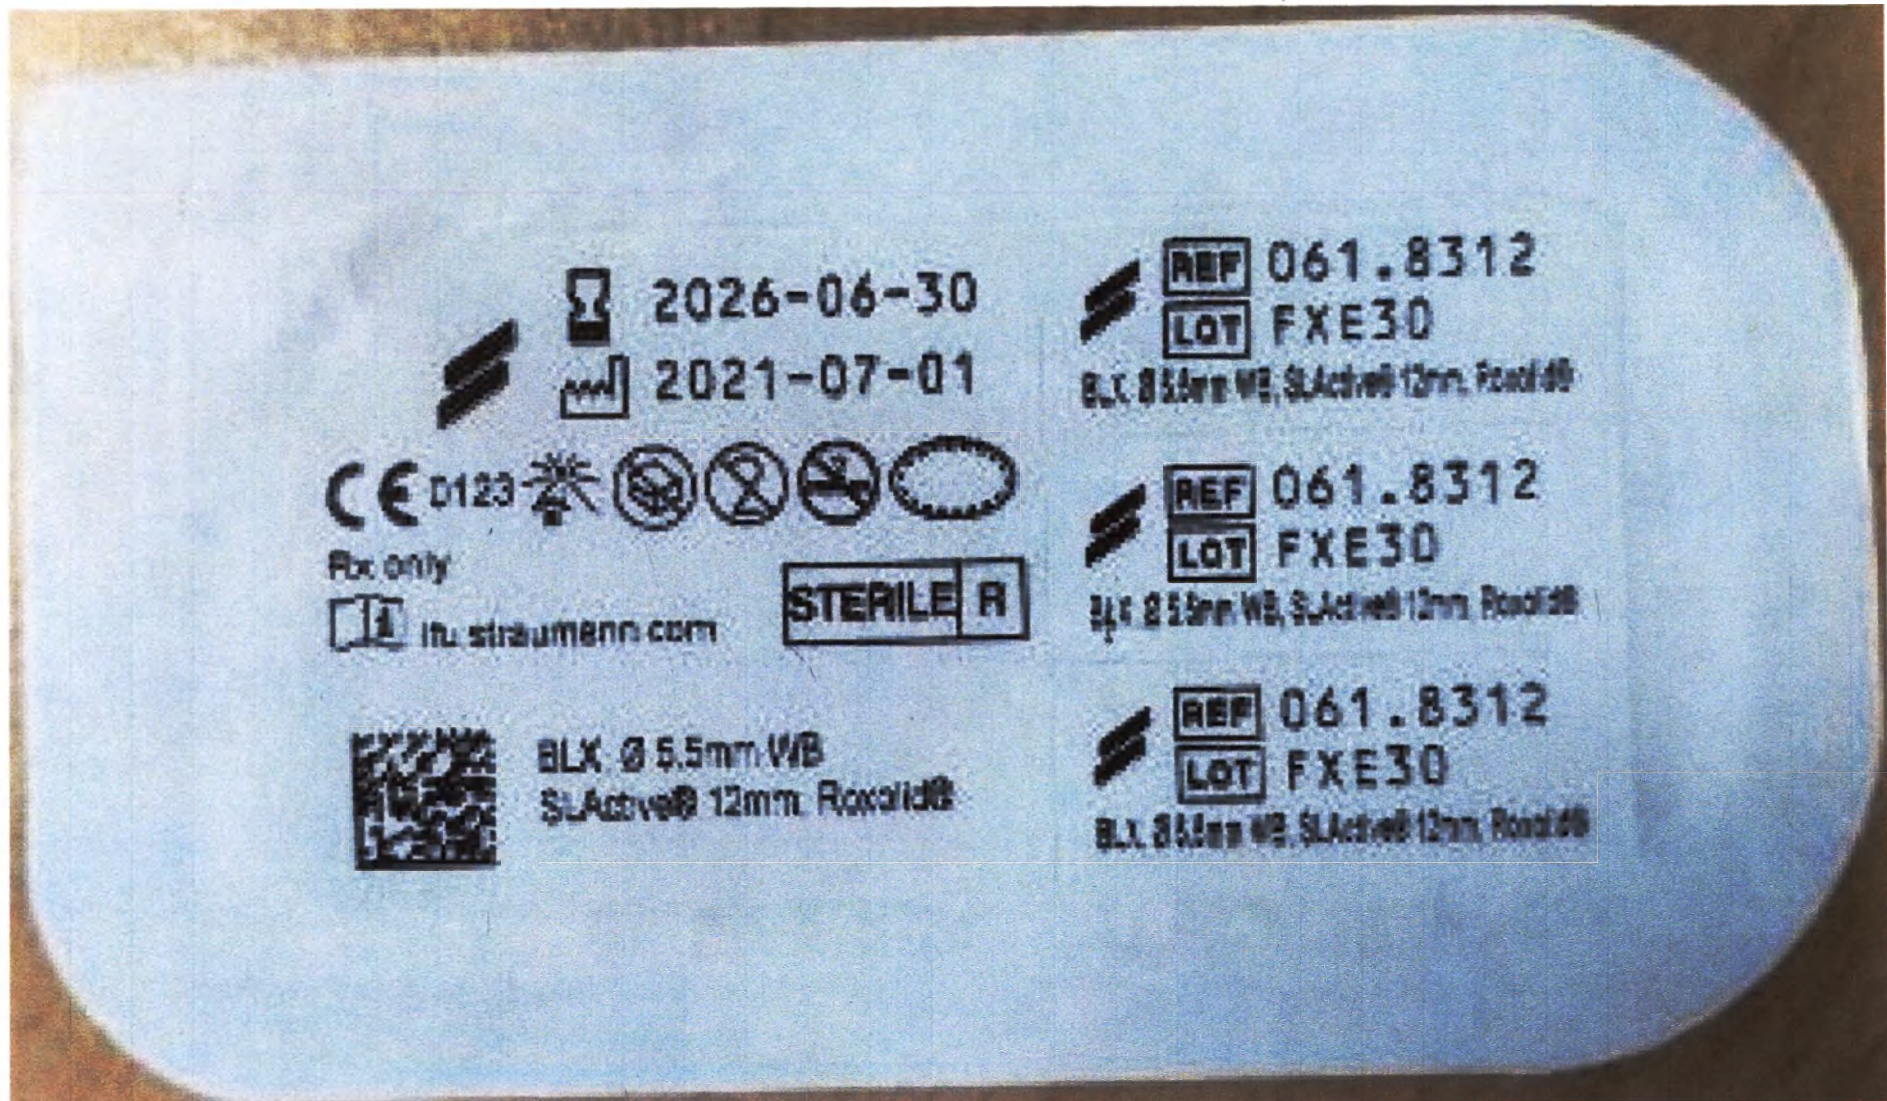


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5mm WB, SLActive® 12mm, Roxolid®

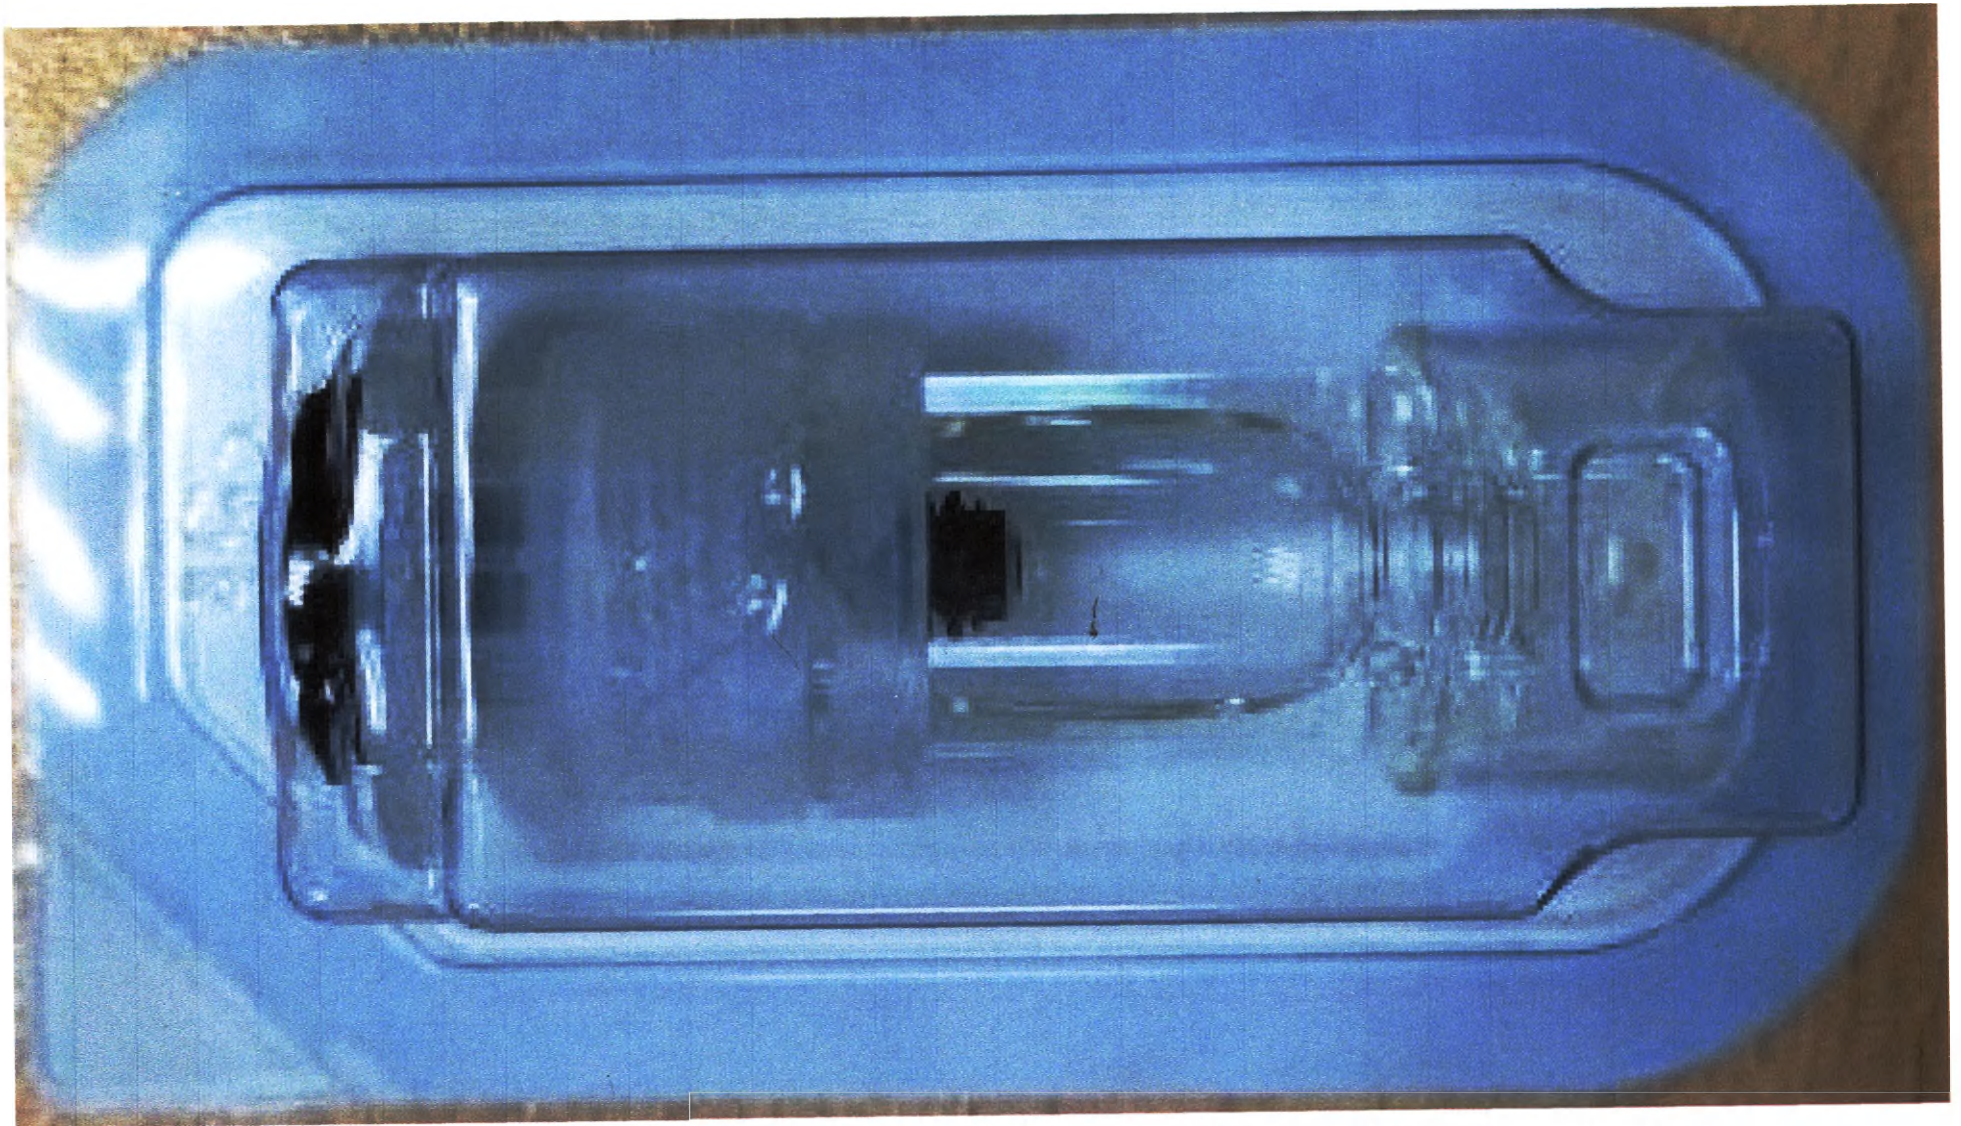


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®

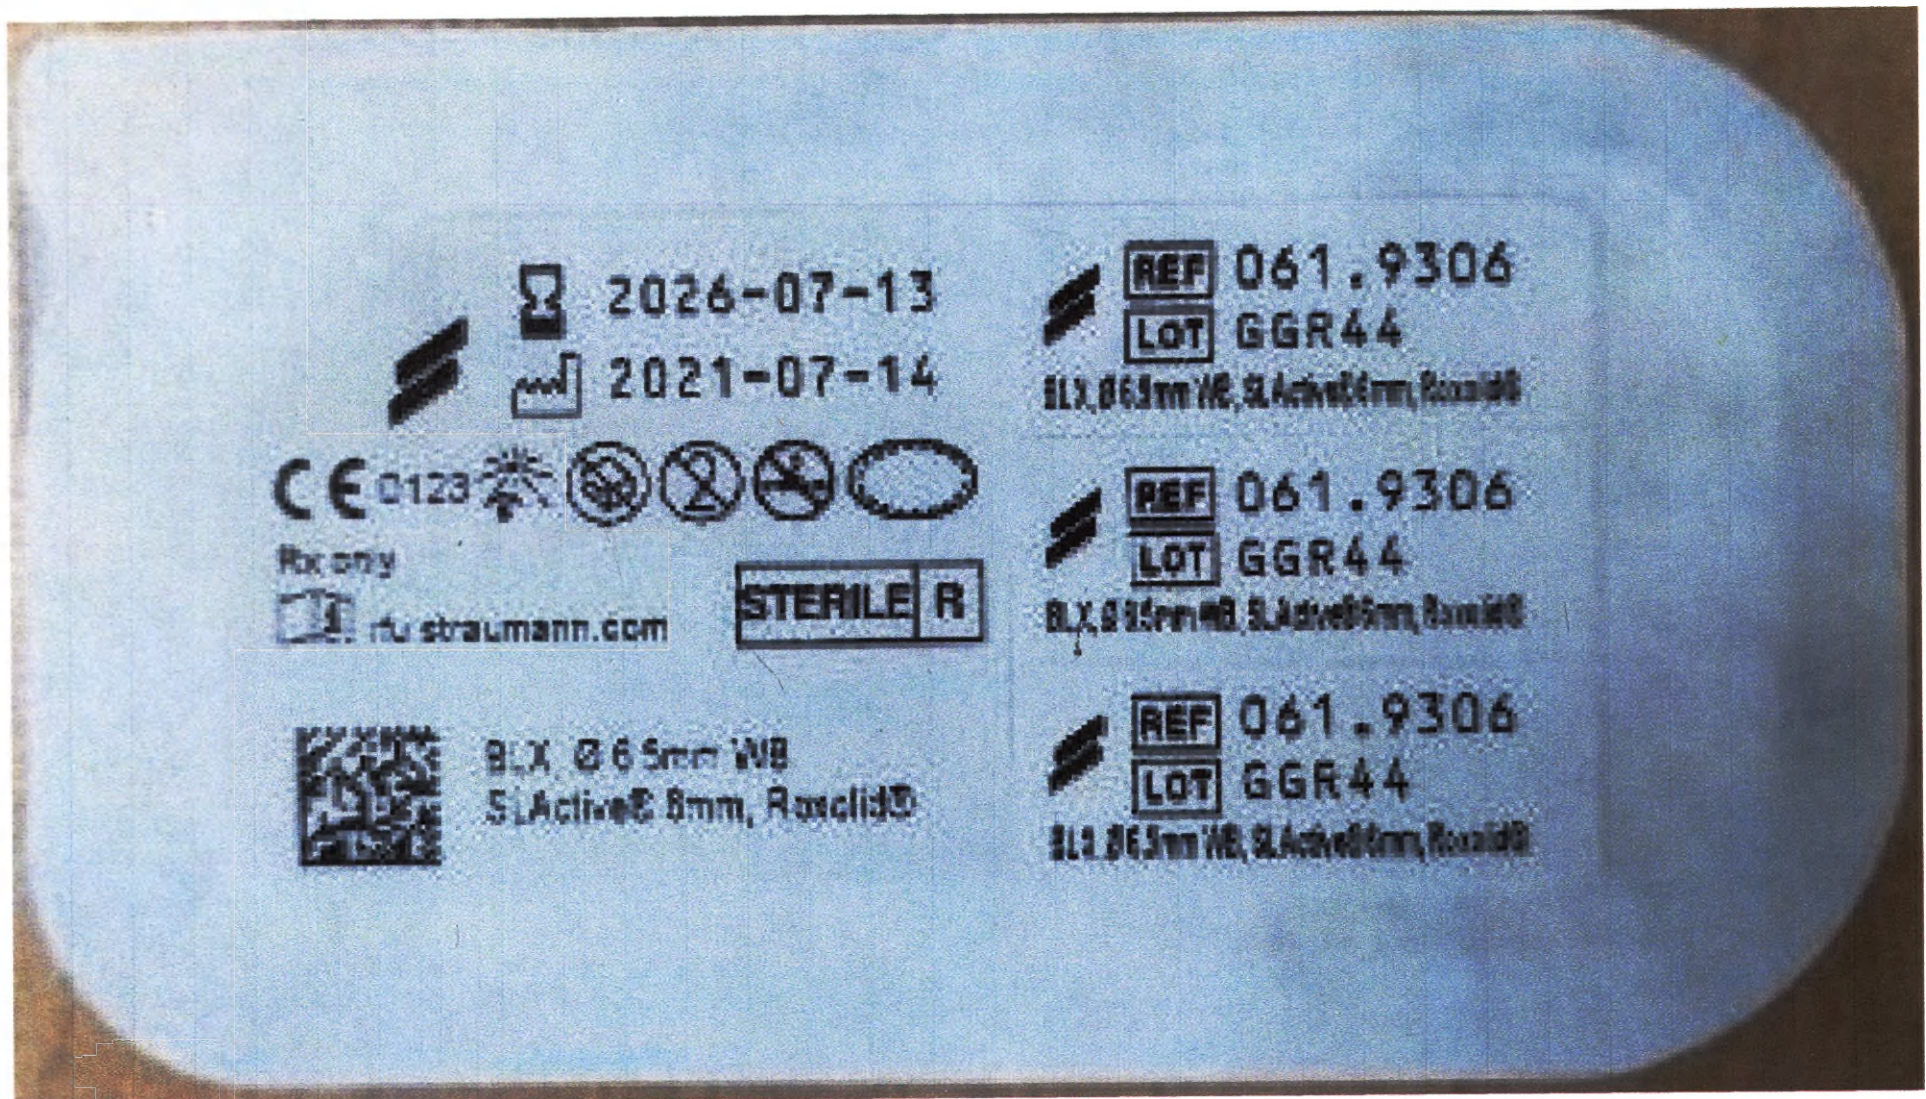


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®

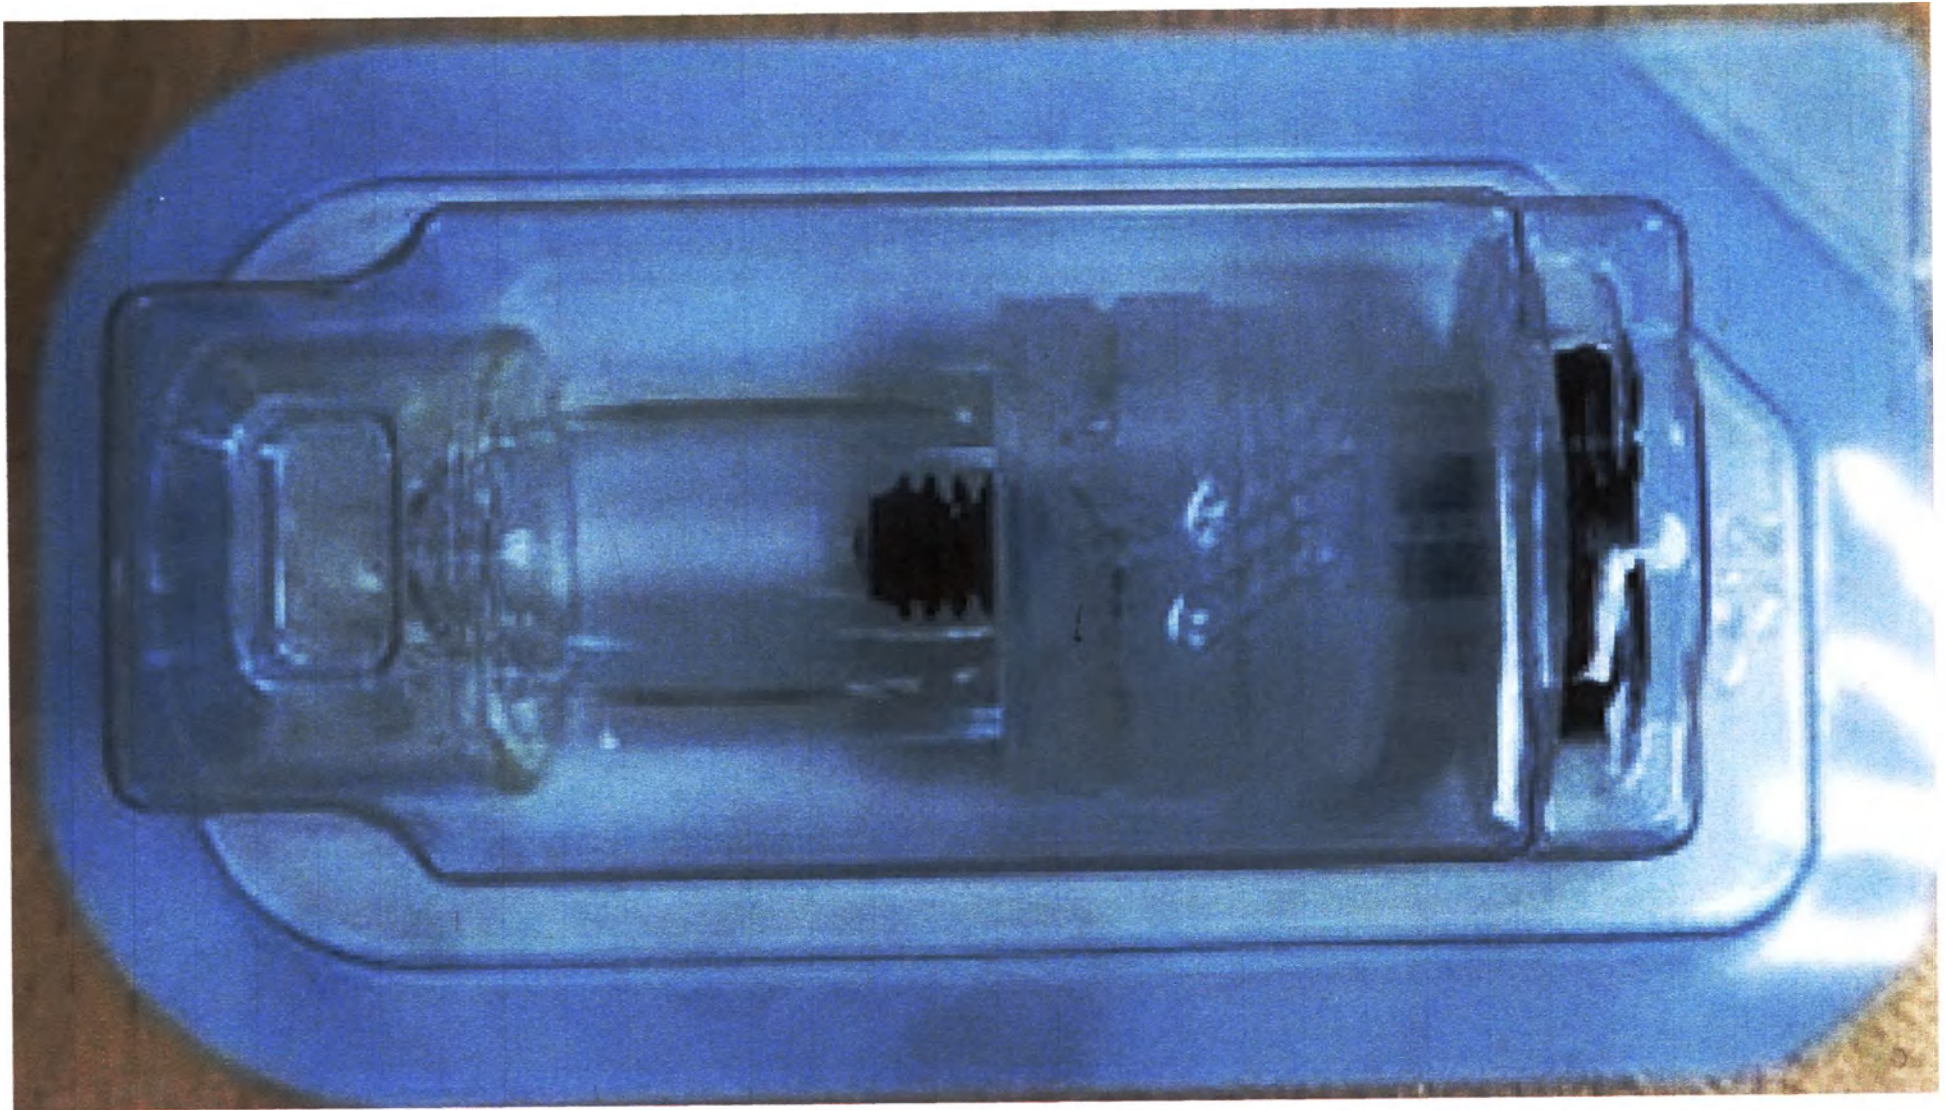


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®

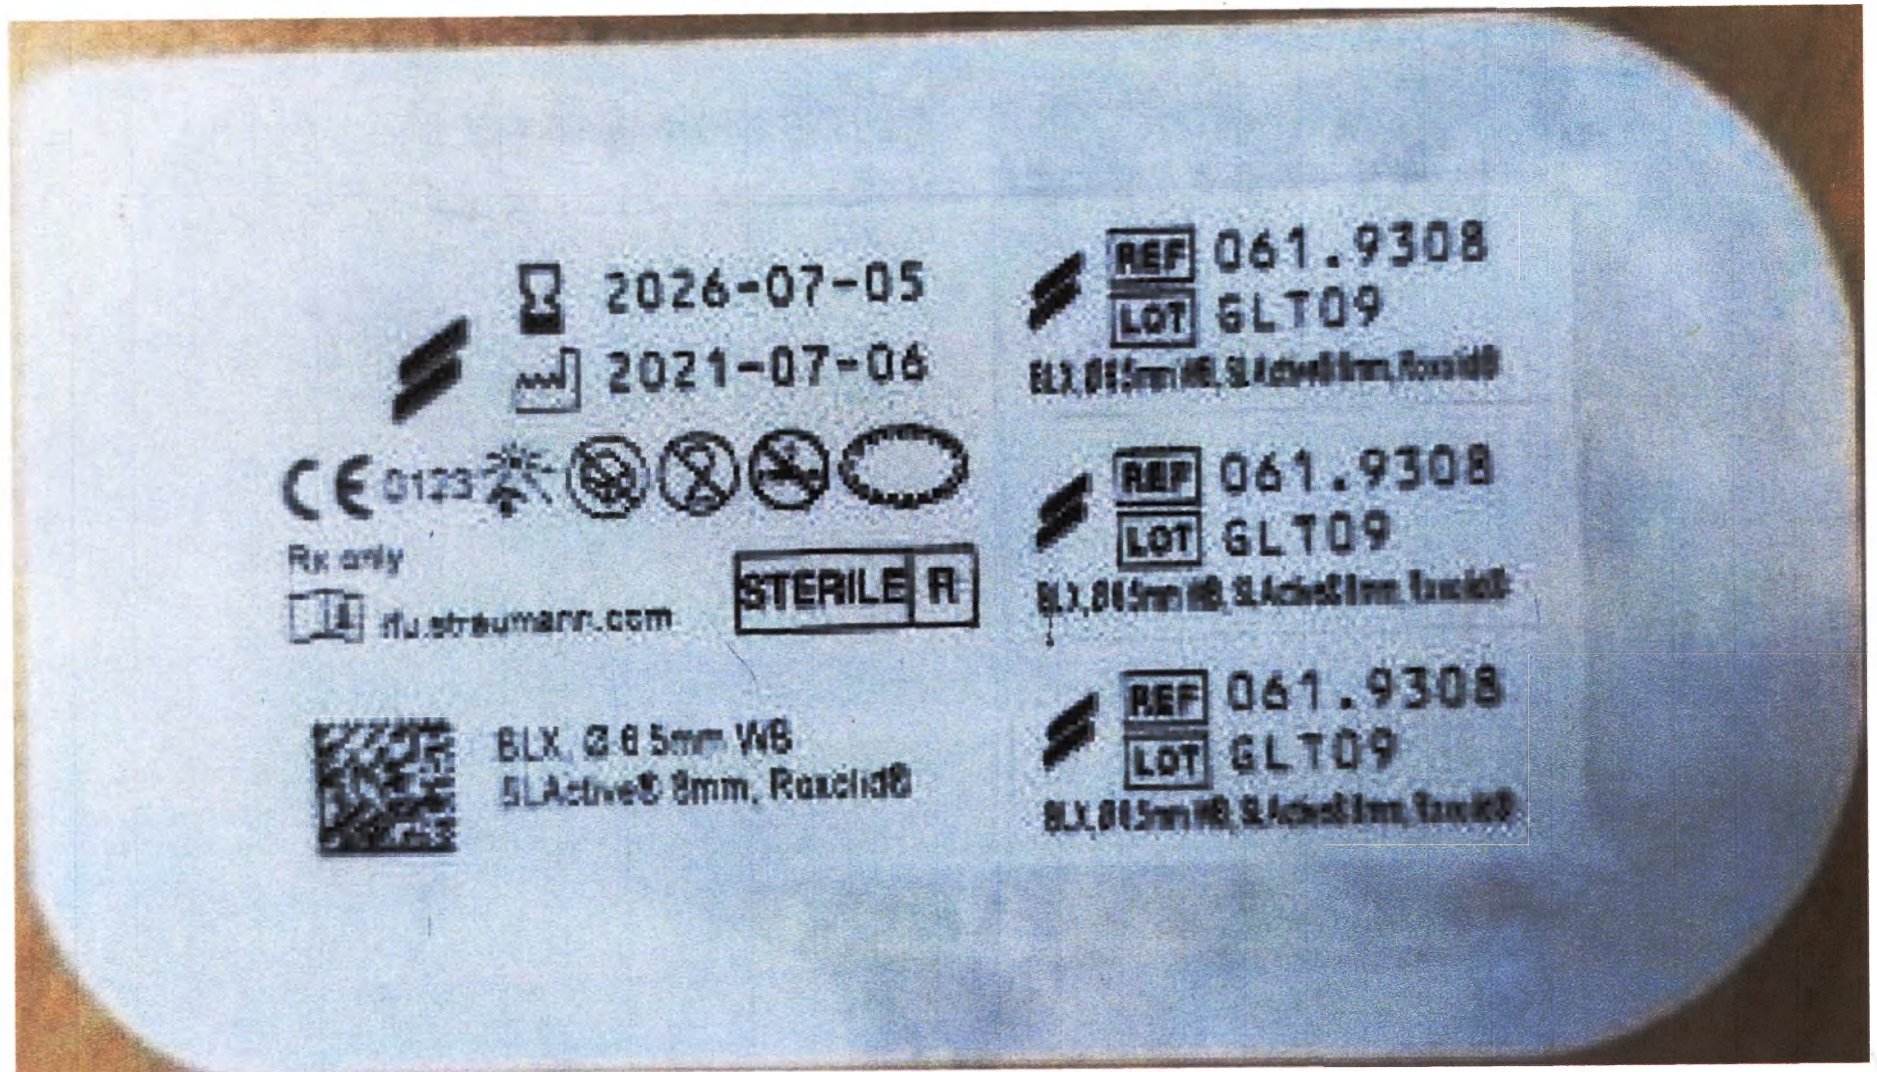


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®

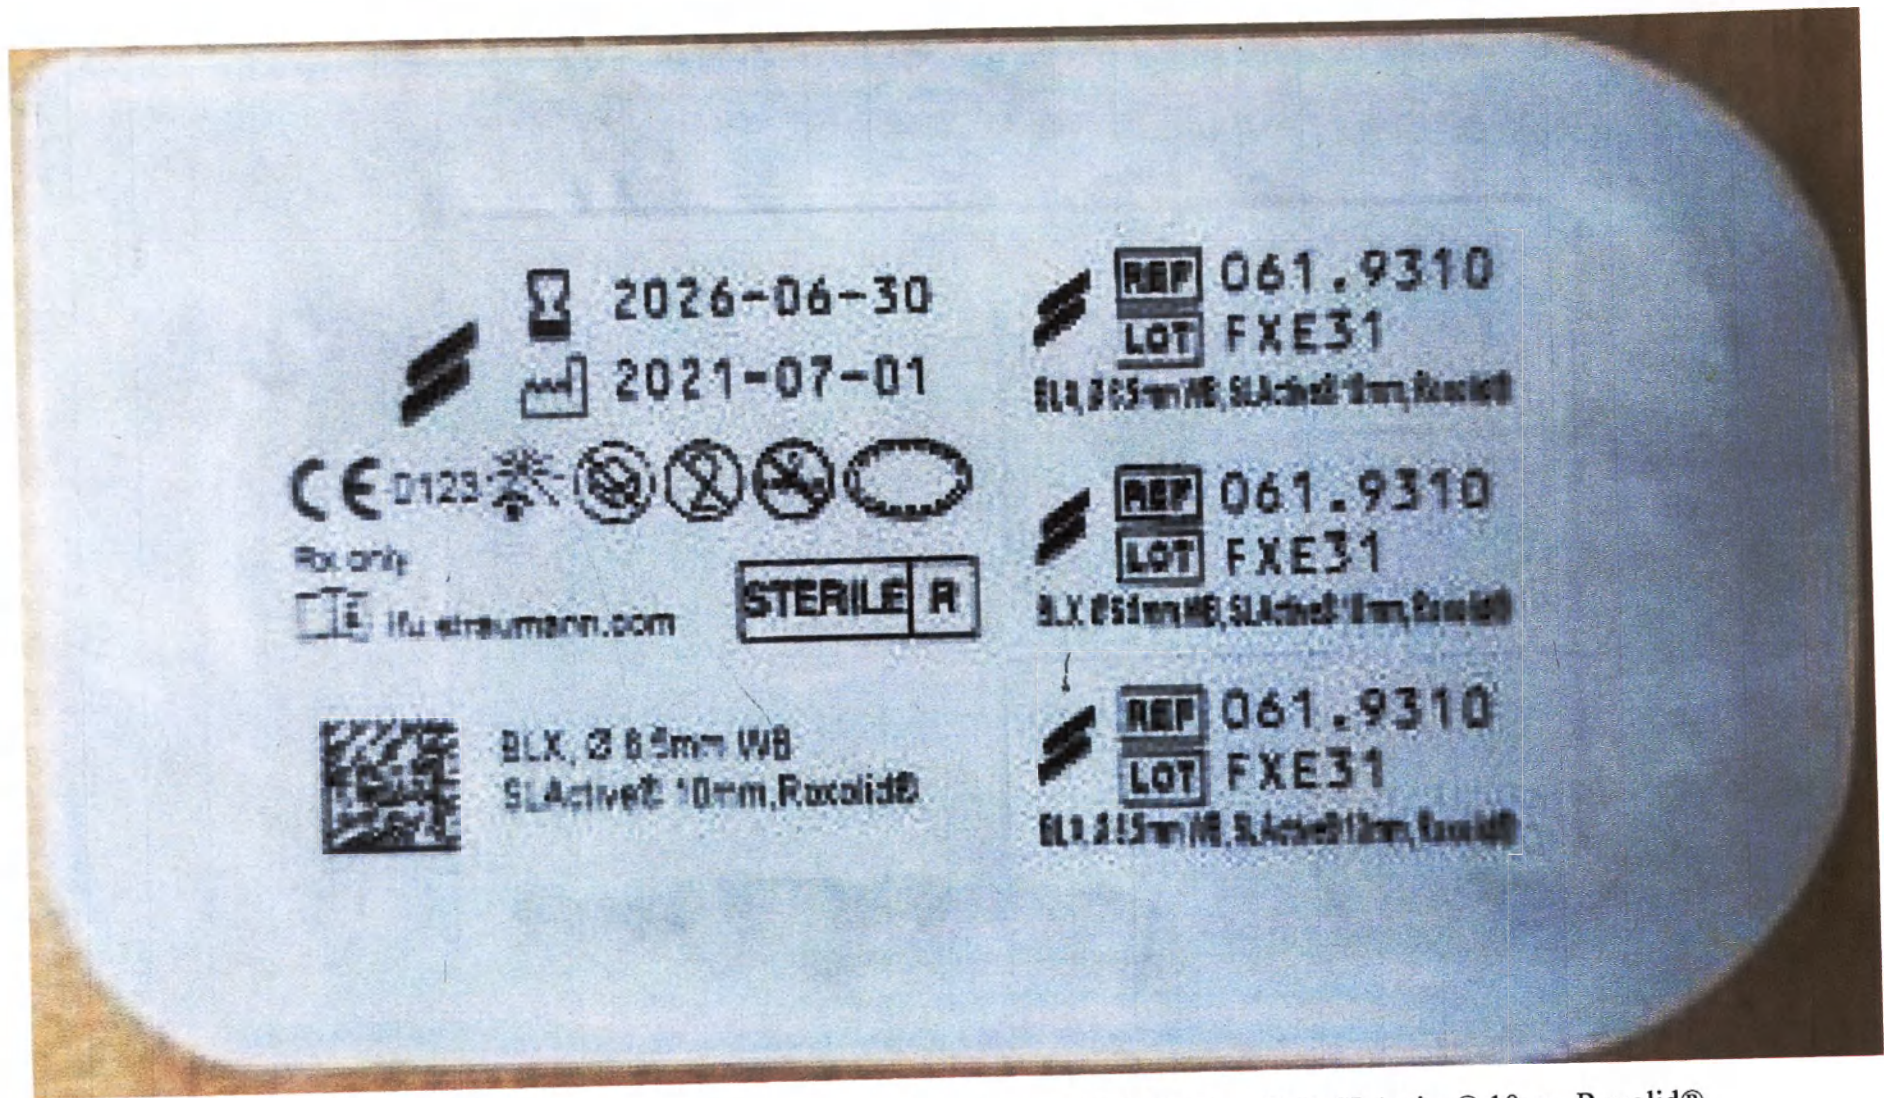


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 10мм, Roxolid®

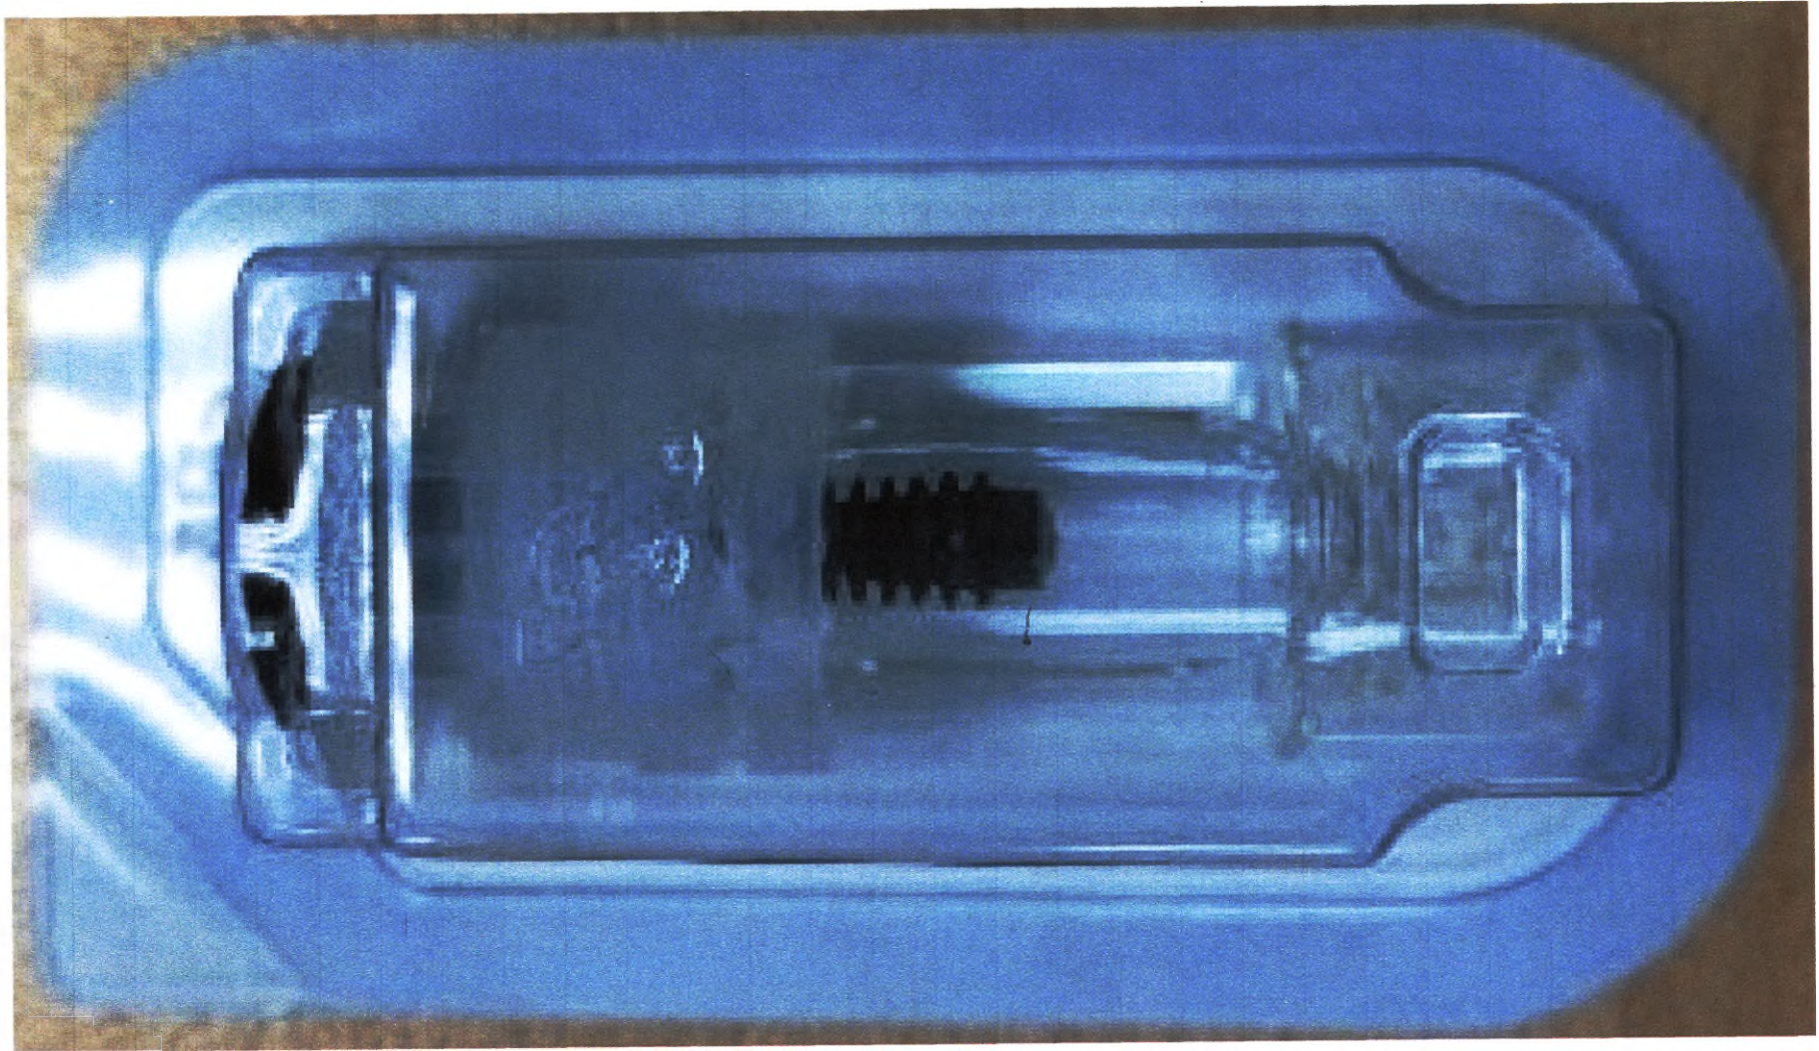


Внешний вид в блистере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 12мм, Roxolid®

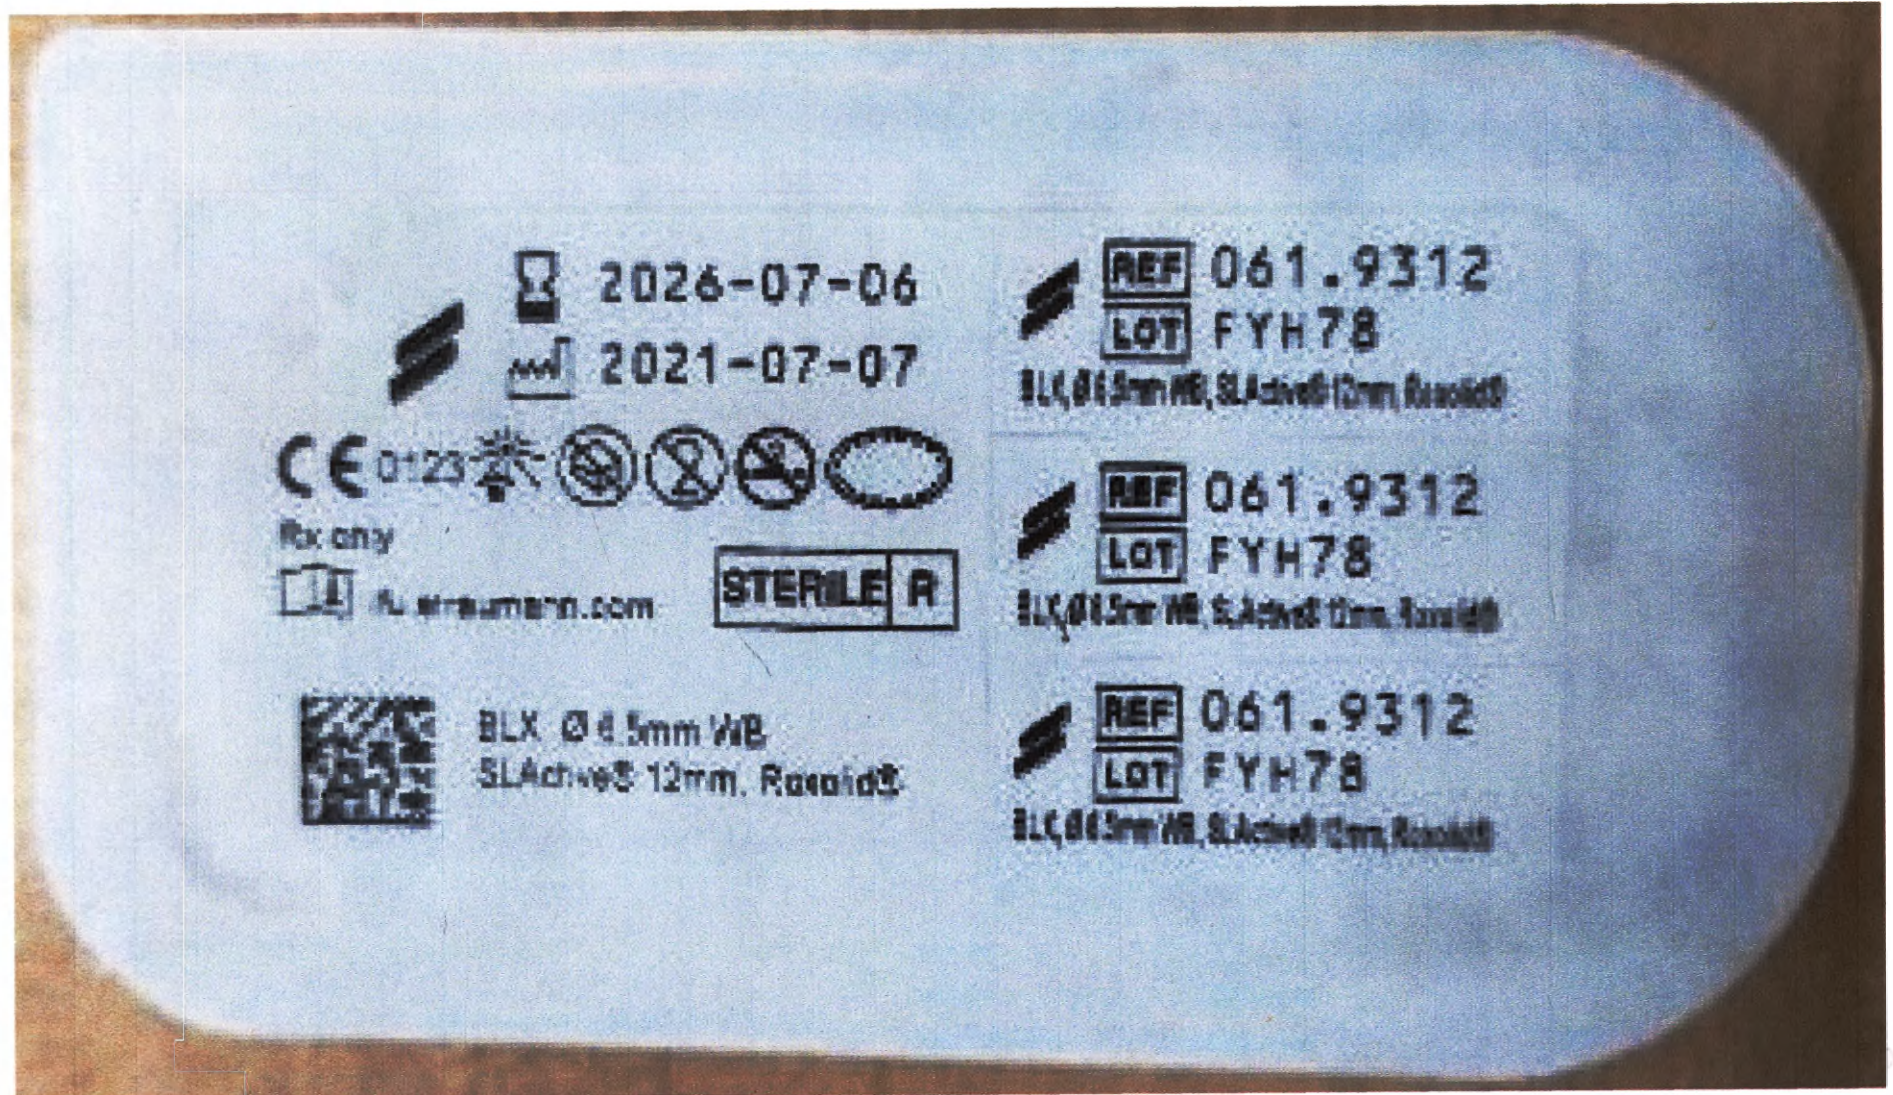


Защитная пленка блистера имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5mm WB, SLActive® 12mm, Roxolid®

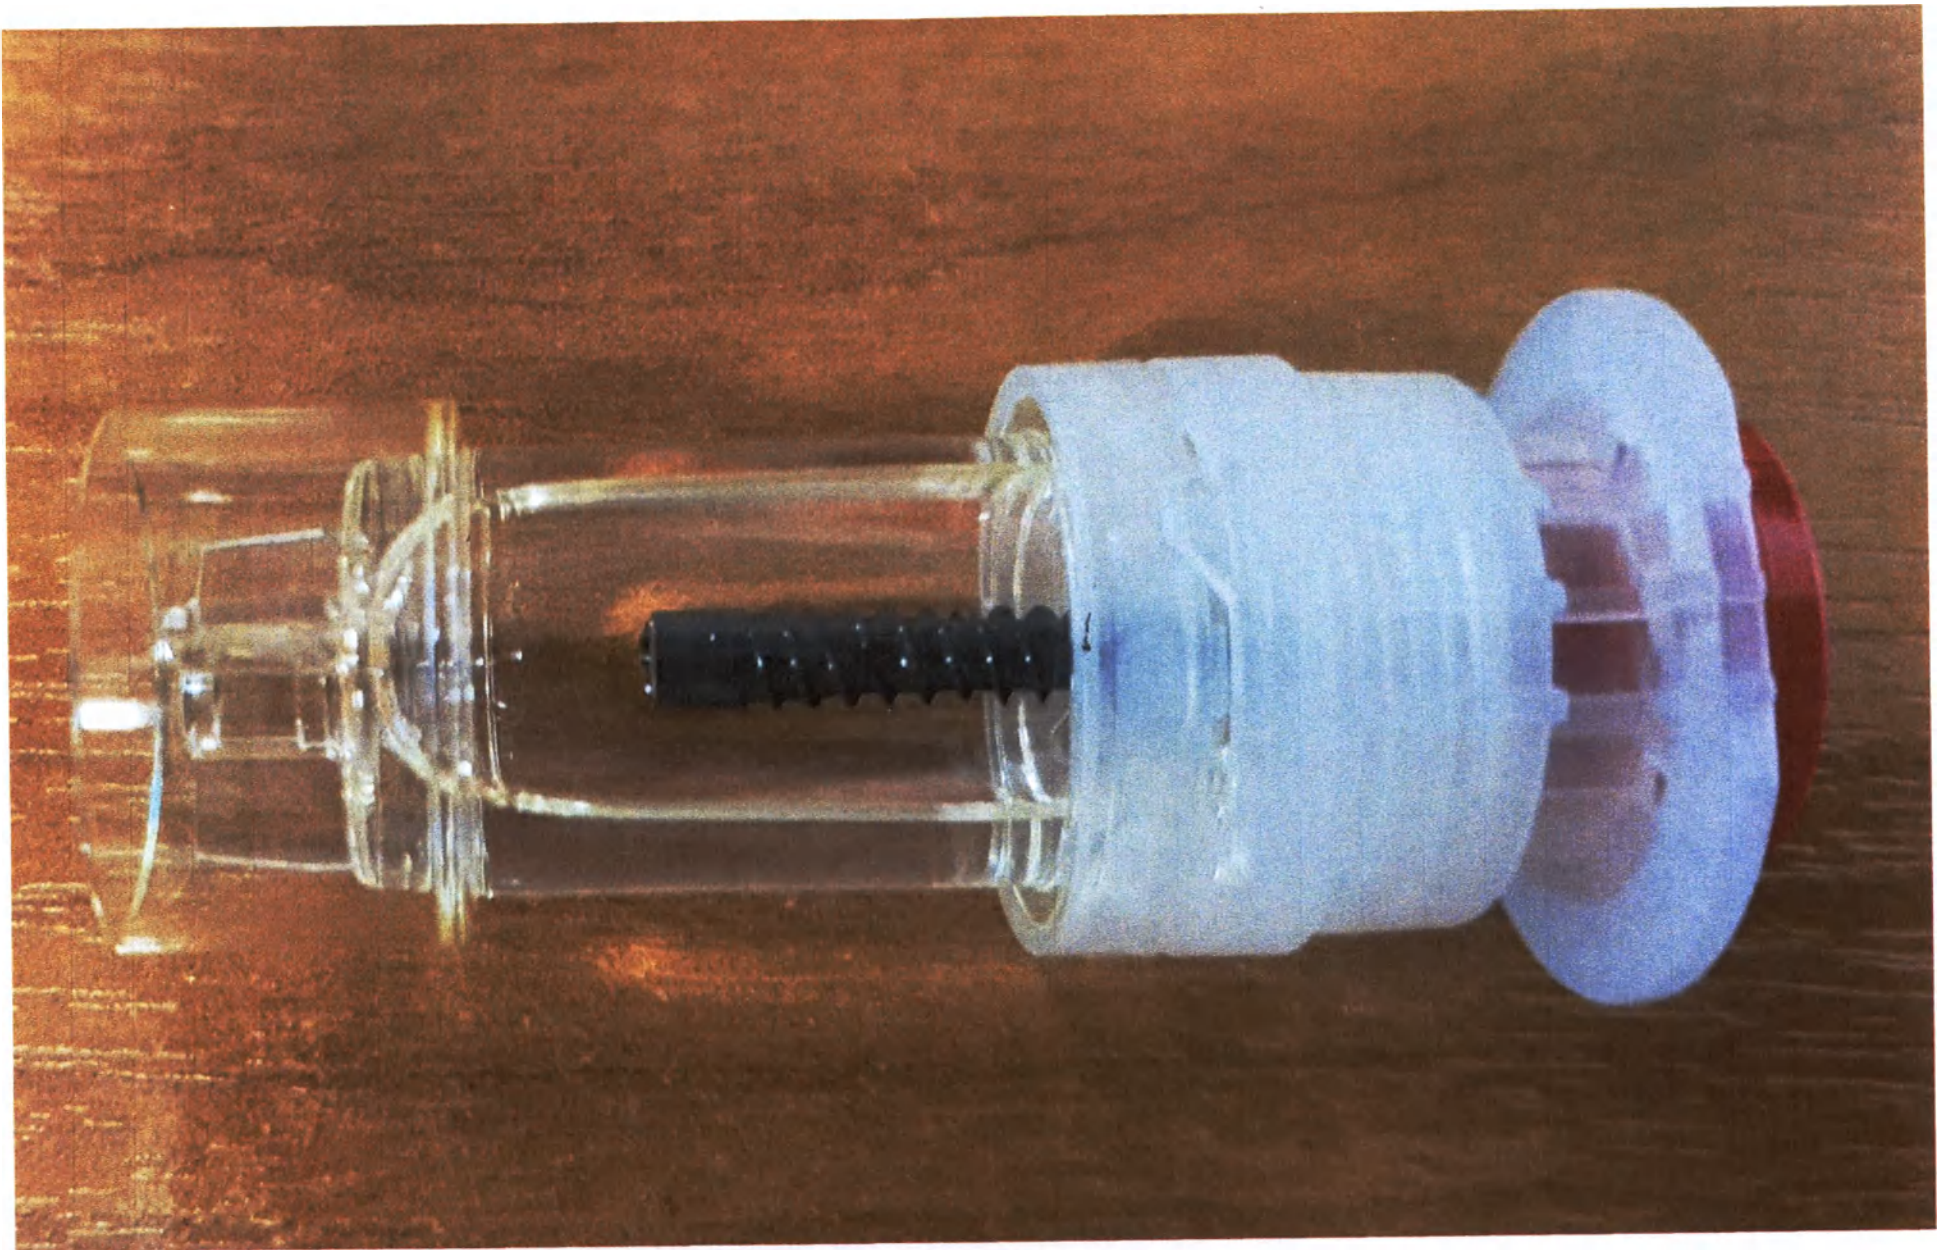

Внешний вид в капсуле имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 3.75mm RB, SLActive® 16mm, Roxolid®

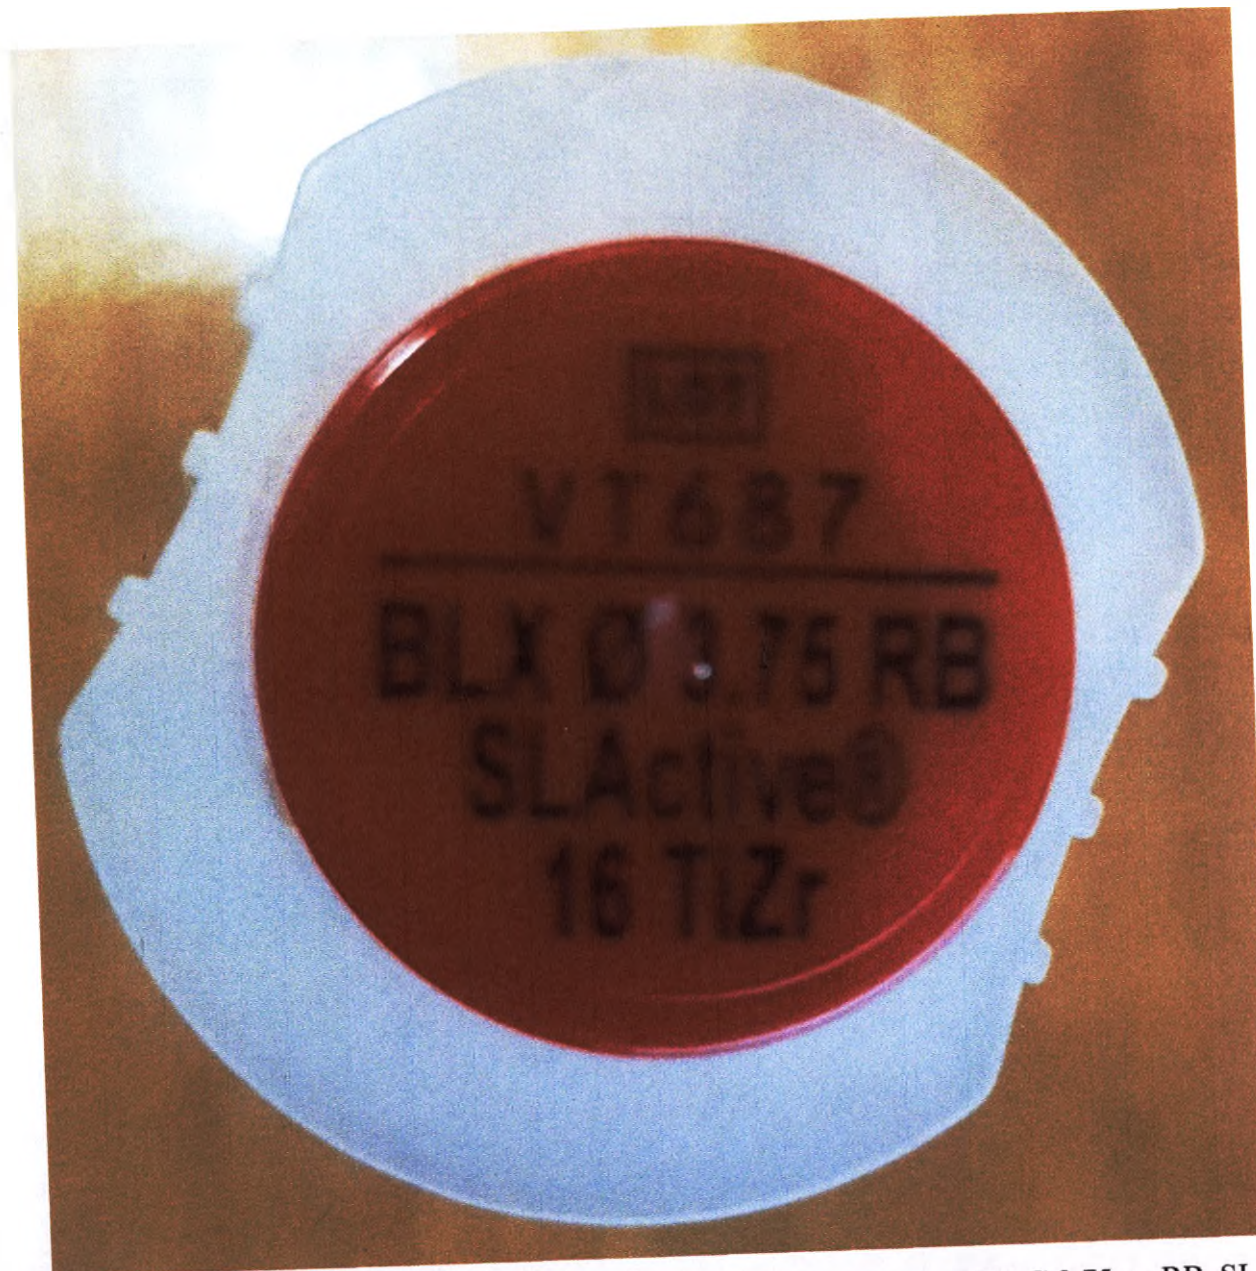


Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 3.75мм RB, SLActive® 16мм, Roxolid®

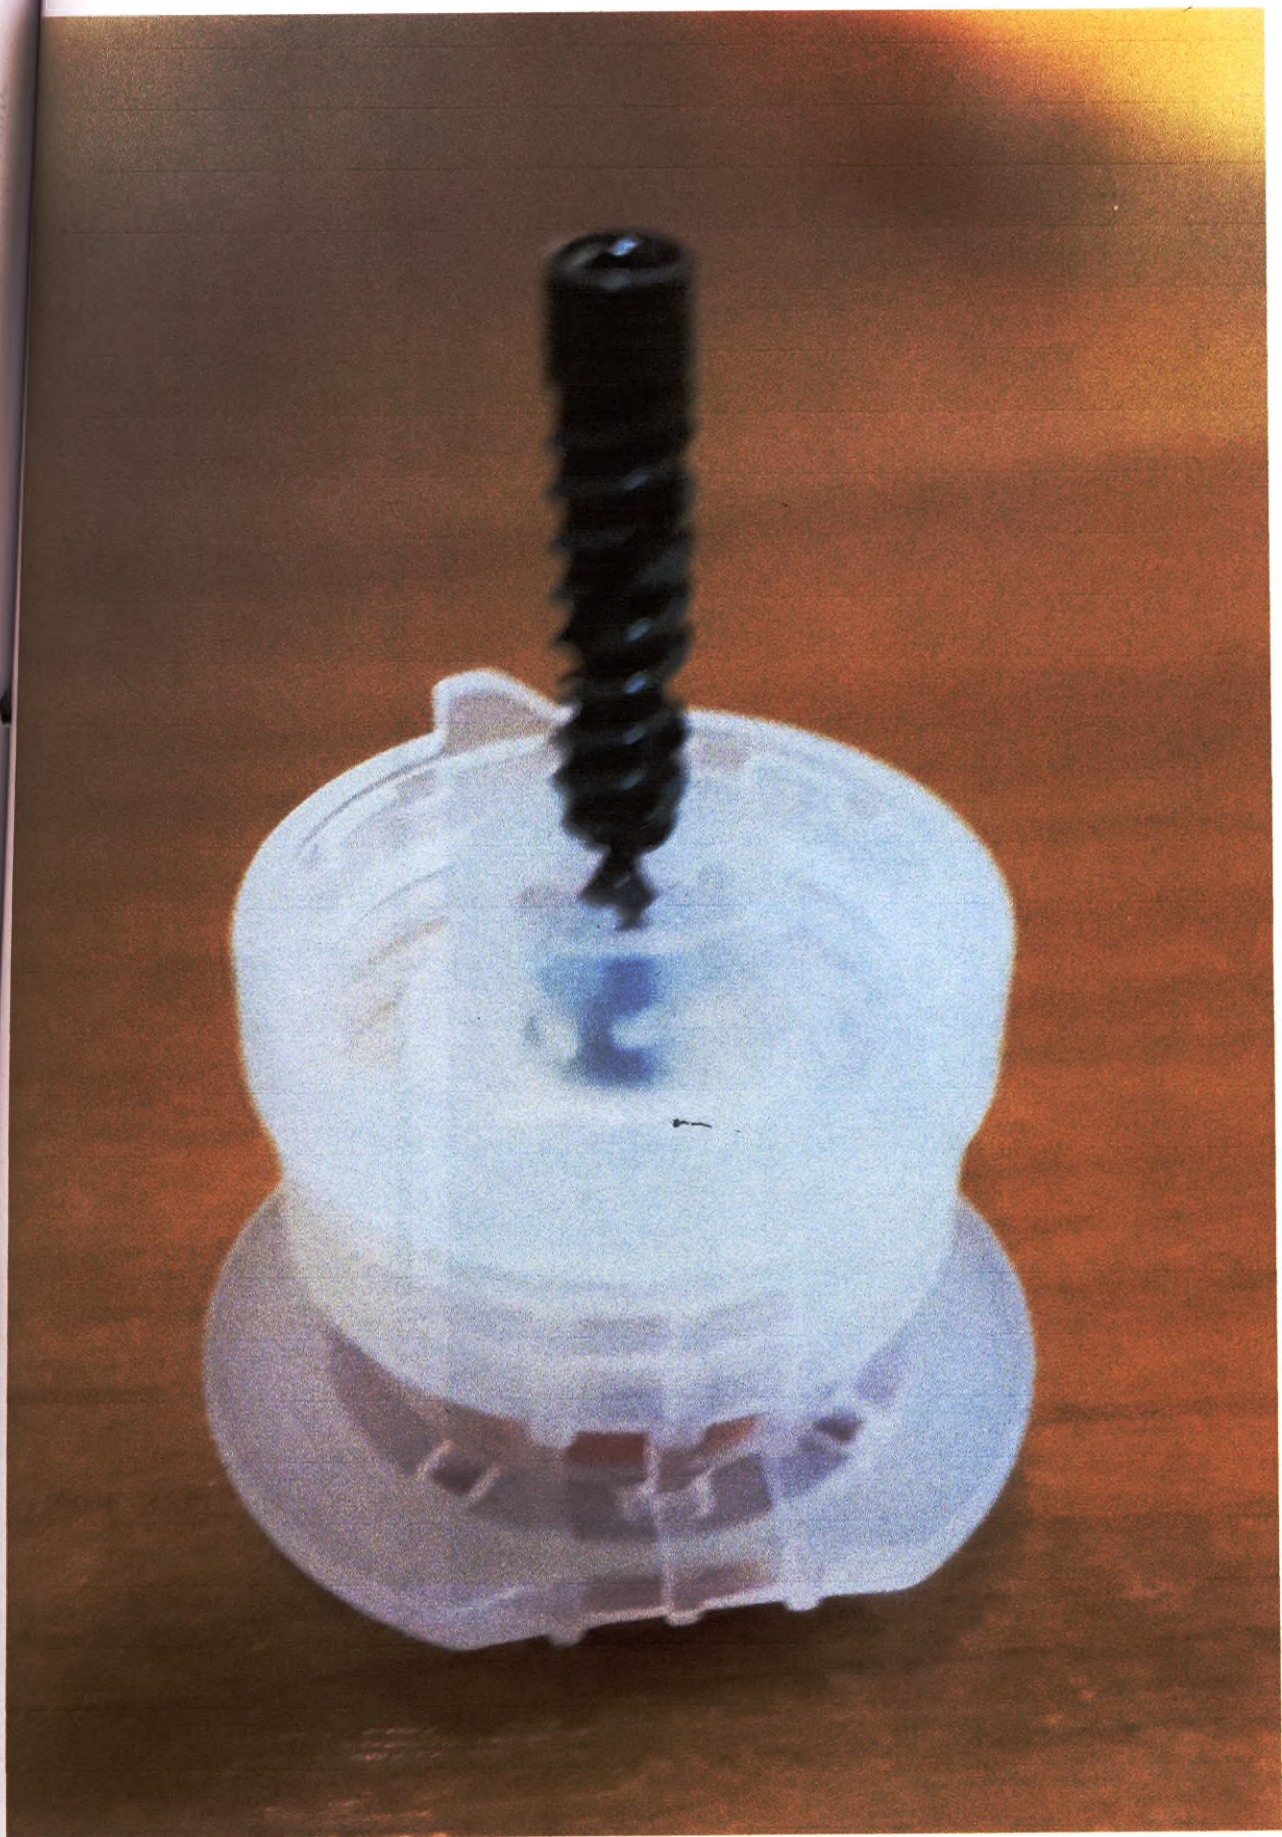

Общий вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 3.75мм RB, SLActive® 16мм, Roxolid®




Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®

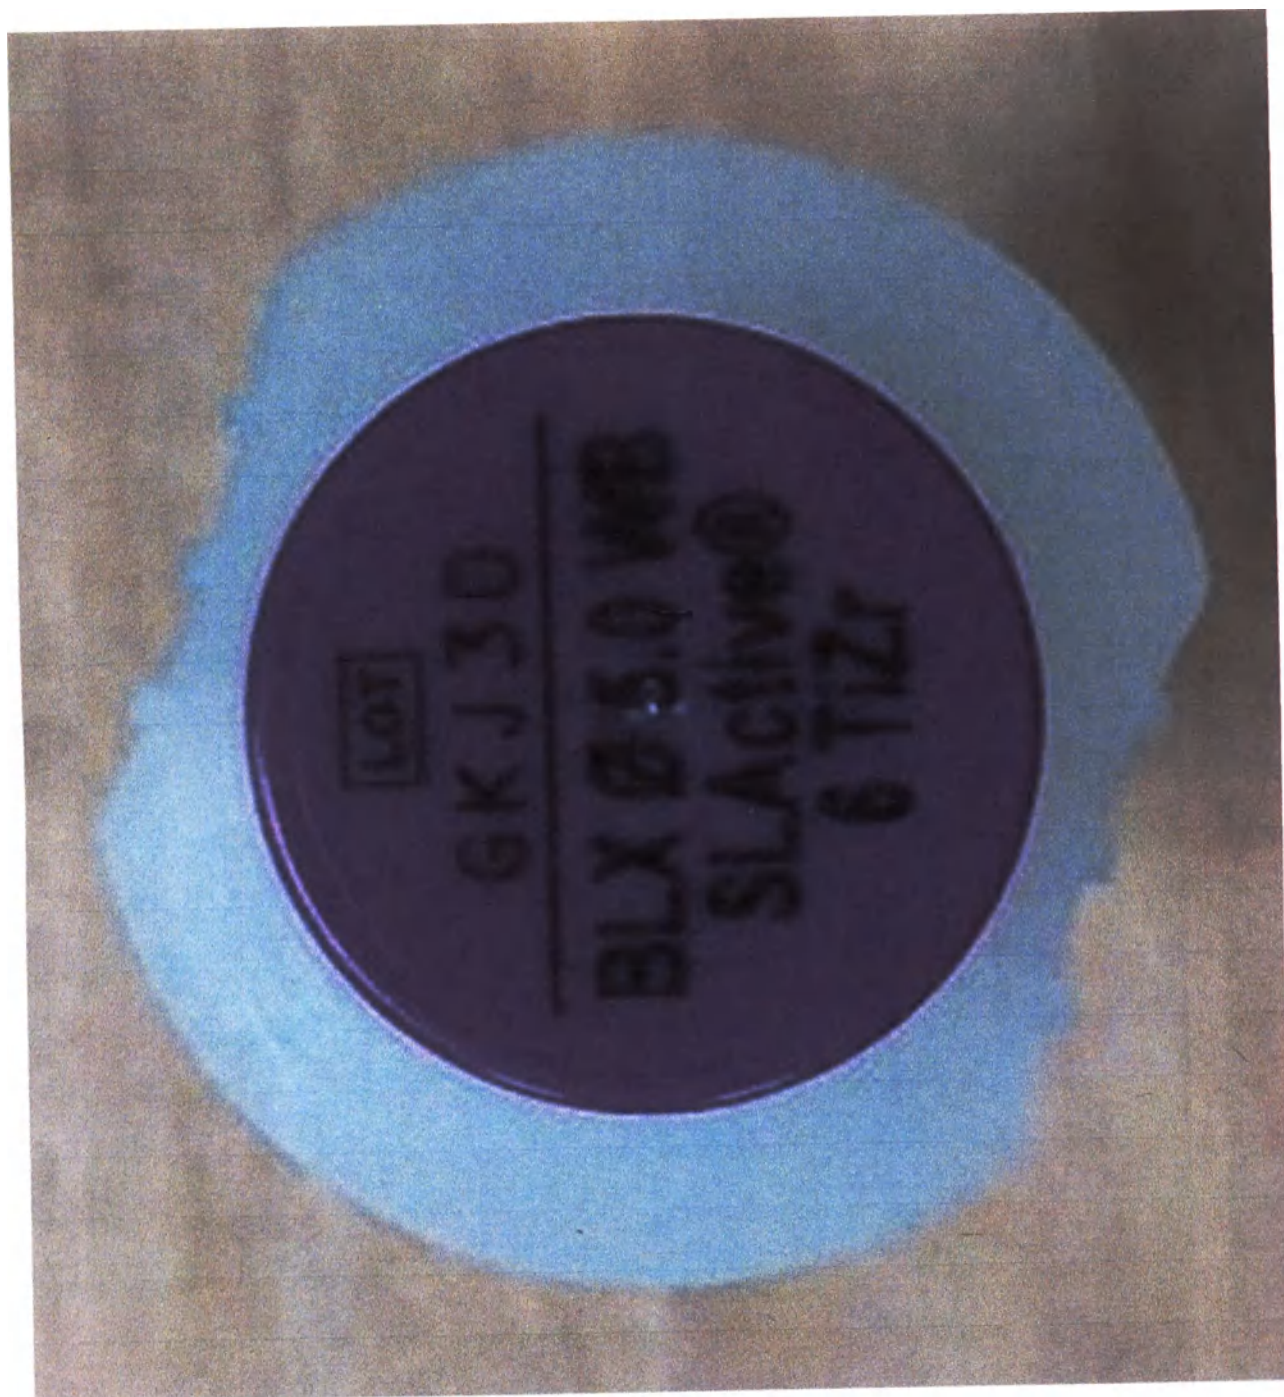

Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®




Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®

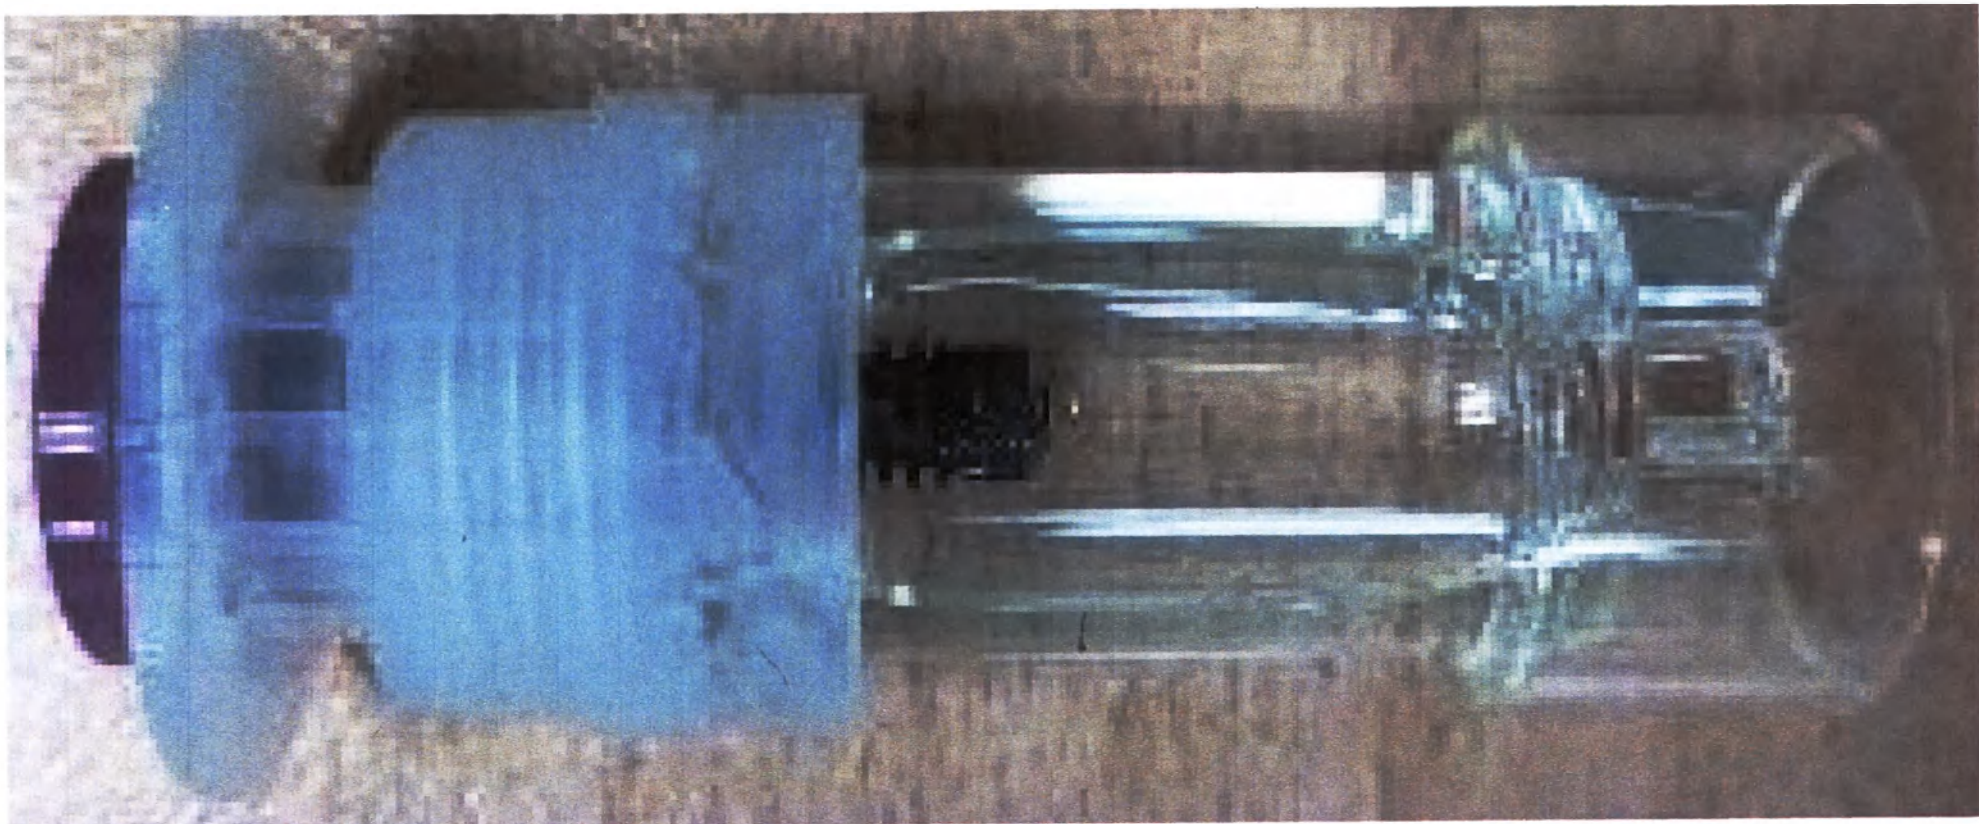


Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®



Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®

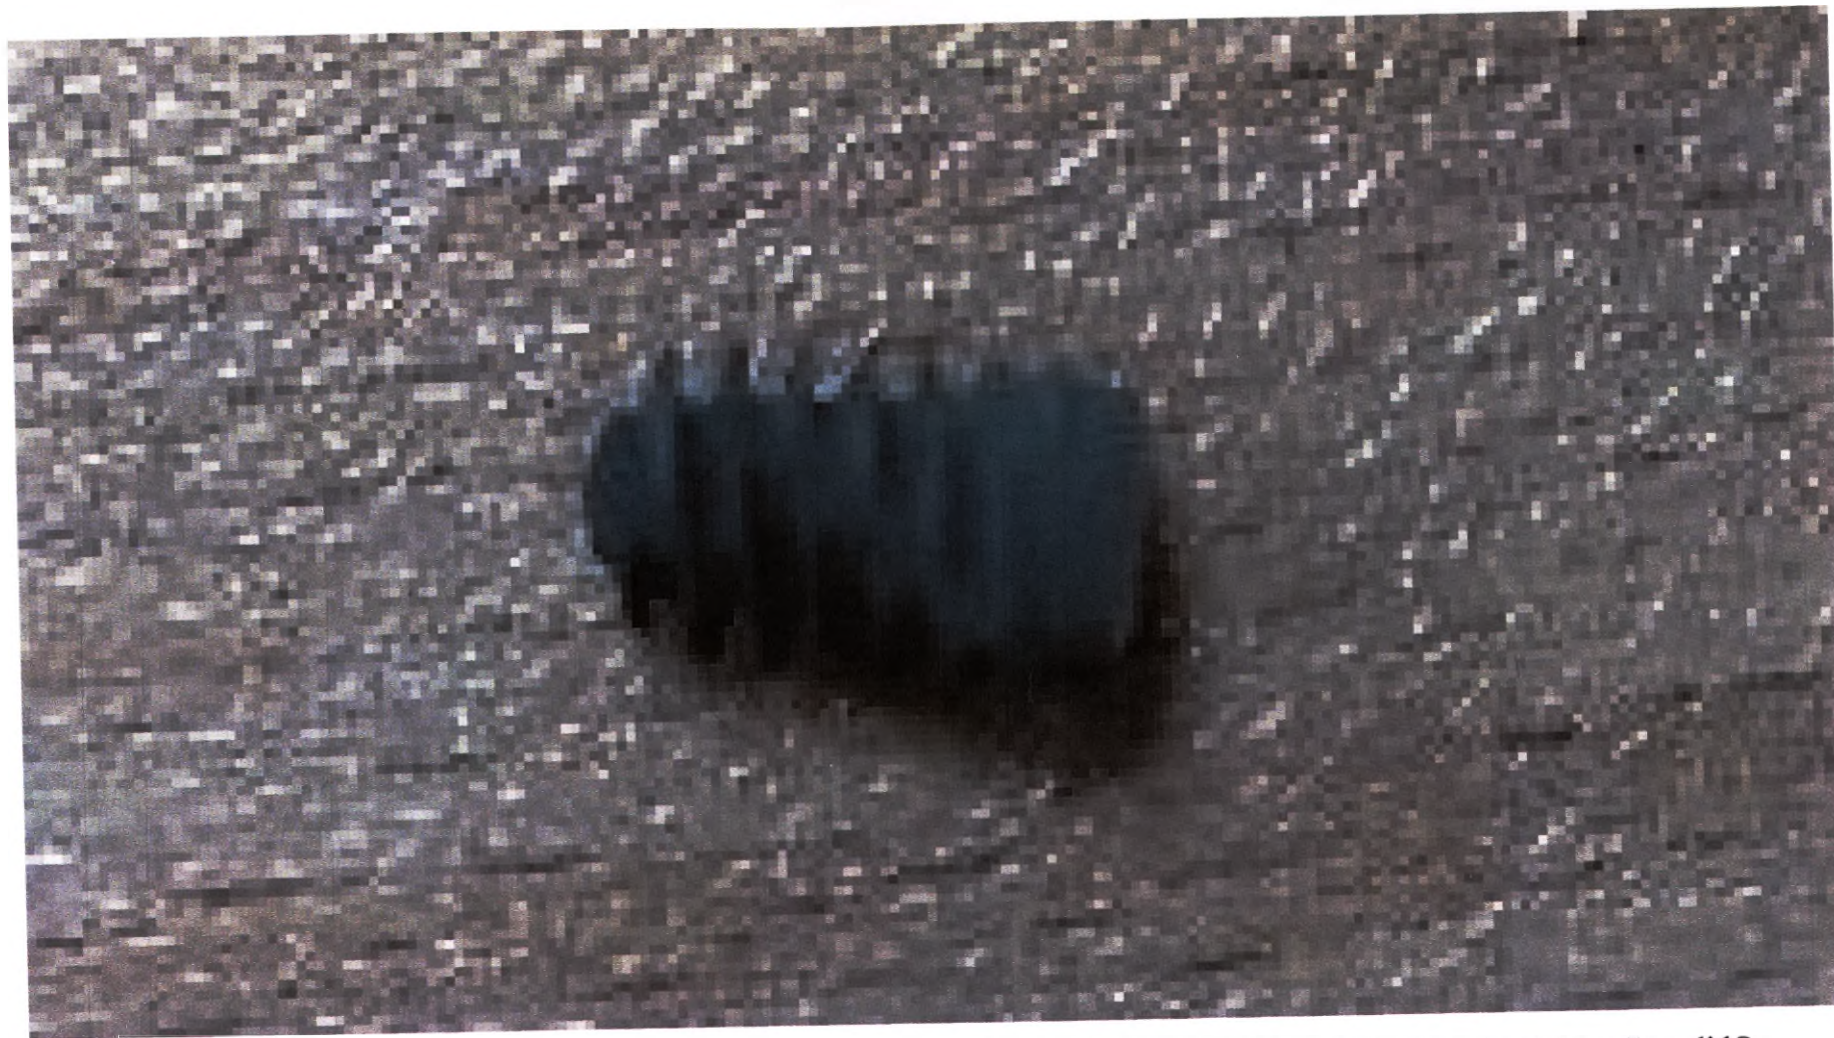


Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®

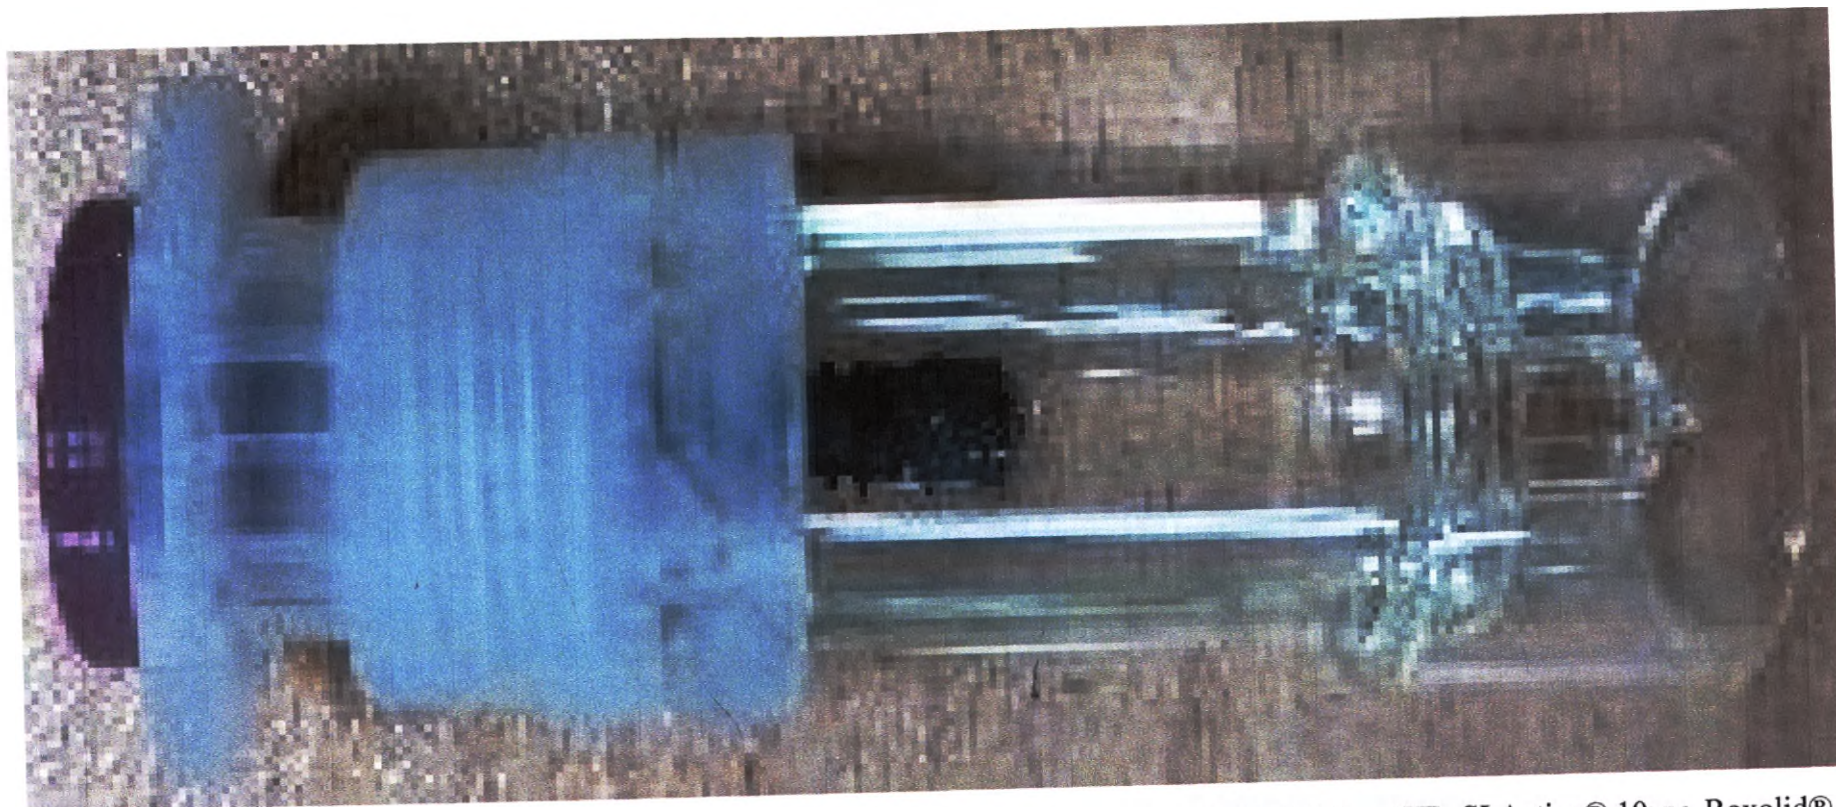


Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 10мм, Roxolid®




Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 12мм, Roxolid®

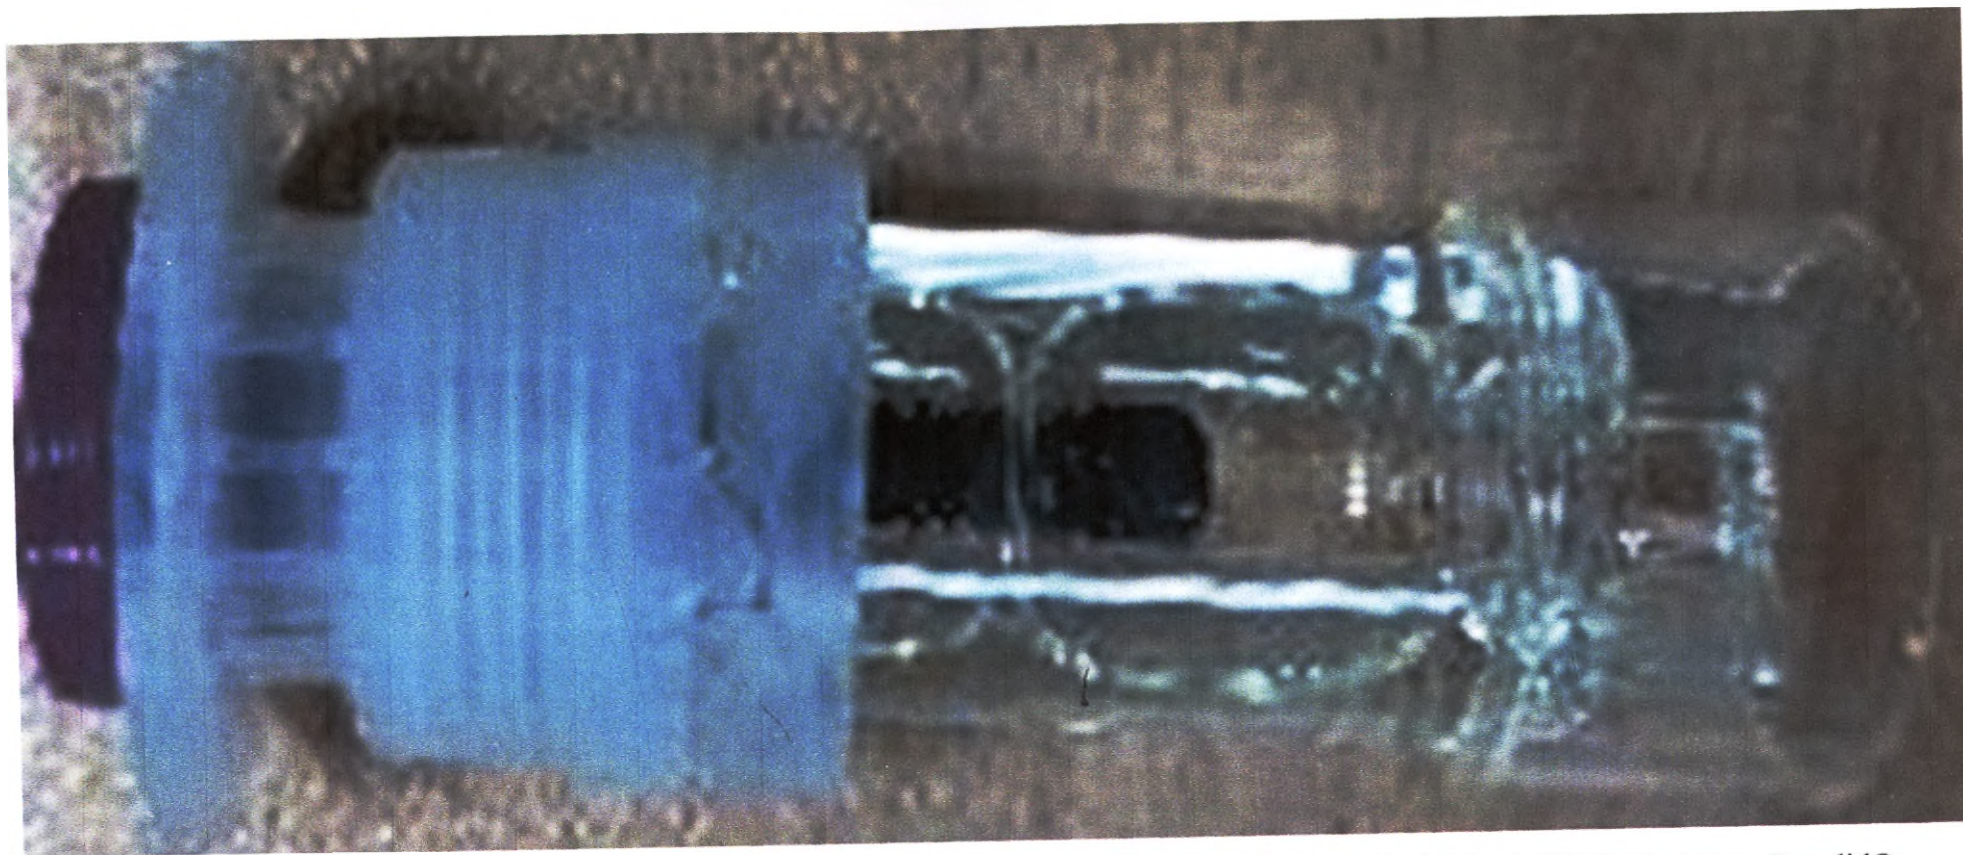


Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 14мм, Roxolid®

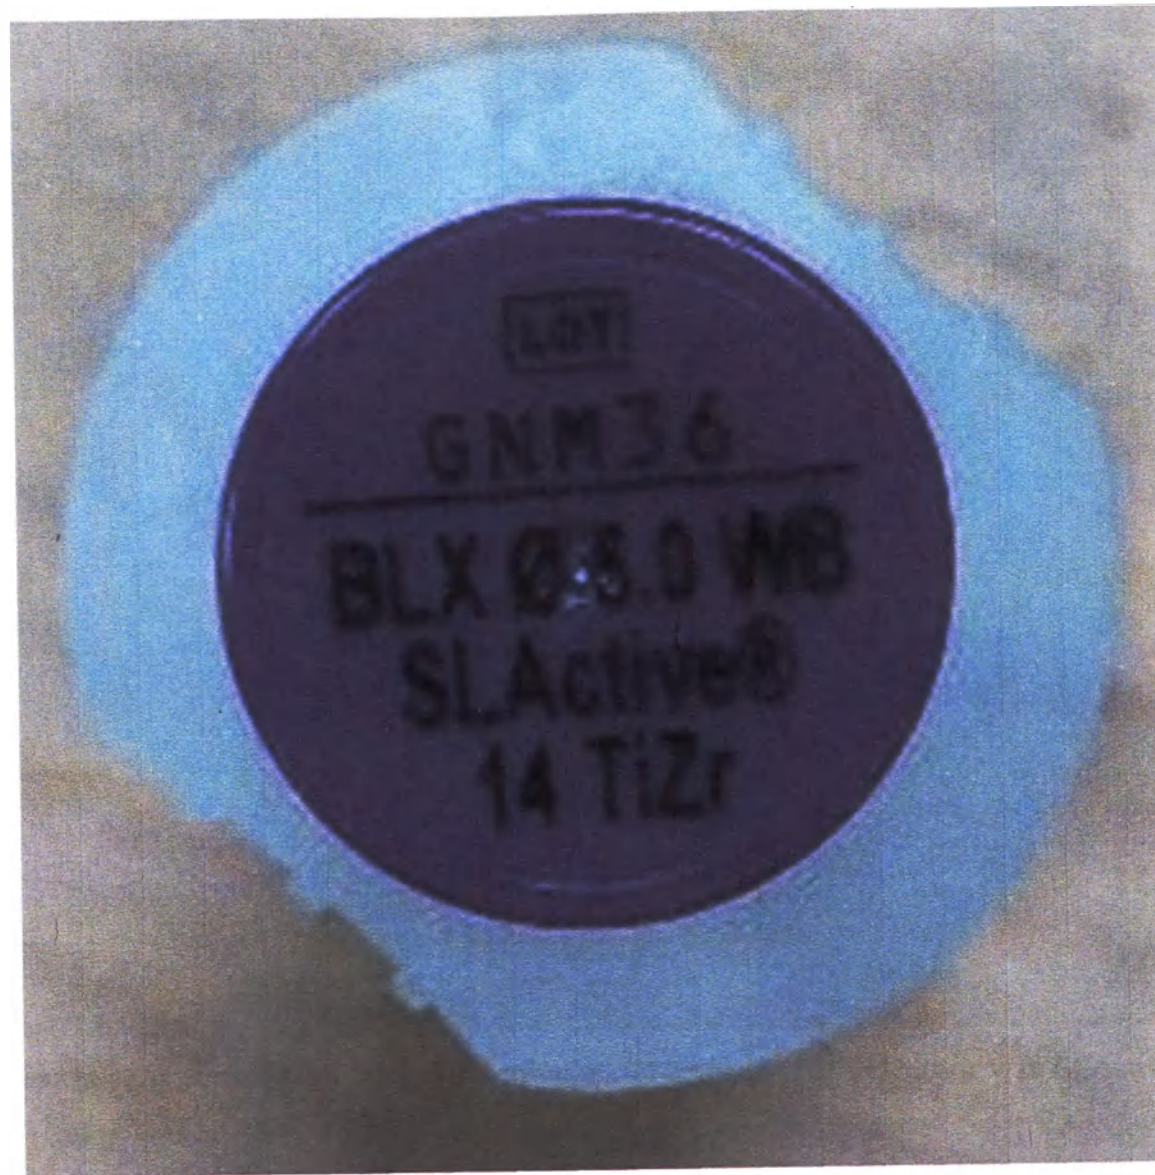

Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 14мм, Roxolid®

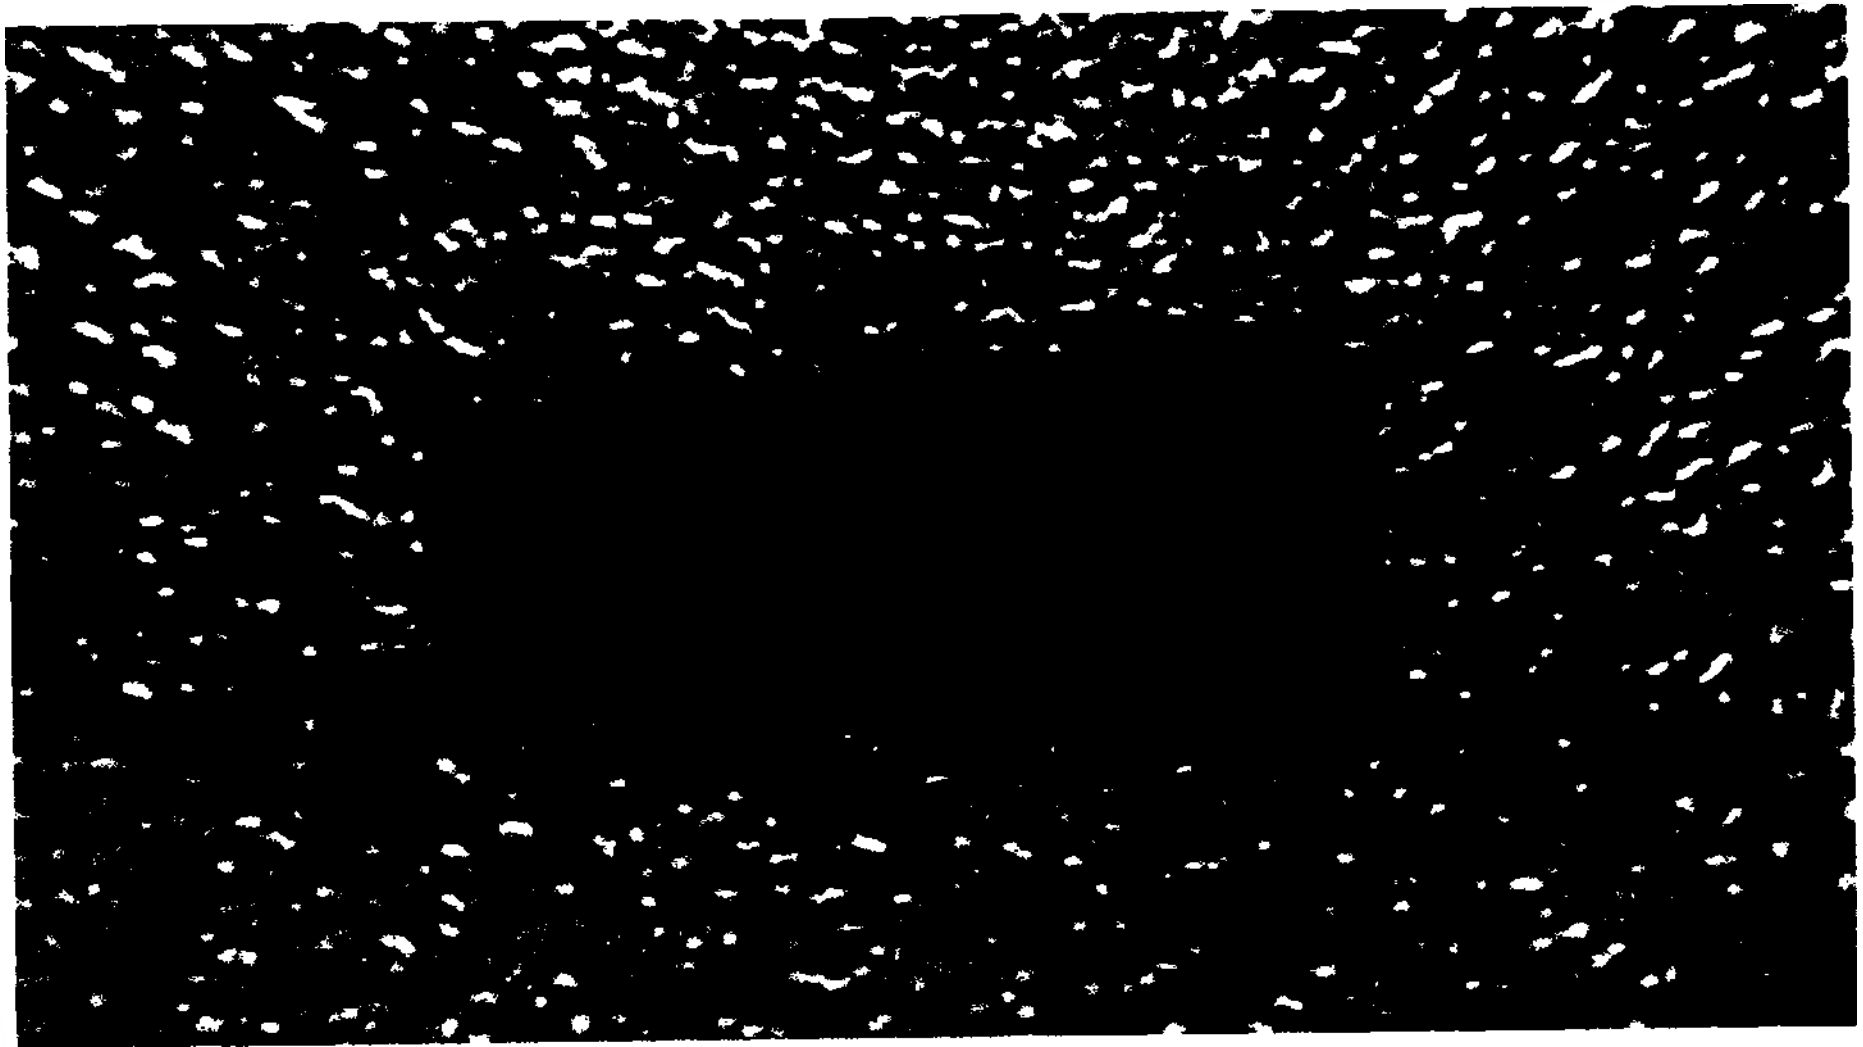

Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 14мм, Roxolid®

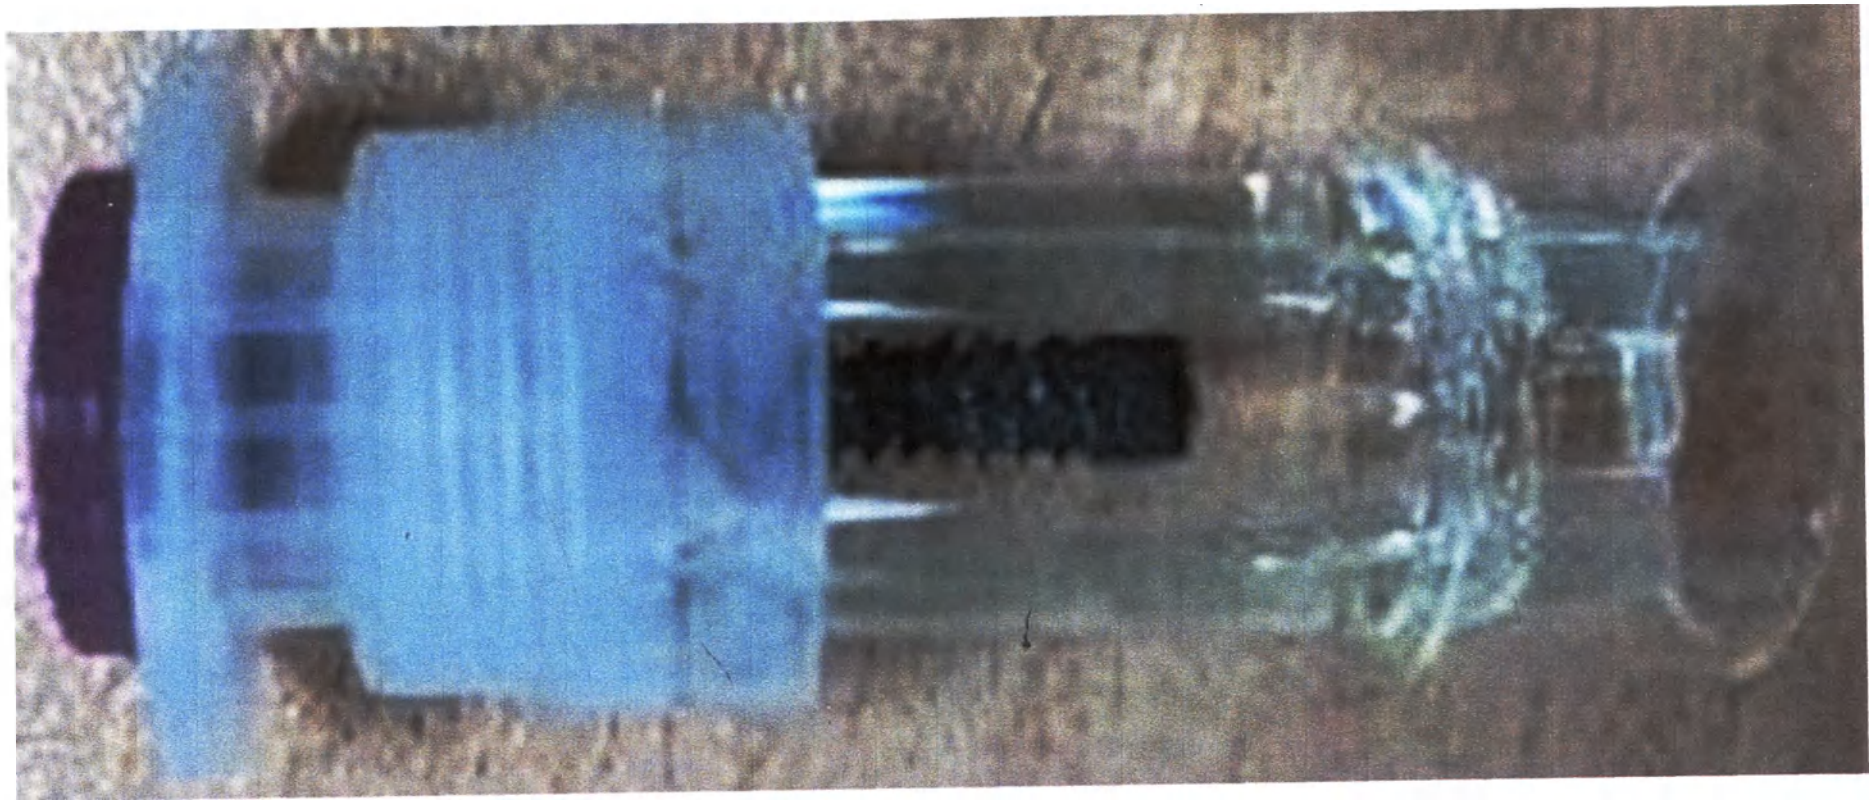


Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 16мм, Roxolid®




Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 16мм, Roxolid®




Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 16мм, Roxolid®

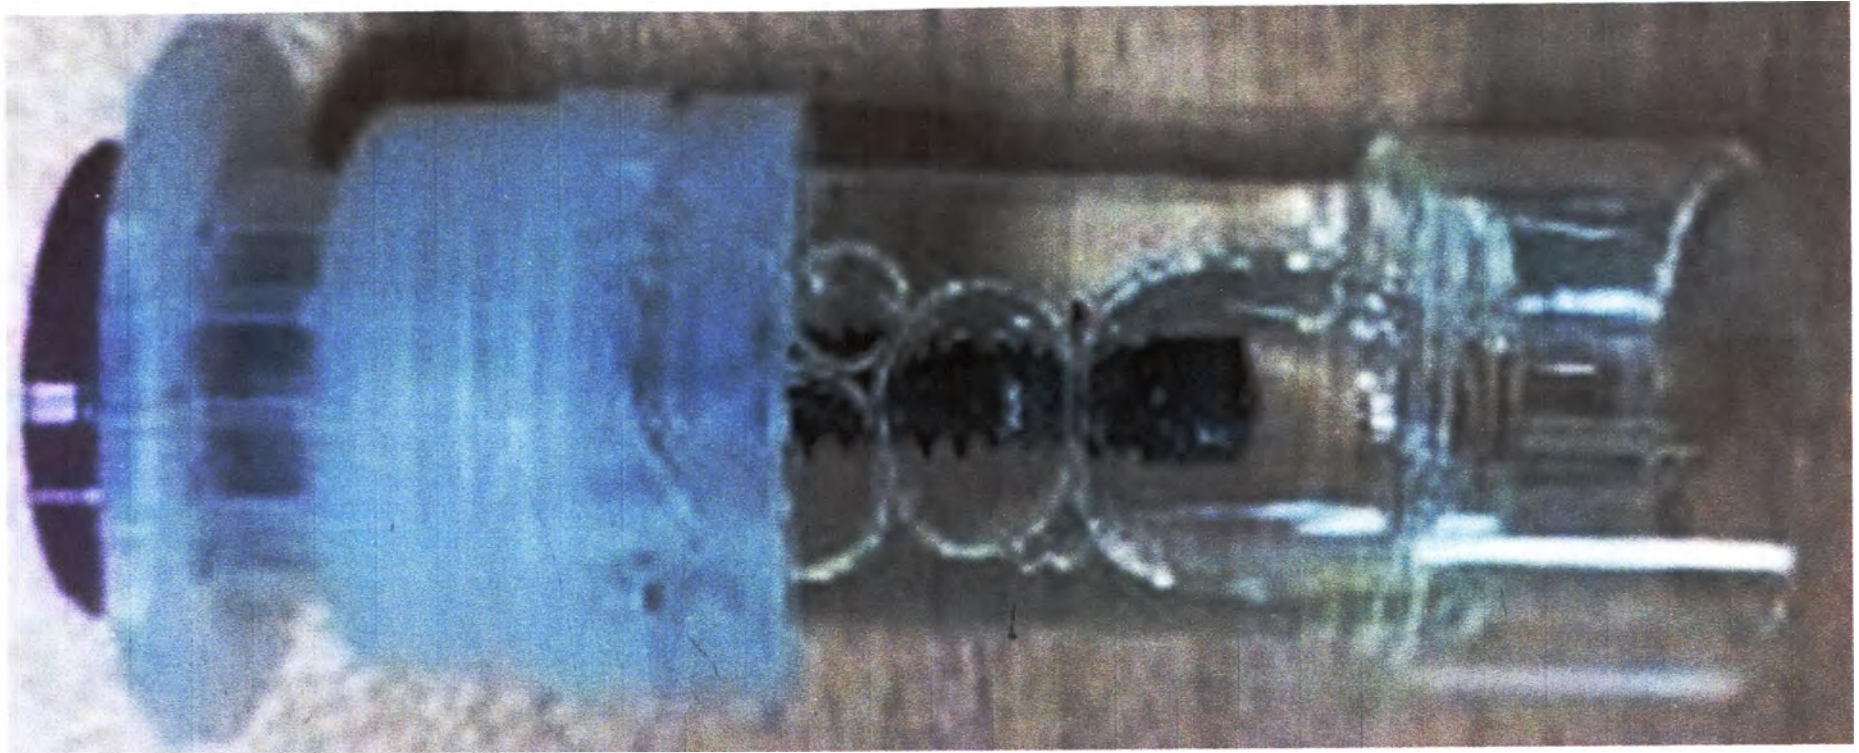

Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 18мм, Roxolid®

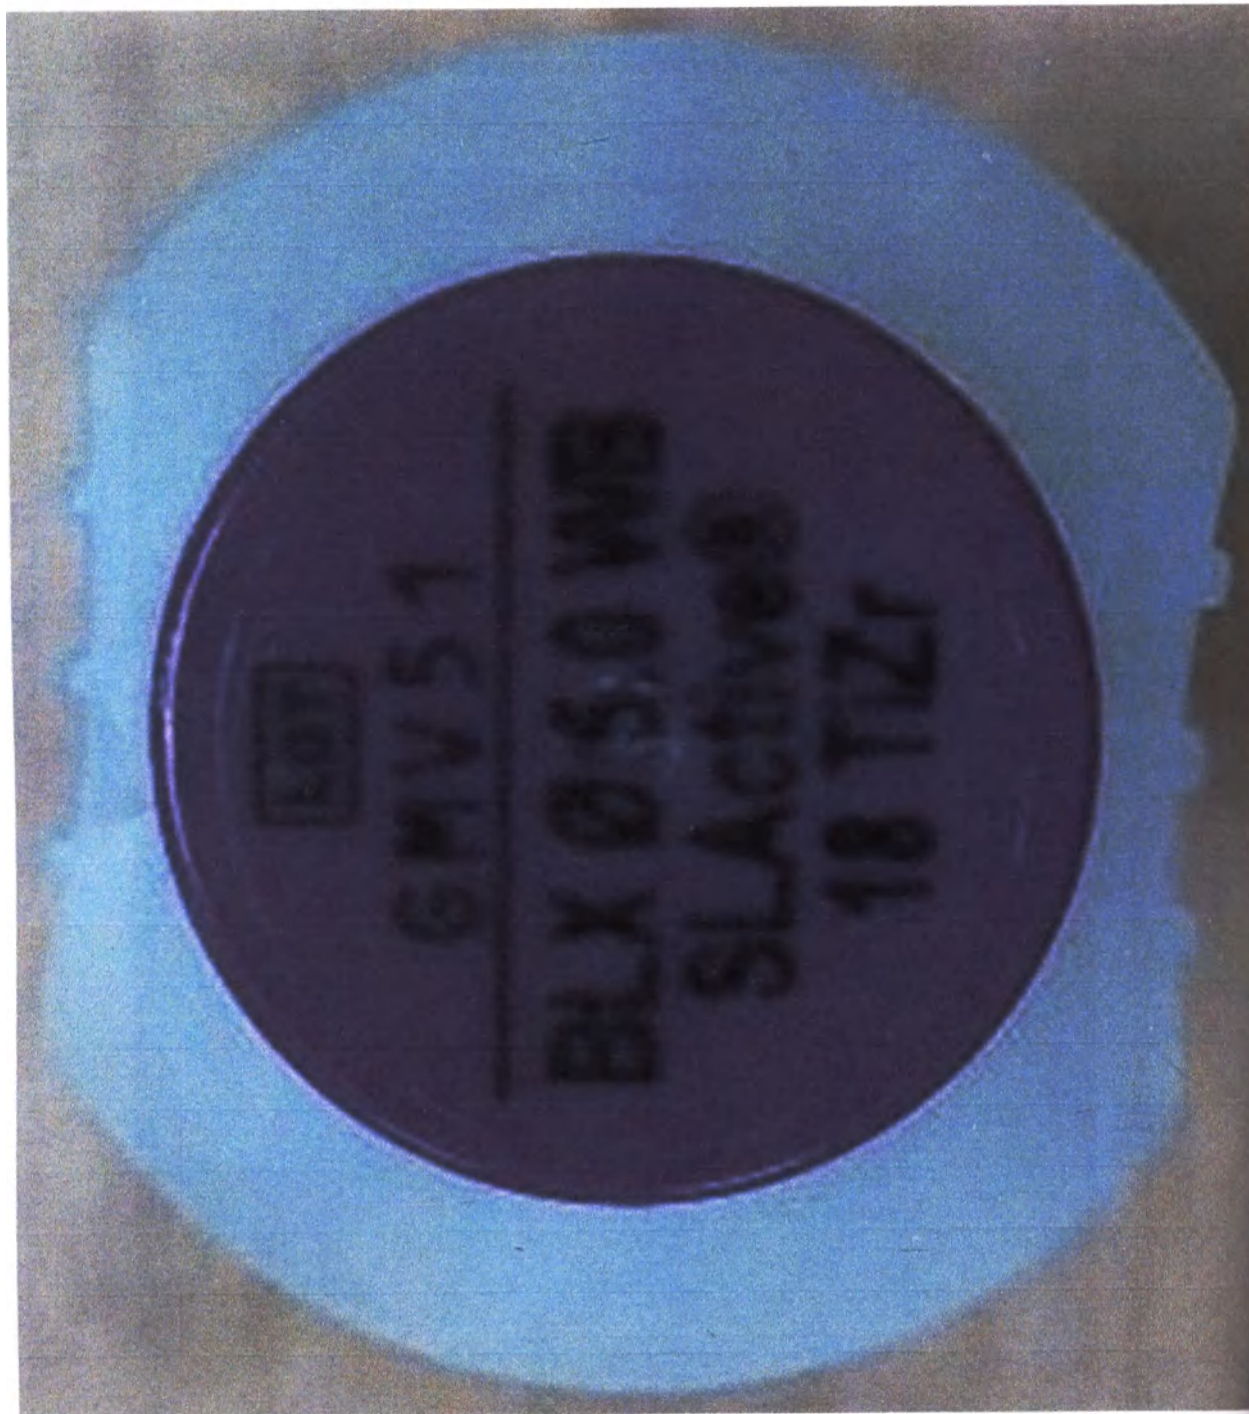




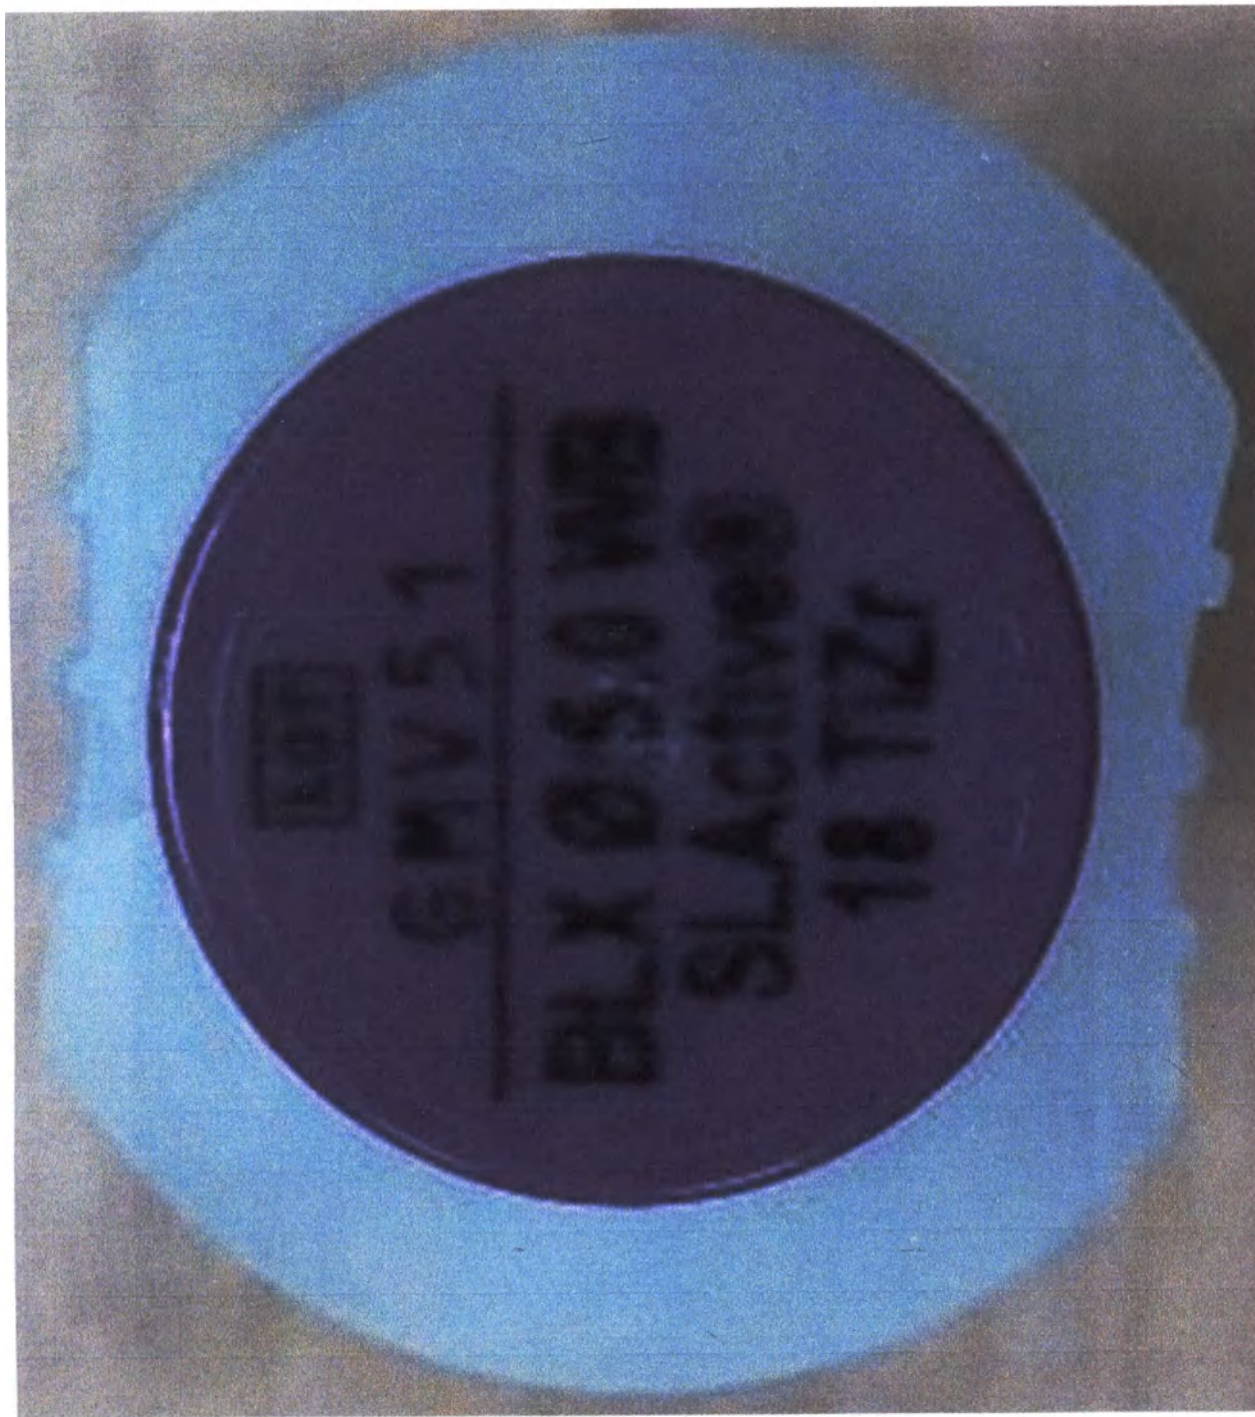

Этикетка заглушки капсулы имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 18мм, Roxolid®




Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 18мм, Roxolid®

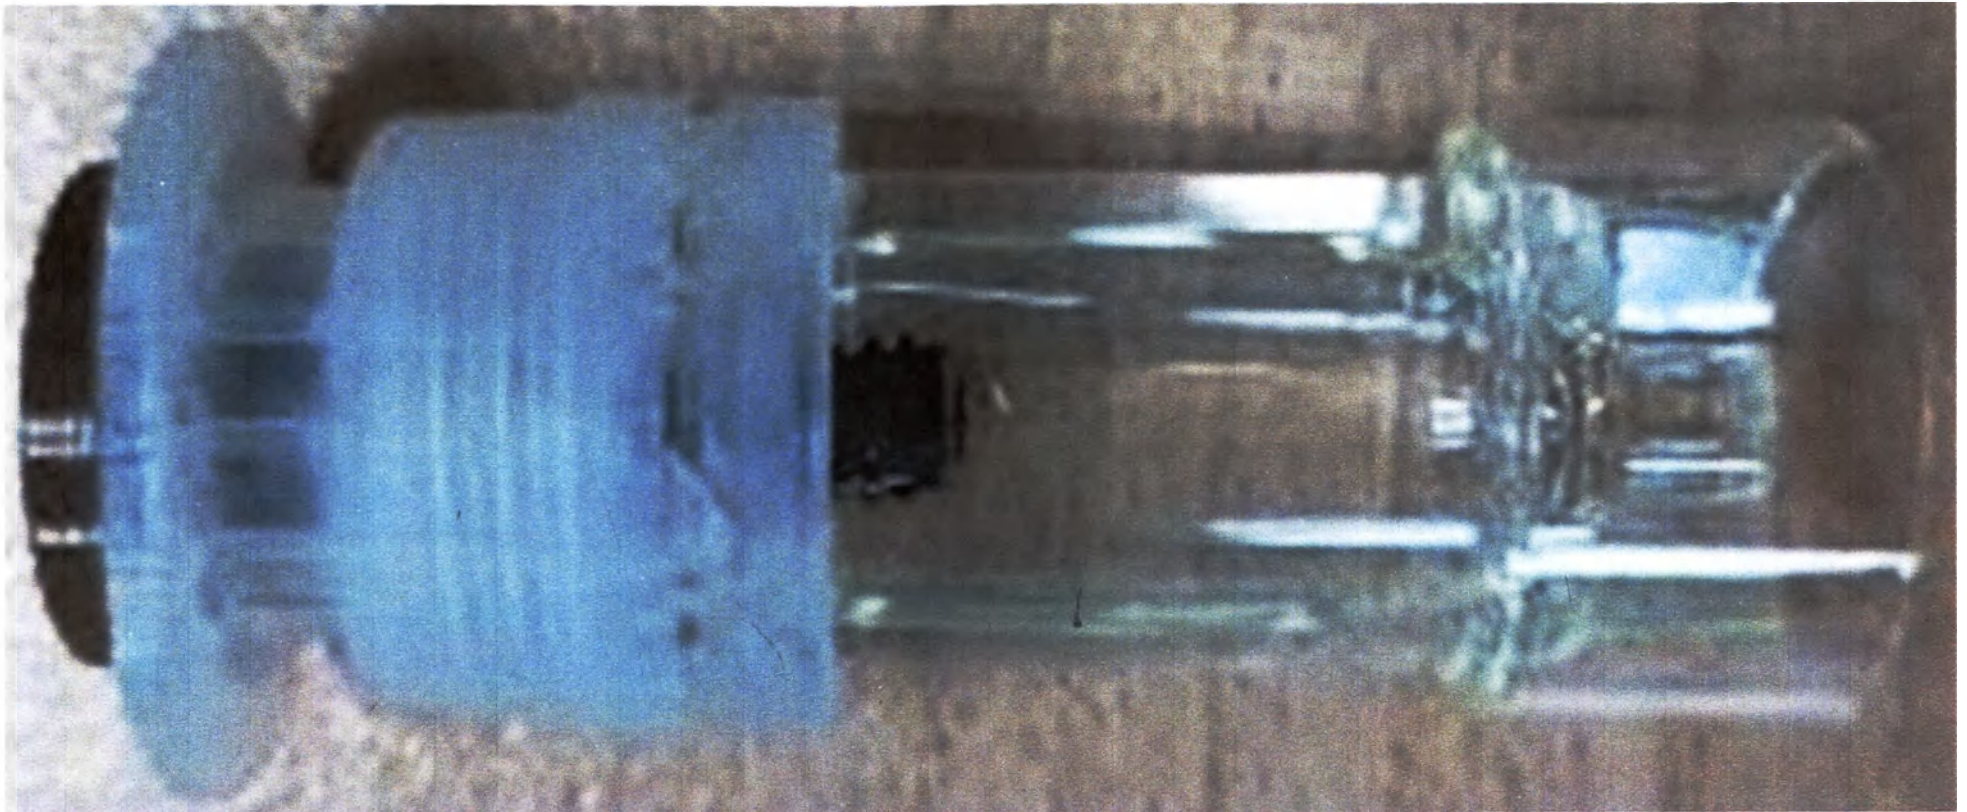


Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®




Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®

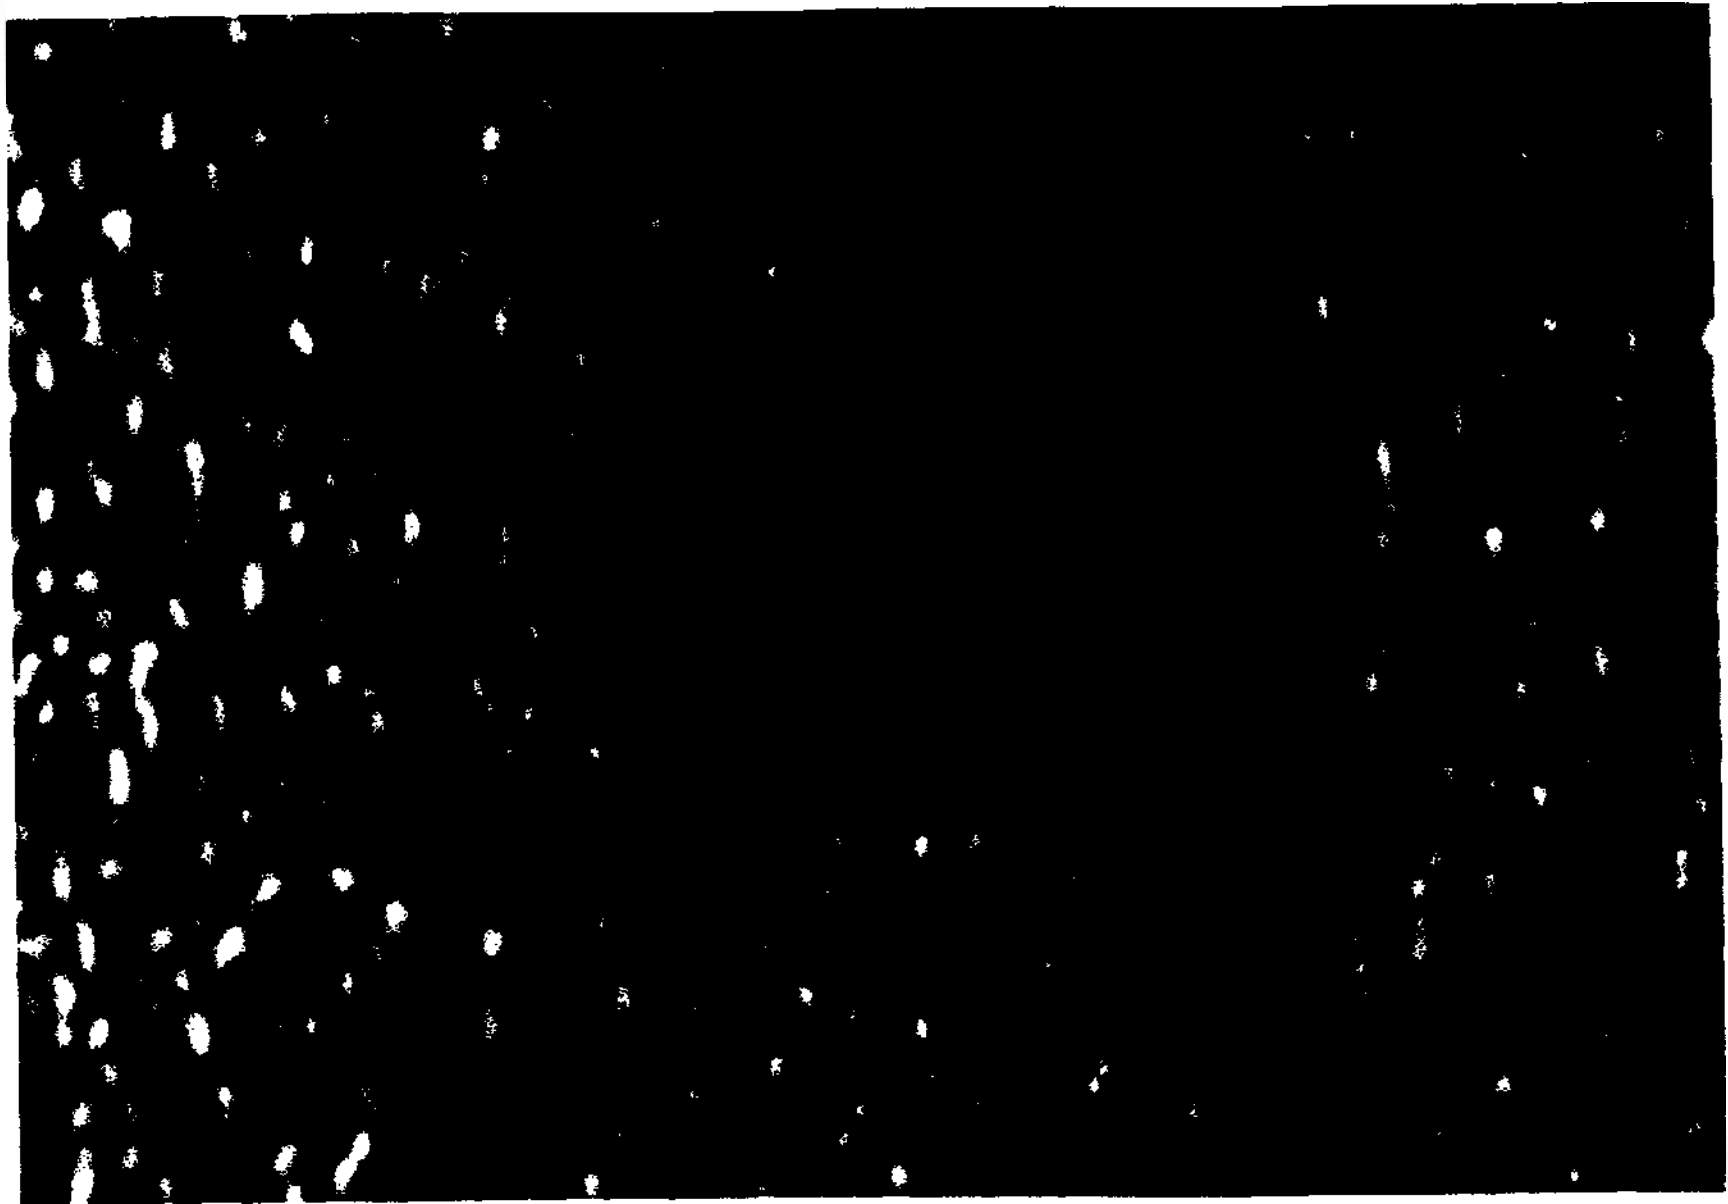

Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®

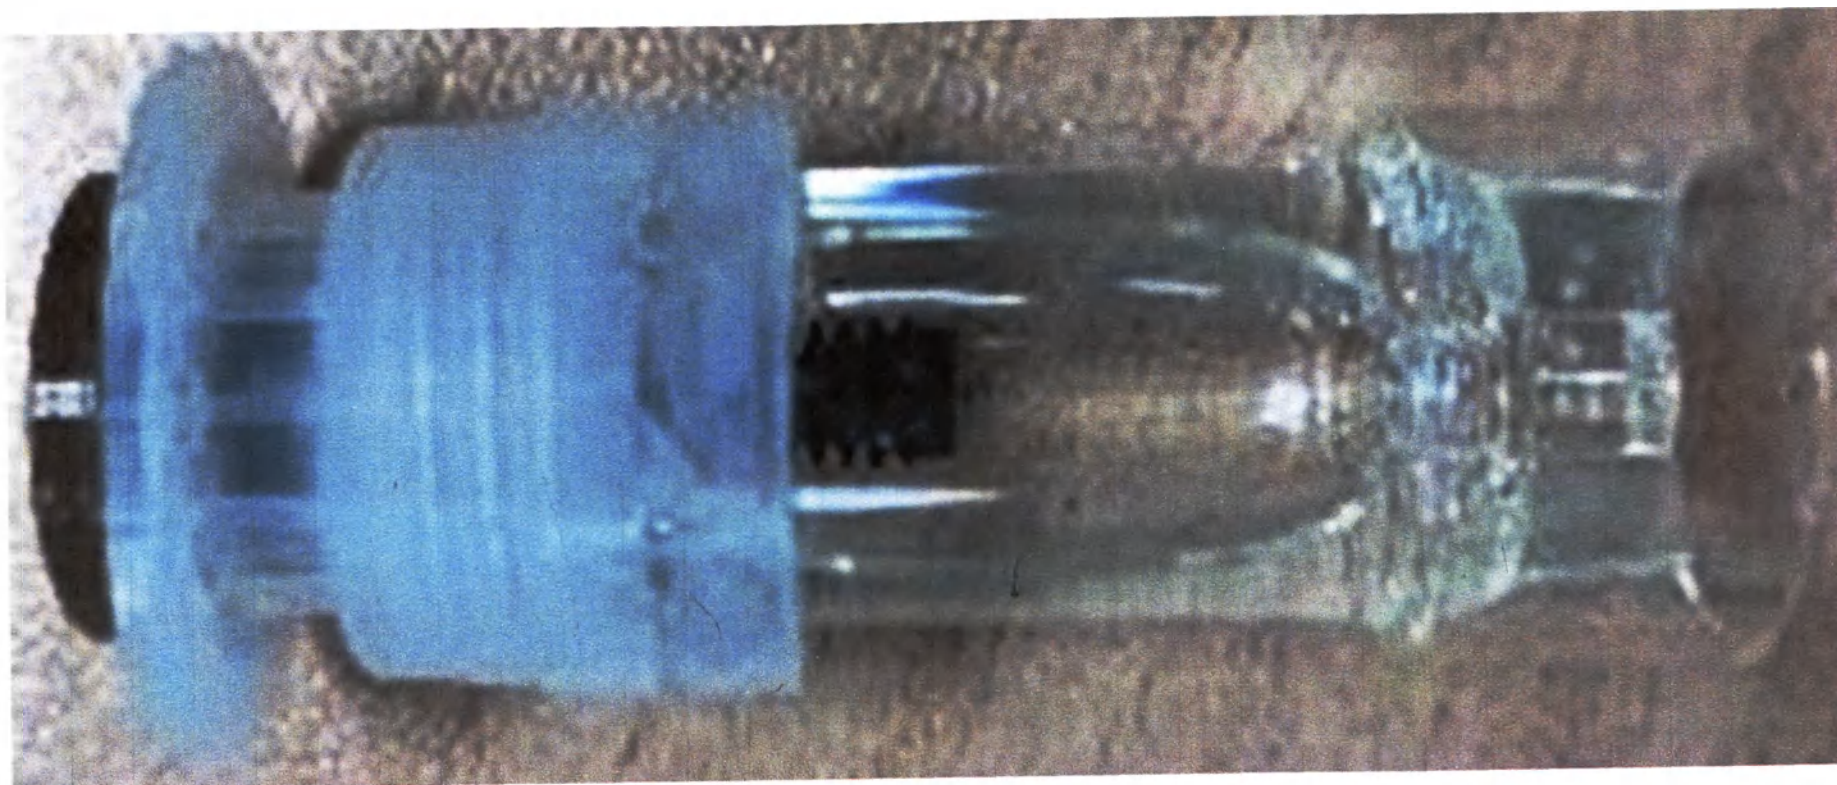

Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®

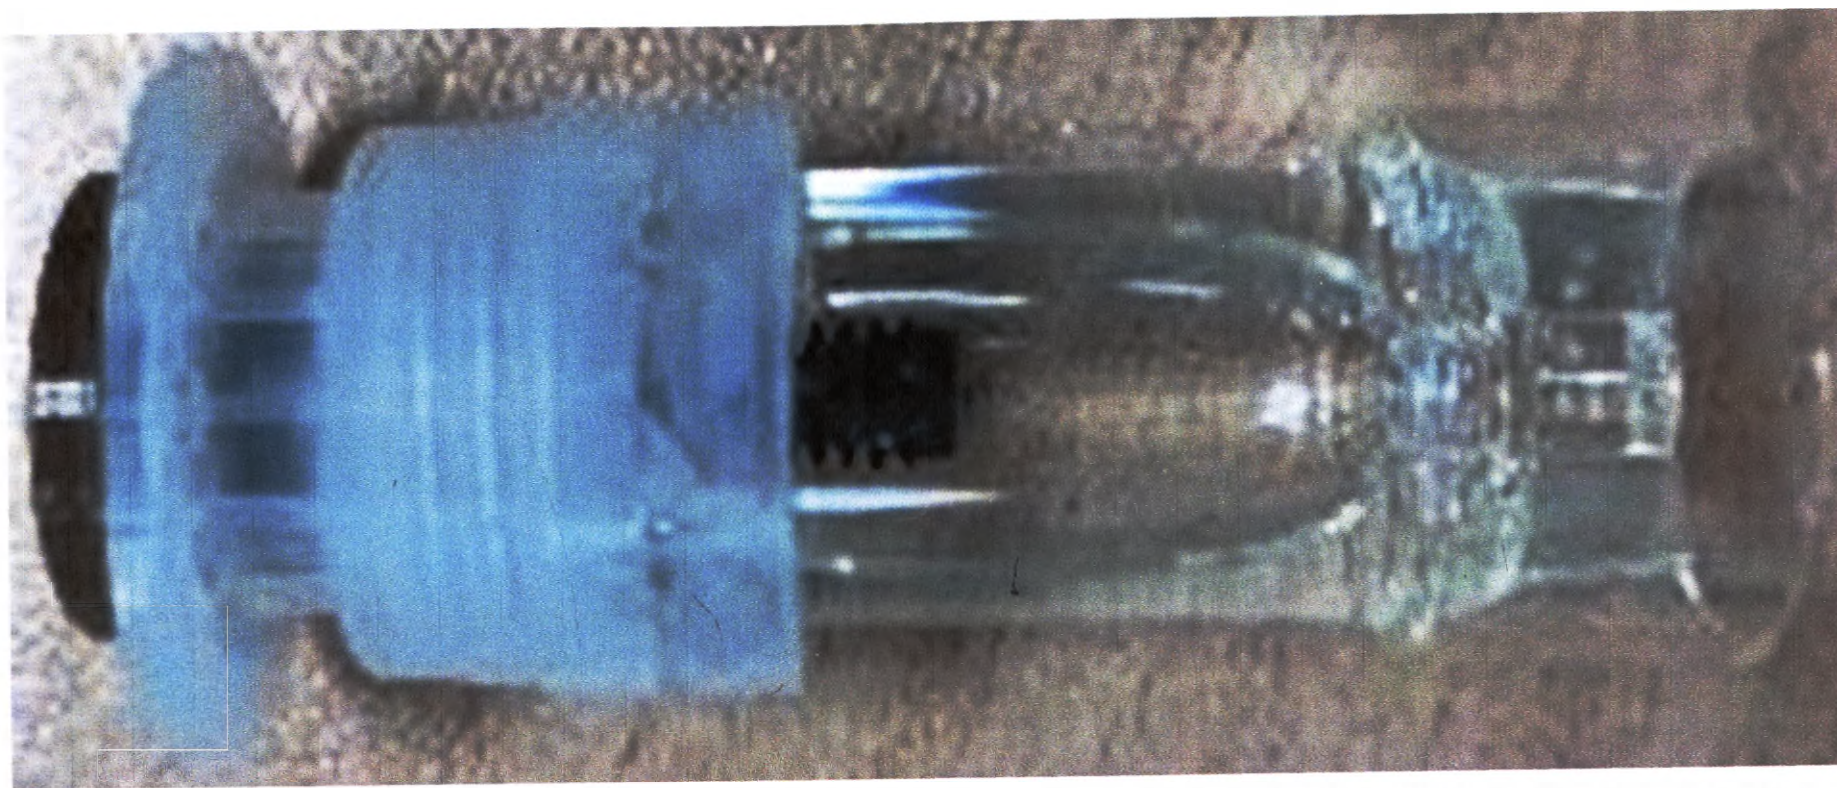


Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®

Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®



Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®

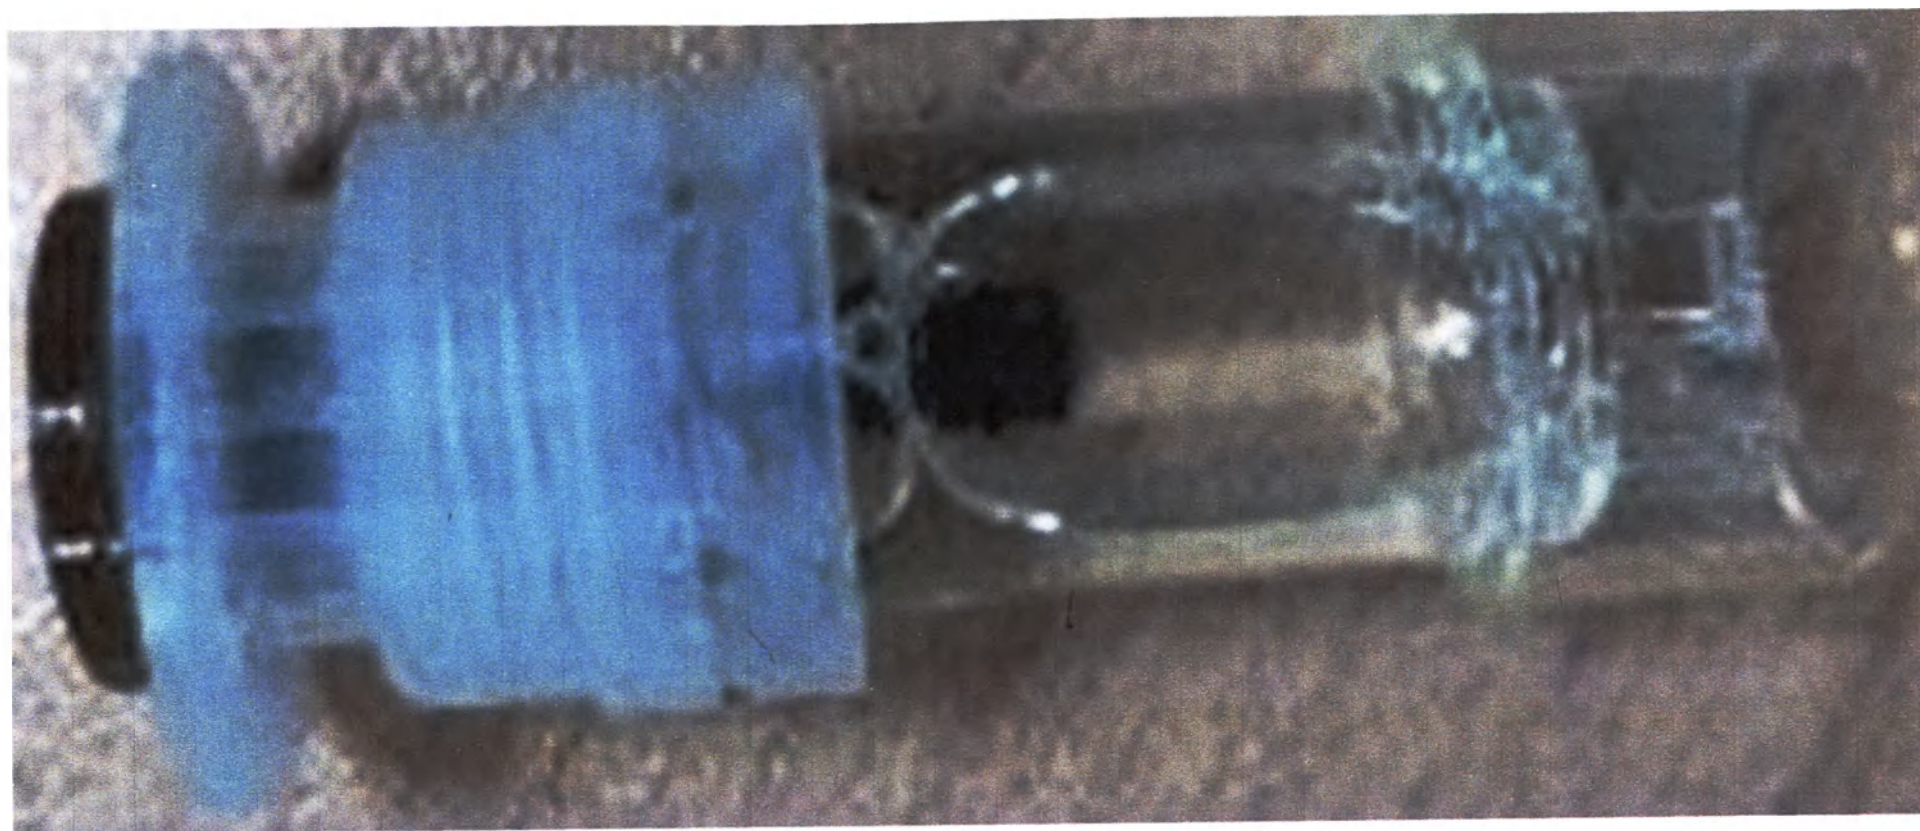


Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 10мм, Roxolid®



Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 10мм, Roxolid®



Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5mm WB, SLActive® 10mm, Roxolid®

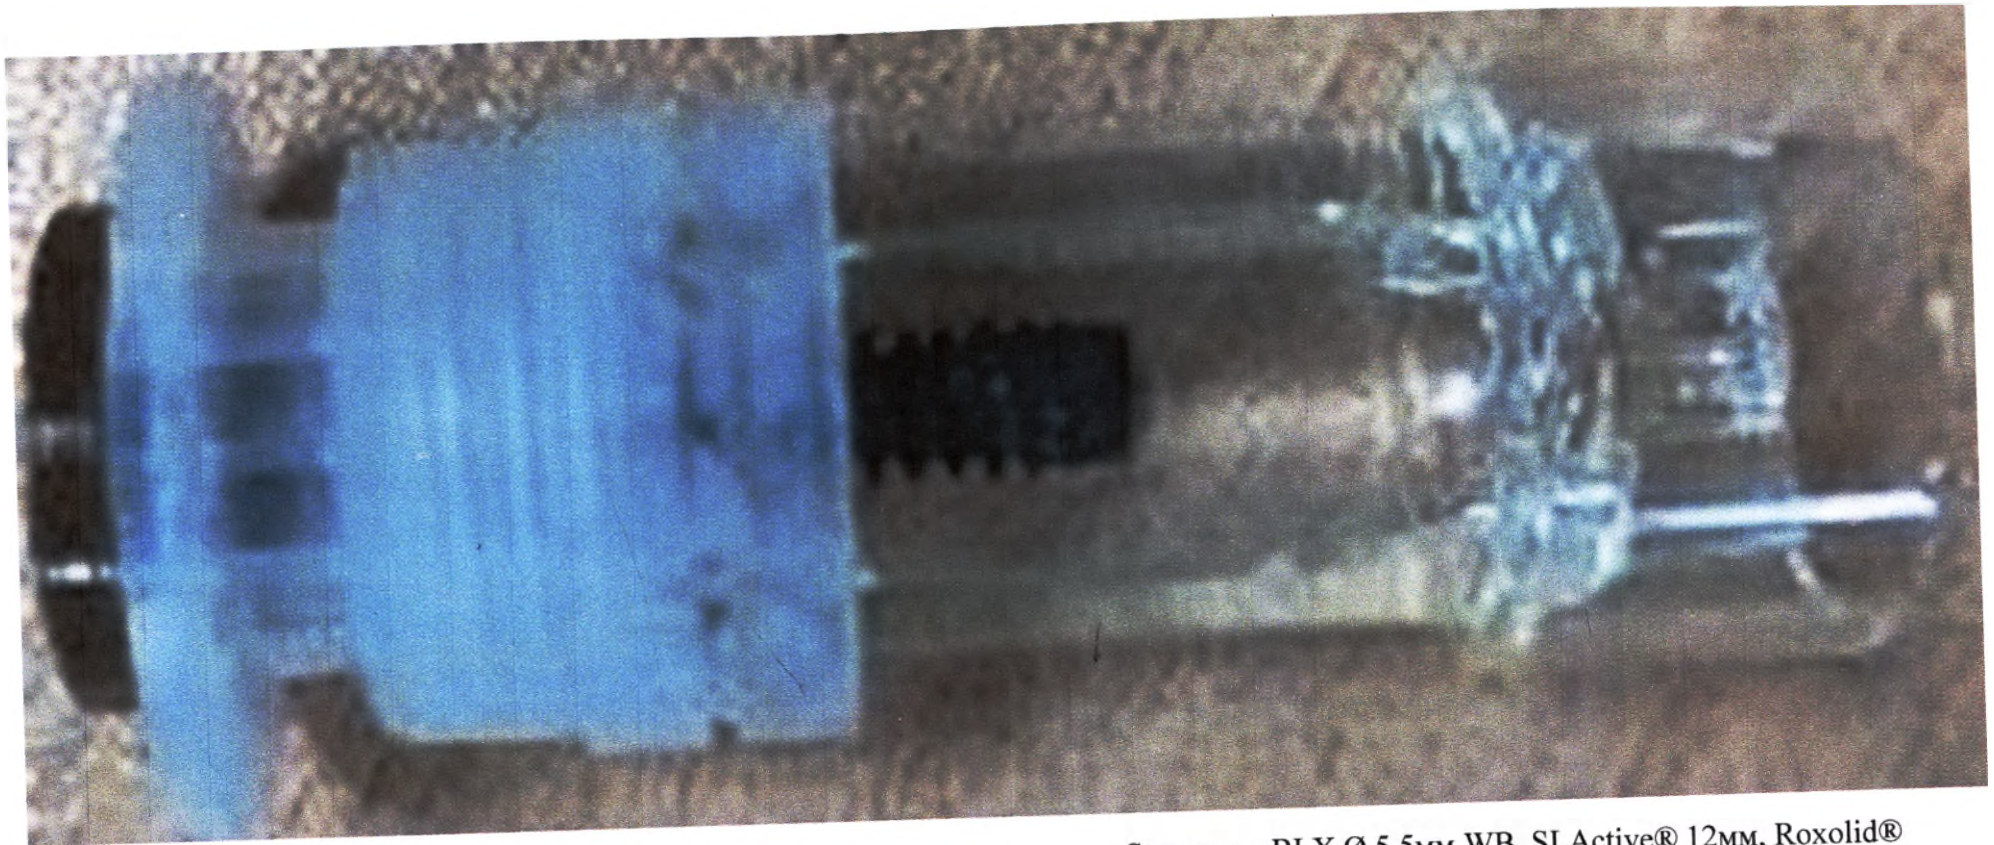


Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 12мм, Roxolid®



Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 12мм, Roxolid®



Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.5мм WB, SLActive® 12мм, Roxolid®

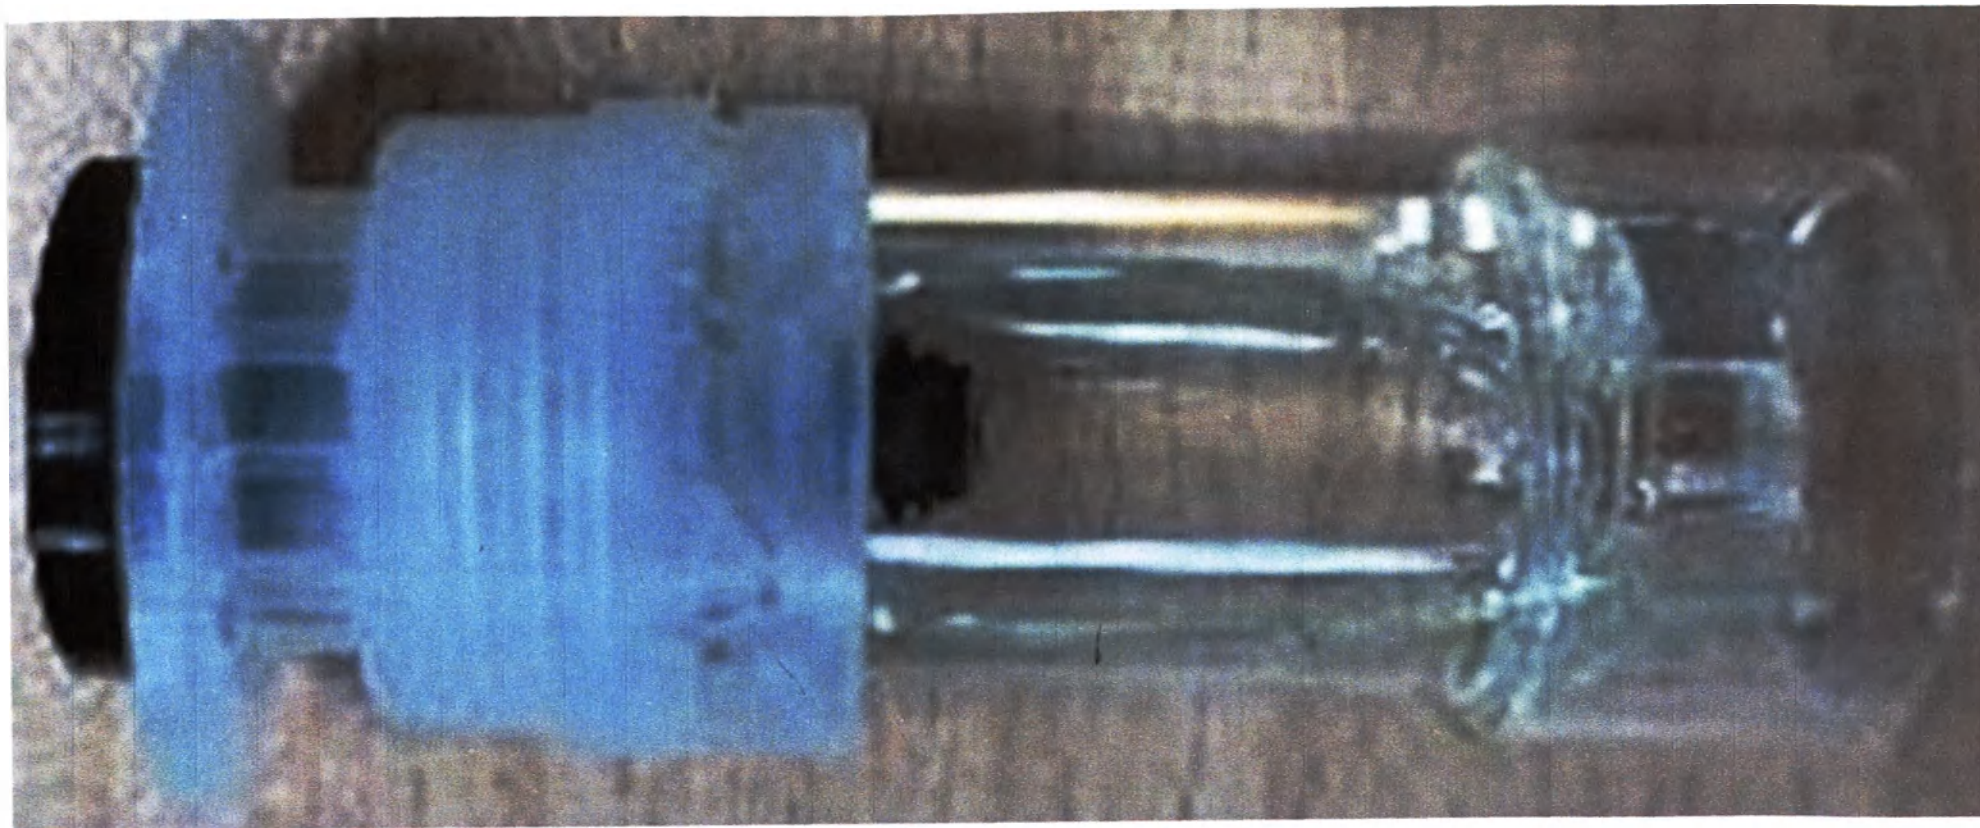


Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®



Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®



Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®

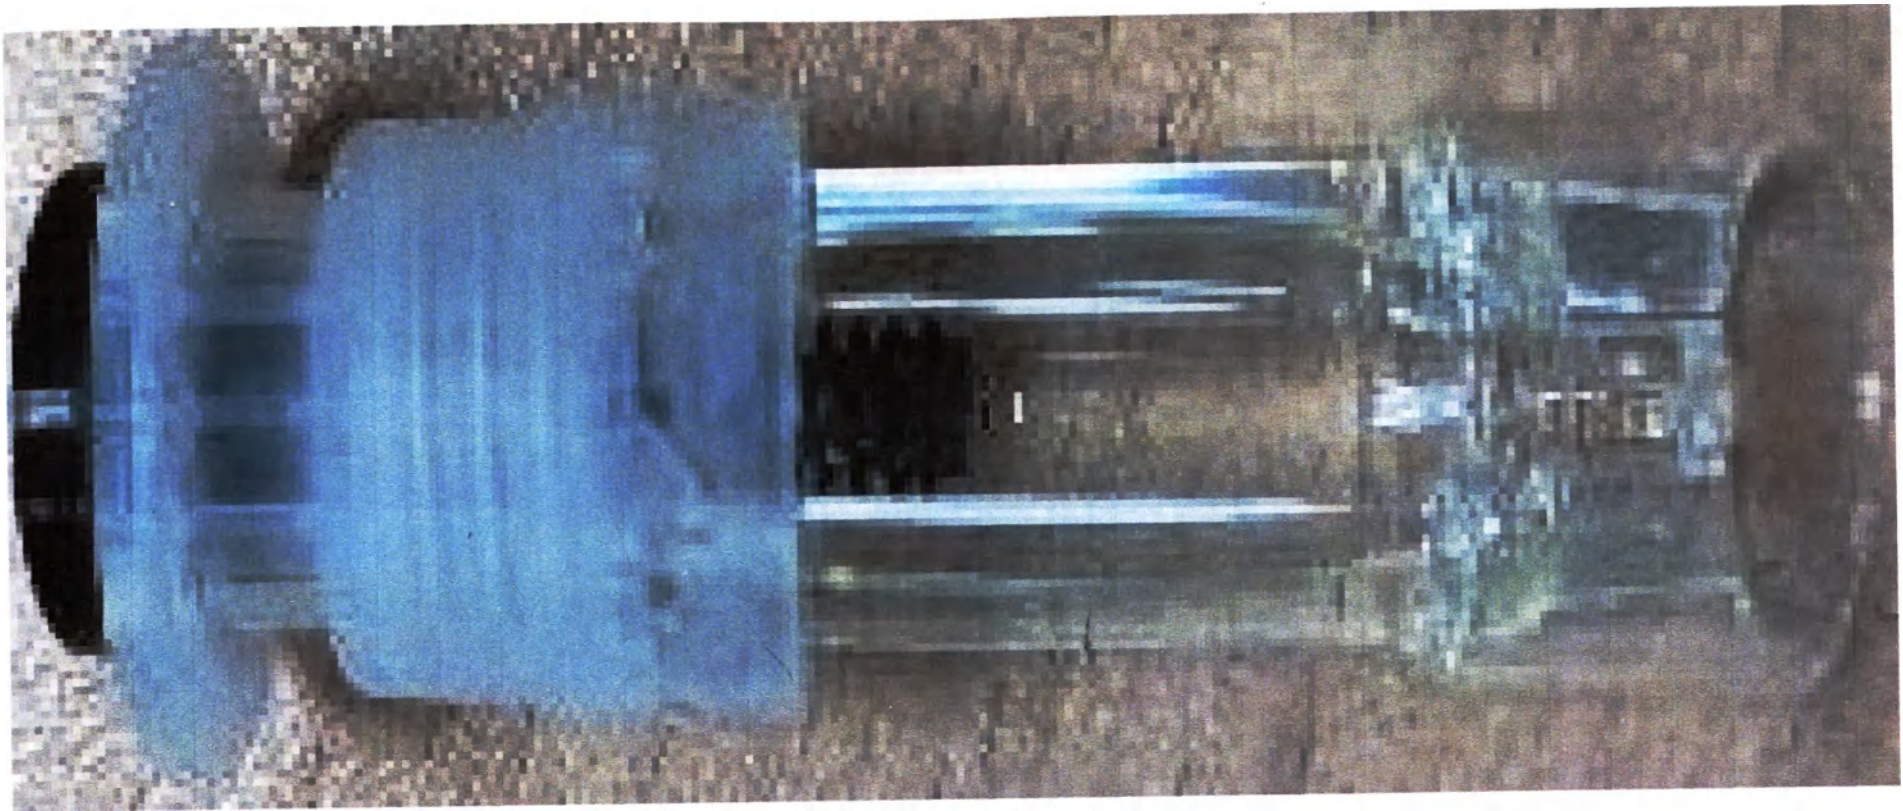


Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®



Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®



Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 8мм, Roxolid®

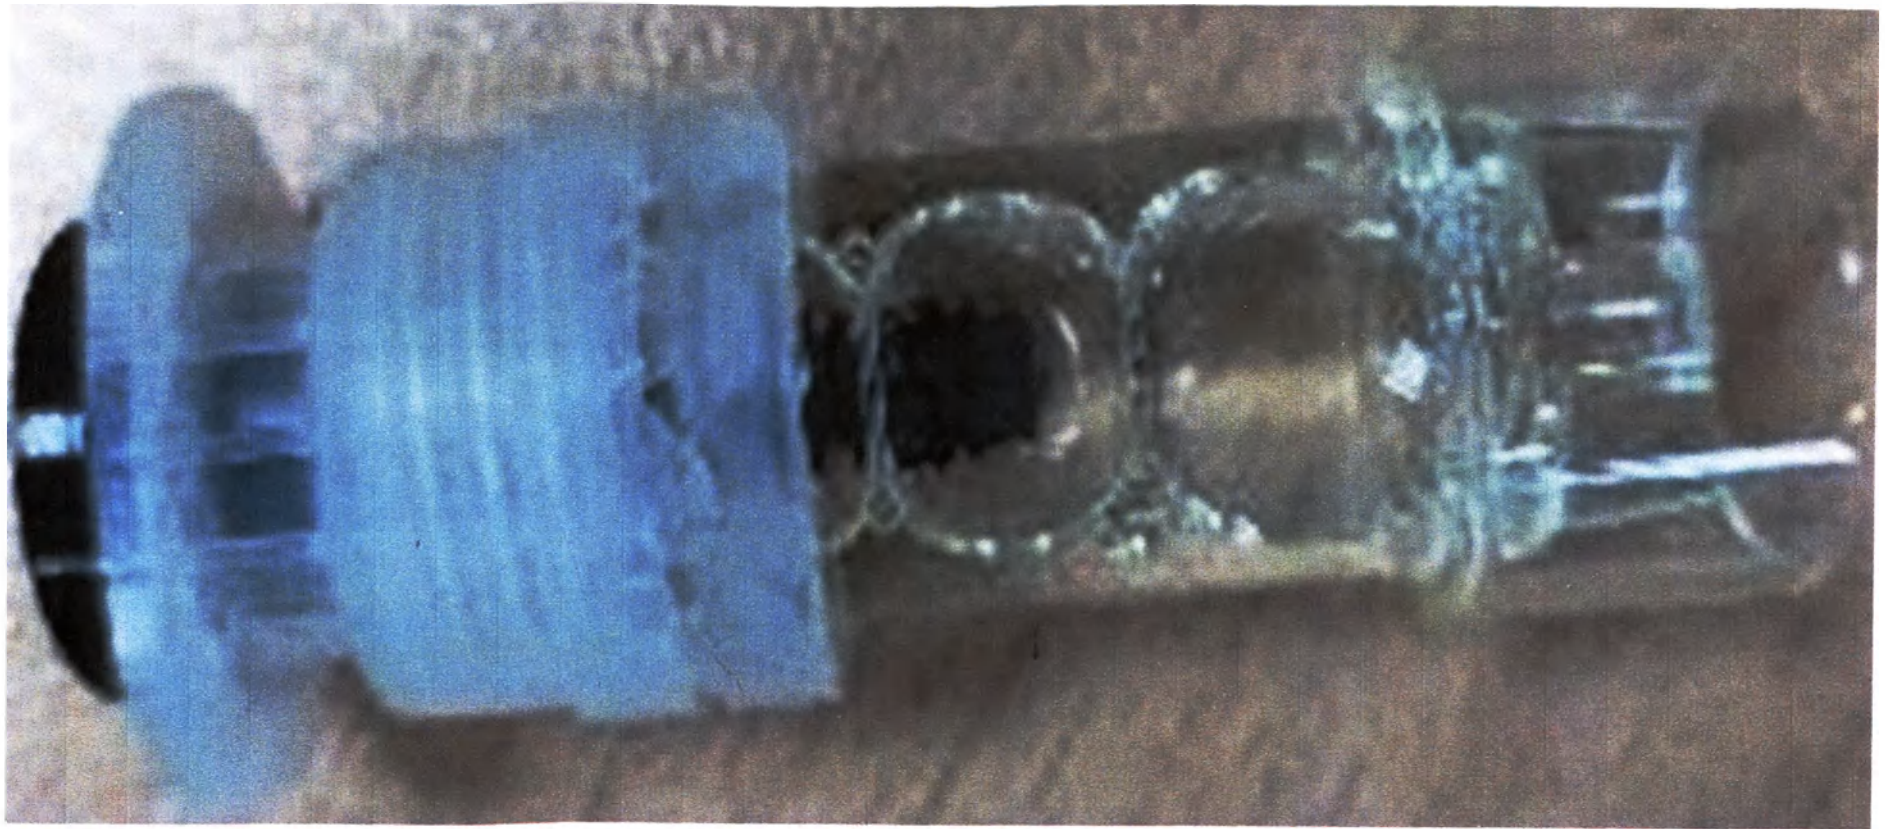


Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 10мм, Roxolid®



Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 10мм, Roxolid®



Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 10мм, Roxolid®

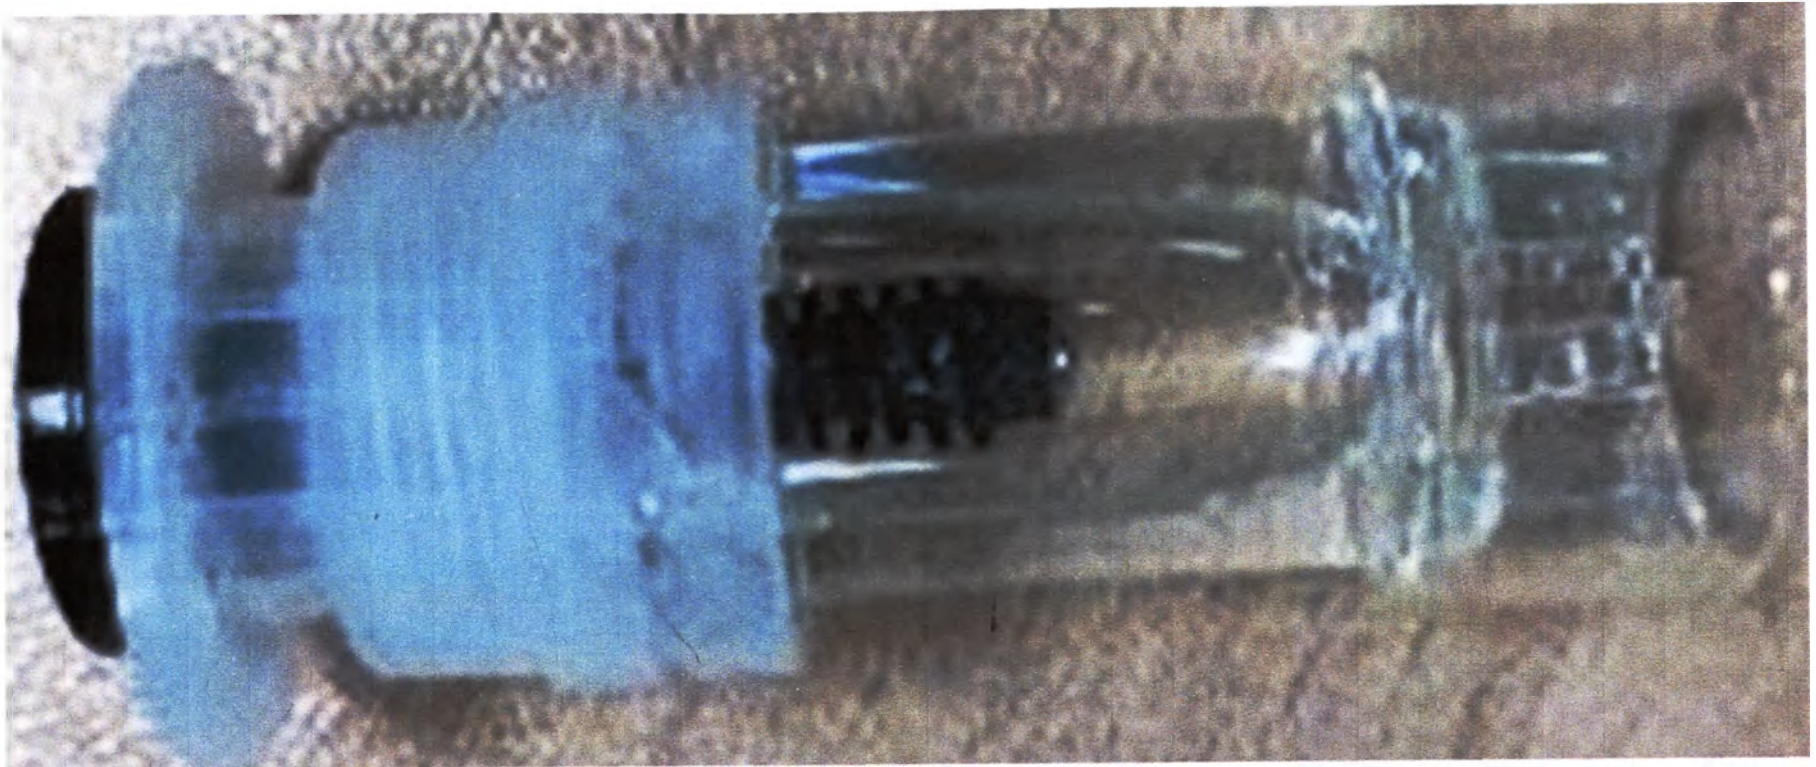

Внешний вид имплантата в капсуле, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 12мм, Roxolid®



Этикетка заглушки капсулы имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 12мм, Roxolid®



Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 12мм, Roxolid®




Внешний вид имплантата, на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 6.5мм WB, SLActive® 12мм, Roxolid®

straumanngroup

Защитная упаковка на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid® – вид со всех сторон:


Straumann®
Implant

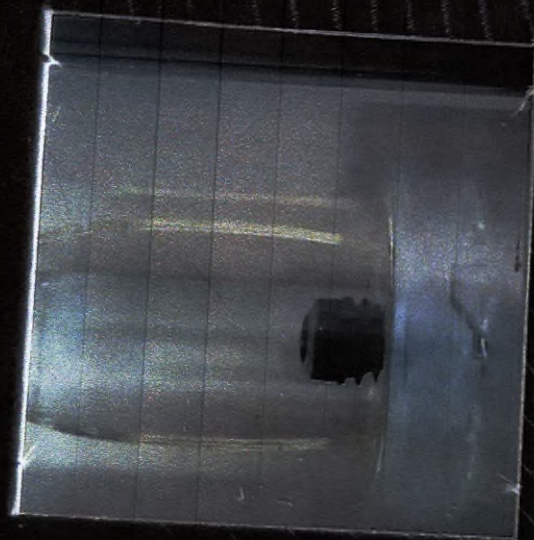

straumanngroup

Защитная упаковка на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid® – вид со всех сторон:


Straumann®
Implant

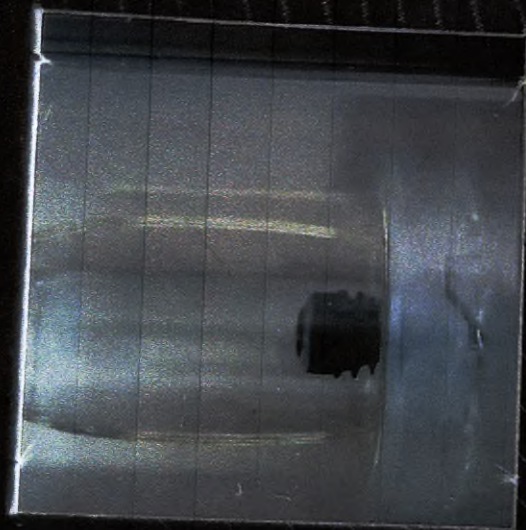

straumanngroup

Защитная упаковка на примере имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid® – вид со всех сторон:

Straumann®
Implant

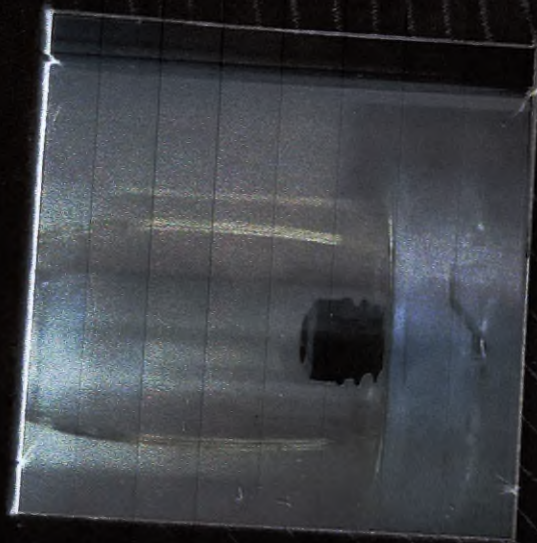

BLX Implant

Ø 5.0mm WB, SLActive® 6mm, Roxolid®

de Implantat
fr Implant
it Impianto
pt Implante
es Implante

Made in Switzerland
Pat: pat.straumann.com



Elkon GmbH | Leihamer Schlag 6 | DE-82166 Grafing | Germany



REF

061.7306

LOT

GKJ30



2026-07-13



2021-07-14

(01)07630031743718
(11)210714
(17)260713
(10)GKJ30



970.219

Защитная упаковка на примере упаковки имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0mm WB, SLActive® 6mm, Roxolid®



Защитная упаковка на примере упаковки имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®



Защитная упаковка на примере упаковки имплантата дентального Straumann BLX Ø 5.0мм WB, SLActive® 6мм, Roxolid®

 «Институт Штрауманн АГ», Швейцария, Institut Straumann AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Switzerland							
Имплантат дентальный Straumann BLX Ø4.5 мм RB, SLActive® 6мм, Roxolid®							
РУ № РЗН 2020/11651 от _____.____.____ г.	<table border="1"> <tr> <td>REF</td> <td>XXX.XXXX</td> </tr> <tr> <td>LOT</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>ГГГГ-ММ-ДД</td> </tr> </table>	REF	XXX.XXXX	LOT	XXXXX		ГГГГ-ММ-ДД
REF	XXX.XXXX						
LOT	XXXXX						
	ГГГГ-ММ-ДД						
Нетоксично. Апиrogenно. Уполномоченный представитель: ООО «Штрауманн» 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 119А Сделано в Швейцарии							
							

Макет маркировки на русском языке на примере макета для Имплантата дентальный Straumann BLX Ø 4.5мм RB, SLActive® 6мм, Roxolid®

Прошнуровано _____ листа/ов

Специалист по регистрации

ООО «Штрауманн»

Limited Liability Company

Москва * М.А. Гребенкина